

**ПОДТВЕРЖДАЮ**

**Финансовый директор**

ООО «биоМерье Рус»

Е.А. Илуридзе



**Фотографические изображения медицинского изделия для  
диагностики in vitro**


**«Набор реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)»  
для количественного определения общего 25-  
гидроксивитамина D в сыворотке или плазме крови  
человека методом иммуноферментного  
флуоресцентного анализа на анализаторах  
иммунологических семейства VIDAS,  
производства «биоМерье С.А.» (bioMérieux S.A.), Франция**




Общий вид набора реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)» для количественного определения общего 25-гидрокситамина D в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS



Стрипы VITD (STR)

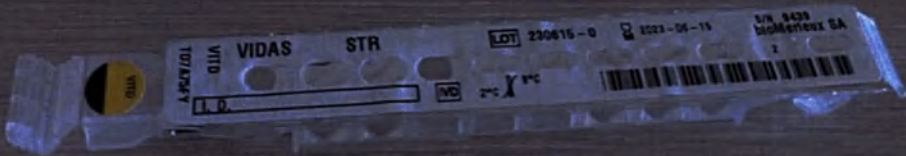

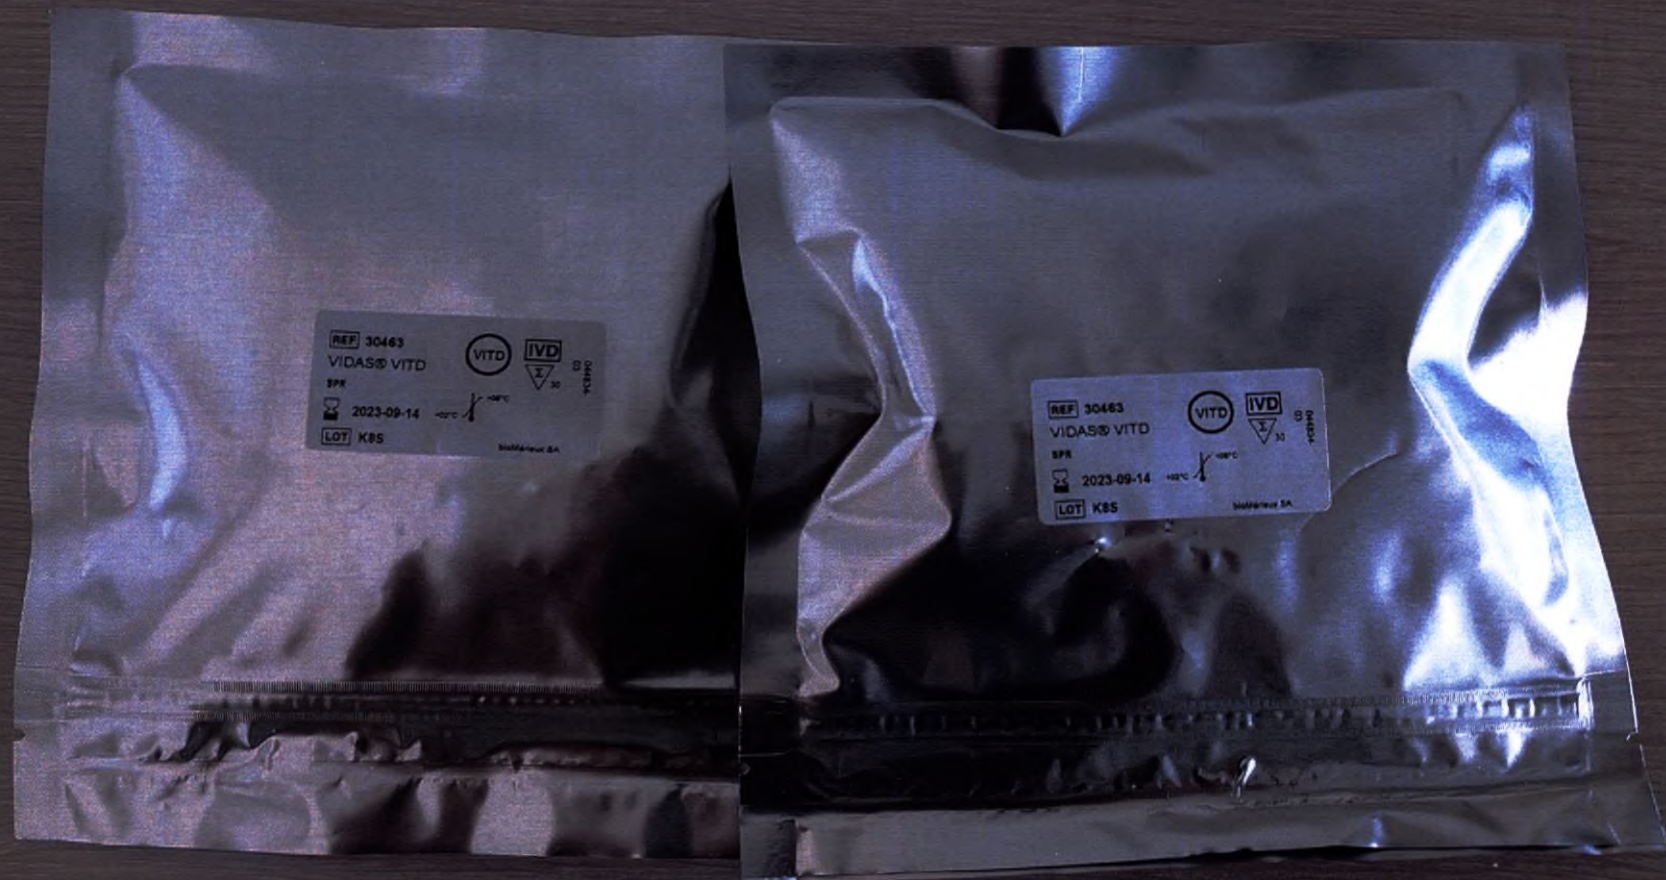





прошито и пронумеровано

7 листов (Семь)

«26» апреля 2022 года



Финансовый директор  
А. Игумов



ПОДТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «биоМерье Рус»

Н.В. Бердникова

**Дополнение к файлу Фотографические изображения  
медицинского изделия для диагностики in vitro**

**«Набор реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)»  
для количественного определения общего 25-  
гидроксивитамина D в сыворотке или плазме крови  
человека методом иммуноферментного  
флуоресцентного анализа на анализаторах  
иммунологических семейства VIDAS,**

**производства «биоМерье С.А.» (bioMérieux S.A.), Франция**


Общий вид набора реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)» для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS



Общий вид набора реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)» для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS





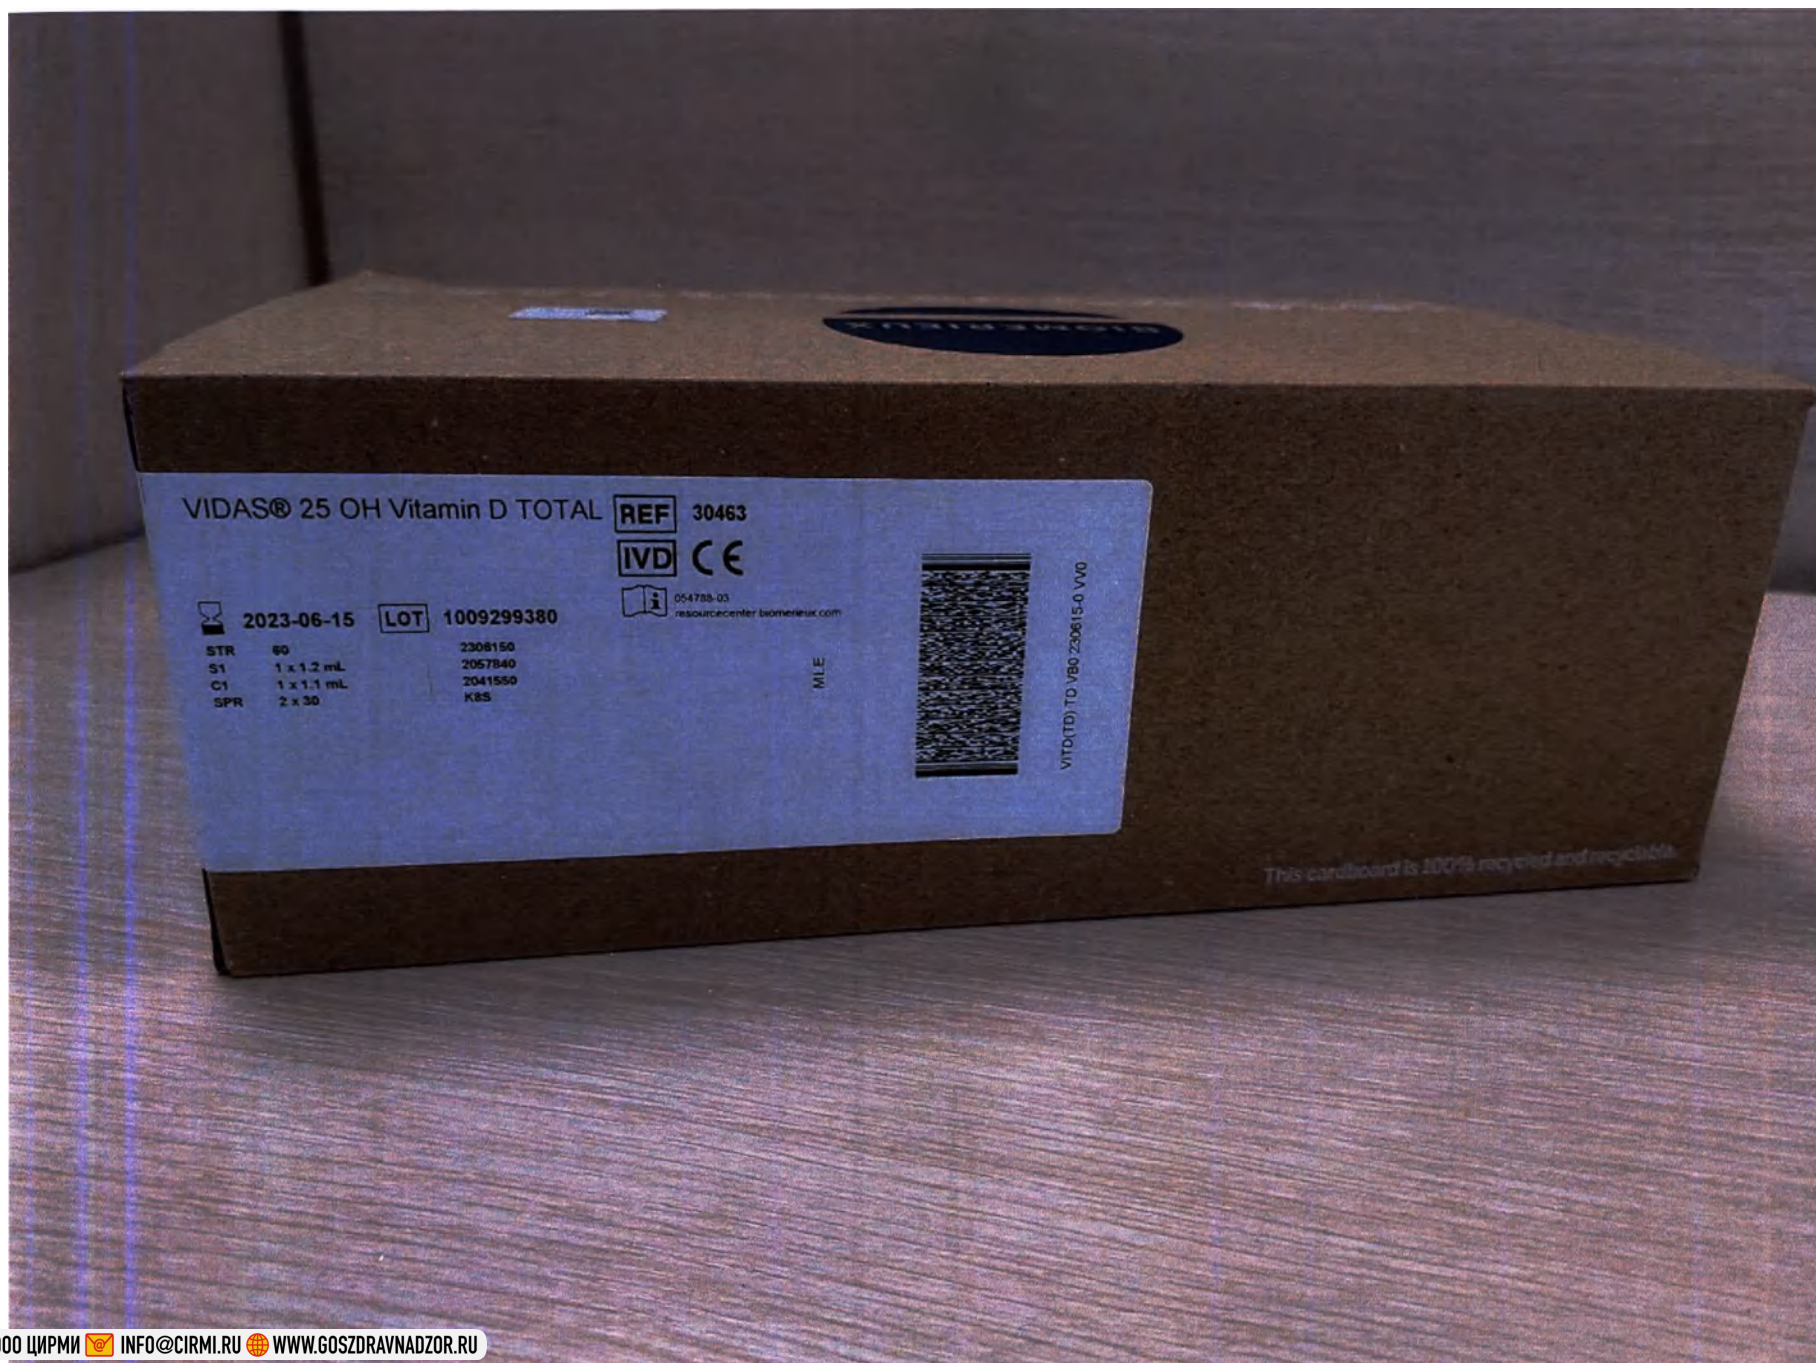

Общий вид набора реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)» для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS



Общий вид набора реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VITD)» для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS



Прошито и пронумеровано

7 листов (Семь)

« 07 » октября 2022 года

Генеральный директор

Бердникова Н.В.



Дополнительная маркировка для Российской Федерации

**REF 30463**

ru

**Производитель:**

**«биМерье С.А.», Франция**

---

**Набор реагентов «VIDAS 25 OH Vitamin D TOTAL (VTD)» для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D в сыворотке или плазме крови человека методом иммуноферментного флуоресцентного анализа на анализаторах иммунологических семейства VIDAS**

Стрипы VTD (STR) – 60 шт.

Наконечники VTD (SPR) – 30 шт./уп., 2 упаковки

Контроль VTD (C1) – 1 флакон х 1,1 мл (жидкий)

Стандарт калибровочный VTD (S1) – 1 флакон х 1,2 мл (жидкий)

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Уполномоченный представитель в РФ:**

**ООО «биМерье Рус»**

**Адрес:**

Россия, 115230, Москва,

1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 221 10 79

**РУ № [номер и дата регистрационного удостоверения]**