



## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), в вариантах исполнения**

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

Общий вид



I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

# Elecsys Anti-HBs II

cobas e analyzers

**REF** 08498598190

**GTIN** 07613336160350

COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are  
trademarks of Roche

 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

02

**CONTENT**

**M** 6.5 mL

**R1** 10 mL

**R2** 8 mL

**Cal1** 2 x 1.3 mL

**Cal2** 2 x 1.3 mL

**LOT** 54179802

 2022-03-31

**IVD**

 0123  2-8 °C


 [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)

 100 H317  
P261, P272  
P280  
P333+P313  
P362+P364  
P501



**cobas®**

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

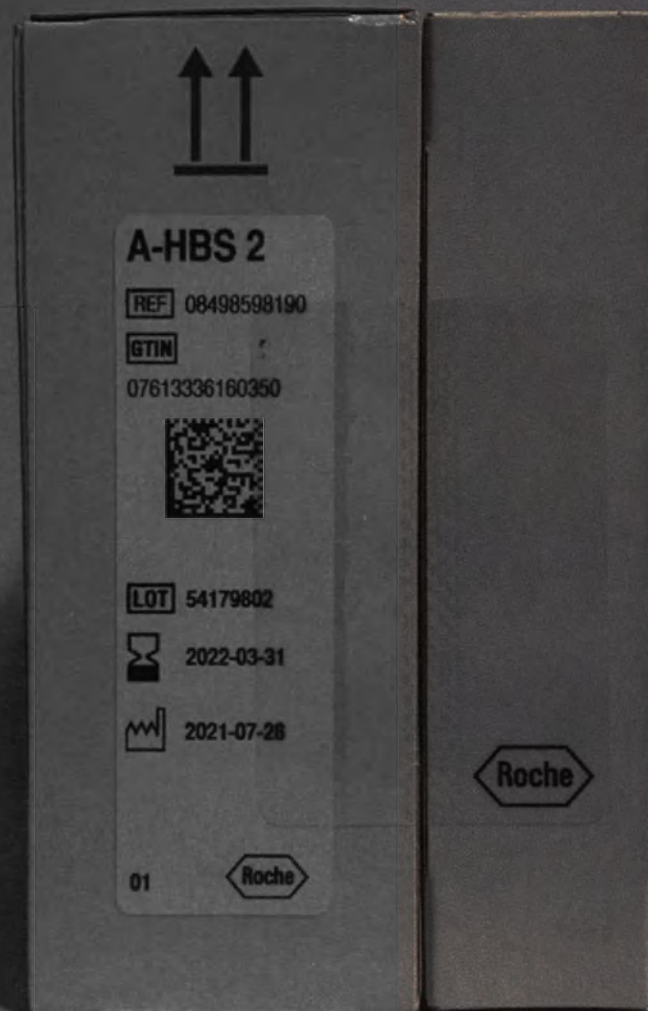

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8403 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (только для A-HBSII CalI и A-HBSII Cal2).

Используемый исходный материал HBsAg инактивировали перед мечением биотином или рутением путем нагревания до 60 °C в течение 15 часов. Кроме того, любые оставшиеся вирусные частицы были удалены ультрацентрифугированием (только для реагентов A-HBS 2)

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат № 08498598190

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке

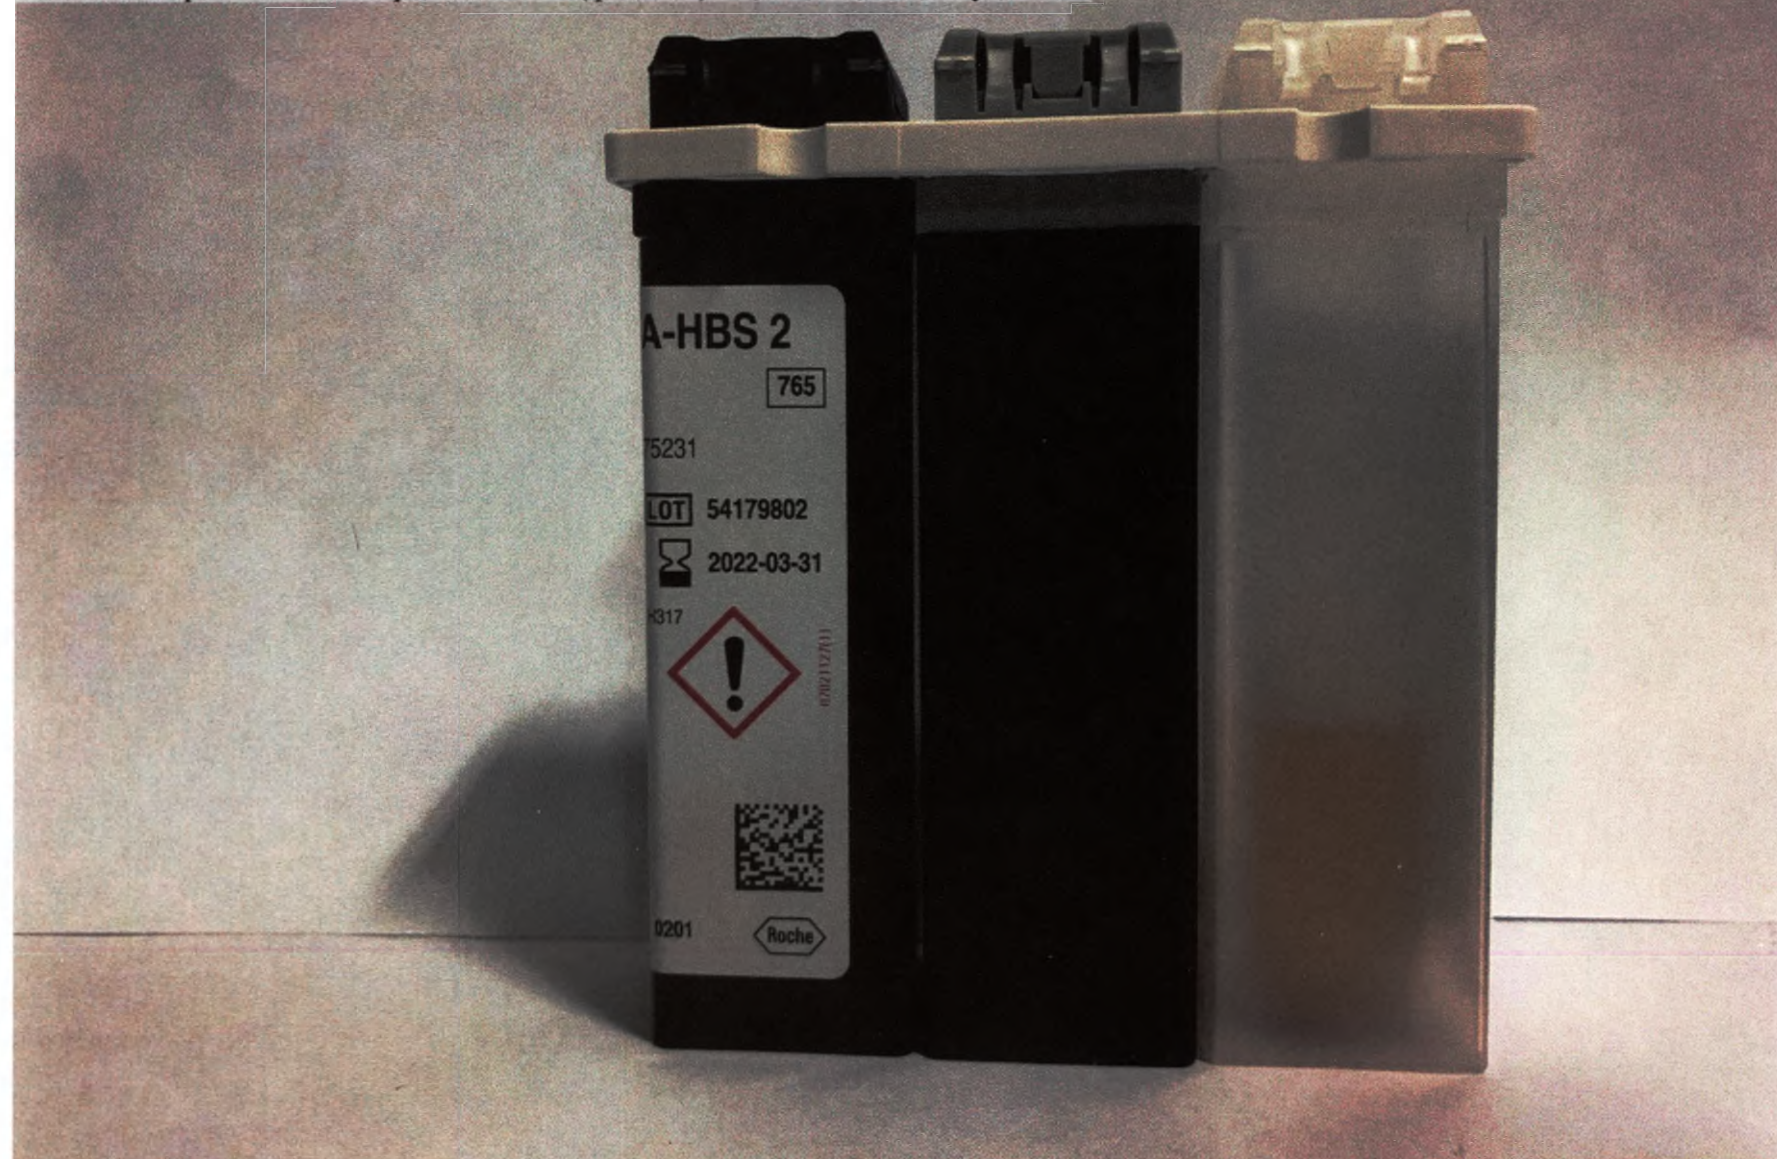

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке

**A-HBS 2**

Elecsys

1840

08498598

**M** 6.5 mL

**R1** 10 mL

**R2** 8 mL

57156

**LOT** 54179802

2022-03-31

2-8 °C

**IVD**




0101

Roche


I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке

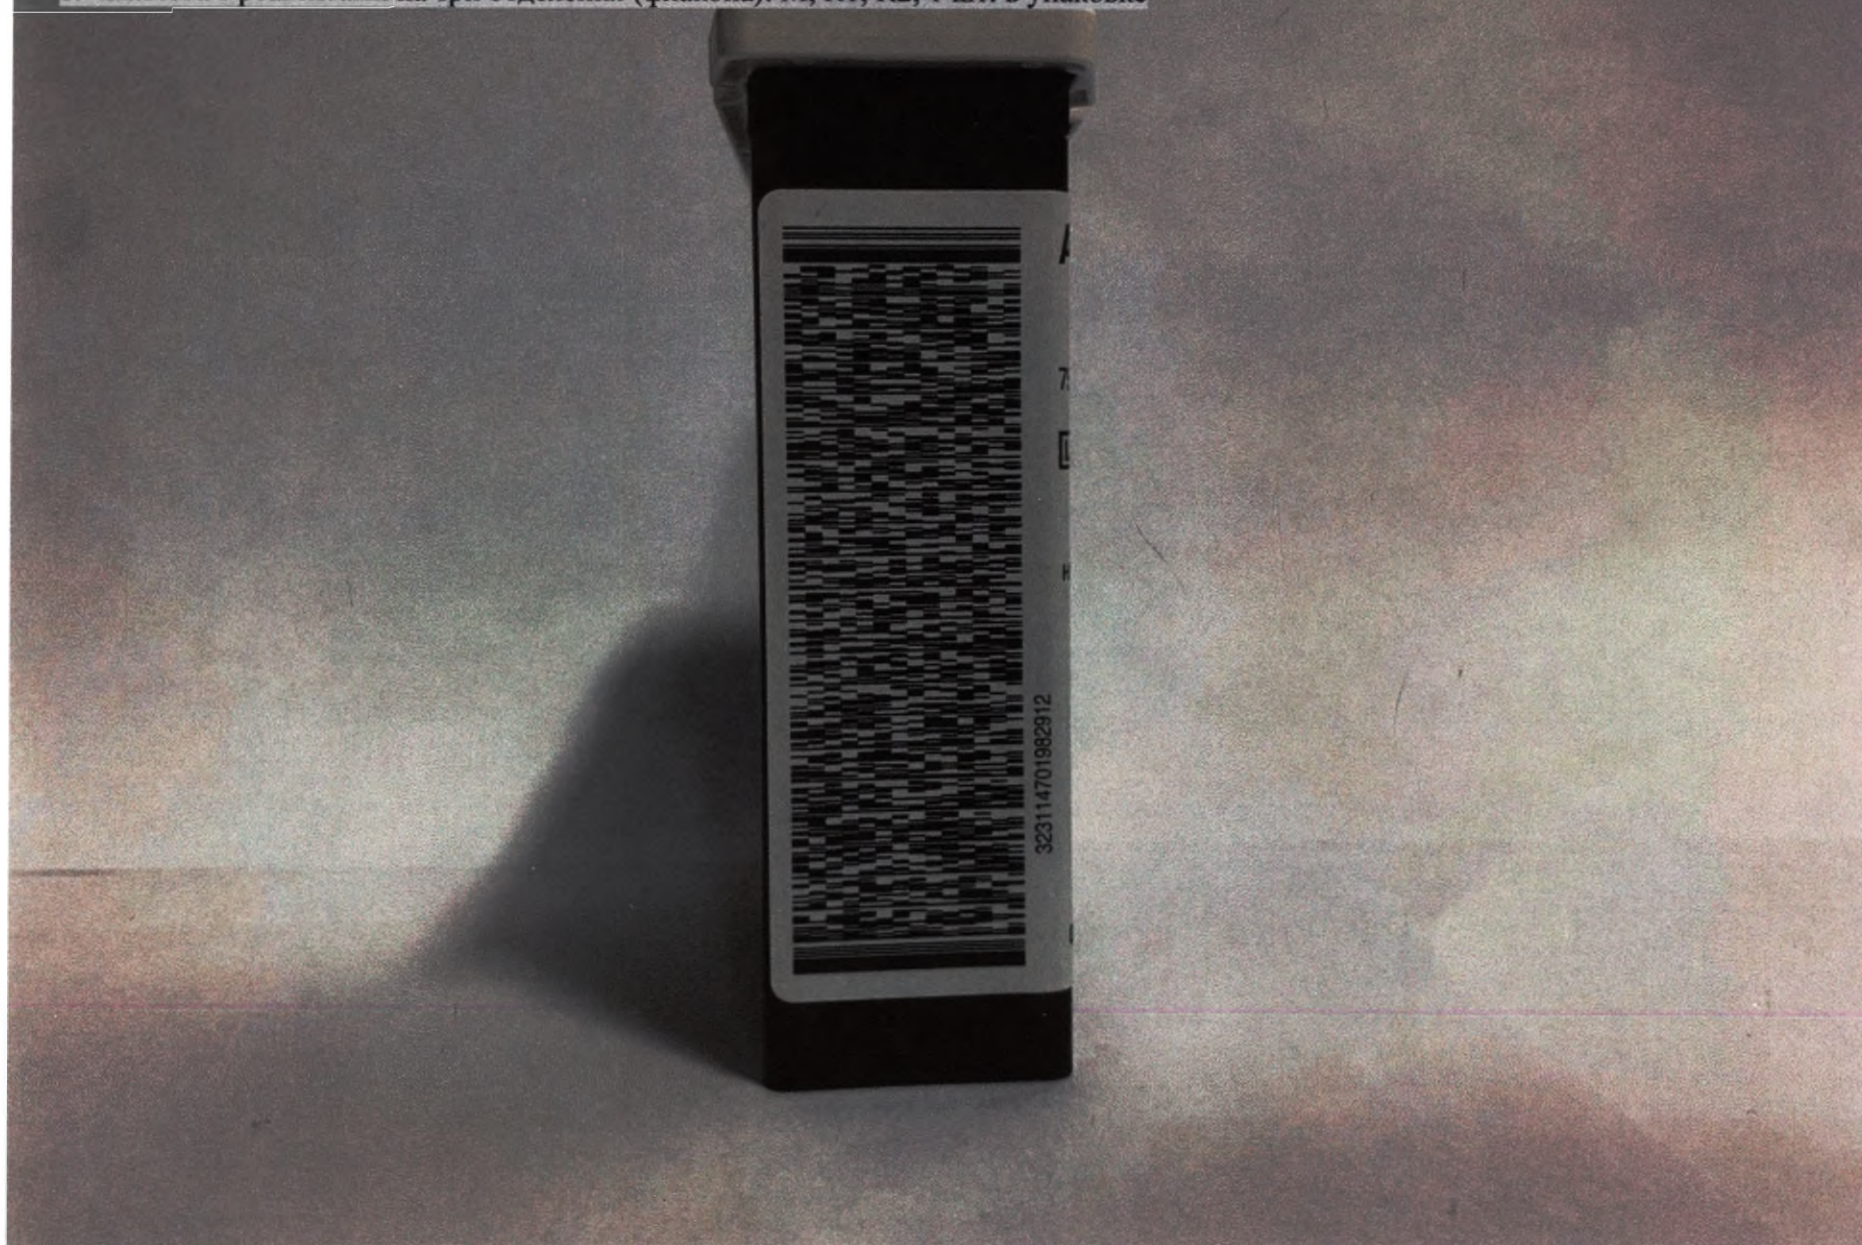


1. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке

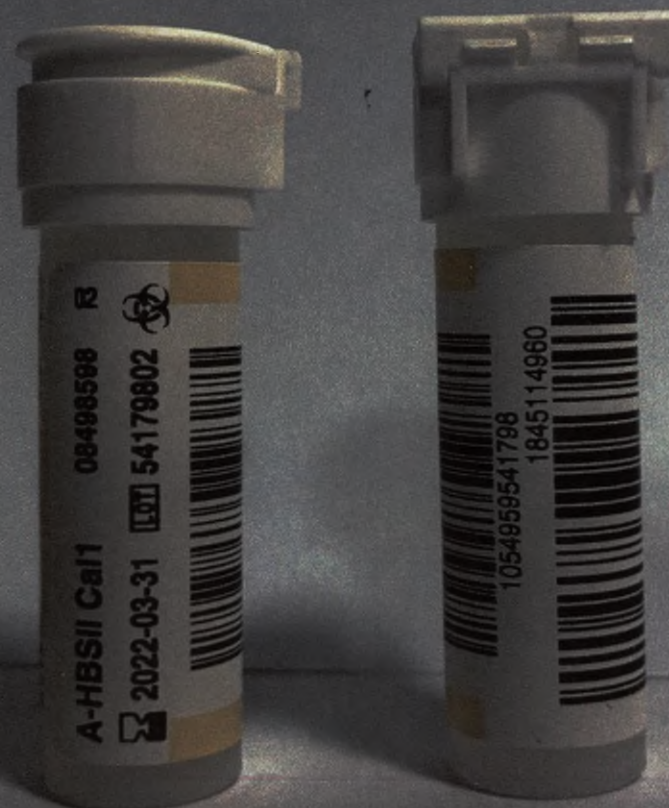

I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке

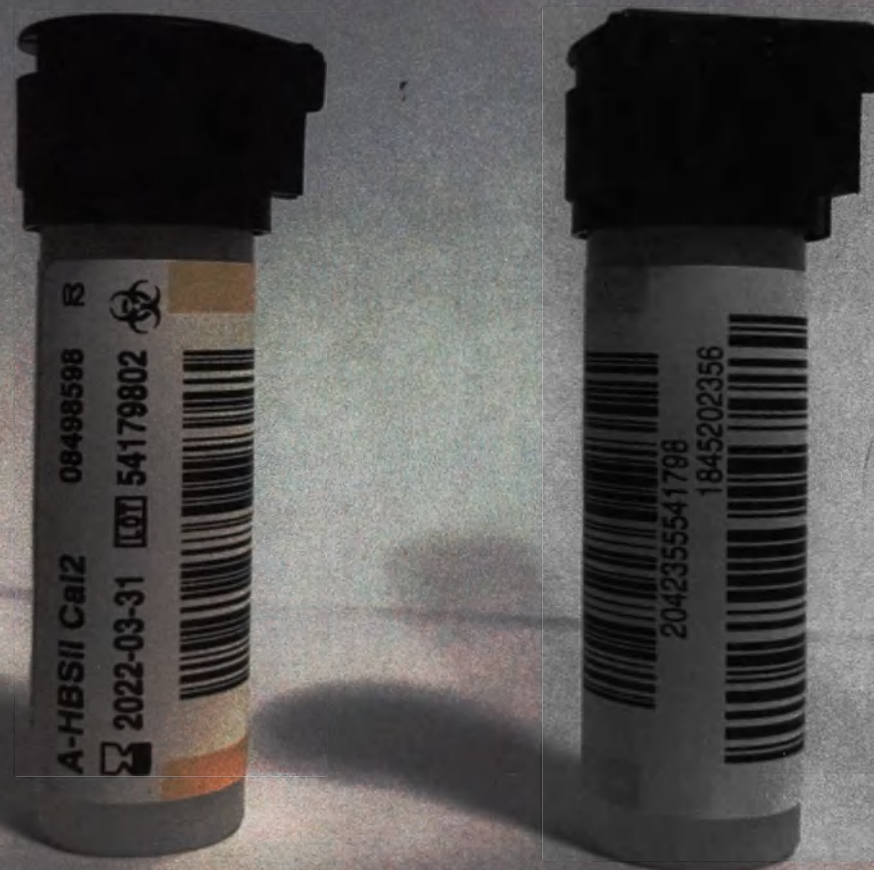


I. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 100 тестов

4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке



II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

Общий вид

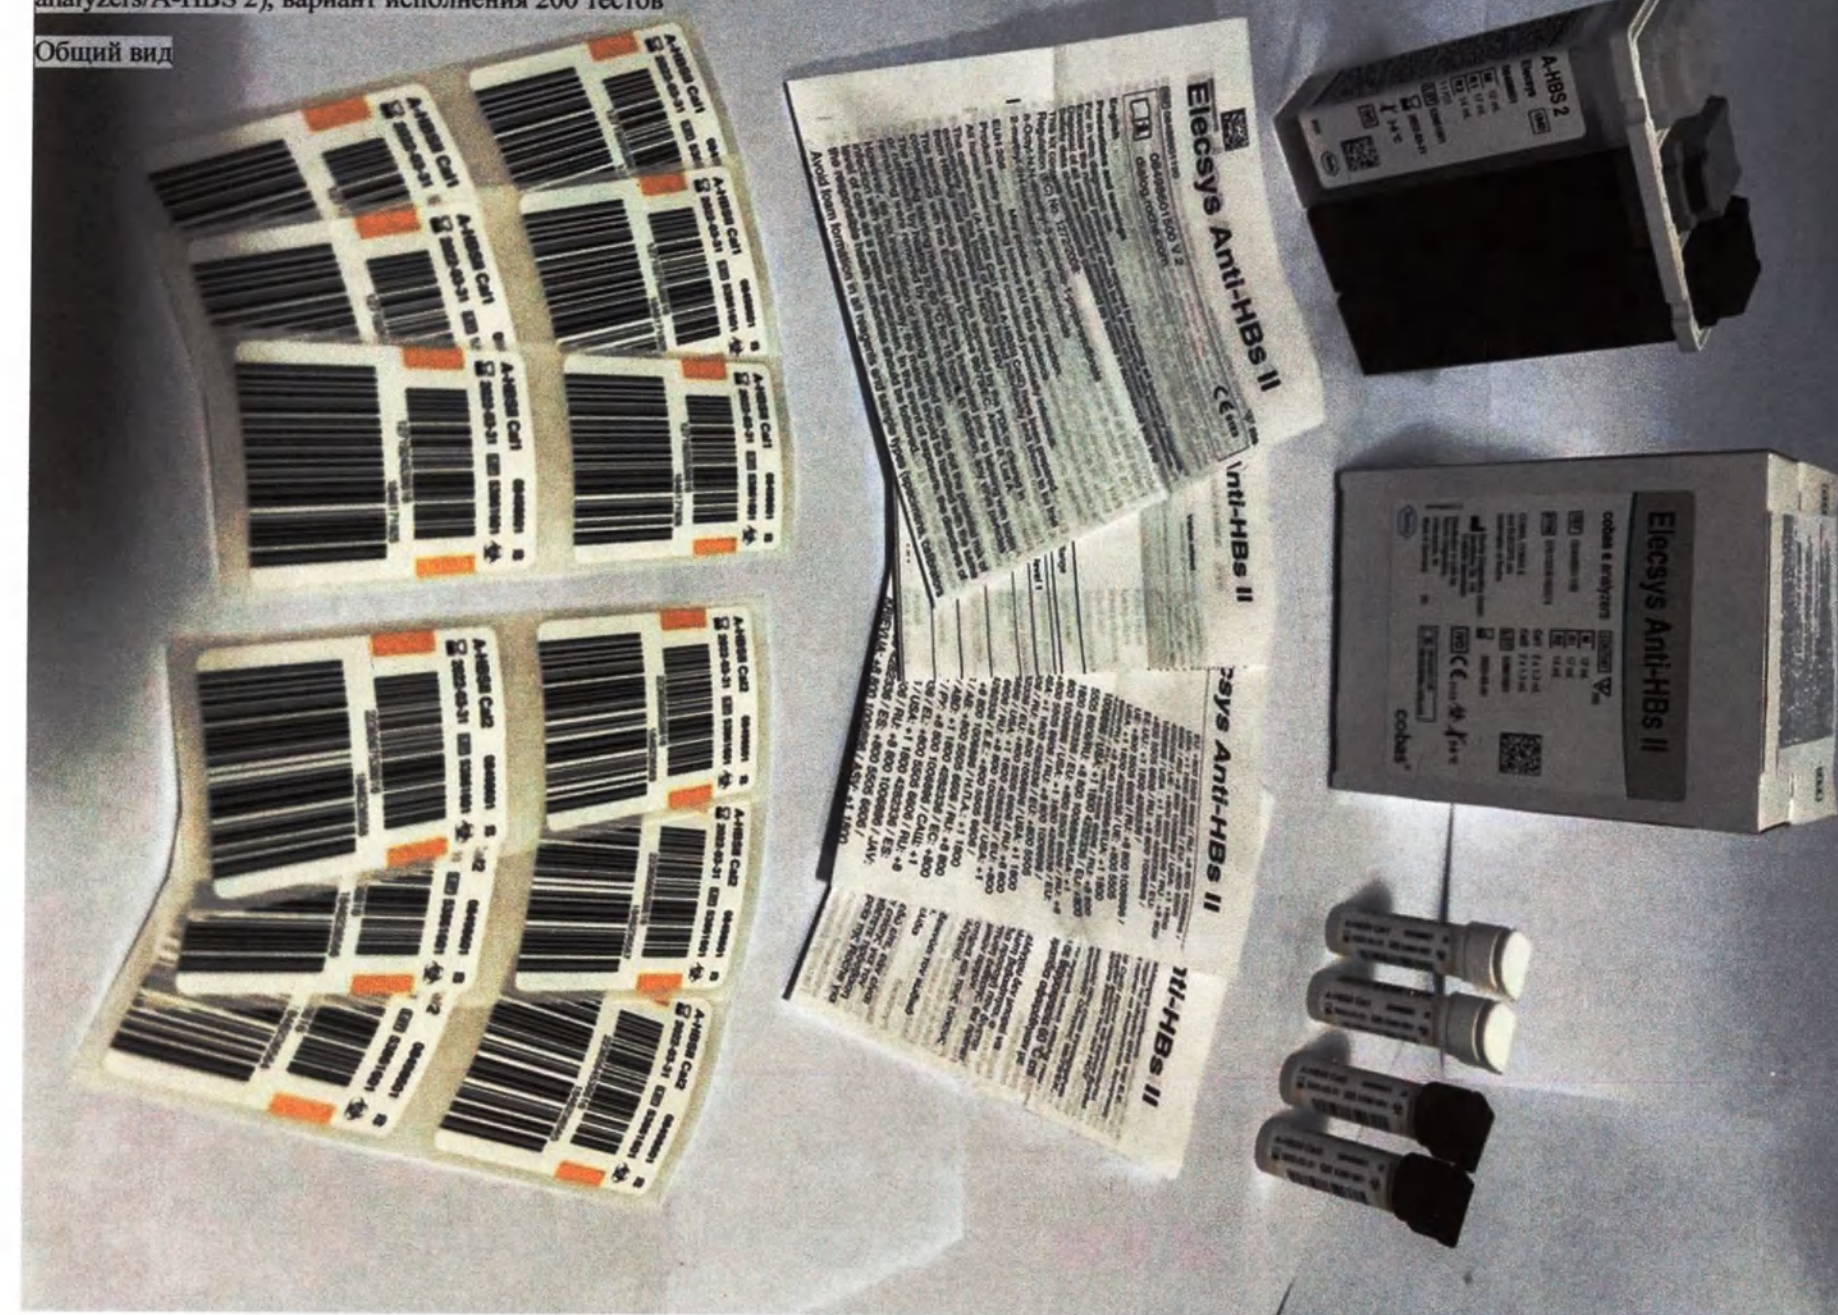

II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

## Elecsys Anti-HBs II

cobas e analyzers

CONTENT  200

REF 08498601190

M 12 mL

R1 17 mL

R2 14 mL

GTIN 07613336160374

Cal1 2 x 1.3 mL

Cal2 2 x 1.3 mL

COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are  
trademarks of Roche.

LOT 53861601



 2022-03-31

 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

IVD  0123   2-8 °C

08498601190  
Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany

01

 08498601190  
<http://e-labdoc.roche.com>



cobas®

II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов



**A-HBS 2**

REF 08498601190

GTIN

07613336160374



LOT 53861601



2022-03-31



2021-06-22

Roche

01

Roche

II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № PЗН 2019/8403 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (только для A-HBSII Cal1 и A-HBSII Cal2).

Используемый исходный материал HBsAg инактивировали перед мечением биотином или рутением путем нагревания до 60 °C в течение 15 часов. Кроме того, любые оставшиеся вирусные частицы были удалены ультрацентрифугированием (только для реагентов A-HBS 2)

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат. № 08498601190


II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке




II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке

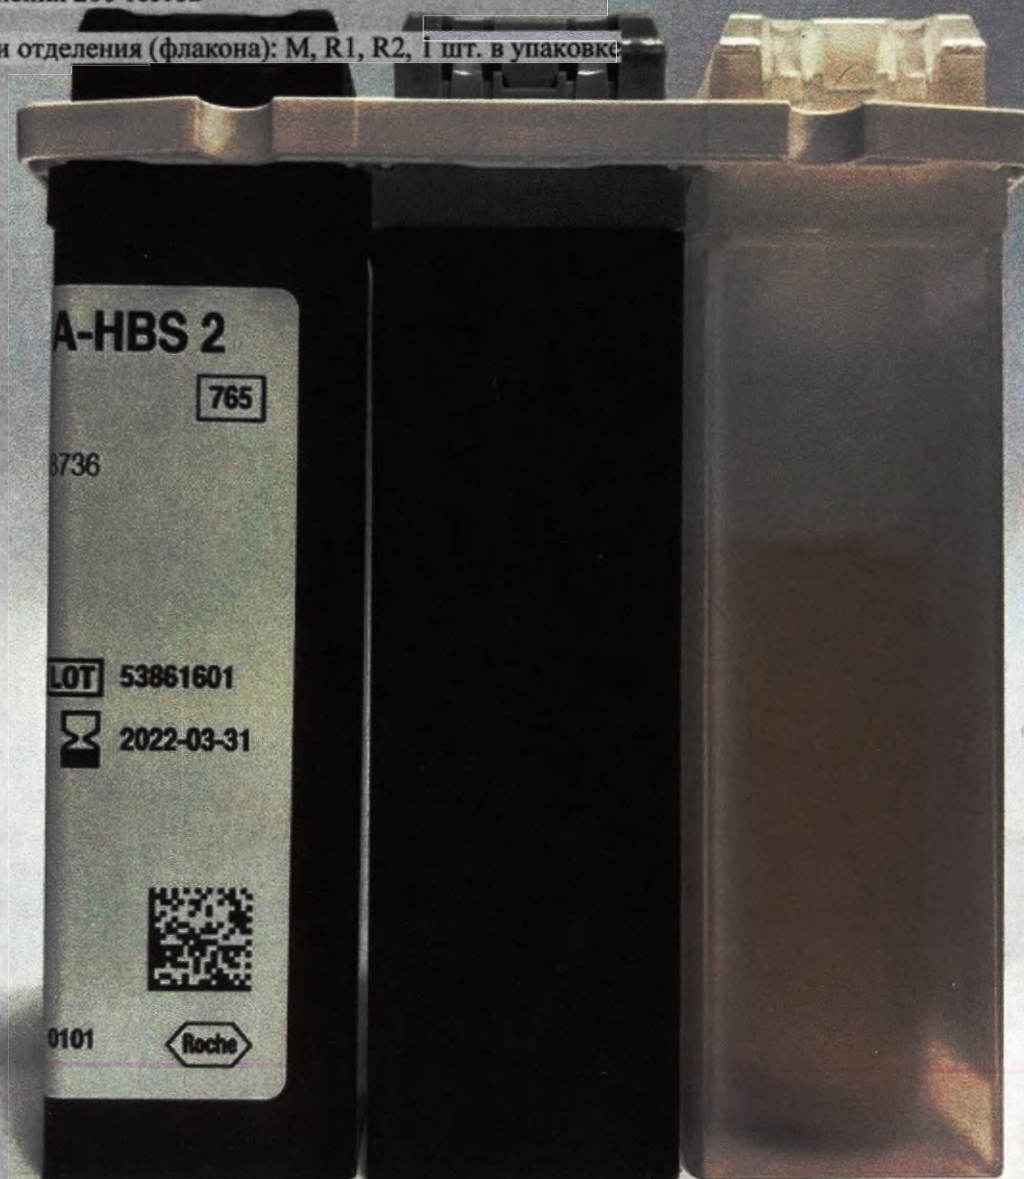


II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке

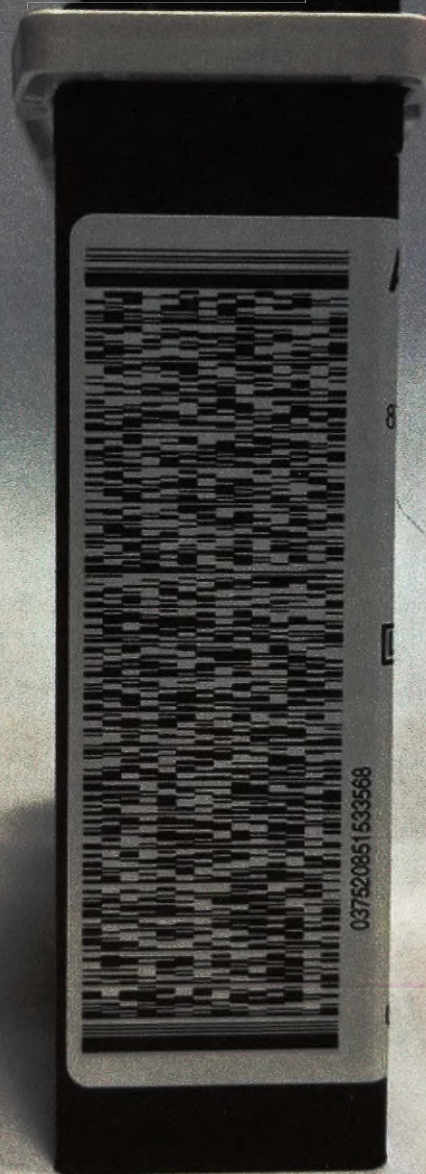


II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке

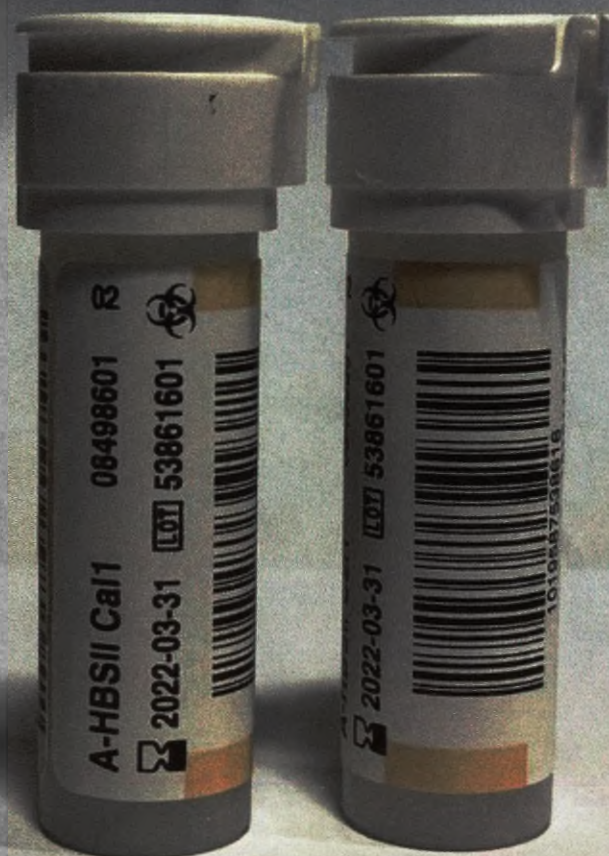

II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке

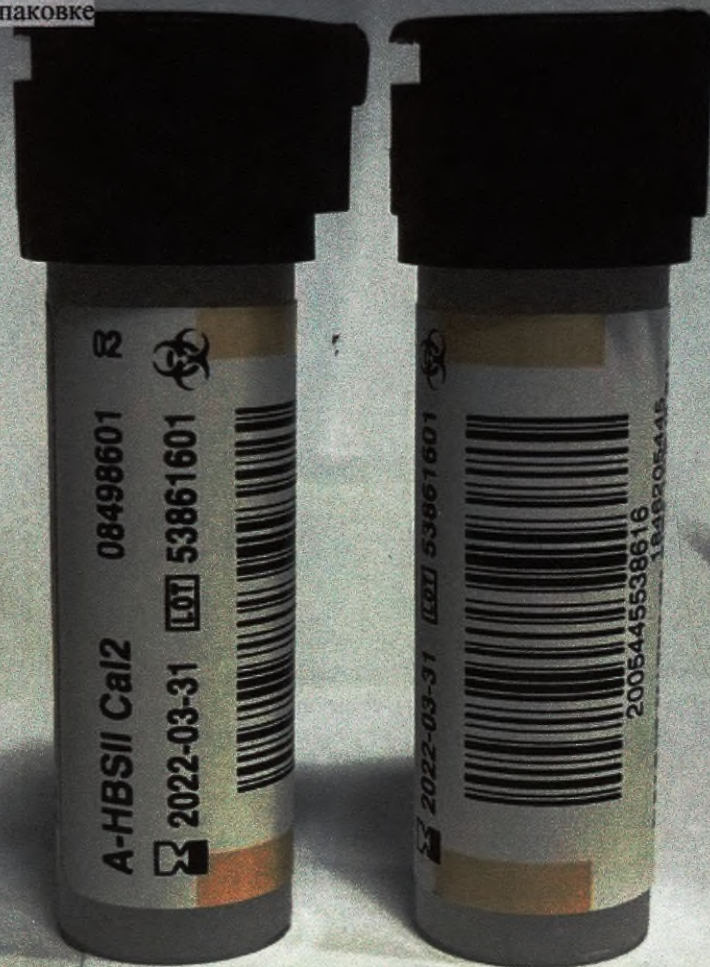


II. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов

4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

Общий вид

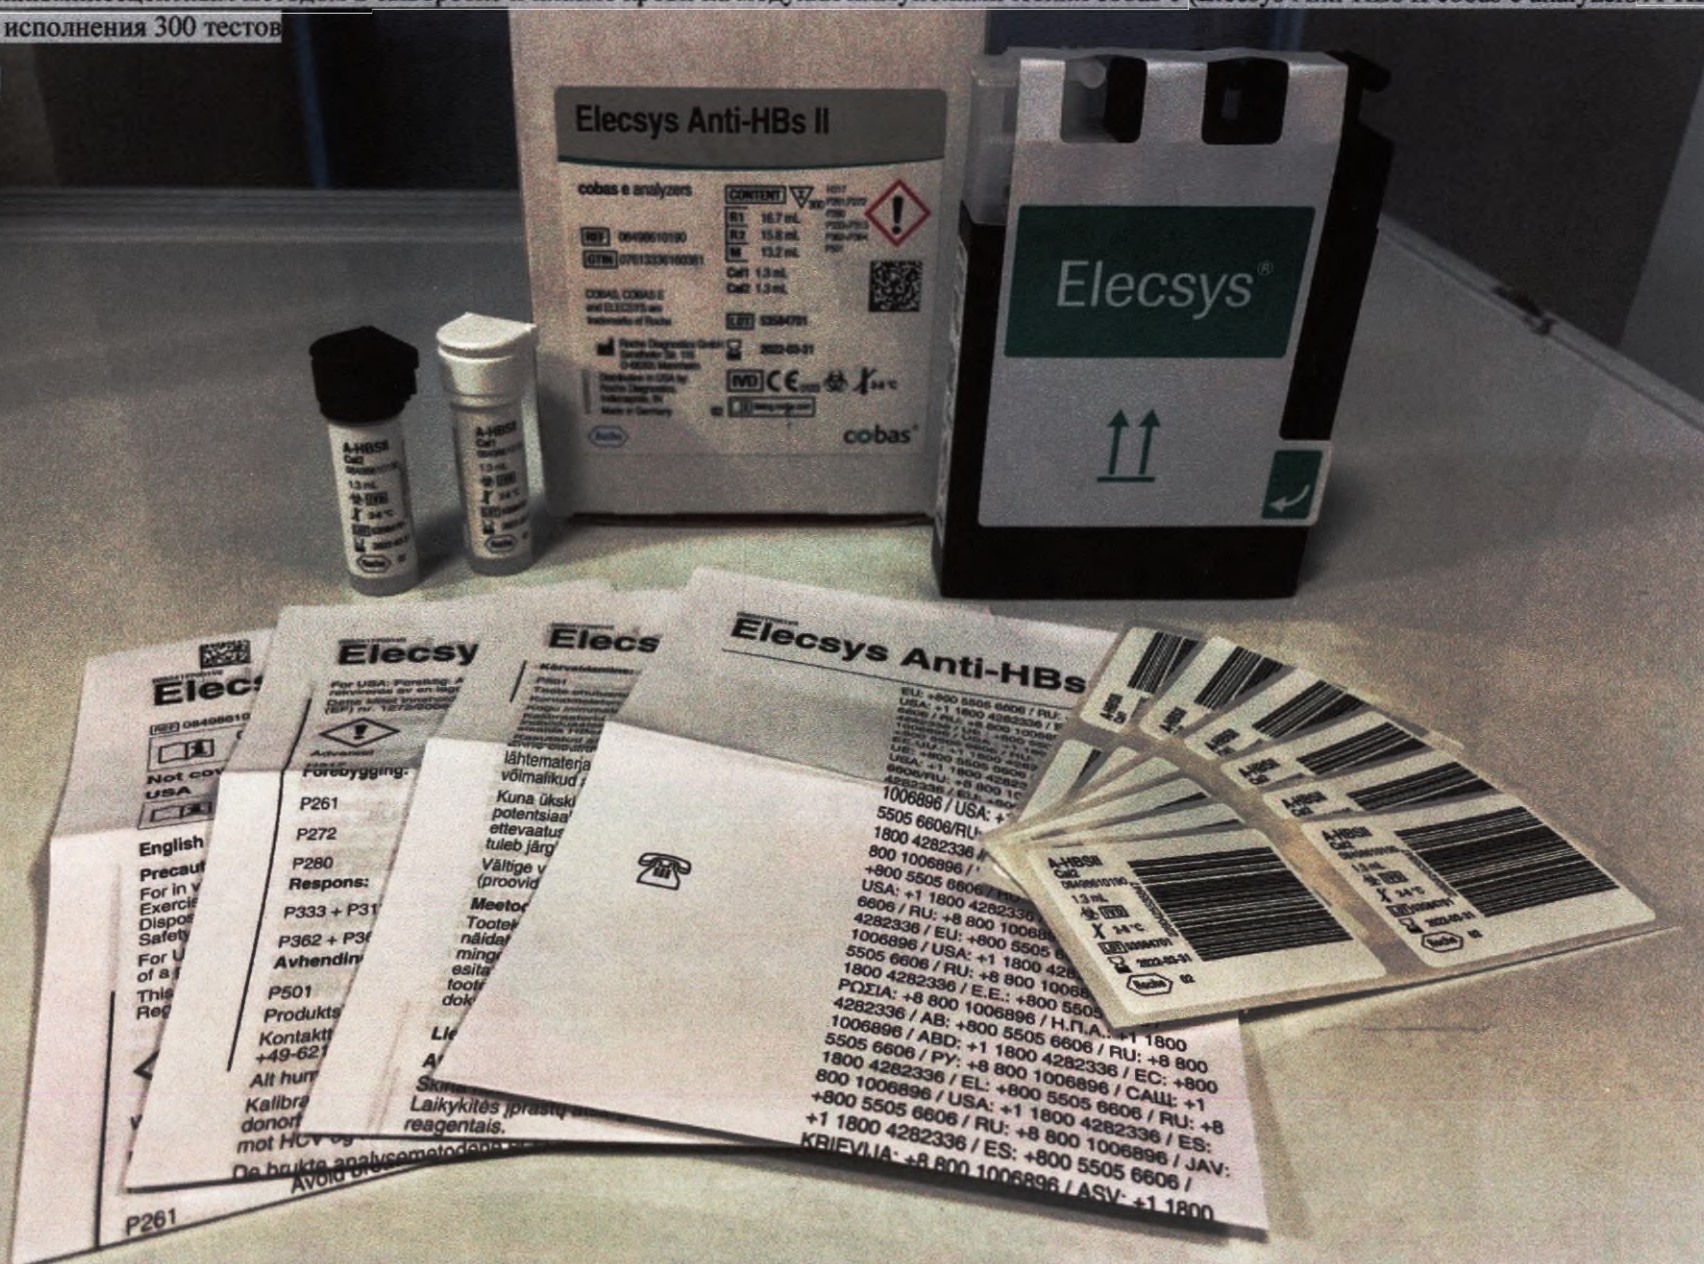

III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

# Elecsys Anti-HBs II

cobas e analyzers

**REF** 08498610190

**GTIN** 07613336160381

COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are  
trademarks of Roche

 Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany



## CONTENT



300

**R1** 16.7 mL

**R2** 15.8 mL

**M** 13.2 mL

**Cal1** 1.3 mL

**Cal2** 1.3 mL

**LOT** 53584701

 2022-03-31

**IVD**  0123

02  [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)

H317  
P261,P272  
P280  
P333+P313  
P362+P364  
P501



  2-8 °C

cobas®

III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

Макет маркировки на русском языке

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 200 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8403 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (только для A-HBSII Cal1 и A-HBSII Cal2).

Используемый исходный материал HBsAg инактивировали перед мечением биотином или рутением путем нагревания до 60 °C в течение 15 часов. Кроме того, любые оставшиеся вирусные частицы были удалены ультрацентрифугированием (только для реагентов A-HBS 2)

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception\_dia@roche.com

Кат № 08498601190

III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

I. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке




III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке

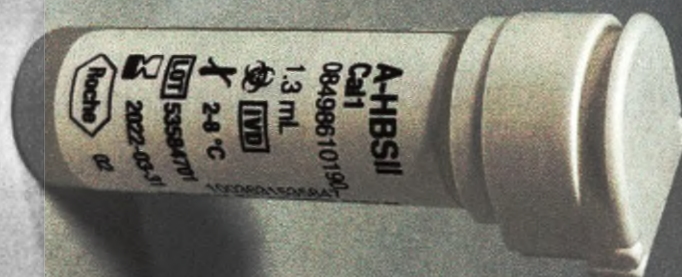


III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

2. Калибратор 1, флакон объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке

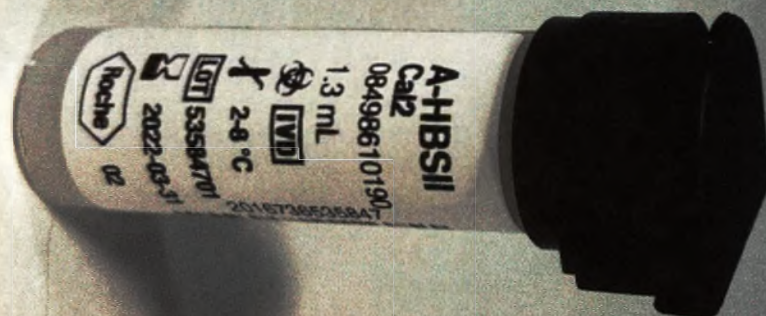

III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

3. Калибратор 2, флакон объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке



III. Набор реагентов и калибраторов для количественного определения человеческих антител к пов...

иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HBs II cobas e analyzers/A-HBS 2), вариант исполнения 300 тестов

4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке





Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью

33 листа (ов)

по доверенности  
от 11.02/2022 г.

И. А.