



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

"Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса G к SARS-CoV-2"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

Комплект №1

серия 07, серия 08

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет (12 стрипов)
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (3 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (объемом до 250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2022 г



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

ТУ 21.20.23-306-70423725-2020 с изм №1

РУ №

Комплект №1

LOT 07

2022.05.20

REF 22.06.1

2024.05.20

Контрольный № 324



22.06.1

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

Иммуносорбент

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

РПРО

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

1,5 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

Конъюгат

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

РРО

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

3 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

РИ

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

LOT 07

2024.05

IVD

40 мл

ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

LOT 07

2024.05

IVD

14 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса G к SARS-CoV-2

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

Комплект №2

серия 07, серия 08

Состав набора

Иммуносорбент

К+, инактивированный

К-, инактивированный

Конъюгат

РПРО

РРО

ФСБ-Т(x25)

РИ

Стоп-реагент

Планшет разборный для предварительного разведения

исследуемых образцов

Одноразовые наконечники для

дозаторов пипеточных (объемом до 250 мкл)

Вспомогательные пластиковые емкости

Клейкая пленка для планшетов

5 планшетов (60 стрипов)

2 фл. (по 4 мл)

3 фл. (по 4 мл)

5 фл. (по 14 мл)

1 фл. (70 мл)

6 фл. (по 14 мл)

2 фл. (по 100 мл)

5 фл. (по 14 мл)

3 фл. (по 25 мл)

6 шт.

32 шт.

8 шт.

8 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1, 2 отсутствуют



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2022 г



ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G

серия 07, серия 08

ТУ 21.20.23-306-70423725-2020 с изм №1

РУ №

Комплект №2

LOT 08

REF 22.06.2








2022.05.20

2024.05.20

Контрольный № 325



22.06.2

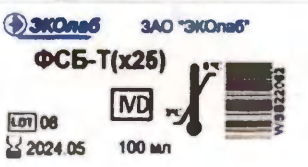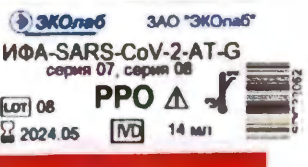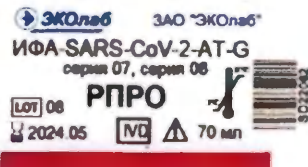

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"


Гашенко Т.Ю.

"07" "08" 2022 г.



**Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к SARS-CoV-2»
«ИФА-SARS-CoV-2-AT-G» серия 07, серия 08**

Комплект № 1 серия 07 от 2022.05.20

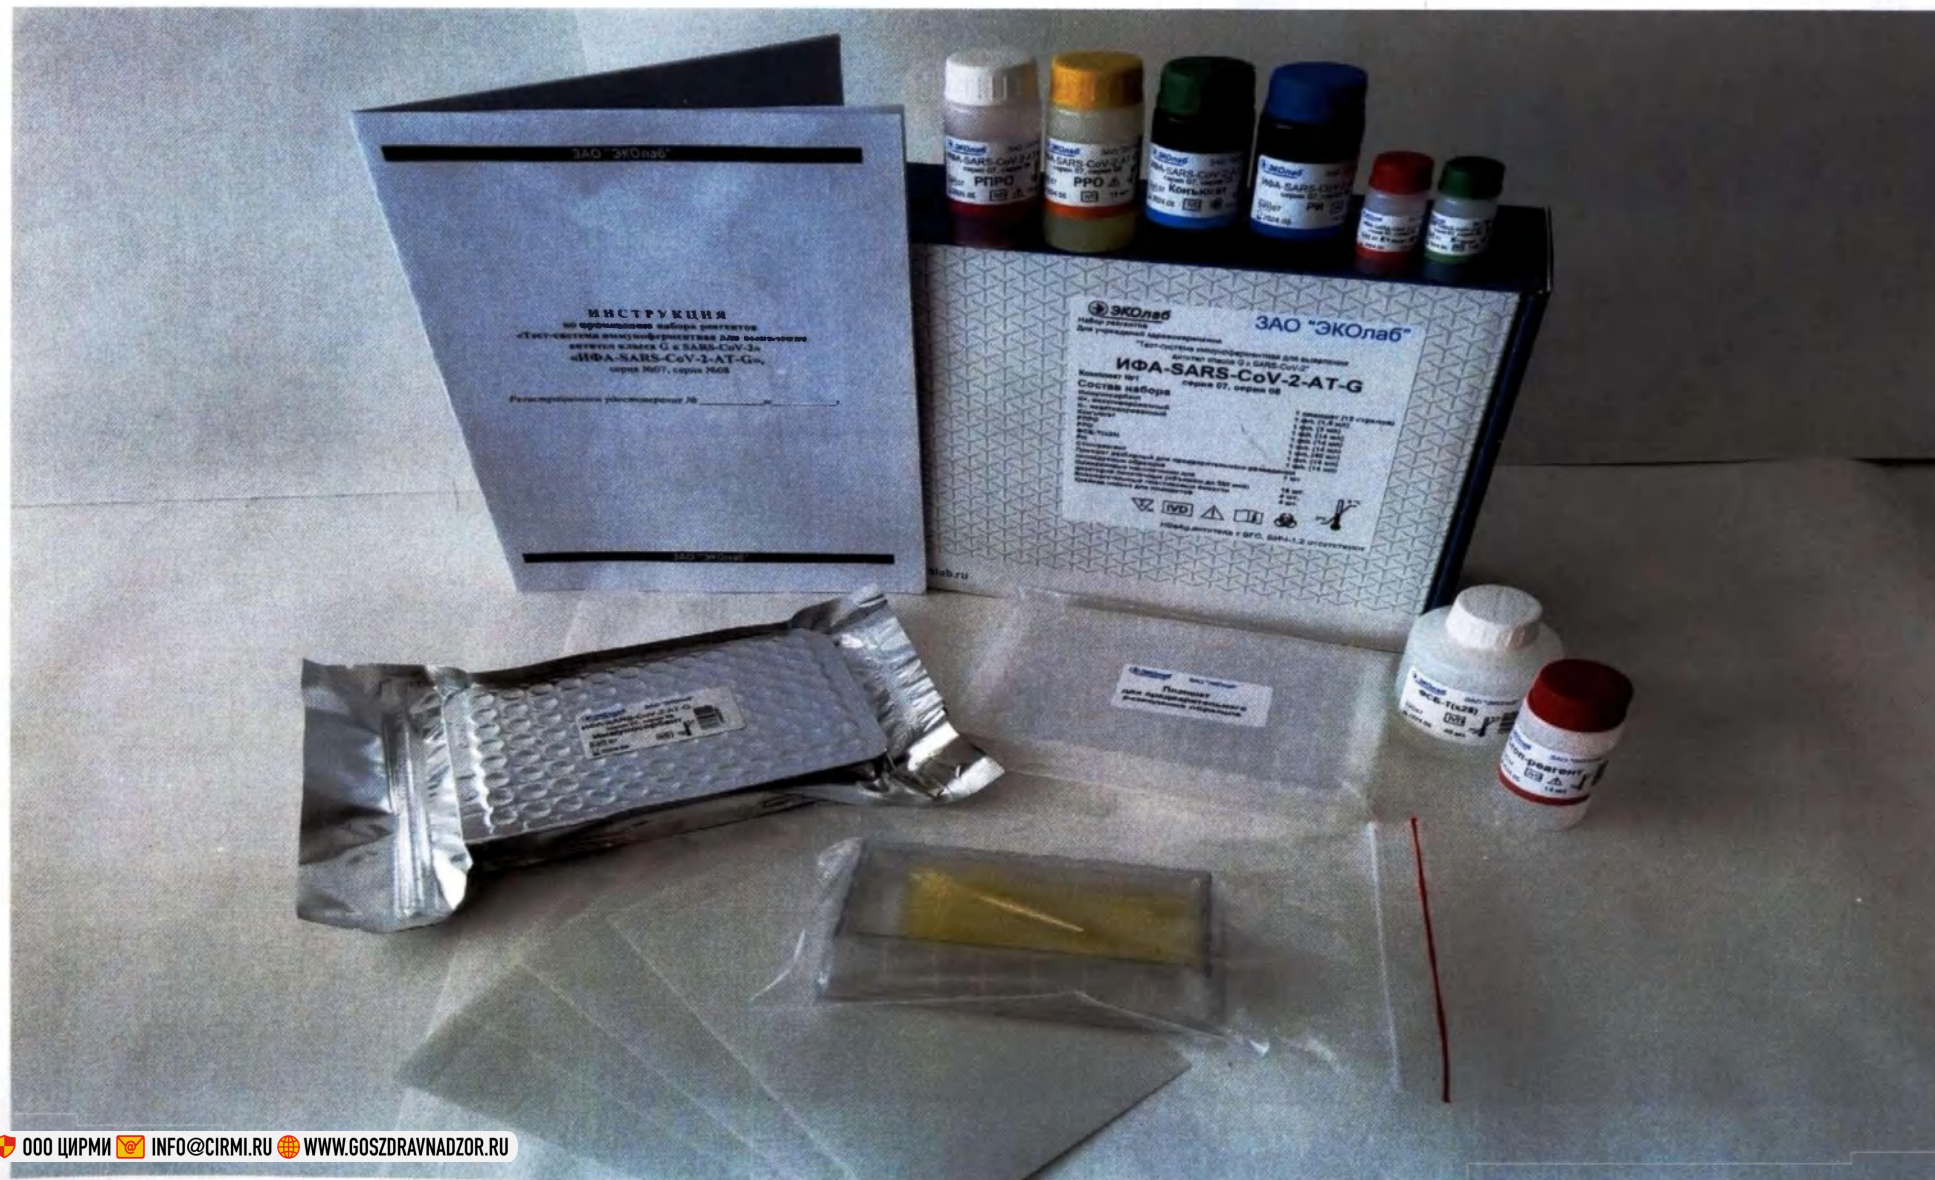

Комплект № 2 серия 08 от 2022.05.20



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2022 г.

