

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

2022 г.

Фотографические изображения общего вида

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения *in vitro* прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295–2021, в исполнениях

2022

В состав наборов могут входить следующие компоненты:

Тест-кассета



Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи




Комплект №1

Скарификатор



Пипетка Пастера

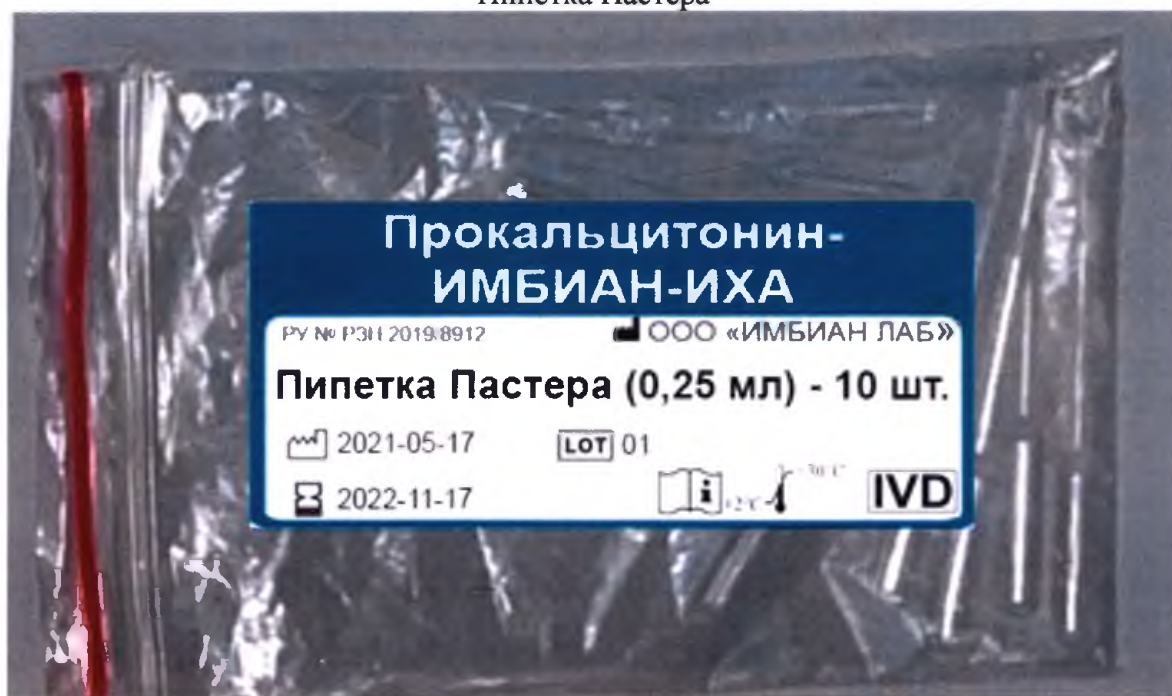

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнении РУ № XXX XXXX/XXXX



Набор содержит:

- | | | | |
|--|-------|-----|------------|
| 1. Тест-кассета | 10 шт | LOT | 01 |
| 2. Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912) | 10 шт | REF | 01 |
| 3. Наклейка со сравнительной шкалой | 10 шт | | |
| 4. Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783) | 10 шт | | |
| 5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822) | 10 шт | | 2021-05-17 |
| 6. Схема использования скарификатора | 1 шт | | 2022-11-17 |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт | | |

Готово к использованию
Только для использования in vitro. ТУ 21.20.23-059-41390295-2021
Для профессионального применения





ООО «ЦИРМИ» ИНН 50-07-0000000
17-02-0000000-0000000
11-0000000-0000000
11-0000000-0000000
11-0000000-0000000
11-0000000-0000000



Инструкция по применению


«Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнении

Схема использования скарификатора

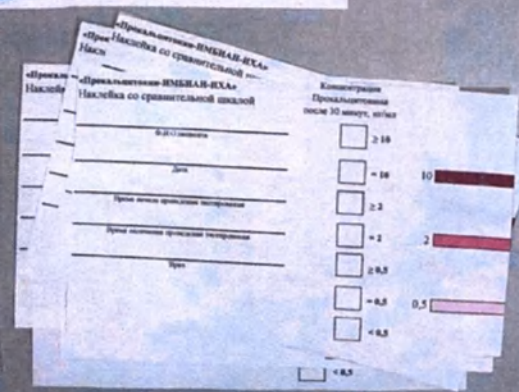


Комплект № 2


Скарификатор

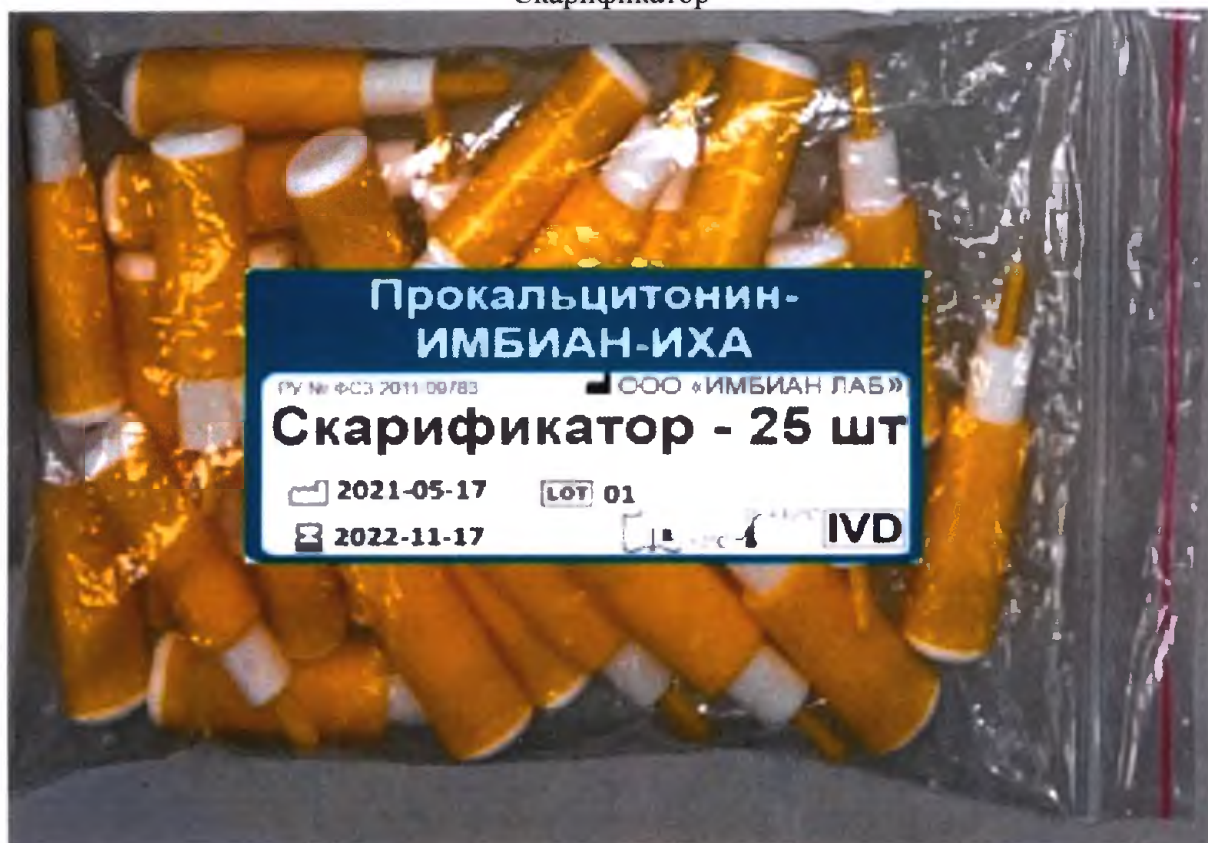

Пипетка Пастера

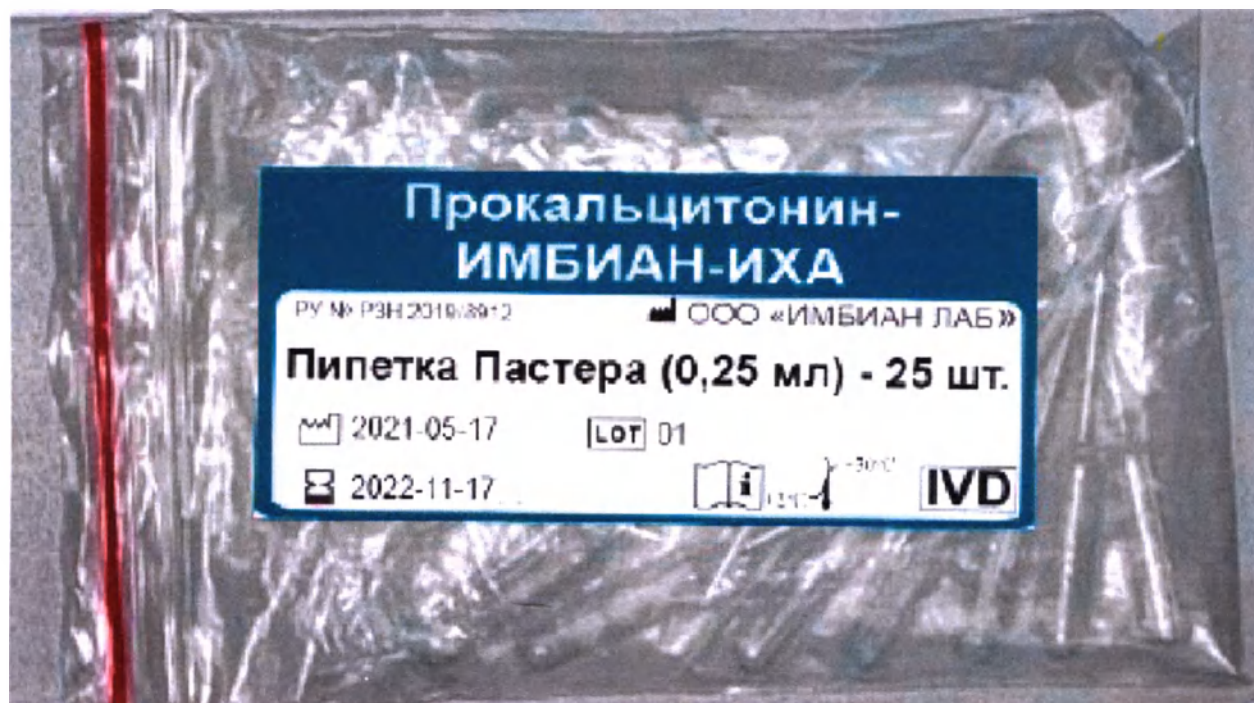

Ы

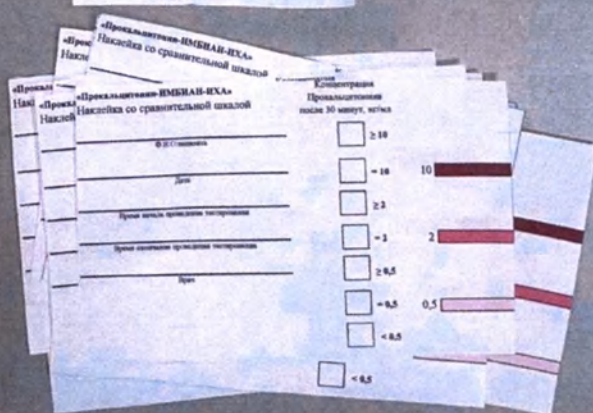

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения *in vitro* прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнениях

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-059-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT 01

 2021-05-17

REF 01

 2022-11-17

IVD

Imbian

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от +2 до +30°C

+2°C  +30°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77: info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 7
семь) лист об

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В.Осипова

2022

г.



Наклейка со сравнительной шкалой

**«Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина
в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-
ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295–2021, в исполнениях»**

«Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА»

Наклейка со сравнительной шкалой

Ф.И.О.пациента

Дата

Время начала проведения тестирования

Время окончания проведения тестирования

Врач

Концентрация
Прокальцитонина
после 10-15 минут,
нг/мл

≥ 10

$= 10$

≥ 2

$= 2$

$\geq 0,5$

$= 0,5$

$< 0,5$

10 

2 

0,5 

Сшито и заверено печатью *2*
gla) лист *a*

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

2022 г.

**«Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического
определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме
«Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295–2021, в
исполнениях»**

Макет маркировки

2022

Комплект 1

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

1 Тест-кассета	10 шт
2 Пипетка Пастера (0.25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	10 шт
3 Наклейка со сравнительной шкалой	10 шт
4 Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	10 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	10 шт
6 Схема использования скарификатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT	XXXXXX
REF	XX-XXX/X
	ГГГГ-ММ-ДД
	ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-059-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559 Новосибирская обл.
ГО Рабочий поселок Кольцово
РП Кольцово ул. Садовая д. 2/П
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Комплект 2

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

1 Тест-кассета	25 шт
2 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	25 шт
3 Наклейка со сравнительной шкалой	25 шт
4 Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	25 шт
5 Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	25 шт
6 Схема использования скарификатора	1 шт
7 Инструкция по применению	1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT	XXXXXX
REF	XX-XXX/X
	ГГГГ-ММ-ДД
	ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-059-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559 Новосибирская обл.
ГО Рабочий поселок Кольцово
РП Кольцово ул. Садовая д. 2/П
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 25 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Скарификатор - 25 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения in vitro прокальцитонина в цельной крови, сыворотке и плазме «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-059-41390295-2021, в исполнениях

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-059-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

IVD

Imbian

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от +2 до +30°C

+2°C +30°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Счито и заверено печатью 3
(при) лист а

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

