

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

2022 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплос-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021, в исполнениях.

В состав наборов могут входить следующие компоненты:


Тест-кассета

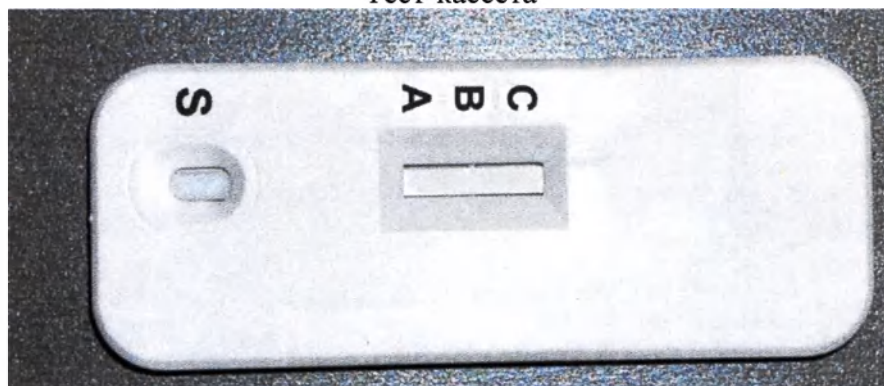

Тест-полоска



Пипетка Пастера

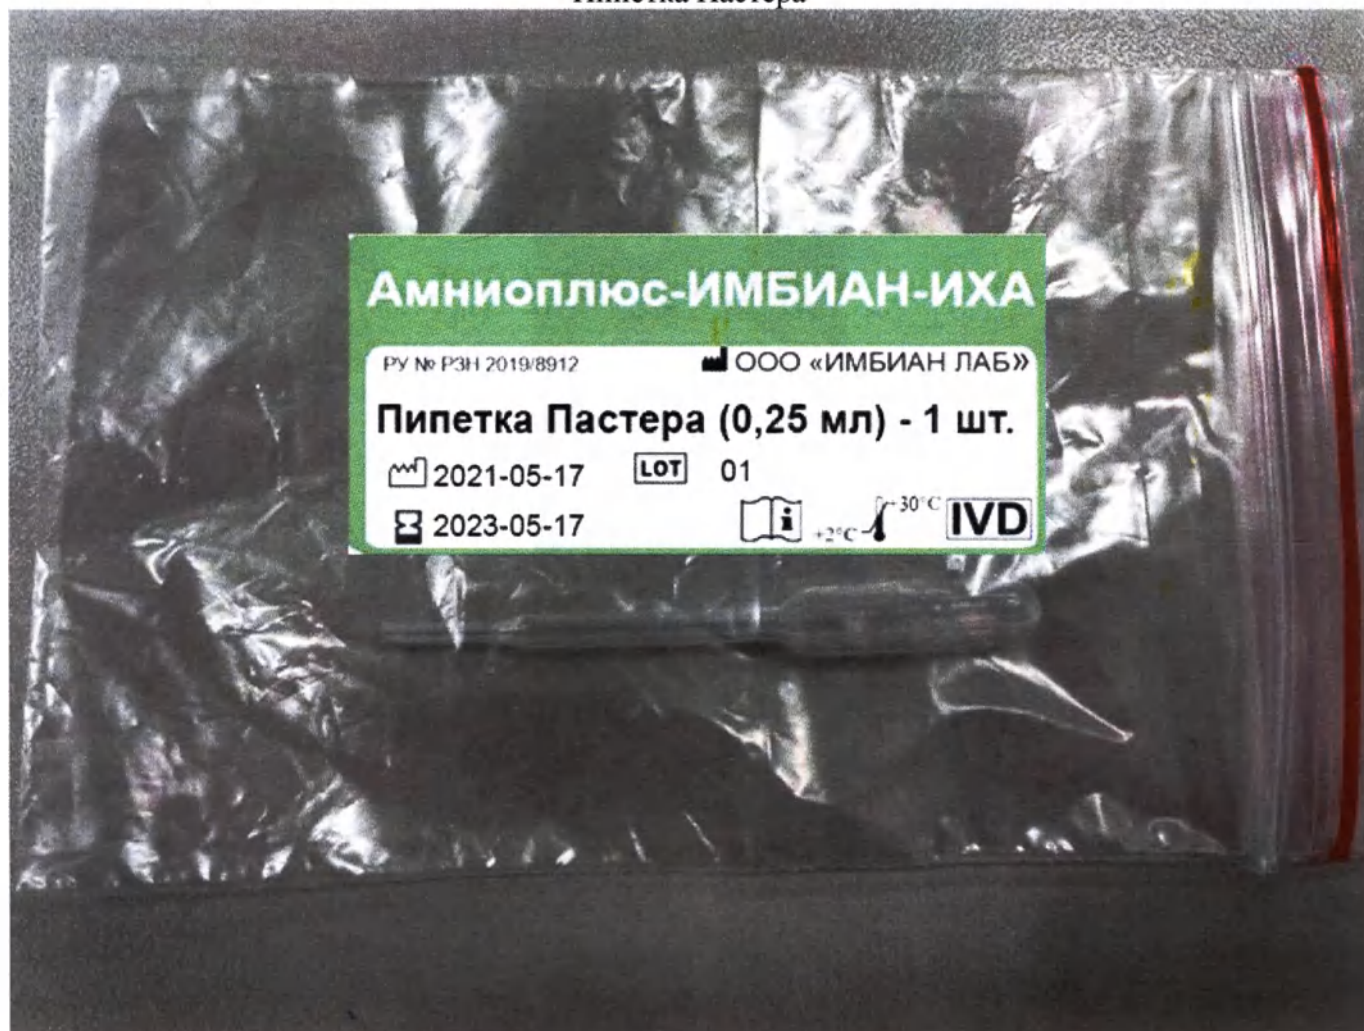

Микропробирка




Флакон-капельница с буферным раствором









Тампон-зонд






Подставка под микропробирки

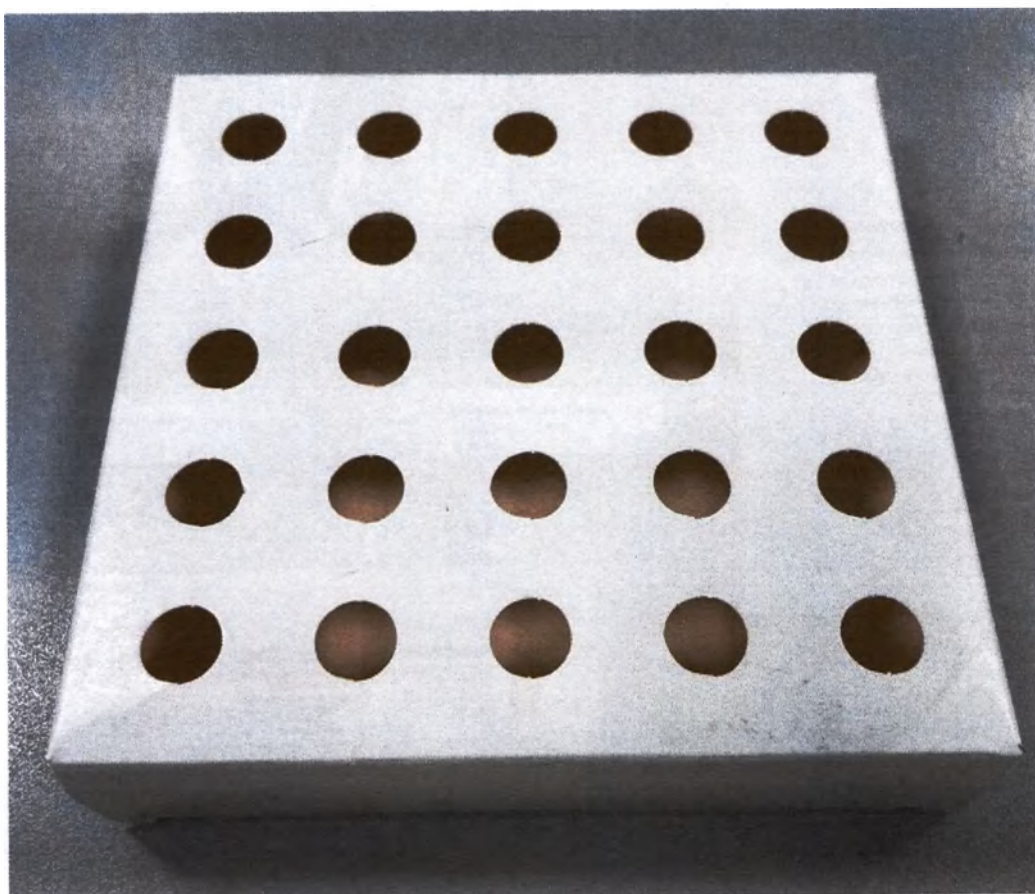

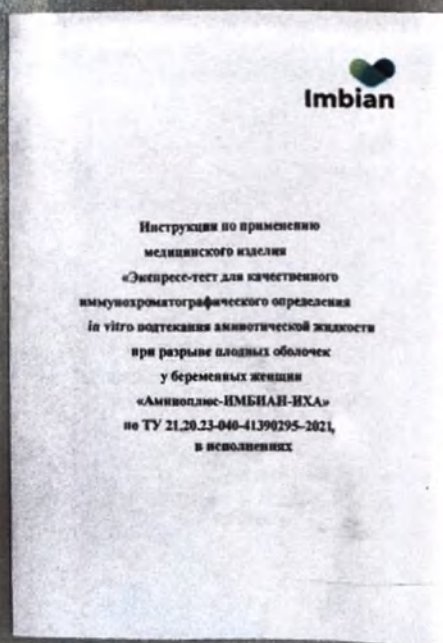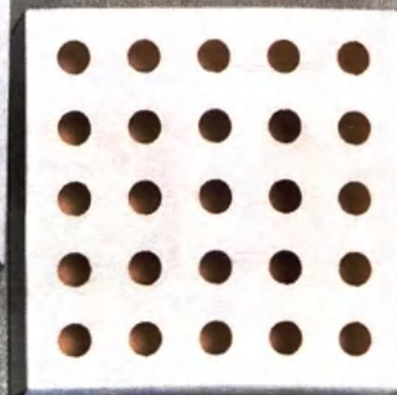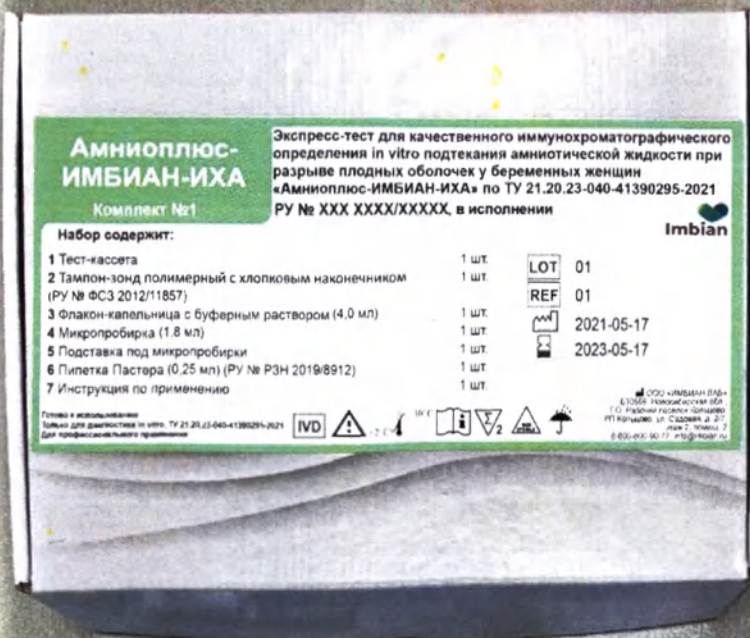

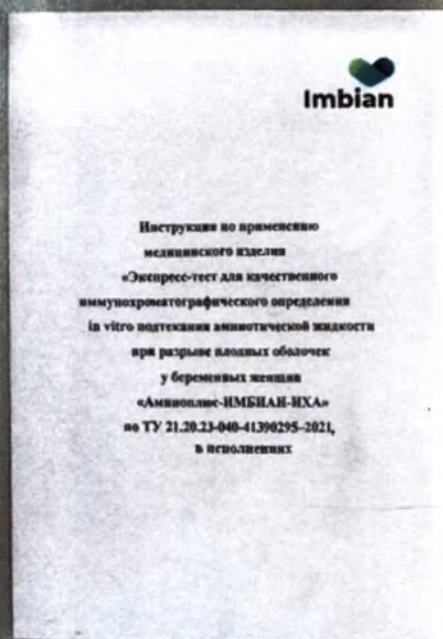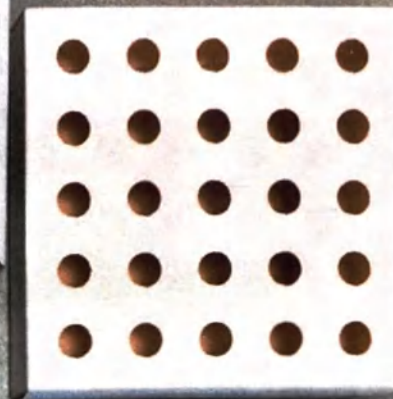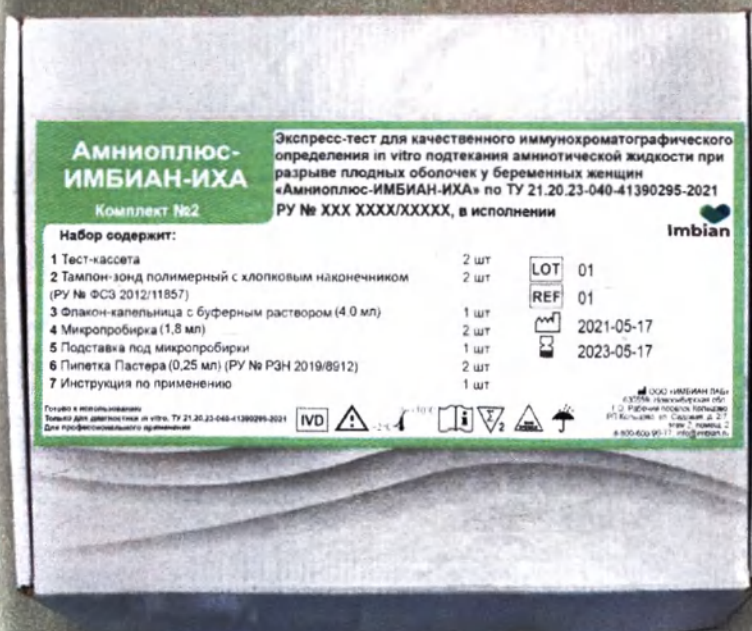

Комплект 3

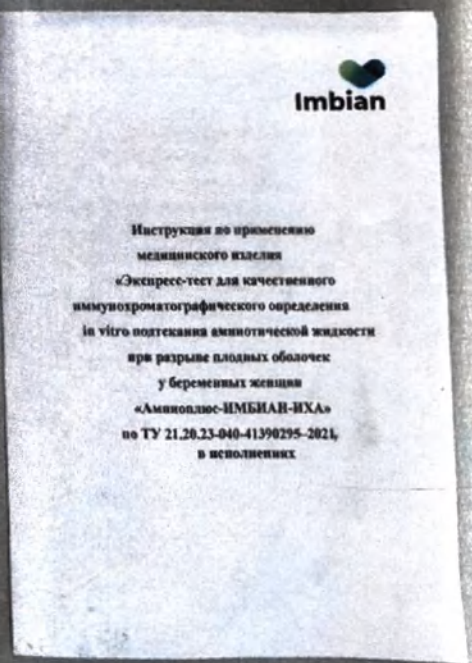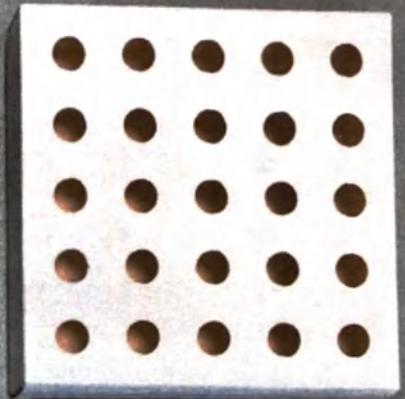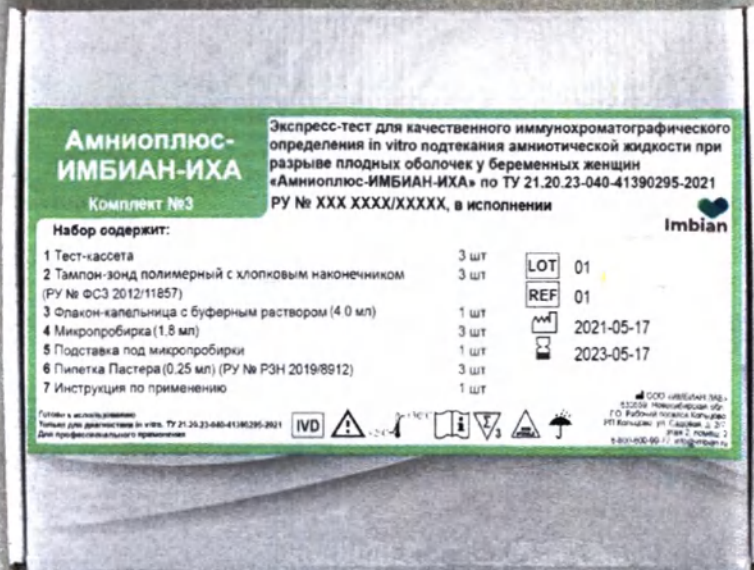

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX, в исполнении


Imbian

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

1 шт	LOT	01
1 шт	REF	01
1 шт		2021-05-17
1 шт		2023-05-17

Готово к использованию
Тепло для диагностики *in vitro* ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630256, Новосибирская обл.
г.о. Рыбинск, пос.г.о. Колызово
ИП Колызово, ул. Садовая, д. 277
РФ 63, пом. 2
8-800-600-8077 info@imbian.ru

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска - 1 шт

2021-05-17 01 01 IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Микропробирка (1,8 мл) - 1 шт.

2021-05-17 01 01 IVD

Imbian

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro подтекания амниотической жидкости
при разрыве плодных оболочек
у беременных женщин
«Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021,
в исполнении

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

3 шт

3 шт

1 шт

3 шт

1 шт

1 шт

LOT 01

REF 01


2021-05-17

2023-05-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «Имбиан» (АО)
«СЗСЗ» производственное предприятие
Г.О. Рабочий поселок Копылово
РП Копылово, ул. Садовая, д. 2/7
Пит. 2, этаж 2
6 800 000 00 77 info@imbian.ru

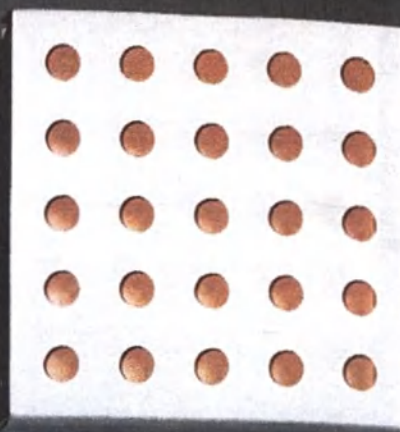

Imbian

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro подтекания амниотической жидкости
при разрыве плодных оболочек
у беременных женщин
«Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021,
в исполнениях

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска - 1 шт
2021-05-17 2023-05-17 IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска - 1 шт

2021-05-17 2023-05-17 IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Микропробирка (1,8 мл) - 3 шт.

2021-05-17 2023-05-17 IVD



Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX, в исполнении




Набор содержит:



- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

10 шт	LOT	01
10 шт	REF	01
1 шт		2021-05-17
10 шт		2023-05-17
1 шт		
1 шт		

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН-РА»
630058, Новосибирская обл.
г. Омск, ул. Горького, 10
РП «Сибирь» от Сибирского
РП «Сибирь» от Сибирского
РП «Сибирь» от Сибирского
8-800-000-10-11 info@imbian.ru

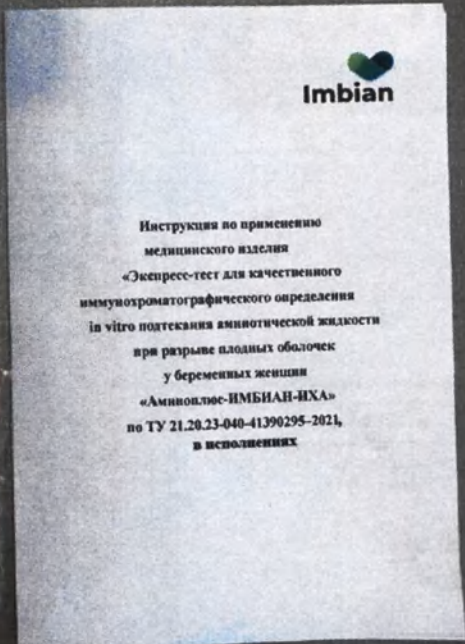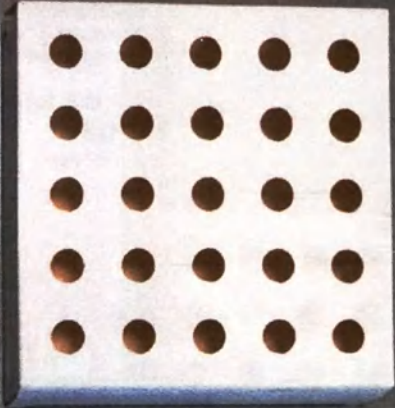

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №7

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXXX, в исполнении




Набор содержит:

1 Тест-полоска	25 шт	LOT	01
2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)	25 шт	REF	01
3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)	1 шт		2021-05-17
4 Микропробирка (1,8 мл)	25 шт		2023-05-17
5 Подставка под микропробирки	1 шт		
6 Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
632669, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колпашово
РП Колпашово ул. Садовая д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

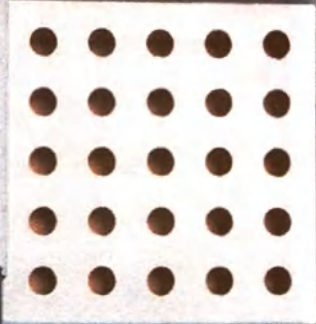

Инструкция по применению
медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro подтекания амниотической жидкости
при разрыве плодных оболочек
у беременных женщин
«Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021,
в исполнении

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №8

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021 РУ № XXX XXXX/XXXX, в исполнении



Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (РУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

50 шт
50 шт
2 шт
50 шт
2 шт
1 шт


LOT 01

REF 01


2021-05-17

2023-05-17

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
400560 Новокузнецкая обл.
г. Новокузнецк, ул. Свободы д. 2/7,
этаж 2, подъезд 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

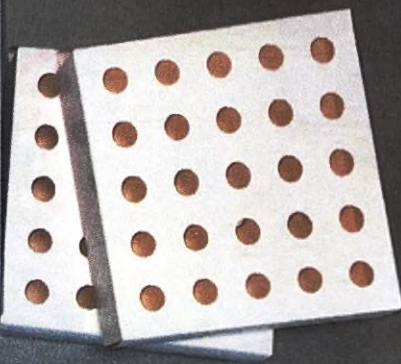

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска - 1 шт

2021-05-17 2023-05-17 IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Микропробирка (1,8 мл) - 50 шт.

2021-05-17 2023-05-17 LOT 01 IVD



Инструкция по применению
маломощного класса
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro подтекания амниотической жидкости
при разрыве плодных оболочек
у беременных женщин
«Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021,
в исполнении

Амниоплюс- ИМБИАН-ИХА

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

TU 21.20.23-040-41390295-2021

**Количество
наборов**

шт

LOT 01

 2021-05-17

REF 01

 2023-05-17

Замораживать
не допускается
Допускается
транспортирование при
температуре от 2 до 30°C

+2°C  +30°C



IVD

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического
определения in vitro подтекания
амниотической жидкости при разрыве
плодных оболочек у беременных женщин
«Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021,
в исполнениях

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Тринадцатый лист 06

Общество с ограниченной ответственностью «Амбианс Лаб»
 Генеральный директор ООО «Амбианс Лаб»
 Филиппов В.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В.\

2022 г.

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021, в исполнениях»

Макет маркировки

Комплект 1

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 1 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Набор содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)
- 7 Инструкция по применению

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

!

-2°C

+30°C

IVD

!

!

!

!

!

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ПУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 1 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Комплект 2

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 2 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Набор содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)
- 7 Инструкция по применению

2 шт

2 шт

1 шт

2 шт

1 шт

2 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD

!

-2°C

+30°C

IVD

!

!

!

!

!

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ПУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 2 шт.

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Комплект 3

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 3 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Набор содержит:

- 1 Тест-кассета
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)
- 7 Инструкция по применению

3 шт

3 шт

1 шт

3 шт

1 шт

3 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro, ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ПУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка Пастера (0,25 мл) - 3 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX IVD

Комплект 4

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 1 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro, ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD


Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX IVD

Комплект 5

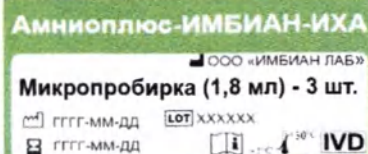


Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Набор содержит:

1 Тест-полоска	3 шт	LOT	XXXXXX
2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)	3 шт	REF	XX-XXX/X
3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
4 Микропробирка (1,8 мл)	3 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Подставка под микропробирки	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Инструкция по применению	1 шт		



Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630550, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА



Комплект 6




Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Набор содержит:

1 Тест-полоска	10 шт	LOT	XXXXXX
2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)	10 шт	REF	XX-XXX/X
3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
4 Микропробирка (1,8 мл)	10 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5 Подставка под микропробирки	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6 Инструкция по применению	1 шт		



Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА



Комплект 7

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 25 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №7

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

25 шт

25 шт

1 шт

25 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД IVD

Комплект 8

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 50 шт.

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Комплект №8

Набор содержит:

- 1 Тест-полоска
- 2 Тампон-зонд полимерный с хлопковым наконечником (ПУ № ФСЗ 2012/11857)
- 3 Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл)
- 4 Микропробирка (1,8 мл)
- 5 Подставка под микропробирки
- 6 Инструкция по применению

50 шт

50 шт

2 шт

50 шт

2 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-040-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77 info@imbian.ru

Imbian

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором (4,0 мл) - 1 шт.

LOT XXXXXX
ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД IVD

Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro подтекания амниотической жидкости при разрыве плодных оболочек у беременных женщин «Амниоплюс-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-040-41390295-2021, в исполнениях

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-040-41390295-2021

Количество наборов

шт

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Imbian

Замораживать не допускается
Допускается транспортирование при температуре от 2 до 30°C

+2°C +30°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 6
(шесть) листов

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

