



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Устройства для ангиографии и эмболизации»


Medos International SARL (Медос Интернешнл САРЛ), Швейцария

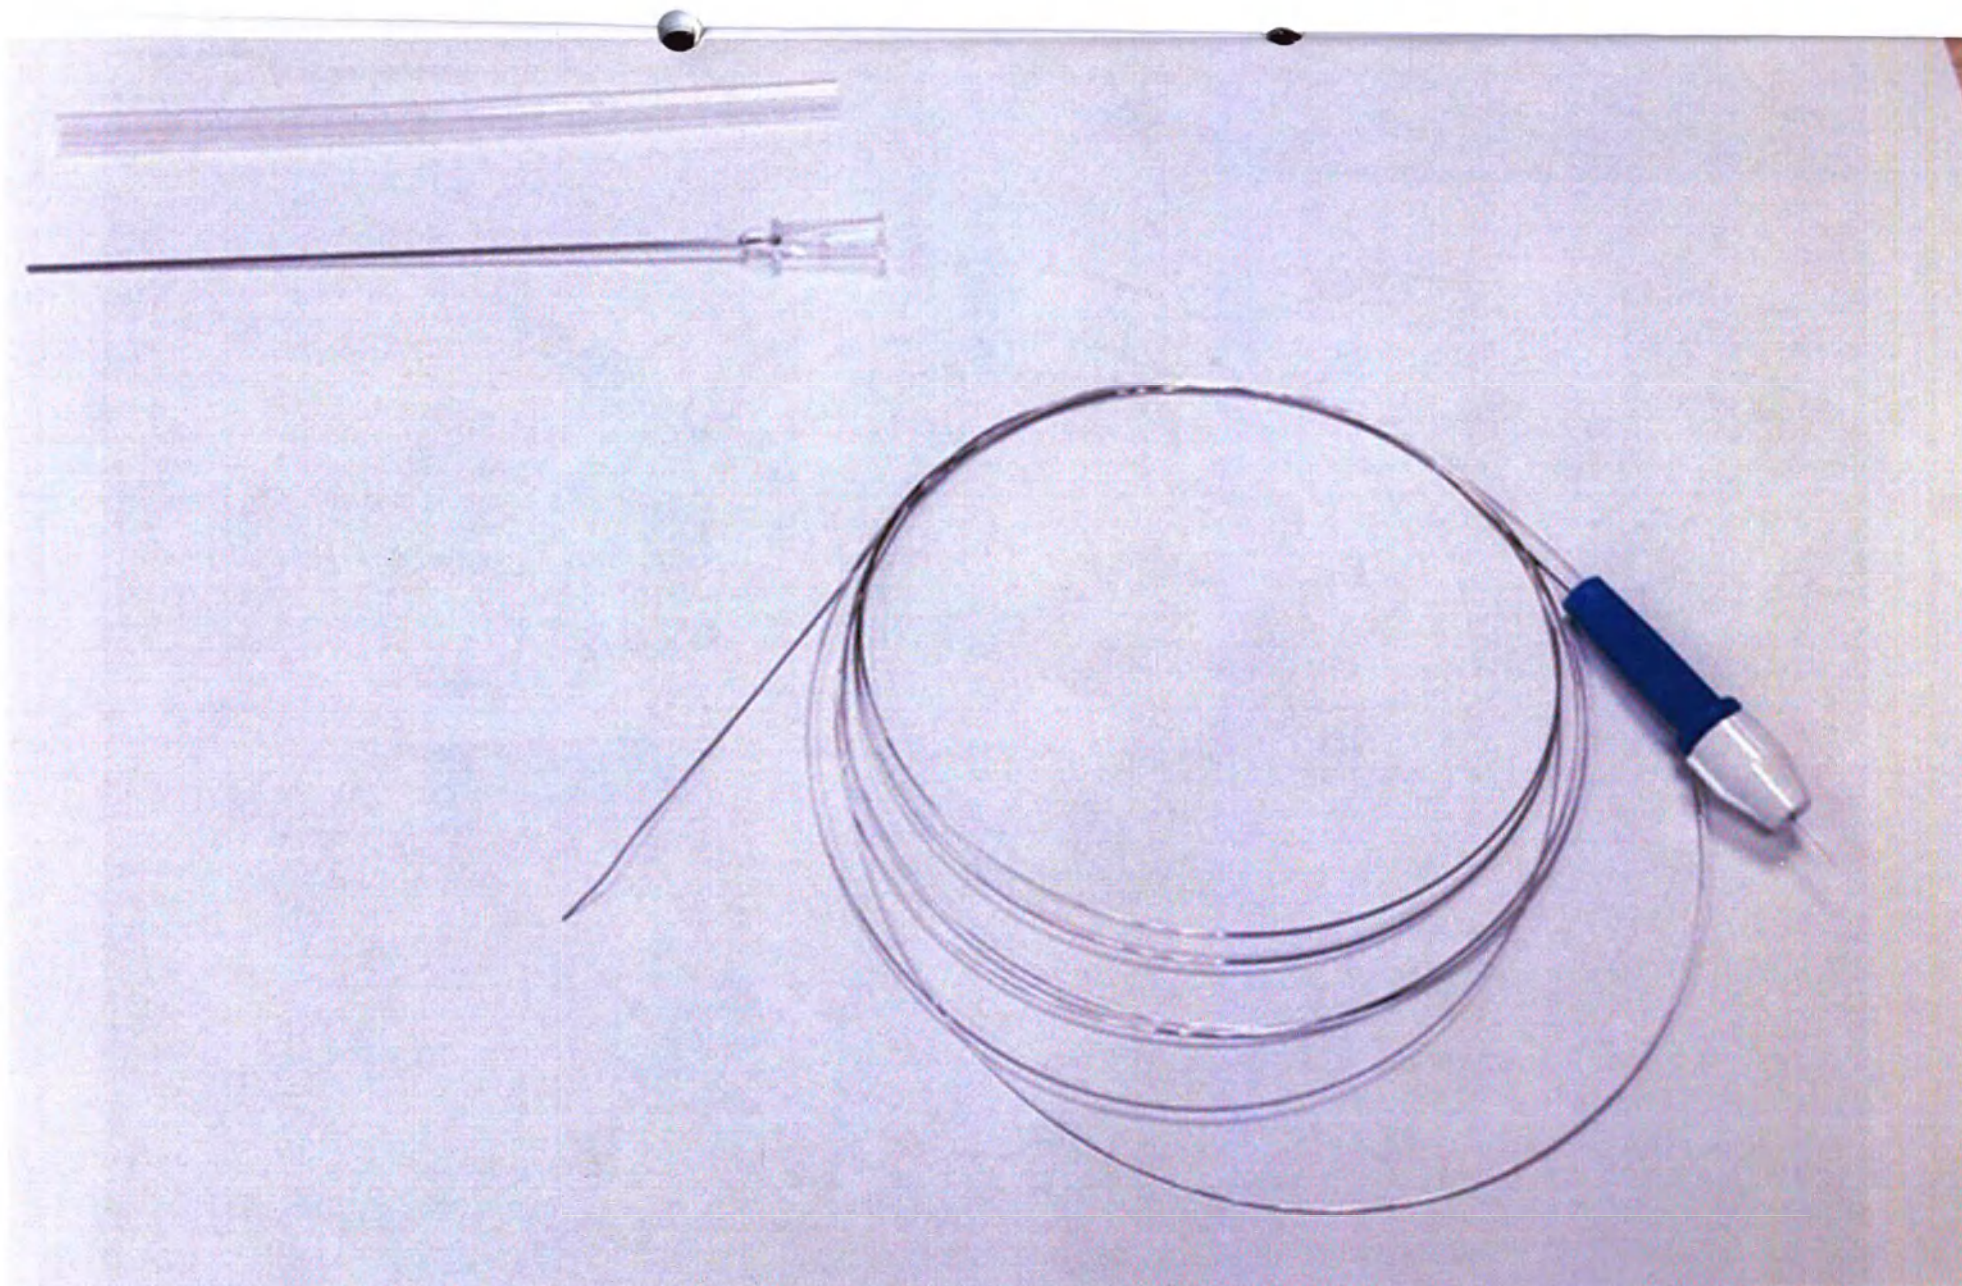

Проводник управляемый AGILITY с поворотным устройством и интродьюсером: AGILITY 16, наружный диаметр 0,040 см, длина 205 см, длина конически суживающейся части 33 см (внешний вид изделия – проводника, поворотного устройства и интродьюсера)

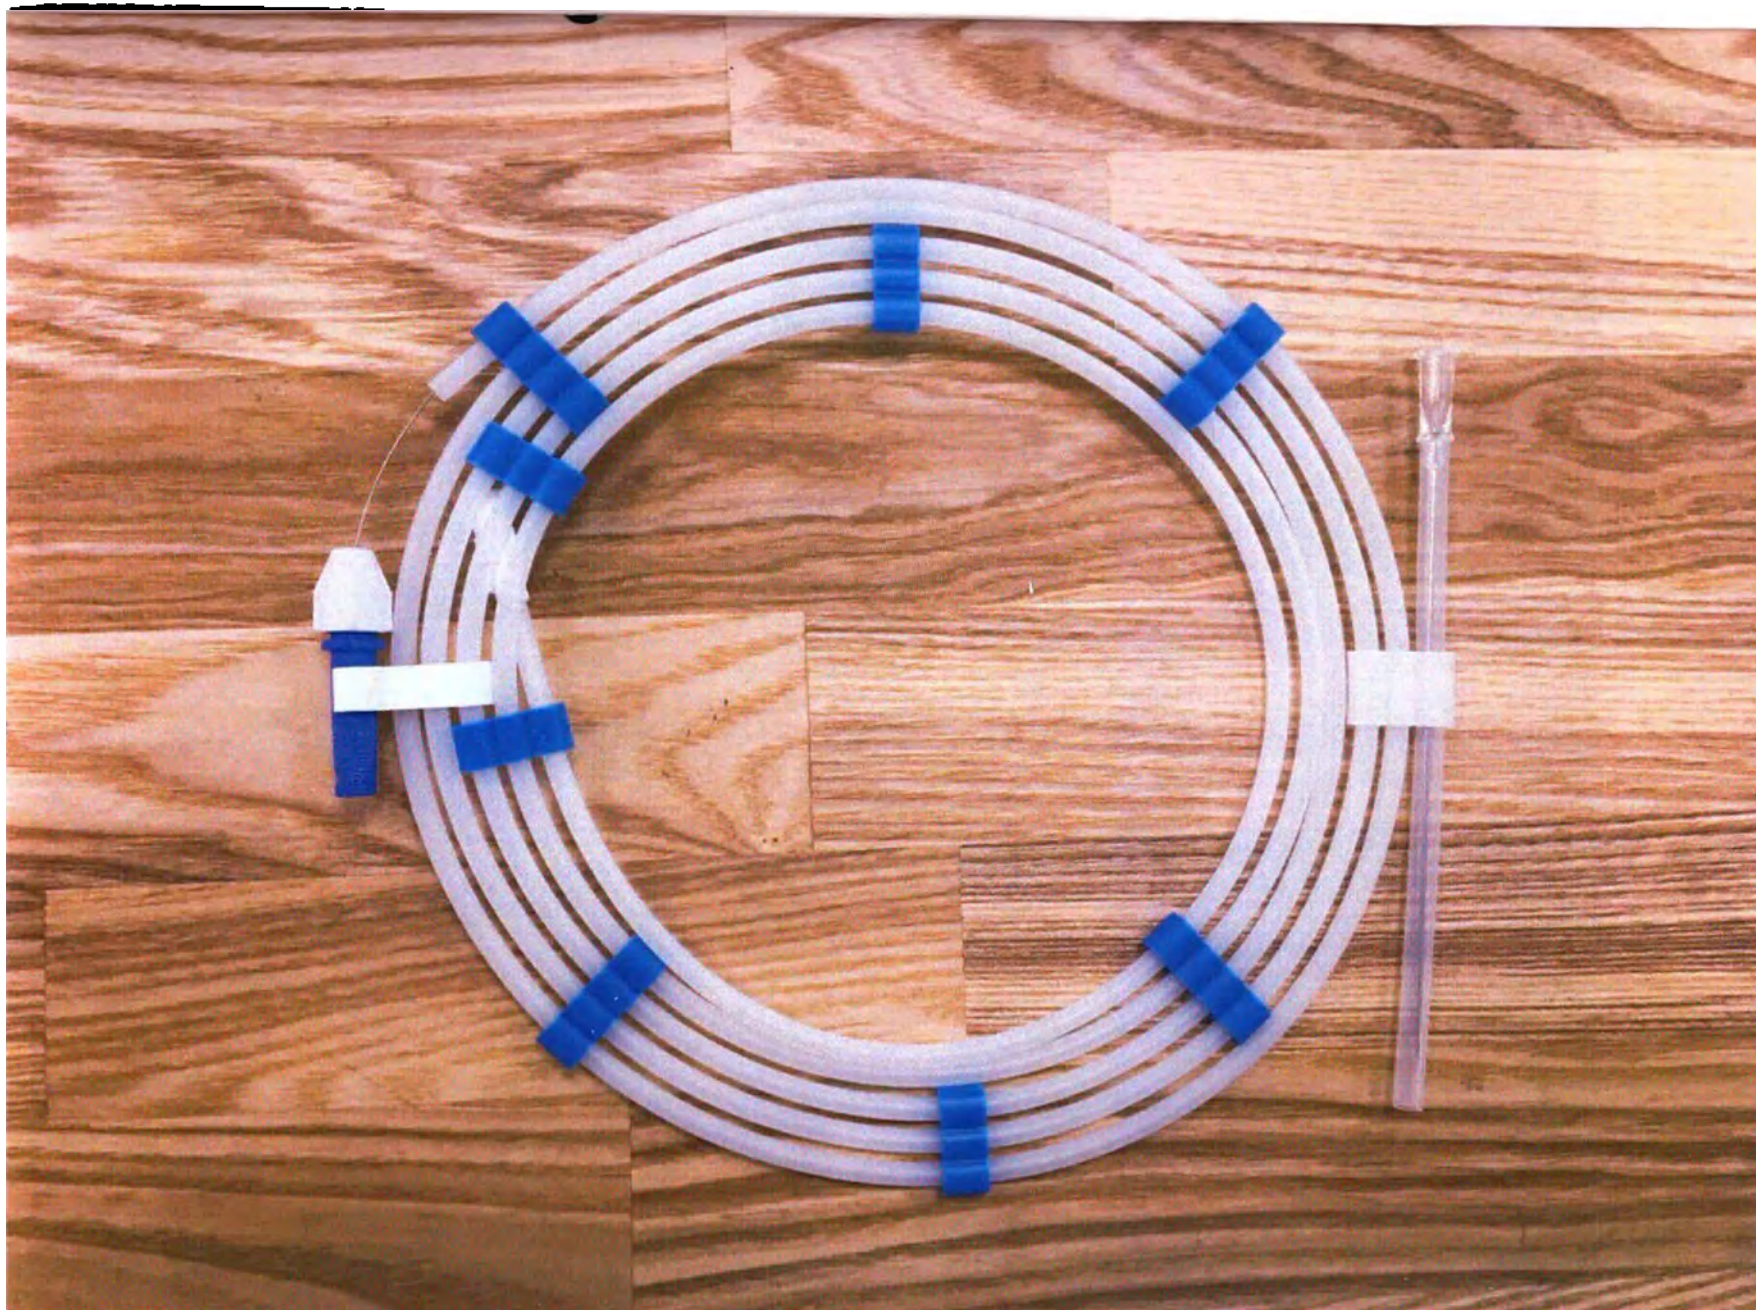

Проводник управляемый AGILITY с поворотным устройством и интродьюсером: AGILITY 16, наружный диаметр 0,040 см, длина 205 см, длина конически суживающейся части 33 см (внешний вид изделия в упаковочной трубке с зажимами, поворотным устройством и интродьюсером)

 CERENOVUS
CENTRE FOR ENERGY RESEARCH AND INNOVATION

QTY	DESCRIPTION	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...

.016"
(.40mm)

REF 614-581

LOT J8406J

2022-05-31

Contents: 1 guidewire, 1 torquing device and 1 introducer



STOCK: LCN (overseas) 407689

Tip Flexibility Standard

REF 614-581

LOT JB409.1

LCN3 REV. 0

Steerable Guidewire with Hydrophilic Coating

[illegible]

Contents: 1 guidewire, 1 forking device and 1 introducer

[illegible][illegible]

Проводник управляемый AGILITY с поворотным устройством и интродьюсером: AGILITY 16, наружный диаметр 0,040 см, длина 205 см, длина конически суживающейся части 33 см (внутренняя упаковка - пакет)


LICENT DEV B

Tip Flexibility Standard

[illegible][illegible]

CERENOVUS

PART OF THE *Johnson-Johnson* FAMILY OF COMPANIES

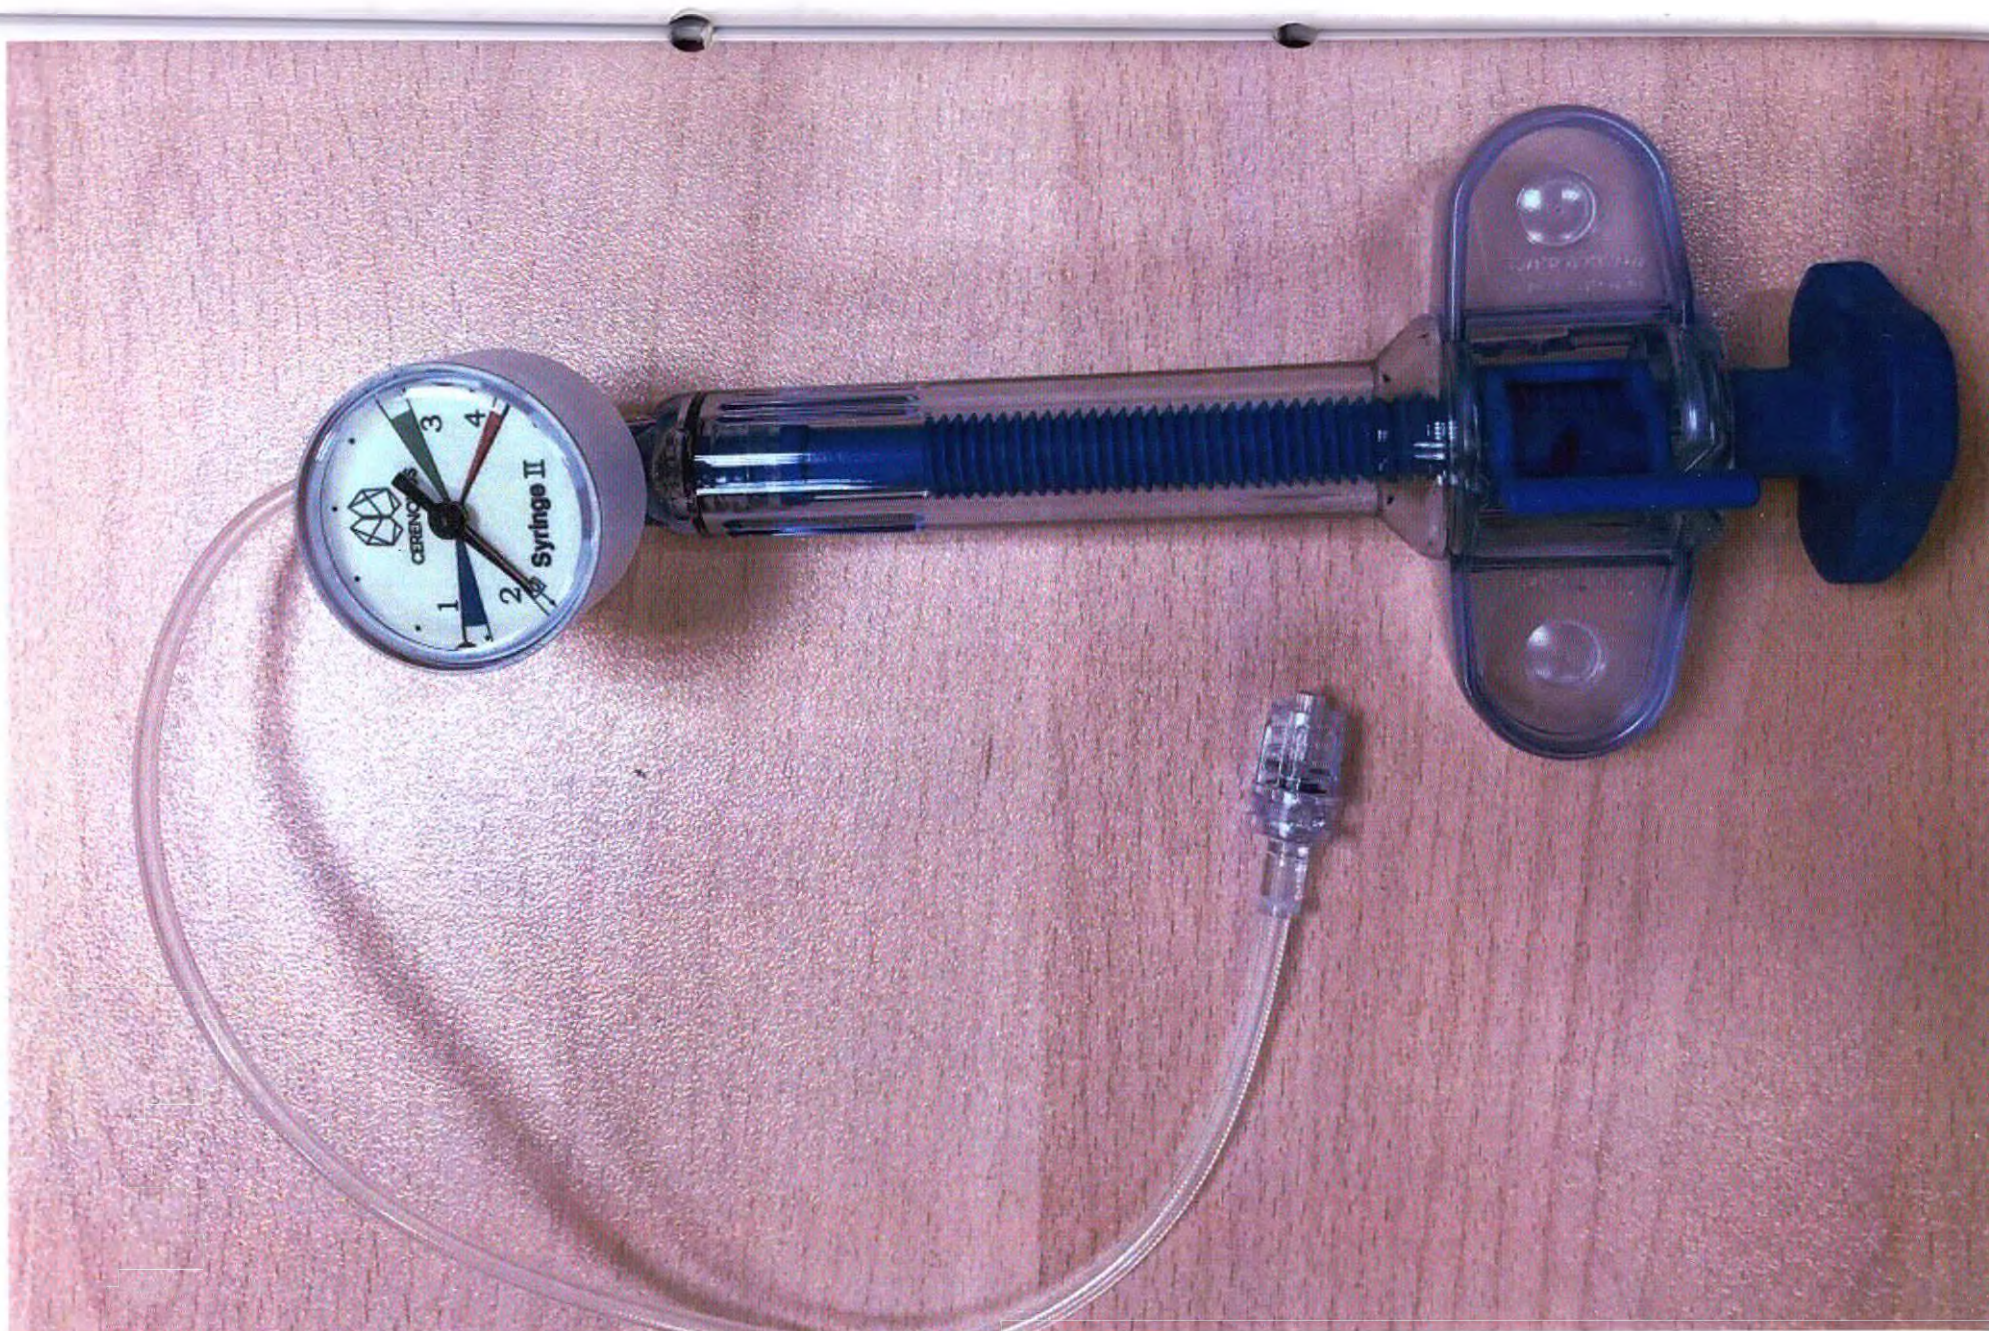


Индефлятор TRUFILL DSC II:

- Шприц с манометром, резьбовым поршнем в сборе с запорным механизмом с фиксатором (внешний вид изделия)




Индефлятор TRUFILL DSC II:

- Шприц с манометром, резьбовым поршнем в сборе с запорным механизмом с фиксатором (внутренняя упаковка – лоток с крышкой)

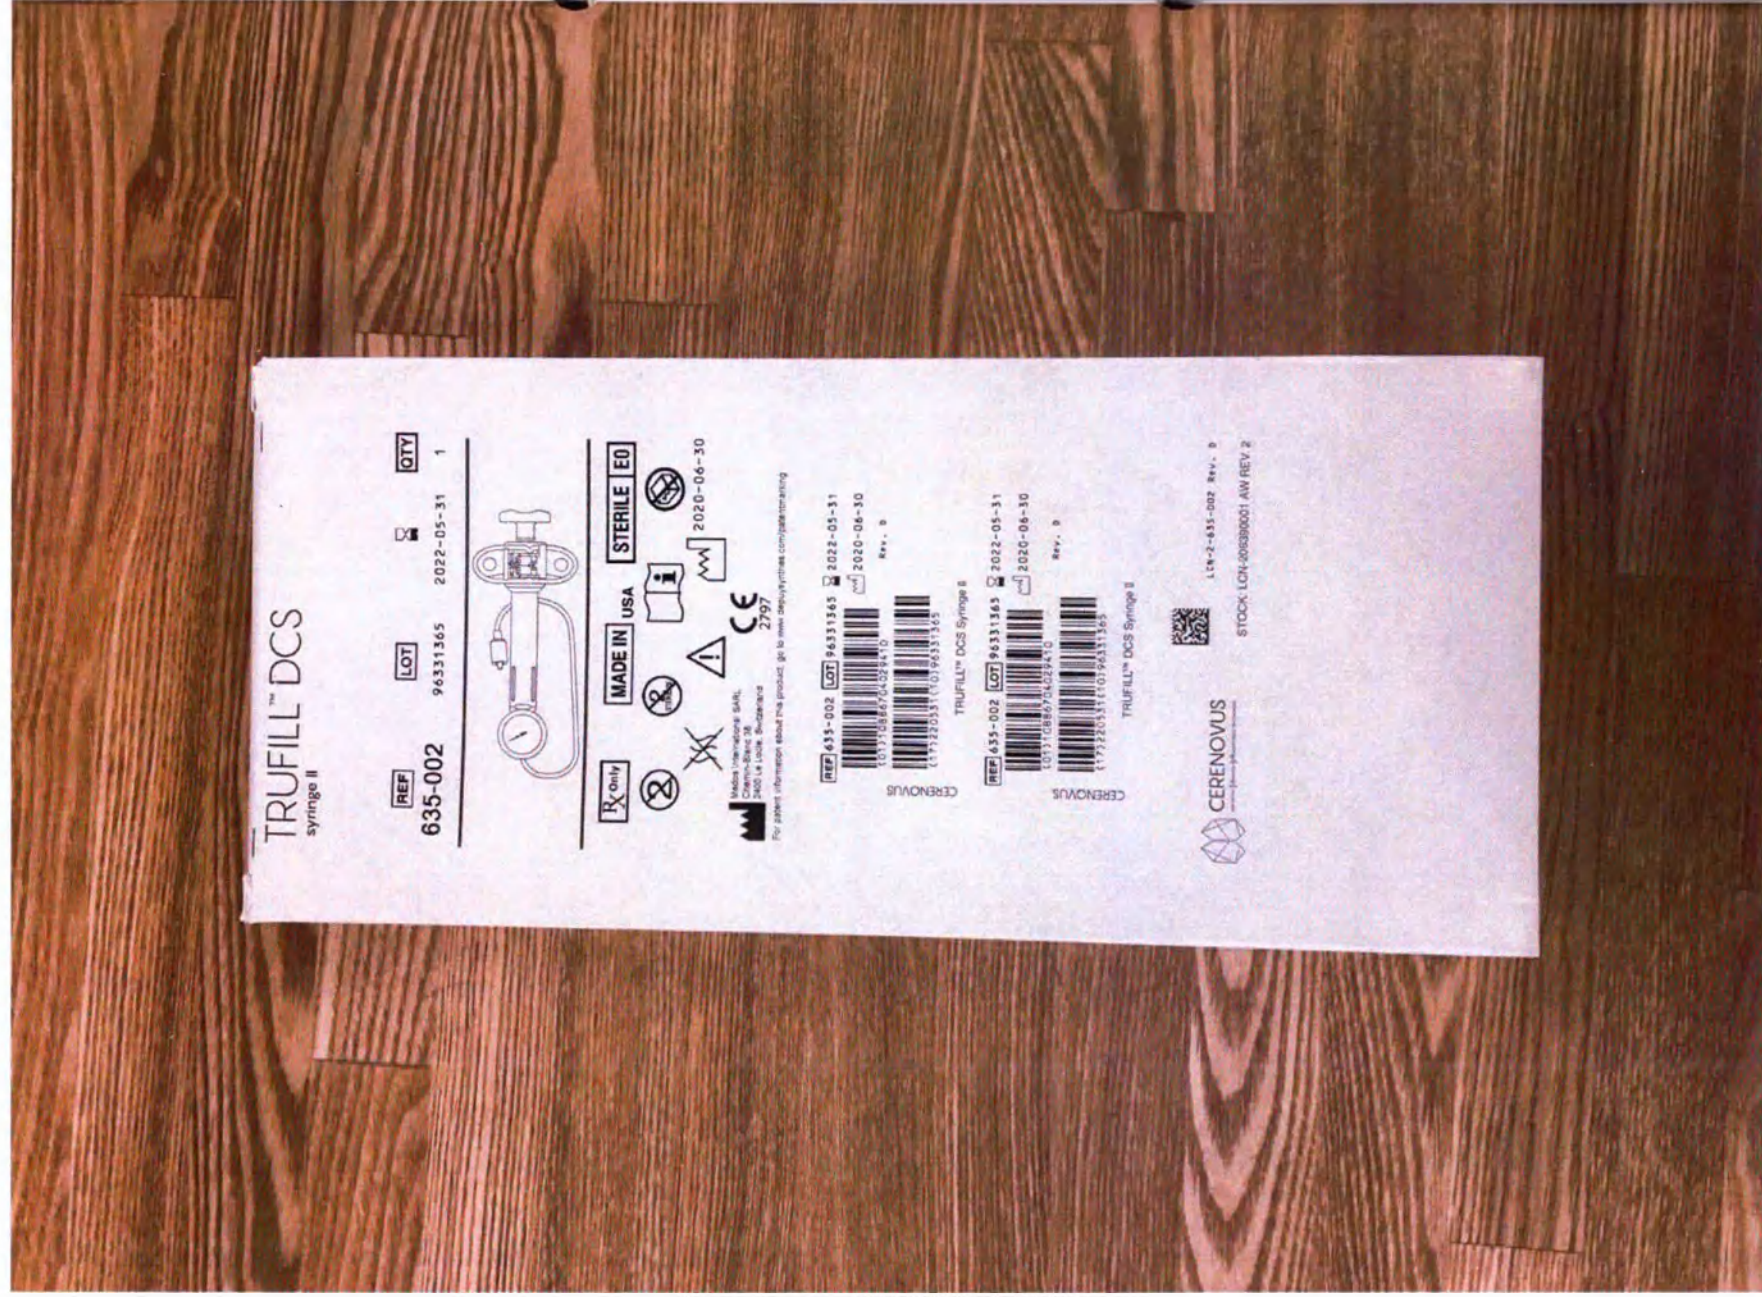


Индефлятор TRUFILL DSC II:

- Шприц с манометром, резьбовым поршнем в сборе с запорным механизмом с фиксатором (индивидуальная коробка)

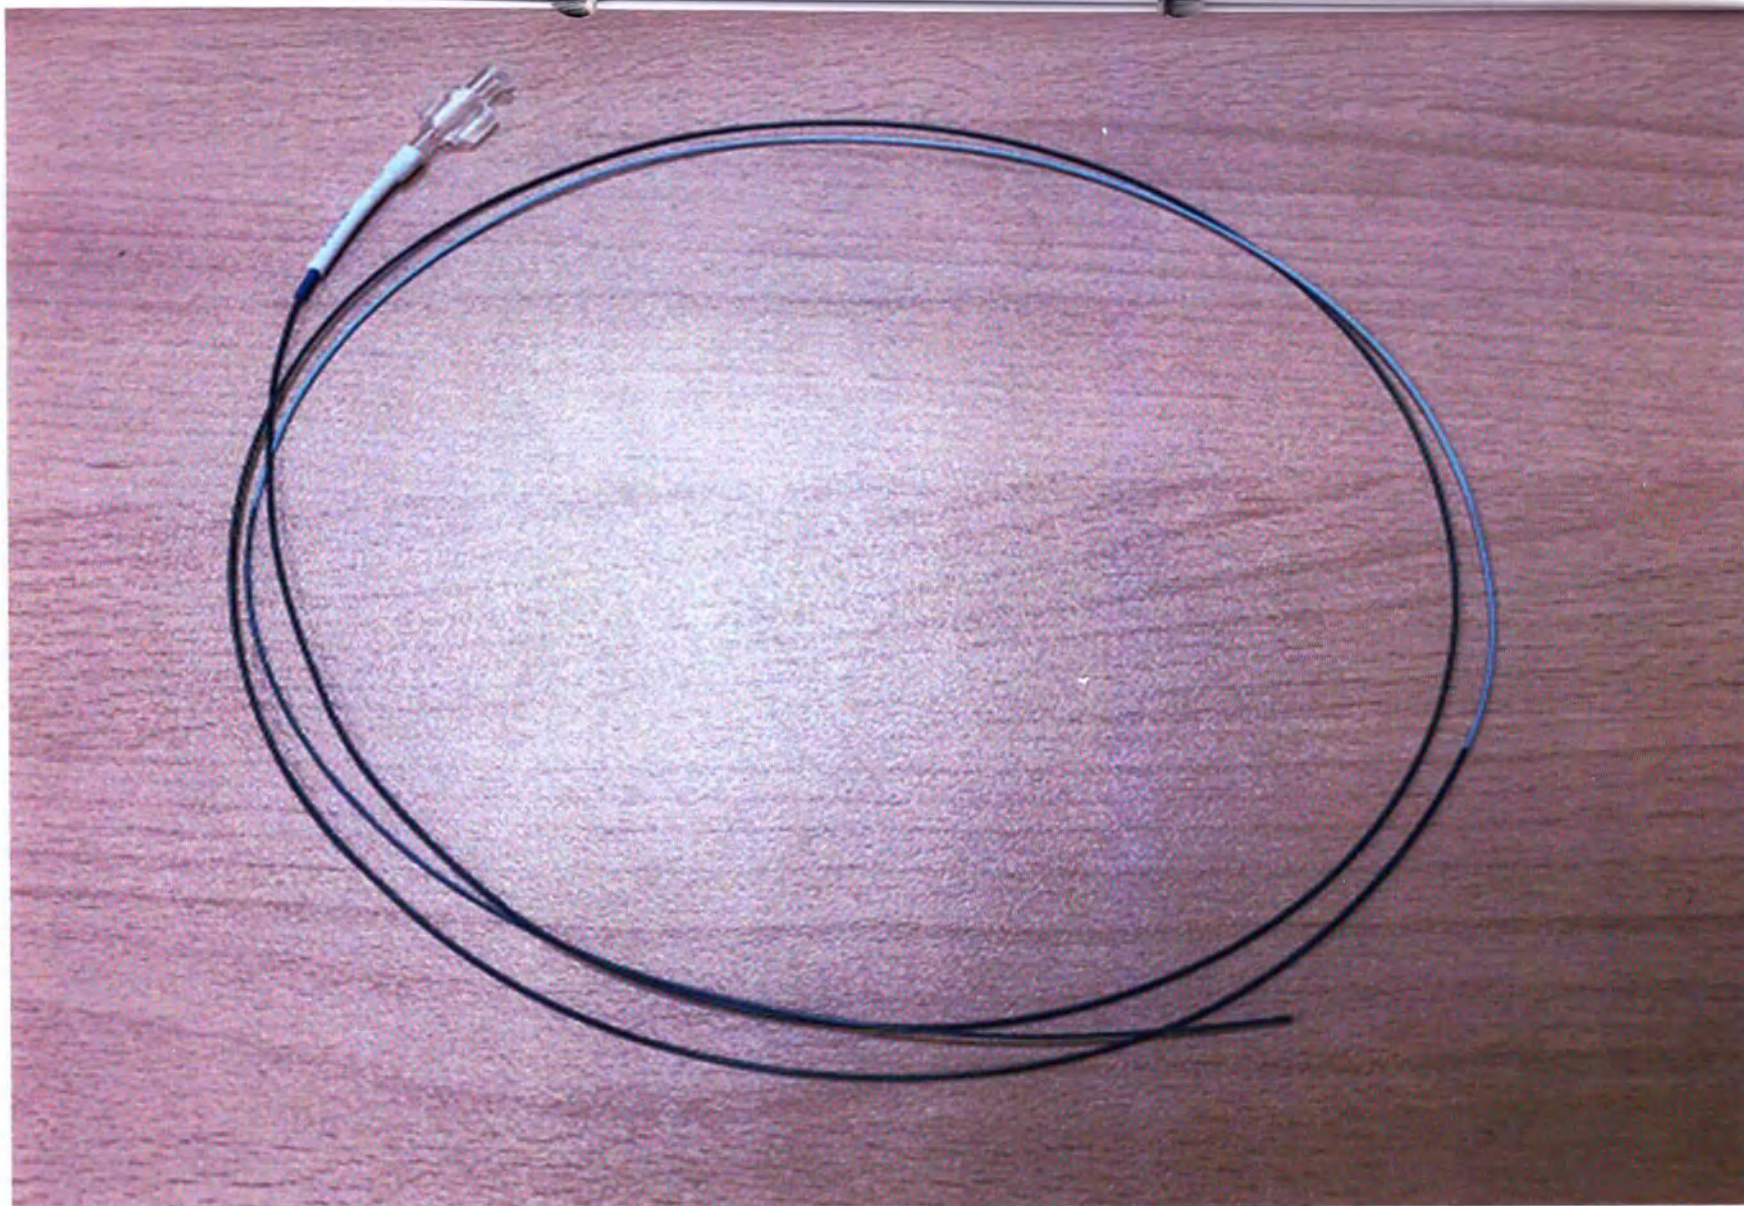


Микрокатетер PROWLER с формирующим мандреном:

- PROWLER Plus, эффективная длина 150 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 1 шт., длина гибкой части 20 см (внешний вид изделия - катетер)

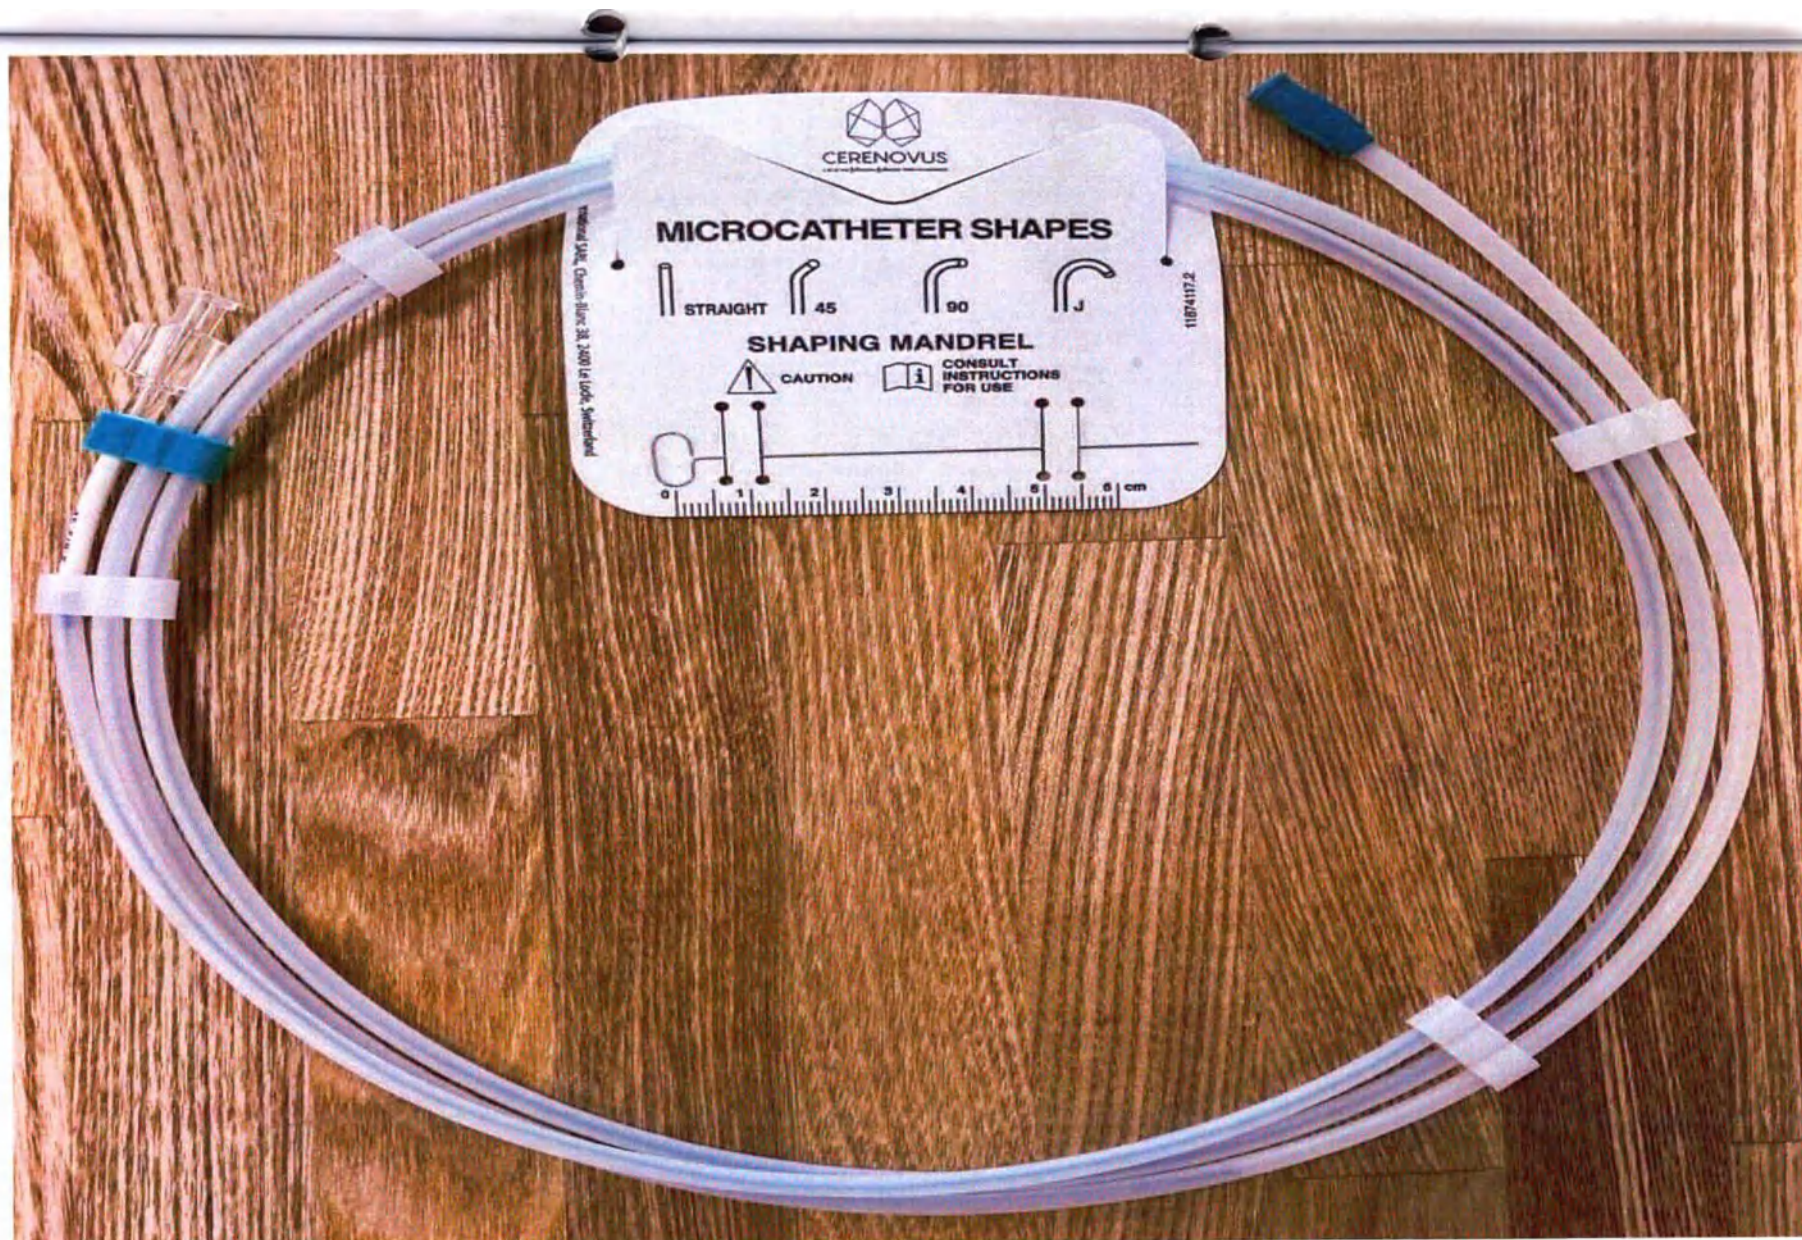


Микрокатетер PROWLER с формирующим мандреном:

- PROWLER Plus, эффективная длина 150 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 1 шт., длина гибкой части 20 см (внешний вид изделия в упаковочной трубке с зажимами и формирующим мандреном на поддерживающем картоне)

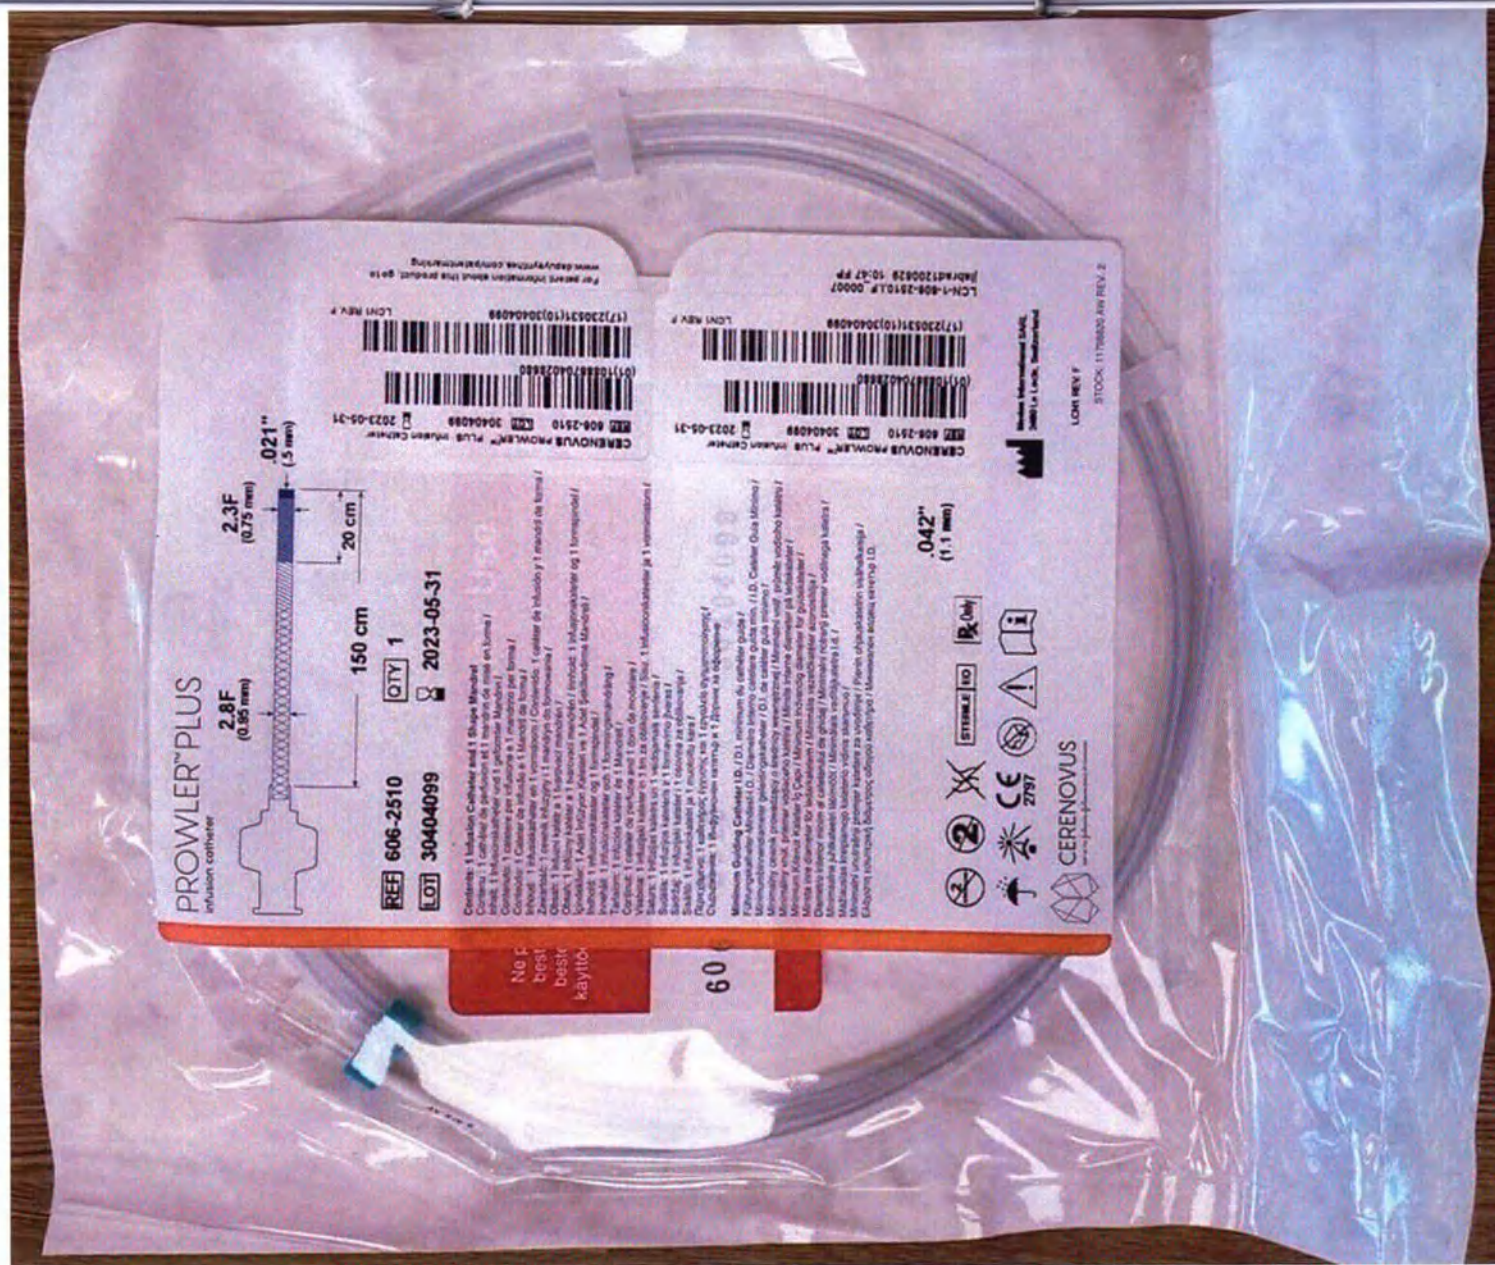


Микрокатетер PROWLER с формирующим мандреном:

- PROWLER Plus, эффективная длина 150 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 1 шт., длина гибкой части 20 см (внутренняя упаковка - пакет)

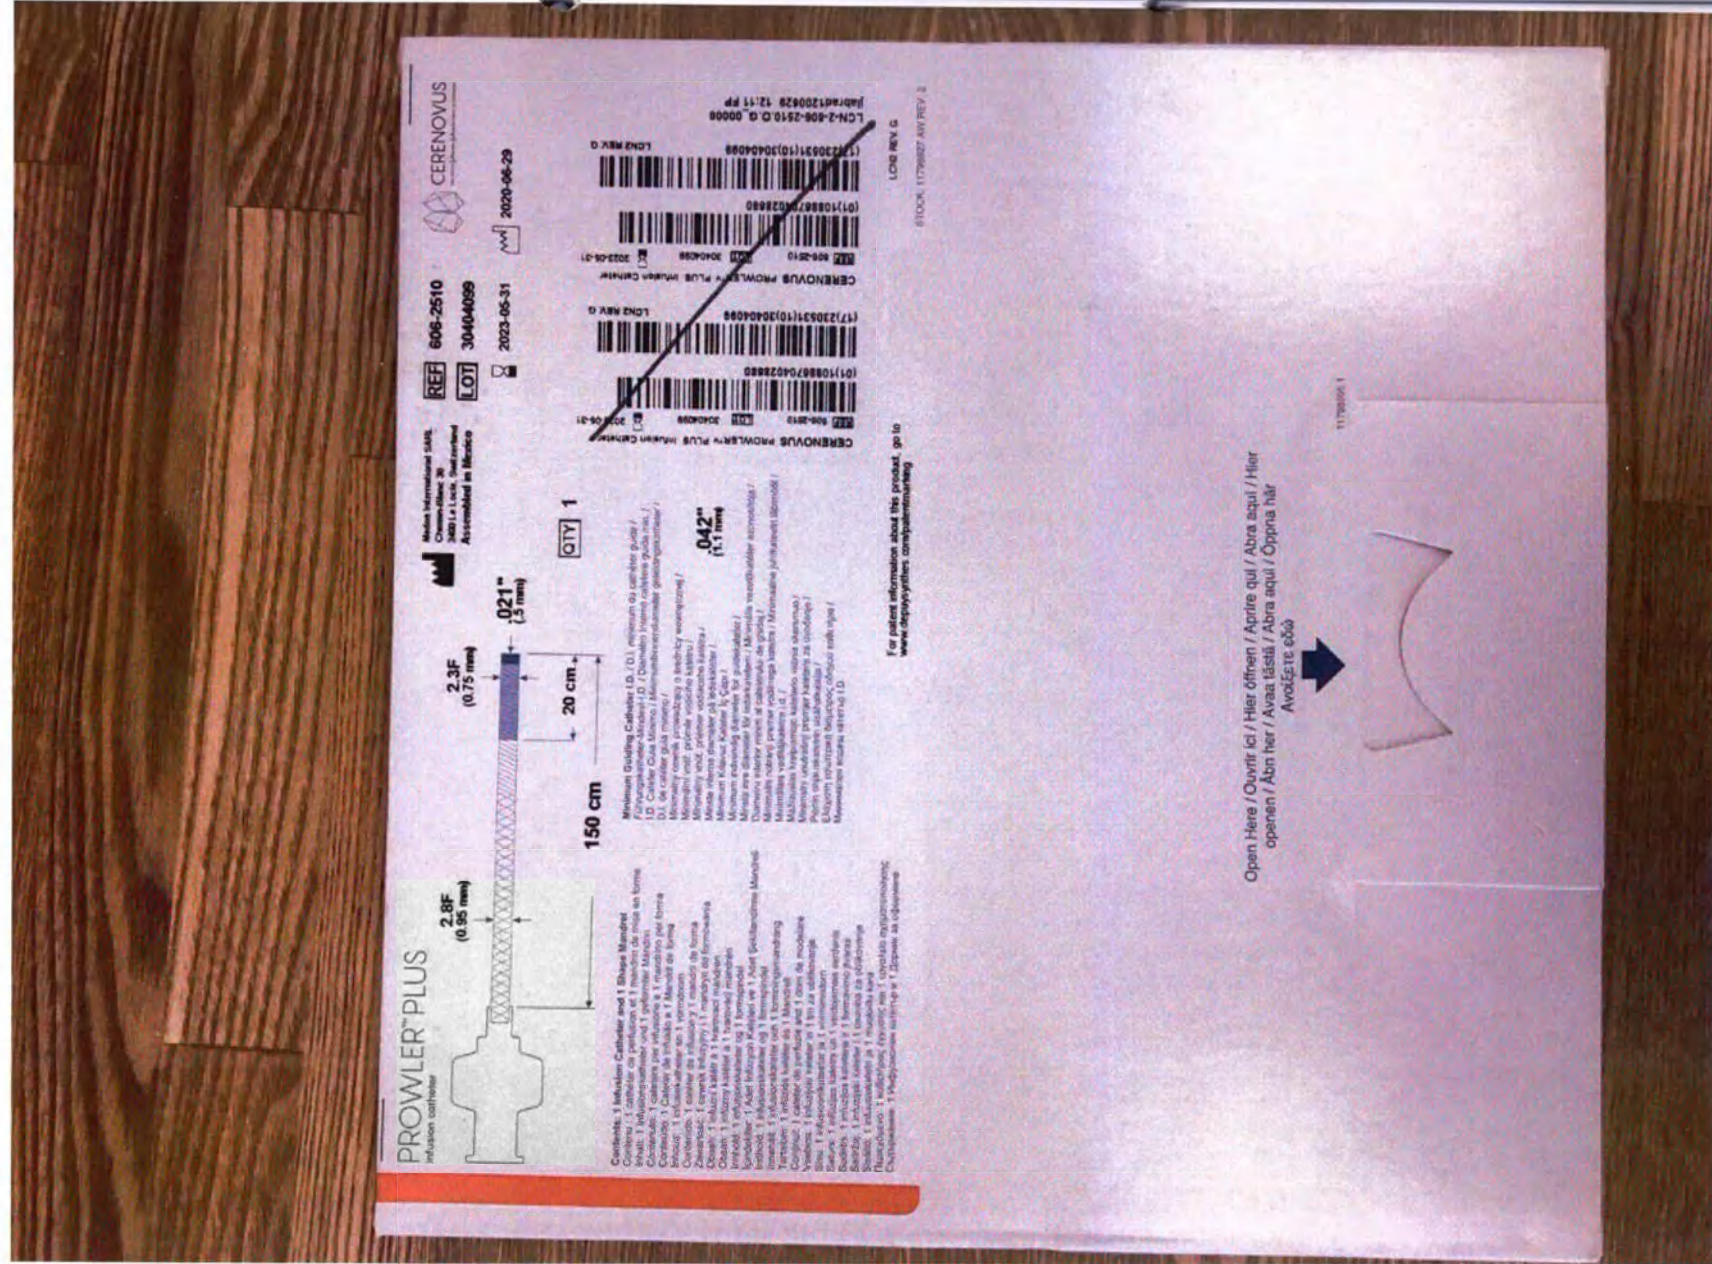


Микрокатетер PROWLER с формирующим мандреном:

- PROWLER Plus, эффективная длина 150 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 1 шт., длина гибкой части 20 см (индивидуальная коробка)

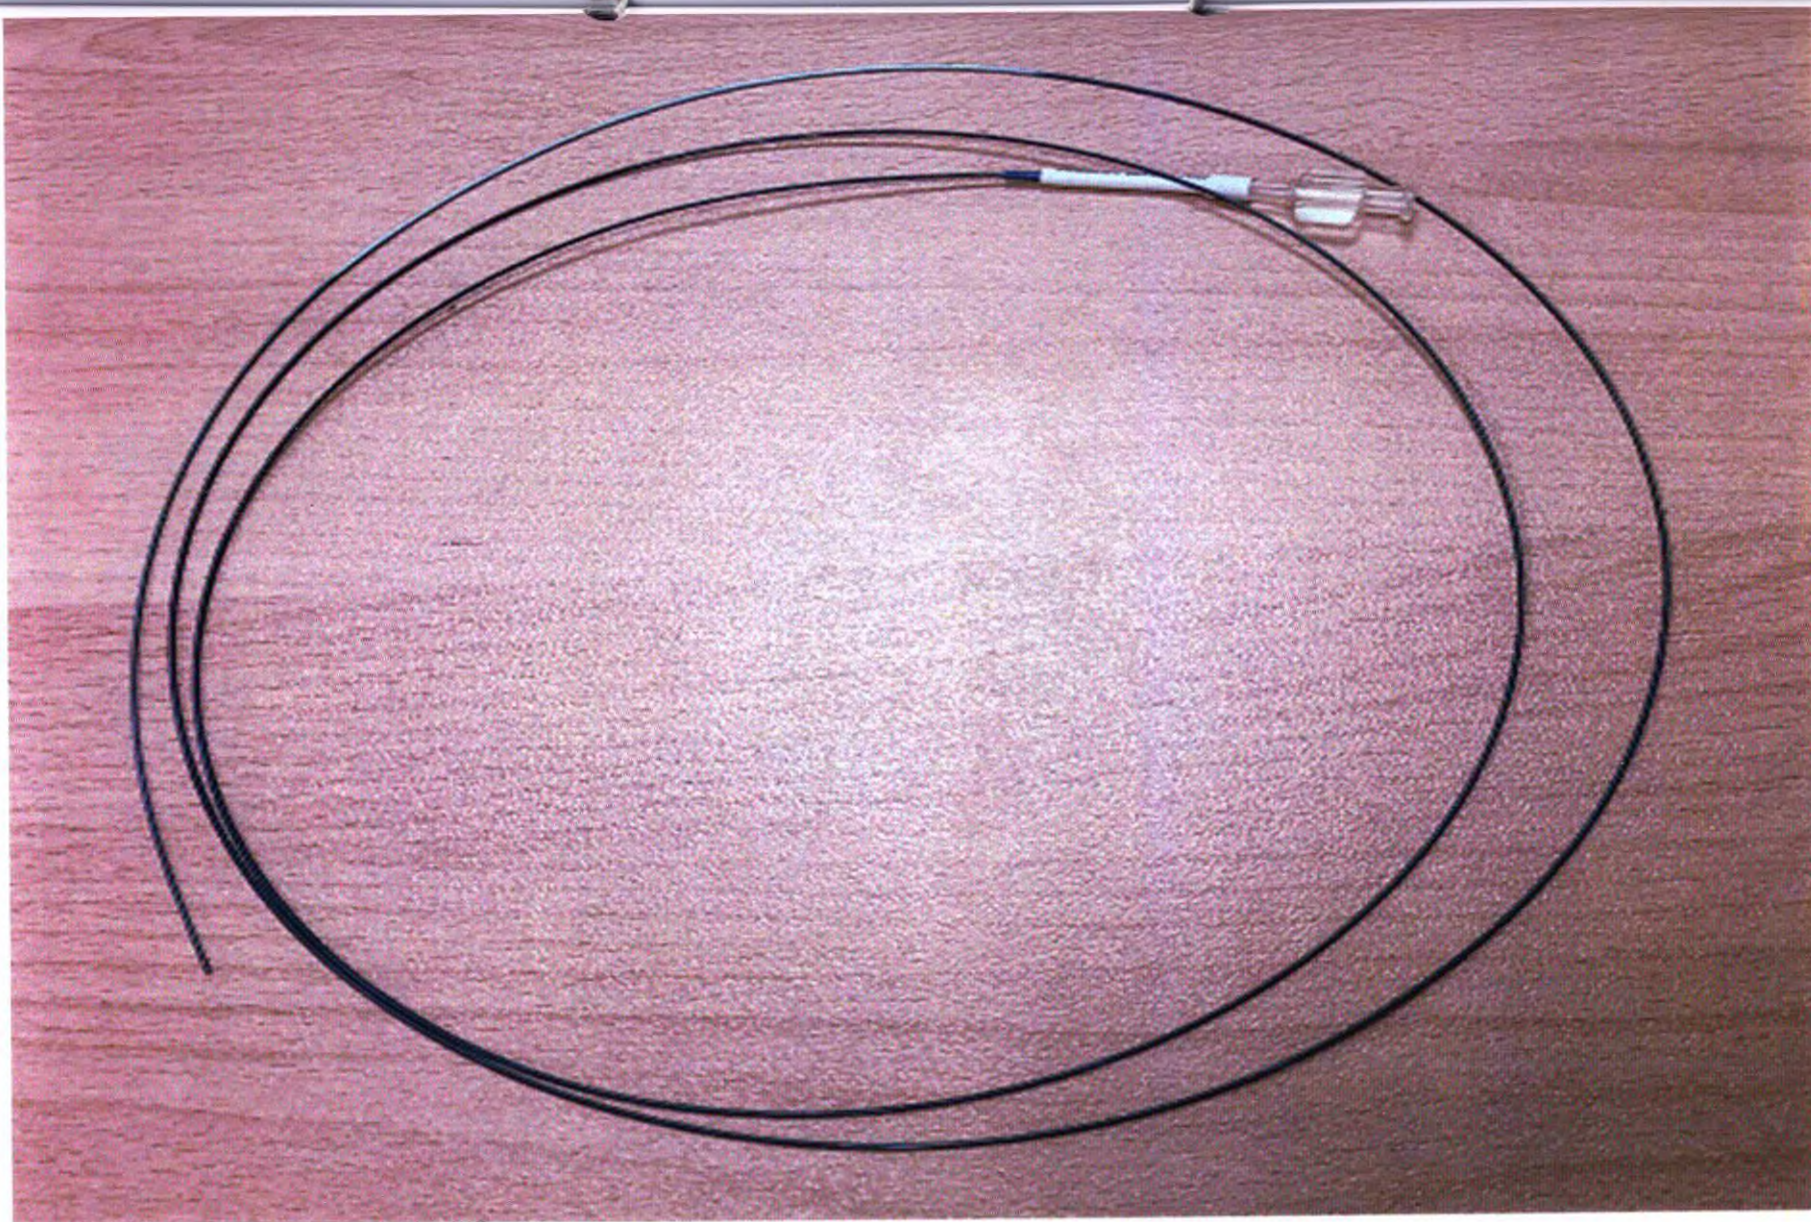


Микрокатетер PROWLER SELECT с формирующим мандреном:

- PROWLER SELECT Plus, эффективная длина 150 см, длина гибкой части 15 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 2 шт. (внешний вид изделия - катетер)

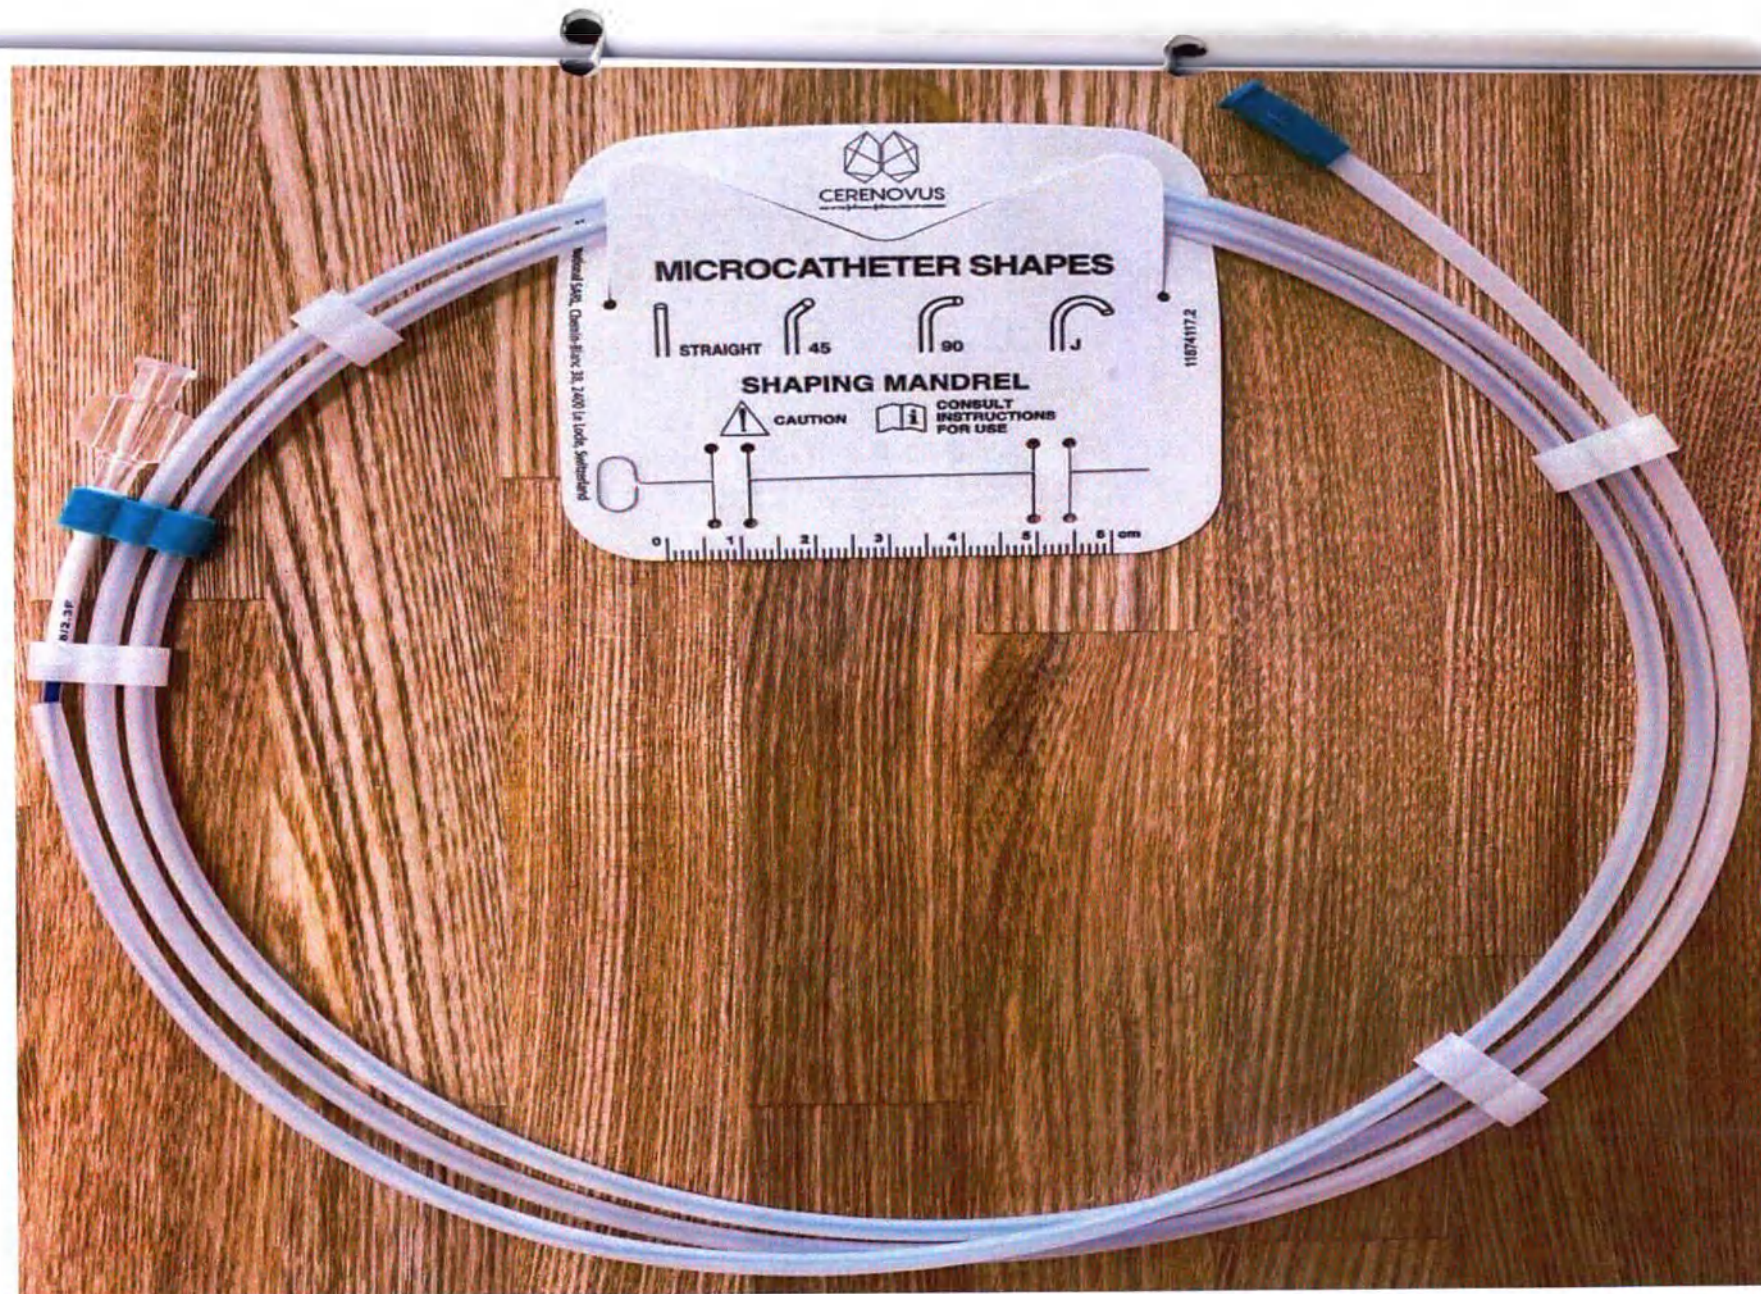


Микрокатетер PROWLER SELECT с формирующим мандреном:

- PROWLER SELECT Plus, эффективная длина 150 см, длина гибкой части 15 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 2 шт. (внешний вид изделия в упаковочной трубке с зажимами и формирующим мандреном на поддерживающем картоне)

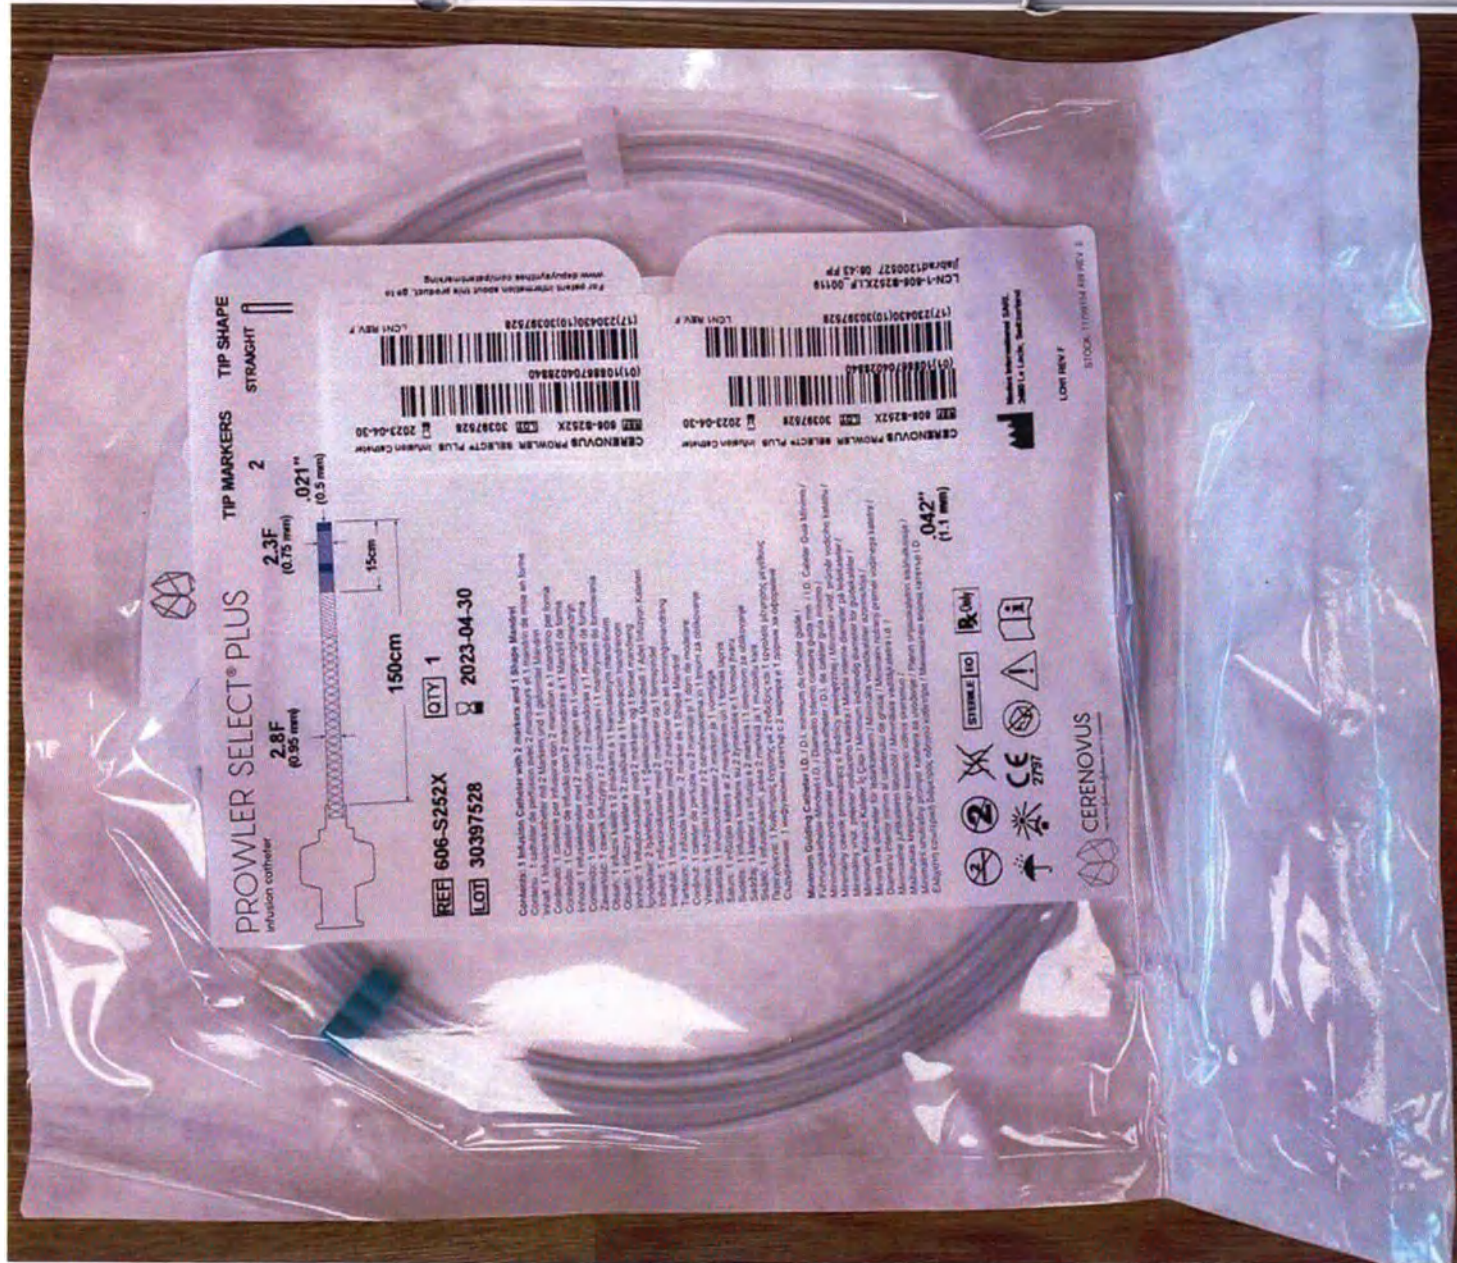

Микрокатетер PROWLER SELECT с формирующим мандреном:

- PROWLER SELECT Plus, эффективная длина 150 см, длина гибкой части 15 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 2 шт. (внутренняя упаковка - пакет)

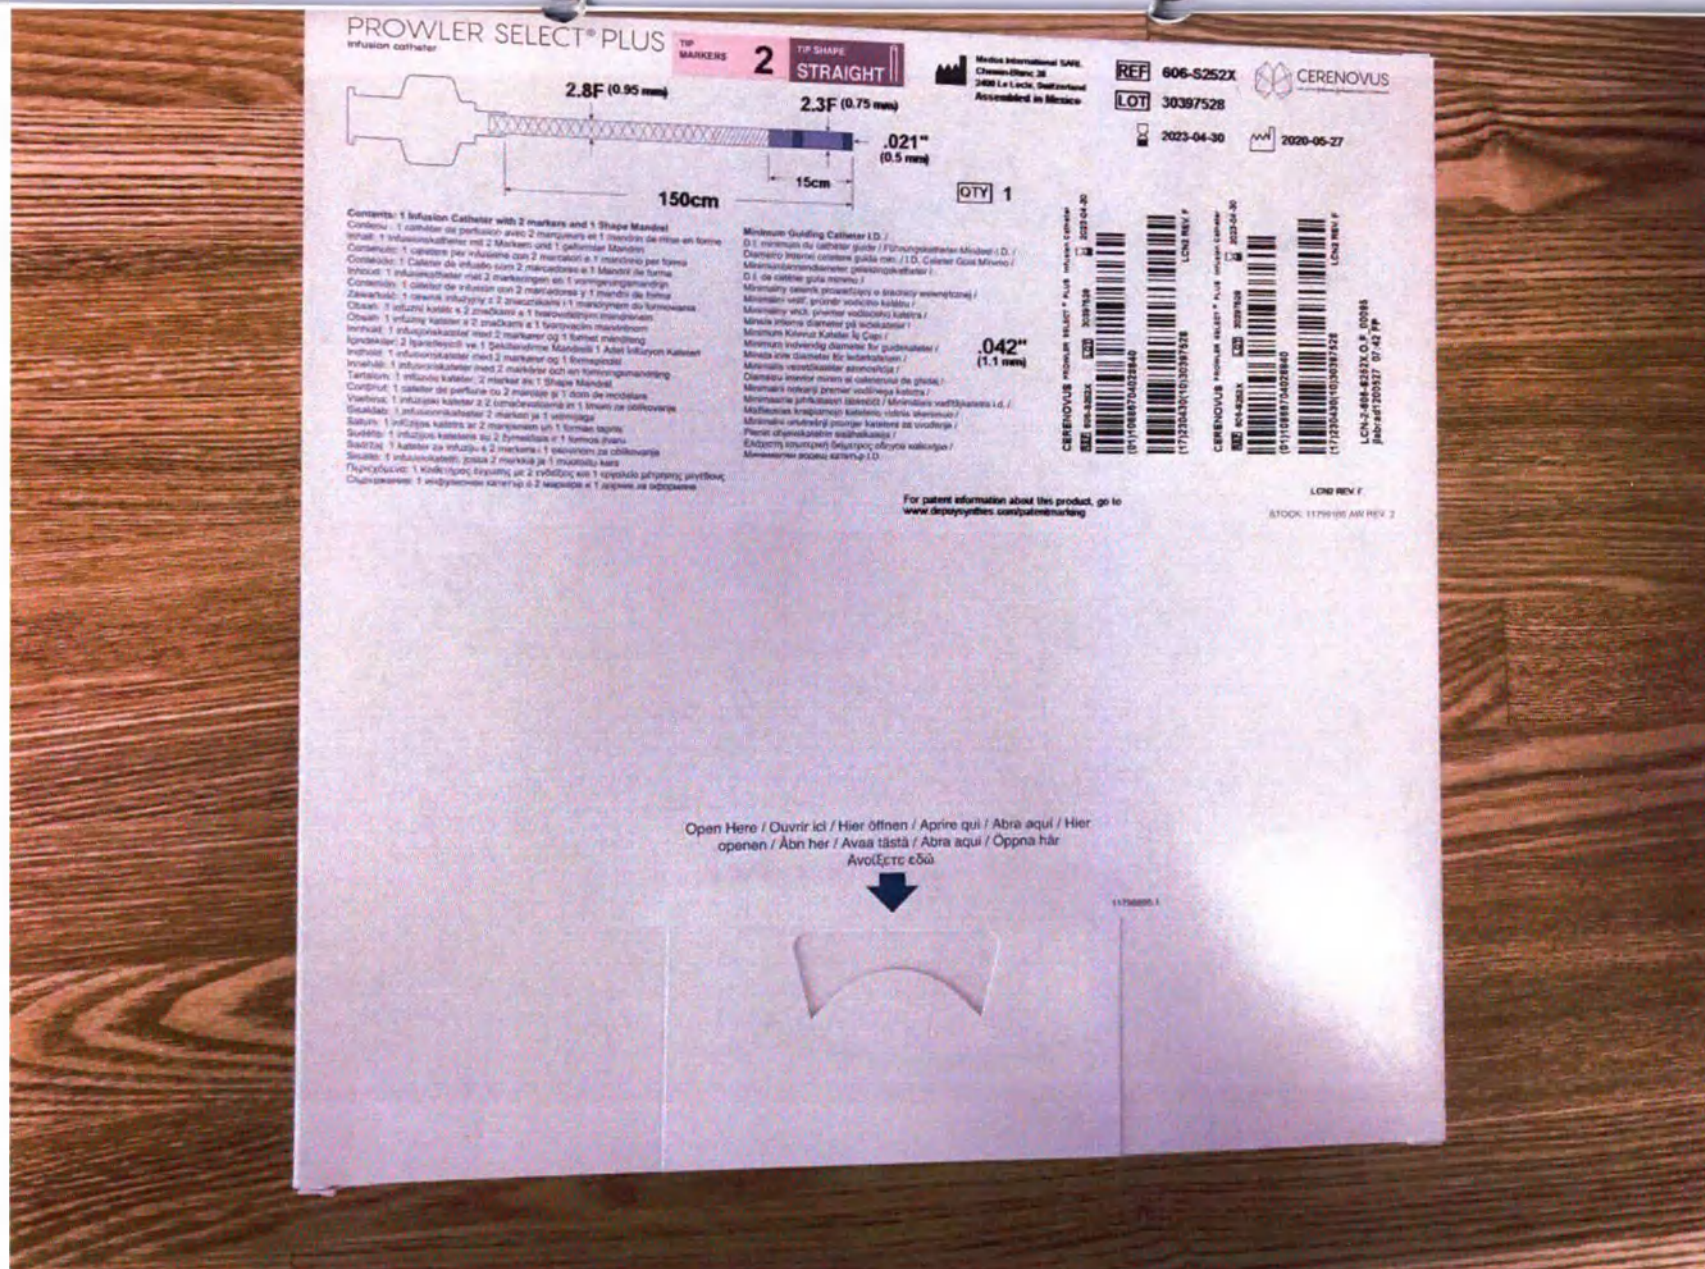

Микрокатетер PROWLER SELECT с формирующим мандреном:

- PROWLER SELECT Plus, эффективная длина 150 см, длина гибкой части 15 см, минимальный внутренний диаметр 0,053 см, форма изгиба прямой, количество рентгено-контрастных маркеров – 2 шт. (индивидуальная коробка)



Катетер проводниковый ENVOY 6F:

-Эффективная длина 90 см, форма изгиба CBL MOD (внешний вид изделия - катетер)

(фото Катетеров проводниковых ENVOY 6F распространяются на варианты исполнения Катетер проводниковый ENVOY XB и Катетер проводниковый ENVOY 5F)



Катетер проводниковый ENVOY 6F :
-Эффективная длина 90 см, форма изгиба CBL MOD (внутренняя упаковка - пакет)



Катетер проводниковый ENVOY 6F:
- Эффективная длина 90 см, форма изгиба CBL MOD (индивидуальная коробка)

REF 614178

Устройства для ангиографии и эмболизации:
Проводник управляемый AGILITY с поворотным устройством и интродьюсером: AGILITY 10, наружный диаметр 0,025 см, длина 195 см, длина конически суживающейся части 36 см

Область применения: Нейроваскулярная хирургия
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085 от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос Интернешнл САПЛ" Medos International SARL, Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400, Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С,

относительная влажность не более 80%,

атмосферное давление 700-1060 гПа



REF 635002

Устройства для ангиографии и эмболизации:

Индефлятор TRUFILL DSC II: Шприц с манометром, резьбовым поршнем в сборе с запорным механизмом с фиксатором

Область применения: Нейроваскулярная хирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085 от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос Интернешнл САПЛ" Medos International SARL, Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400, Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С,

относительная влажность не более 80%,

атмосферное давление 700-1060 гПа



635002@003RU

REF 6062510

Устройства для ангиографии и эмболизации:
Микрокатетер PROWLER с формирующим
мандреном: PROWLER Plus, эффективная длина
150 см, минимальный внутренний диаметр 0,053
см, форма изгиба прямой, количество
рентгено-контрастных маркеров – 1 шт., длина
гибкой части 20 см

Область применения: Нейроваскулярная хирургия
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085
от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос
Интернешнл САПЛ" Medos International SARL,
Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400,
Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С, относительная
влажность не более 80%, атмосферное давление
700-1060 гПа



6062510@002RU

Наружная этикетка для применения в Российской Федерации (проект): Микрокатетер PROWLER

REF 606S252X

Устройства для ангиографии и эмболизации:

Микрокатетер PROWLER SELECT с
формирующим мандреном: PROWLER SELECT
Plus, эффективная длина 150 см, длина гибкой
части 15 см, минимальный внутренний диаметр
0,053 см, форма изгиба прямой, количество
рентгено-контрастных маркеров – 2 шт.

Область применения: Нейроваскулярная хирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085
от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос
Интернешнл САПЛ" Medos International SARL,
Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400,
Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С, относительная
влажность не более 80%, атмосферное давление
700-1060 гПа



606S252X@002RU

Наружная этикетка для применения в Российской Федерации (проект): Микрокатетер PROWLER SELECT

REF 67026090

Устройства для ангиографии и эмболизации:

Катетер проводниковый ENVOY 6F: Эффективная
длина 90 см, форма изгиба STR

Область применения: Нейроваскулярная хирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085
от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос
Интернешнл САПЛ" Medos International SARL,
Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400,
Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С, относительная
влажность не более 80%, атмосферное давление
700-1060 гПа

Наружная этикетка для применения в Российской Федерации (проект): Катетер проводниковый ENVOY 6F



67026090@001RU

REF 67026090B

Устройства для ангиографии и эмболизации:

Катетер проводниковый ENVOY XB: Эффективная
длина 90 см, форма изгиба STR

Область применения: Нейроваскулярная хирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085
от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос
Интернешнл САПЛ" Medos International SARL,
Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400,
Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С, относительная

влажность не более 80%, атмосферное давление
700-1060 гПа

Наружная этикетка для применения в Российской Федерации (проект): Катетер проводниковый ENVOY XB



67026090B@001RU

REF 55625090

Устройства для ангиографии и эмболизации:

Катетер проводниковый ENVOY 5F: Эффективная
длина 90 см, форма изгиба CBL MOD

Область применения: Нейроваскулярная хирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2010/07085
от XX.XX.XXXX

Производитель (Изготовитель): "Медос

Интернешнл САПЛ" Medos International SARL,
Швейцария. Chemin – Blanc 38, Le Locle, CH-2400,
Switzerland.

Уполномоченный представитель производителя,
адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614,
Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55 °С, относительная
влажность не более 80%, атмосферное давление
700-1060 гПа

Наружная этикетка для применения в Российской Федерации (проект): Катетер проводниковый ENVOY 5F



55625090@001RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

26 (Двадцать шесть)
листов

Менеджер по регистрации


Д.Н. Лихаев

