

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Центральная станция CARESCAPE с принадлеж-
ностями***

Производства

GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

**ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолод-
жиз, Инк.**

**9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226, USA,
США**

Центральная станция CARESCAPE

1



2

EC REP

GE Medical Systems SCS
283 Rue de la Miniere, 78530 Buc, France

Rx ONLY

Собрано в Мексике





IPX1



0197



DP++(1)



DP++(2)

1a	Вариант исполнения
2a	Производитель



REF
SN

Центральная станция CARESCAPE

1

3

2
4

1a	Вариант исполнения
2a	Дата производства
3a	Штрихкод
4a	Производитель

I. Варианты исполнения: MAI700, MAI800: 1. Встроенный процессорный блок (моноблок).



2. Кабель электропитания.



3. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Центральная станция CARESCAPE

Руководство пользователя

Номер модели: MA750, MA800 и MA800

Продукт версии 3



Центральная станция CARESCAPE
Русский/Русский

2048005-402 3-4 издание
© 2021 General Electric Company.
Все права защищены.

3. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Центральная станция CARESCAPE

Руководство пользователя

Модель: MAI700 и MAS700

Программное обеспечение версии 2



Центральная станция CARESCAPE
Russian / Русский
2048003-003 (CD/DVD)
2048001-157A
© 2016 General Electric Company.
Все права защищены.

3. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Russian/Русский

Электронные инструкции по эксплуатации (eIFU)

3048302-440

Версия 1

2020-06-17

© General Electric Company, 2020. Все права защищены.

Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Краткое описание

Центральная станция CARESCAPE является медицинским устройством и предназначена для использования только квалифицированными медицинскими персоналом. Данный документ содержит сведения, необходимые для доступа к электронным инструкциям по эксплуатации медицинских устройств и для хранения этих инструкций.

Инструкции по эксплуатации являются неотъемлемой частью медицинского устройства. Перед использованием этого устройства необходимо прочесть и понять инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить его надлежащую работу и правильную эксплуатацию, а также безопасность пациента и медицинского персонала. Инструкции по эксплуатации следует постоянно хранить в месте, доступном для персонала. При этом район с медицинским устройством необходимо разместить табличку с указанием места хранения инструкций по эксплуатации.

Доступ к электронным инструкциям по эксплуатации и их хранение

Для получения последней версии электронной инструкции по эксплуатации перейдите на портал пользователя для устройств компании GE Healthcare по адресу portal.gehealthcare.com/education/educationcenter. Введите CXC700 в поле поиска и нажмите Поиск. Найдите и загрузите инструкции по эксплуатации. Кроме того вы можете обратиться в отдел информации / биомедицинской технологии и загрузить инструкции по эксплуатации, используя учетную запись пользователя системы электронной доставки информации компании GE Healthcare.

Скачайте электронную инструкцию по эксплуатации на электронном носителе. Если электронная инструкция по эксплуатации находится на съемном носителе (например, на флэш-накопителе USB), подключите его к устройству для просмотра (компьютер, планшет), убедившись, что на устройстве для просмотра установлен приложении обновления для открытия PDF-файлов (например, Adobe® Acrobat® Reader). Для просмотра найдите электронную инструкцию по эксплуатации на устройстве и дважды щелкните на.


Кроме электронное устройство с электронной инструкцией по эксплуатации в своем производстве не имеет, и/или выключено и отключено. Включите устройство с помощью клавиш. После использования уберите устройство в соответствующее место хранения.

3048302-440

CARESCAPE Central Station



2. Дисплеи основные (не более 2 шт.).

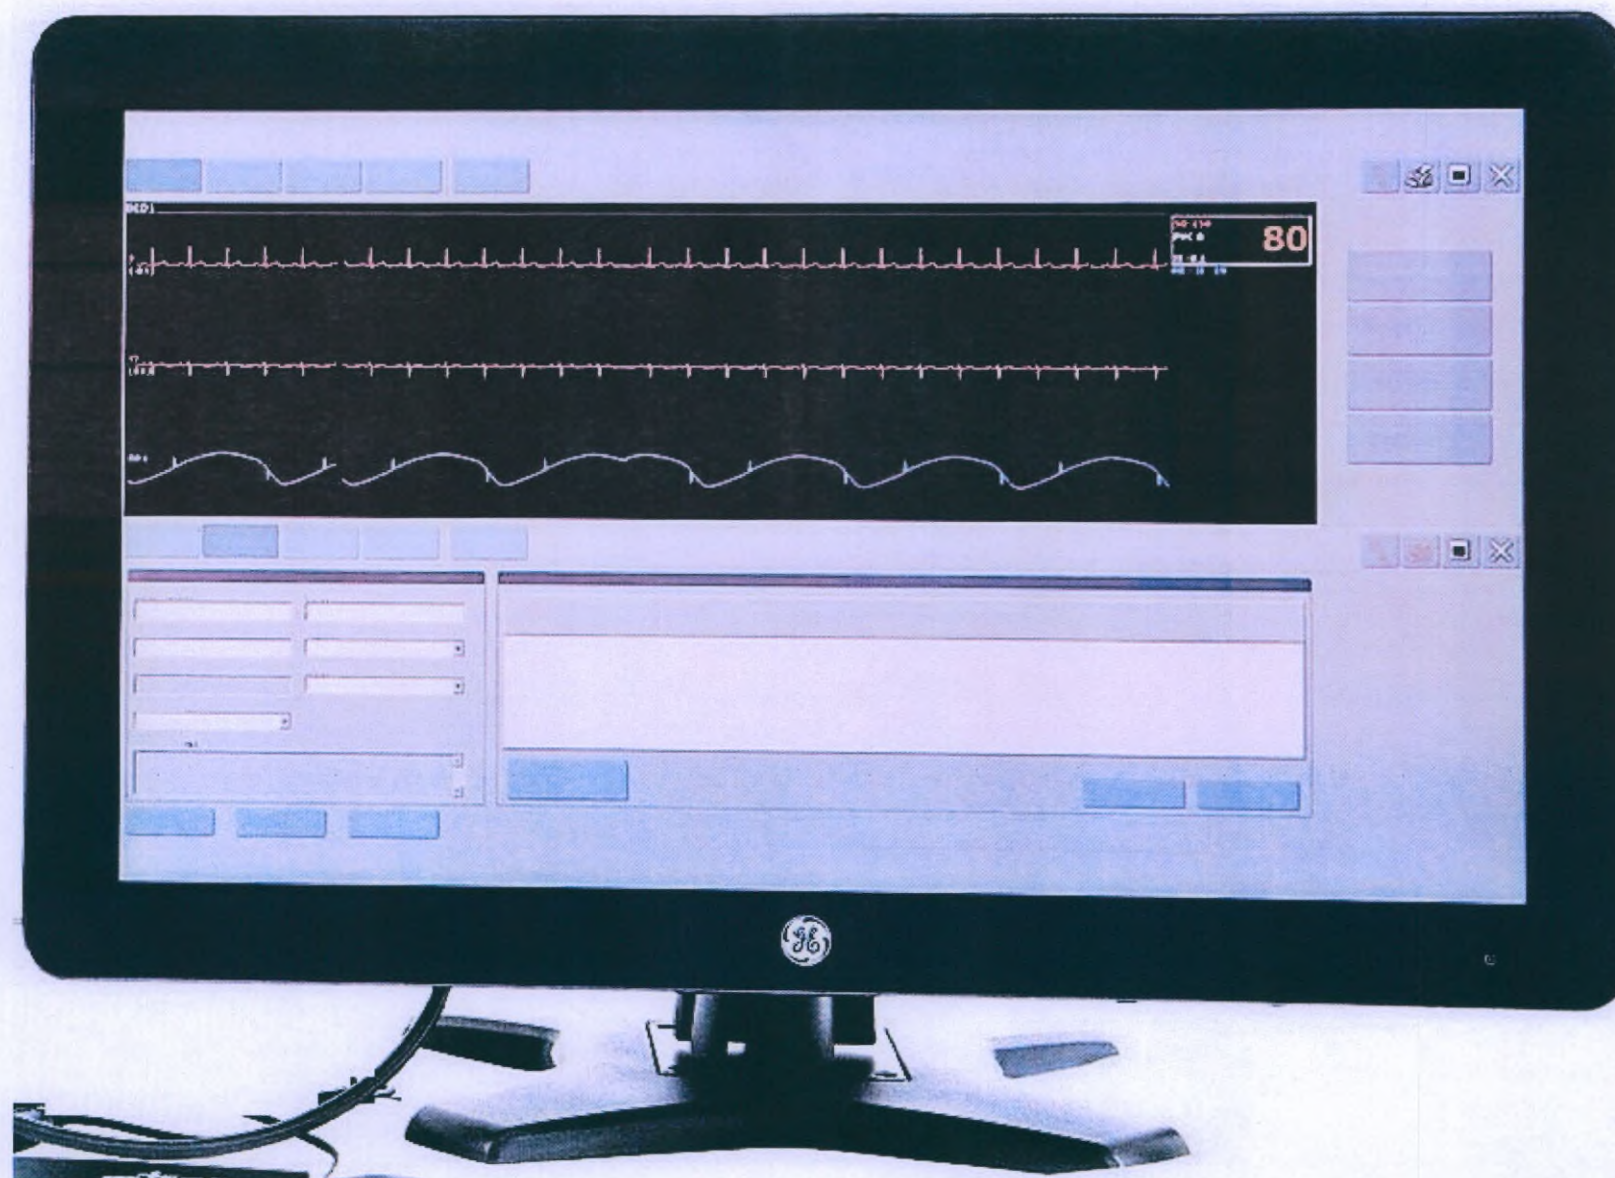

3. Кабель электропитания.



4. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Центральная станция CARESCAPE

Руководство пользователя

Номер модели: MA1750, MA1800 и MA1900

Продукт версии 3



Центральная станция CARESCAPE
Русский/Русский

0140000-400 3-е издание
© 2021 General Electric Company.
Все права защищены.

4. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Центральная станция CARESCAPE
Руководство пользователя
Модели MA1700 и MA2700
Программное обеспечение версии 2



Центральная станция CARESCAPE
Модели MA1700 и MA2700
Программное обеспечение версии 2
© 2016 General Electric Company.
Все права защищены.

4. Руководства пользователя (не более 10 шт.).

Russian/Русский

Электронные инструкции по эксплуатации (eIFU)

Model 440

Version 1

2016-01

© General Electric Company, 2016. Все права защищены.

Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Краткое описание

Центральная станция (CARECAP) является медицинским устройством и предназначена для использования только квалифицированными медицинскими персоналом. Данный документ содержит сведения, необходимые для доступа к электронным инструкциям по эксплуатации медицинского устройства и для хранения этих инструкций.

Инструкции по эксплуатации являются частью медицинского устройства. Перед использованием этого устройства необходимо прочесть и понять инструкции по эксплуатации, чтобы обеспечить его надлежащую работу и правильную эксплуатацию, а также обеспечить хранение и использование. Инструкции по эксплуатации следует постоянно хранить в месте, доступном для пользователей. При этом рядом с медицинским устройством необходимо разместить таблицу с указанием места хранения инструкций по эксплуатации.

Доступ к электронным инструкциям по эксплуатации и их хранение

Для получения последней версии электронных инструкций по эксплуатации перейдите на страницу пользовательской документации компании GE Healthcare на сайте www.gehealthcare.com. Введите C4400 в поле Поиск и нажмите Поиск. Найдите и загрузите инструкции по эксплуатации. Кроме того, вы можете обратиться в отдел информационных / биомедицинских технологий и загрузить инструкции по эксплуатации, используя уникальную ссылку пользователя системы электронной доставки информации компании GE Healthcare.

Сформируйте электронные инструкции по эксплуатации на электронном носителе. Если электронная инструкция по эксплуатации находится на экране компьютера (например, на флэш-накопителе USB), подключите его к устройству для просмотра изображений, к компьютеру. Обратите внимание, что на устройстве для просмотра изображения (при просмотре) обязательно для установки PC-программ (например, GE Advantage Worklist) для просмотра загрузите электронные инструкции по эксплуатации на устройство и загрузите данные на.

Кроме электронного устройства с электронной инструкцией по эксплуатации в случае просмотра места, таблицы хранения и хранения. Электронные устройства GE Healthcare Healthcare. После использования уберите устройство в соответствующее место хранения.

C4400-440

CARECAP Central Station

Принадлежности:
1. Дисплеи (не более 8 шт.).




2. Источники бесперебойного питания (не более 4 шт.).




3. Кабели (не более 100 шт.). Кабель DVI




3. Кабели (не более 100 шт.). Кабель VGA

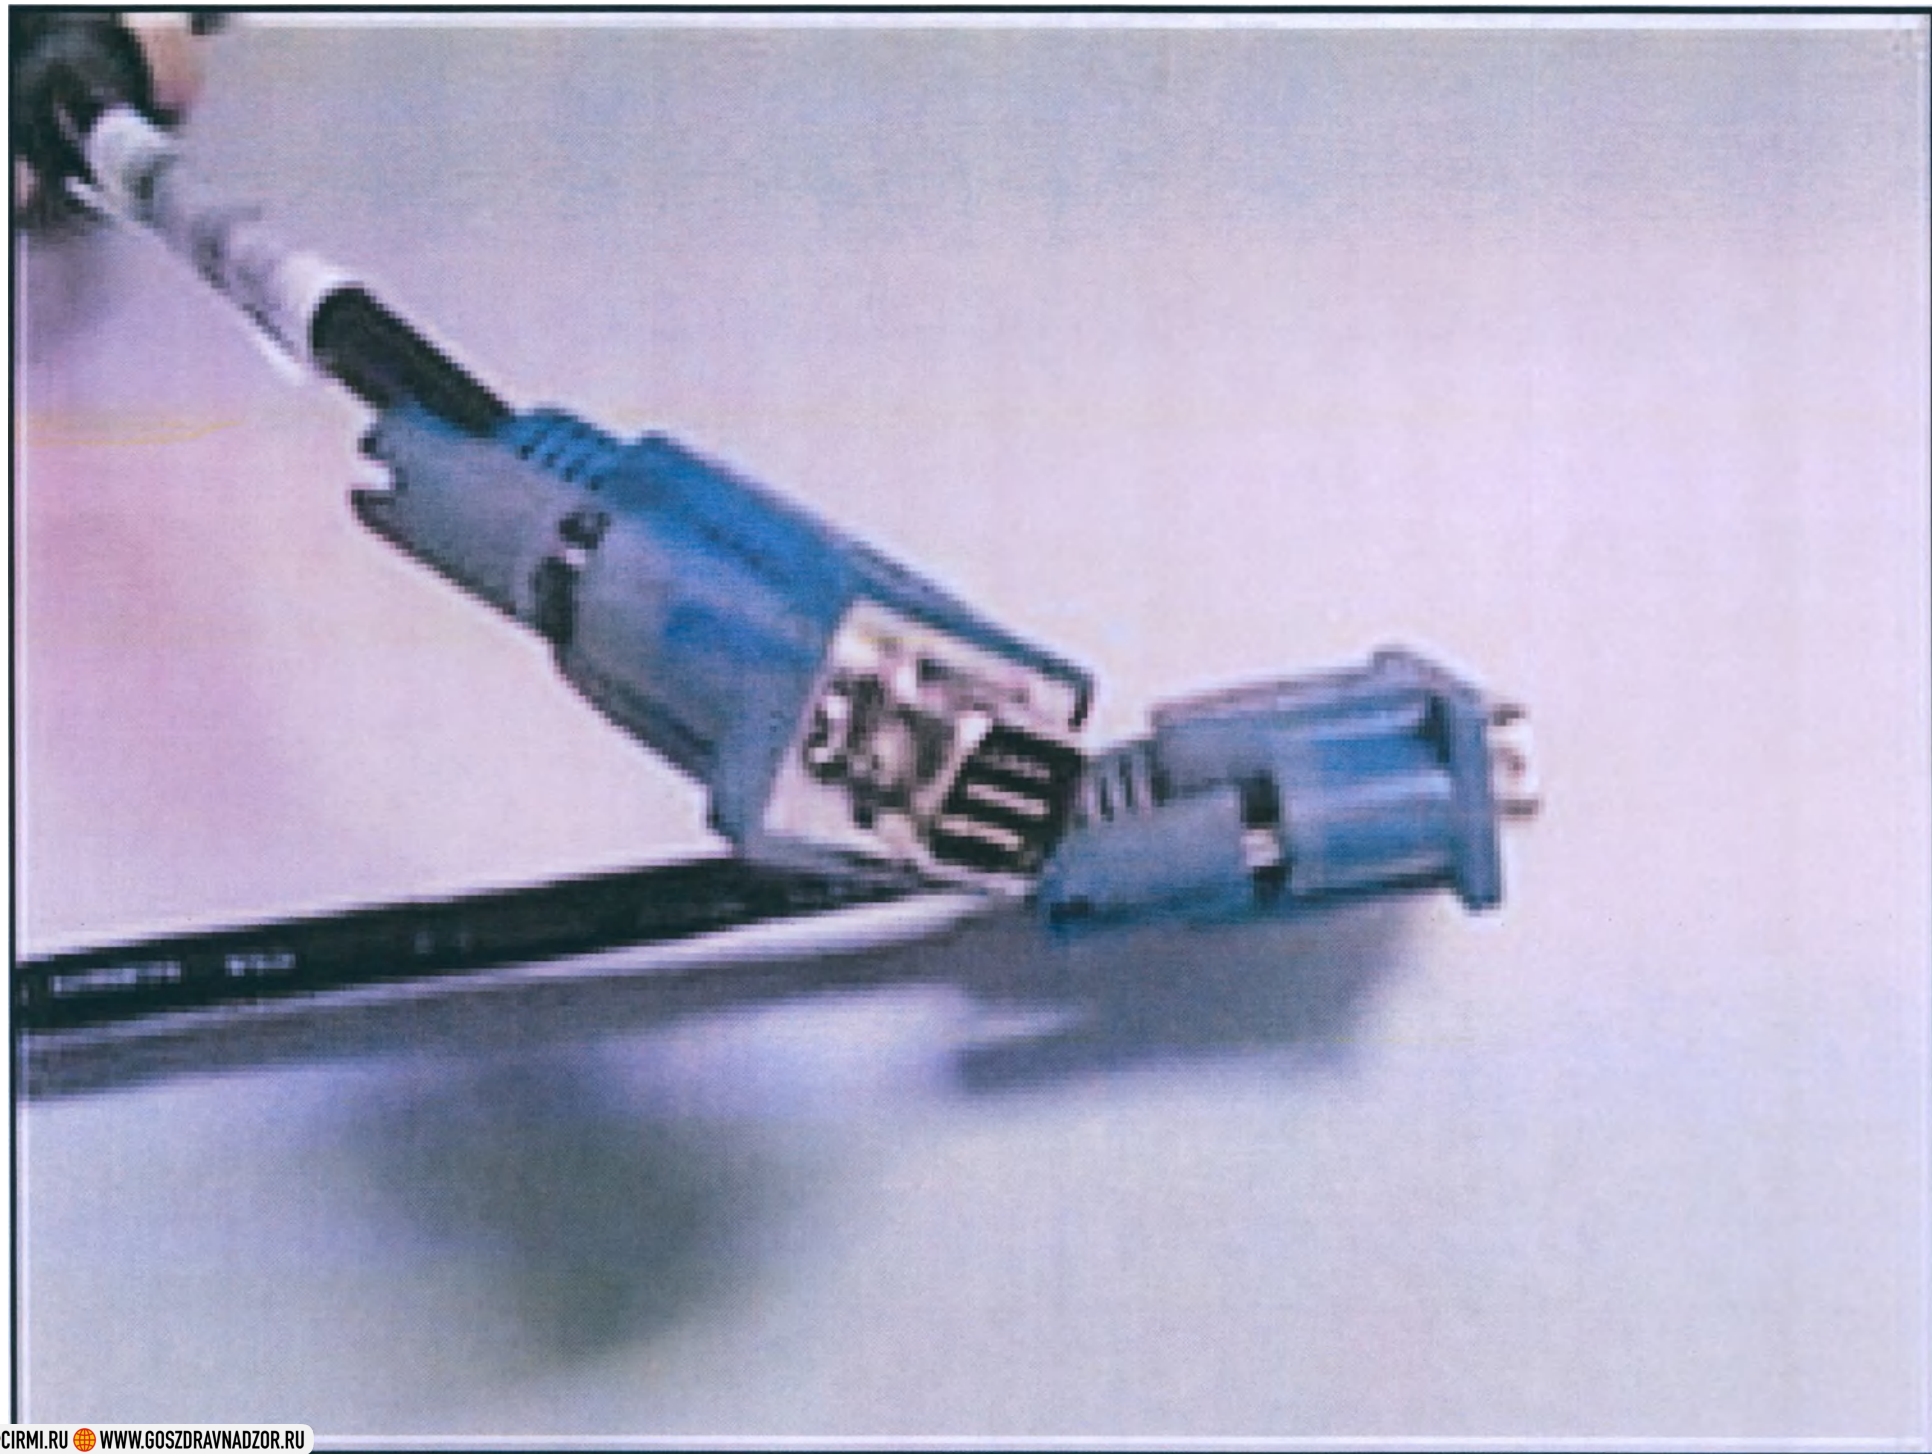

3. Кабели (не более 100 шт.). Кабель подключения принтера.

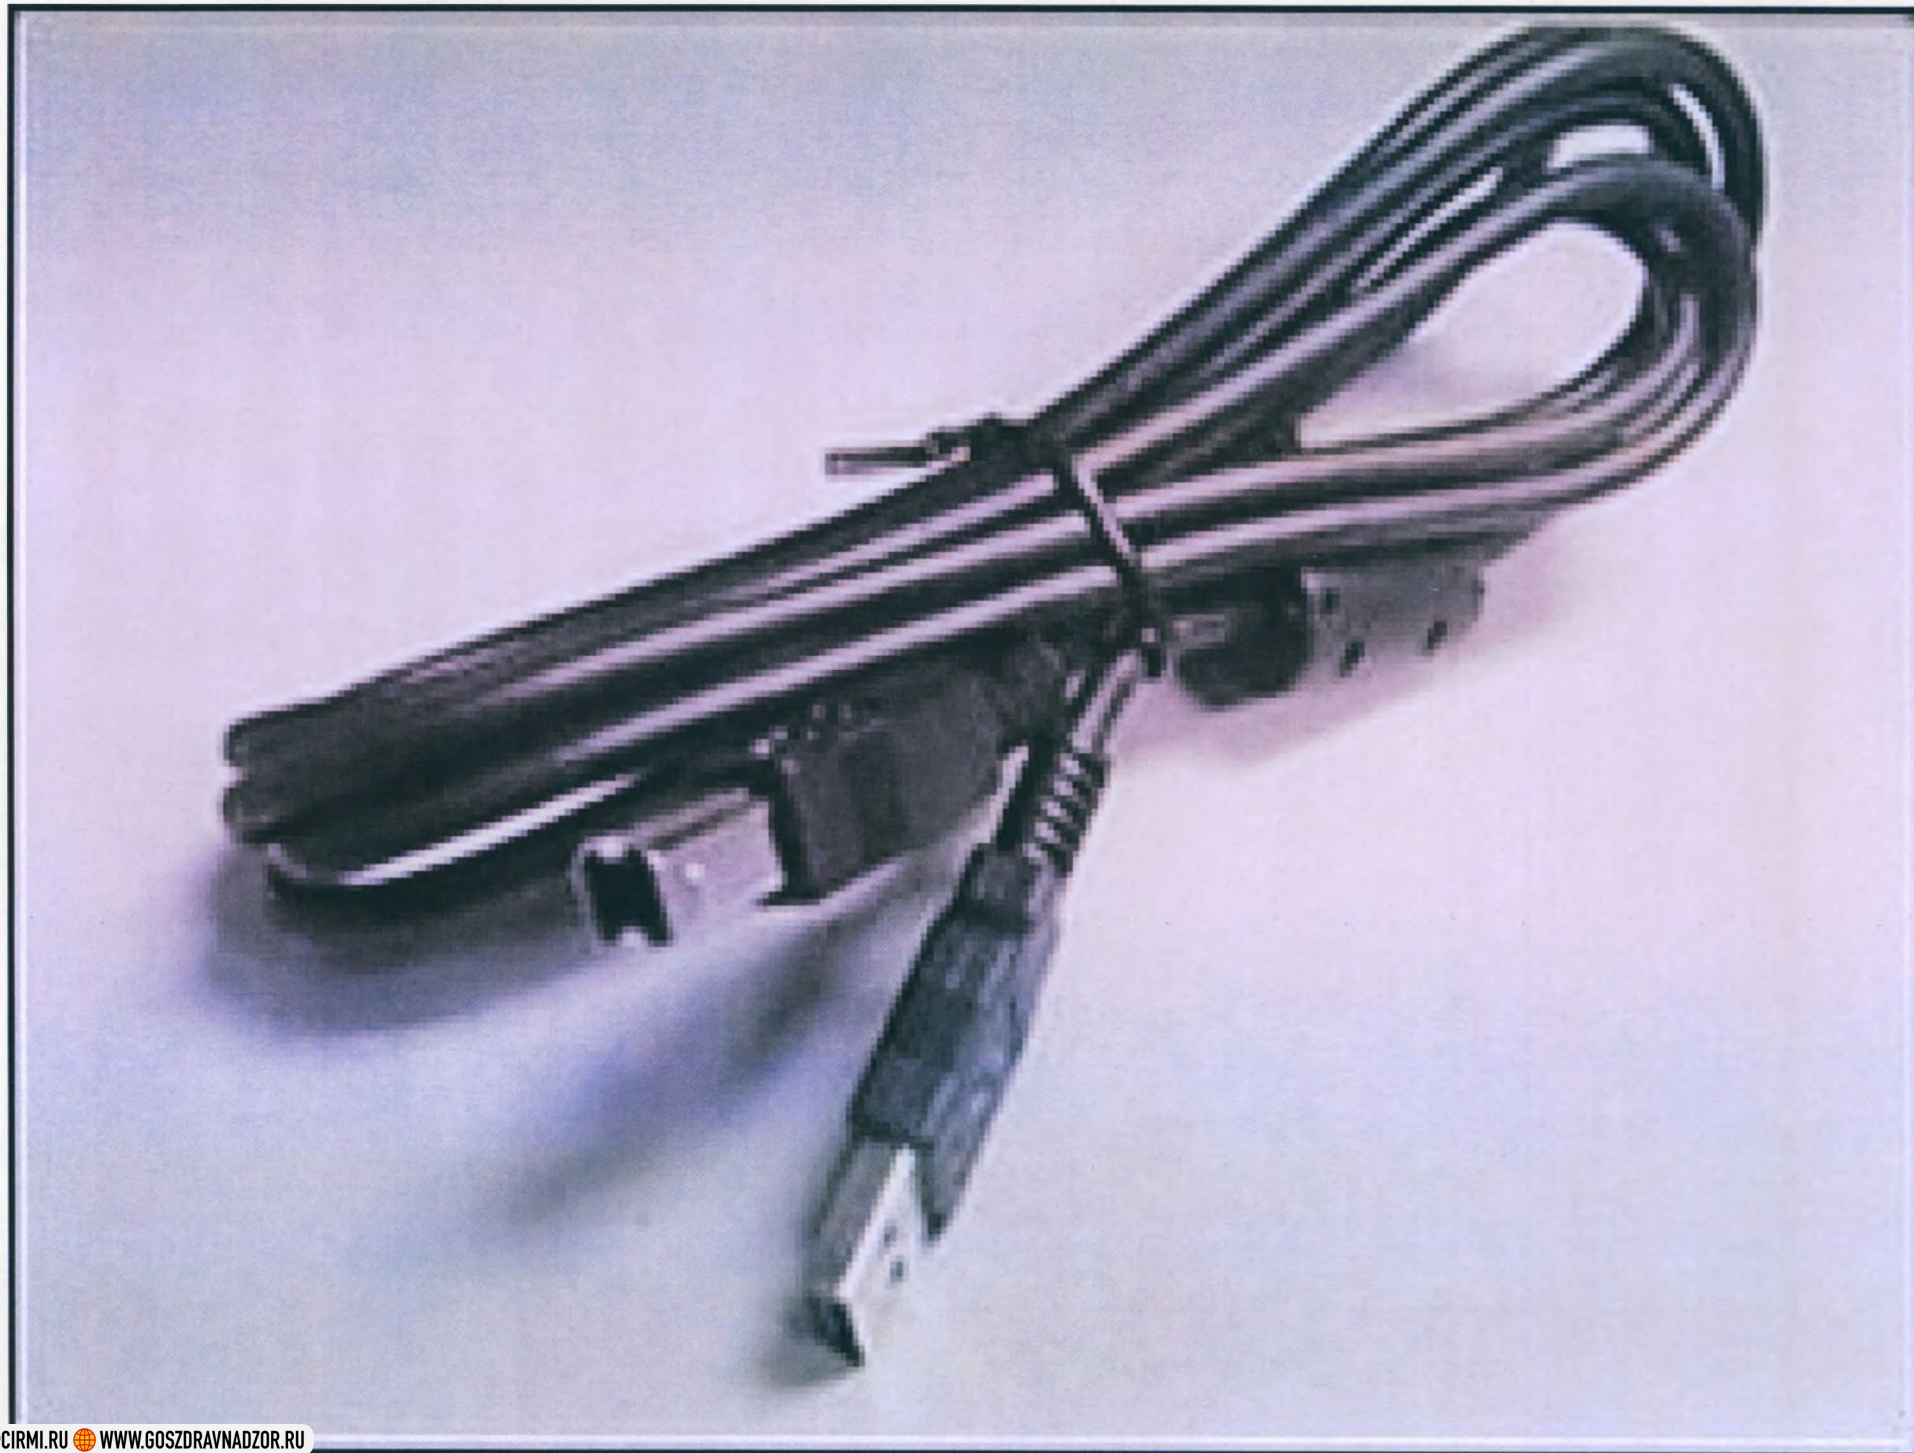

3. Кабели (не более 100 шт.). Кабель сетевой.

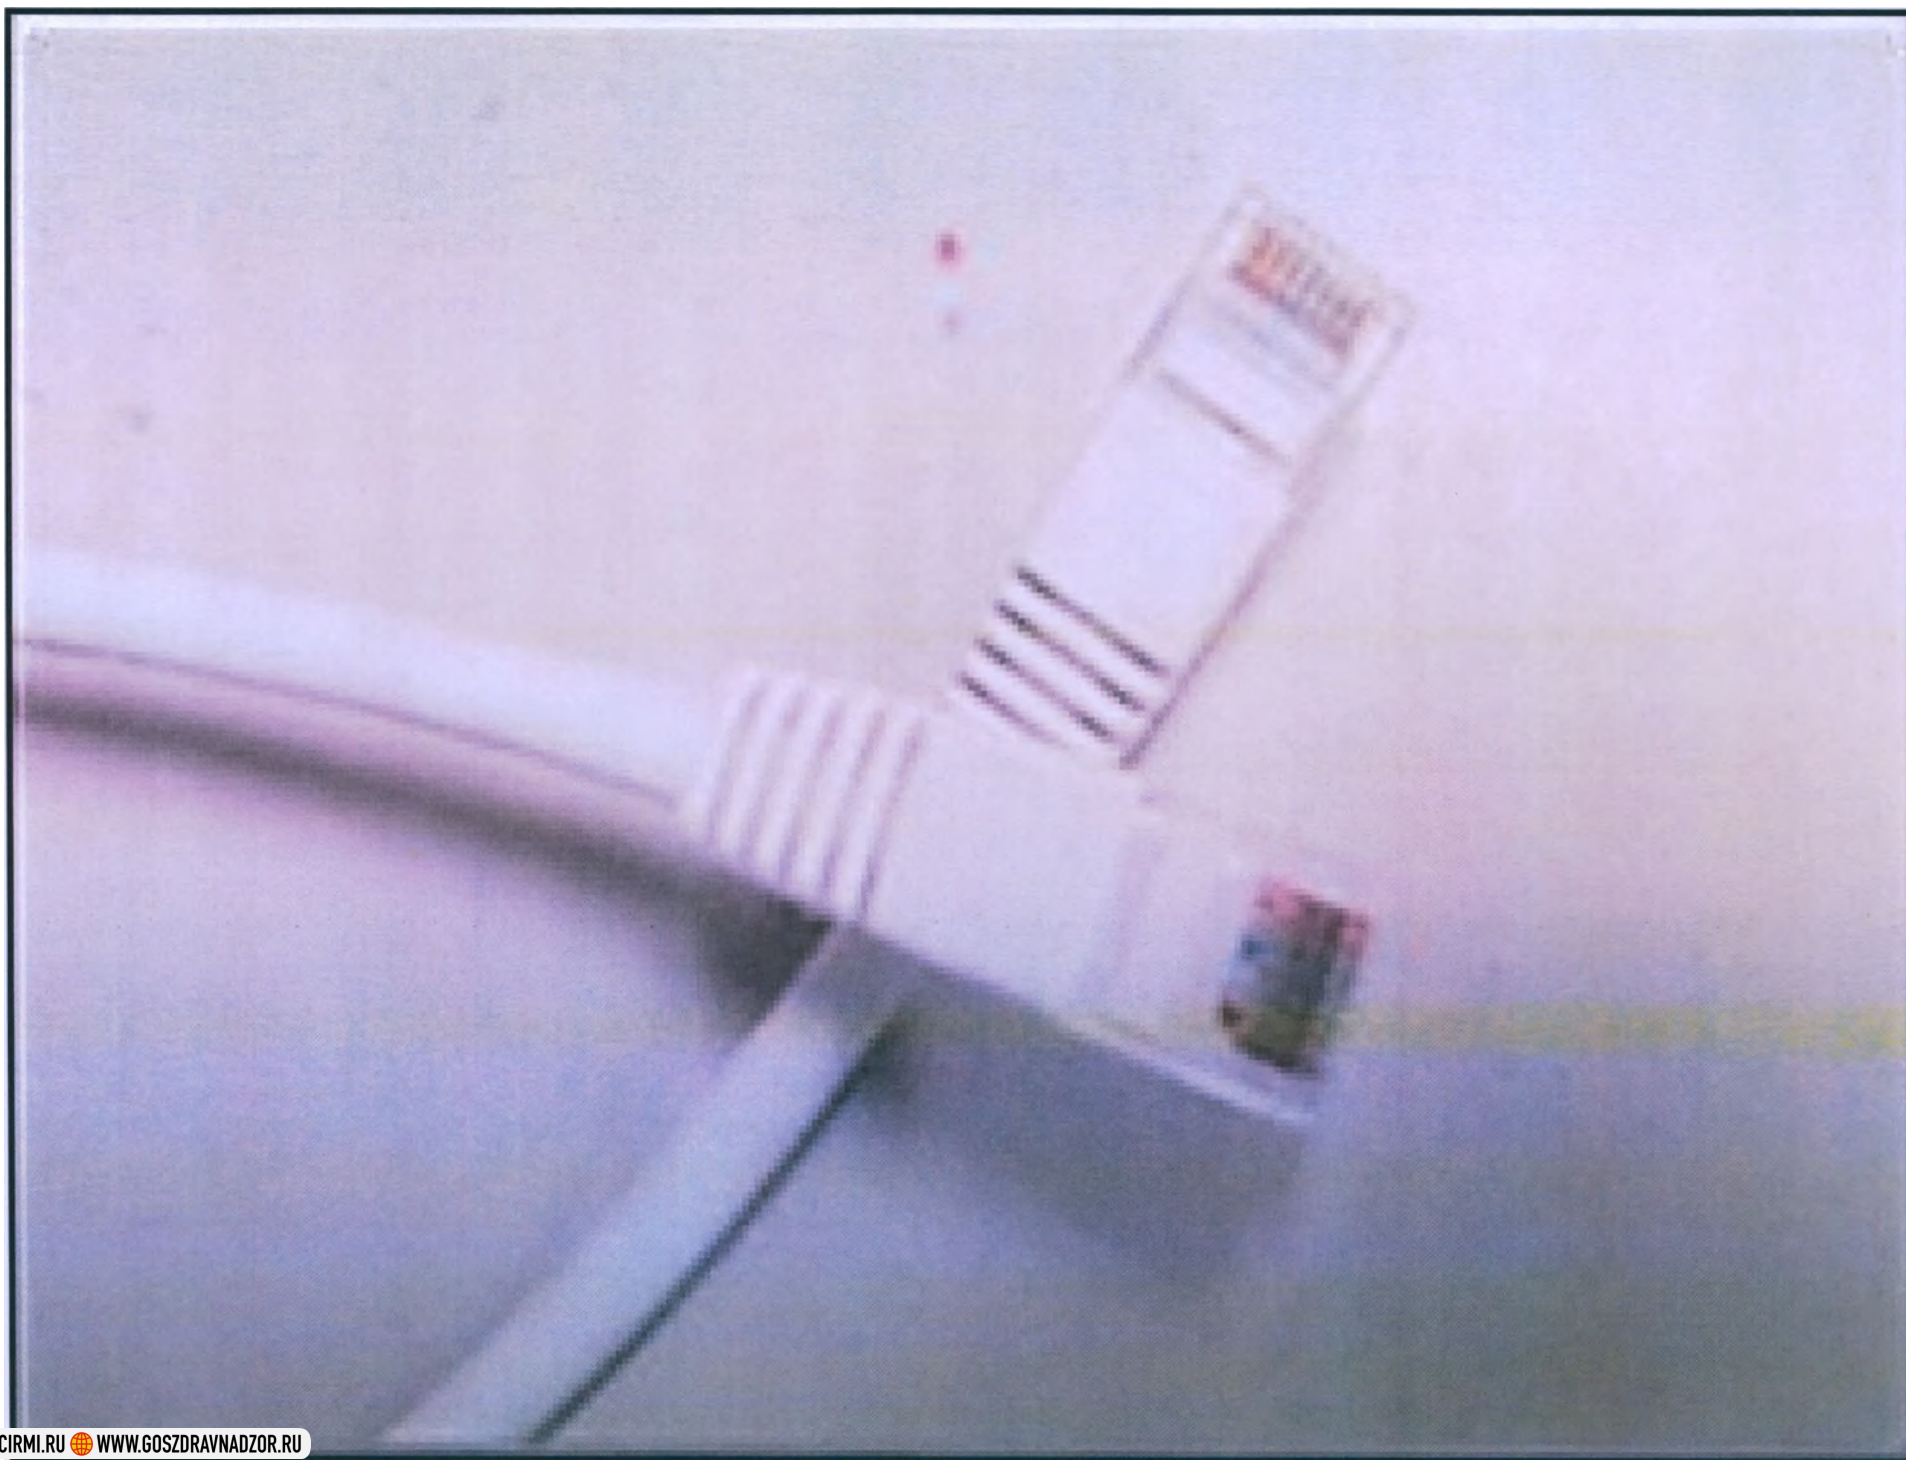


3. Кабели (не более 100 шт.). Кабель Display port



3. Кабели (не более 100 шт.). Оптический кабель



4. USB-кабели (не более 4 шт.).

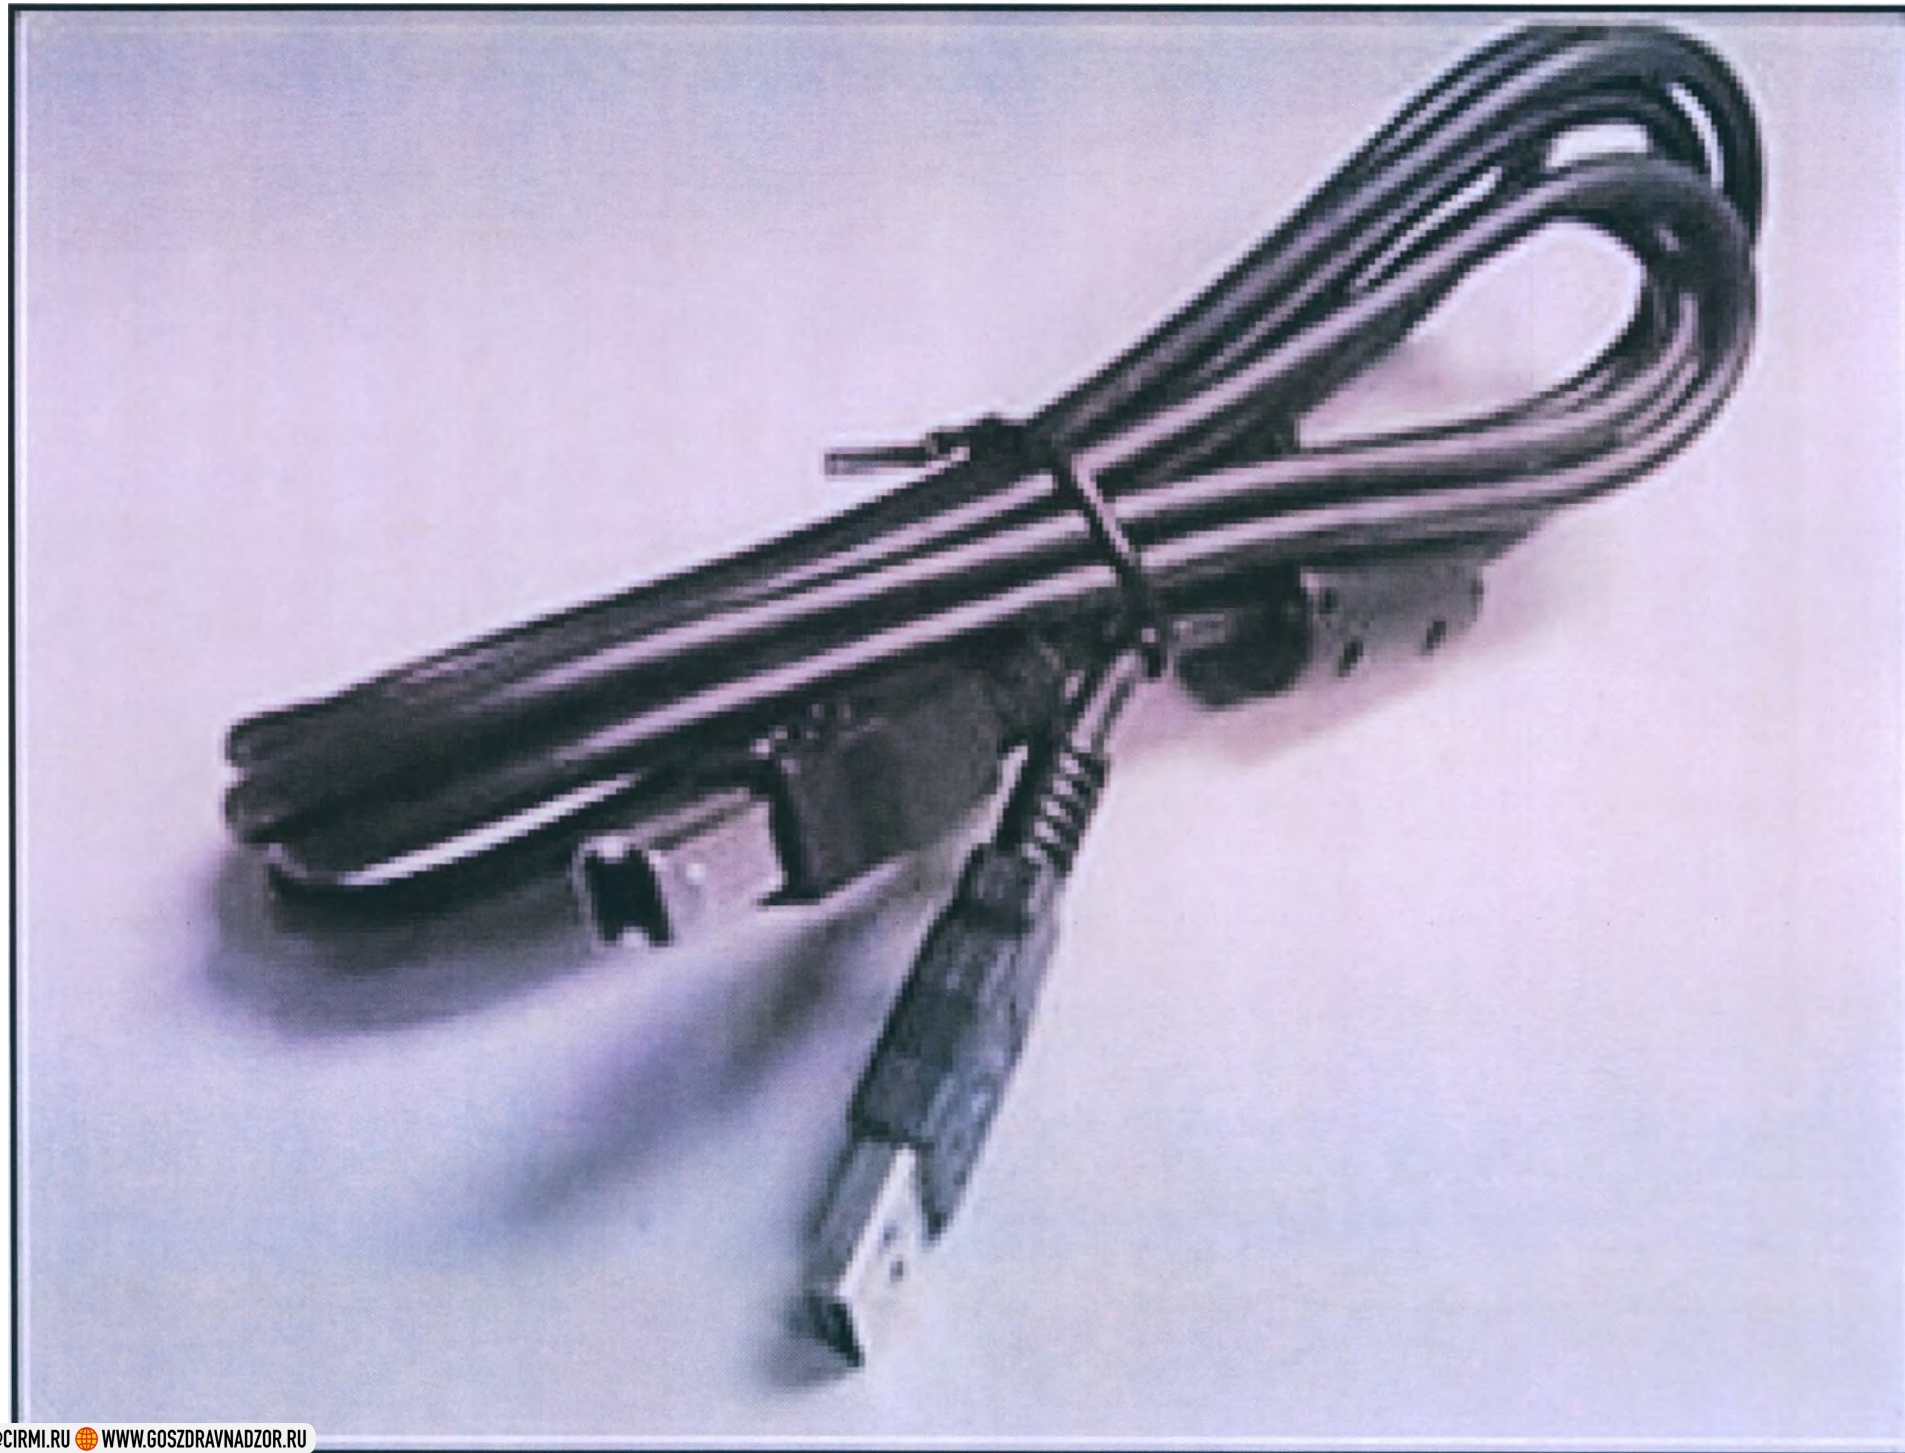

4. USB-кабели (не более 4 шт.).



5. Клавиатура.




6. Оптическая мышь.



6. Оптическая мышь.



7. Коврик для оптической мыши.

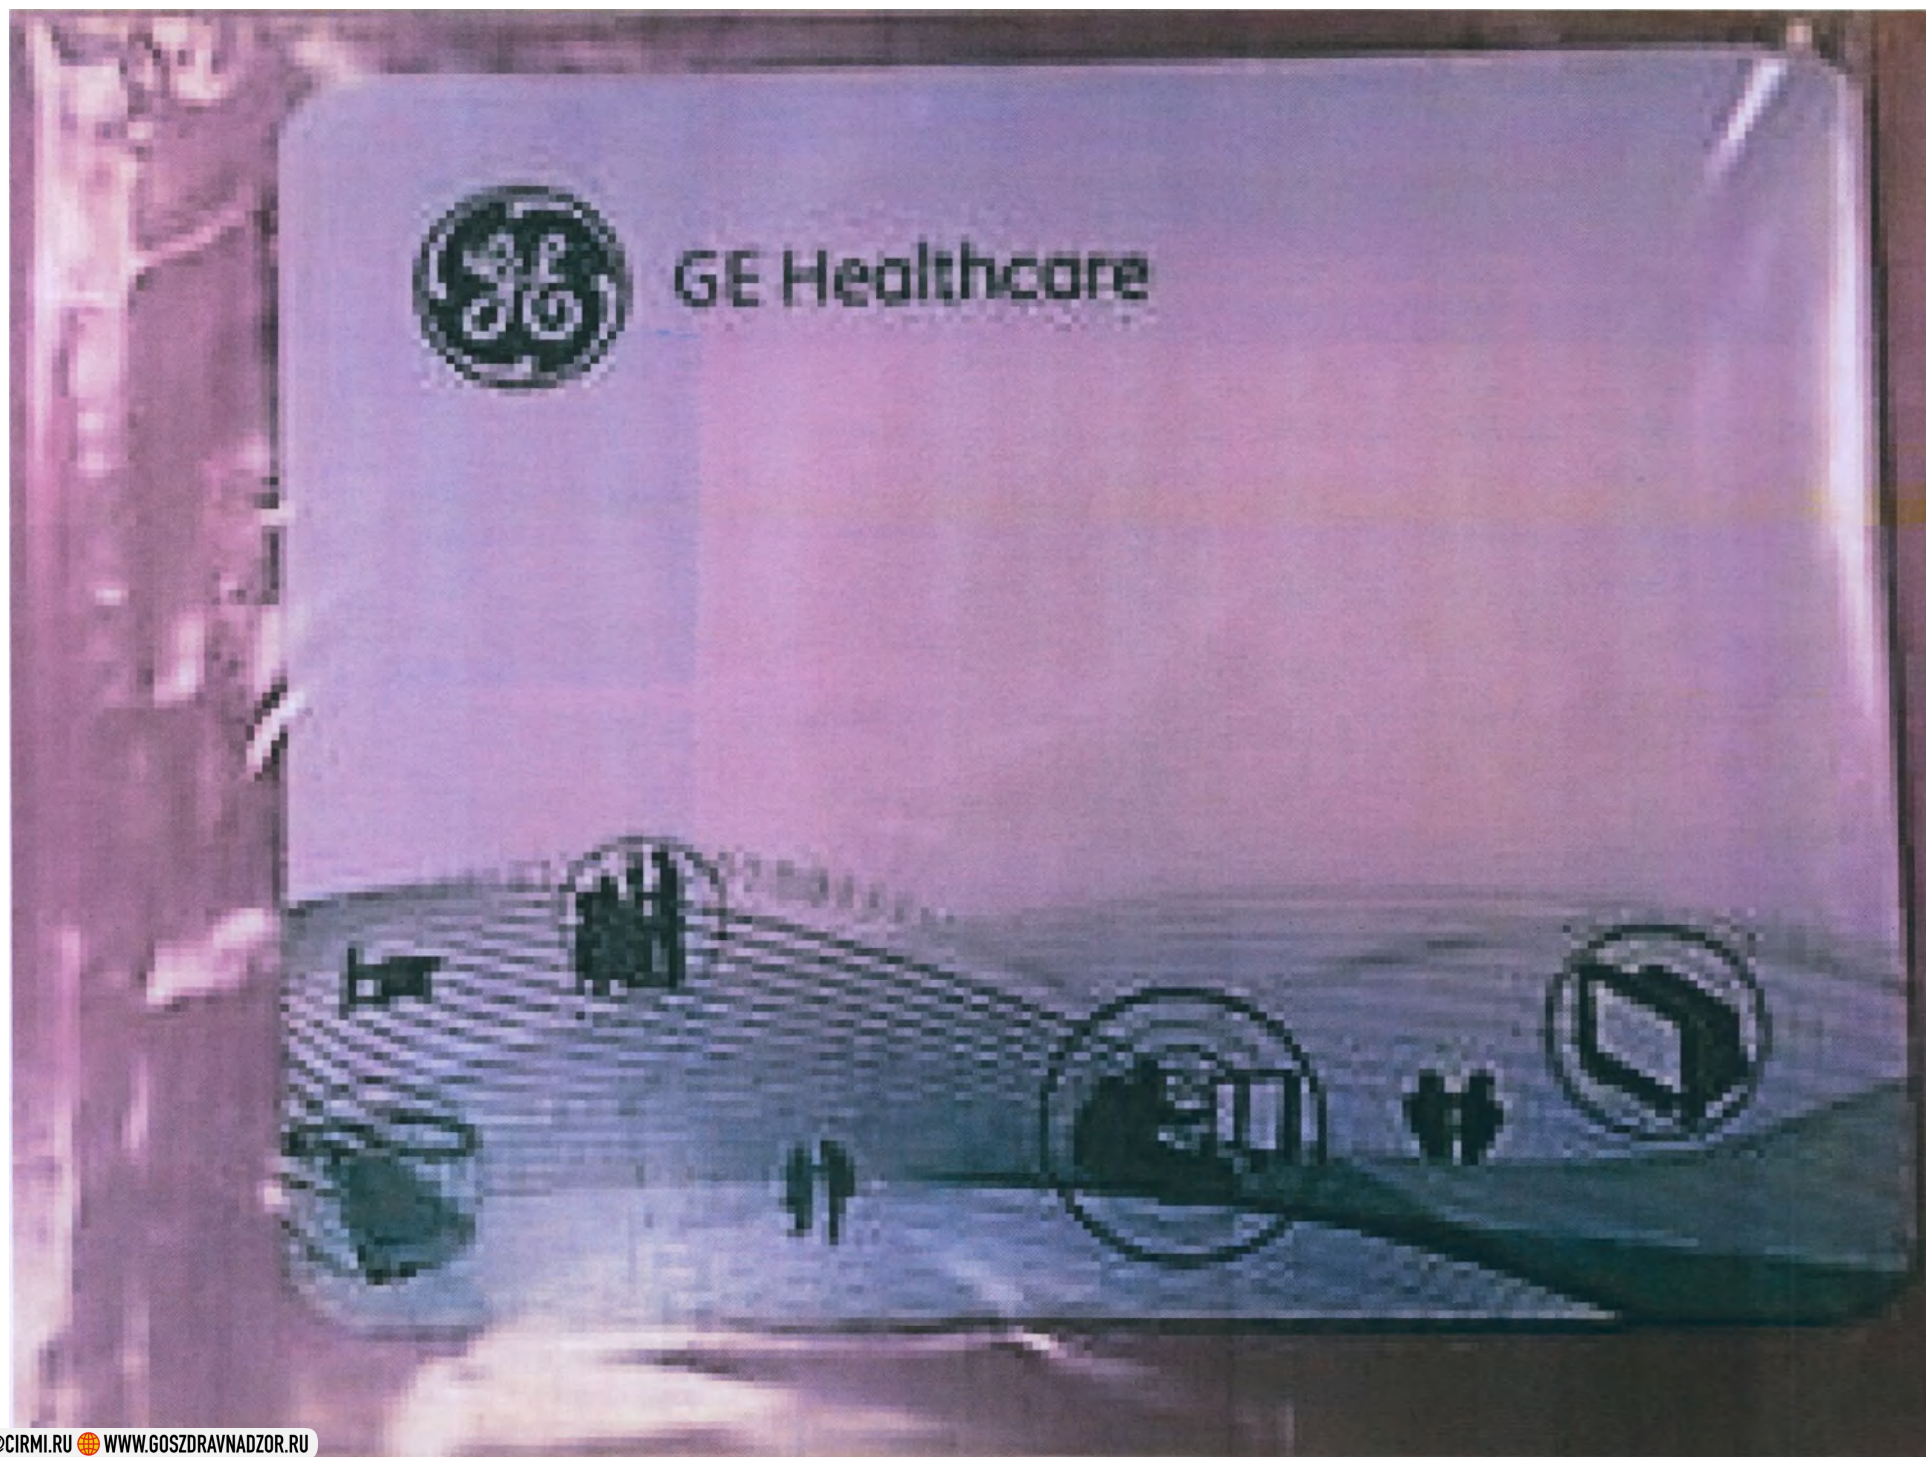

8. Удлинитель кабеля.




8. Удлинитель кабеля.




9. Колонки звуковые.




9. Колонки звуковые.

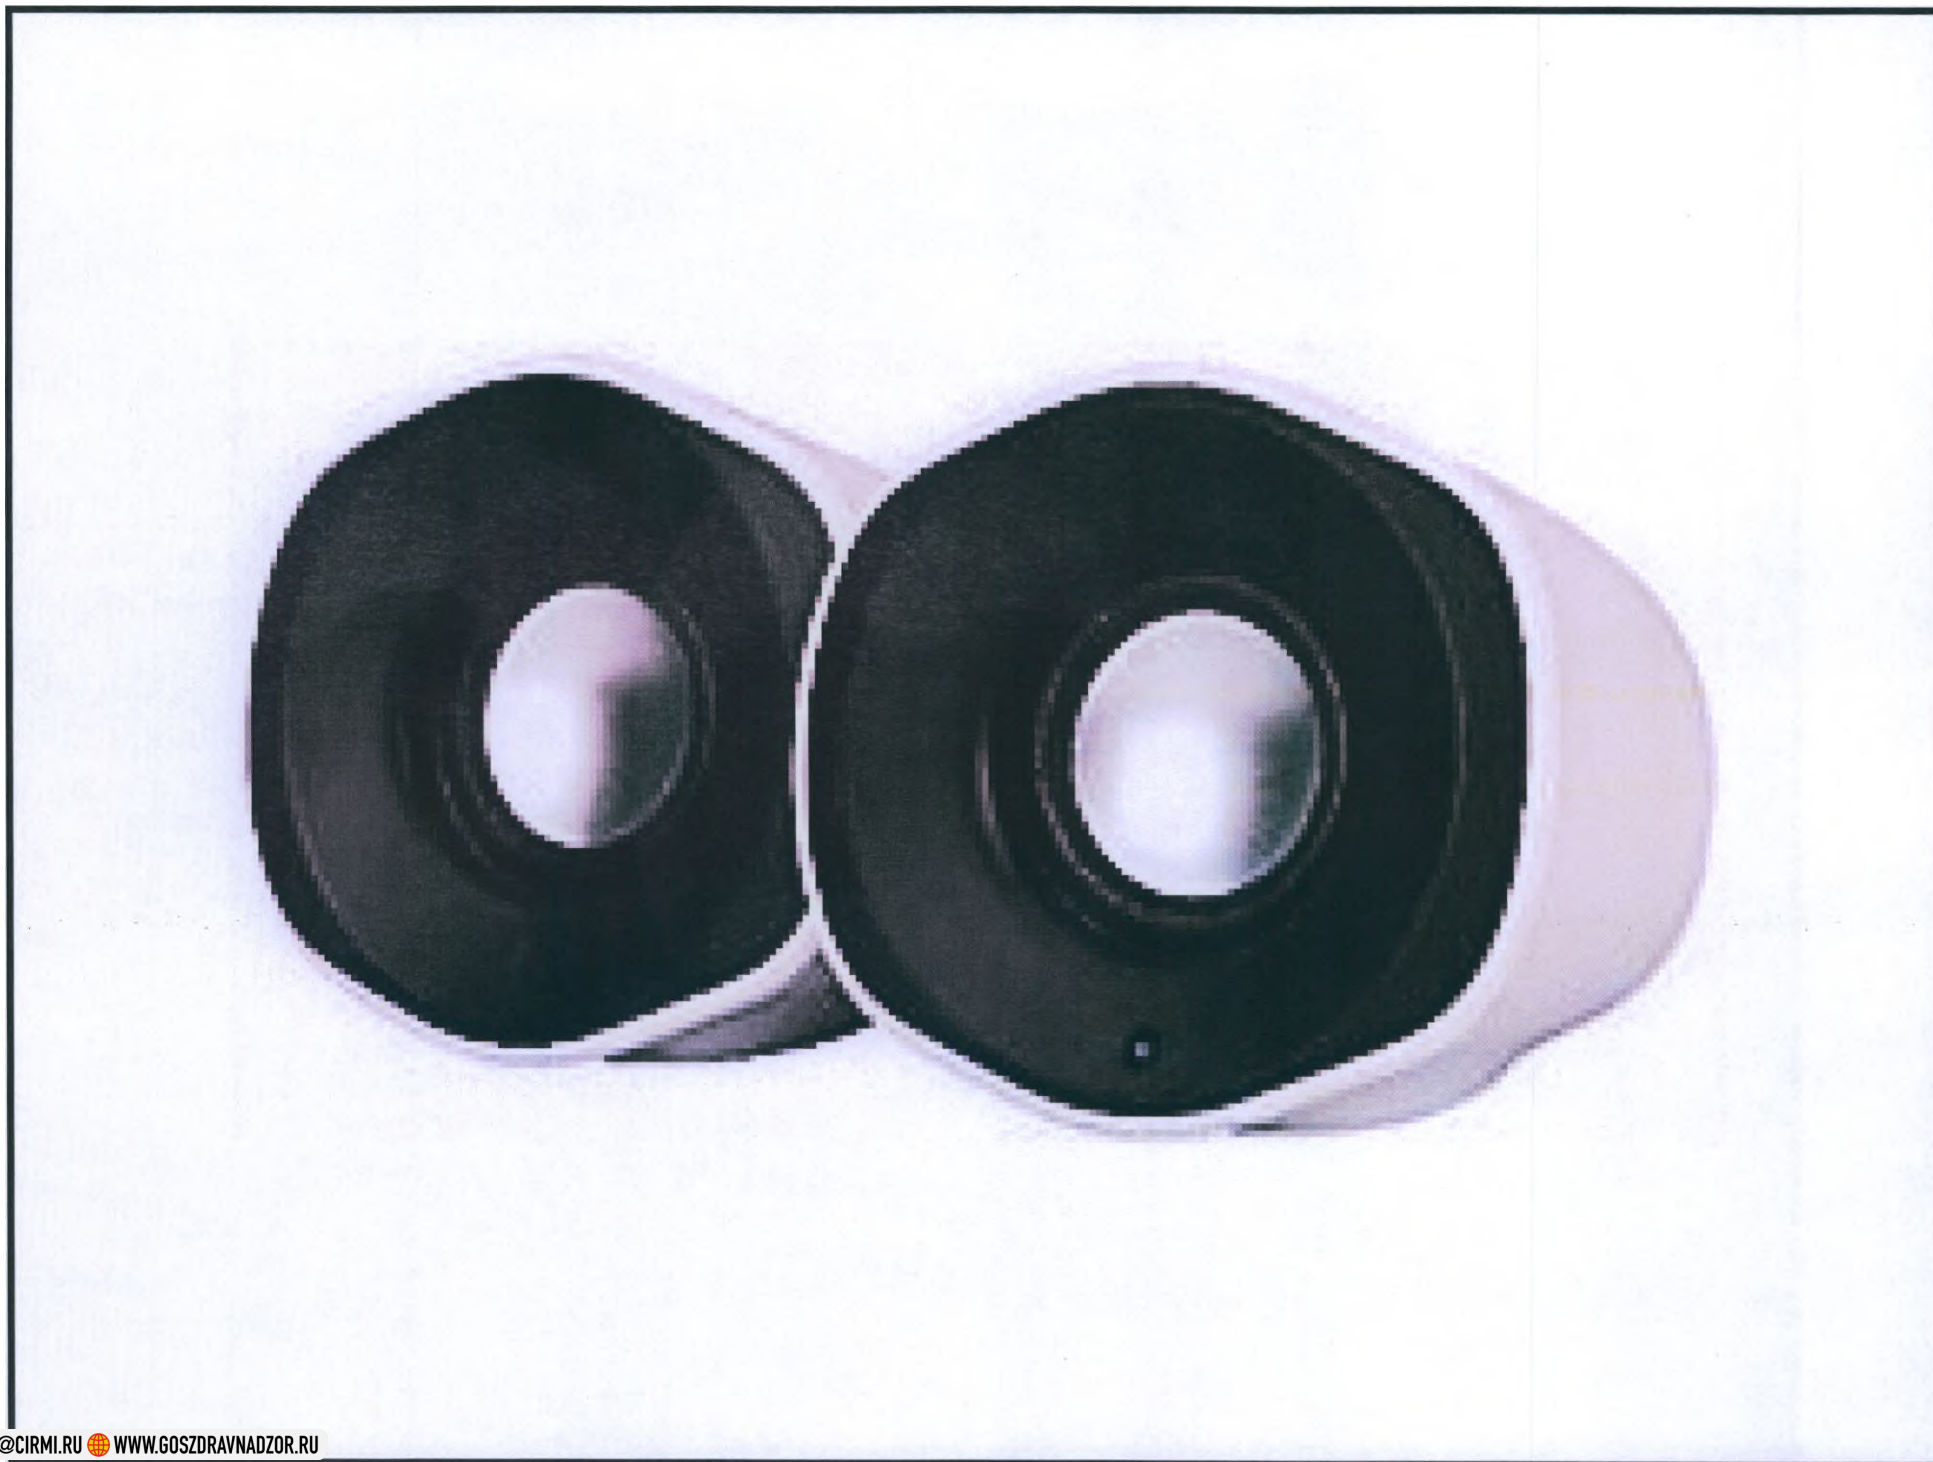

10. Цифровой регистратор (Цифровой регистратор PRN 50-M+)

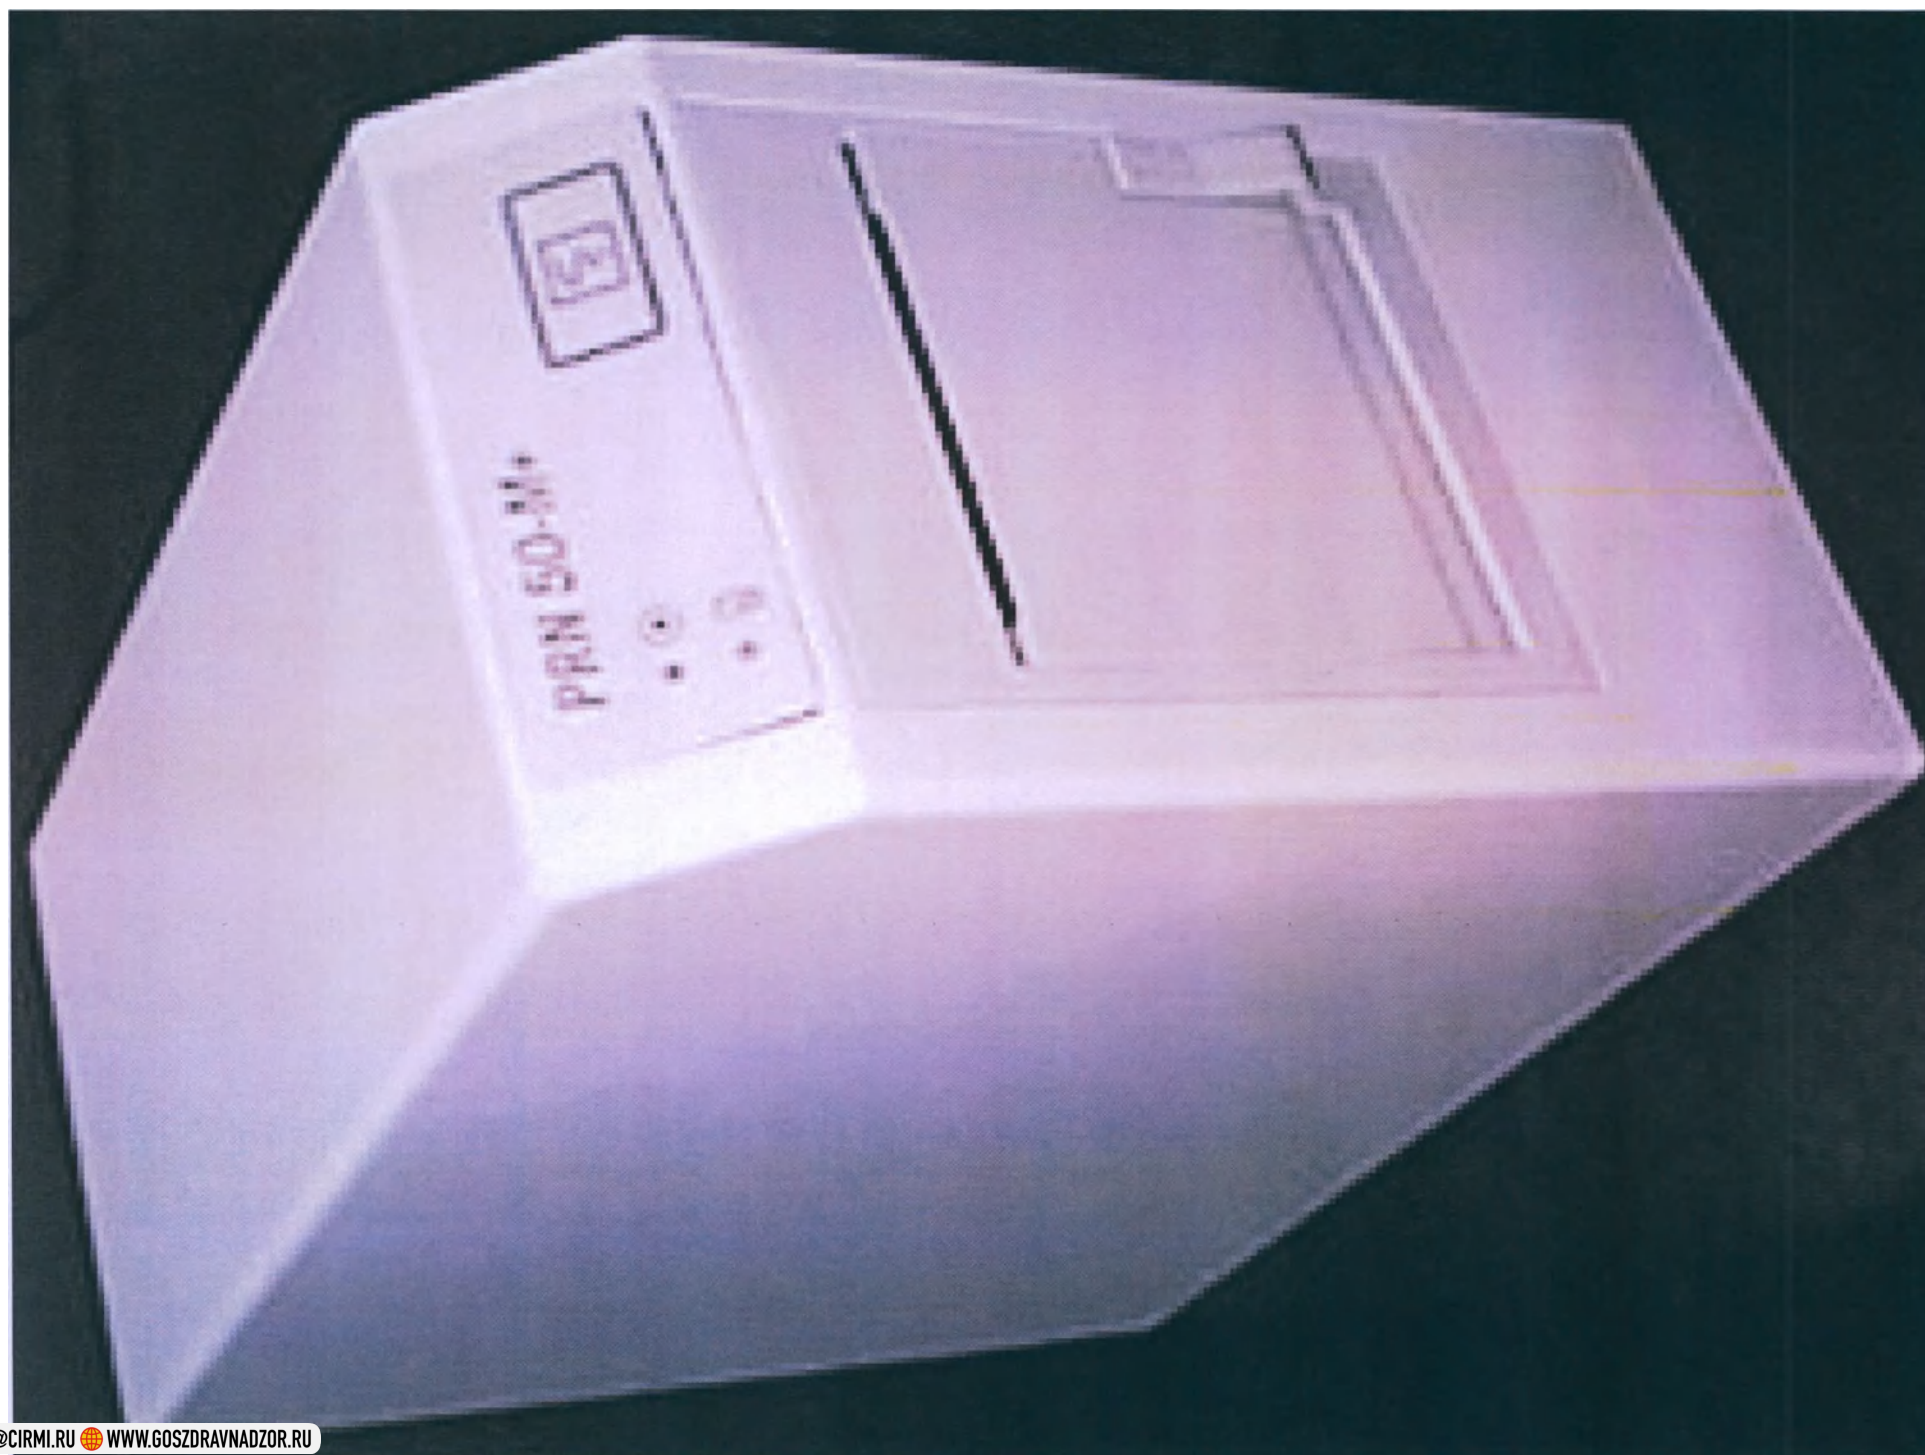


10. Цифровой регистратор (Цифровой регистратор PRN 50-M)

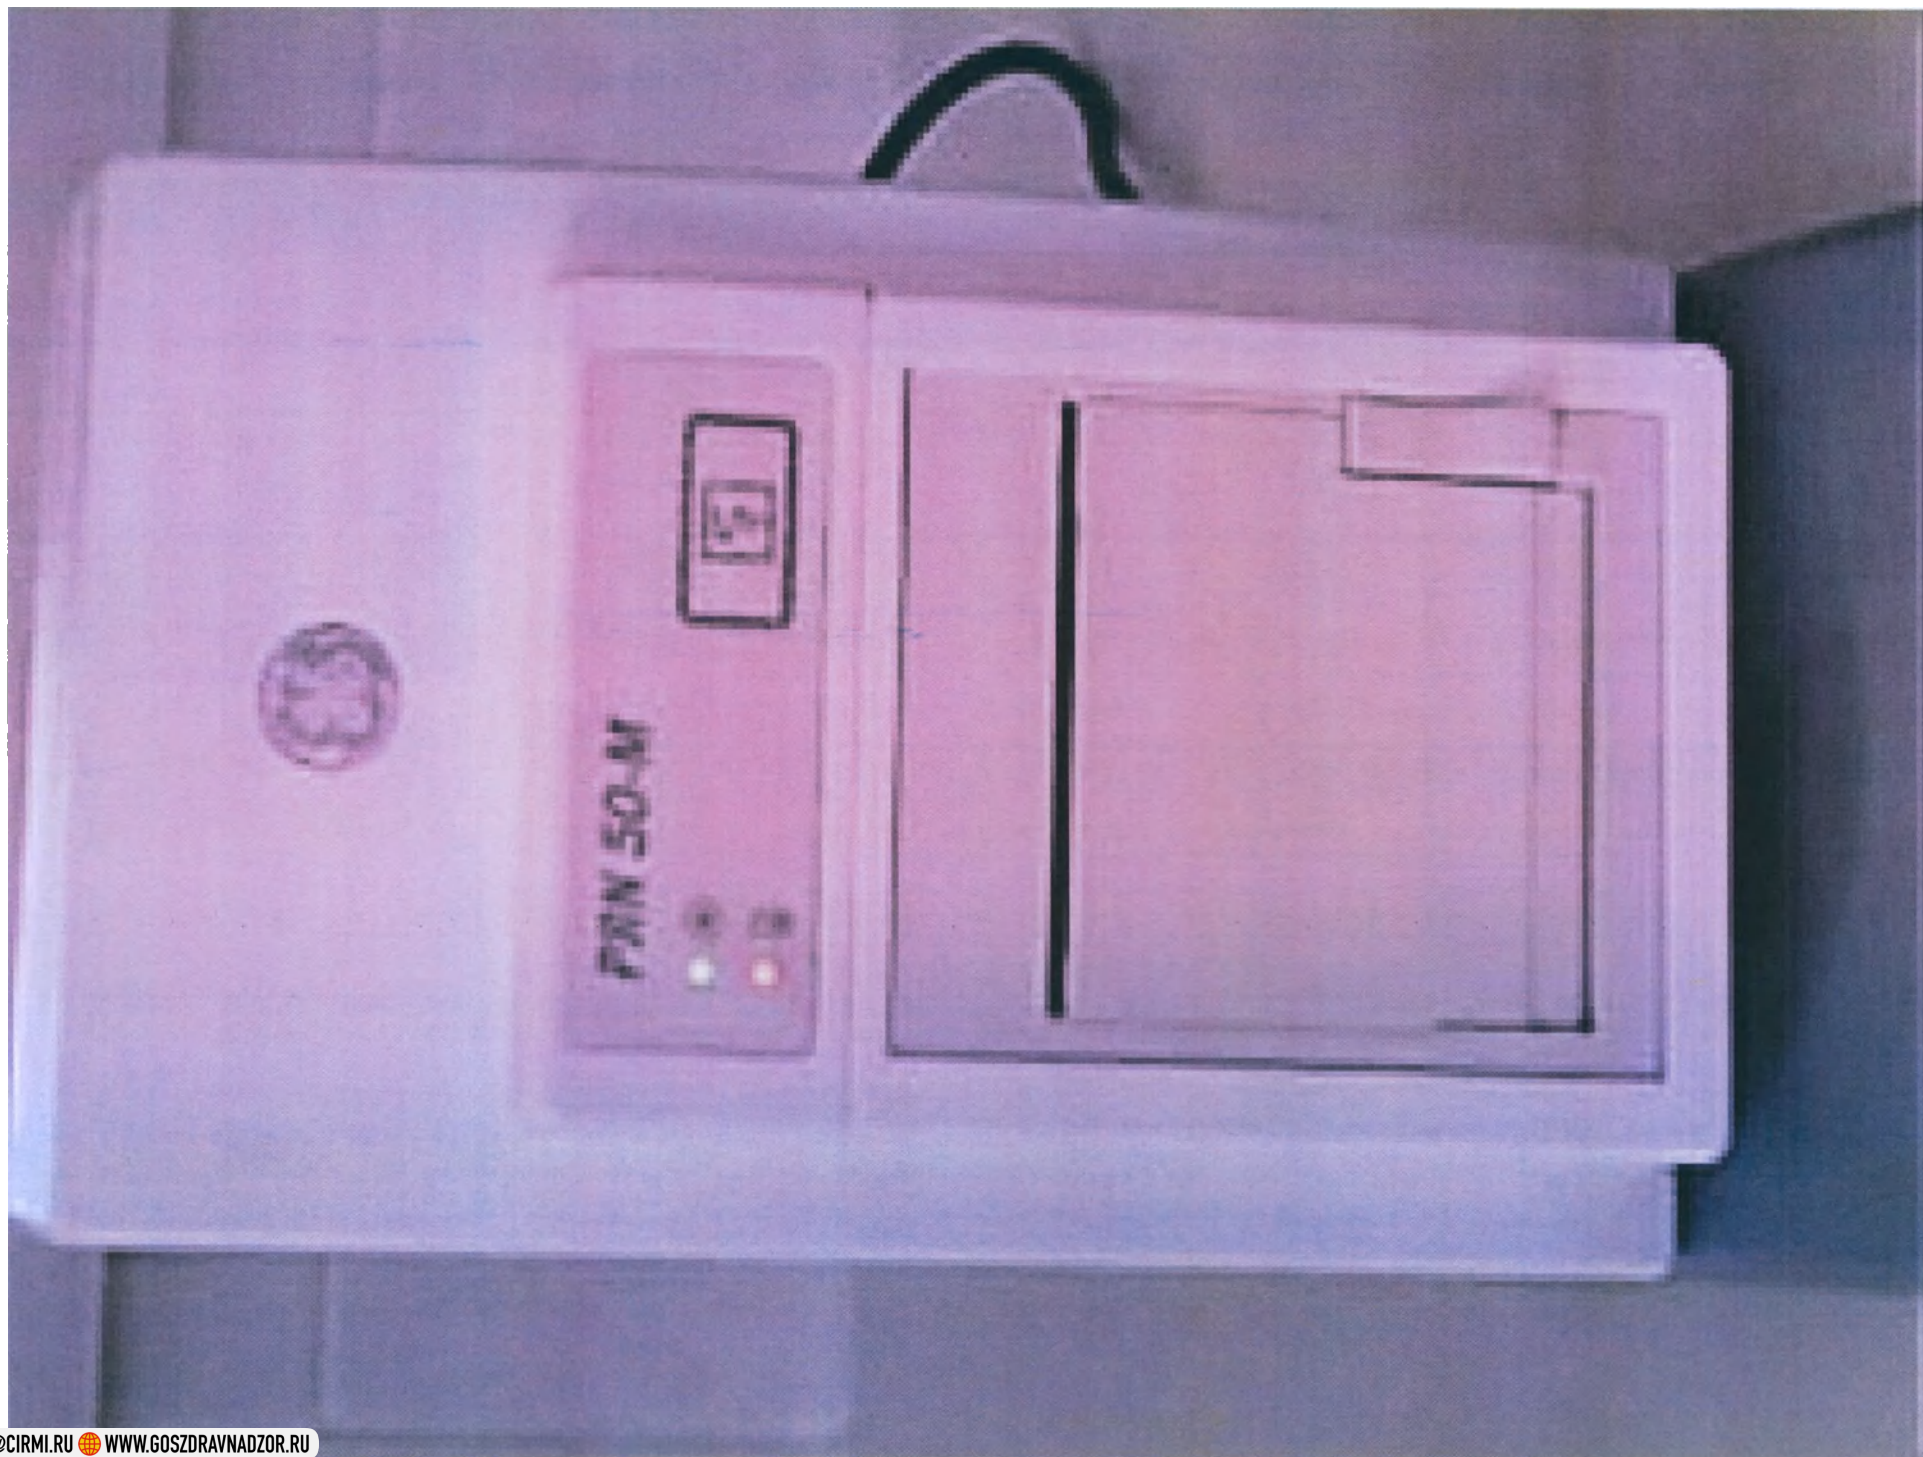


11. Вертикальная опорная стойка.




11. Вертикальная опорная стойка.

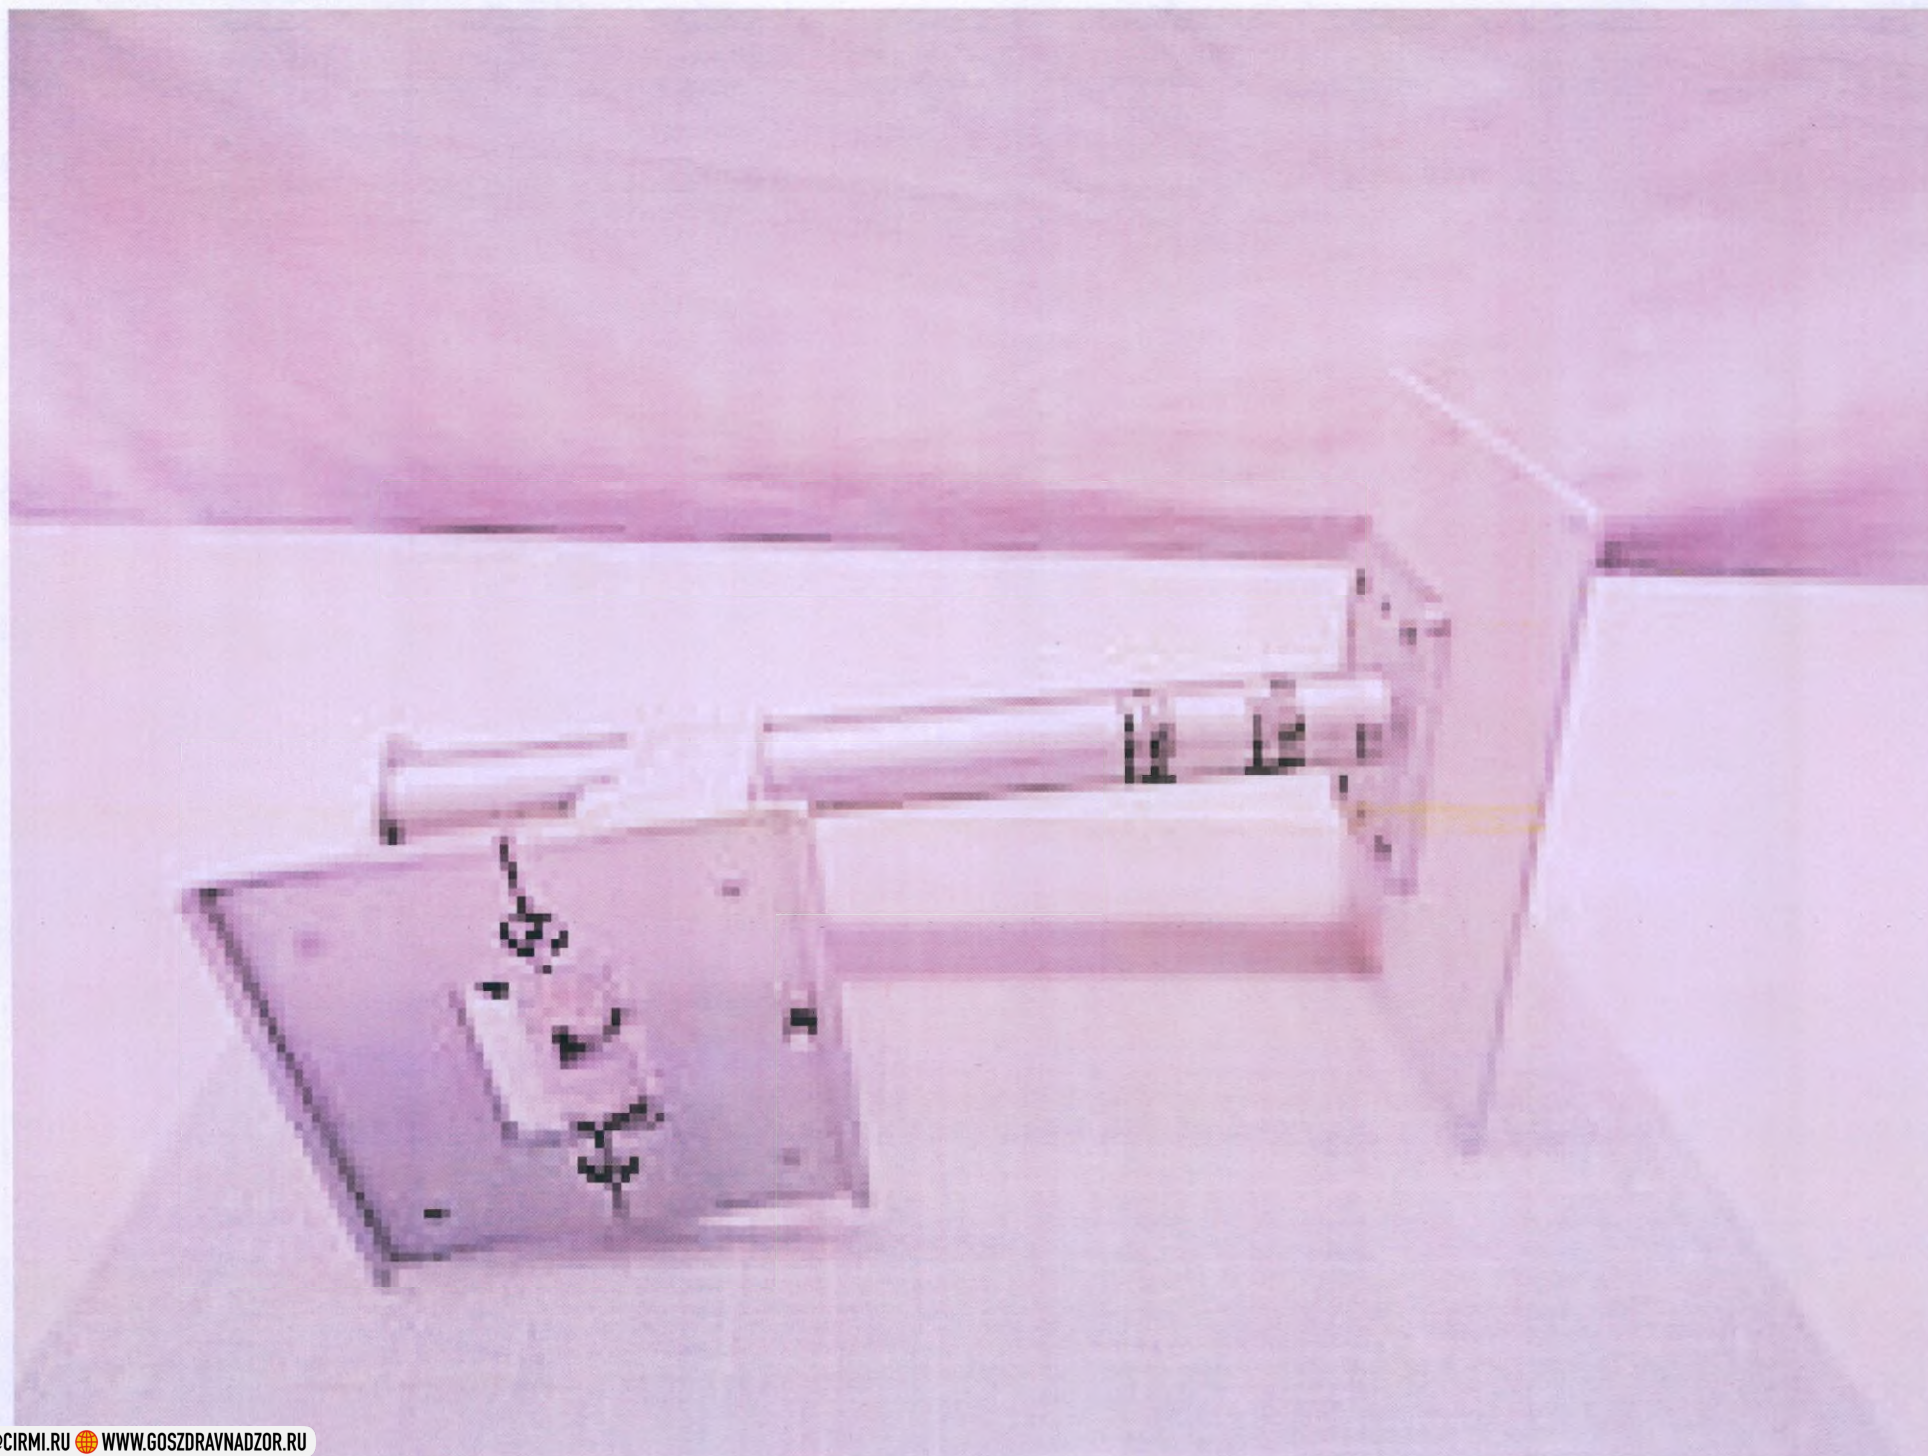


12. Программное обеспечение (не более 10 шт.).

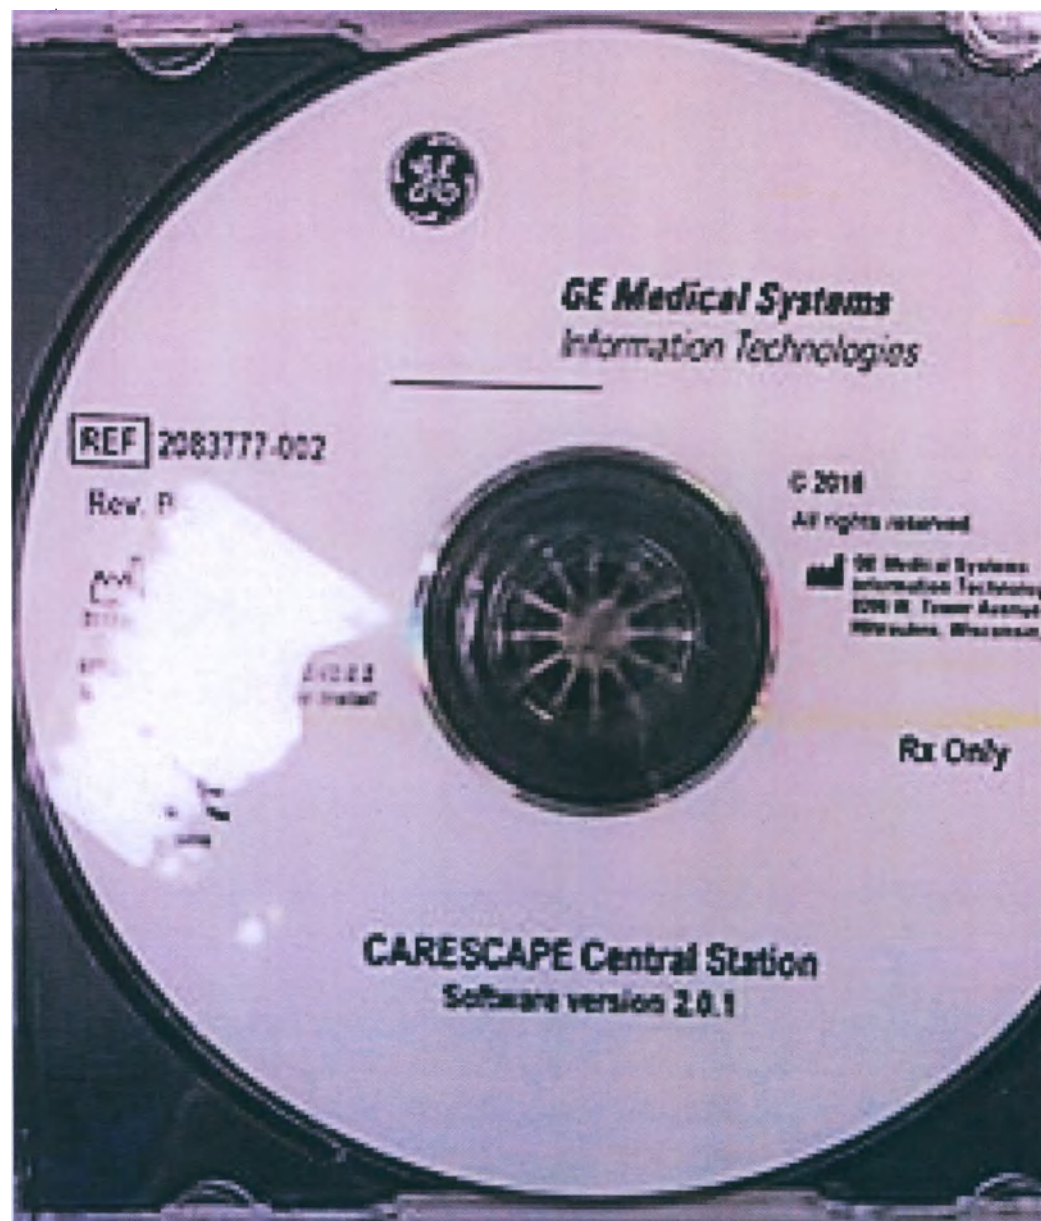


12. Программное обеспечение (не более 10 шт.).

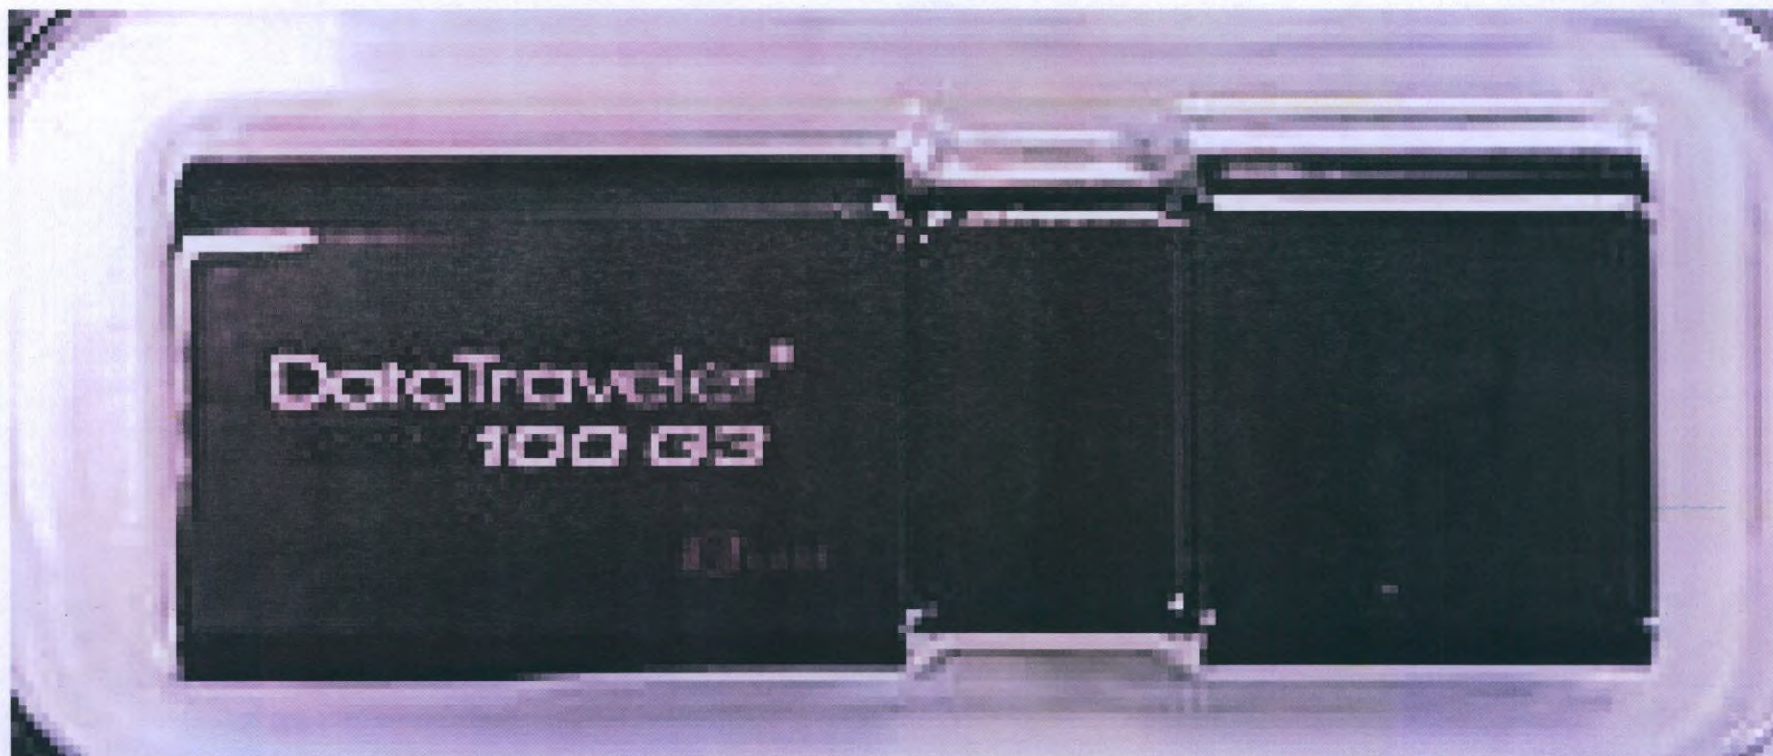


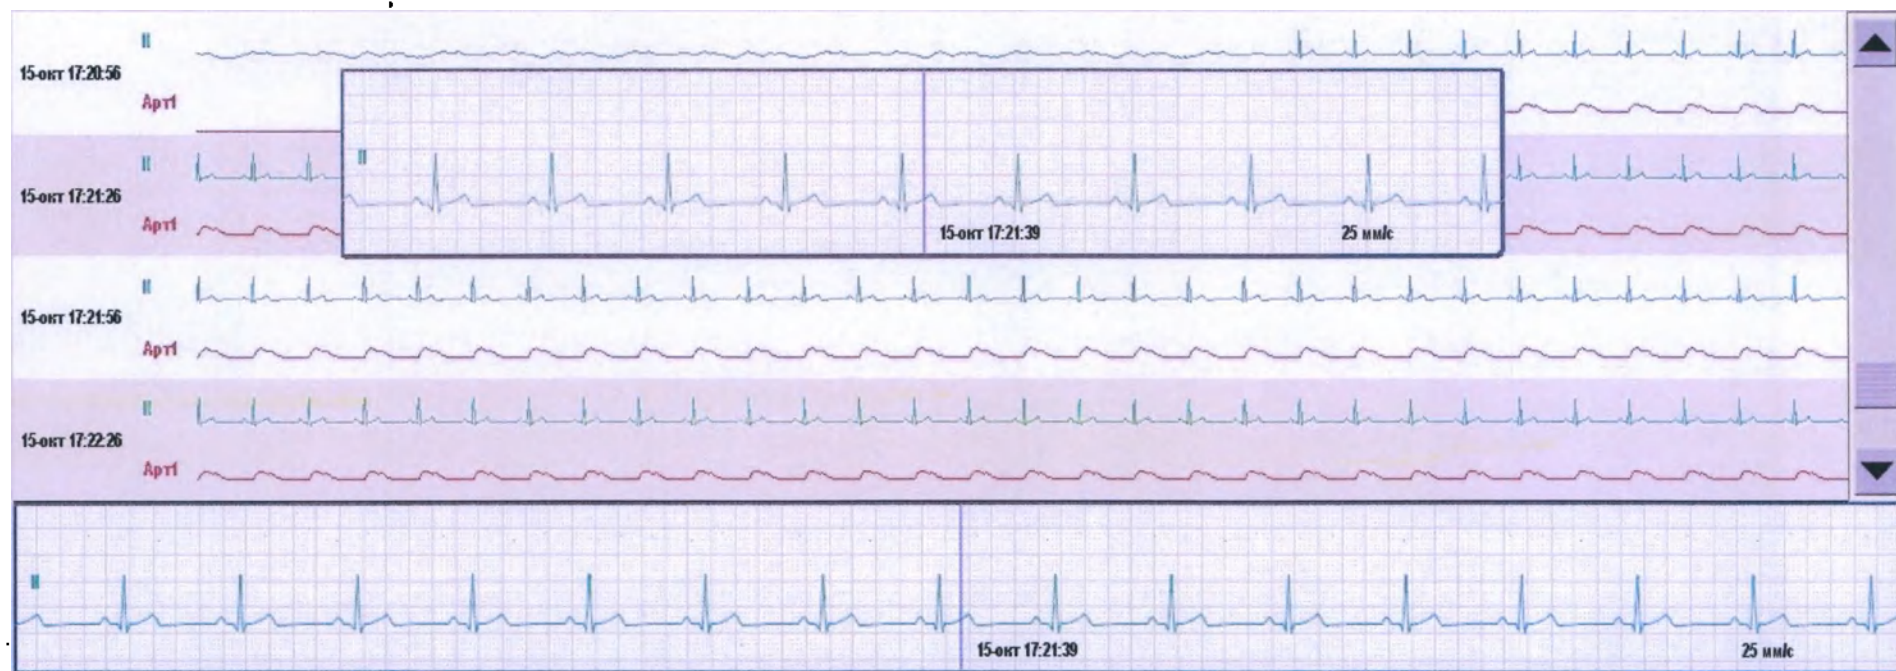





14. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Страница полной записи» на бумажном или электронном носителе.

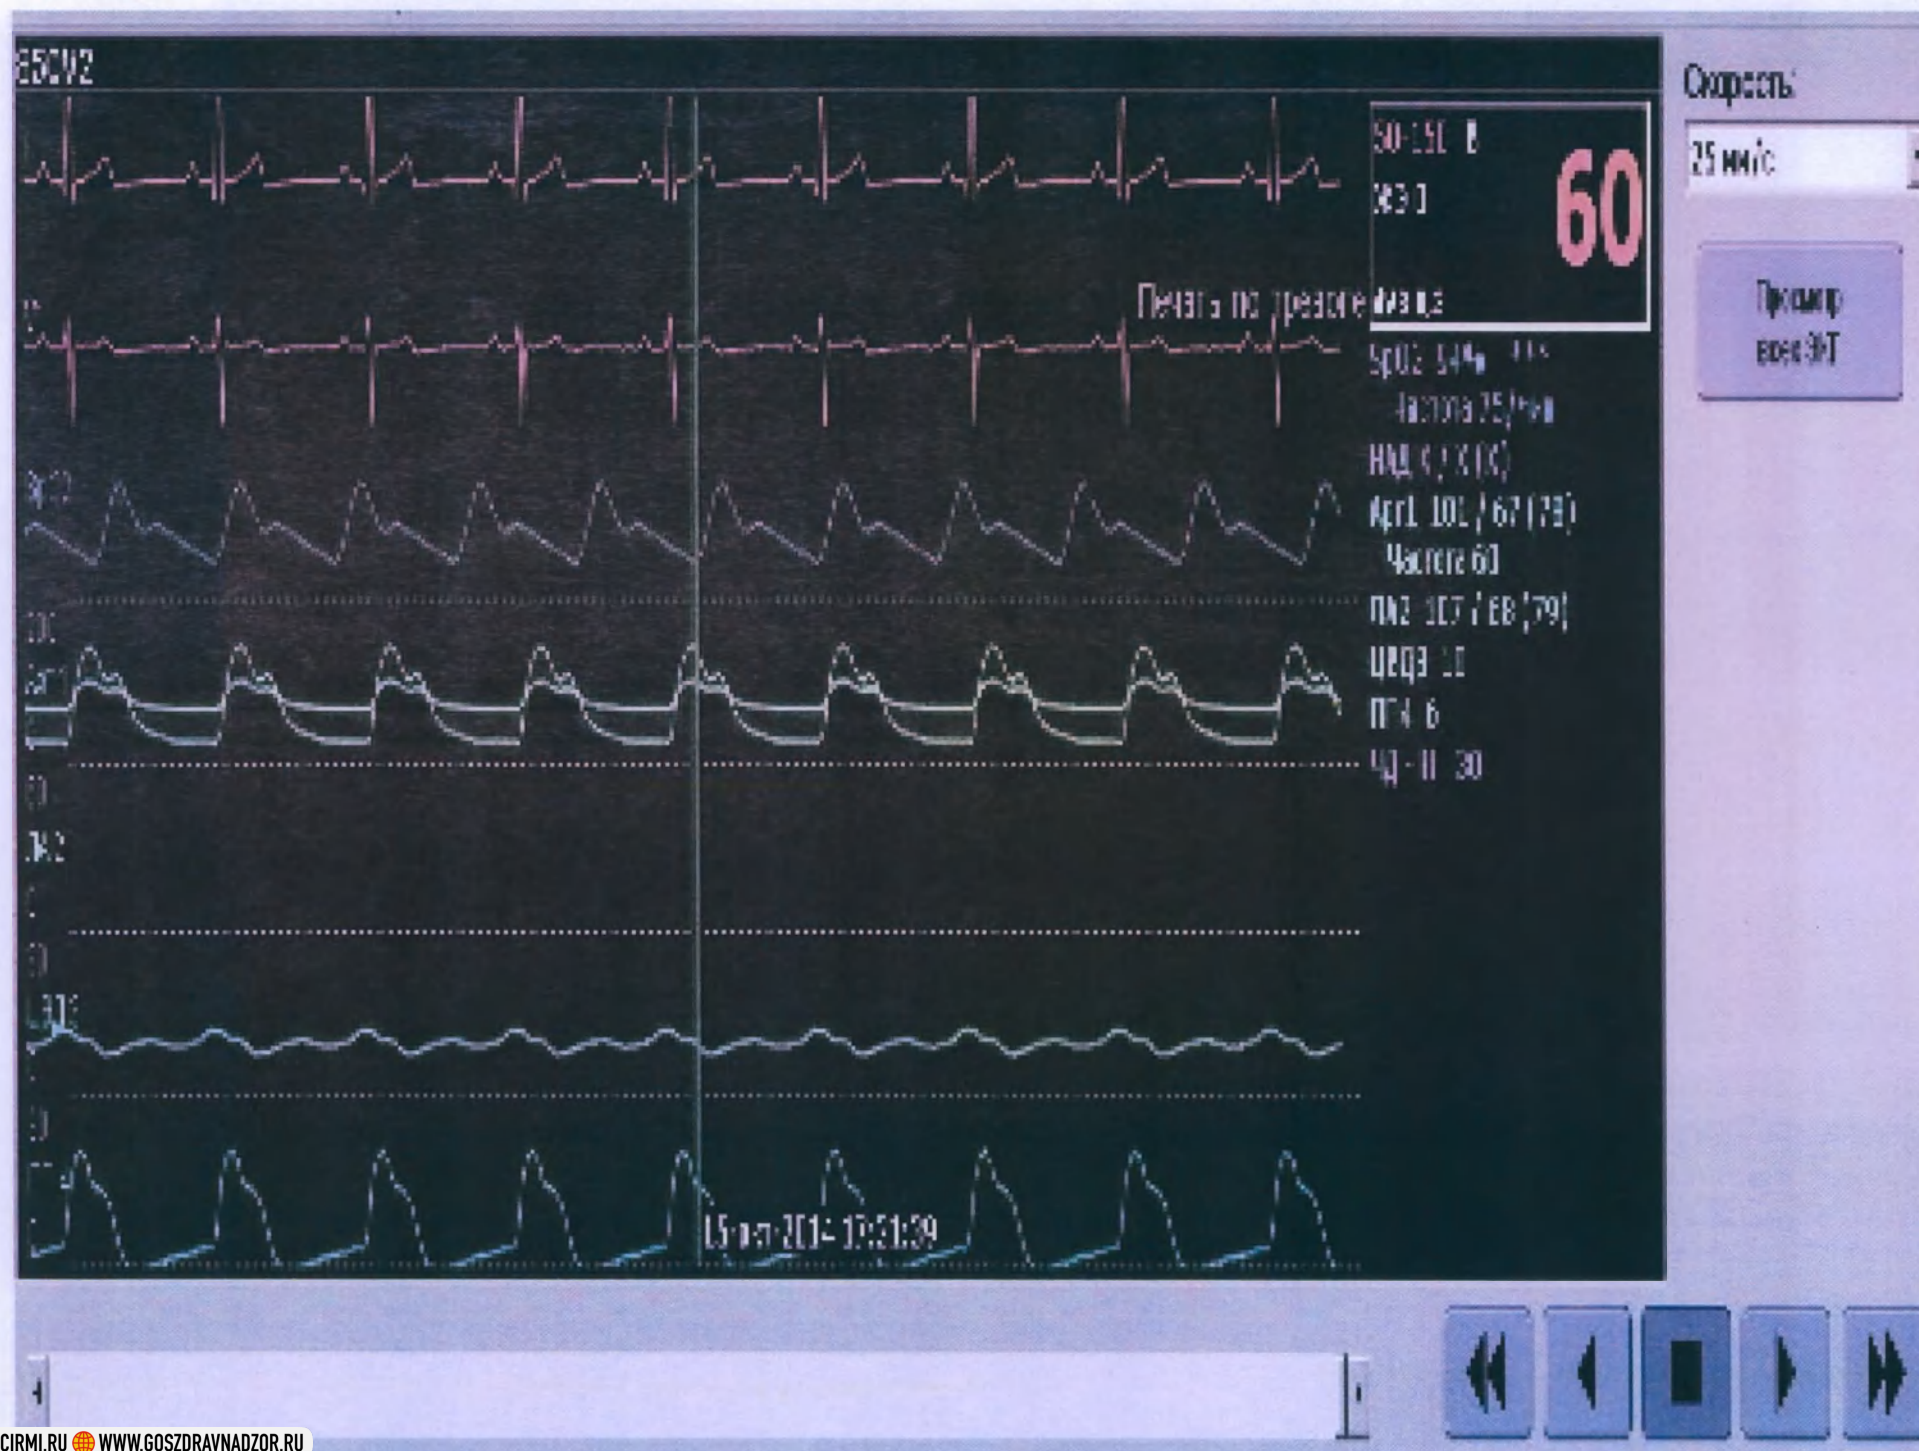


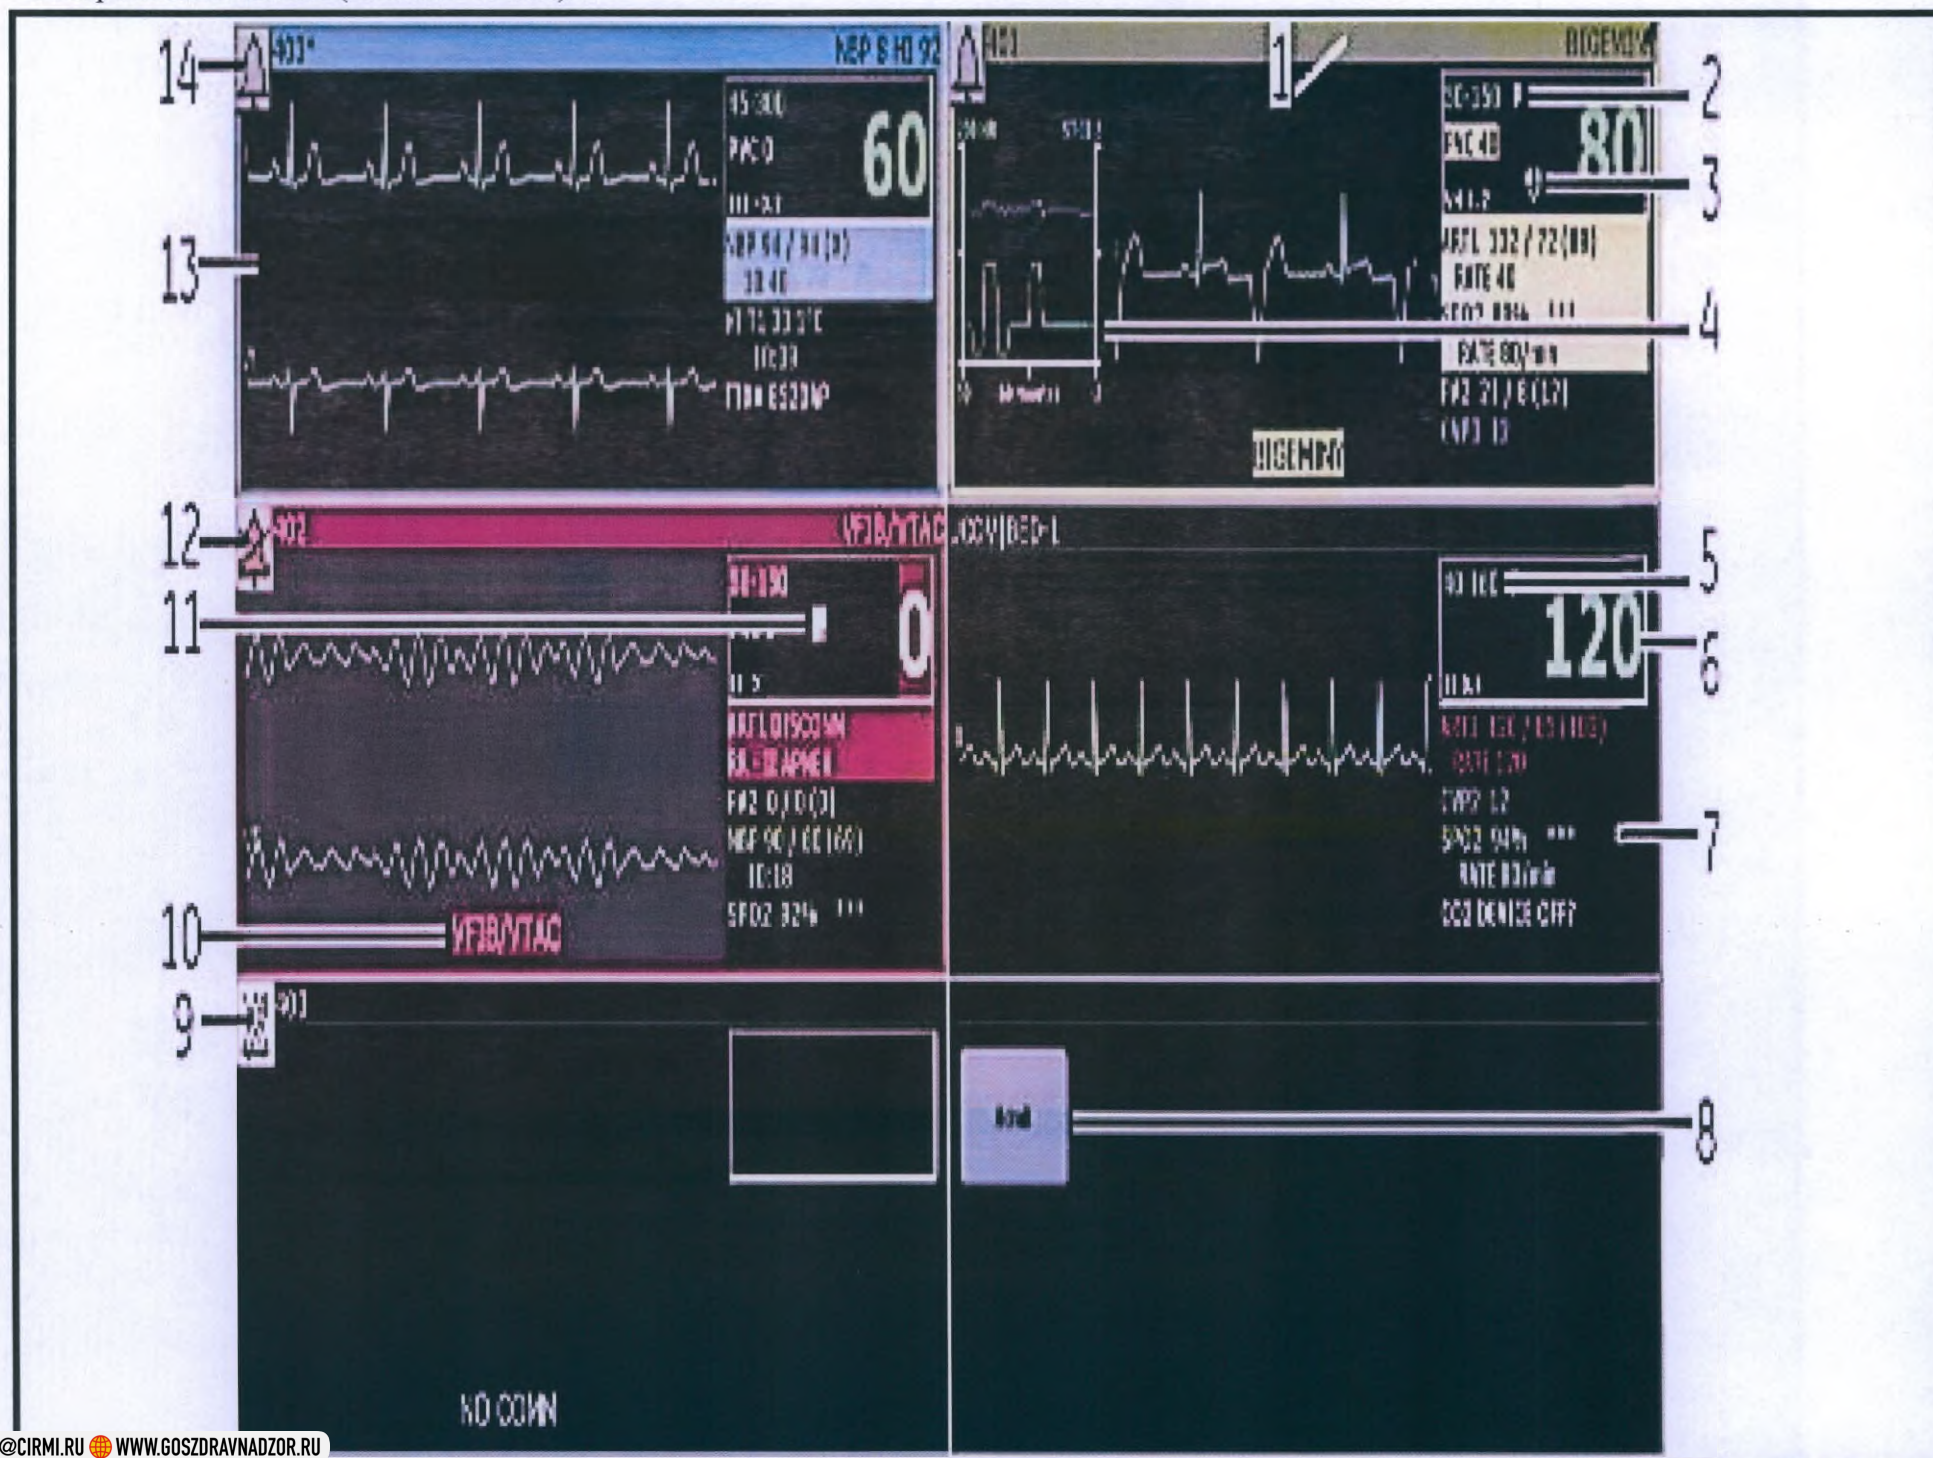

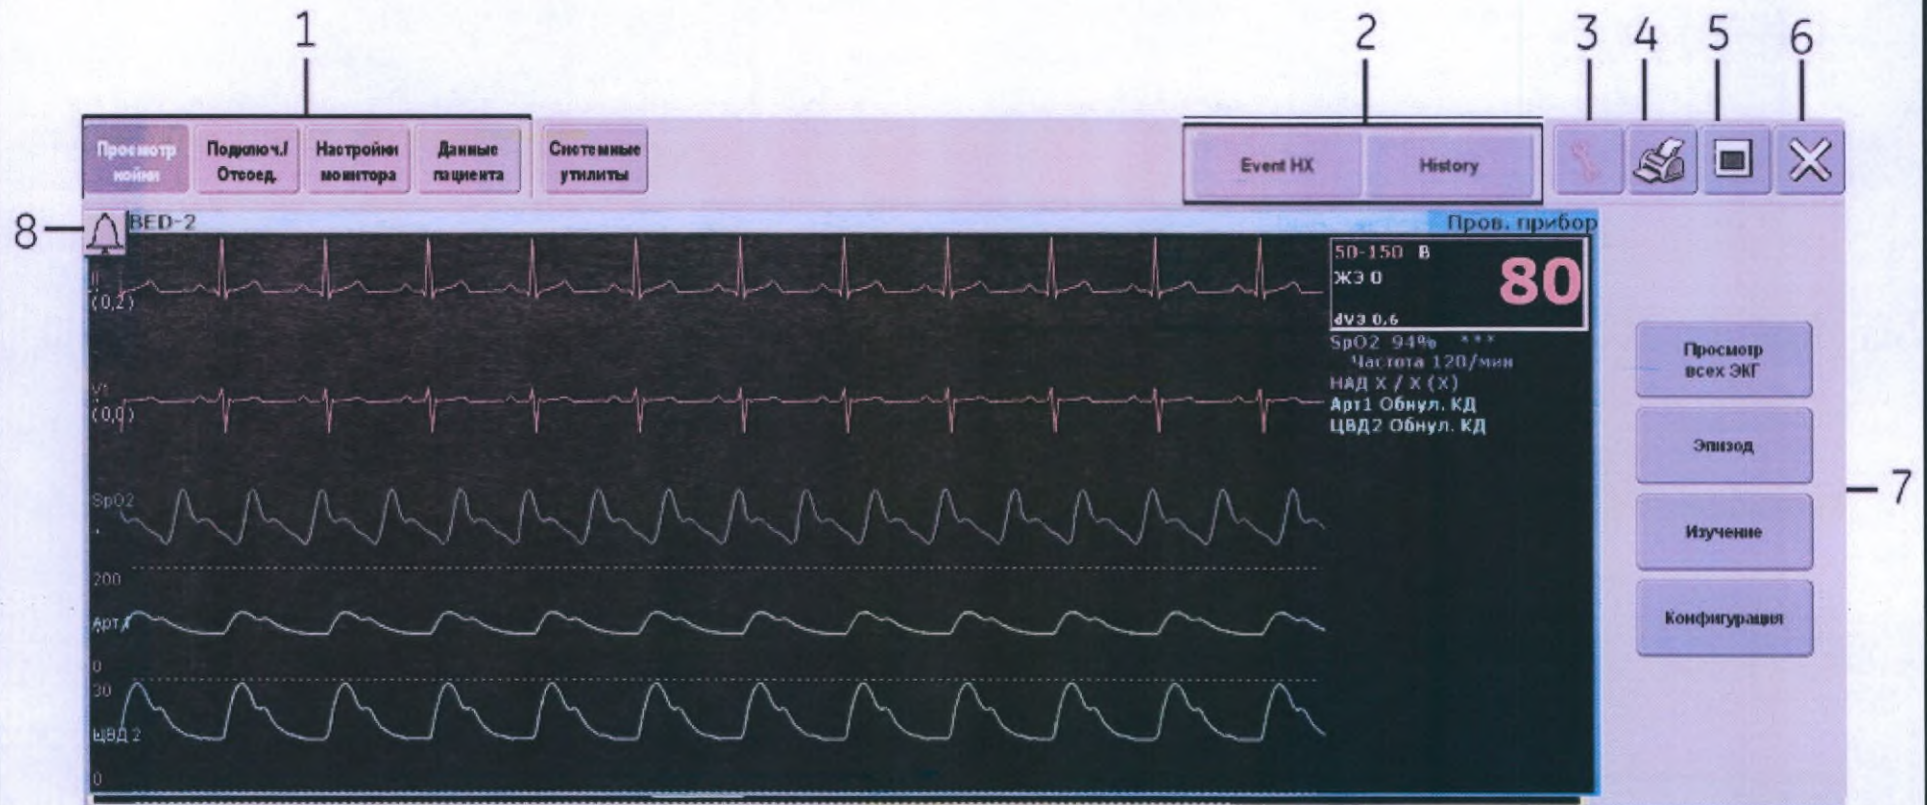


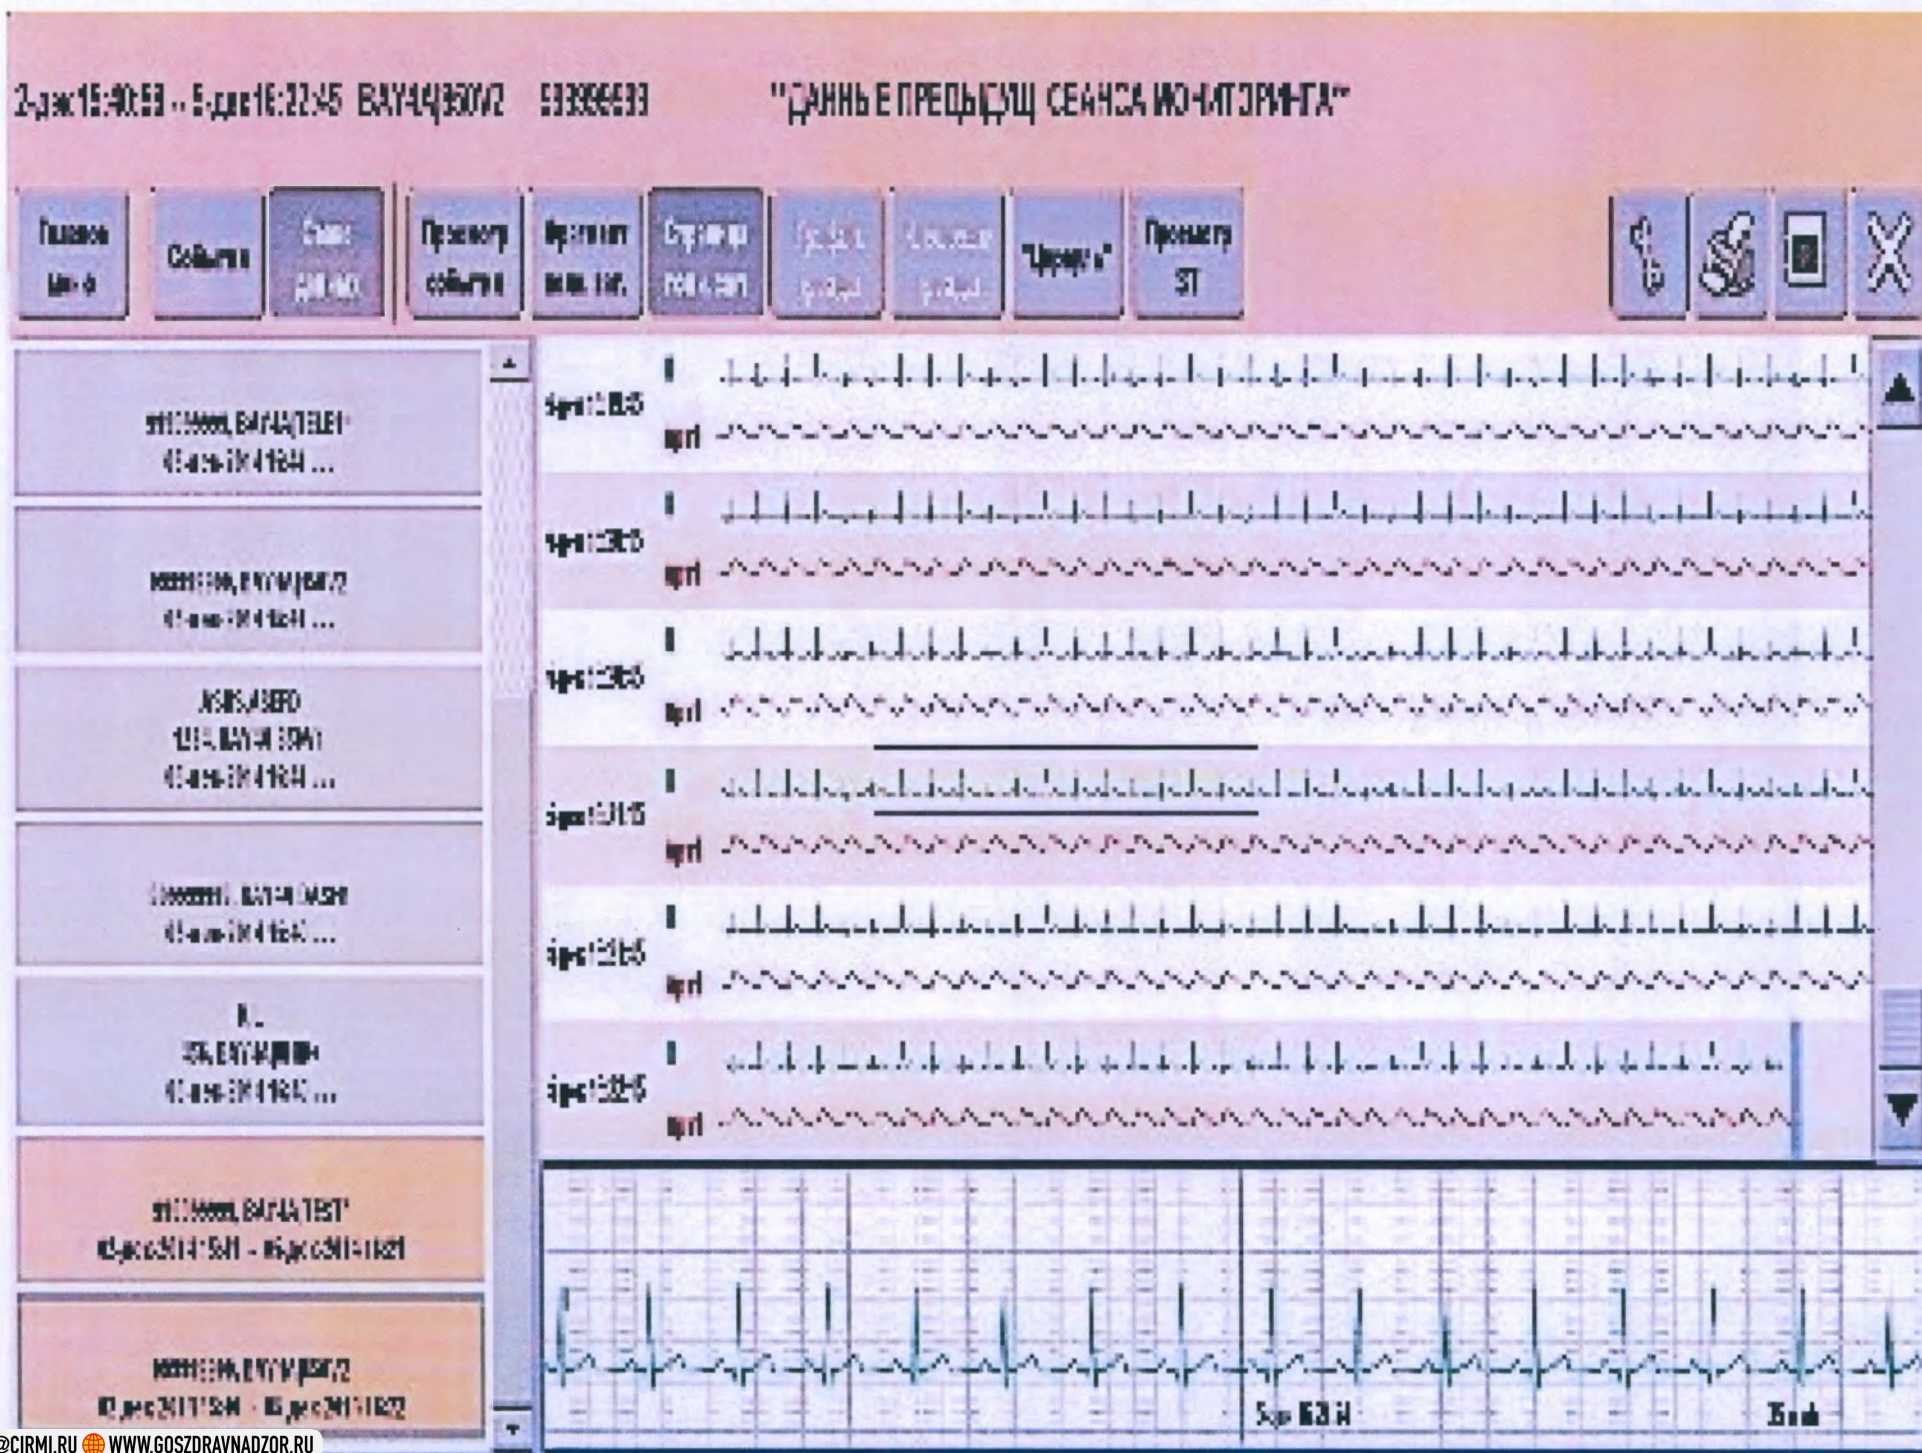


18. Лицензионный ключ активации пакета приложения «События» на бумажном или электронном носителе.

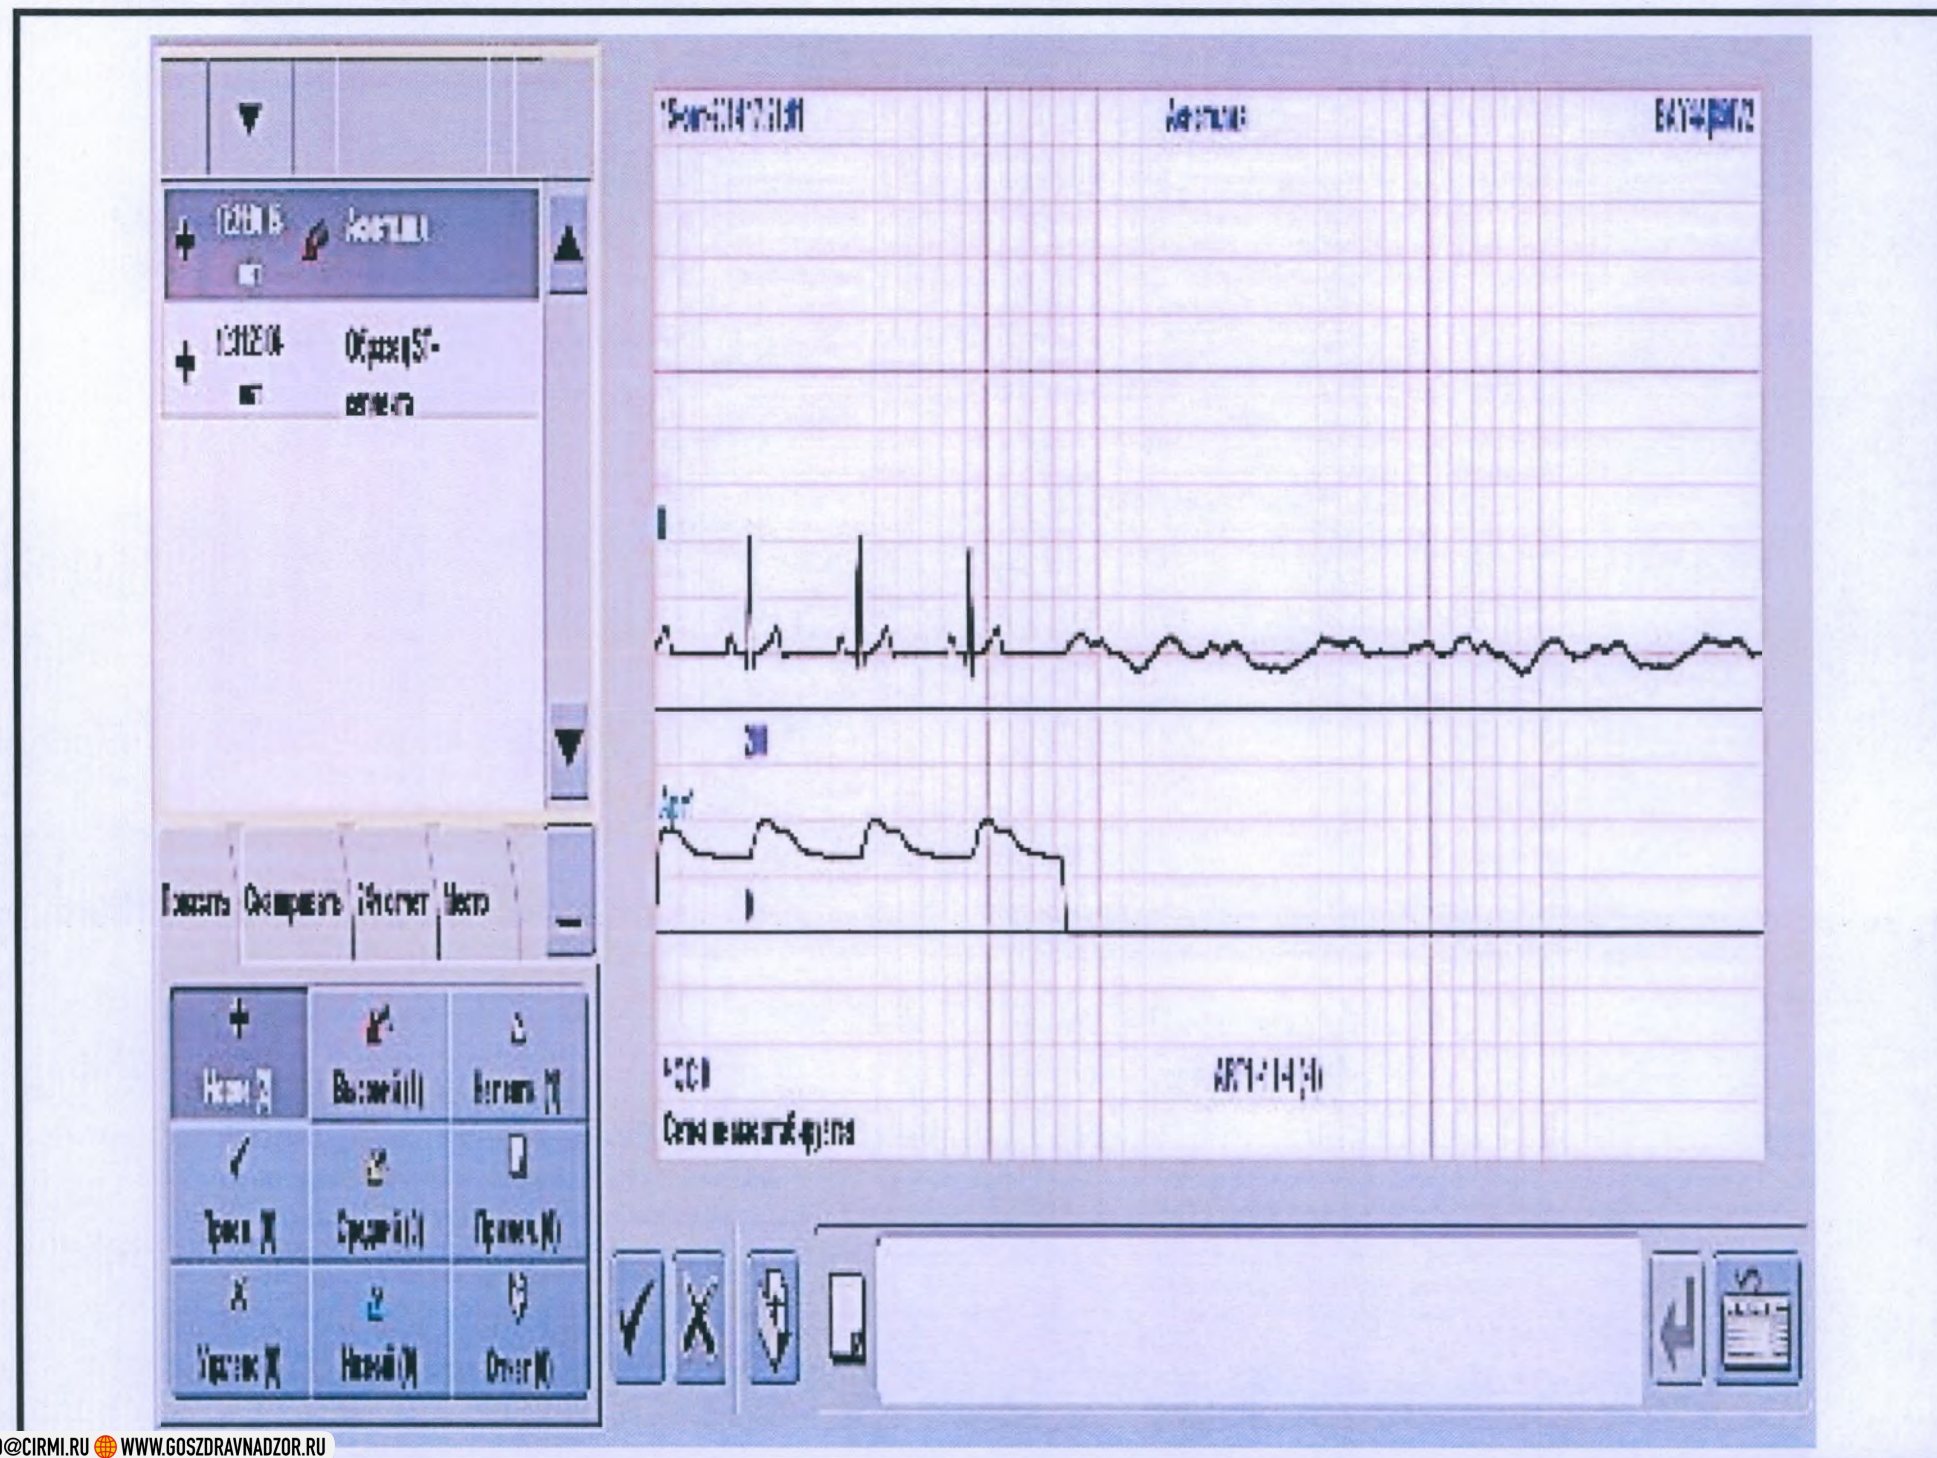


19. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Просмотр событий» на бумажном или электронном носителе.

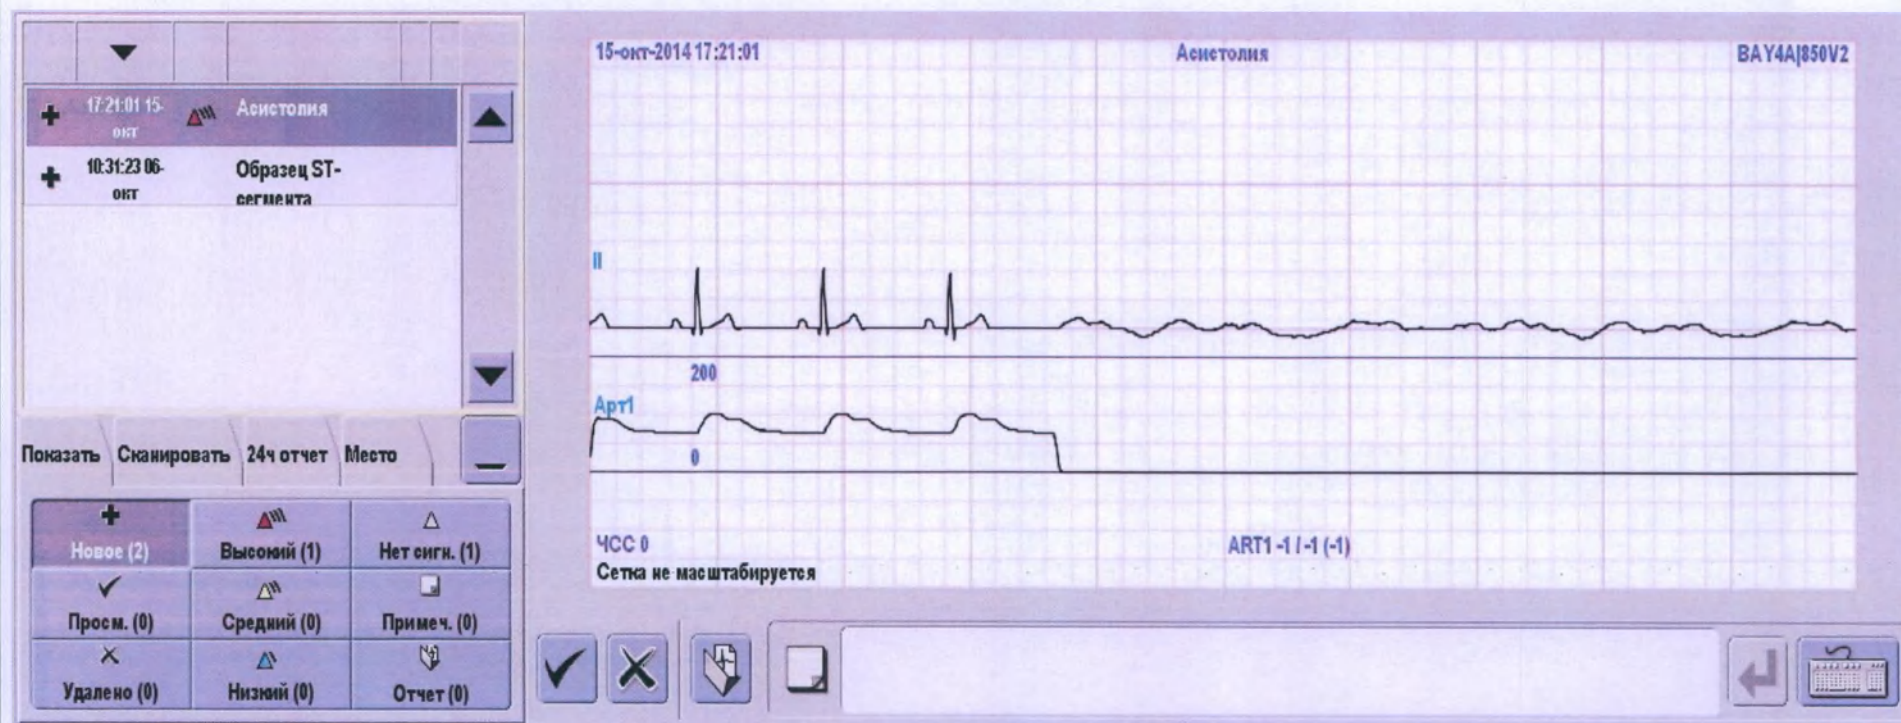

20. Лицензионные ключи активации пакета приложения «Графические тренды» на бумажном или электронном носителе (не более 16 шт.).

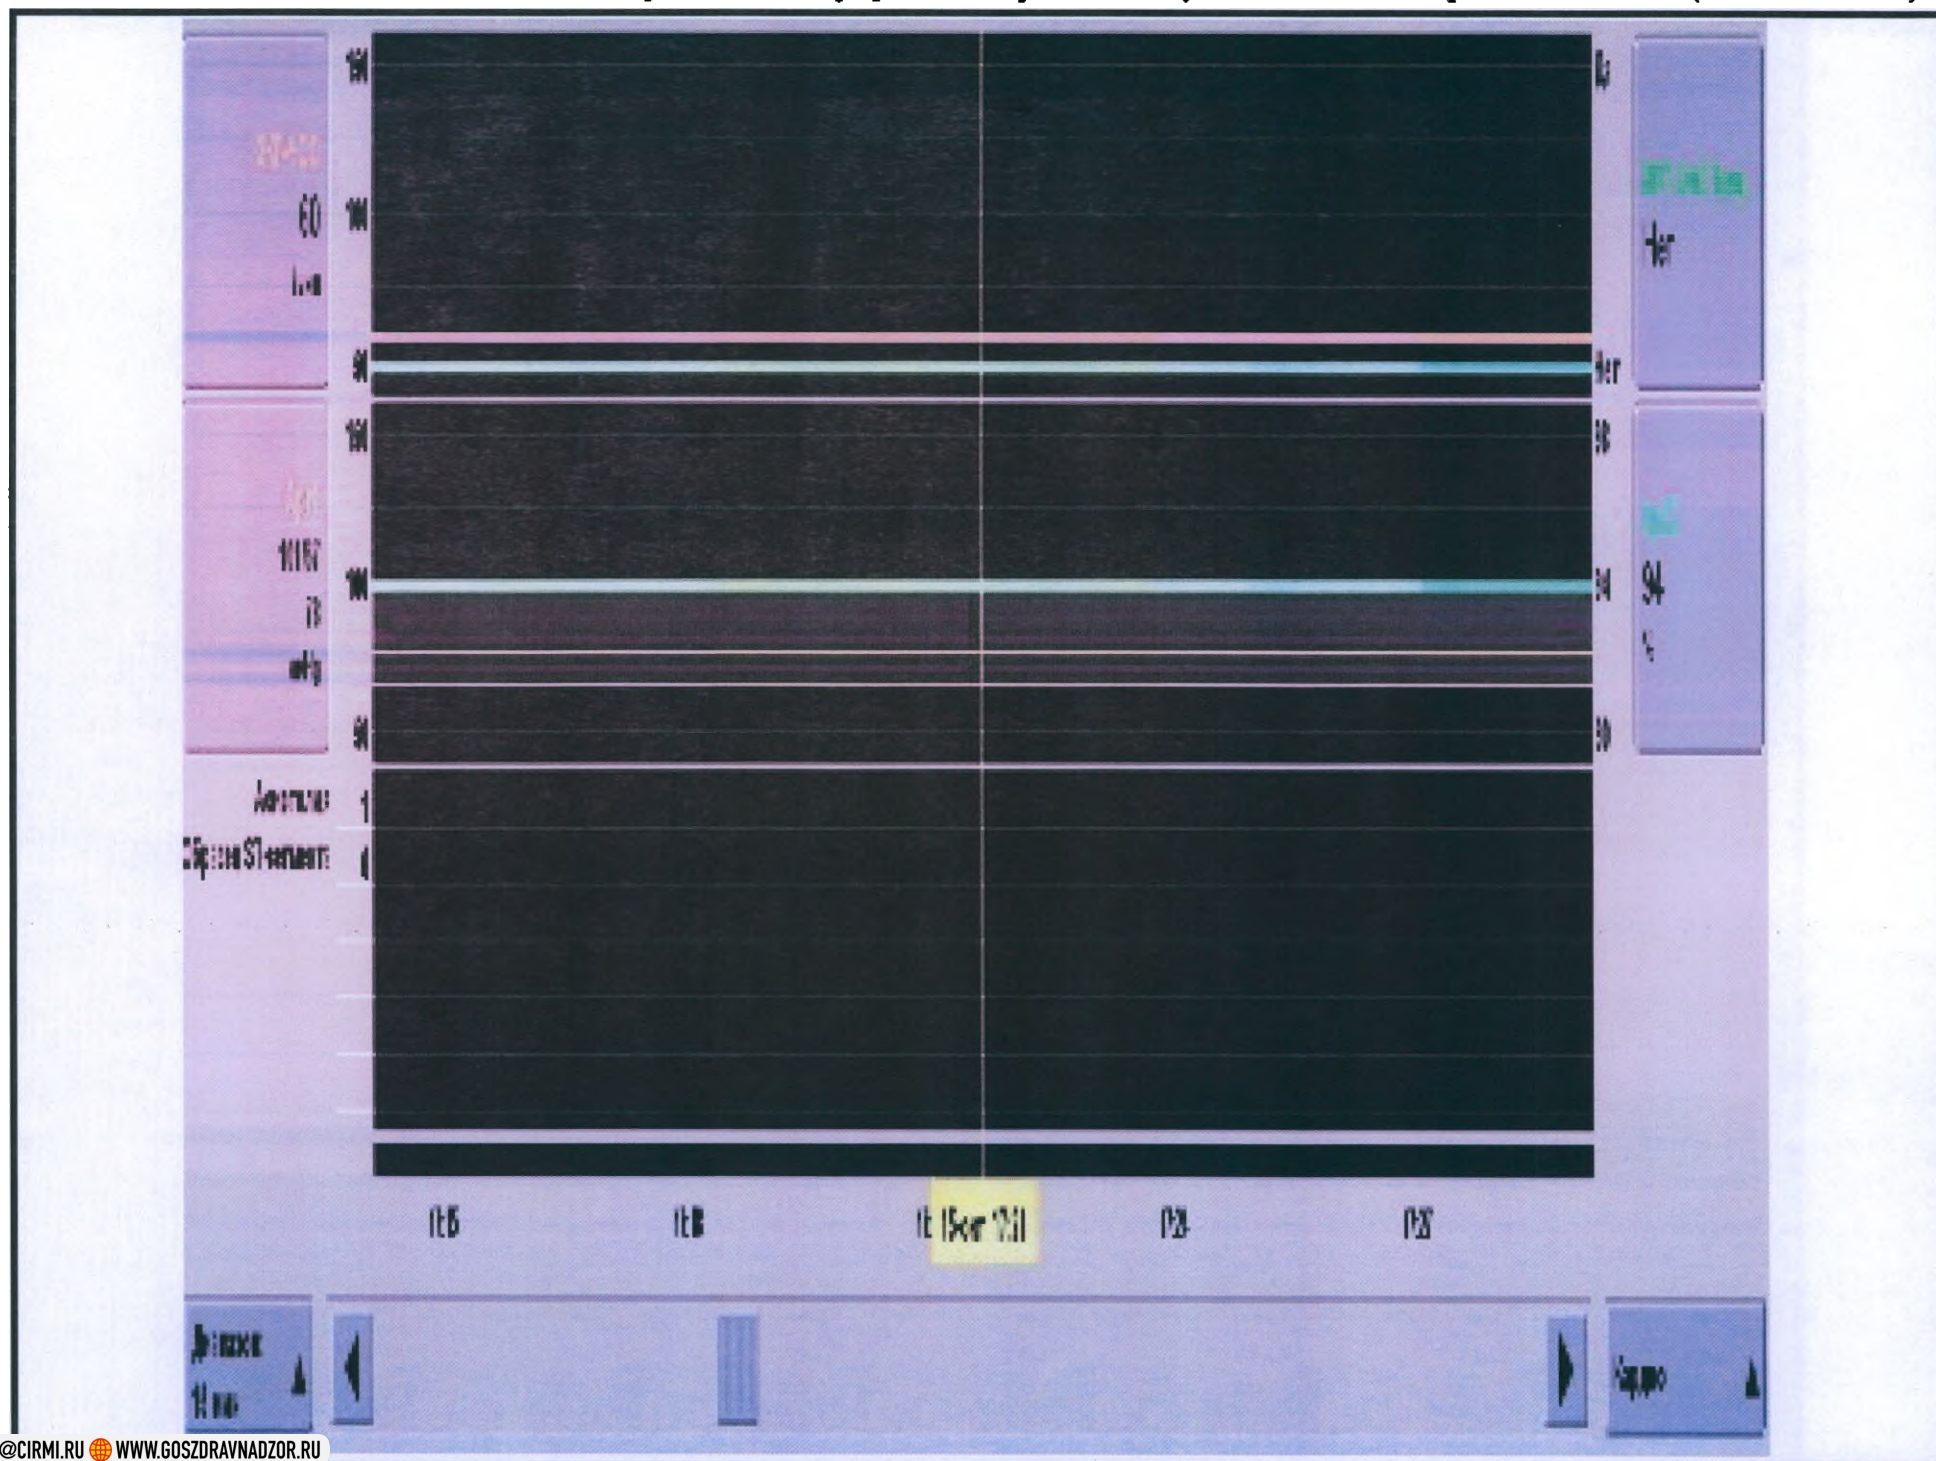

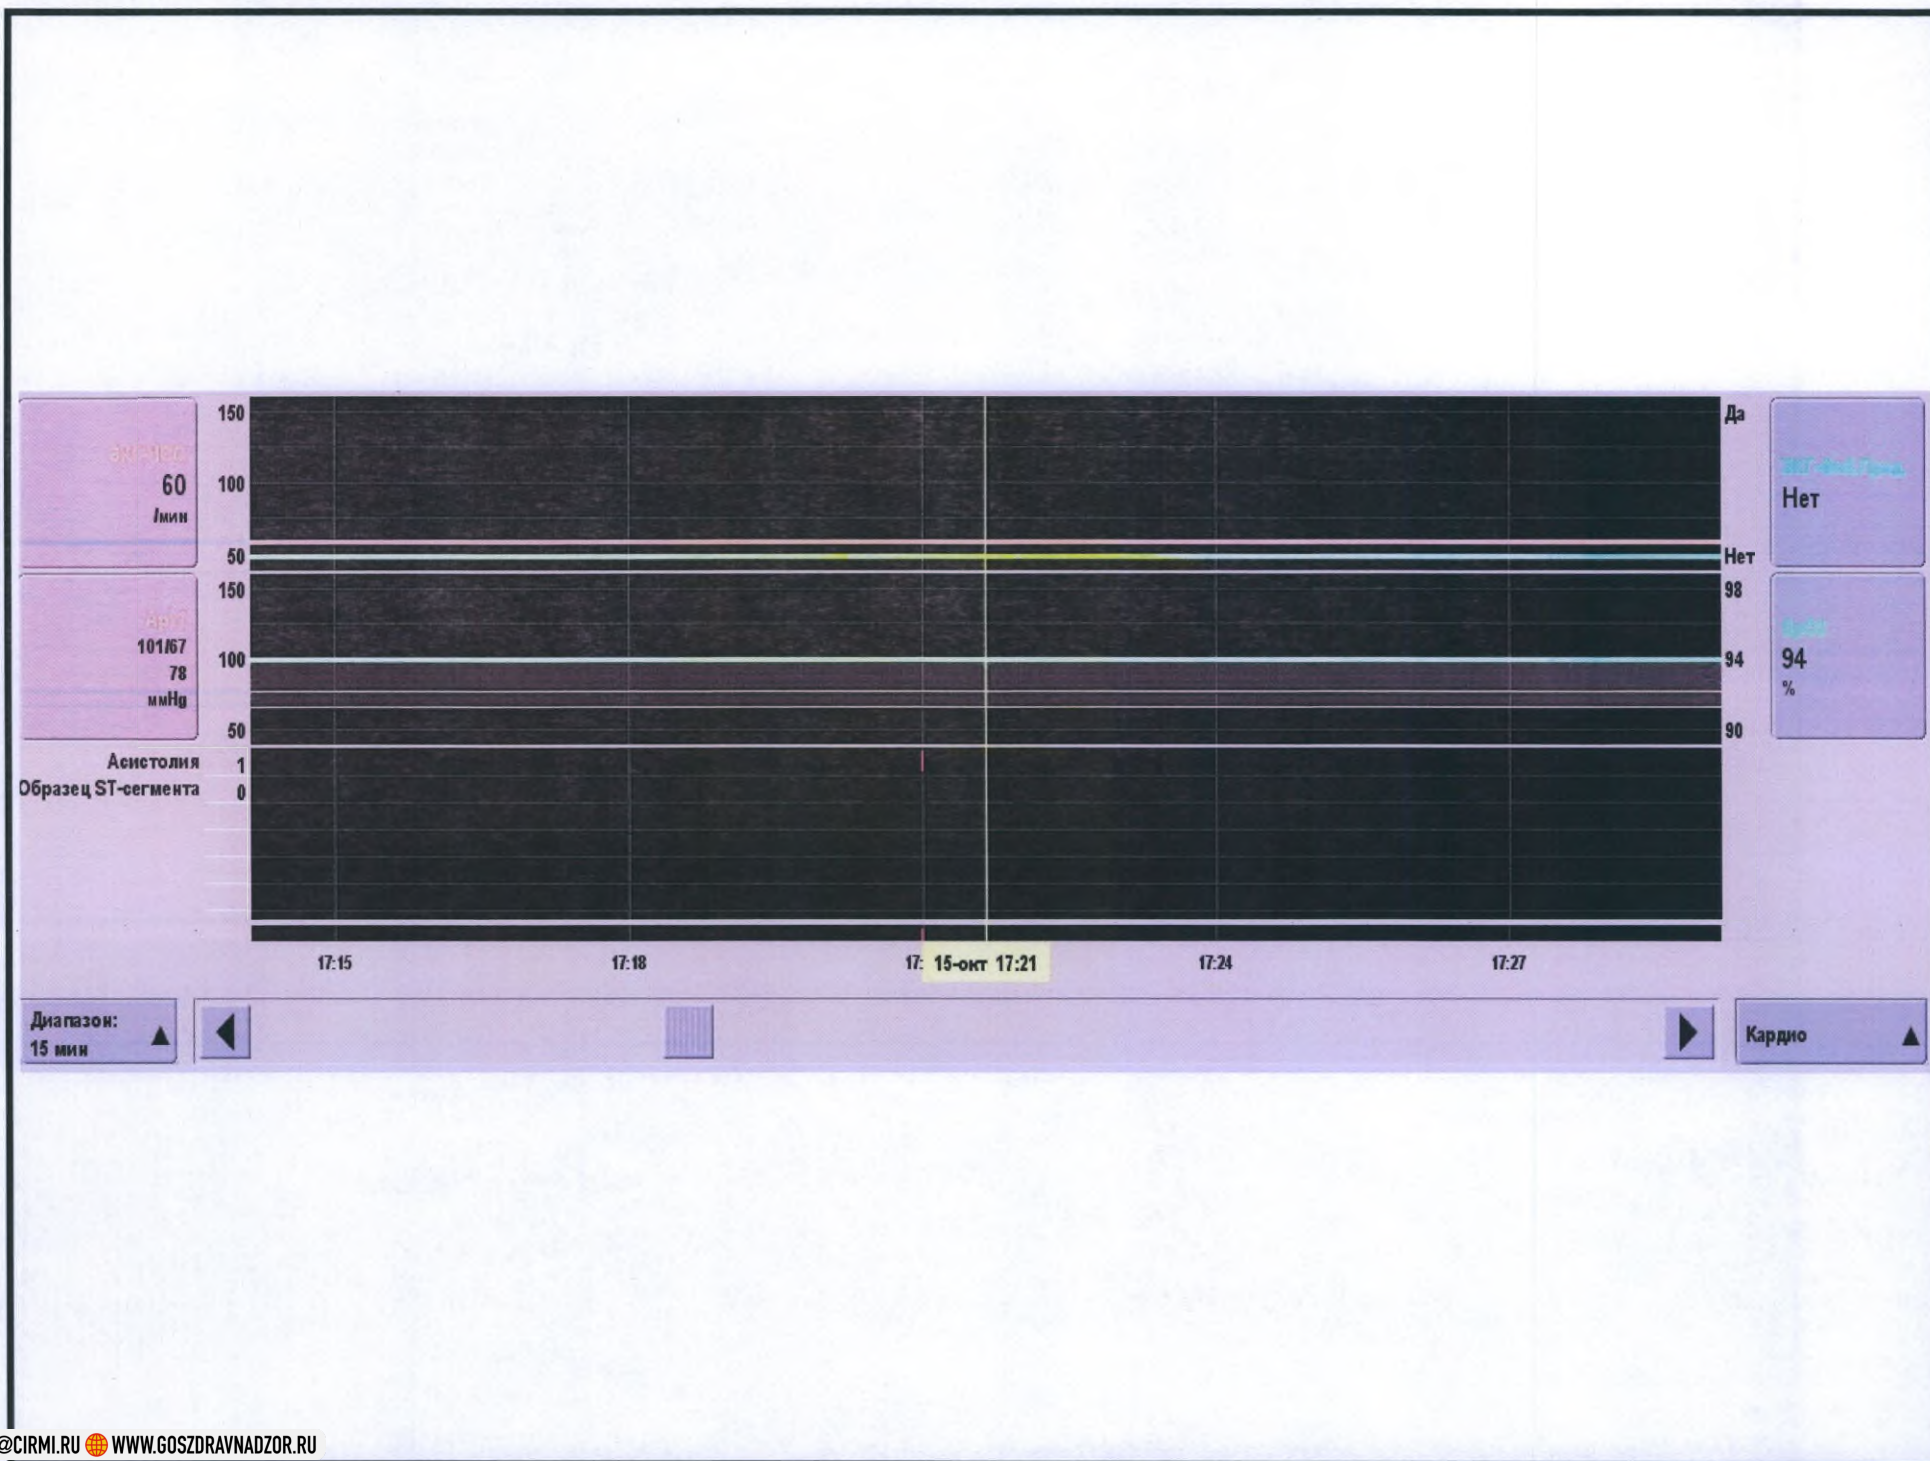


Сторона: Водитель	Г	11-лет 11:03	11-лет 11:04	11-лет 11:05	11-лет 11:06	11-лет 11:07	11-лет 11:08	11-лет 11:09	11-лет 11:20	11-лет 11:21	15-лет 12:01	11-лет 11:22	11-лет 11:24	15-лет 12:02
30T-000	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-002	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-003	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-004	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-005	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-006	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-007	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-008	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-009	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-010	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-011	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-012	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-013	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-014	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-015	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-016	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-017	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-018	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-019	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-020	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-021	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-022	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-023	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-024	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-025	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-026	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-027	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-028	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-029	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-030	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-031	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-032	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-033	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-034	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-035	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-036	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-037	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-038	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-039	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-040	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-041	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-042	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-043	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-044	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-045	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-046	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-047	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-048	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-049	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-050	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-051	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-052	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-053	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-054	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-055	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-056	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-057	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-058	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-059	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30T-060	1000	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00


23. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Фрагмент полной записи» на бумажном или электронном носителе.




24. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Циркуль» на бумажном или электронном носителе

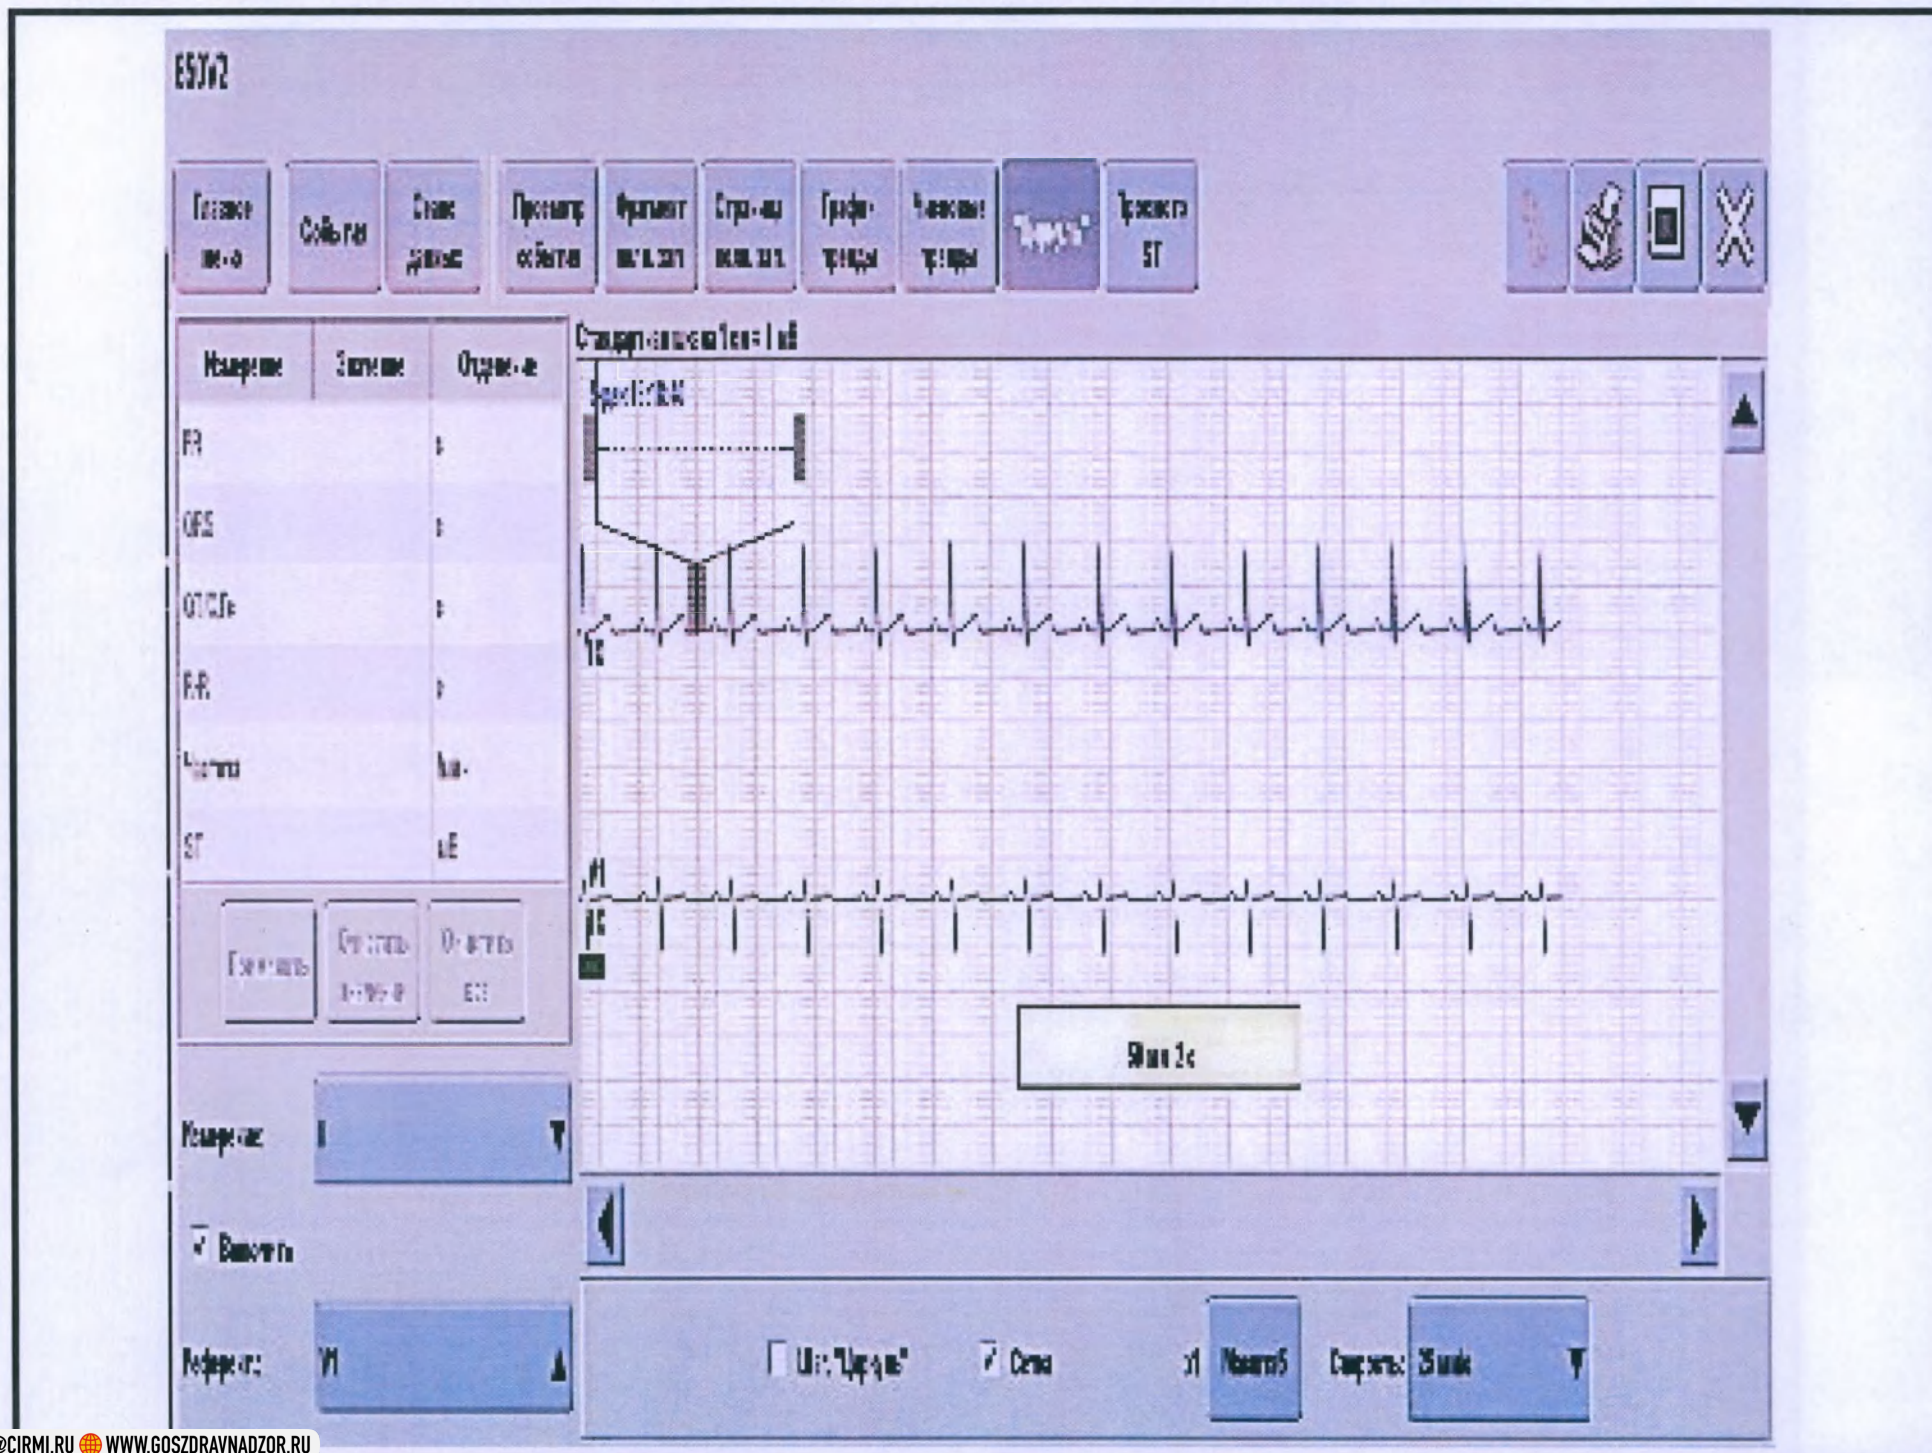

25. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Просмотр ST» на бумажном или электронном носителе.

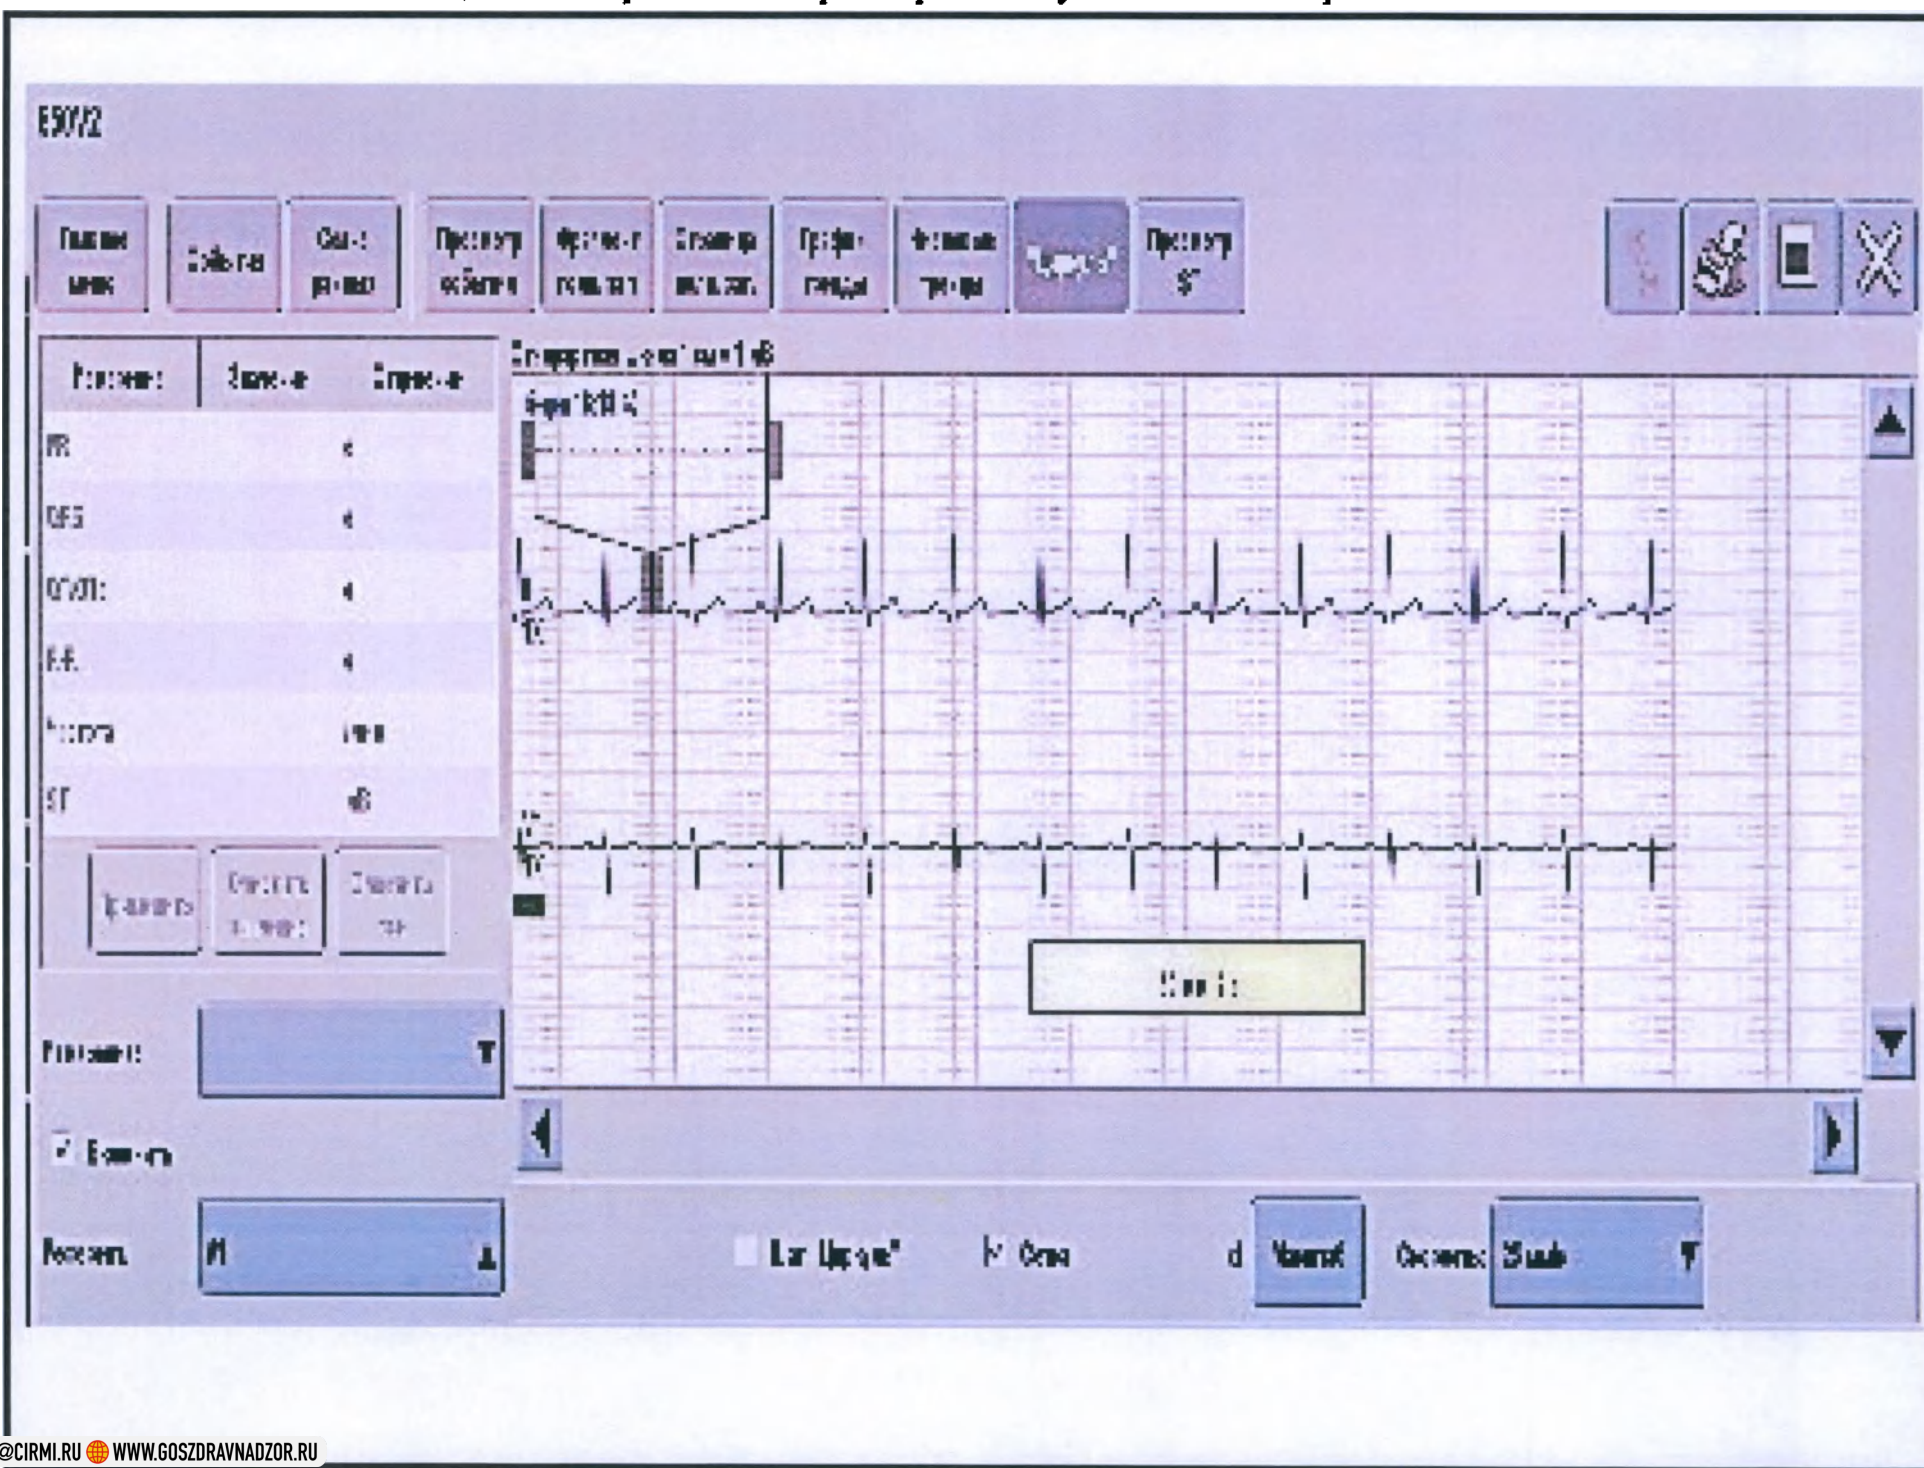

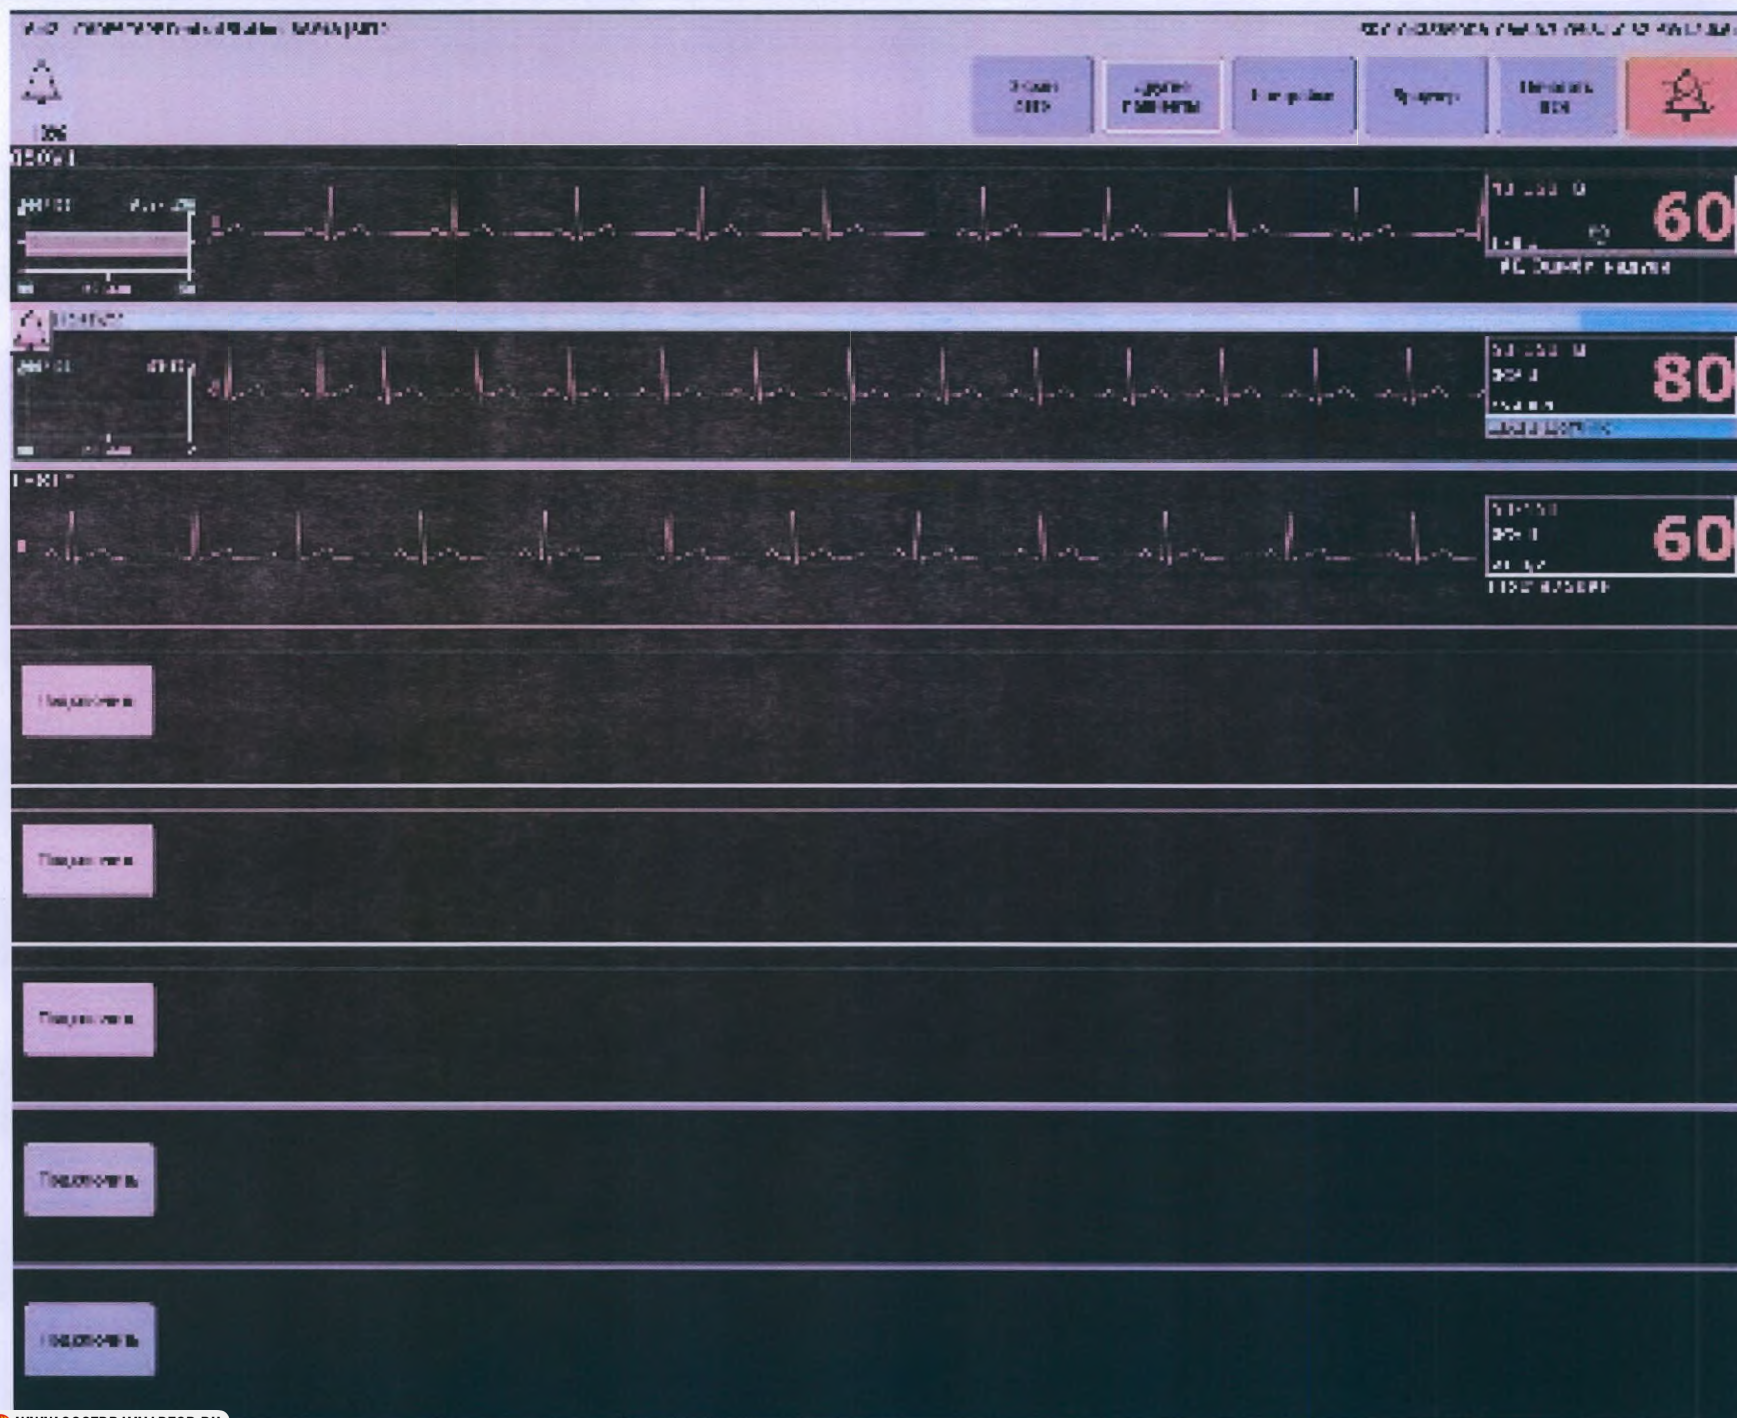



Просмотр койки

Подключ./Отсоед.

Настройки монитора

Данные пациента

Системные утилиты

Сведения о пациенте

Фамилия:

Имя:

ID пациента:

FF111

Возраст:

Взрослые

Отделение:

BAY4A

Койка:

BKM1

ЭКГ от:

Монитор

Заметки по лечению:

Сохранить

Отсоединить

Новый пациент

Выбрать пациента


Отделение Койка	Фамилия, имя, ID пациента (дополн. ID)	Дата рождения	Пол
BAY2B TEST4	SILVA, JAMES FF111 (2004066661)	01.05.1973	М

Запрос сведений по подключению


Выбрать

Очистить


29. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Дополнительный дисплей» на бумажном или электронном носителе.

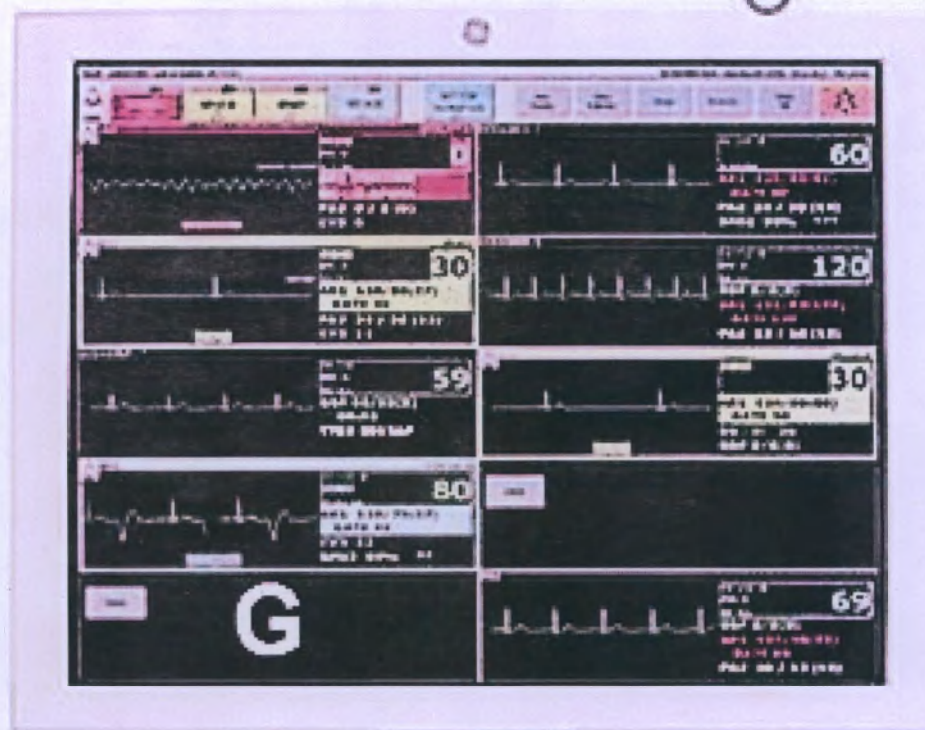

30. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Дистанционный дисплей» на бумажном или электронном носителе.

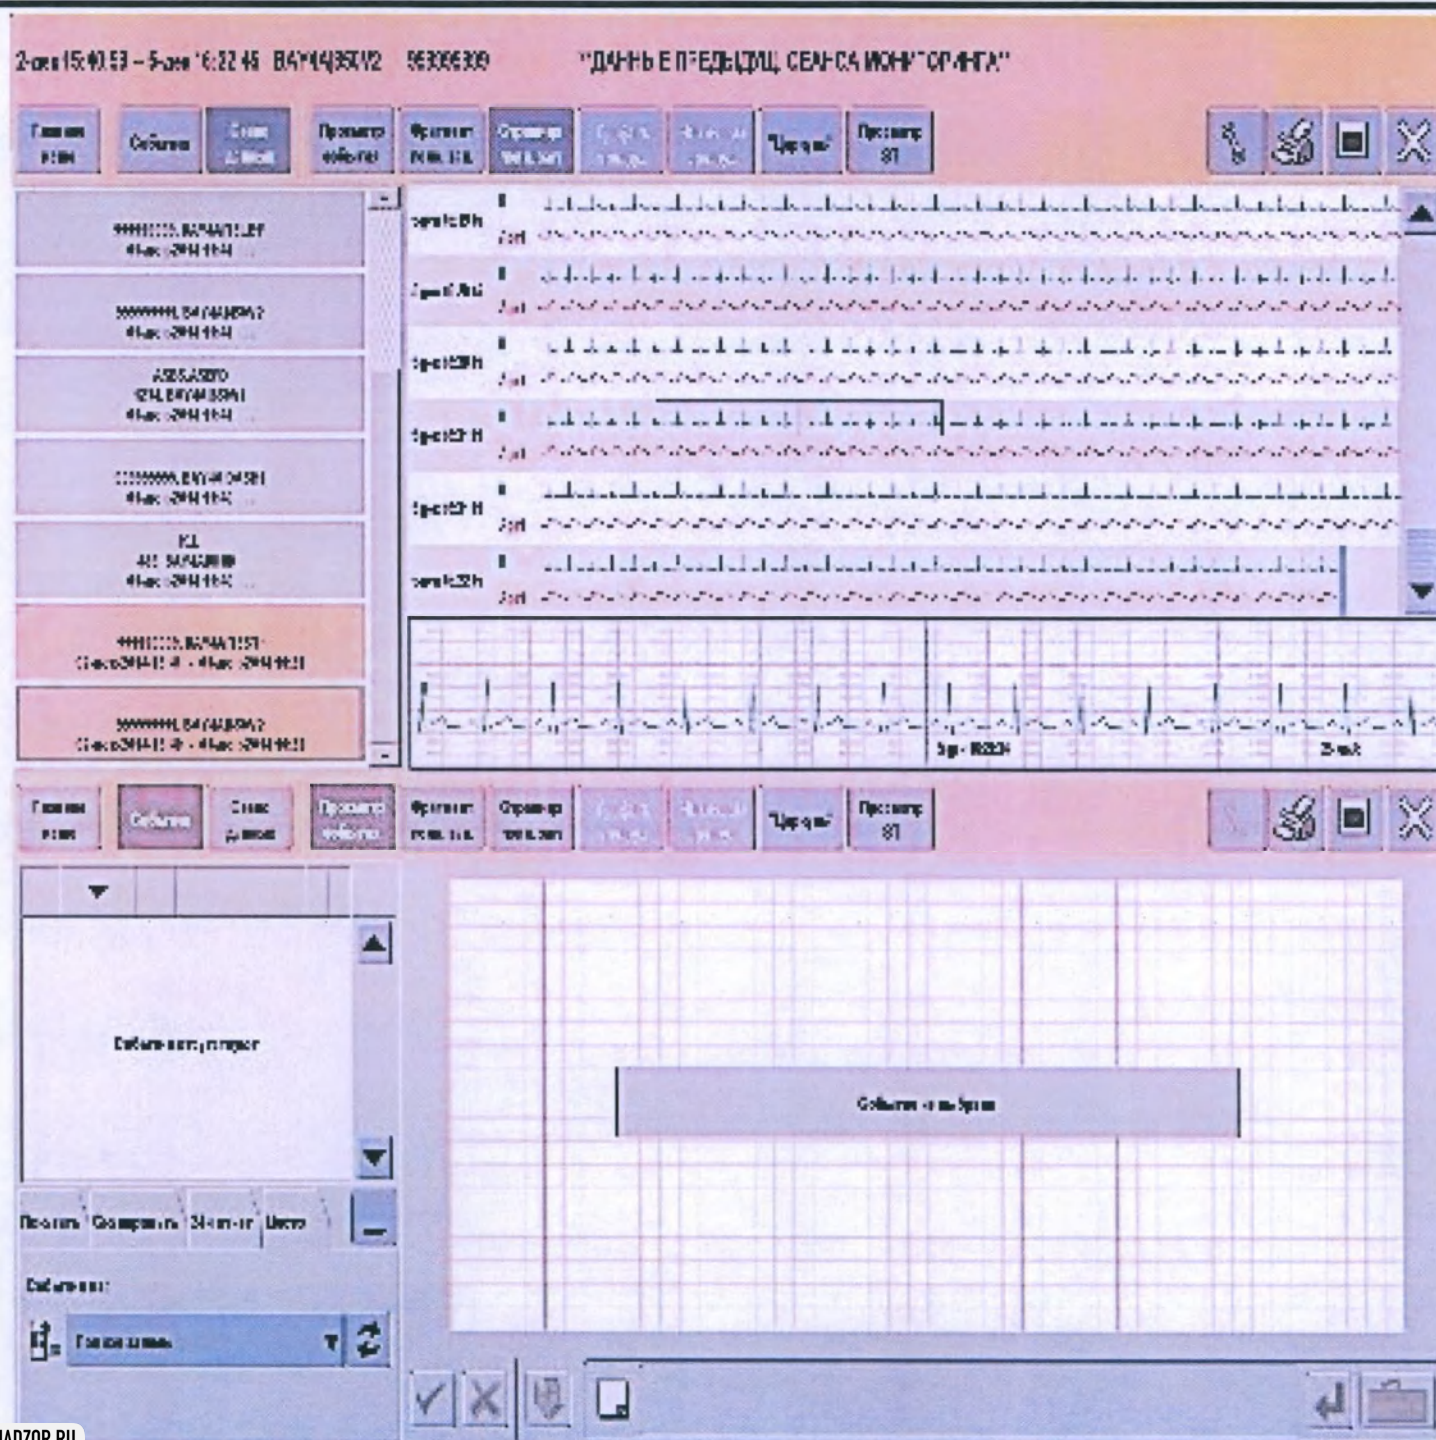


31. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Дублирующий дисплей» на бумажном или электронном носителе.

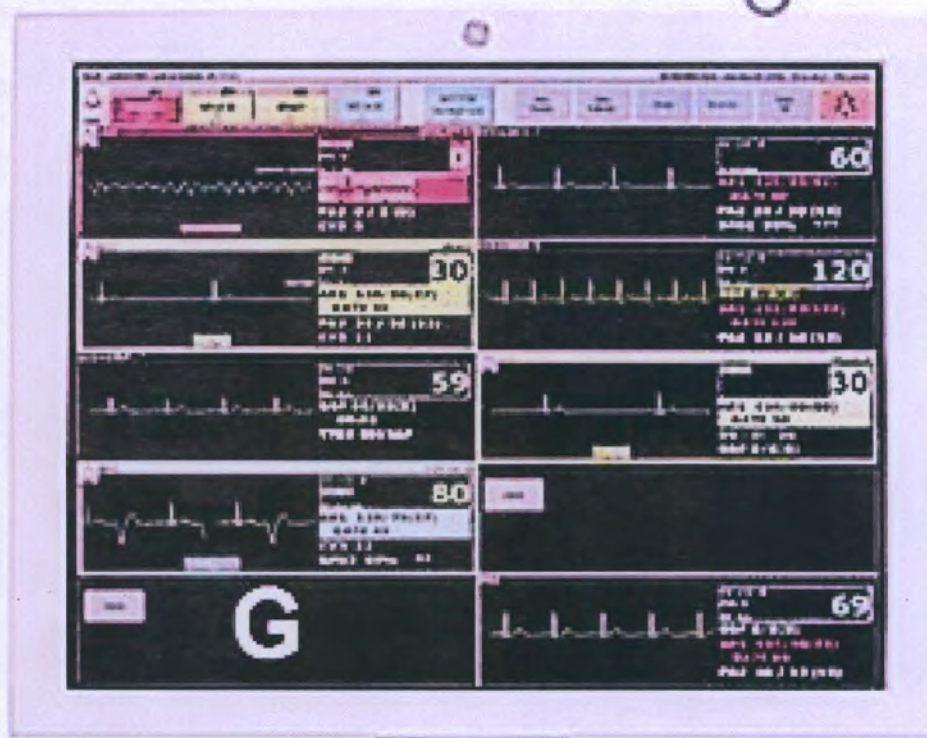




33. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Режим MultiKM» на бумажном или электронном носителе.

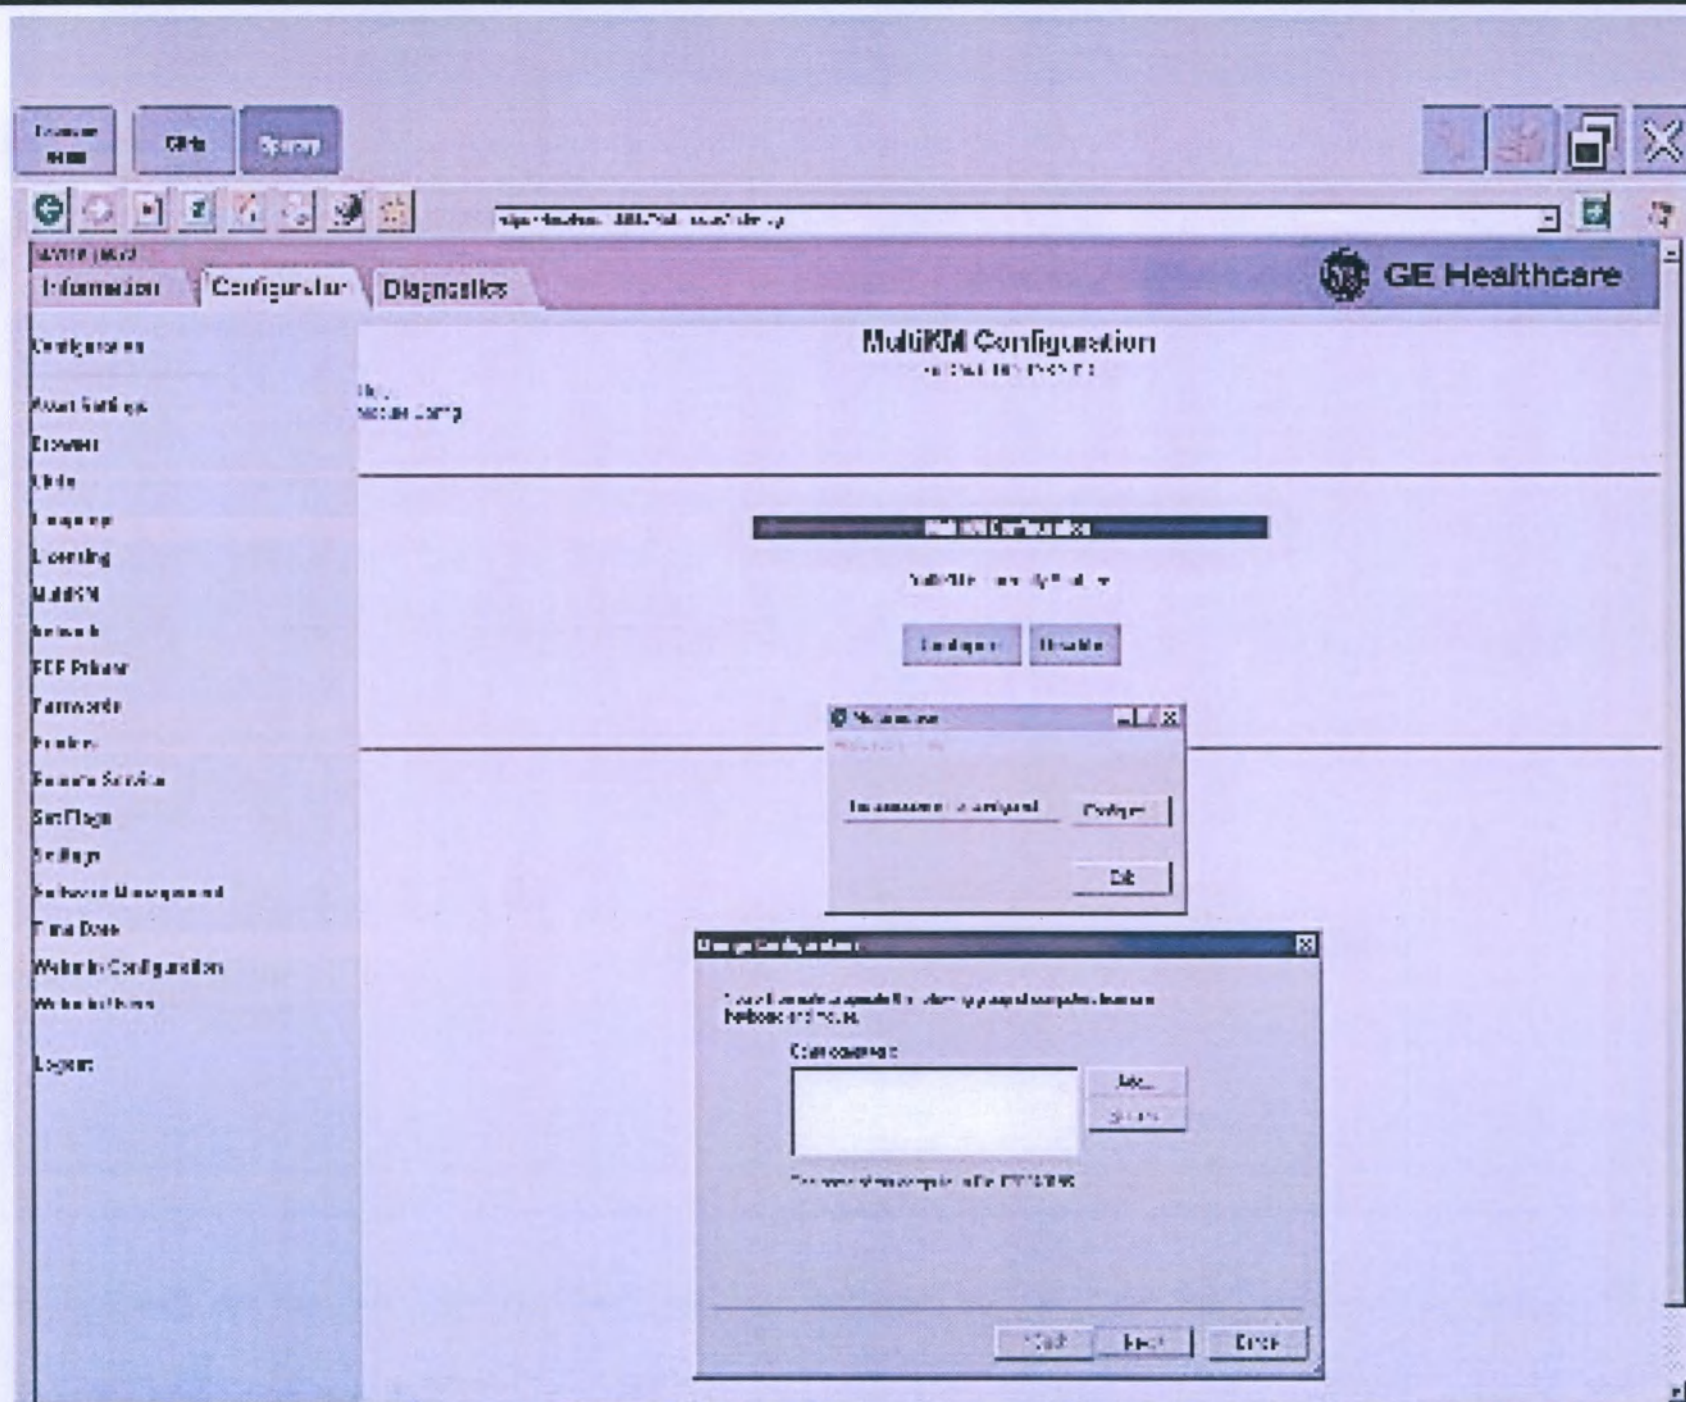

Главное меню 3D SpO2 Данные Данные Работа с данными Настройка				
SpO2	Дыхание			CO2
Методы	Чувствительность	Регистрация	Триггеры событий	Ед. измерения
☐ Вкл. ☐ Выкл.	☐ 17% ☐ 23% ☐ 33% ☐ 43% ☐ 53% ☐ 53% ☐ 73% ☐ 83% ☐ 93%	☐ x1 ☐ x2 ☐ x3 ☐ x4 ☐ x5 ☐ x6 ☐ x7 ☐ x8 ☐ x9 ☐ x10	☐ Вкл. ☐ Выкл.	☐ ч ☐ д/с ☐ ммг
Установка			Отображение ☐ I ☐ II ☐ RL-LL	
☐ x1 ☐ x2 ☐ x4 ☐ x8			Удержание	
☐ x0		Автоматический размер		

35. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Магнитуда вектора ST» на бумажном или электронном носителе.

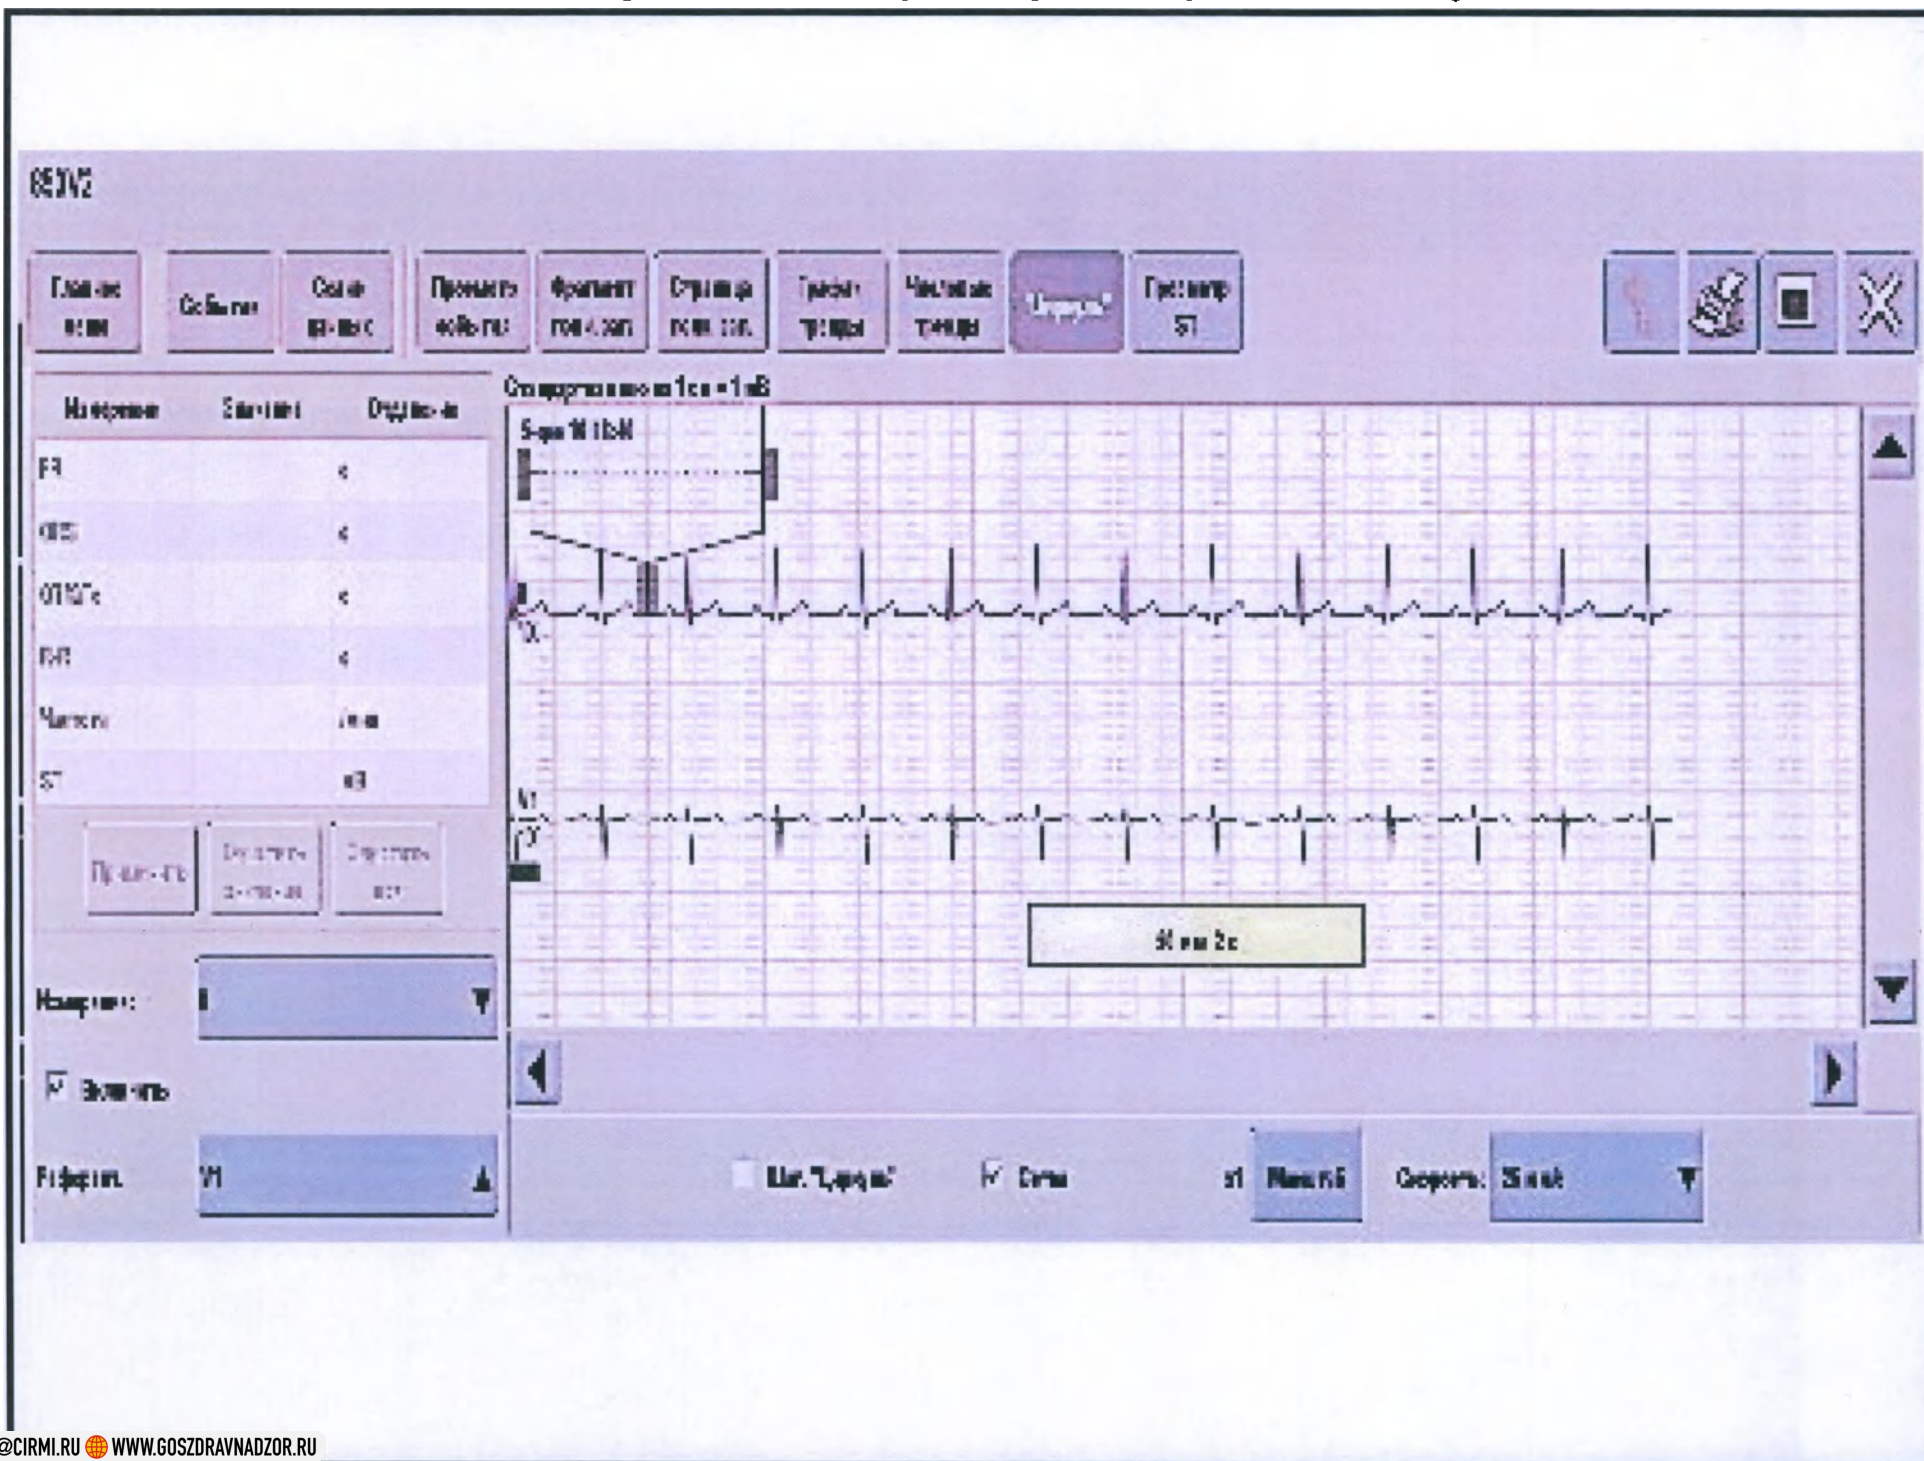

Главное меню

ЭКГ

SpO2/Дыхание

Давления

Настройка тревог

Настройка печати



ЭКГ

Показать отведение

☐ I

☒ II

☐ III

☐ V

☐ aVR

☐ aVL

☐ aVF

Изучение

Усиление

☐ x0,5

☒ x1

☐ x2

☐ x4

Обнаружение имп. ИВР

☐ ИВР 1

☒ ИВР 2

☐ Выкл.

Справка по ИВР

Анализ ЭКГ

☐ По 1 отв.

☒ По всем отв.

Аритмия

☒ Все

☐ Летальные

☐ Выкл.

Тревога ЖЭ

☒ Вкл.

☐ Выкл.

ST

☒ Вкл.

☐ Выкл.

Отведение Va

☒ V1

☐ V2

☐ V3

☐ V4

☐ V5

☐ V6

Доп. настройки ЭКГ...

Сведения о пациенте

Фамилия:

Имя:

ID пациента:

Возраст:

Взрослые

Отделение:

UCDV

Койка:

BED-3*

ЭКГ от:

Заметки по лечению:

Подключить

Отсоединить

Новый пациент

Выбрать пациента

Отделение Койка	Фамилия, имя, ID пациента (дополн. ID)	Дата рождения	Пол


Запрос сведений по подключению

Выбрать


Очистить

Новое подключение

37. Лицензионные ключи для активации программного обеспечения на бумажном или электронном носителе (не более 16 шт.).

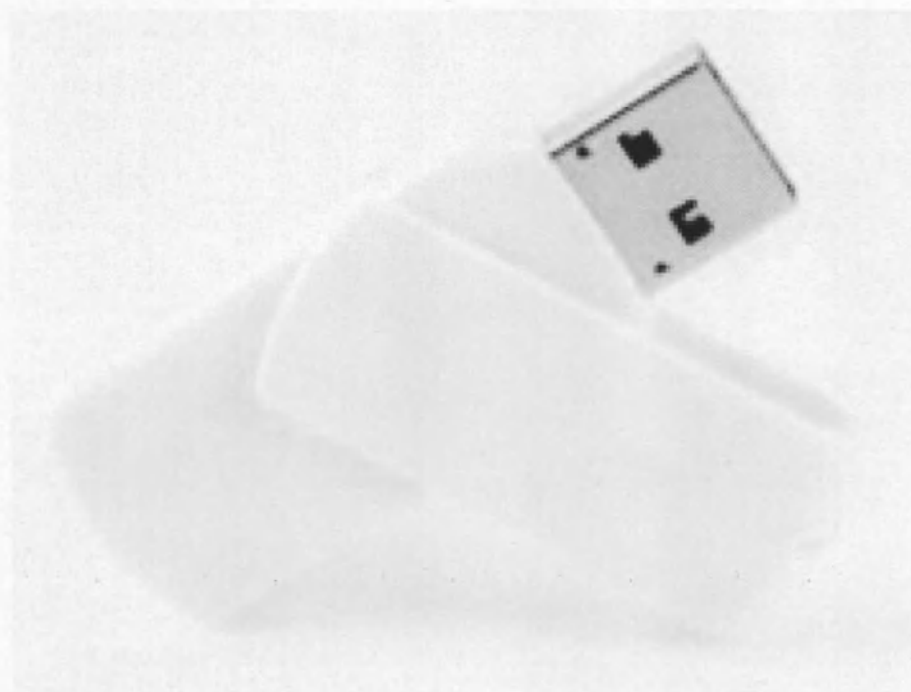

38. Сервер коммутации с внутрибольничной сетью.

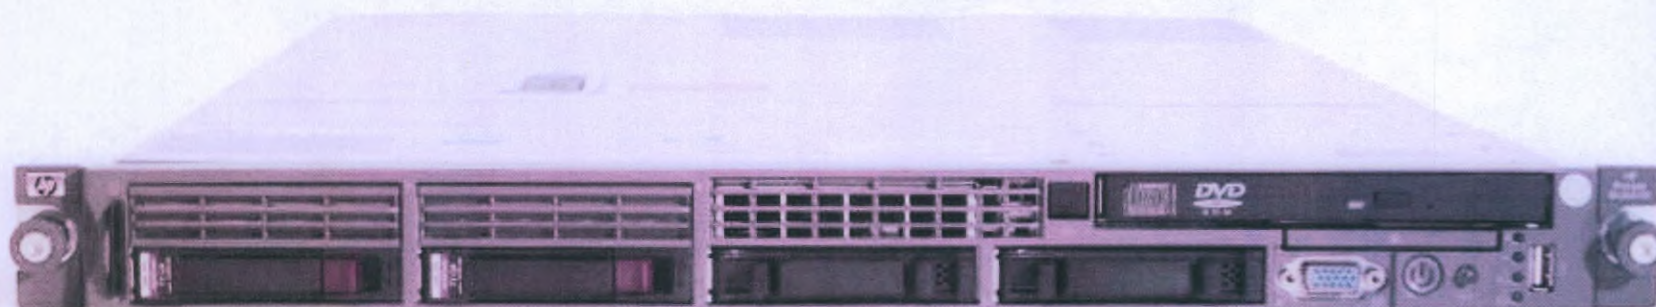


39. Кабели питания сервера (не более 8 шт.)



67




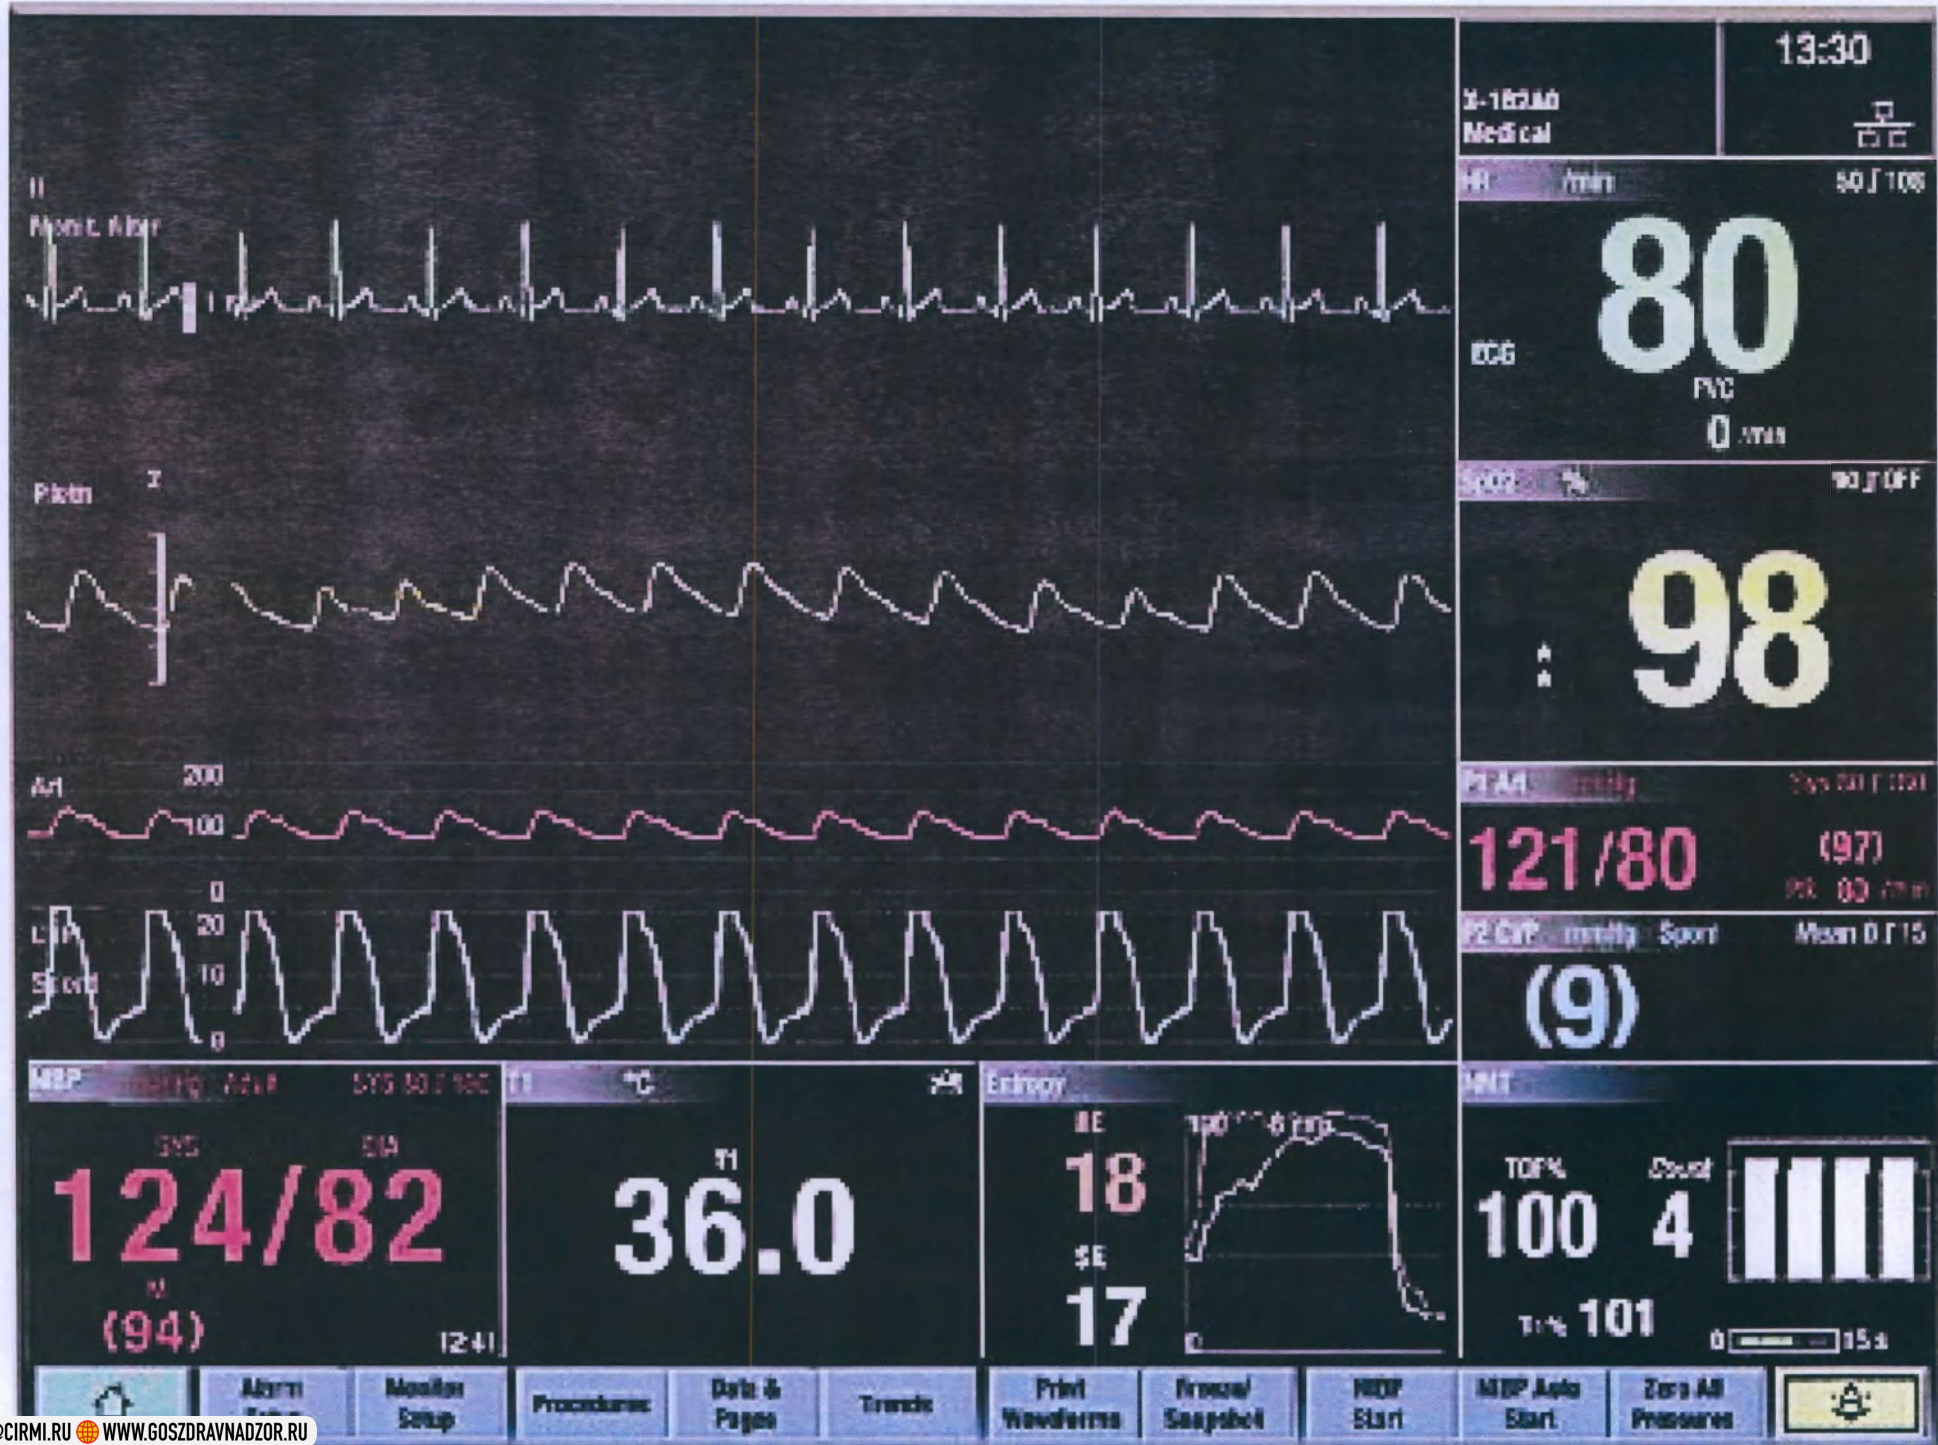

42. Устройства сопряжения сети (не более 16 шт.).



43. Кабели питания устройства сопряжения сети (не более 16 шт.).

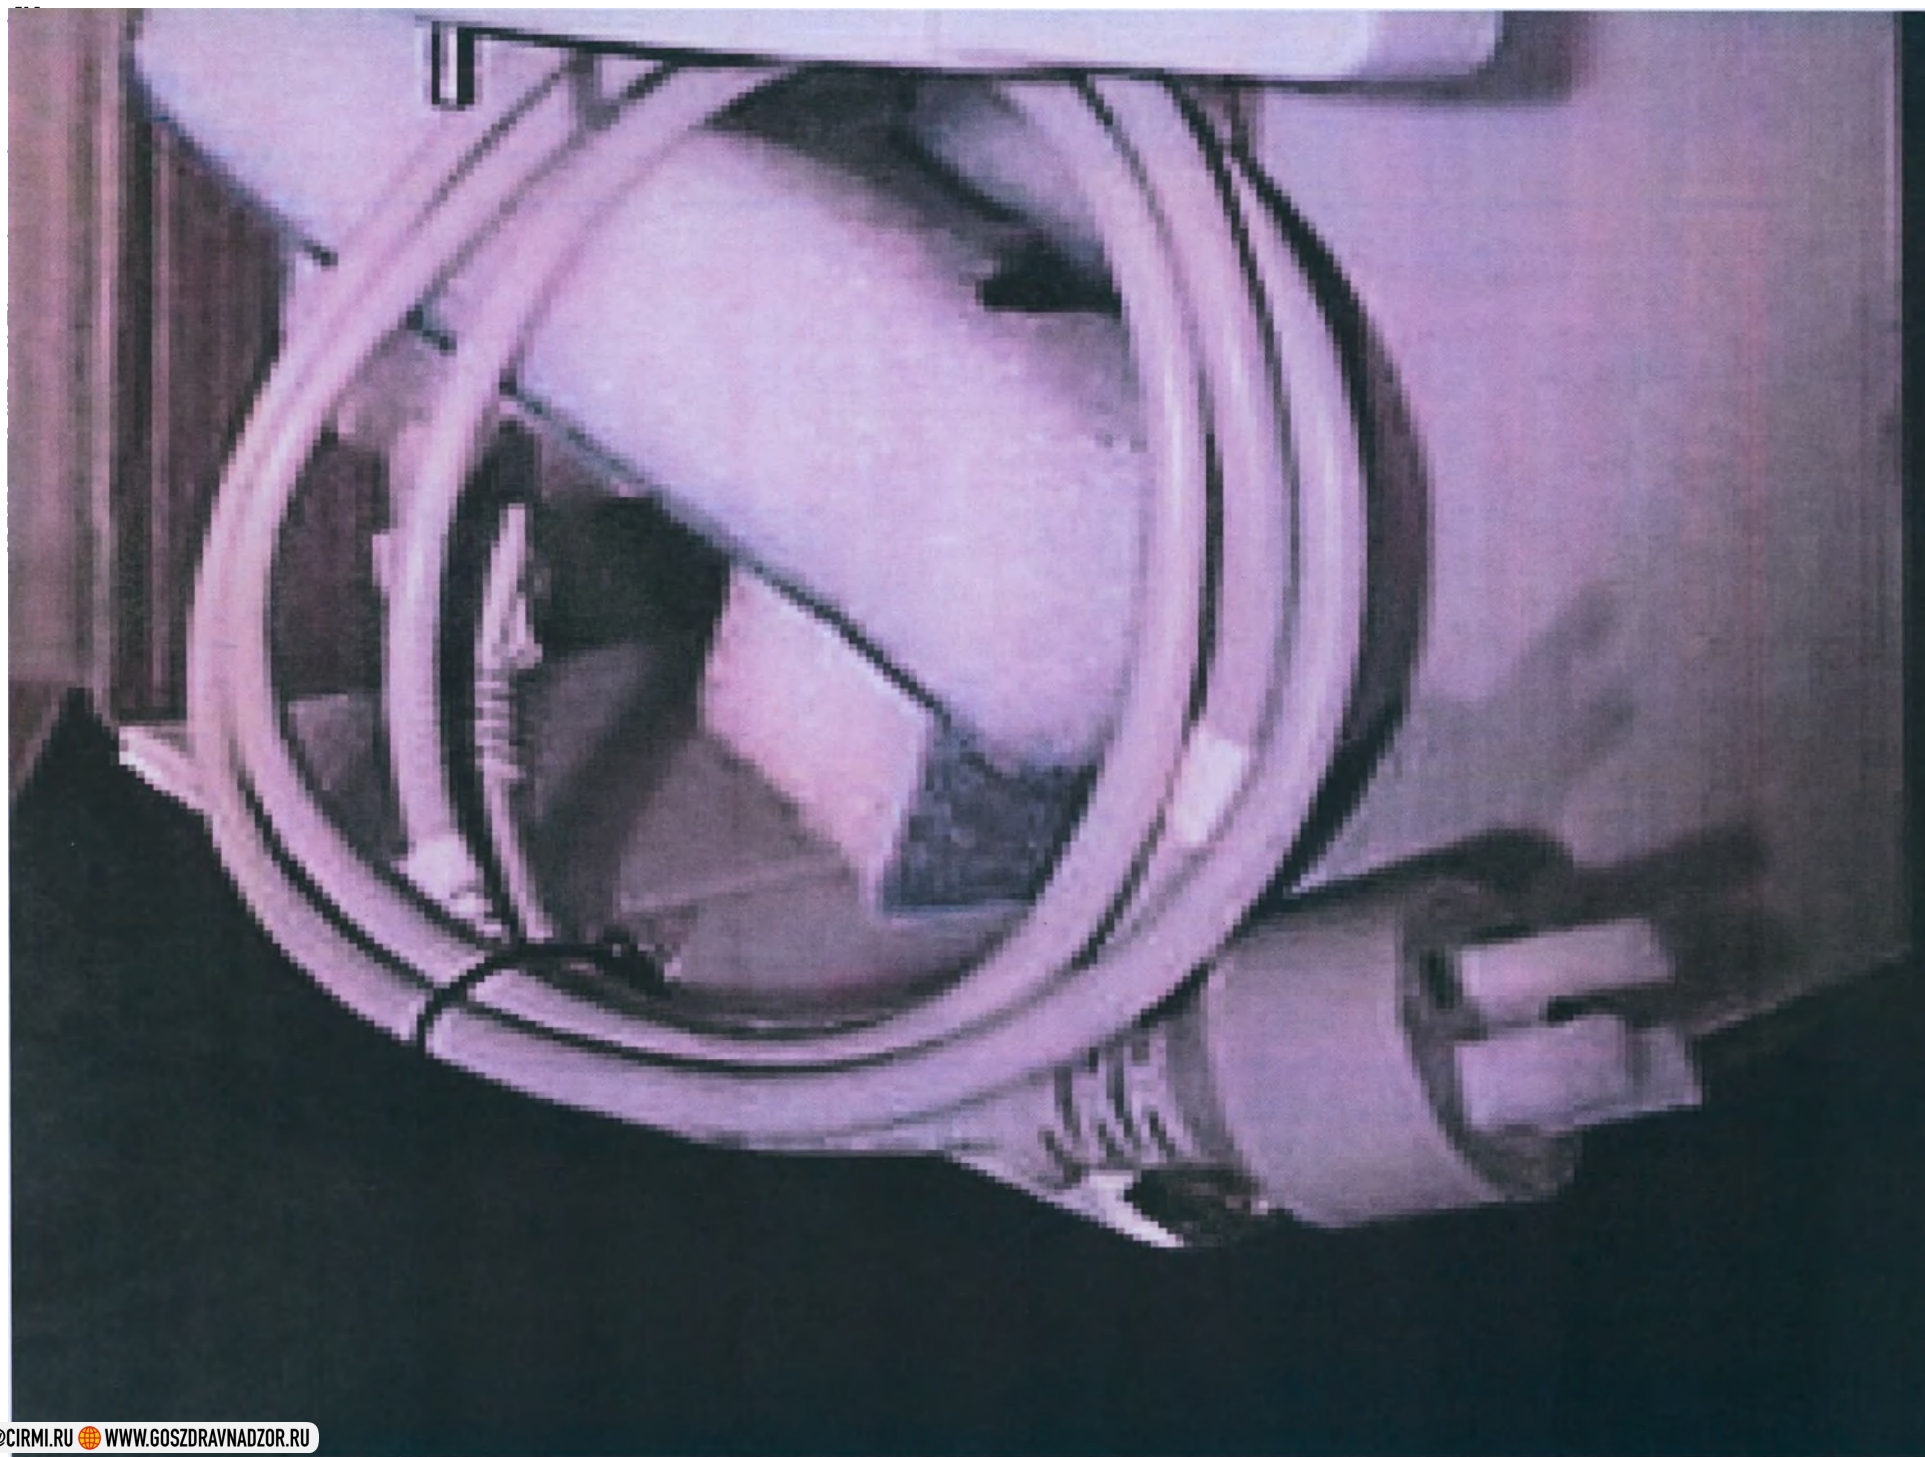



45. Принтер лазерный. (M406dn)



45. Принтер лазерный. (M506dn)



45. Принтер лазерный. (M555dn)




46. Кабели сетевые (не более 5 шт.).



47. Видео-сплиттеры (не более 4 шт.).



47. Видео-сплиттеры (не более 4 шт.).

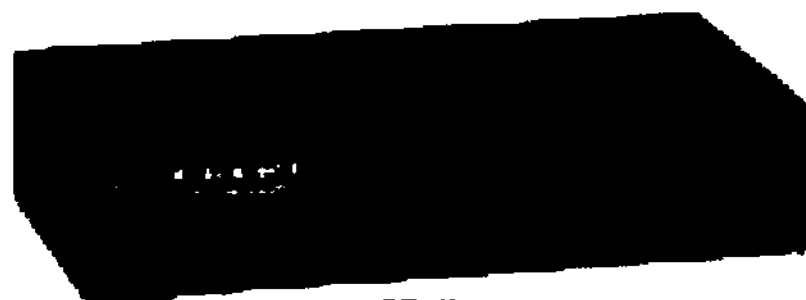

Видео-сплиттер



Видео-сплиттер



Видео-сплиттер




Видео-сплиттер



48. Видео-удлинители (не более 10 шт.).



48. Видео-удлинители (не более 10 шт.).

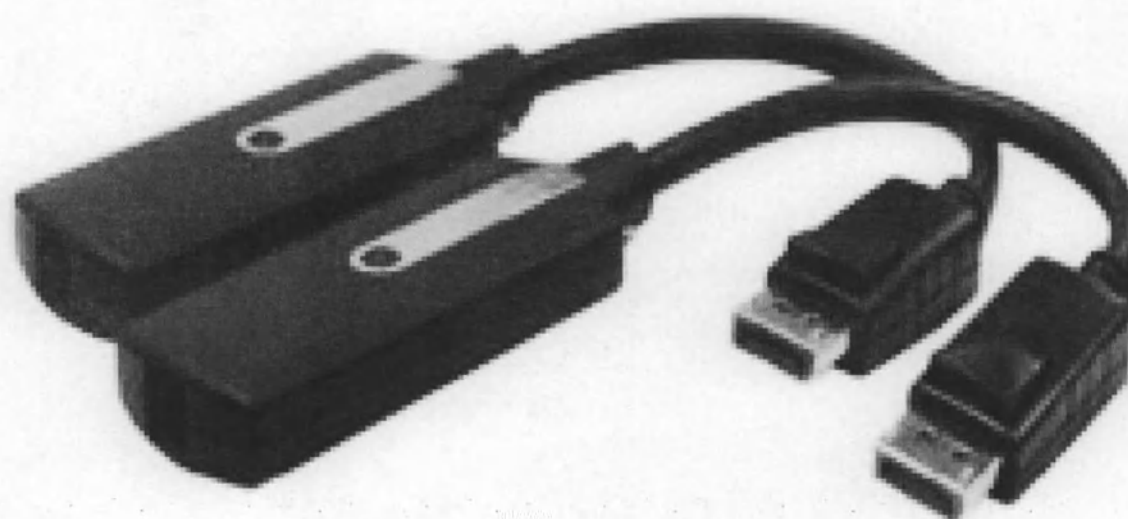

48. Видео-удлинители (не более 10 шт.).



49. Кабели волоконно-оптические (не более 4 шт.).



50. Кабели подключения дисплея (не более 4 шт.).



51. Кабели RJ45 (не более 50 шт.).



51. Кабели RJ45 (не более 50 шт.).




52. Карта звуковая.




52. Карта звуковая.




53. Адаптеры (не более 10 шт.).

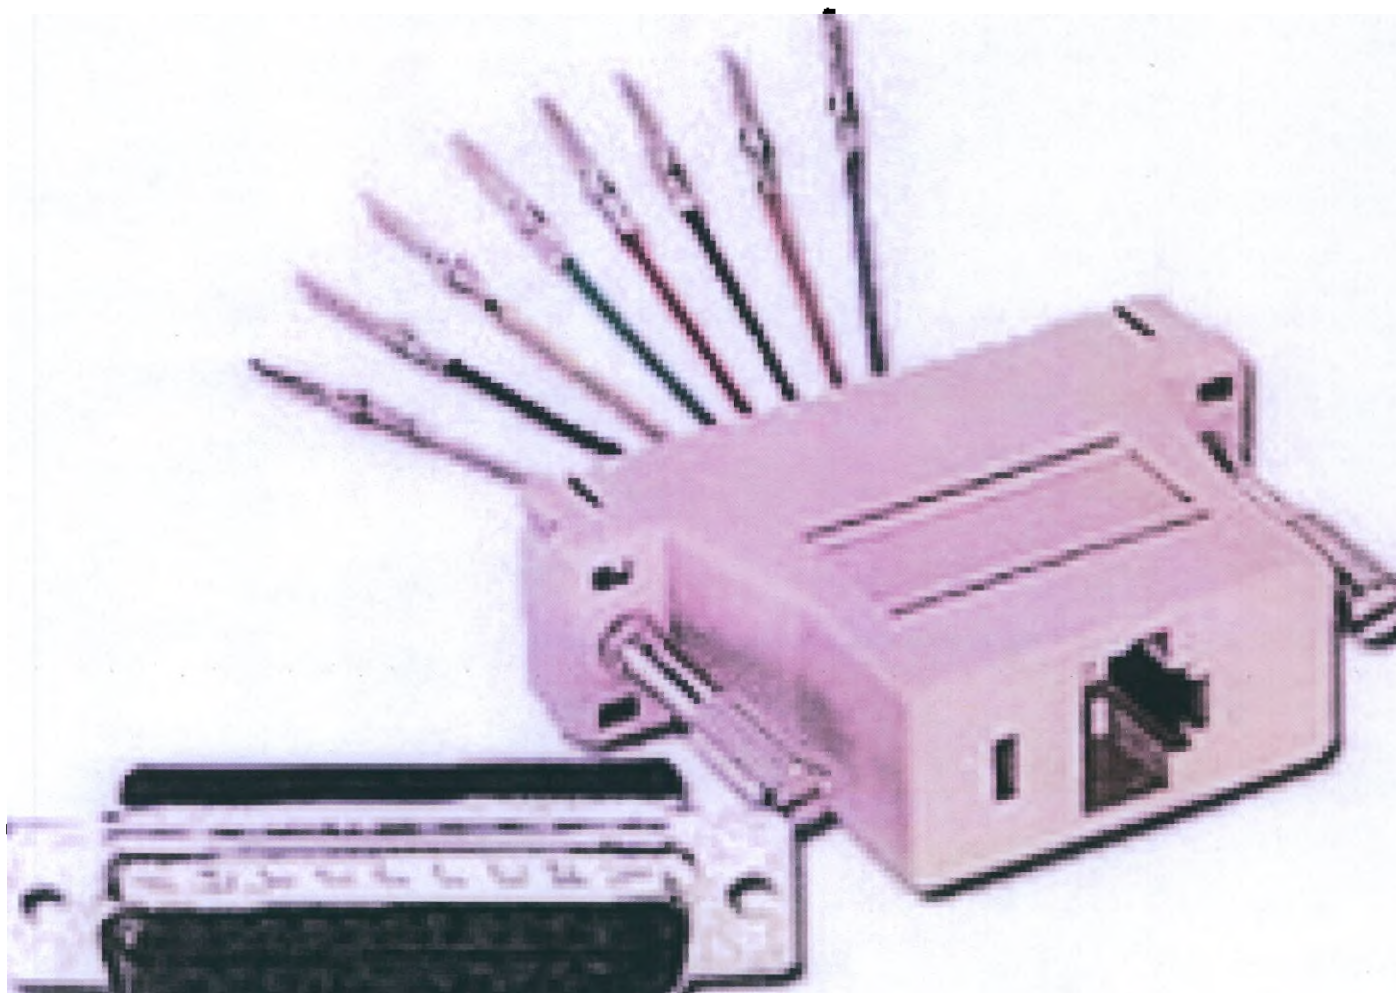


53. Адаптеры (не более 10 шт.).

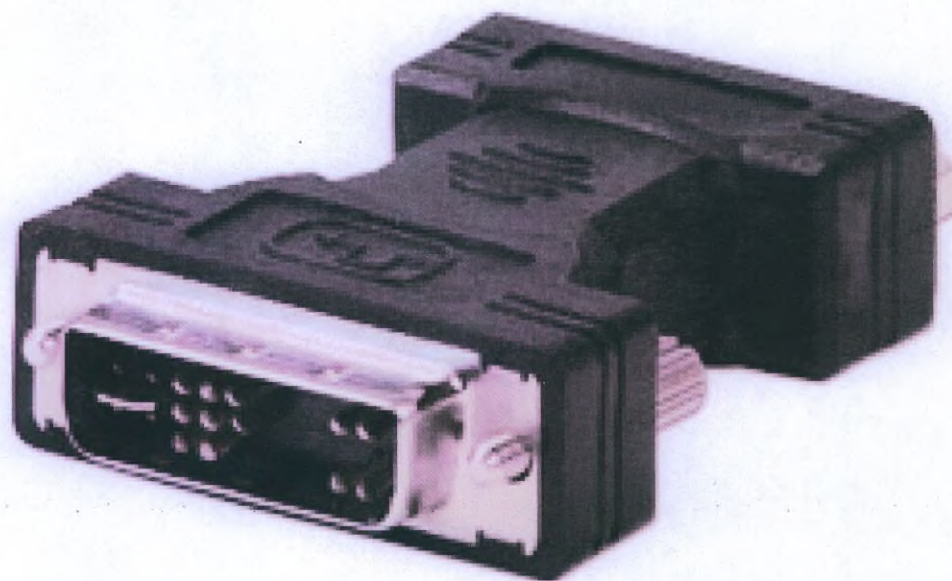


54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

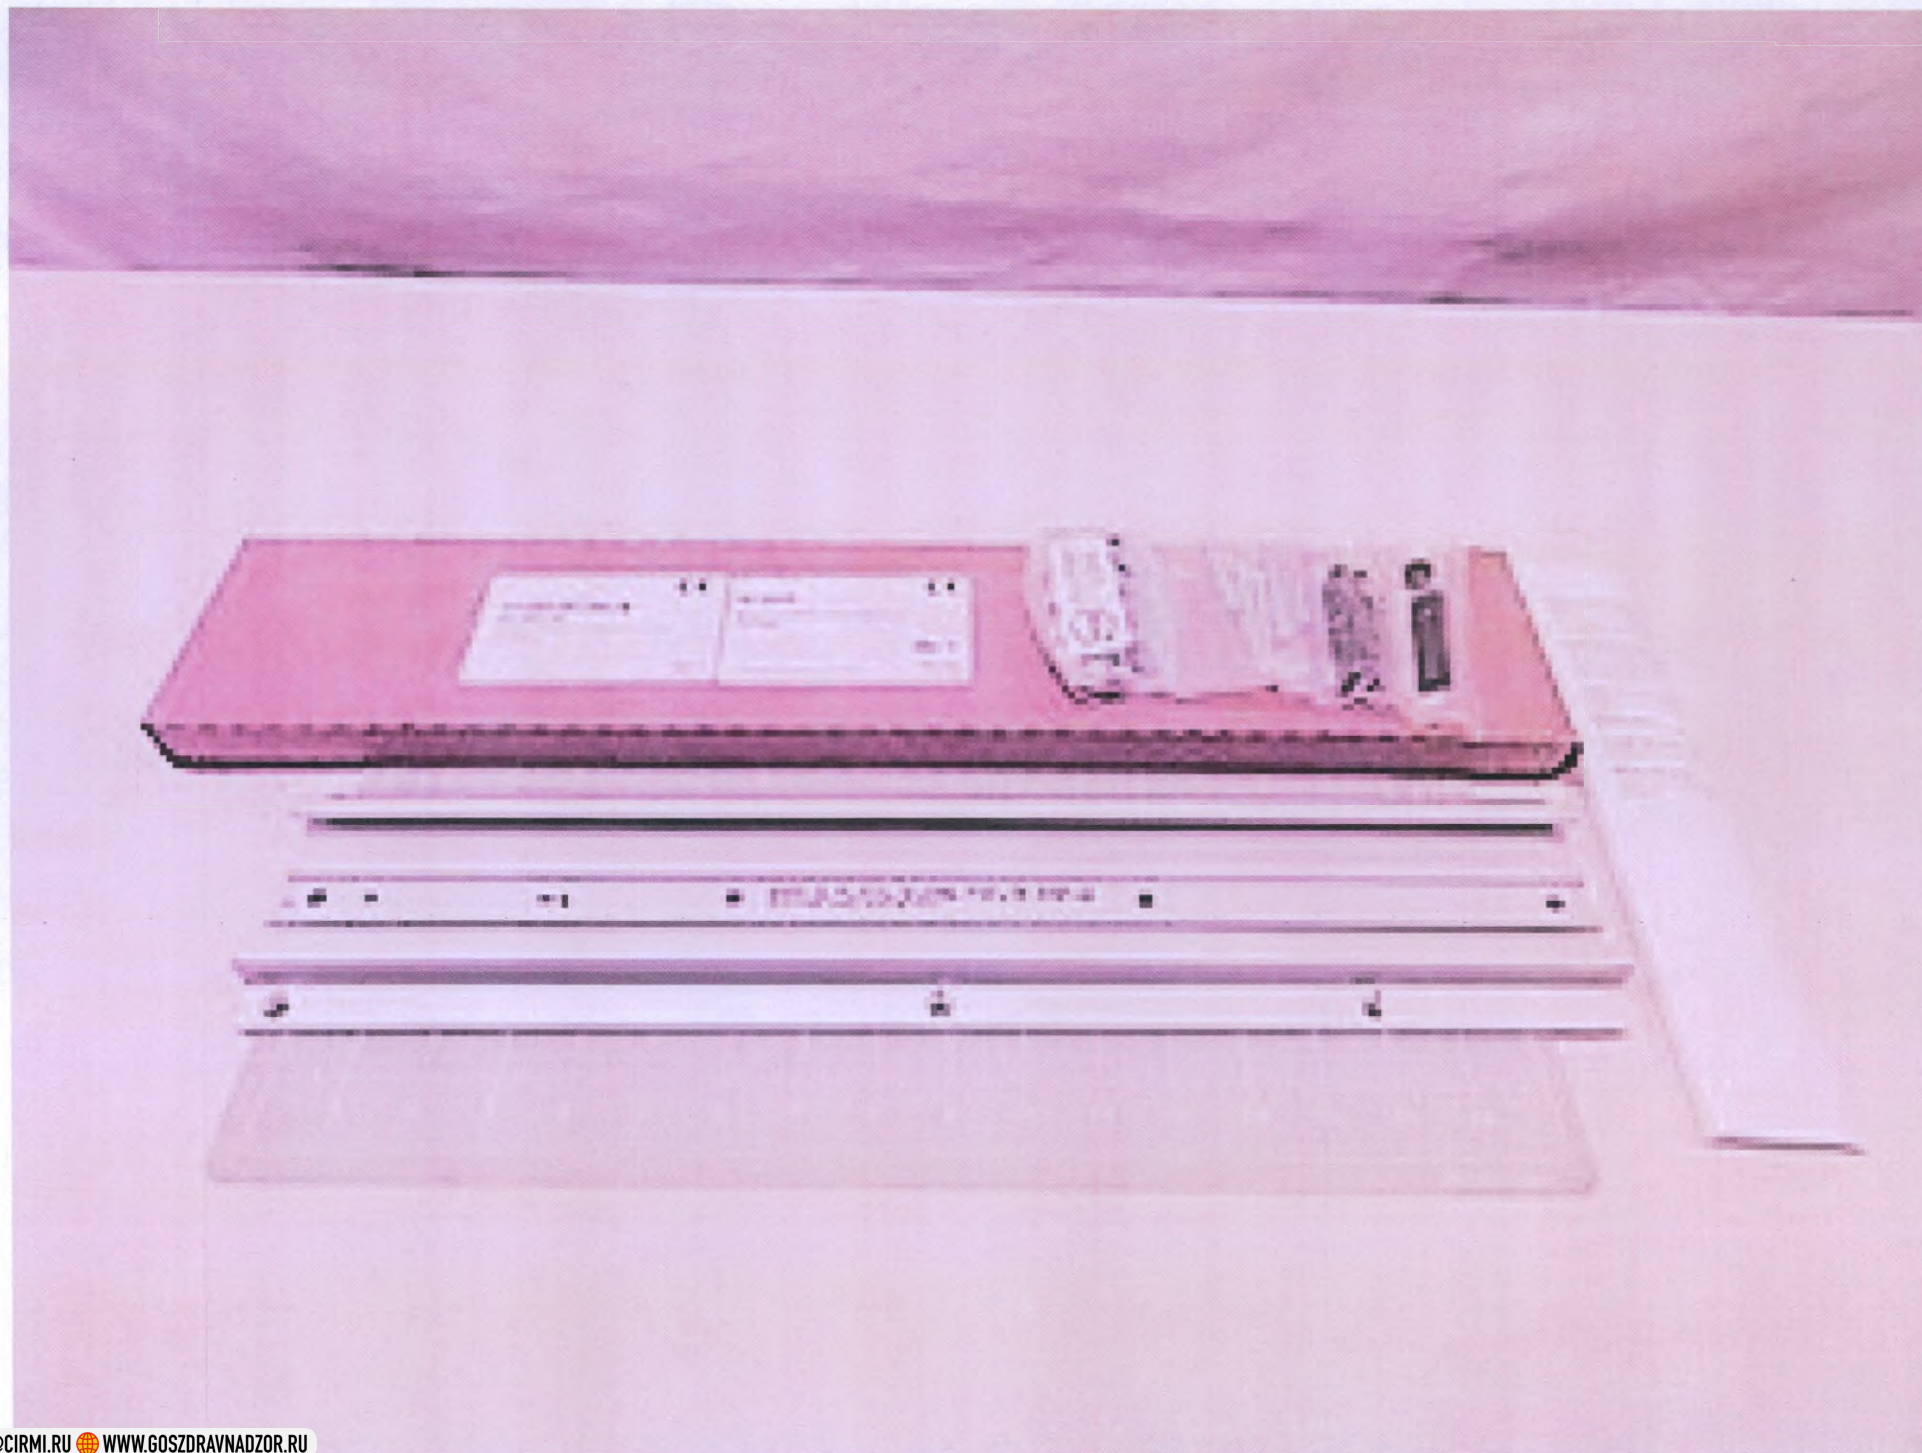

54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

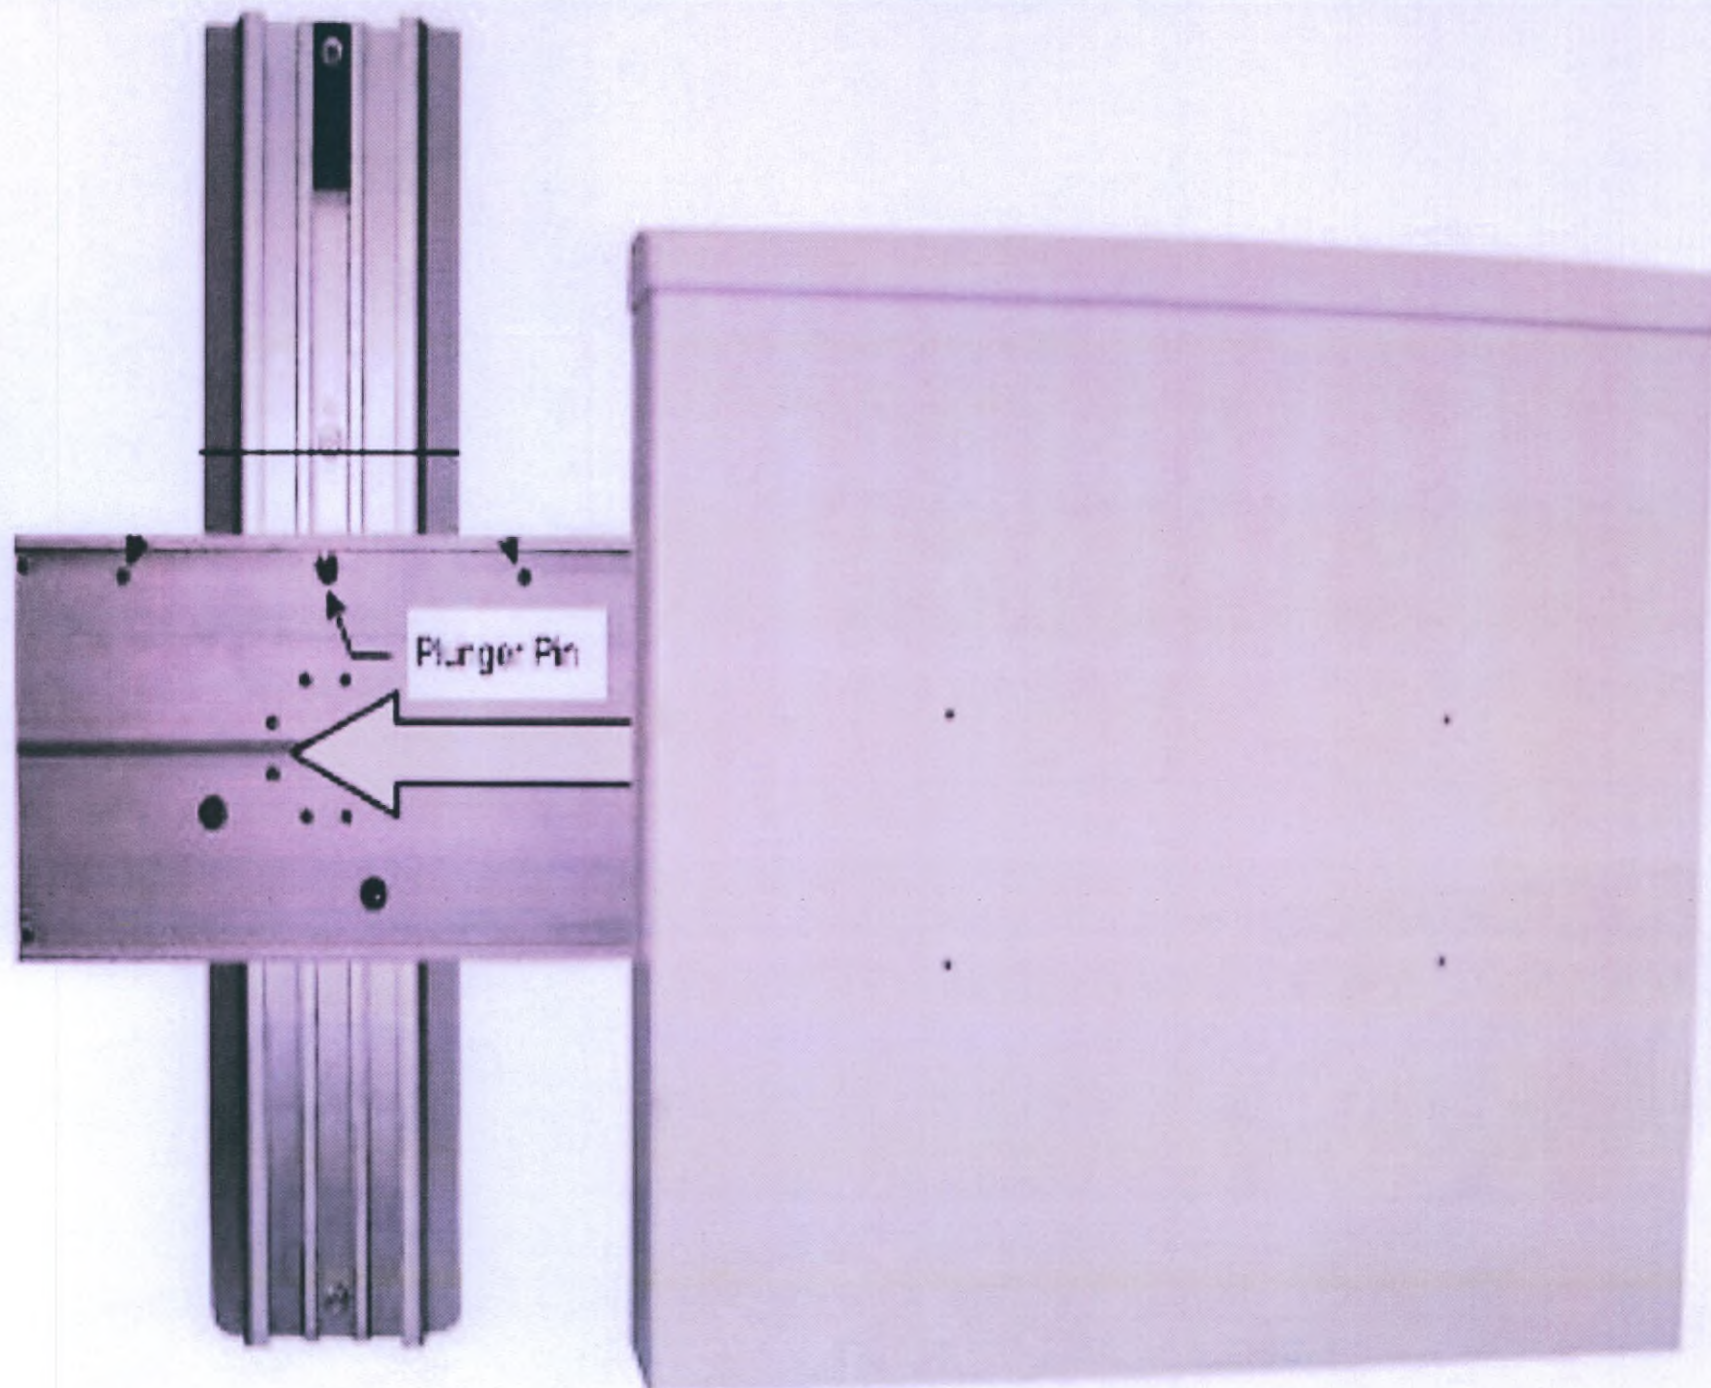


54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

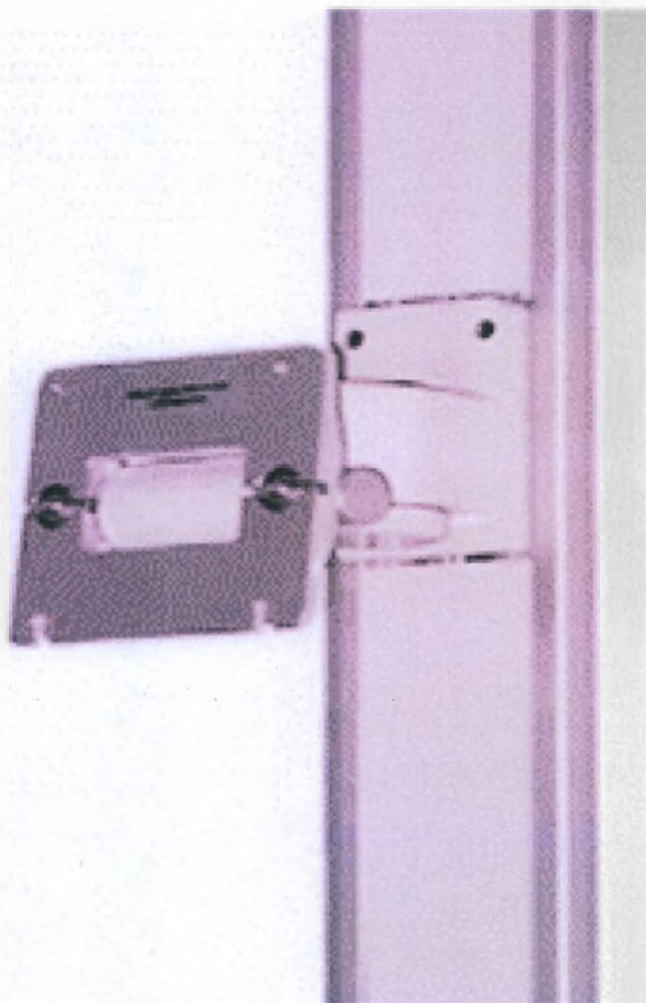


54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).



54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

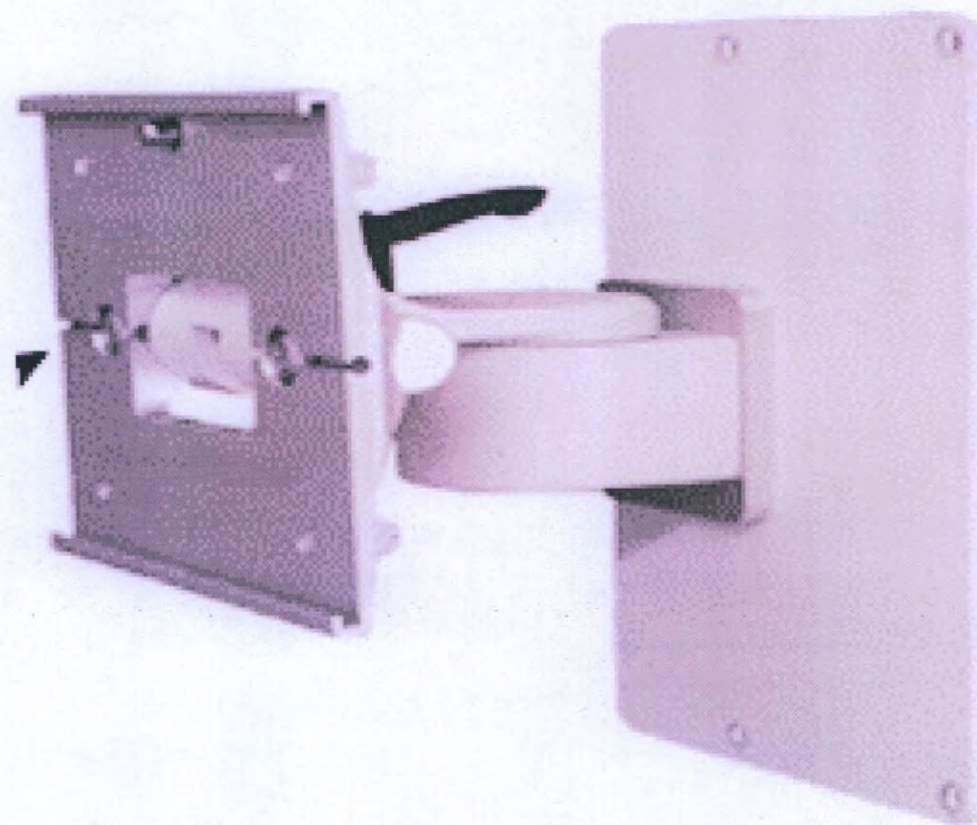

54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

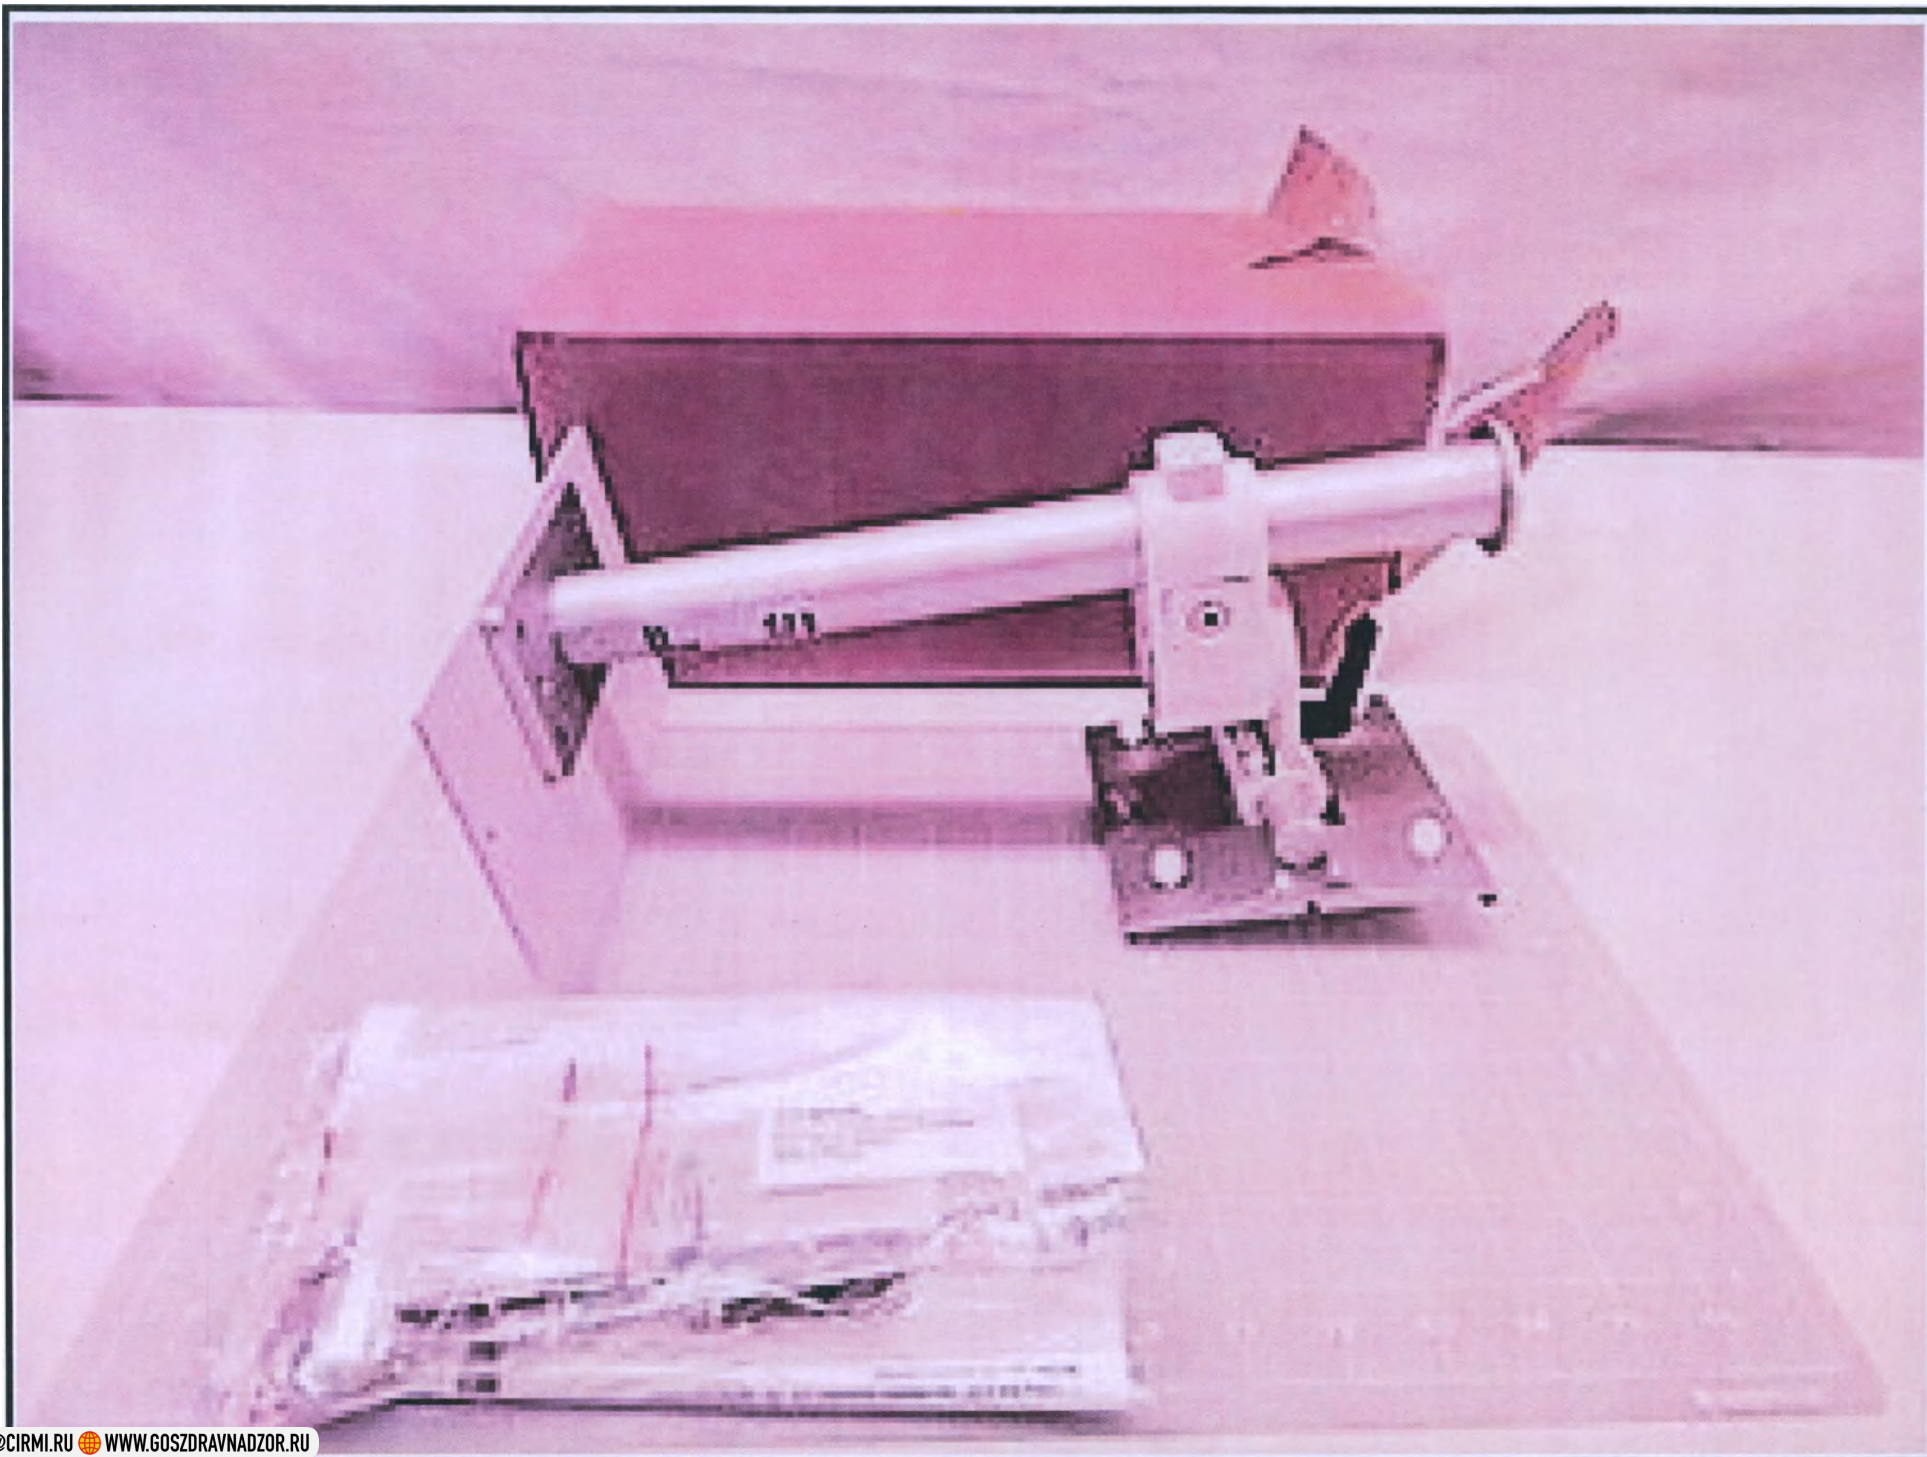


54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).



54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).




54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

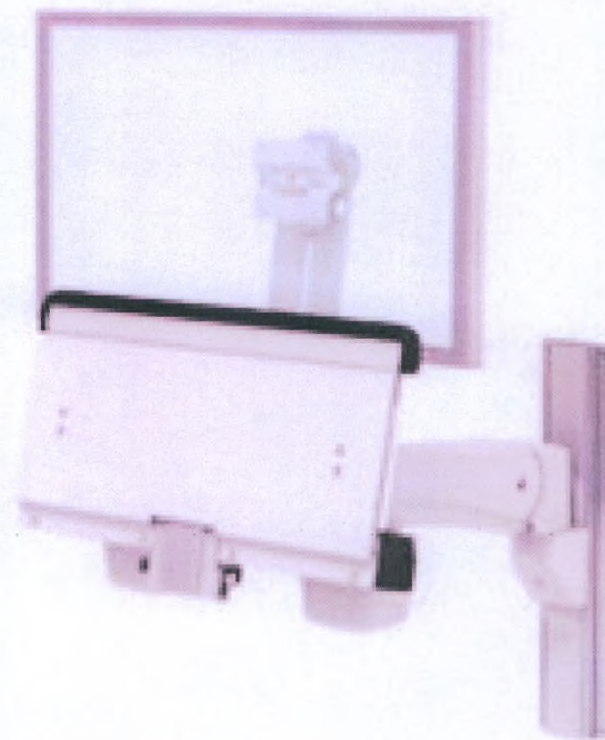


54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).




54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

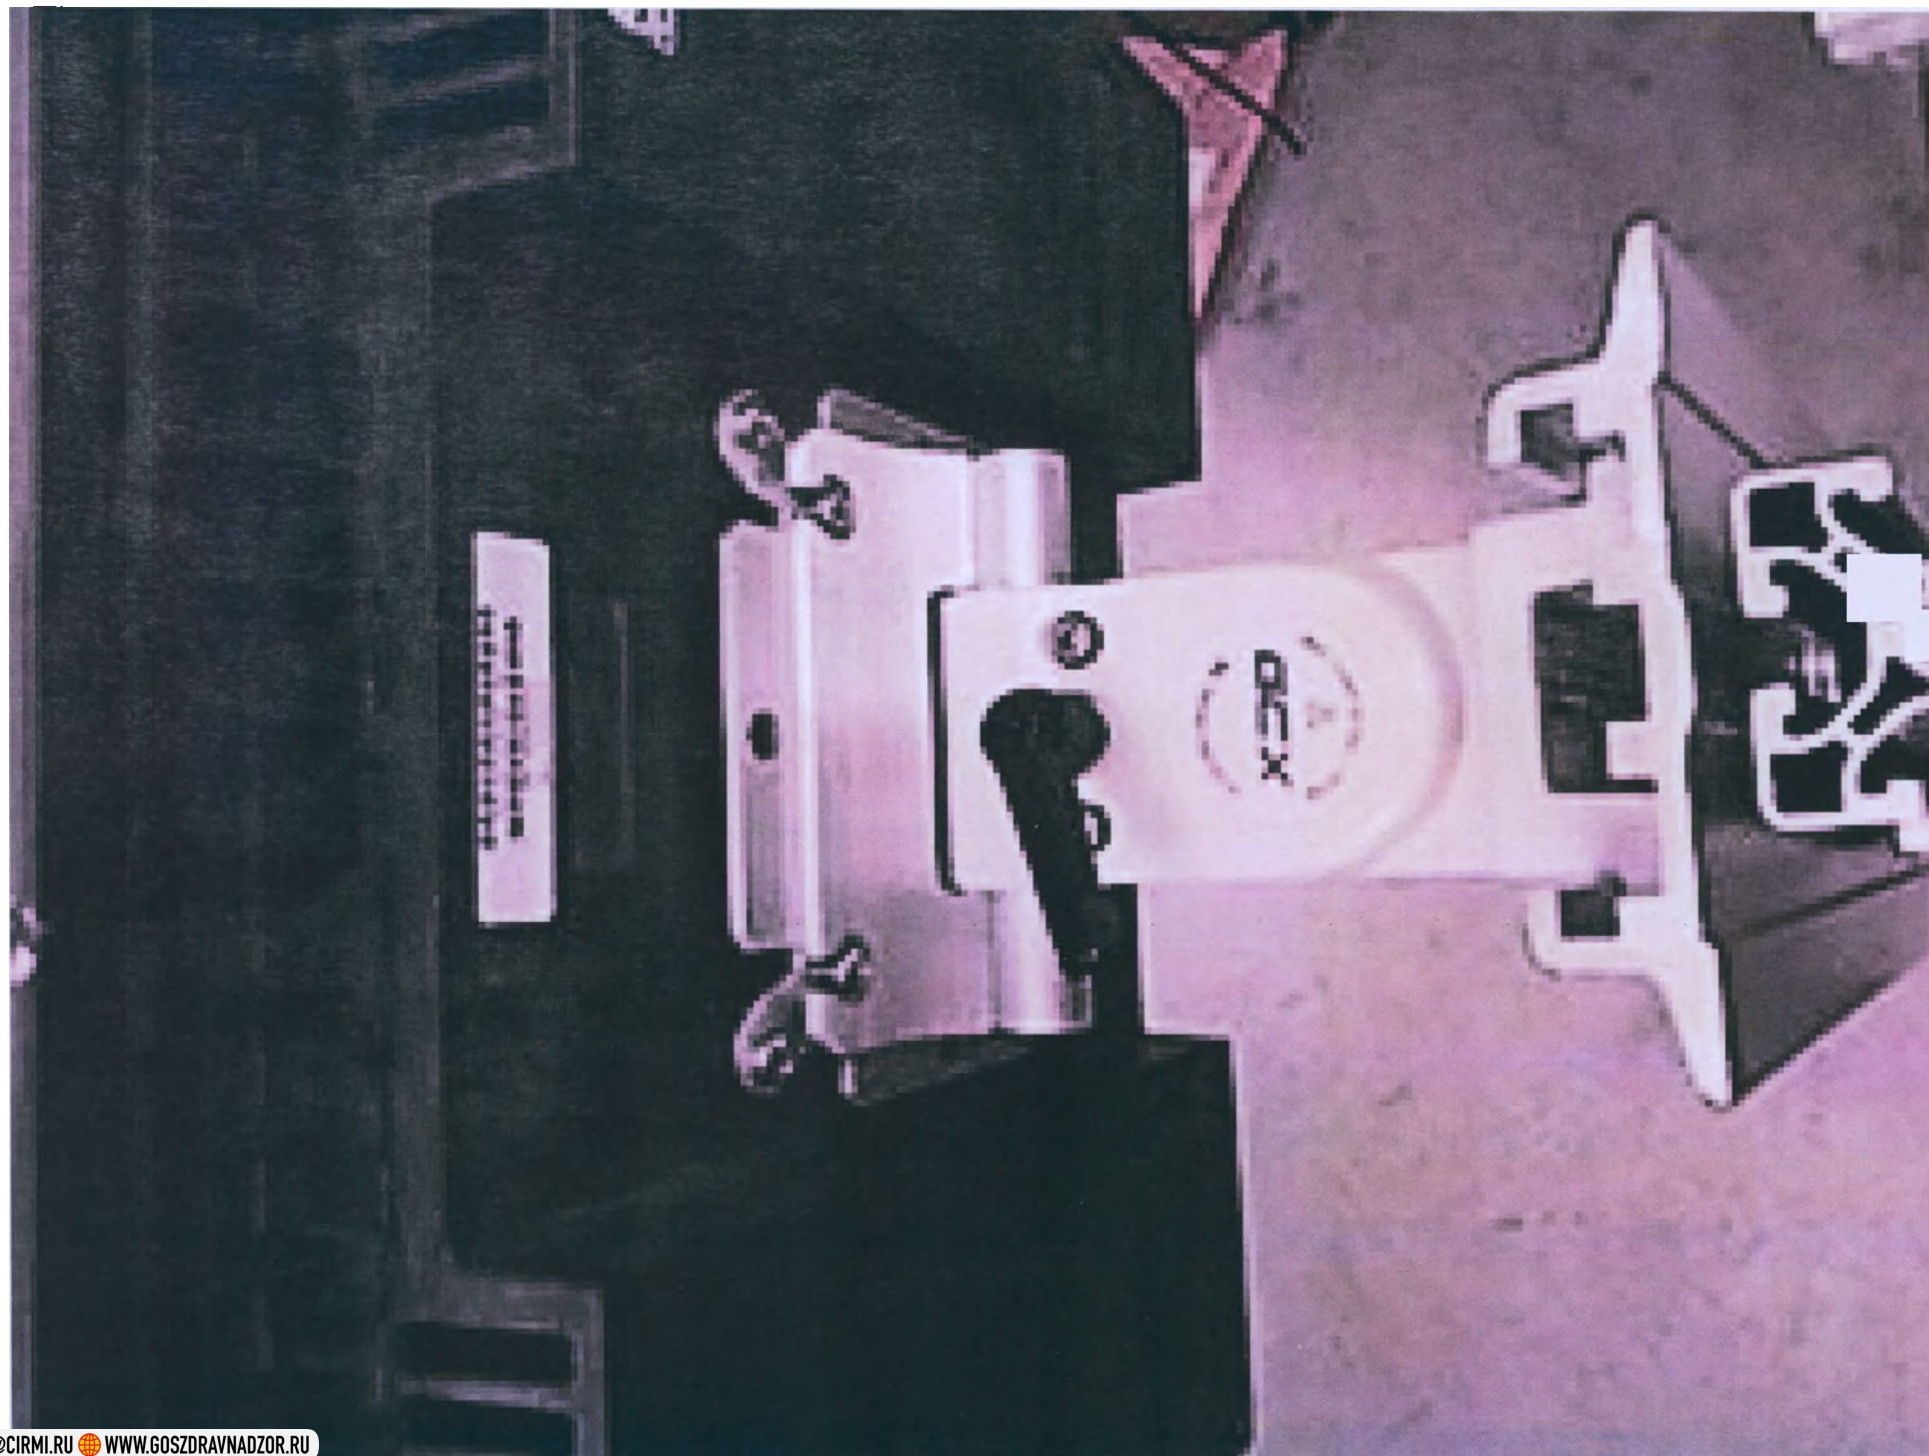

54. Крепления для монтажа (не более 5 шт.).

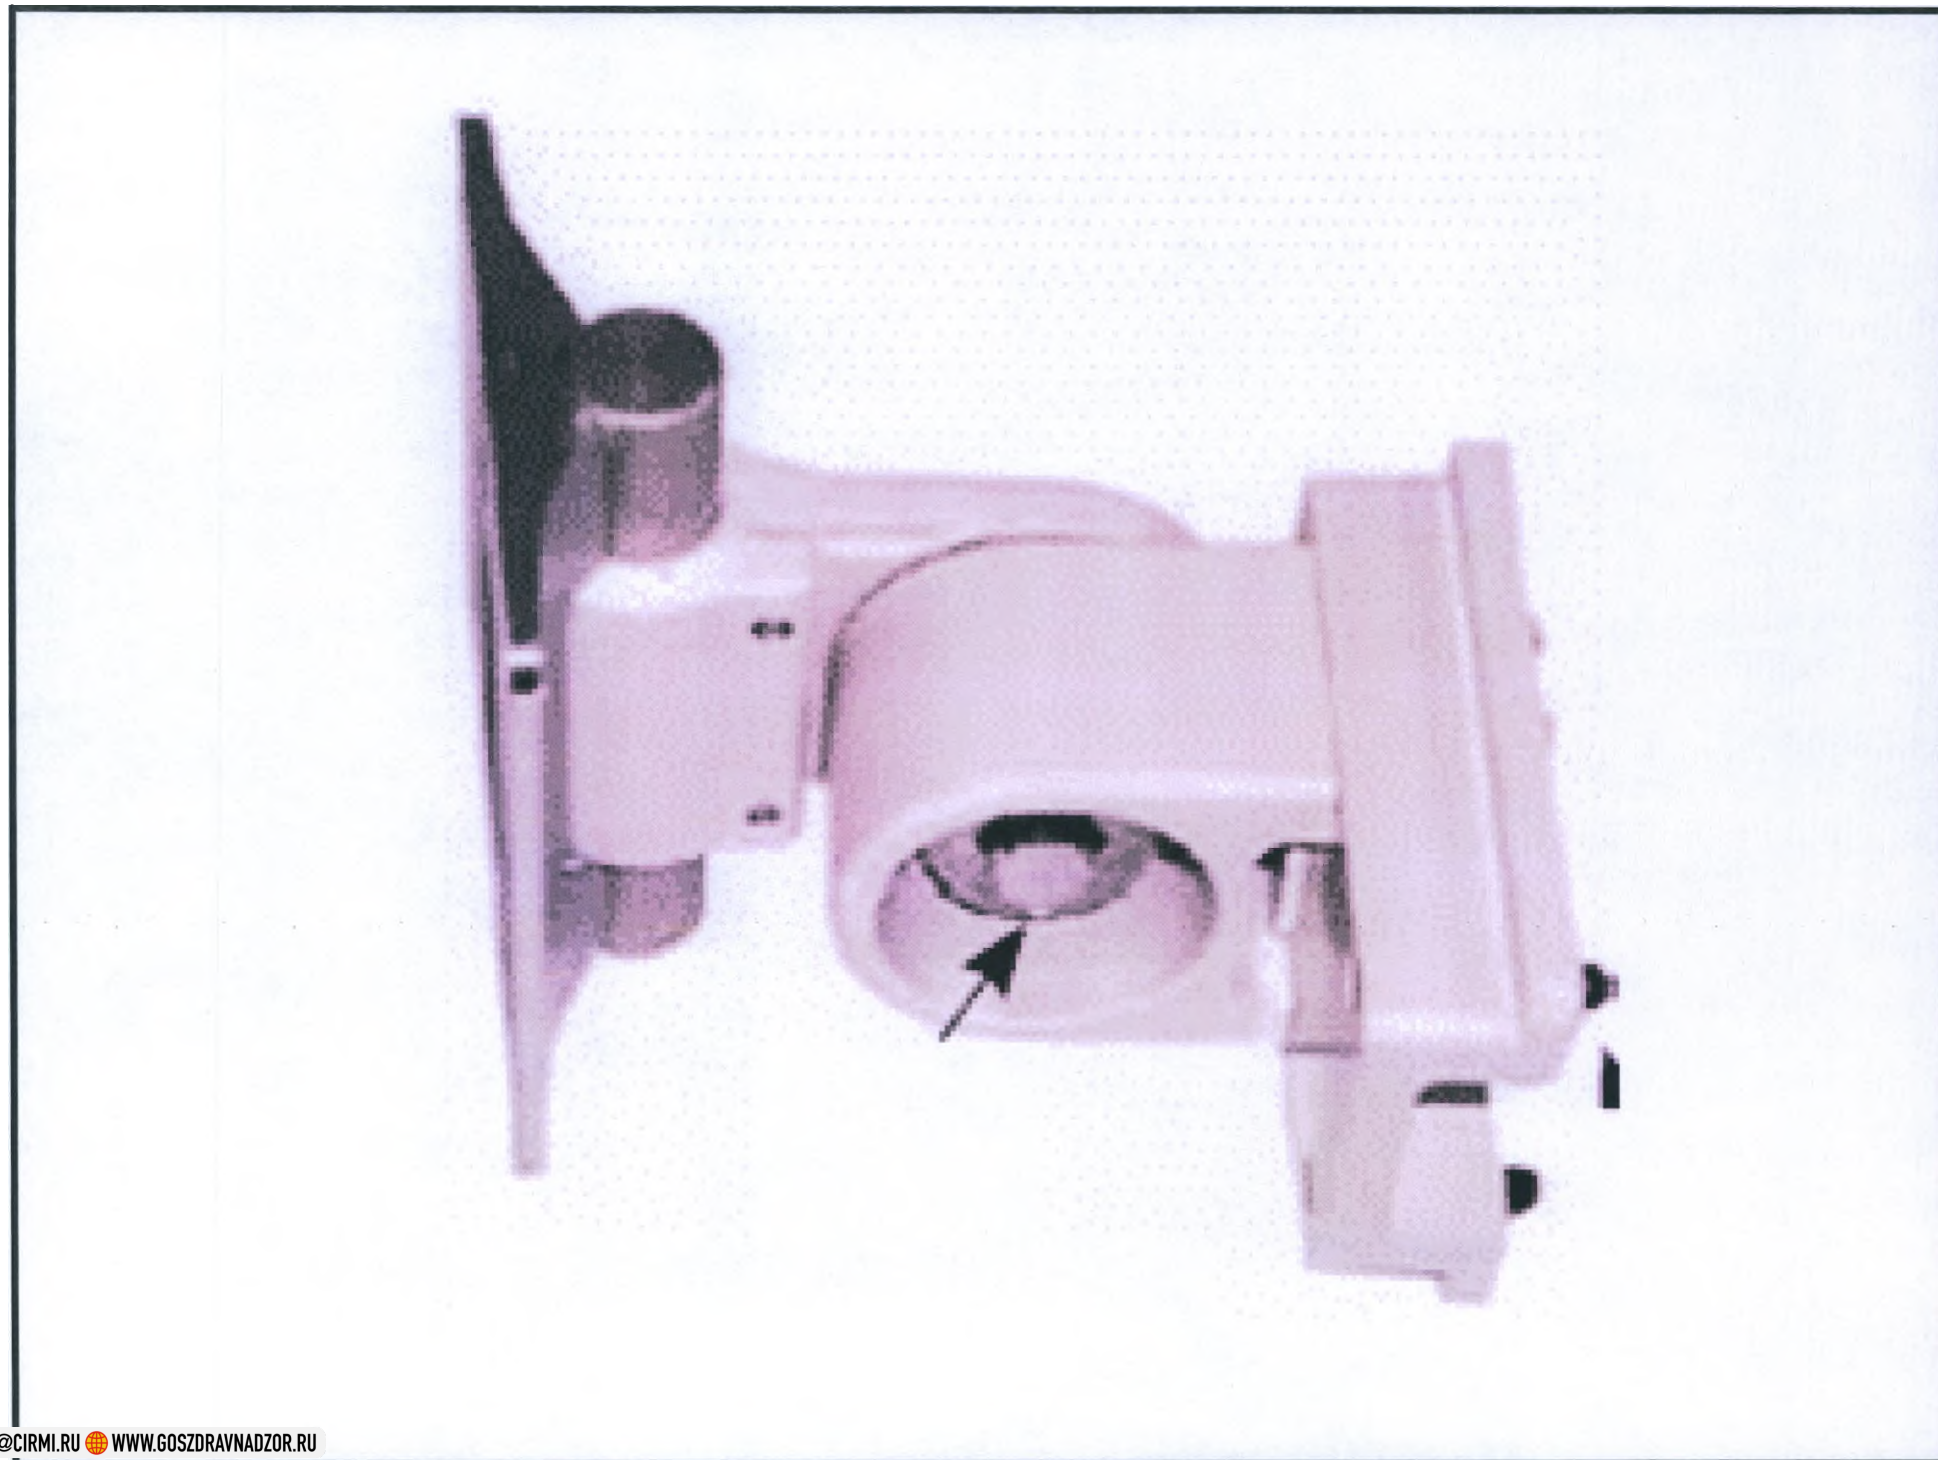


55. Лицензионный ключ активации пакета приложения «Удаленный экран центральной станции» на бумажном или электронном носителе.

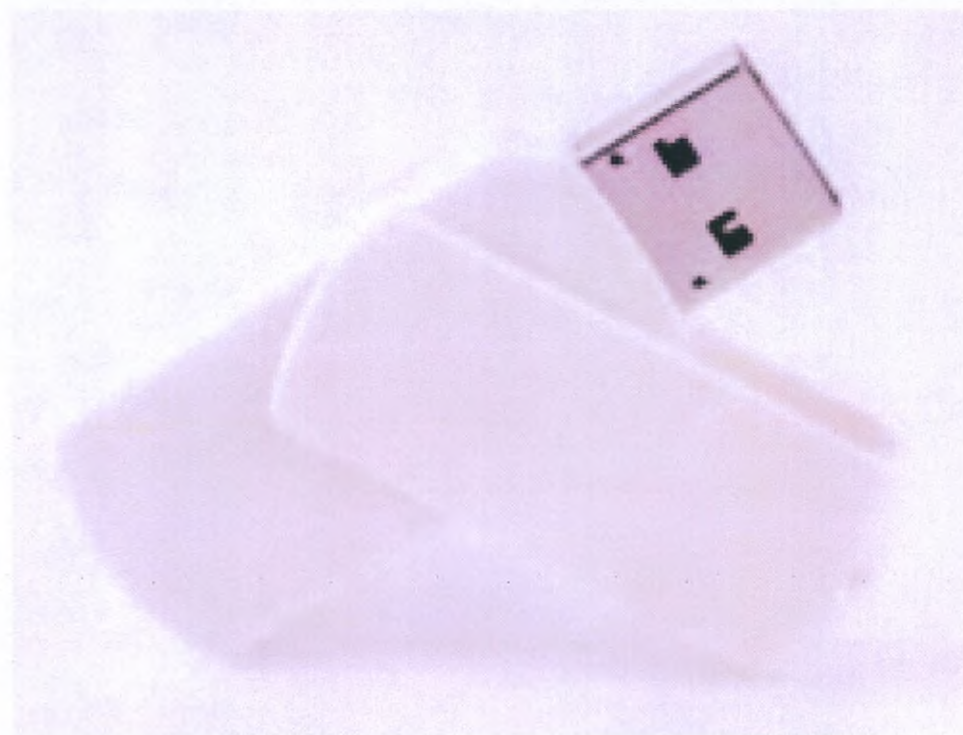

56. Блоки передачи и (или) приема данных (не более 32 шт.).



57. Сервер телеметрический.

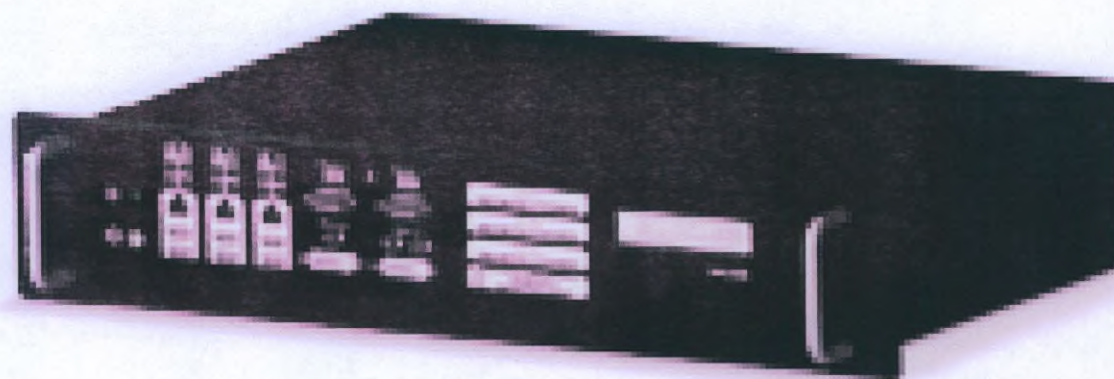


58. Устройства передачи данных (не более 500 шт.).




59. Устройства для установки сервера телеметрического (не более 2000 шт.).




60. Программное обеспечение сервера телеметрического (не более 16 шт.)

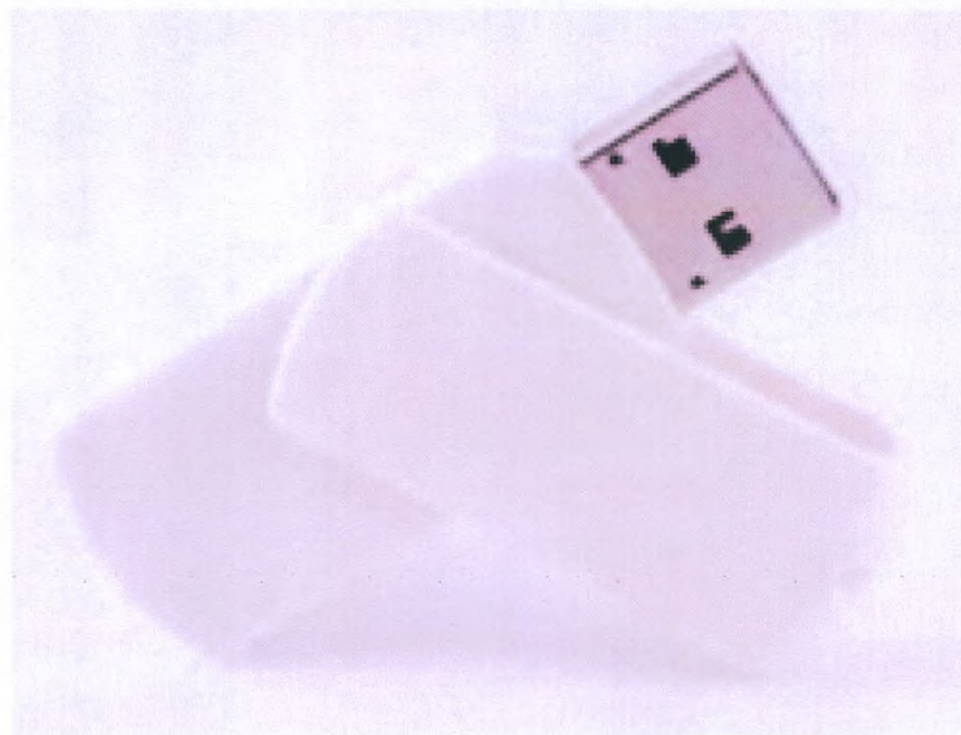


61. Накопители программного обеспечения (не более 10 шт.).

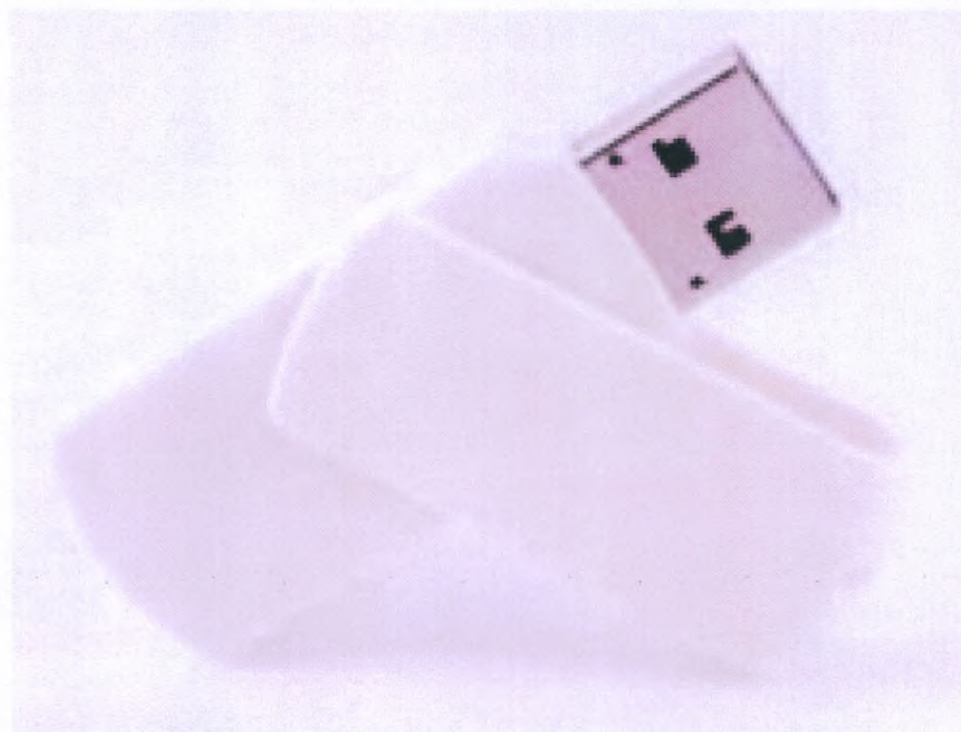


62. Шлюз мобильного мониторинга.

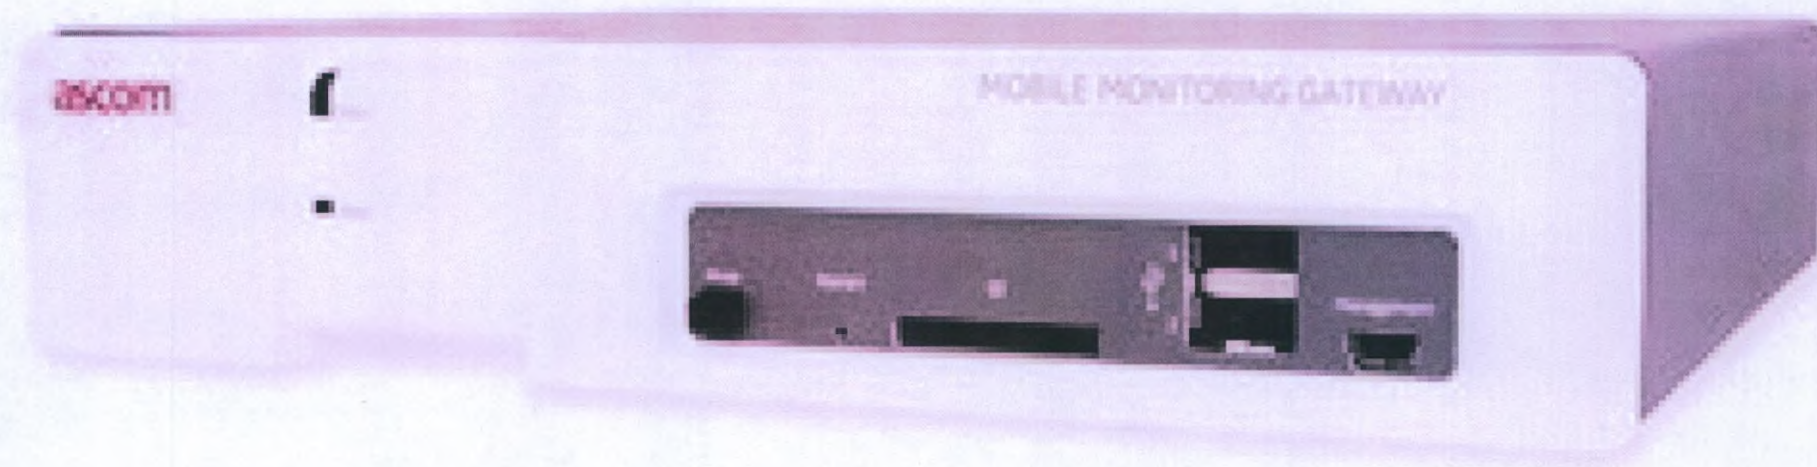

63. Программное обеспечение шлюза мобильного мониторинга на электронном или оптическом носителе.

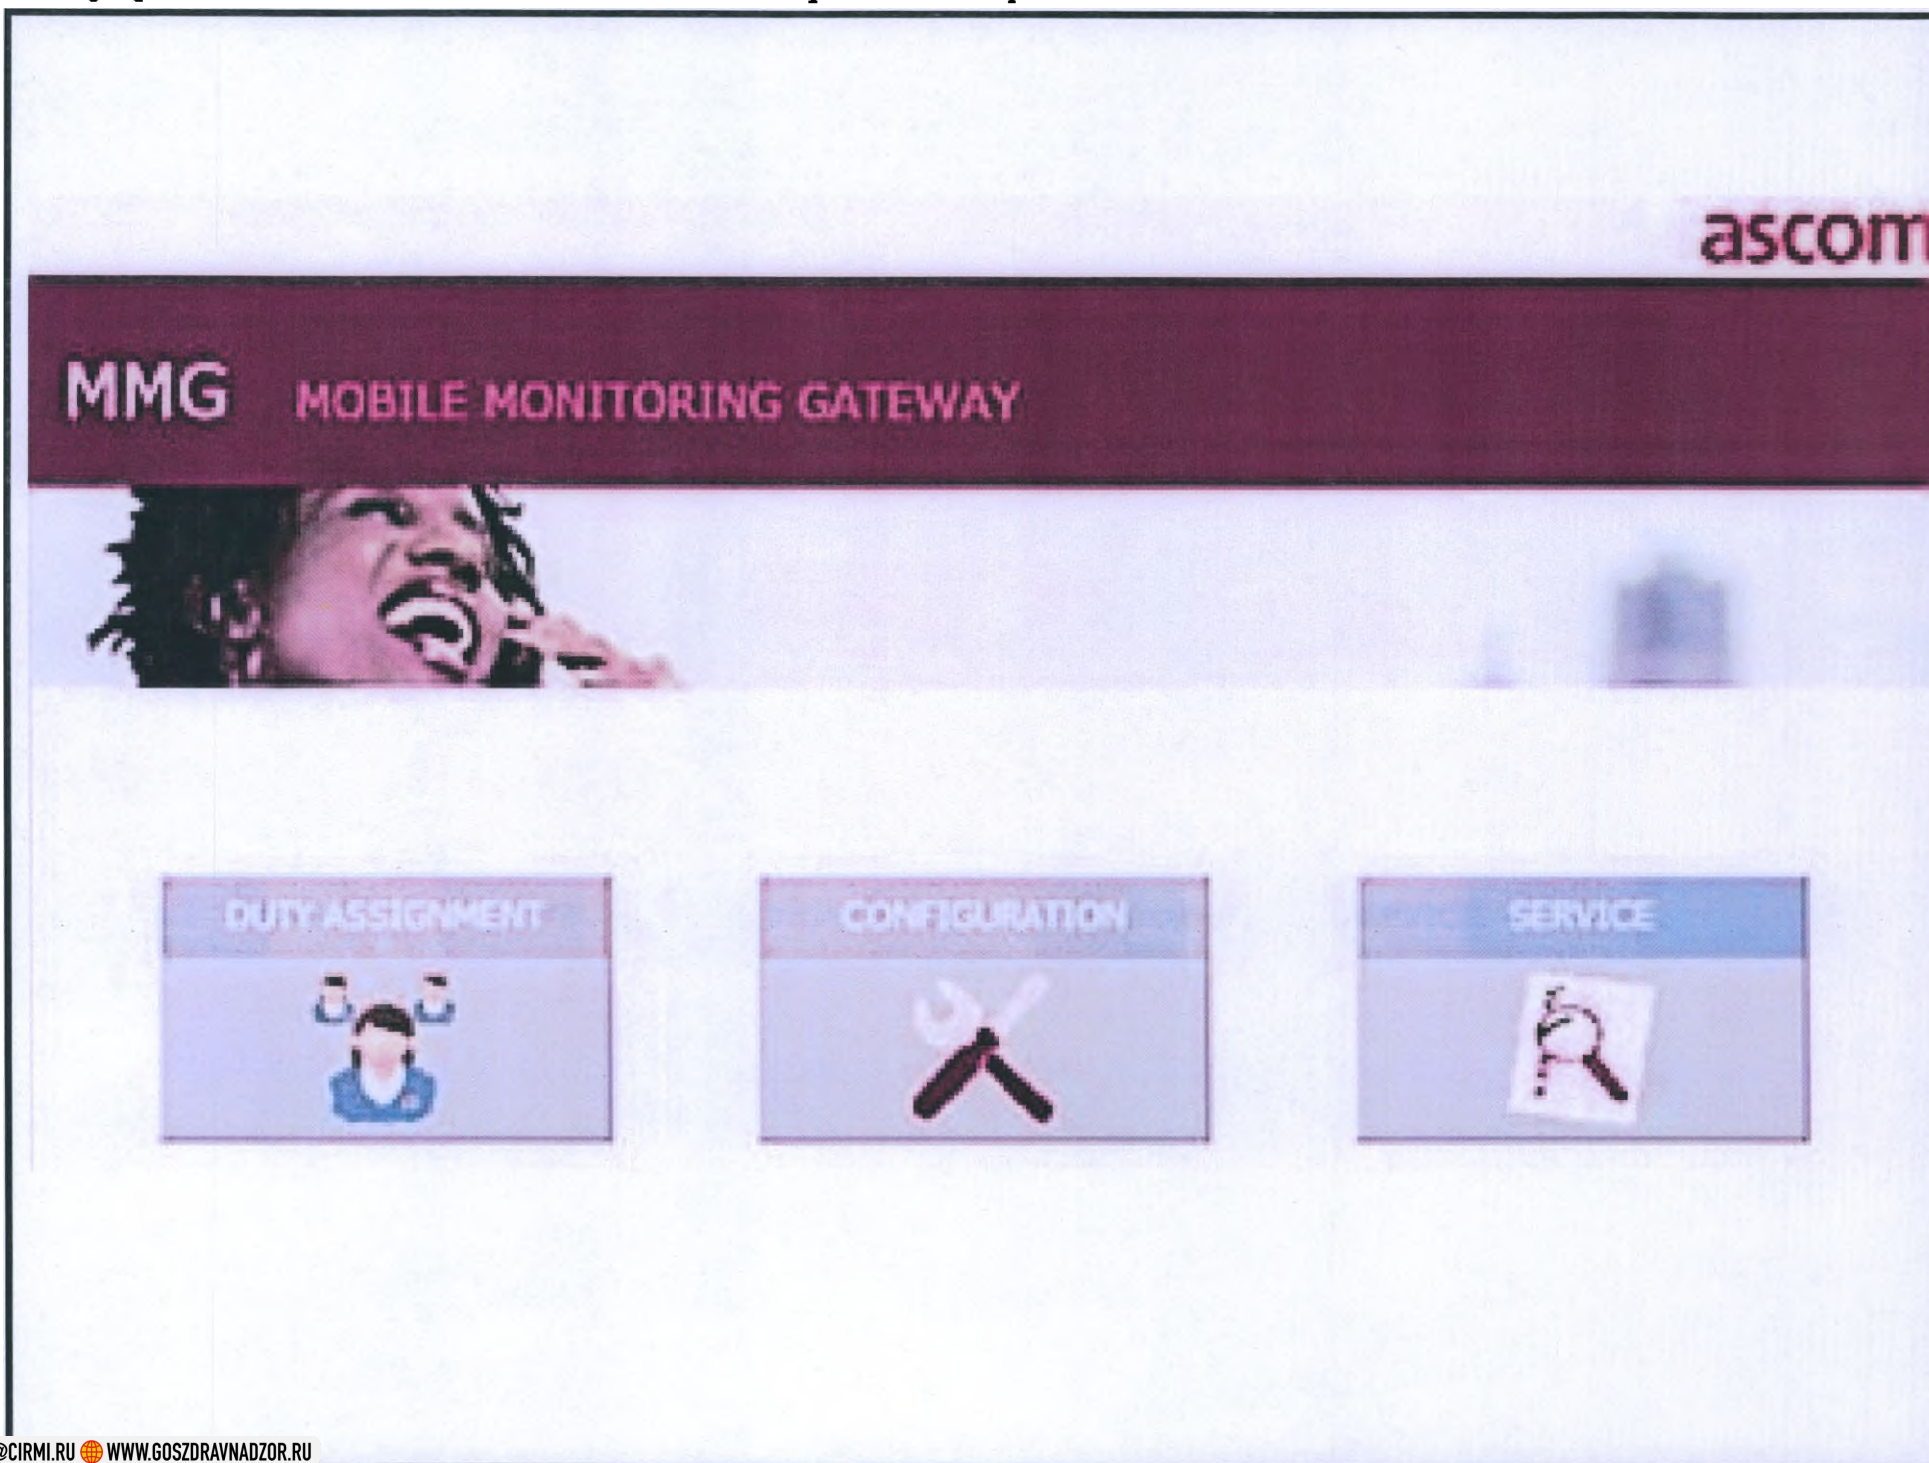

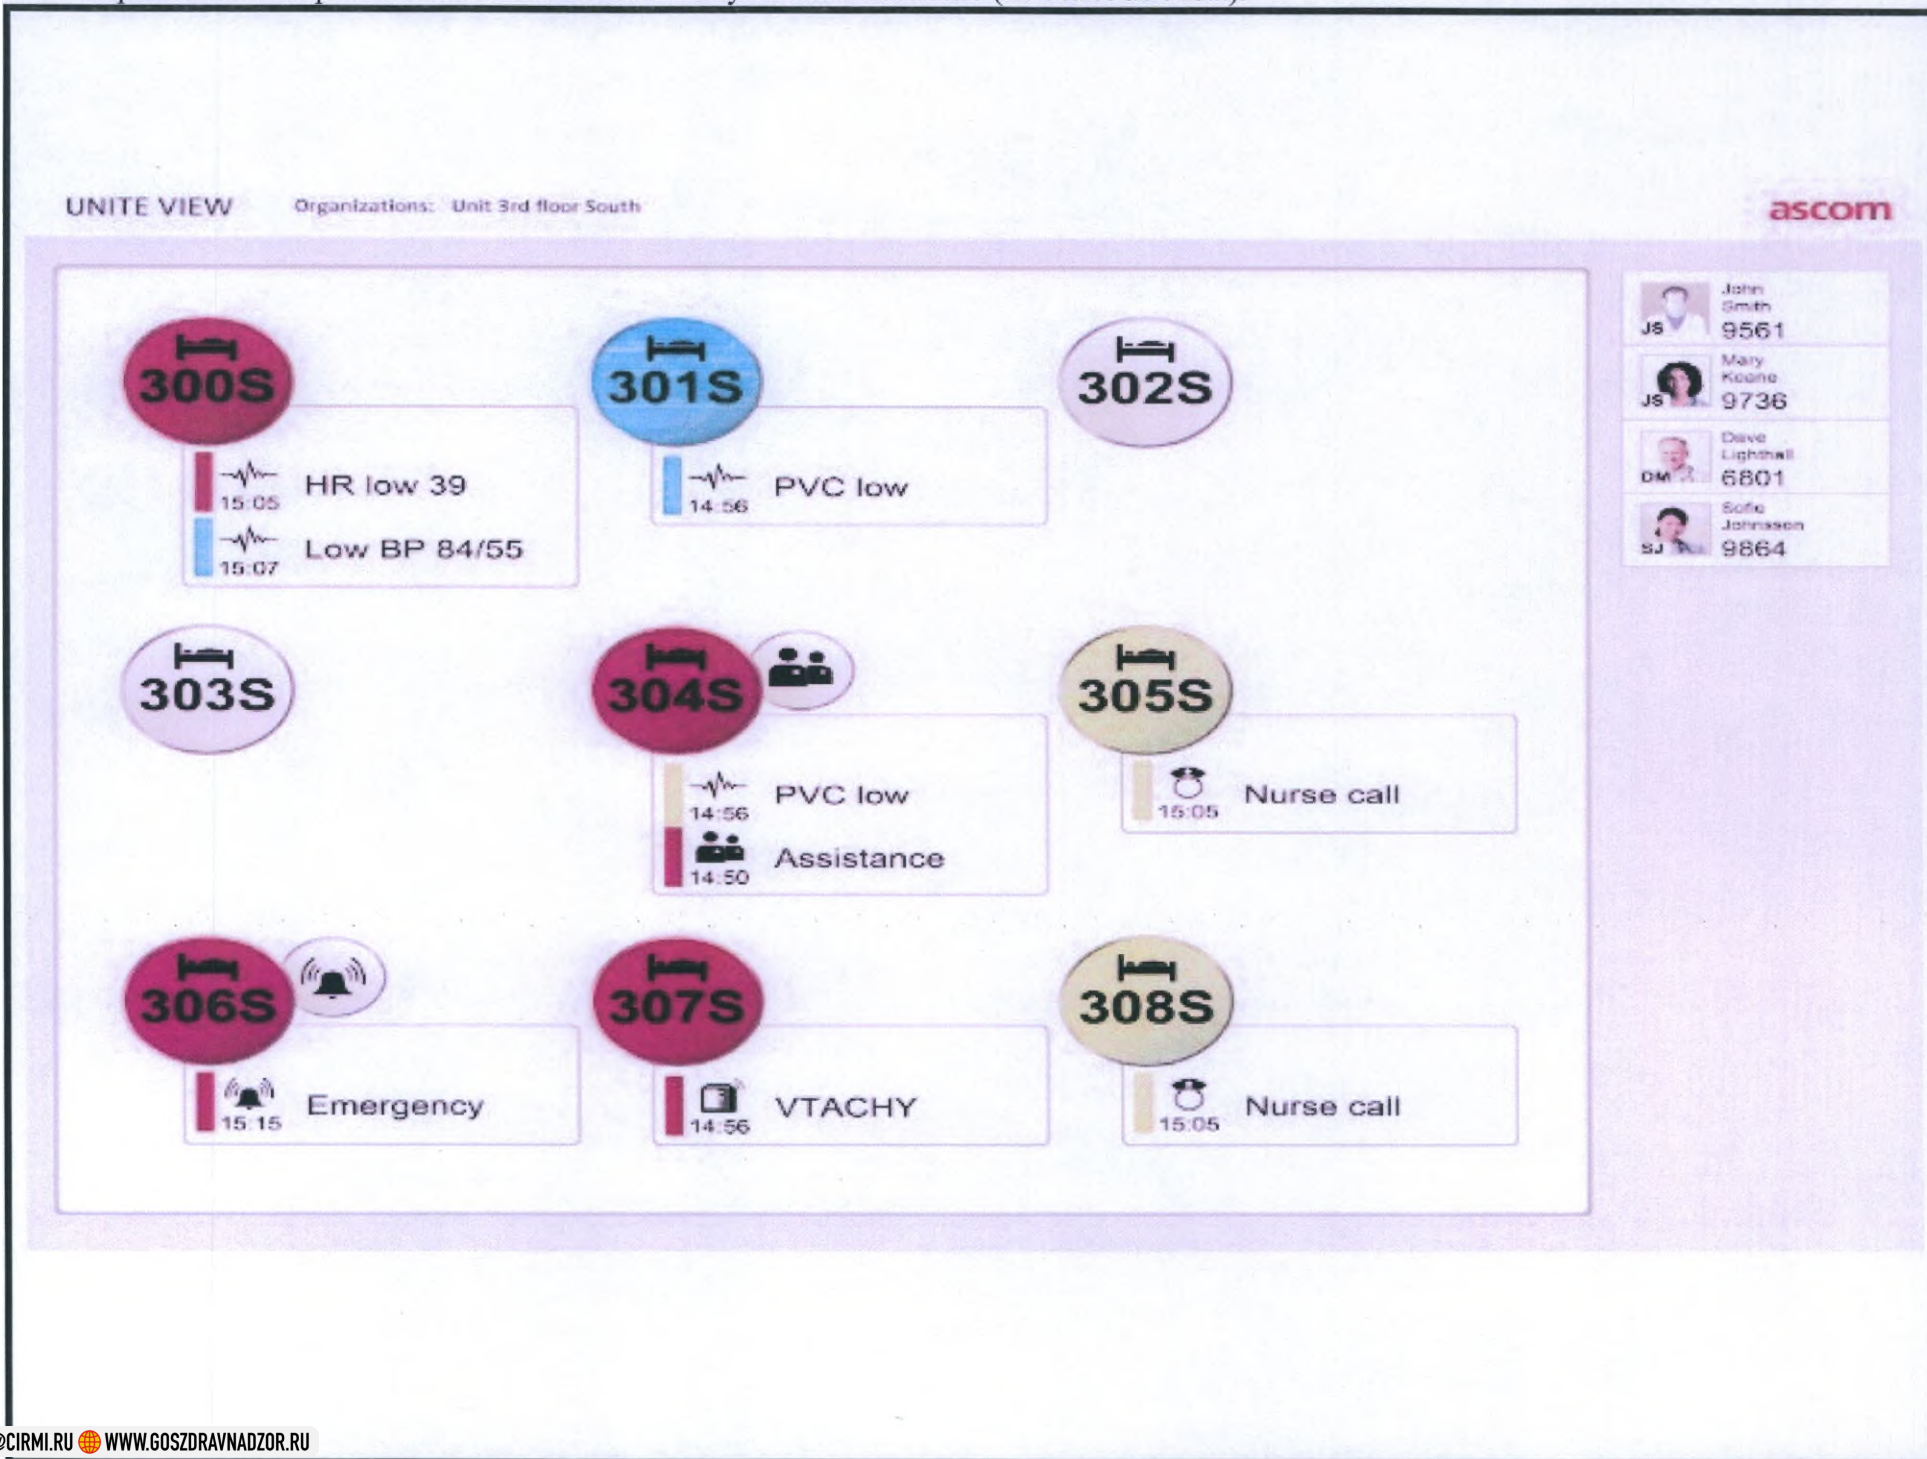



The screenshot displays the UNITE VIEW interface for 'Unit 3rd floor South'. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** 'UNITE VIEW' logo, 'Organizations: Unit 3rd floor South', and the 'ascom' logo.
- Left Panel (Staff List):**
 - John Smith (JS), 9561, LPN, Room 300S
 - Mary Keane (MK), 9736, RN, Room 305S
 - Dave Lighthall (DL), 6801, DR
 - Sofie Johnson (SJ), 9864, RN, Room 306S
- Central Panel (Bed 304S):**
 - Heart rate monitor showing 'VTACH' (Ventricular Tachycardia).
 - ECG waveform display.
 - Users in room:**
 - 14:10:23 John Smith
 - 14:35:33 Dave Lighthall
 - 14:50:49 John Smith
 - Send to:** A selection interface with icons for JS, DL, and MK. A search bar is present.
 - Event history:** 15:15:48 Initiated
- Right Panel (Bed Status List):**
 - Bed 306S: Emergency call, Sofie Johnson, 15:15:28, 00:34
 - Bed 300S: HR low 39, Mary Keane, 15:05:50, 19:01
 - Bed 307S: VTACHY, Dave Lighthall, 14:56:17, 19:43
 - Bed 305S: Nurse call, Mary Keane, 15:05:39, 11:19
 - Bed 308S: Nurse call, Dave Matheson, 15:03:02, 12:58
 - Bed 304S: PVC low, Dave Matheson, 14:56:04, 19:56
 - Bed 300S: Low BP 64/55, Dave Matheson, 15:07:31, 12:26
 - Bed 301S: HR 162, Dave Matheson, 14:56:05, 19:55

67. Сервер управления передачей данных.



68. Программное обеспечение сервера управления передачей данных на электронном или оптическом носителе.

UNIT

Friday, March 23, 2012 16:31



MORNING 07:30
TODAY

DAY 15:38
NOW

NIGHT 23:30
TODAY



CALENDAR



TO ONGOING

STAFF ON THE SHIFT

AL	Ava Lee Doctor 3383	
ET	Ethan Tremblay Head nurse 5258	
DL	Daniel Li Nurse 4177	
SL	Sophia Lee Physician 1743	
SB	1 Sophia Brown Nurse 2534	
EL	1 Ethan Li Nurse 4460	
AL	Alexander Lam Head nurse 3819	

ASSIGNMENTS

6 UNASSIGNED BEDS

Unit 122



Room 201



1:1	2:2	3:3	4:4	5:5	6:6

Room 202



1:1	2:2	3:3	4:4

Patient monitor



ascom

Unite Connectivity Manager

Send Message



Phonebook



Device Manager



Users & Groups




Activity Log Viewer




Configuration




71. Лицензионный ключ для активации приложения "Доступ для Ascom Мусо" сервера управления передачей данных на электронном или оптическом или бумажном носителе (не более 250 шт.). 118

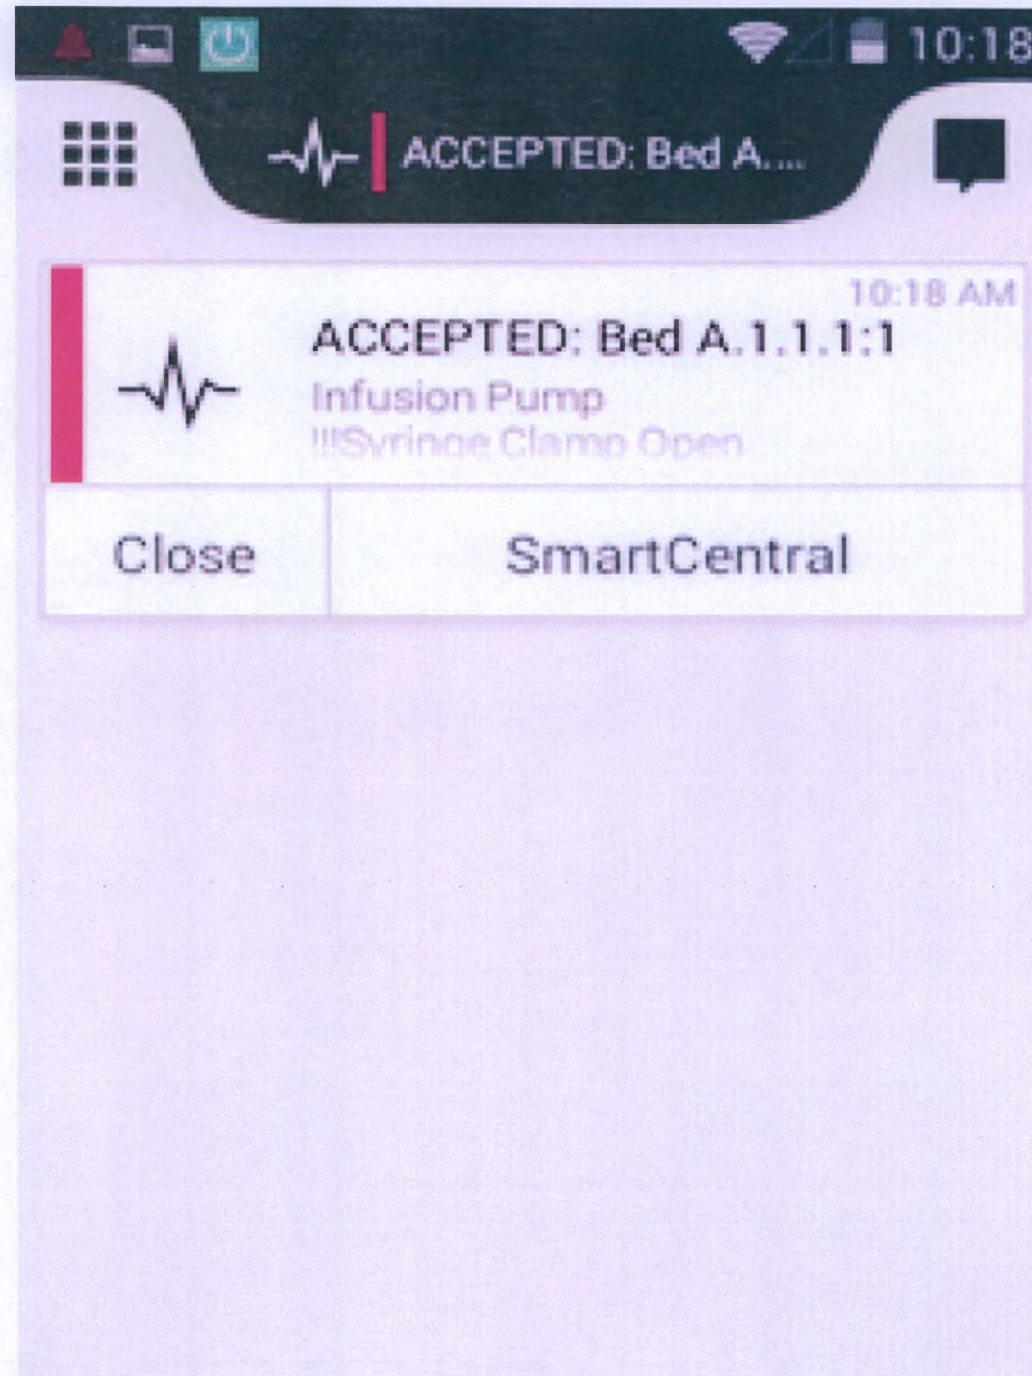




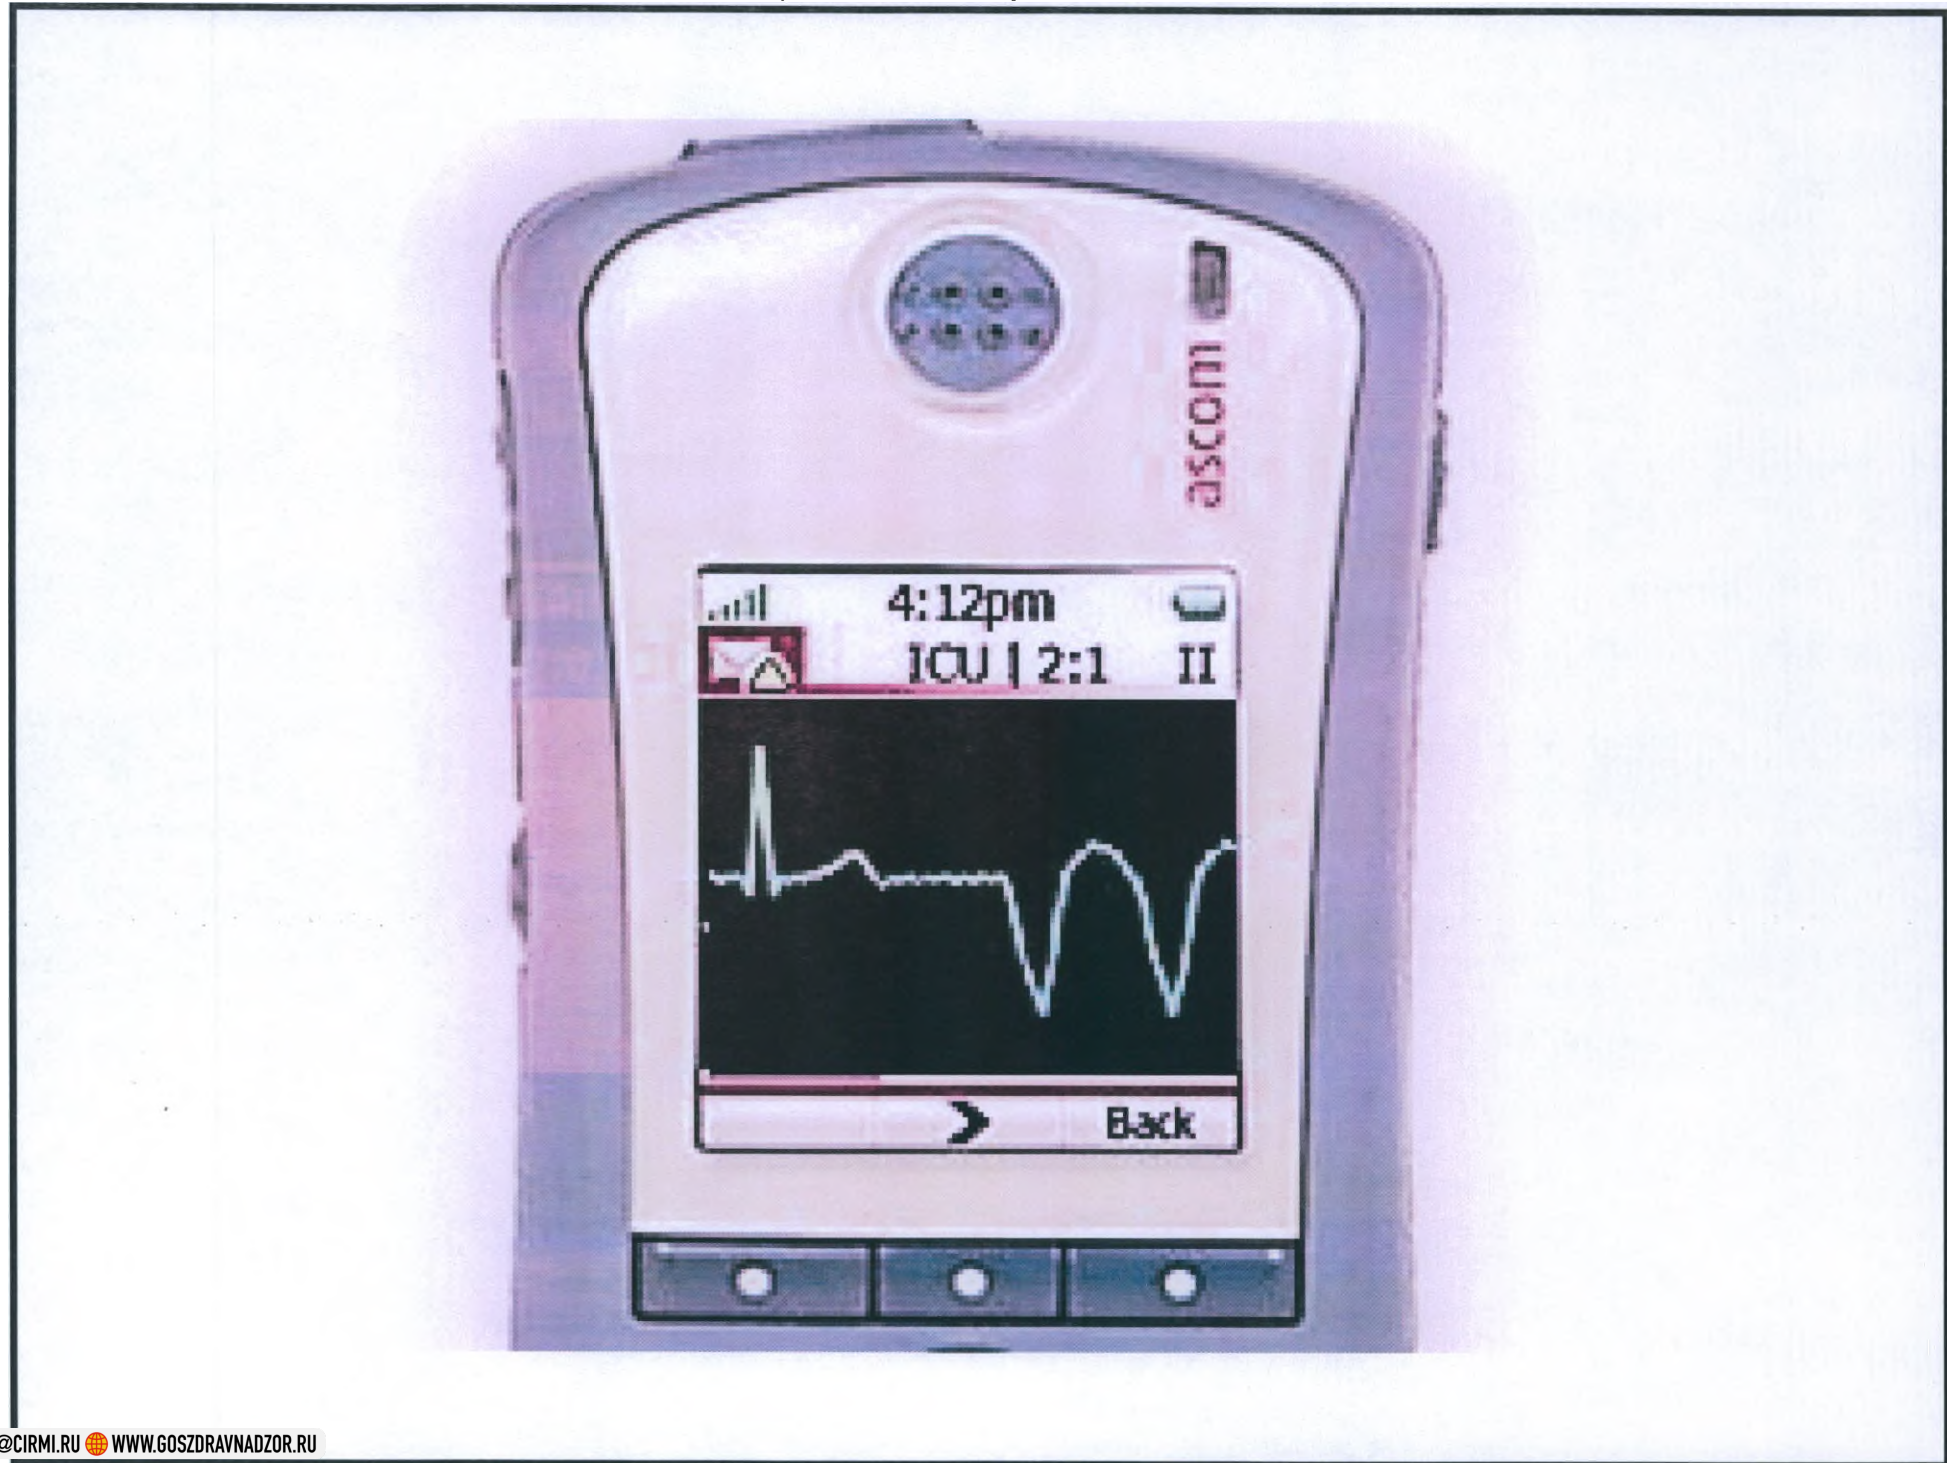



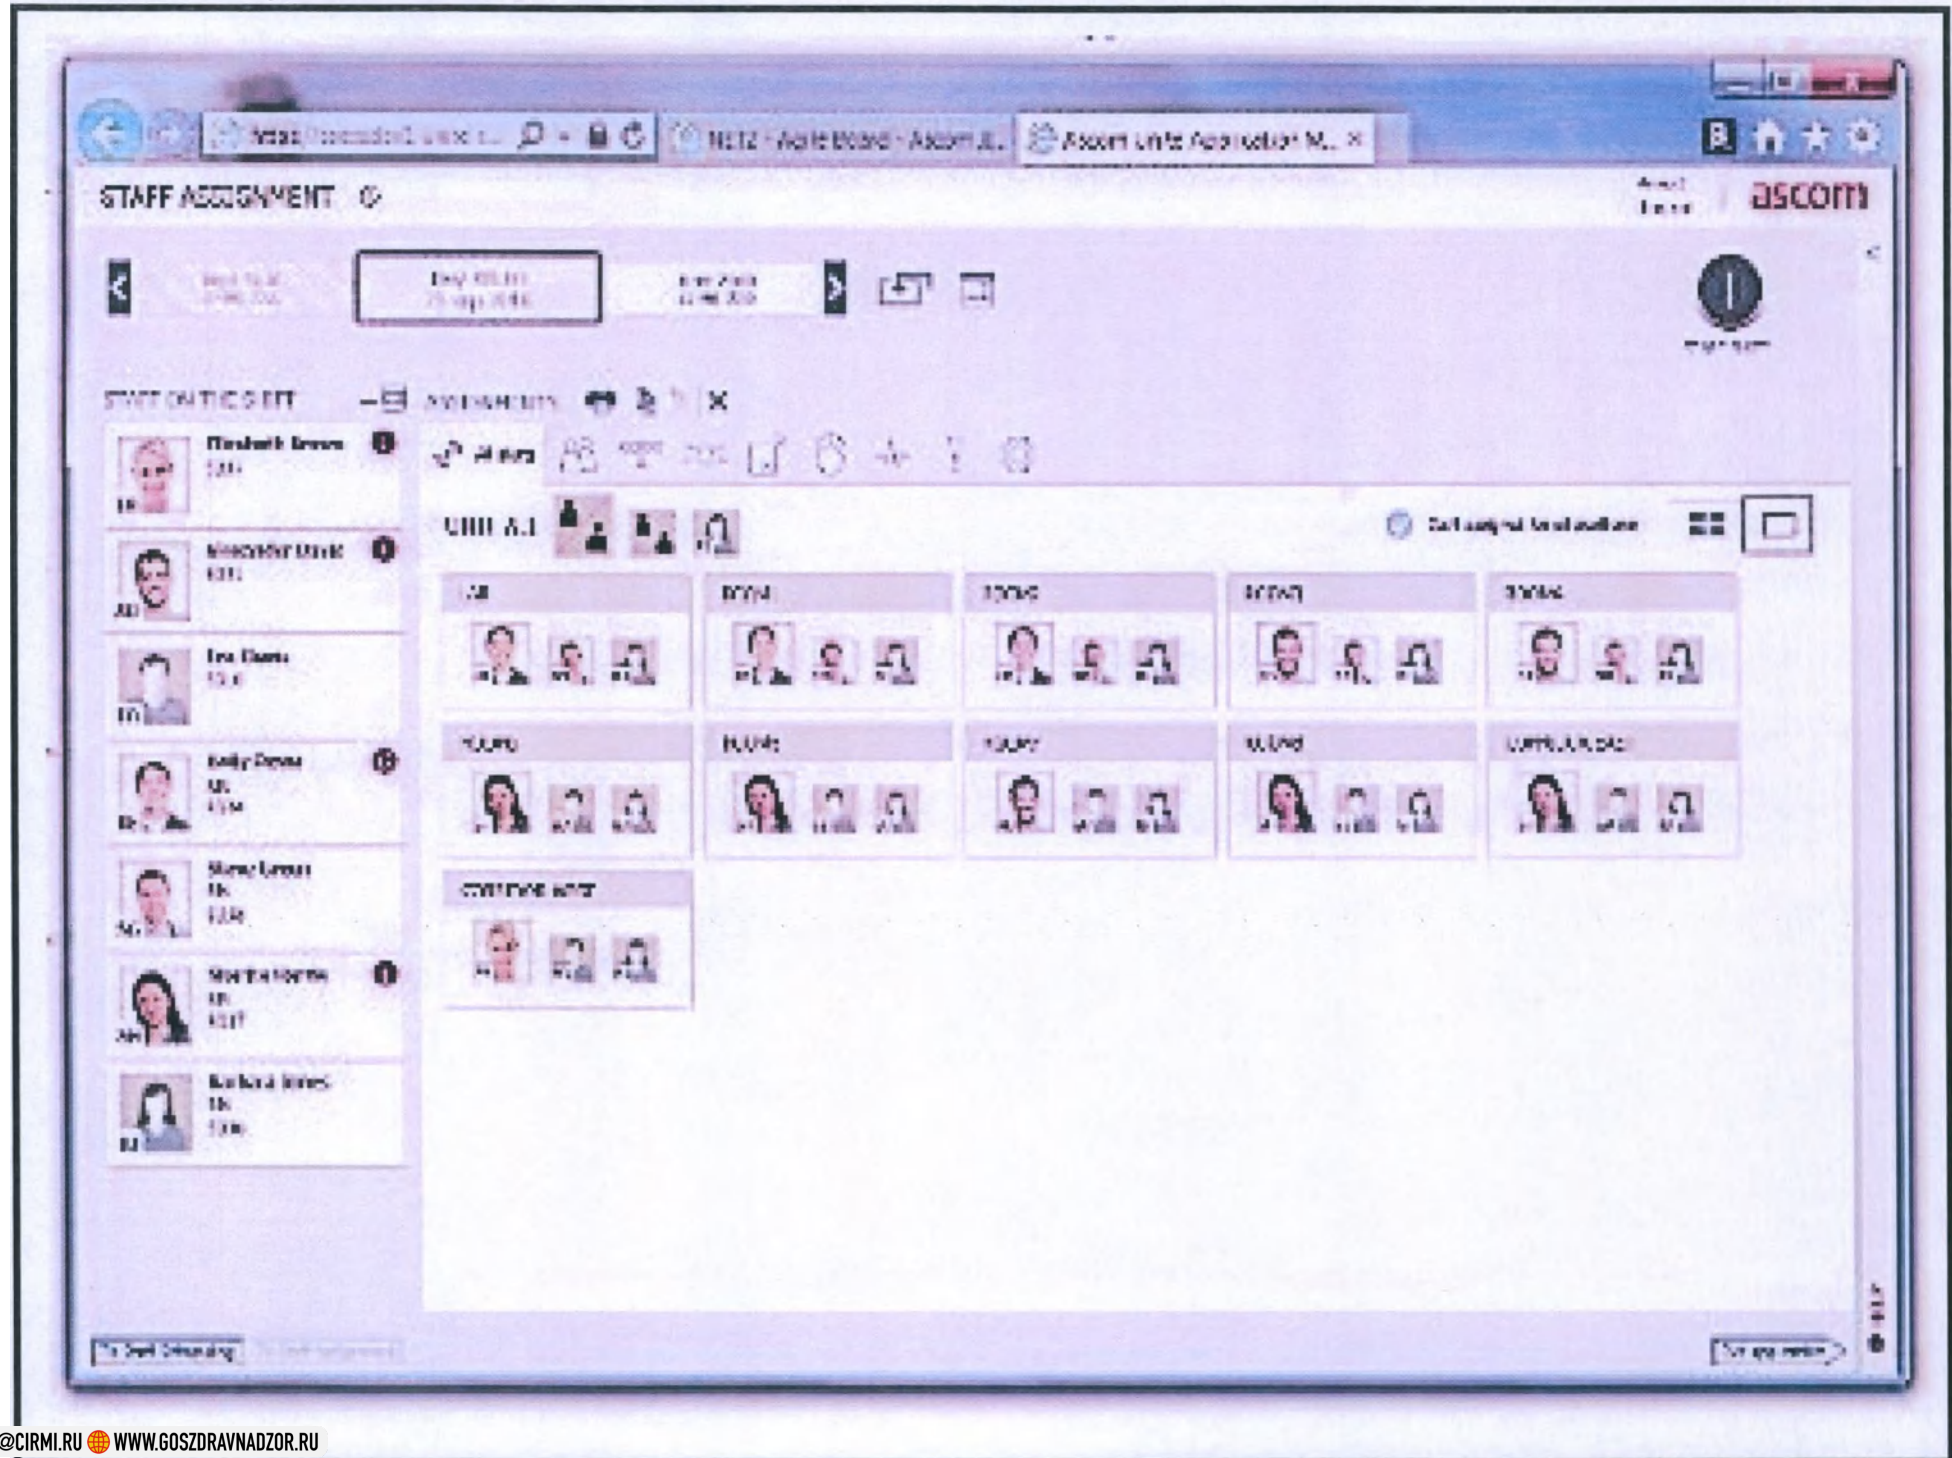

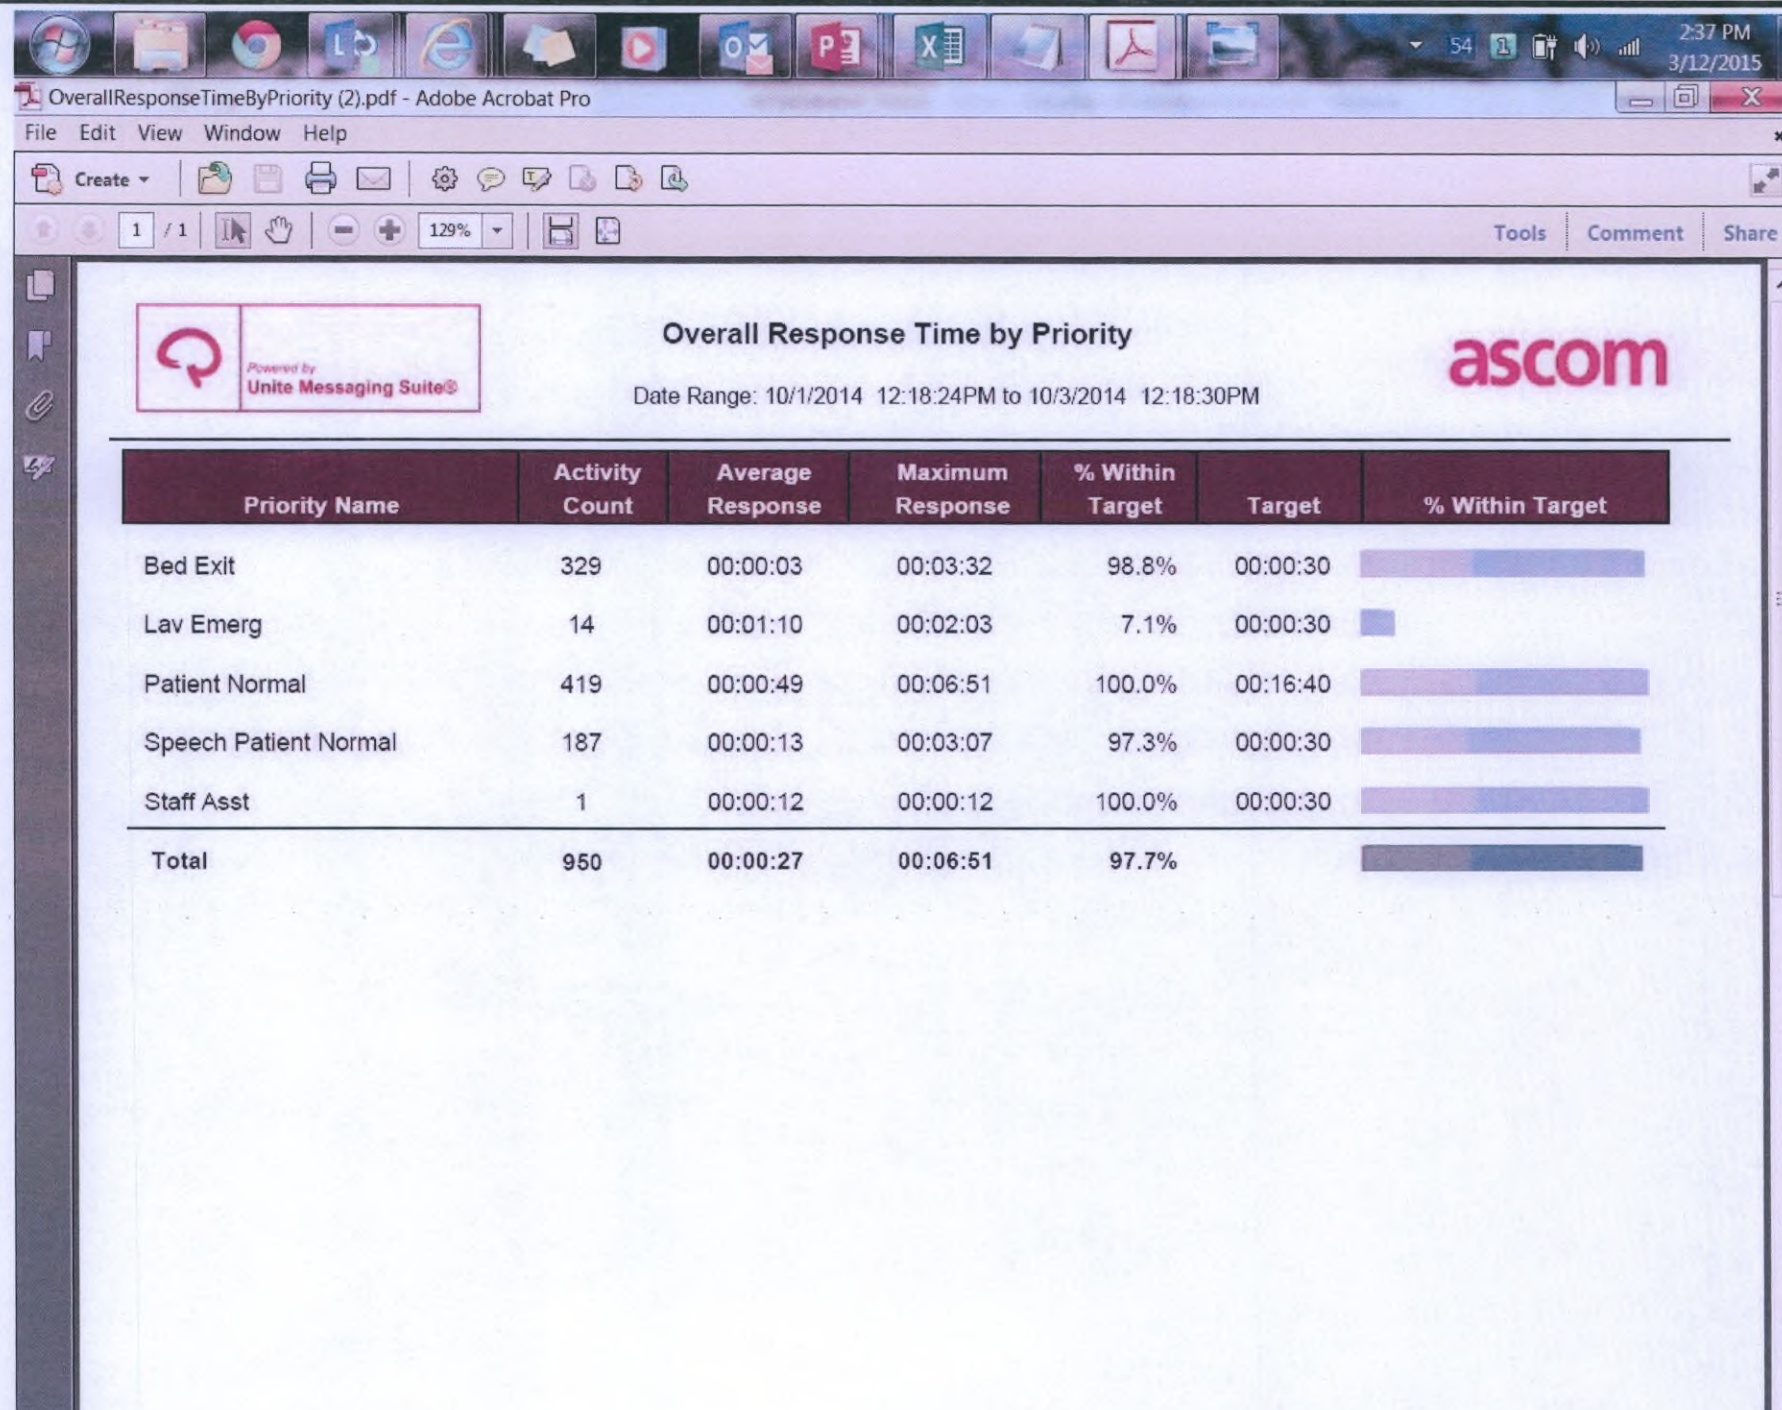

ResponseTimeTarget-ExceptionList (2).pdf - Adobe Acrobat Pro File Edit View Window Help Create 1 / 16 129% Tools Comment Share					
Powered by Unite Messaging Suite® Response Time Target-Exception List ascom					
Area(s): 1ST CARDIAC, 1ST EMERGENCY DEPT, 2ND ICU, 3RD FLR, 4TH FLR, test					
Date Range: 10/1/2014 12:49:35PM to 10/31/2014 12:49:42PM					
Priority Exception		Target			
Bed Exit		> 00:30			
Response Time	Call Sent Date & Time	Call Clear Date & Time	Area	Location	
00:01:49	10/01/14 03:07:49PM	10/01/14 03:09:38PM	4TH FLR	4211	
00:00:32	10/02/14 12:15:25AM	10/02/14 12:15:57AM	3RD FLR	3152	
00:00:36	10/02/14 12:12:28PM	10/02/14 12:13:04PM	3RD FLR	3152	
00:03:32	10/03/14 10:19:34AM	10/03/14 10:23:06AM	4TH FLR	4262	
00:03:22	10/03/14 02:34:16PM	10/03/14 02:37:38PM	3RD FLR	3091	
00:00:33	10/03/14 05:19:13PM	10/03/14 05:19:46PM	3RD FLR	3091	
00:01:17	10/03/14 08:09:19PM	10/03/14 08:10:36PM	3RD FLR	3091	
00:00:37	10/04/14 06:34:36PM	10/04/14 06:35:13PM	4TH FLR	4001	
00:02:35	10/05/14 02:54:46AM	10/05/14 02:57:21AM	3RD FLR	3121	
00:00:34	10/05/14 02:00:57PM	10/05/14 02:01:31PM	4TH FLR	4241	
00:00:58	10/05/14 05:45:22PM	10/05/14 05:46:20PM	4TH FLR	4281	
00:00:41	10/05/14 06:00:46PM	10/05/14 06:01:27PM	4TH FLR	4281	
00:00:42	10/05/14 11:55:42PM	10/05/14 11:56:24PM	3RD FLR	3121	
00:01:13	10/06/14 01:25:10AM	10/06/14 01:26:23AM	3RD FLR	3121	
00:01:06	10/07/14 01:39:30AM	10/07/14 01:40:36AM	3RD FLR	3121	
00:00:38	10/07/14 03:37:29PM	10/07/14 03:38:07PM	4TH FLR	4011	
00:00:34	10/07/14 03:39:00PM	10/07/14 03:39:34PM	3RD FLR	3001	
00:00:31	10/07/14 04:21:26PM	10/07/14 04:21:57PM	3RD FLR	3181	
00:00:39	10/08/14 10:38:58AM	10/08/14 10:39:37AM	3RD FLR	3211	
00:01:23	10/08/14 11:34:29AM	10/08/14 11:35:52AM	3RD FLR	3101	
00:00:39	10/08/14 01:36:47PM	10/08/14 01:37:26PM	4TH FLR	4011	
00:00:46	10/08/14 01:39:06PM	10/08/14 01:39:52PM	4TH FLR	4011	
	10/08/14 02:41:08PM	10/08/14 02:42:19PM	3RD FLR	3181	



79. Сервер передачи данных.



80. Программное обеспечение сервера передачи данных на электронном или оптическом носителе.

UNITE VIEW Organization: Unit 3rd Base South **ascom**

John Smith
0981 LTN
Nurse 300

Mary Moore
0733 RN
Nurse 300

David Lightfoot
0001 DR
DR

Sally Johnson
0004 RN
Nurse 300

Bed 3345 Nurse call
Last alarm: 11:42

Staff in room

Send to:

De: [Search]

Page 1 of 1

Send

Call history

History

Patient Information

Admitted to: 15/03/2015
First alarm: John
Admission: Andrew
Last alarm: David
Date of birth: 01 March 1975
Age: 40
Sex: Male

Previous location: Emergency Room
Transfer location: 28 June 2015
Planned discharge: 28 June 2015

Attending doctor: David Lightfoot
Physician: Mary Smith
Nurse: Sally Johnson

Comments: with wife David, phone number 063 000 0000 (private, wheelchair only)

Bed 3355 Emergency call
Last alarm: 11:42

Bed 3355 HR 100
Last alarm: 11:42

Bed 3375 VITALITY
Last alarm: 11:42

Bed 3355 Nurse call
Last alarm: 11:42

Bed 3355 Nurse call
Last alarm: 11:42

Bed 3345 PVD low
Last alarm: 11:42

Bed 3355 Low BP 90/60
Last alarm: 11:42

Bed 3315 HR 150
Last alarm: 11:42

6 South

Staff Phones

Print...

Clear All

Undo

Search

Assignments saved

CN Brian Brown

-  Brian Brown 6002 (1)
-  Chloe Brown 9068 (3)
-  Elizabeth Brown 9007 (3)
-  Patricia Crawley 6005 (4)
-  Alexander Davis 9001 (4)
-  Amanda Garcia 9156 (20)
-  Anna Israelsson No phone (1)
-  Melissa Johnson 9048 (5)

		RN	LPN	AIDE
601-S	John Davis M 45	Elizabeth Brown	Emma Williams	Amanda Garcia
602-S	Linda Harris F 62	Elizabeth Brown	Emma Williams	Amanda Garcia
603-S	Lisa Jones F 59	Chloe Brown	Emma Williams	Amanda Garcia
604-S	Peter Martin M 61	Chloe Brown	Patricia Johnson	Amanda Garcia
605-S	Karen Williams F 49	Chloe Brown	Emma Williams	Amanda Garcia
606-S	Kelly Evans F 53	Patricia Crawley	Patricia Johnson	Amanda Garcia
607-S	Dorothy Taylor F 71	Patricia Crawley	Patricia Johnson	Amanda Garcia
608-S	Barbara White F 68	Patricia Crawley	Emma Williams	Amanda Garcia

John Smith
9581 LPN
Room 3005

Mary Keane
9736 RN
Room 3055

Dave Lighthall
6901 DR

Sofie Johnson
9584 RN
Room 3065

Bed 304S Nurse call
John Davis M 40

Staff in room

Send to:

On:

Type a message

Send

Select reason

Dismiss

History

Patient information

Patient ID: 123-45-567

First name: John

Middle name: William

Last name: Davis

Date of birth: 14 March 1975

Age: 40

Sex: Male

Previous location: Emergency Room

Temporary location:

Planned discharge: 28 June 2015

Ambulatory status: Vision Impaired

Physicians: Mary Smith

Diet: Vegetarian

Comments/notes: Wife Kate Davis, phone number 562-756-2233 (Tuesday, Wednesday only)

Bed 306S Emergency call
Lisa Harris F 55

Bed 300S HR low 39
Karen Williams F 57

Bed 307S VTACHY
Ben White M 62

Bed 305S Nurse call
James Taylor M 59

Bed 308S Nurse call
Linda Jones F 64

Bed 304S PVC low
John Davis M 40

Bed 300S Low BP 84/55
Karen Williams F 57

Bed 301S HR 162
Ben Harris M 65

UNITE VIEW
Organizations: Unit 3rd floor South


	Bed 306S	Emergency call	15:15:26 00:34	Sofie Johnson SJ	
	Bed 300S	HR low 39	15:05:59 10:01	» 2	
	Bed 307S	VTACHY	14:56:17 10:43	» 3	
	Bed 304S	Assistance call	14:50:25 25:32	» 4	
	Bed 305S	Nurse call	15:05:39 11:19	» 2	
	Bed 308S	Nurse call	15:03:02 12:58	» 2	
	Bed 304S	PVC low	14:56:04 19:55	» 3	
	Bed 300S	Low BP 84/55	15:07:31 12:29	» 2	
	Bed 301S	HR 162	14:56:05 19:55	» 3	


John Smith
JS 9561


Mary Keane
JS 9736


Dave Lighthall
DM 6801


Sofie Johnson
SJ 9864

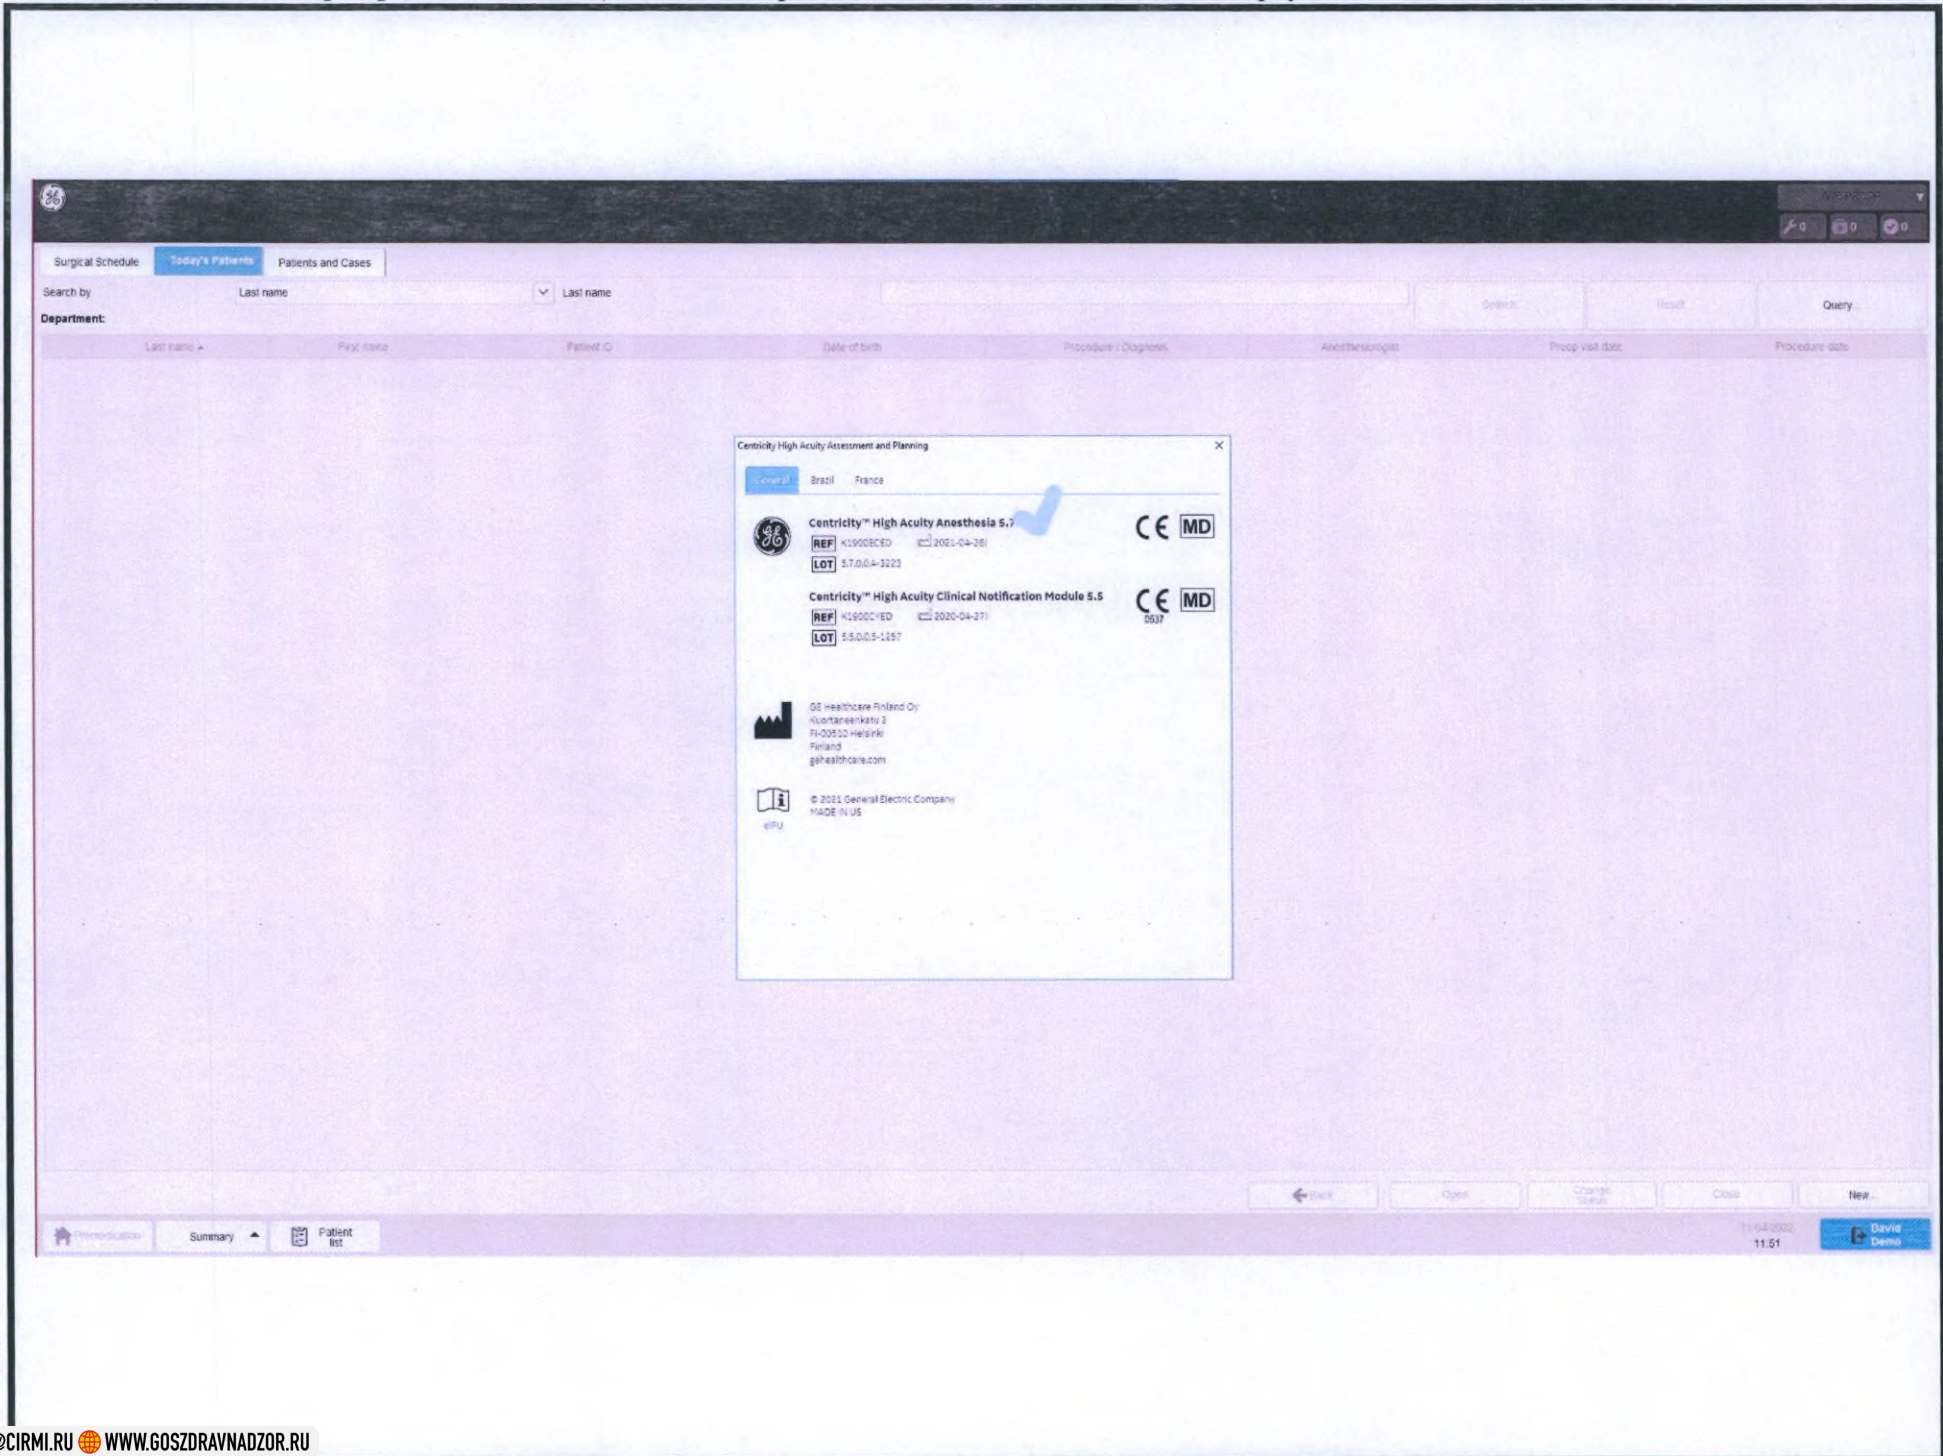

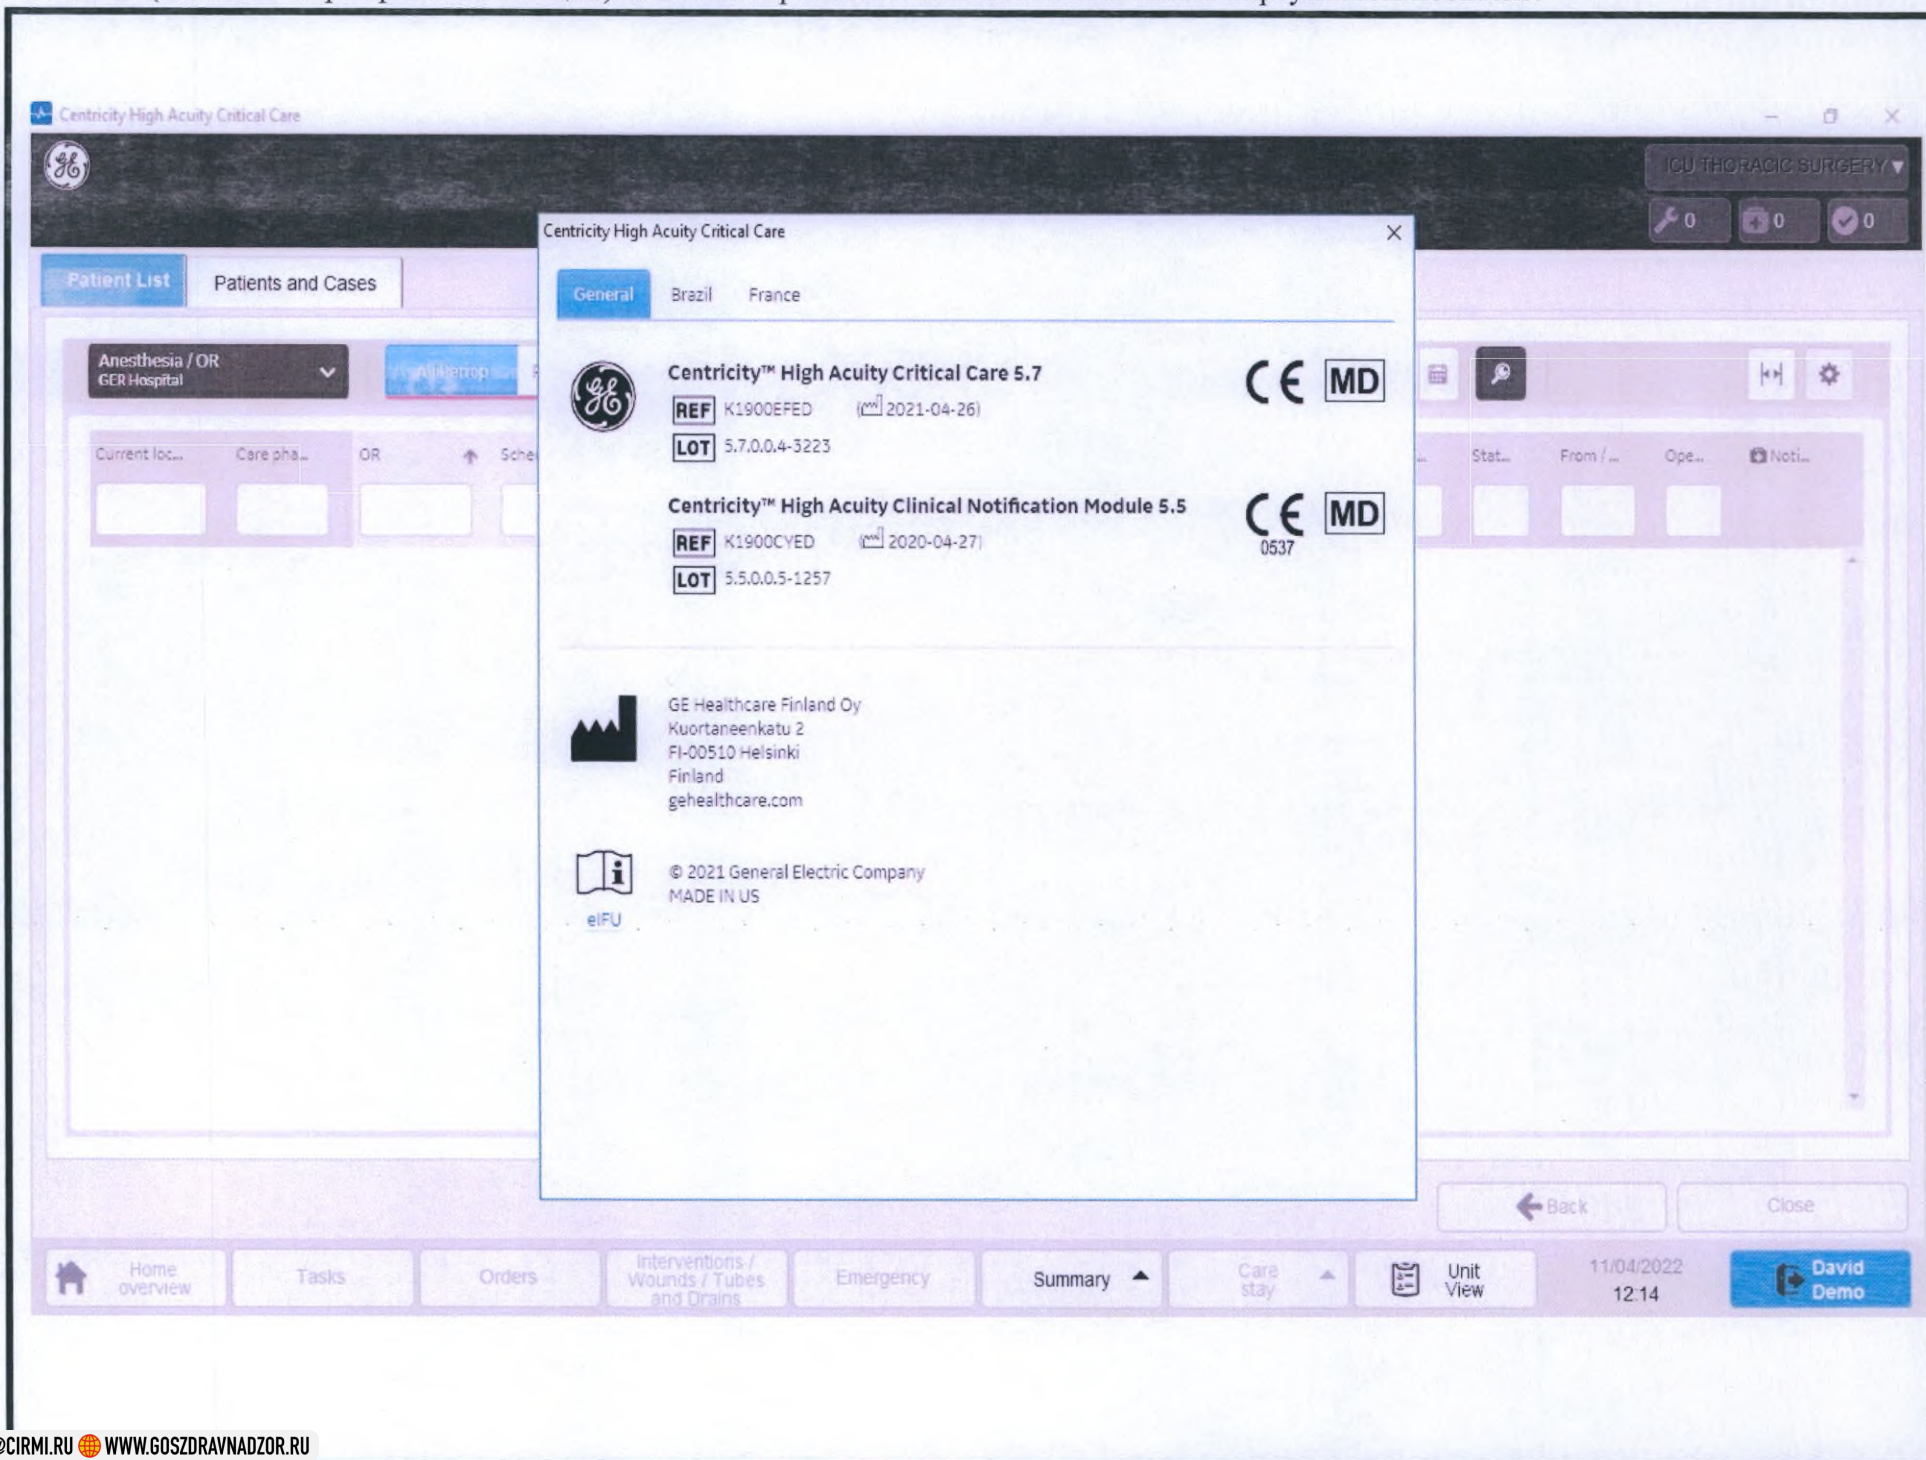

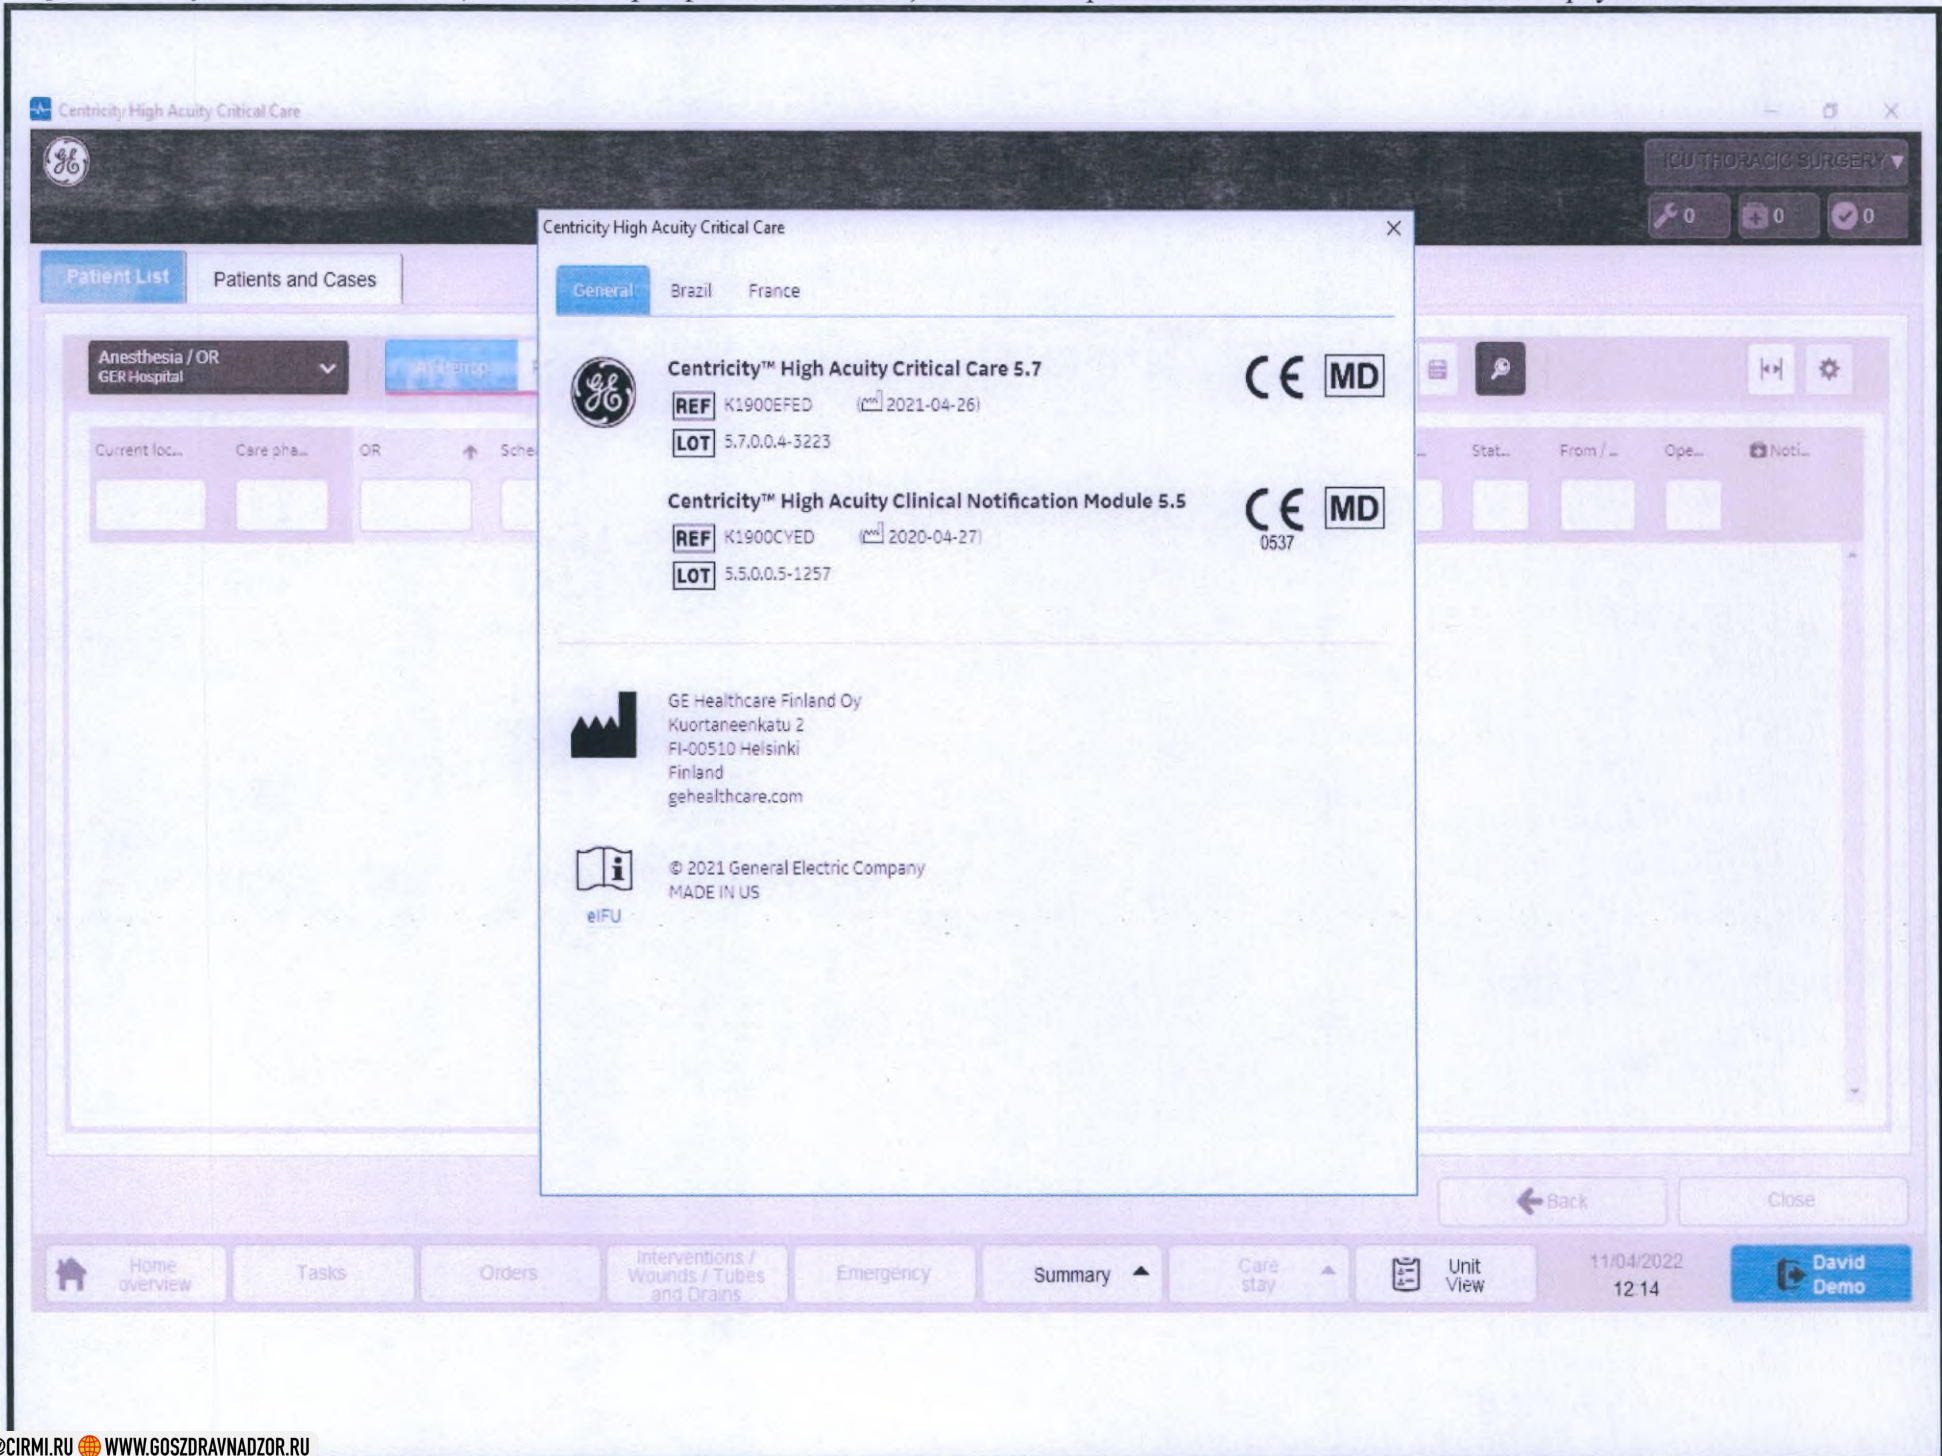

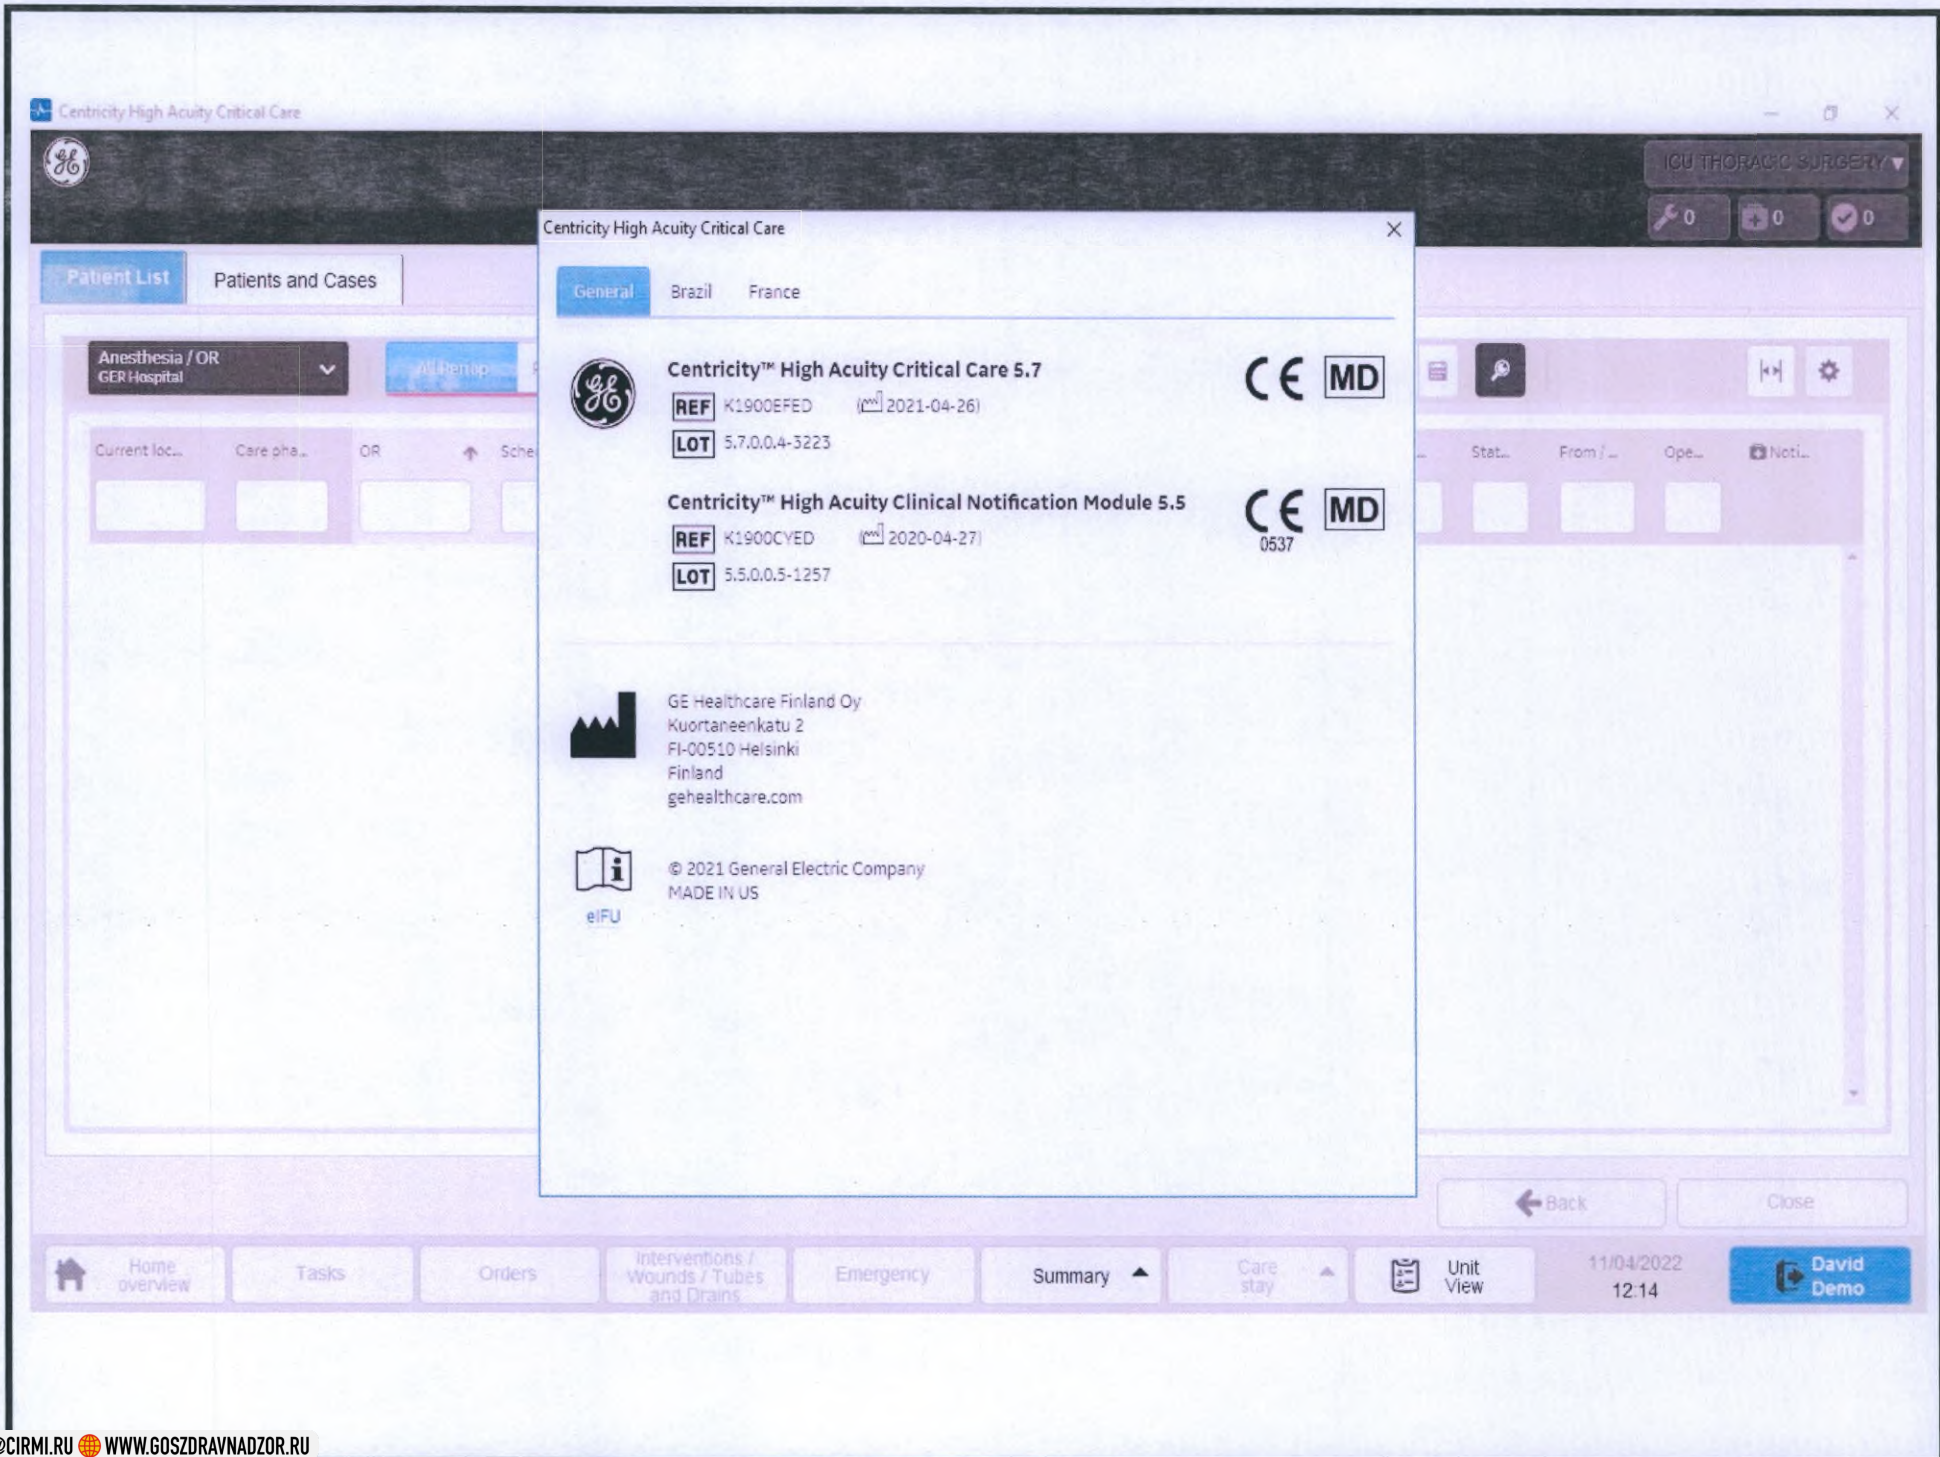

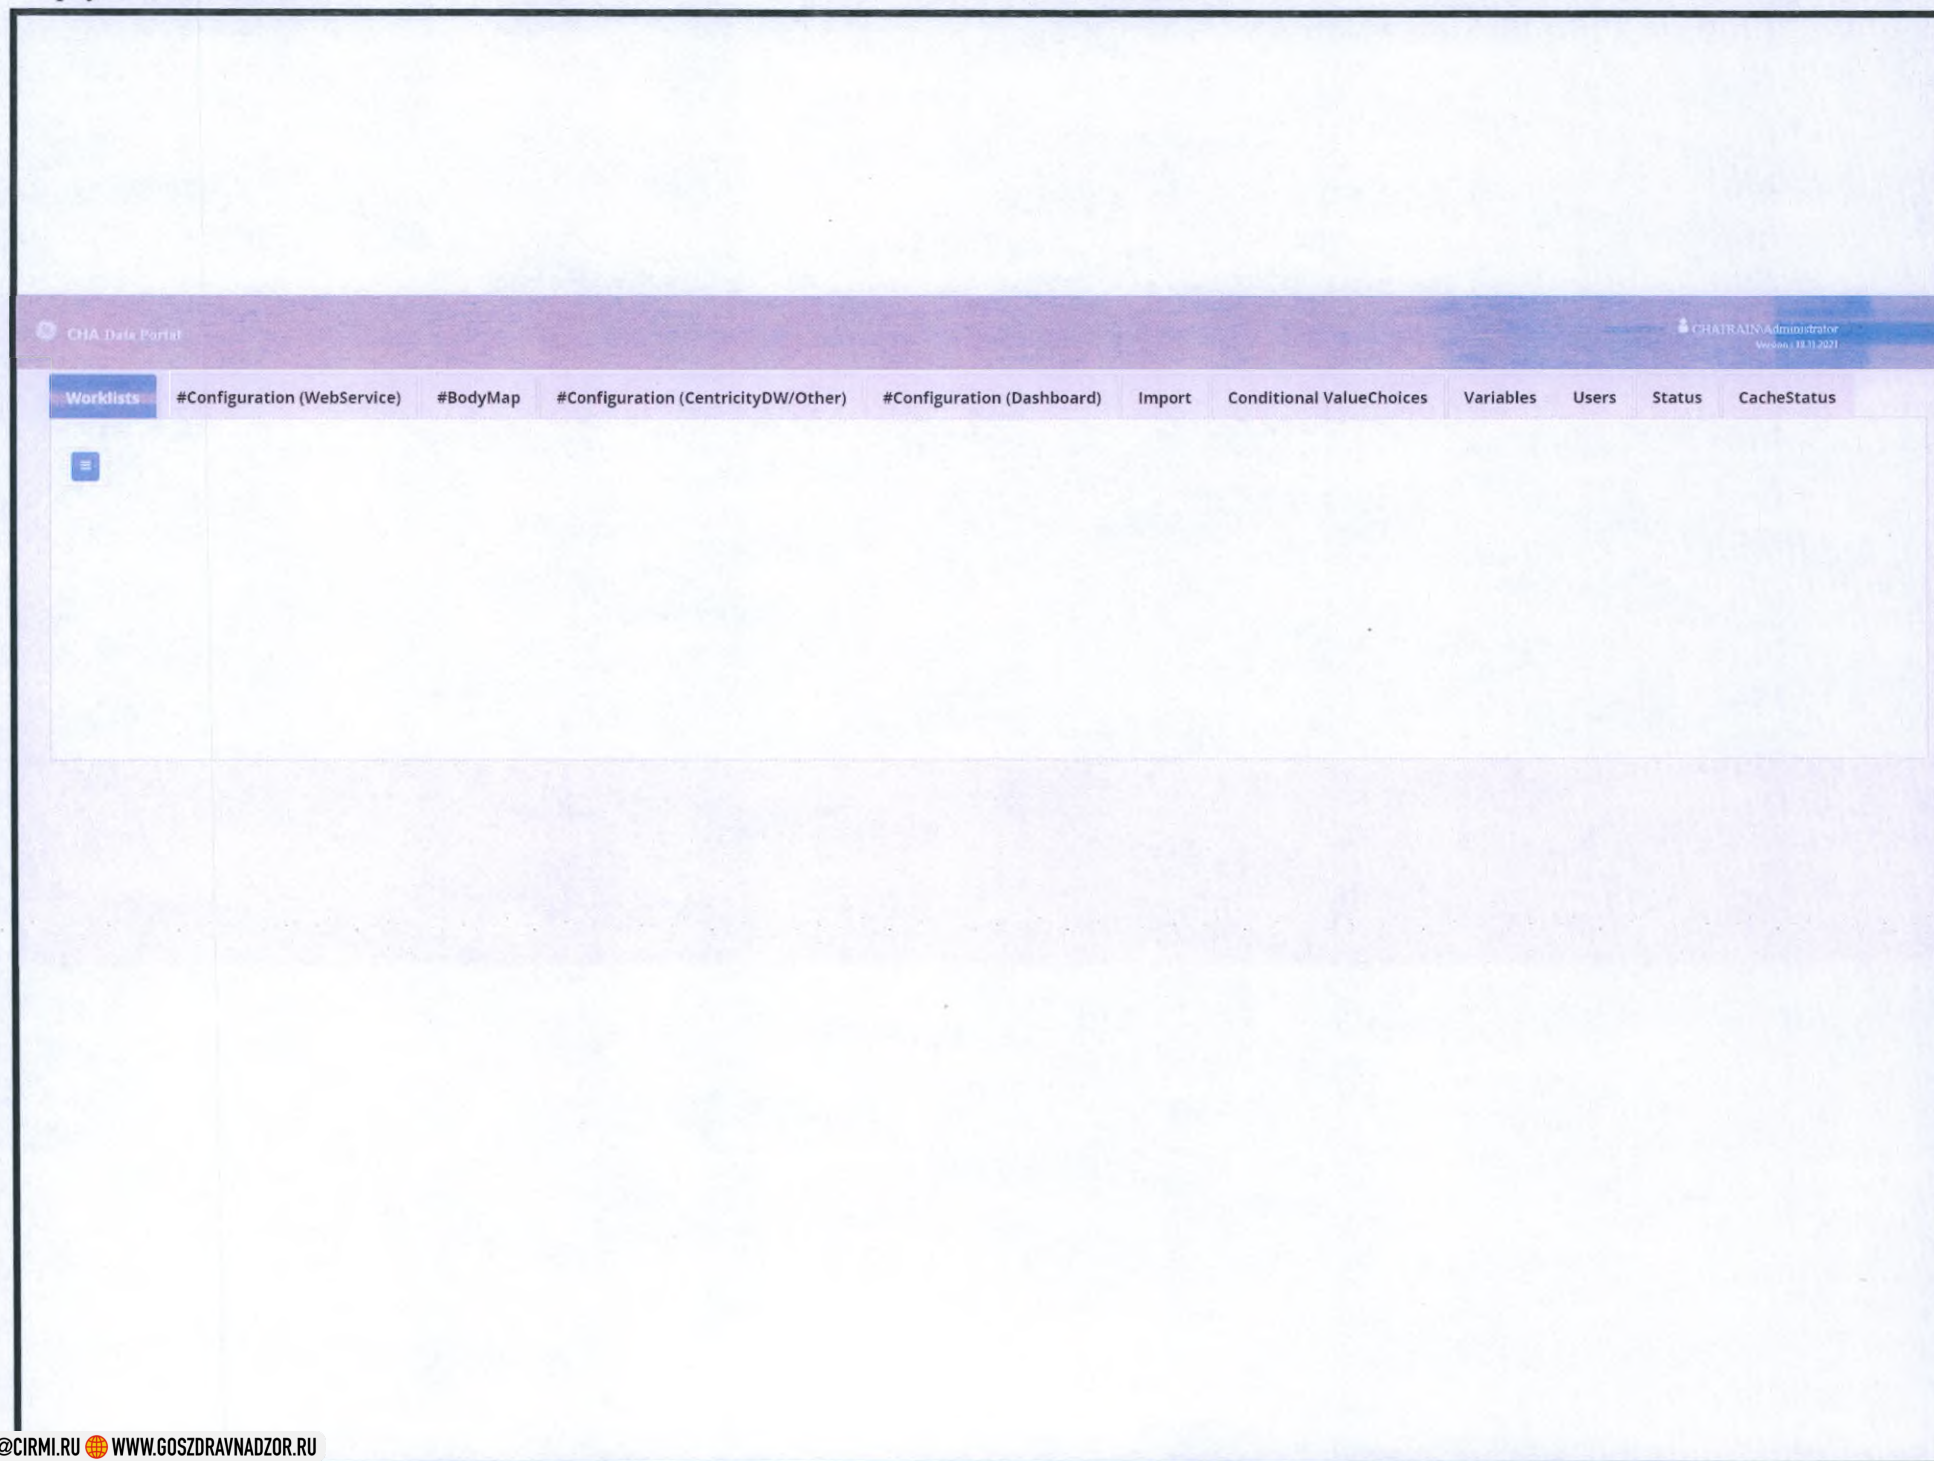

test test - Centricity High Acuity PostAnesthesia

GE

Pat Info

test, test

1

DOB

cm

kg

Aller...

Not assessed yet

ANE PACU

evide

No devices are connected

A

Risks

Not assessed yet

0

0

0

PostOP orders

Tasks

Select

Show All

Order selection

Search

Order sets

Search

Standard orders for current patient group shown

Show standard orders for all patient groups

Standard orders for ANE PACU

Medical orders

Patient fixation order / evaluation

Nursing tasks

Positioning & mobilisation

Interventions

Evaluation regional catheter

Post-op orders for PACU

BG control

BGA PACU

CVC - Position control PACU

Drink when awake

Back

PostOP

PACU admission time

Now

Staff

PostOP orders

PACU discharge

PACU discharge time

Now

End case

PACU

Medication


Emergency

Summary

Patient list

11/04/2022 12:31

David Demo

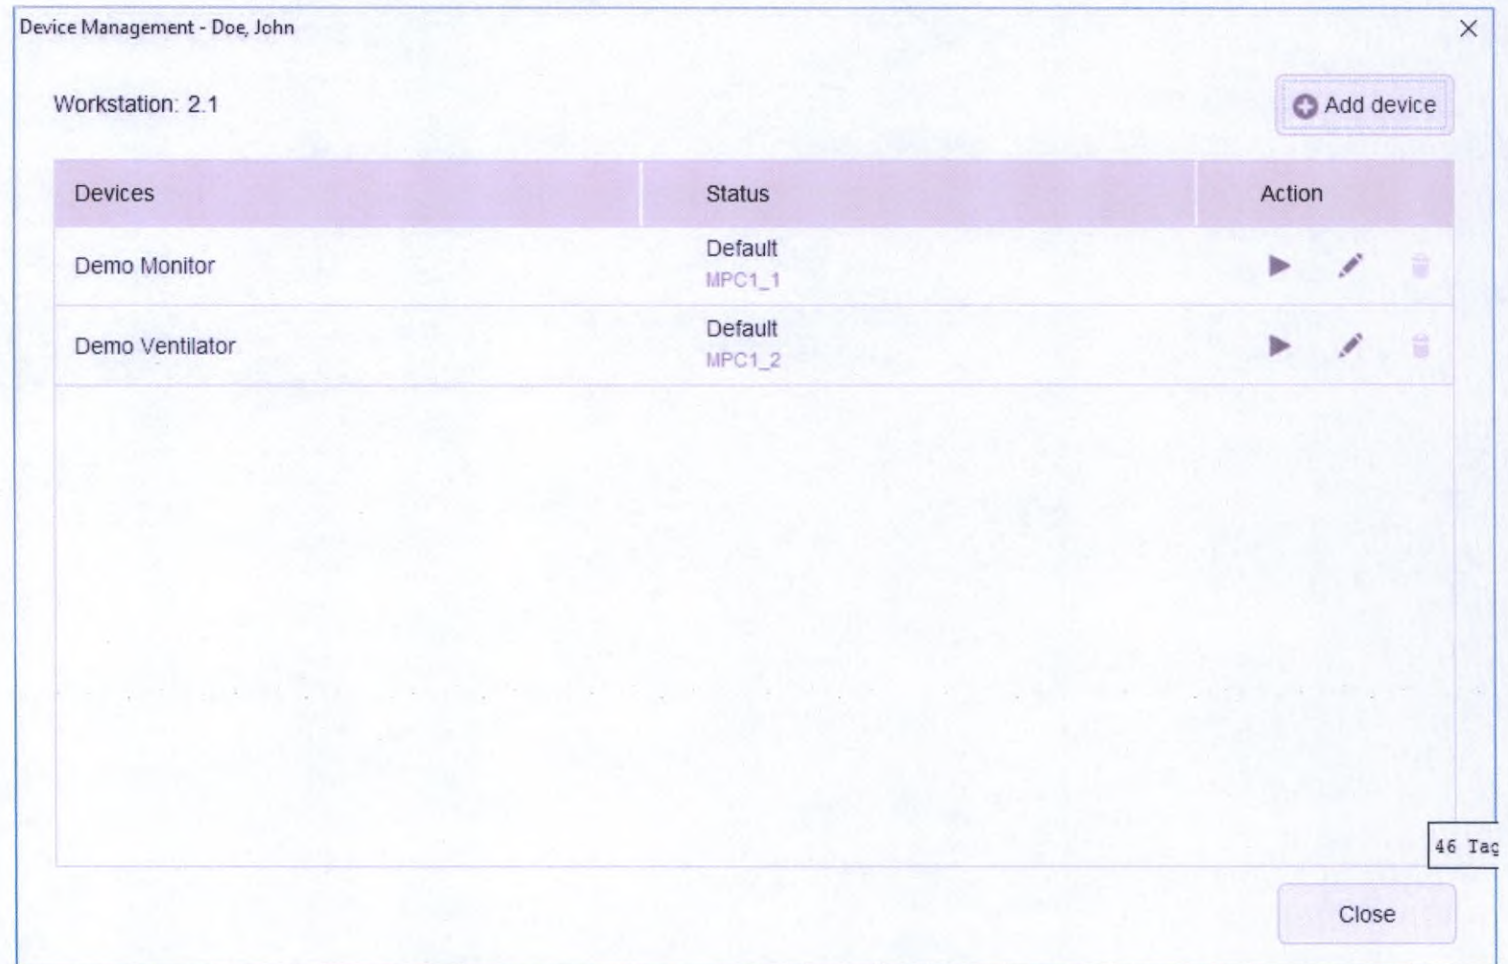

Monitoring

Engine Monitor

Communication Points

Routes

Web Services

REST Clients

System Monitor

Error Queue

Hold Queue

Ports in Use

Find Messages

Input Search

Output Search

Route Search

Message Collector Search

Saved Searches

Recent Results

Notifications

My Notifications

Watchlists

Suspend / Resume All

Delivery Methods

Public Holidays

Default Settings

Management

Change Password

Reset Counters

Lookup Tables

Archive Cleanup

Backup and Restore

Product Usage

Communication Points (27)

Stopped (6)

Running (21)

Scheduled (1)

Non-Scheduled (26)

Search by name or type

	COMMUNICATION POINT	TYPE	STATUS	ACTION	CONNECTION IN QUEUE	OUT QUEUE	FAILED QUEUE	RECEIVED	SENT	FAILED	IDLE TIME
	CHA (27)										
	CHA-CO-SI (11)										
	CO-CP - Read data from Opera-DB t...	Database	Stopped	Start	-	0	0	0	0	0	0 -
	CO-CP - Resend to WS ManageRiskP...	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - Resend to WS UpdateOpera...	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - Resend to WS UpdateRequest	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - Trash	Sink	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - WebServiceClient ManageRI...	Web Ser...	Stopped	Start	-	0	0	0	0	0	0 -
	CO-CP - WebServiceClient UpdateOp...	Web Ser...	Stopped	Start	-	0	0	0	0	0	0 -
	CO-CP - WebServiceClient UpdateRe...	Web Ser...	Stopped	Start	-	0	0	0	0	0	0 -
	CO-CP - Write CHA inbound Patient ...	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - Write CHA outbound Patien...	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CO-CP - Write coXML to file	Directory	Running	Stop	1	0	0	0	0	0	0 4 hours
	CHA-DI (5)										
	CA-CP - Device trash	Sink	Running	Stop	1	0	0	0	0	71,763	0 5 secs
	CA-CP - iXML to DeviceLink1	TCP Client	Stopped	Start	-	0	7	0	0	0	0 -
	CA-CP - iXML to DeviceLink2	TCP Client	Running	Stop	1	0	0	0	18,744	163	0 35 mins
	CA-CP - Receive device commands fr...	HTTP Cli...	Running	Stop	0	0	0	0	53,179	0	0 5 secs

Start

Stop

None selected.

Reset Counters

Change Notification Thresholds

Add Notifications

Suspend Notifications

Resume Notifications

Change Log Level

License Information

Maximum Communication Points: 300
Licensed Communication Points Used: 74
Next Expiry Date : Never

Environment: Production

Installed Licenses

Install

Remove

Connection Properties

Current connection properties:


Authentication	
Authentication Method	Windows Authentication
User Name	CHATRAIN\Administrator
Connection	
Database	master
SPID	55
Network Protocol	<default>
Network Packet Size	4096
Connection Timeout	30
Execution Timeout	0
Encrypted	No
Product	
Product Name	Microsoft SQL Server Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit)
Product Version	13.0.5865 SP2
Server Name	CHATRAIN\CHA57RO
Instance Name	CHA57RO
Language	English (United States)
Collation	SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Server Environment	
Server Environment	

Close Help

94. Терминальный сервер для подключения до 16 периферических устройств (не более 200 шт.).




94. Терминальный сервер для подключения до 16 периферических устройств (не более 200 шт.).

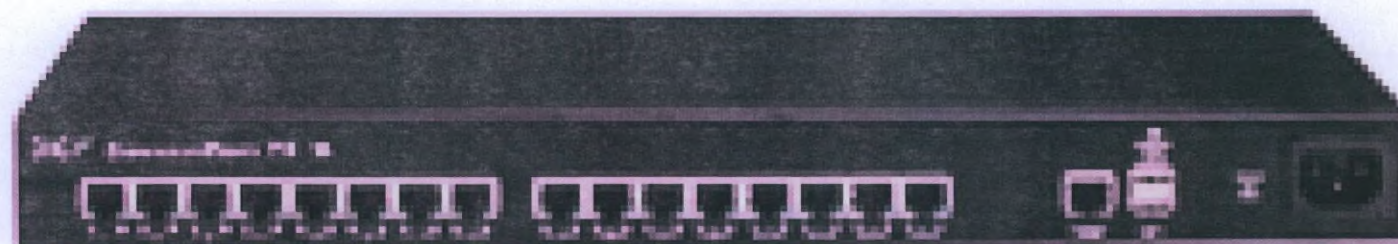

95. Терминальный сервер для подключения до 8 периферических устройств (не более 200 шт.).



95. Терминальный сервер для подключения до 8 периферических устройств (не более 200 шт.).

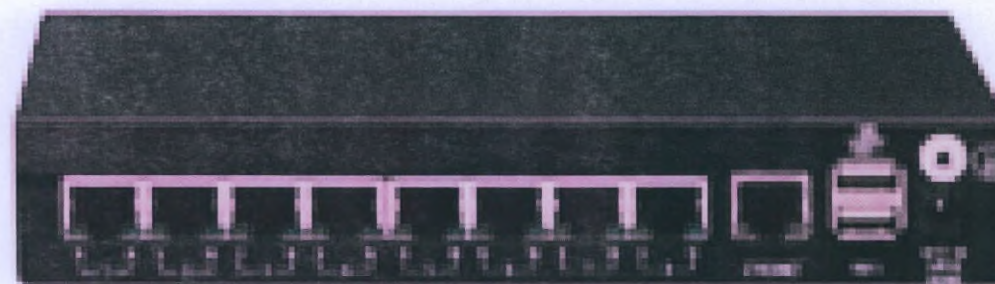

96. Терминальный сервер для подключения до 4 периферических устройств (не более 200 шт.).



96. Терминальный сервер для подключения до 4 периферических устройств (не более 200 шт.).



97. Адаптер для подключения периферических устройств (не более 500 шт.).



97. Адаптер для подключения периферических устройств (не более 500 шт.).




97. Адаптер для подключения периферических устройств (не более 500 шт.).



97. Адаптер для подключения периферических устройств (не более 500 шт.).



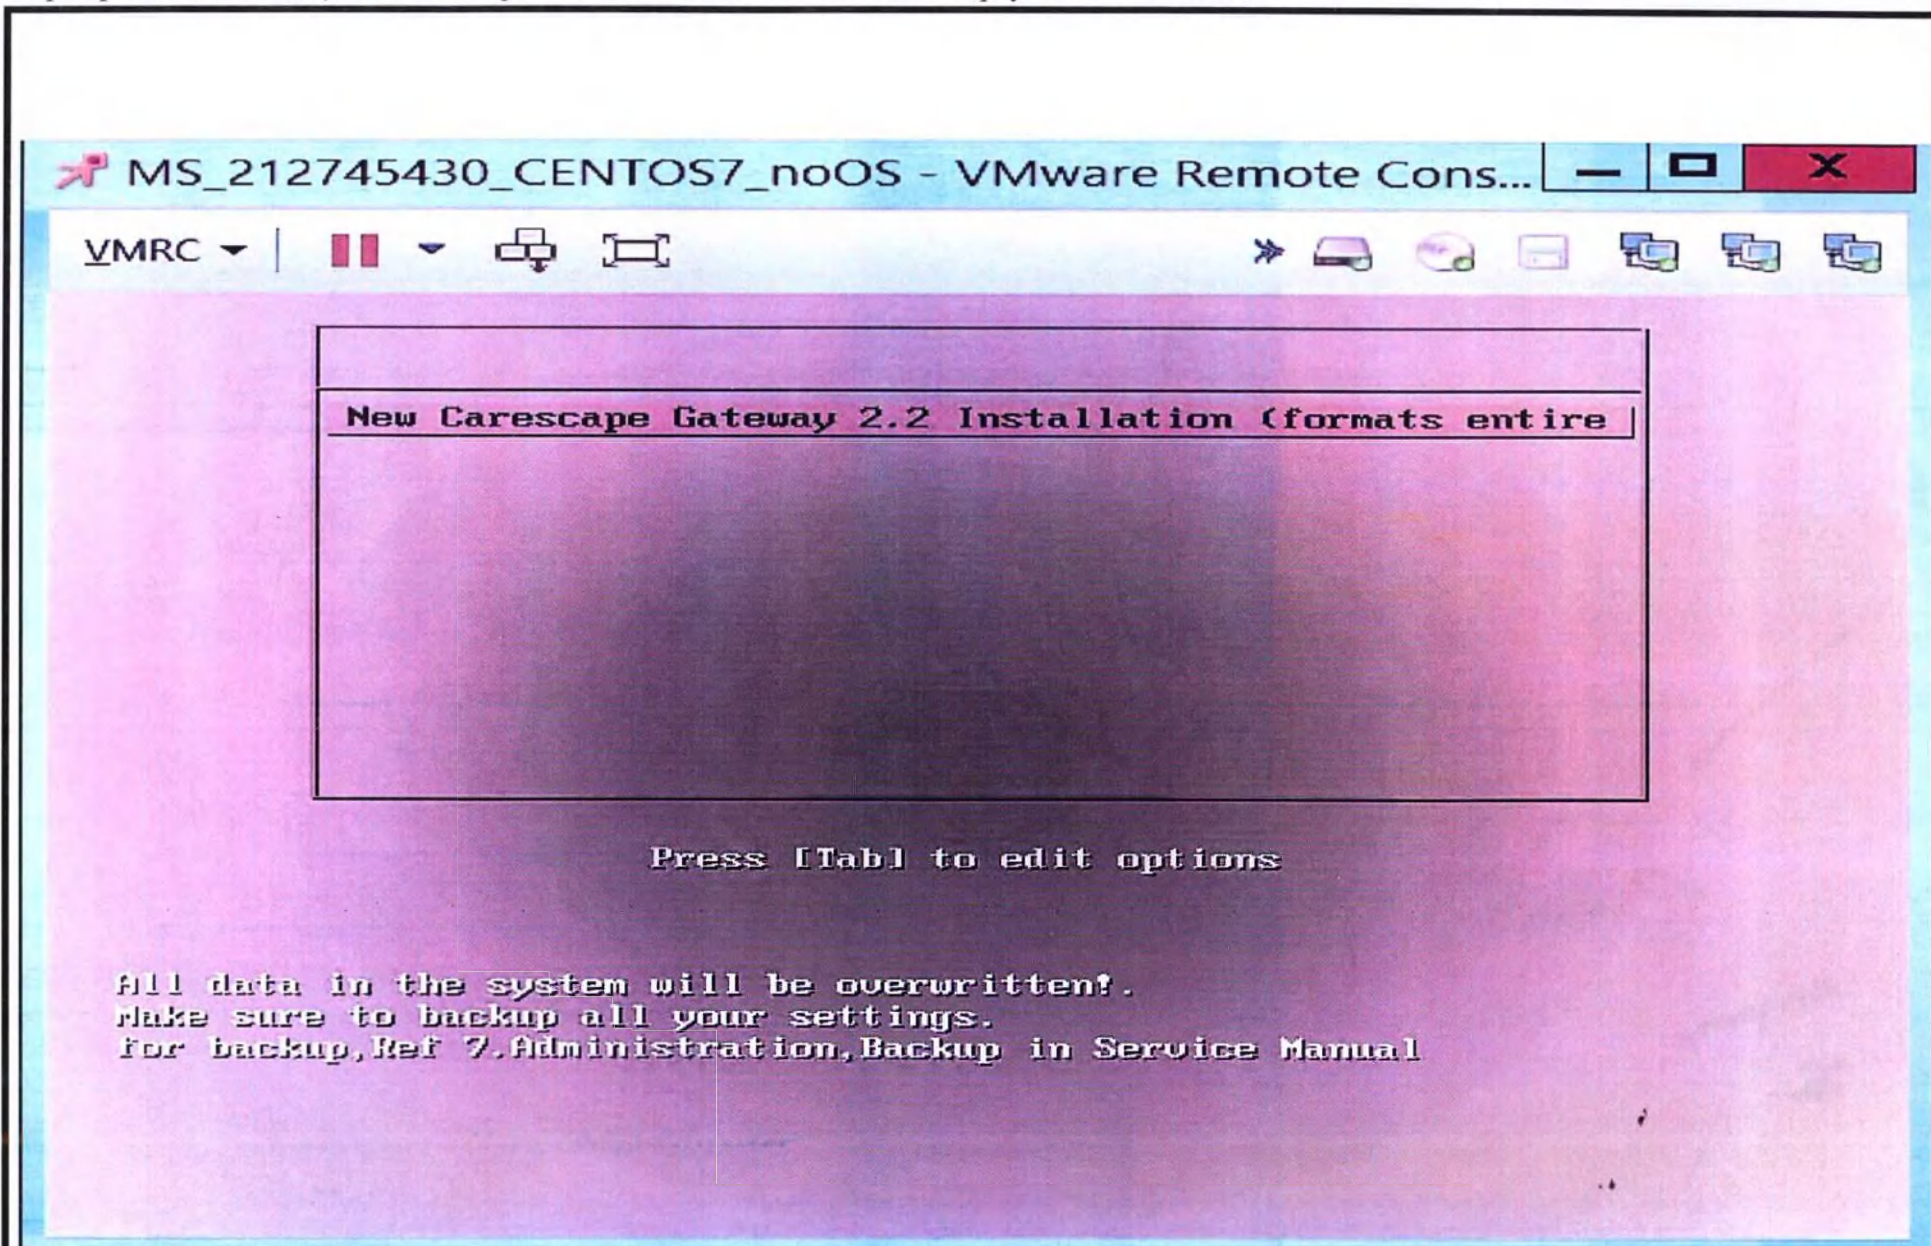



Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 151

Александров листах