




УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор
медицинских изделий

 А.А. Чупов



«19» июля 2022

Фотографические изображения медицинского изделия

Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03
по ТУ 9444-138-07539541-2015

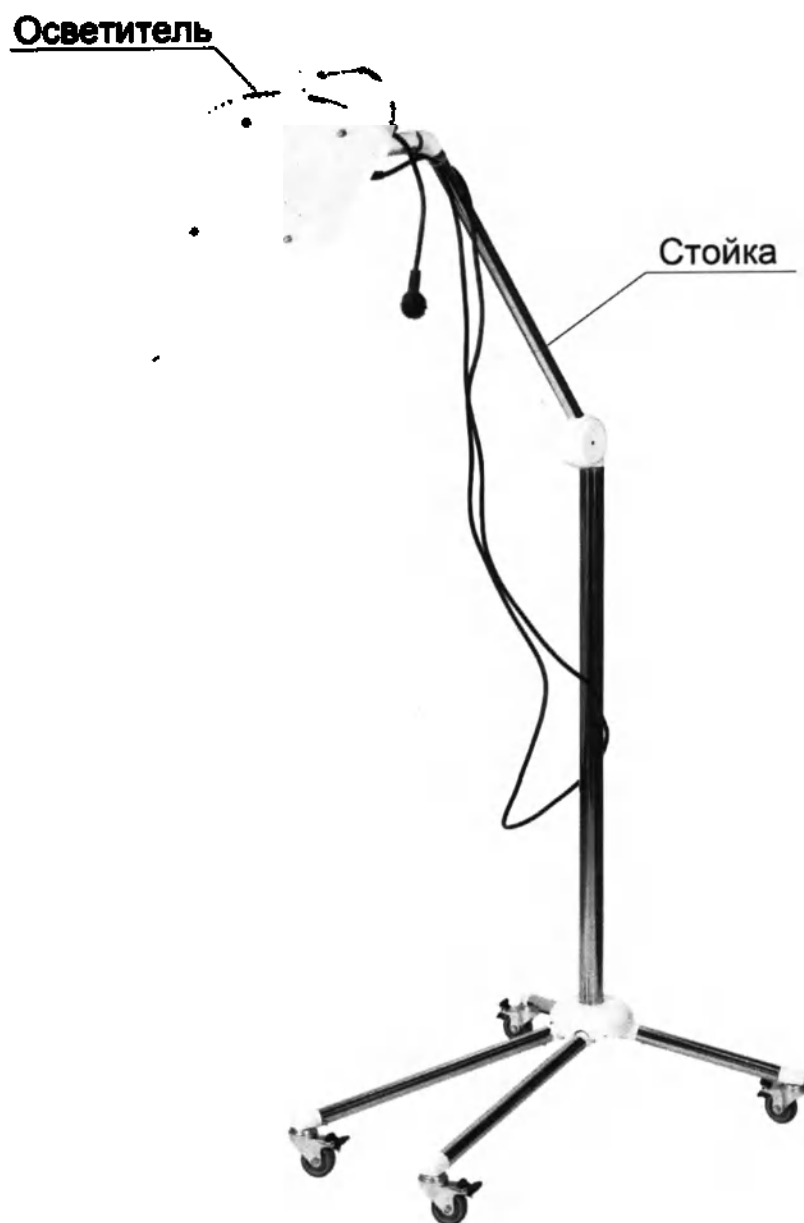


Рисунок 1 – Облучатель со стойкой 3111.00000000. Вид сбоку



Рисунок 2 – Облучатель со стойкой 3111.00000000. Вид спереди



Рисунок 3 – Облучатель со стойкой 3111.00000000 (расположение осветителя в крайнем нижнем положении). Вид спереди



Рисунок 4 – Осветитель облучателя без стойки 3111.000000000-01. Вид сверху

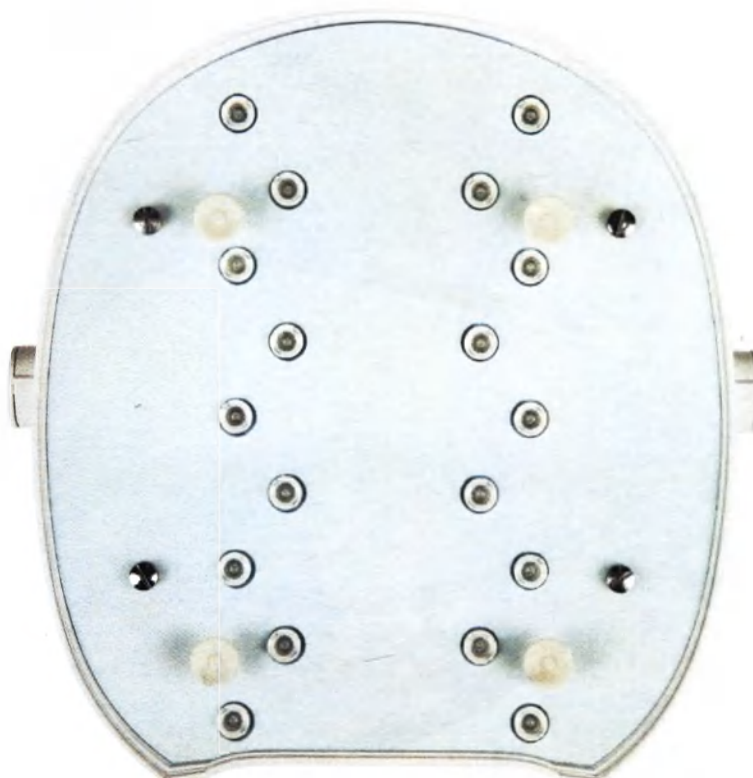


Рисунок 5 – Осветитель облучателя без стойки 3111.000000000-01. Вид снизу



Рисунок 6 – Защита для глаз при фототерапии, «Ковидиен Ллс» (США),
РУ от 29.12.2018 № ФСЗ 2012/11846. Общий вид



Рисунок 7 – Кабель питания 3111.00001000. Общий вид



Рисунок 8 – Ключ 2,5 - 1 - Х9 ГОСТ Р 57981-2017
и ключ 6 - 1 - Х9 ГОСТ Р 57981-2017. Общий вид



Рисунок 9 – Предохранитель 0215002.Р, Littelfuse (5x20; 2 А, Time-Lag, 1500
А @ 250 VAC). Общий вид

Всего 7 (семь) лист(ов).
Главный конструктор КБ медицинских изделий
А.А. Чупов





Фотографические изображения медицинского изделия

**Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03
по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями**



Рисунок 1 – Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03
3111.00000000 по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями.
Вид сбоку



Рисунок 2 – Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03
3111.00000000 по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями.
Вид спереди



Рисунок 3 – Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03
3111.00000000 по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями
(расположение осветителя в крайнем нижнем положении).
Вид спереди



Рисунок 4 – Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03 3111.00000000-01 по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями.
Вид сверху

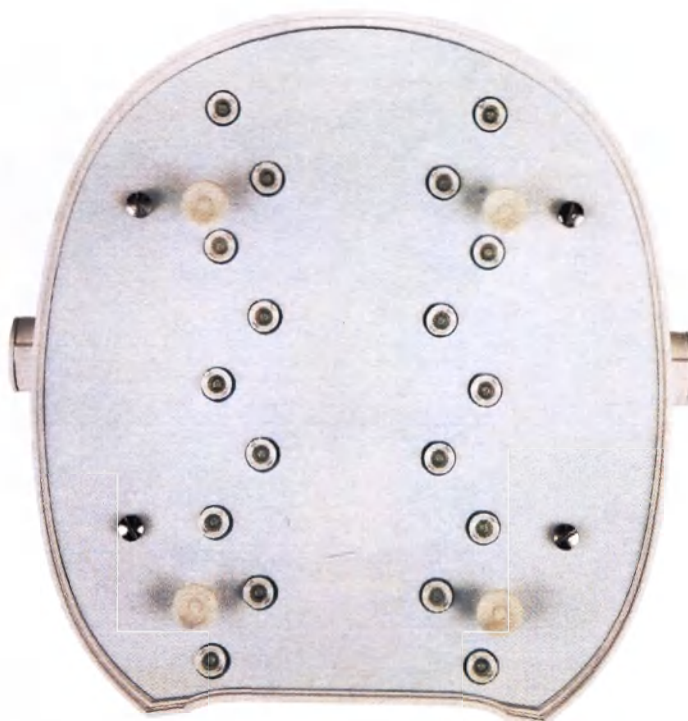


Рисунок 5 – Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-03 3111.00000000-01 по ТУ 9444-138-07539541-2015, с принадлежностями.
Вид снизу



Рисунок 6 – Защита для глаз при фототерапии, «Ковидиен Ллс» (США),
 РУ от 29.12.2018 № ФСЗ 2012/11846. Общий вид



Рисунок 7 – Кабель питания 3111.00001000. Общий вид



Рисунок 8 – Ключ 2,5 - 1 - Х9 ГОСТ Р 57981-2017
и ключ 6 - 1 - Х9 ГОСТ Р 57981-2017. Общий вид



Рисунок 9 – Вставка плавкая ВП2Б-1В-2А-250В, АГ0.481.304ТУ. Общий вид

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Всего 7 (семь) листа (ов).

Главный конструктор медицинских изделий

А.А. Чупов

