

Общество с ограниченной ответственностью "ОПОРА"
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. №1



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "ОПОРА"

Р. С. Жуков

«18» июля 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пульсоксиметр «Armed»

Пульсоксиметр «Armed», варианты исполнения:

1. Пульсоксиметр «Armed» A300, в составе:

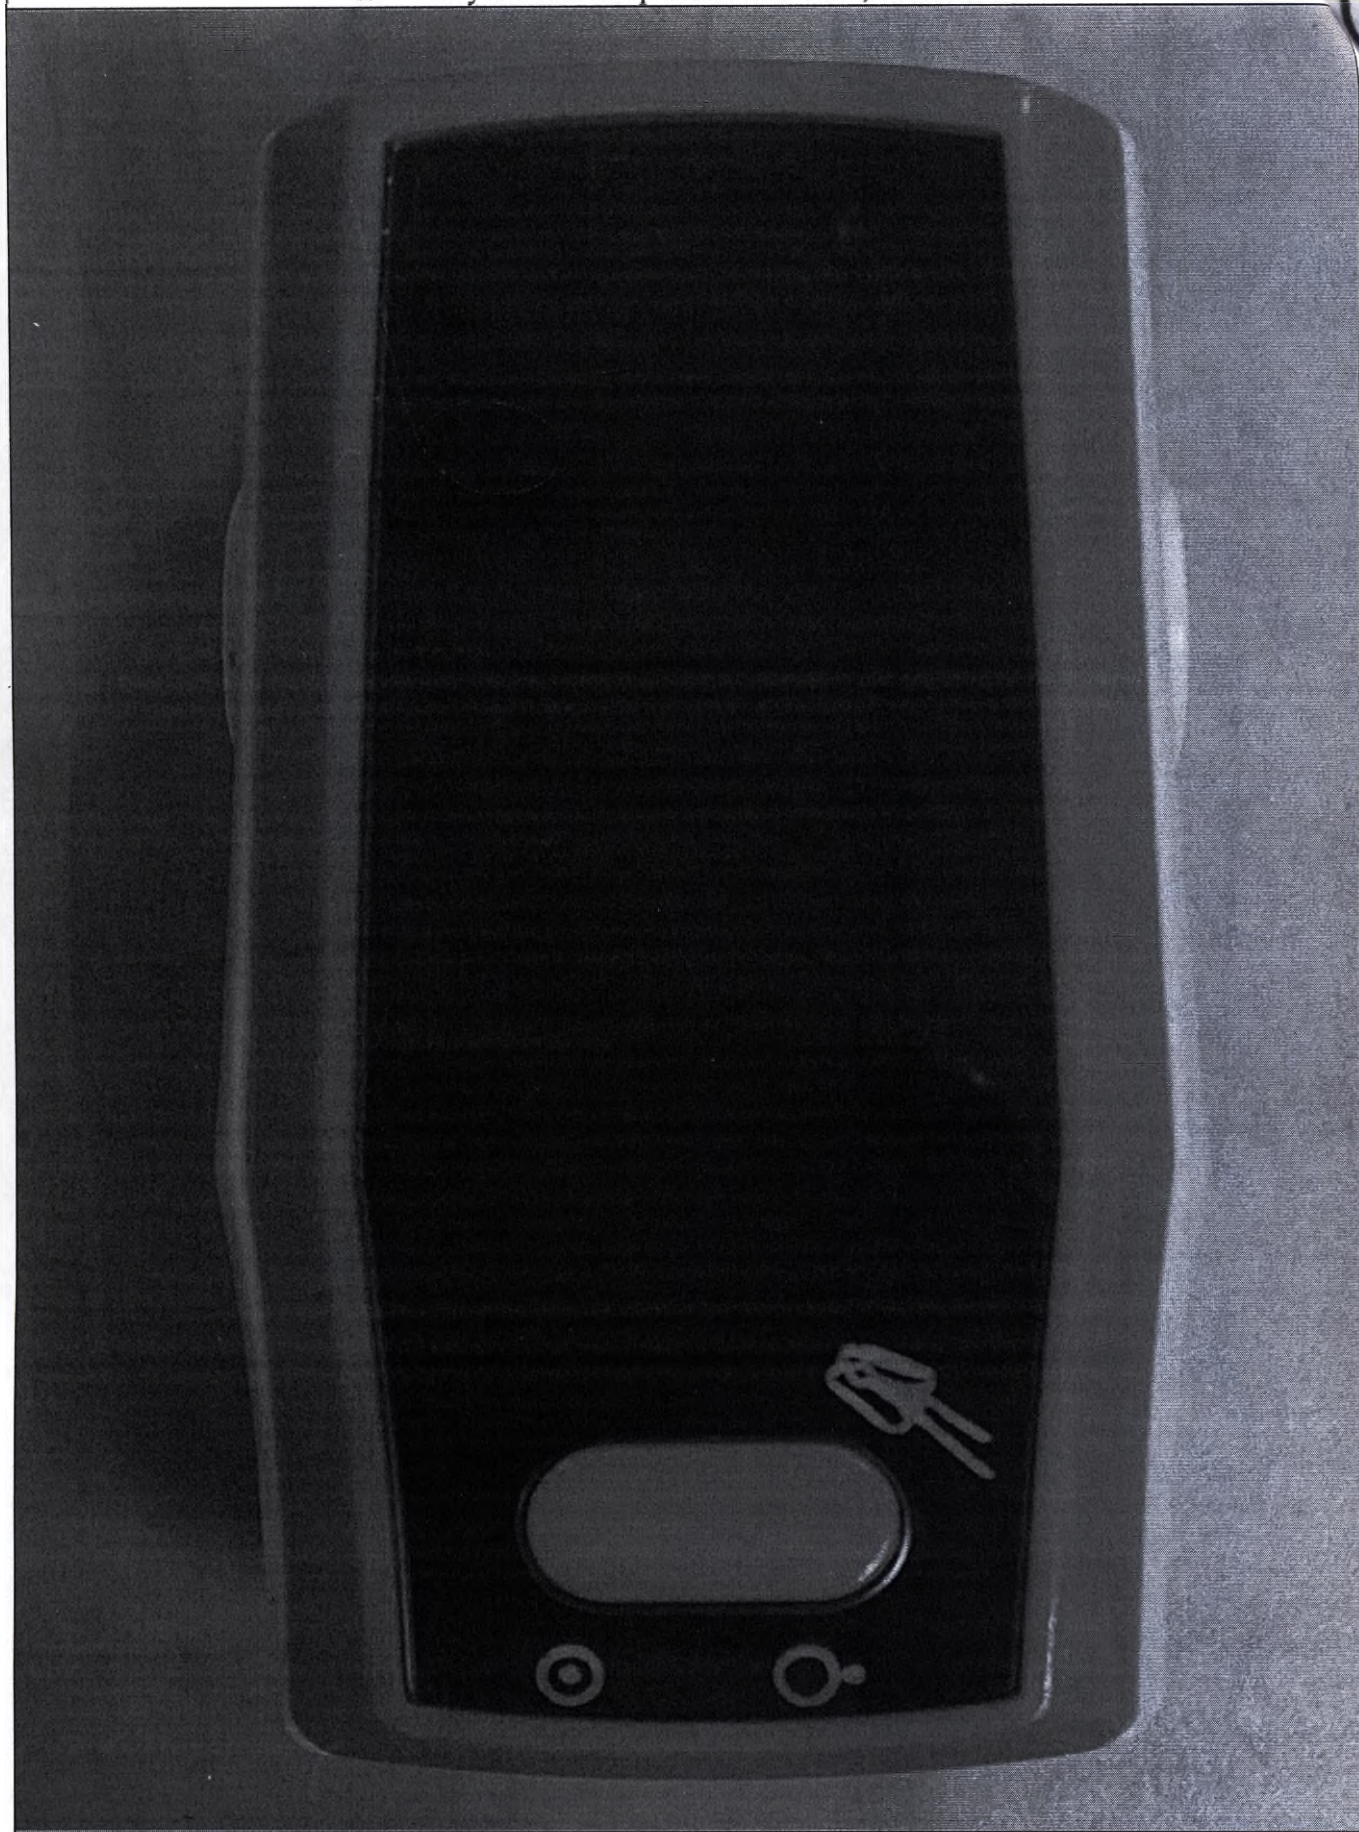


Фото 1. Пульсоксиметр «Armed» A300 – общий вид изделия.

Пульсоксиметр "Armed" A300

РУ № _____

ОТ _____

Произведено: Shenzhen Aeon
Technology Co., Ltd., Китай

2,6 - 3,6 В / не более 45 мА

Дата выпуска:



SpO₂

IP22

SN



Фото 1.2. Пульсоксиметр «Armed» A300 – макет маркировки изделия.

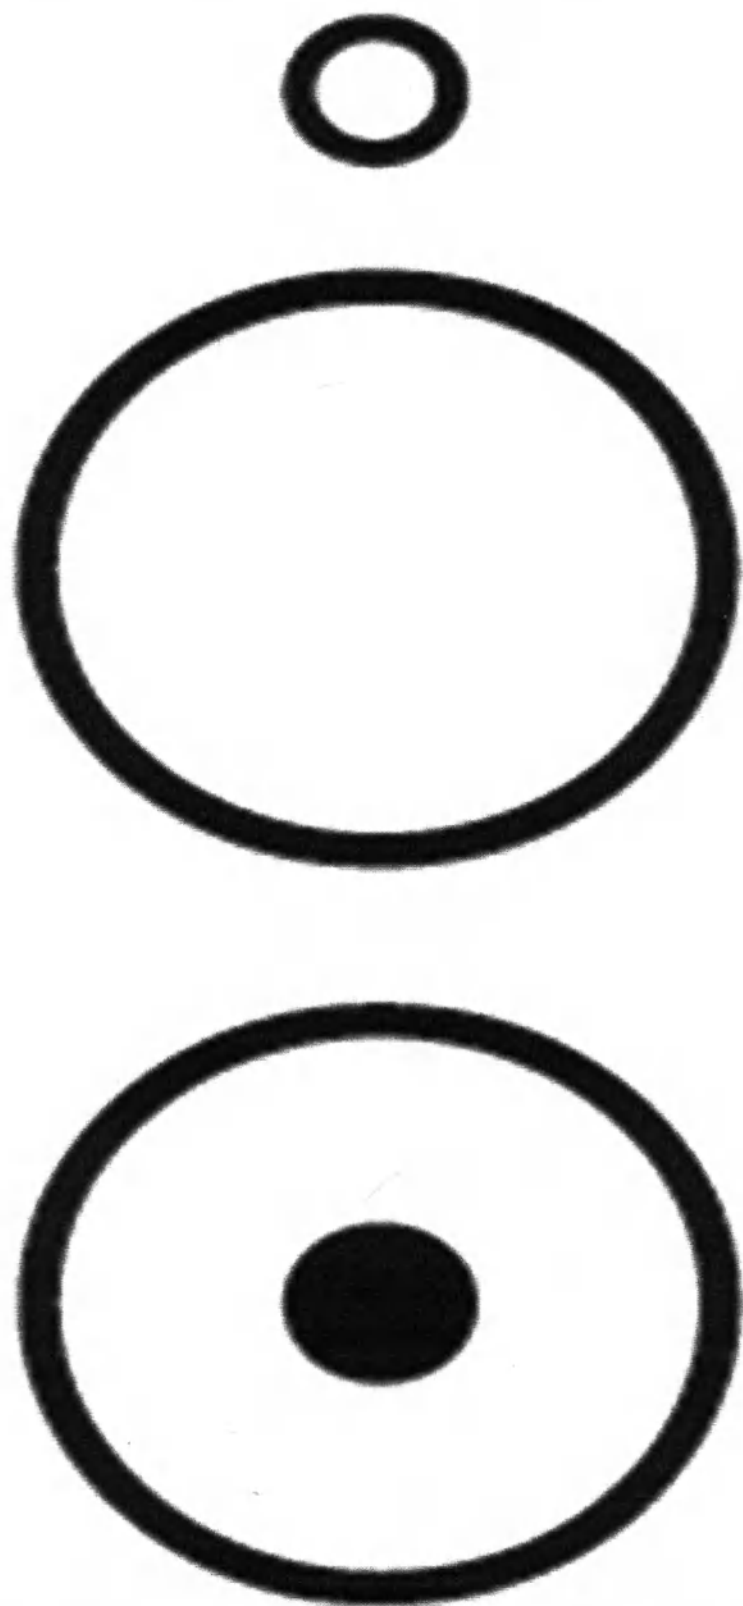


Фото 1.3. Пульсоксиметр «Armed» А300 – макет маркировки «Кнопка включения» на изделии.



Фото 1.4. Пульсоксиметр «Armed» А300 – маркировка «Правильное расположение пальца относительно датчика» на изделии.

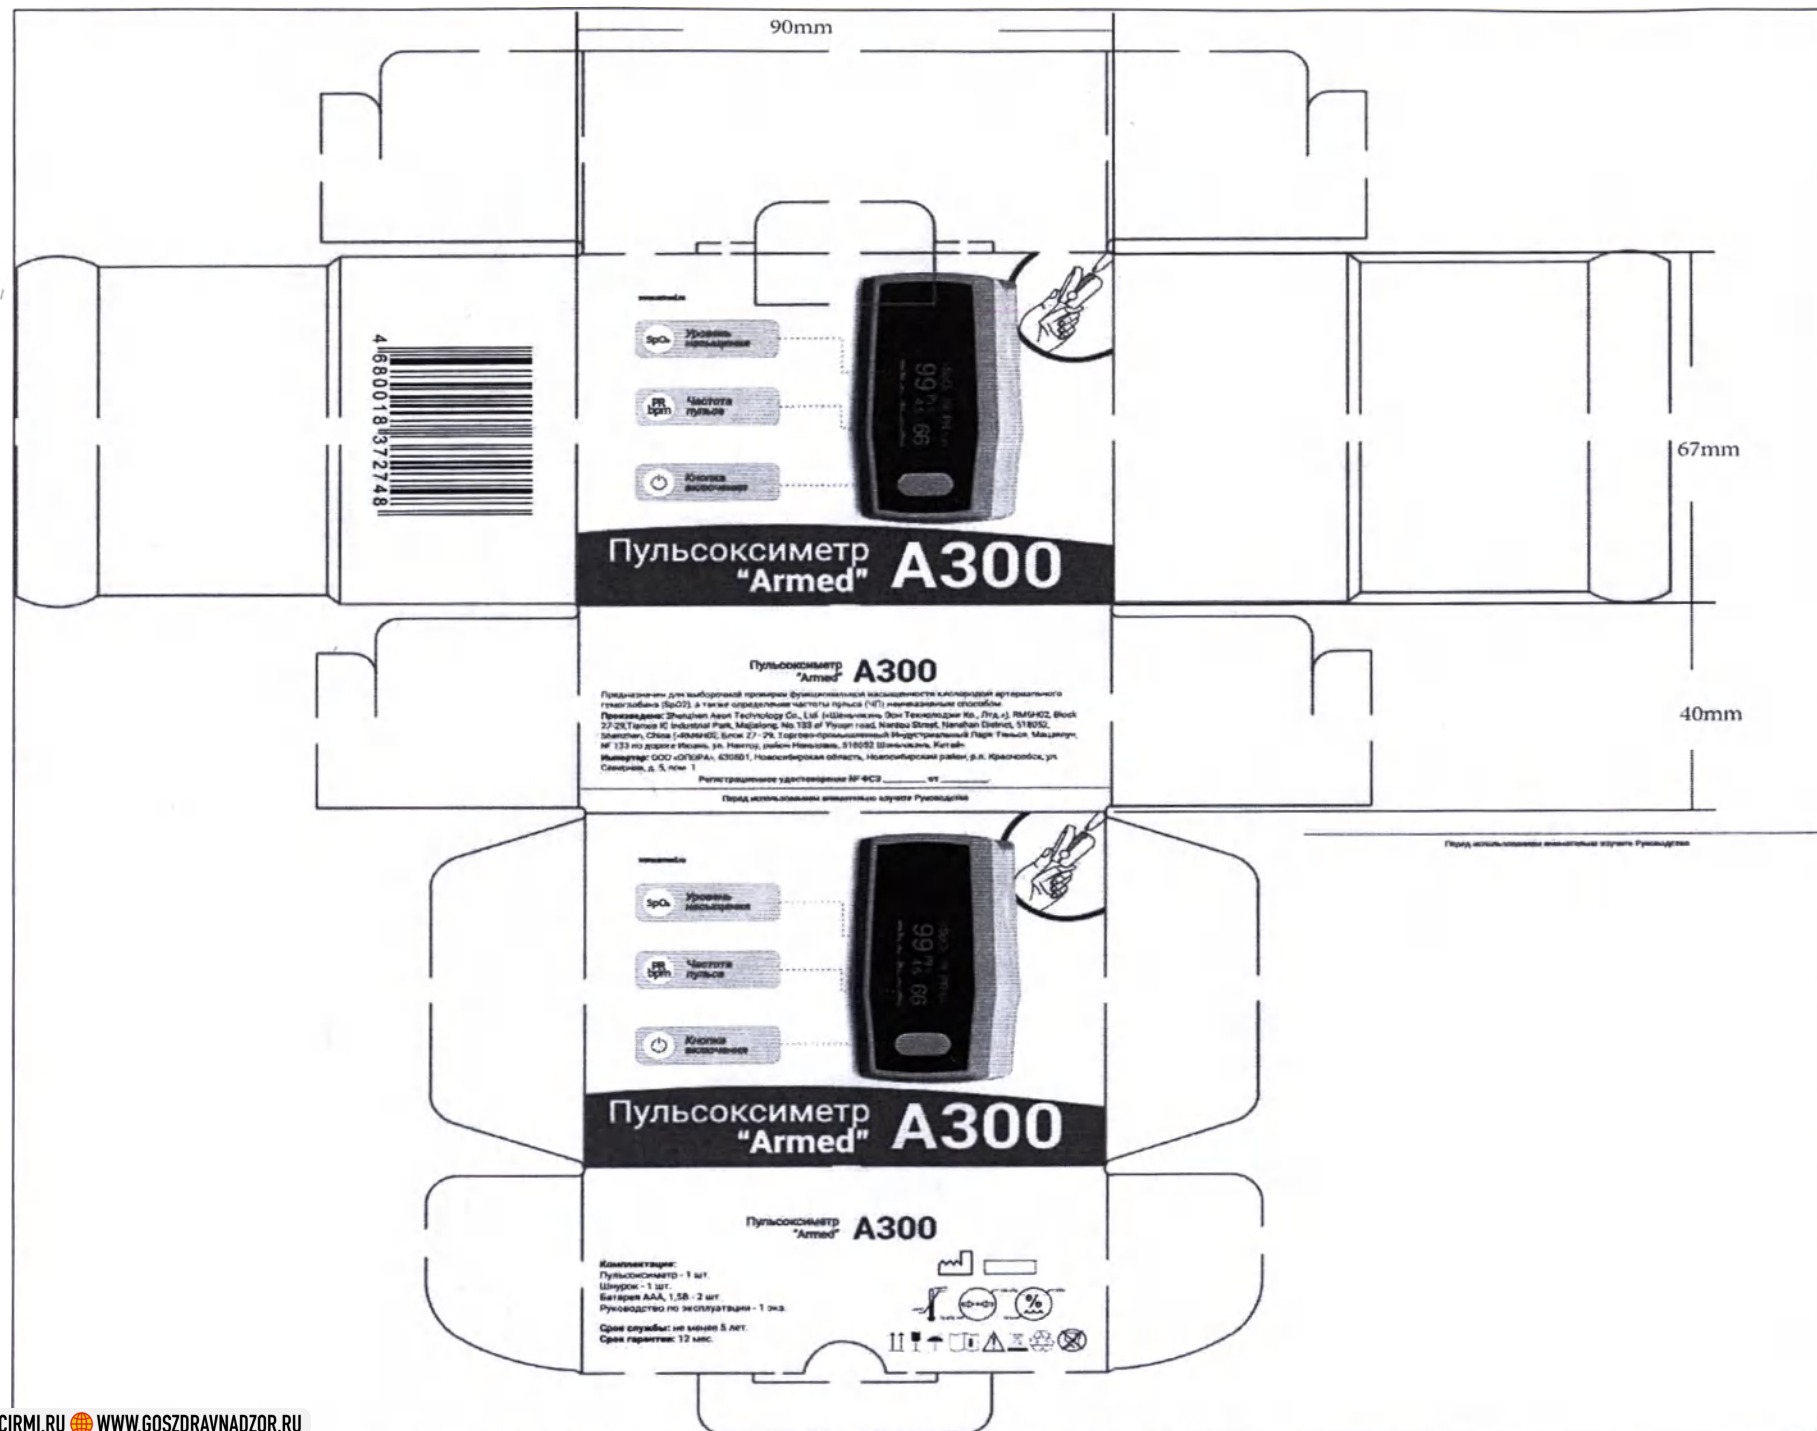


Фото 1.5. Пульсоксиметр «Armed» A300 – макет потребительской упаковки.



Фото 2. Шнурок – общий вид изделия.

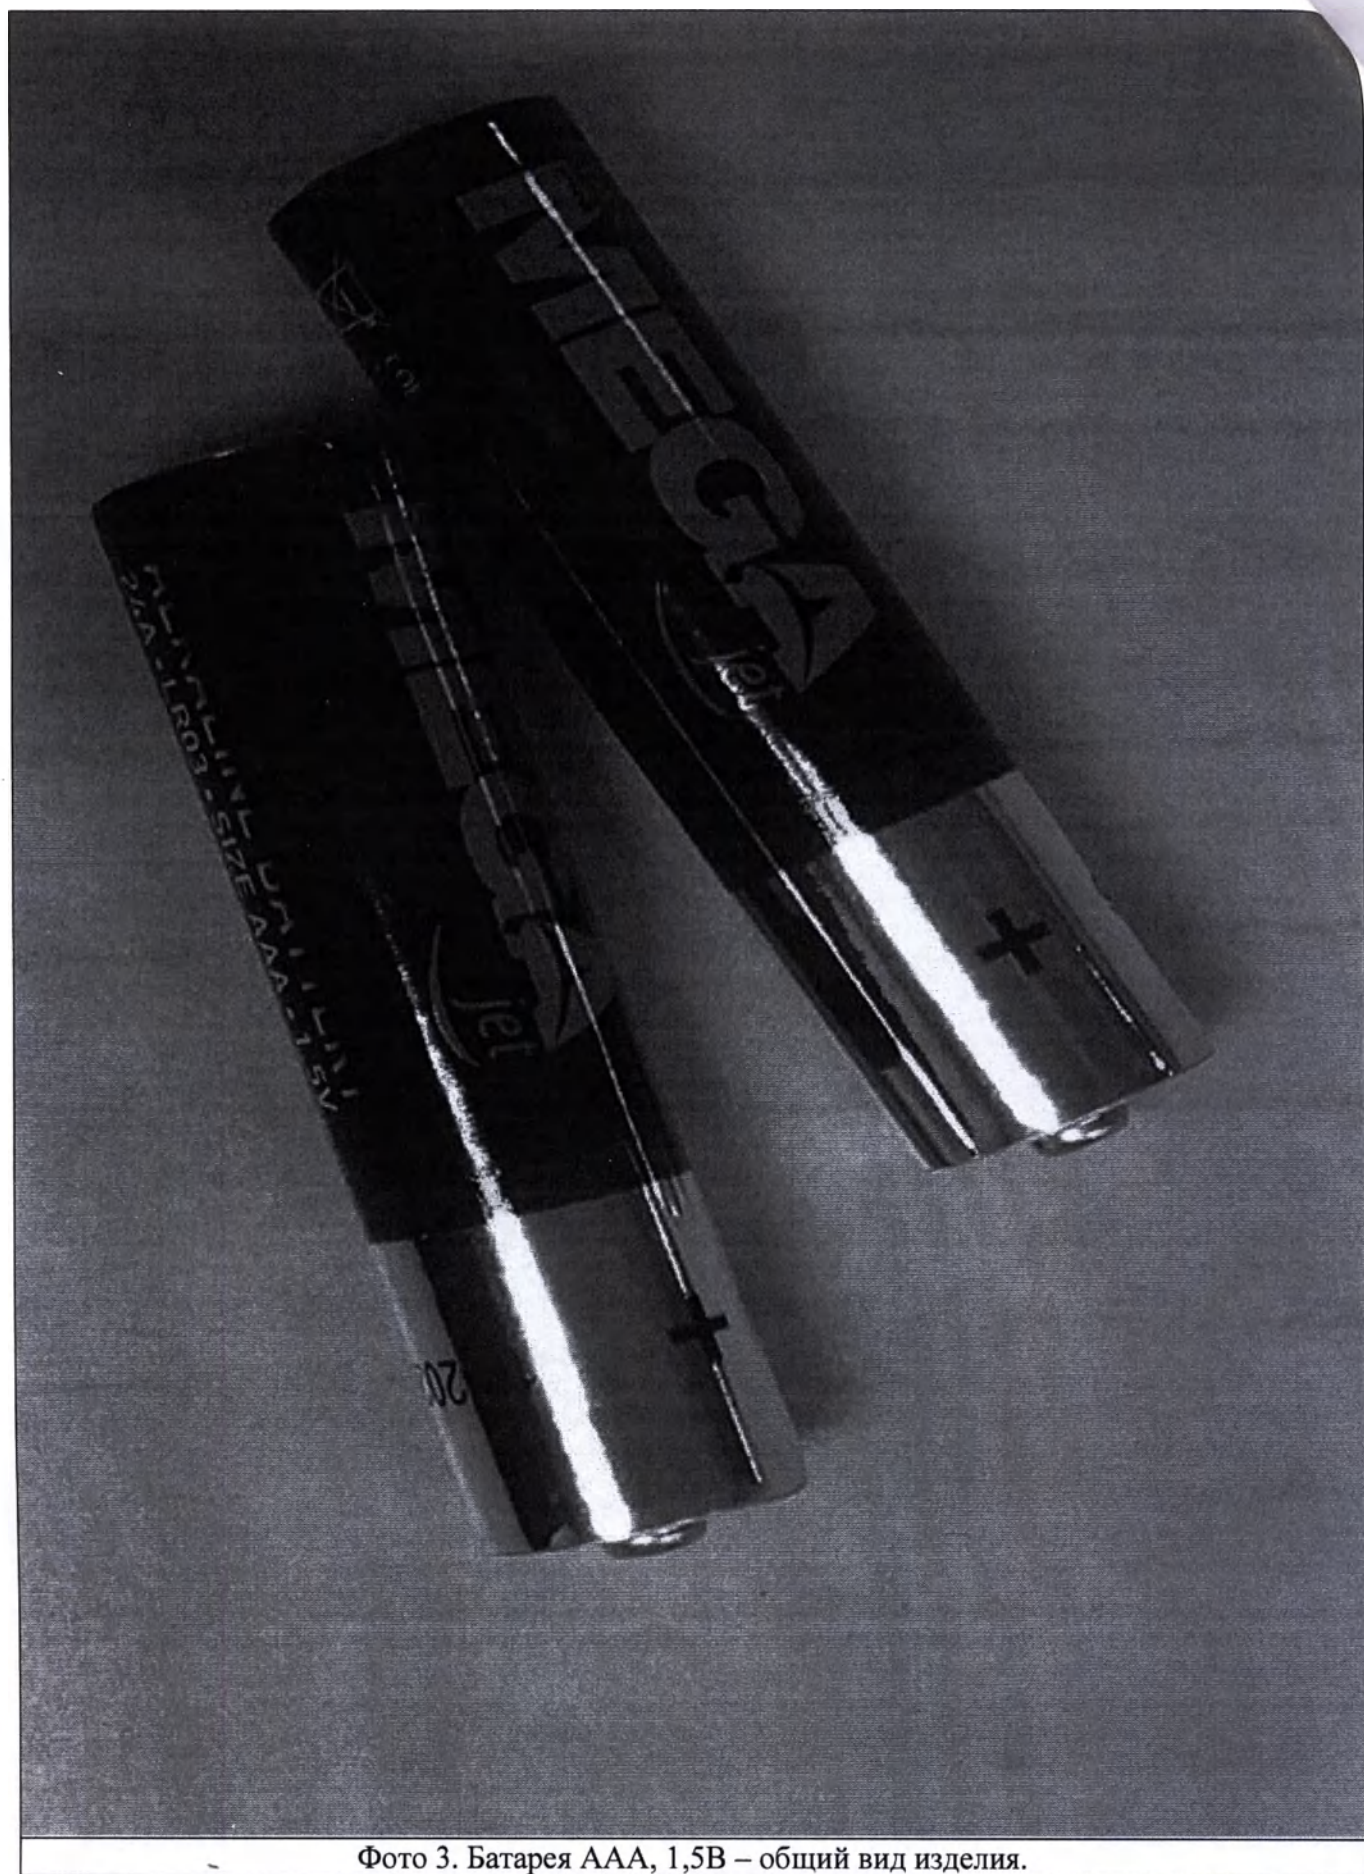


Фото 3. Батарея AAA, 1,5В – общий вид изделия.



Фото 1.1 Пульсоксиметр «Artned» A340L – общий вид изделия.

Пульсоксиметр "Armed" A340L

РУ № _____

Произведено: Shenzhen Aeon
Technology Co., Ltd., Китай
2,6 - 3,6 В / не более 45 мА

Дата выпуска:

SN



SpO₂

IP22



Фото 1.2. Пульсоксиметр «Armed» A340L – макет маркировки изделия.

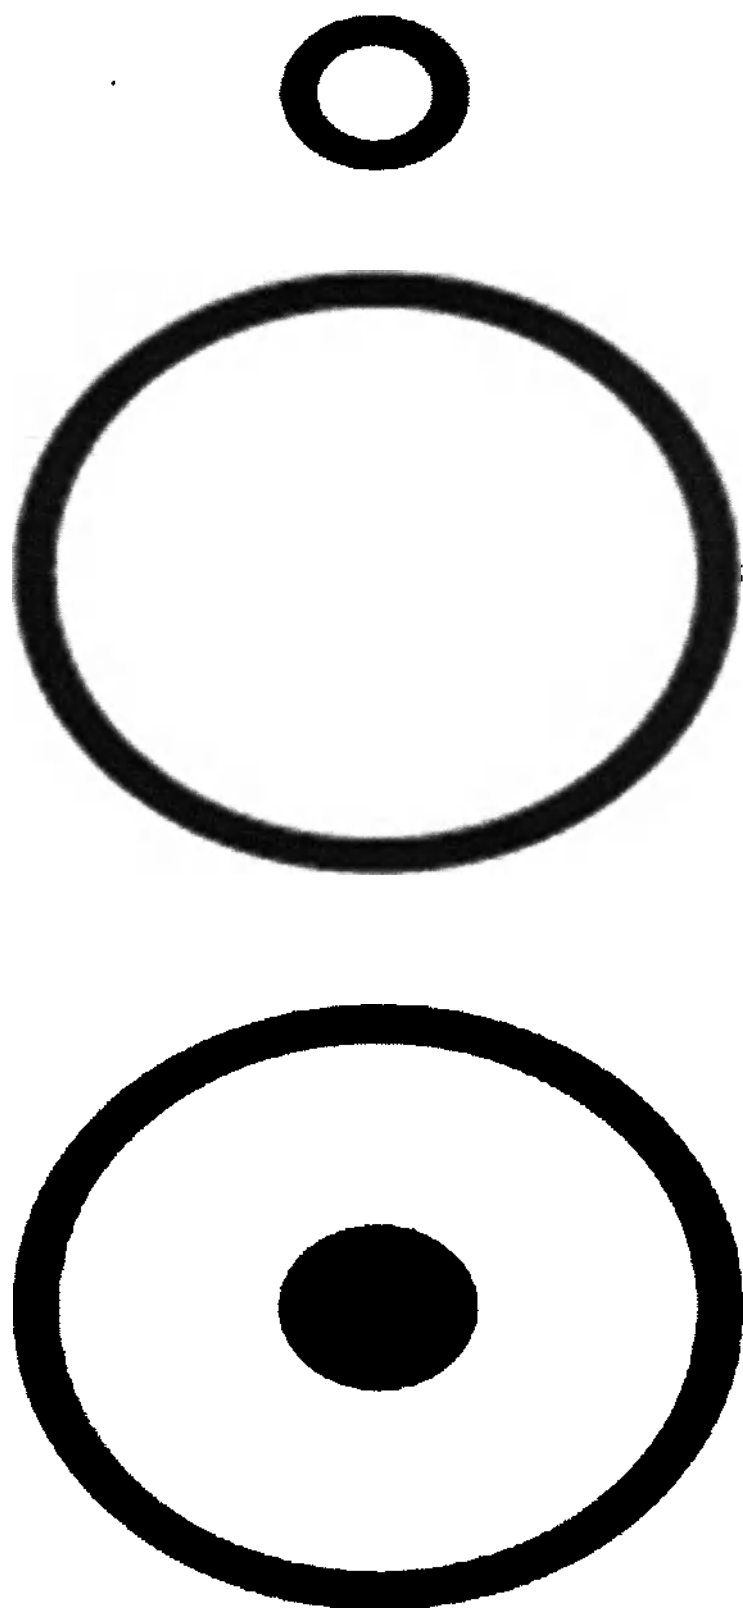


Фото 2.3. Пульсоксиметр «Armed» А300 – макет маркировки «Кнопка включения» на изделии.



Фото 2.4. Пульсоксиметр «Armed» A300 – макет маркировки «Правильное расположение пальца относительно датчика» на изделии.

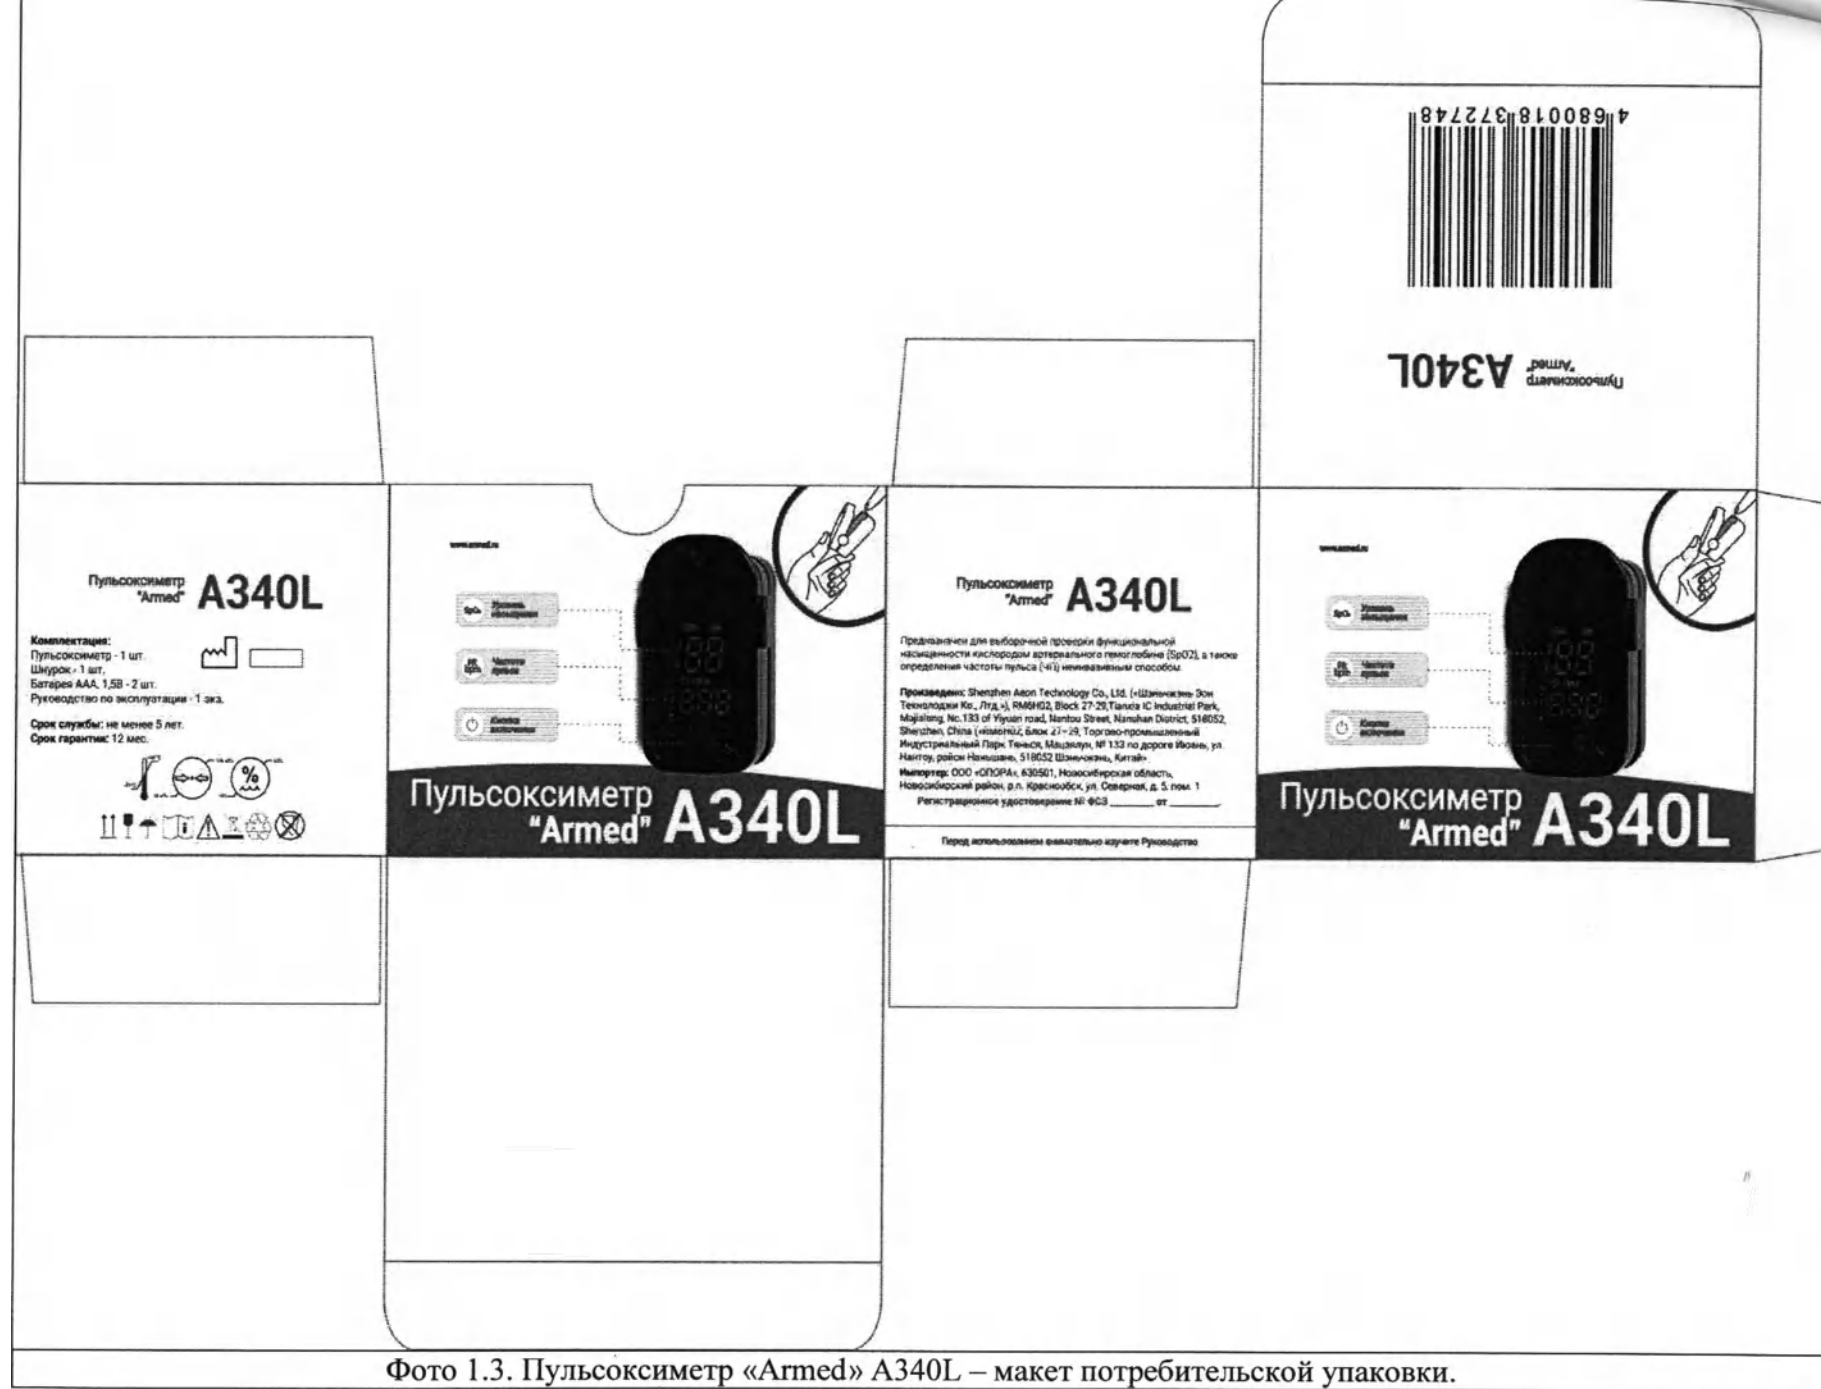


Фото 1.3. Пульсоксиметр «Armed» A340L – макет потребительской упаковки.



Фото 2. Шнурок – общий вид изделия.



Фото 3. Батарея AAA, 1,5В – общий вид изделия.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

Воскресенский
лист *об*



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.