

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МТО «Сормовь»



Брукс Е.В.


20.08.2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА DIXION ST
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ DIXION ST-E500


Корпус с инструментальной поверхностью.




Осветитель.

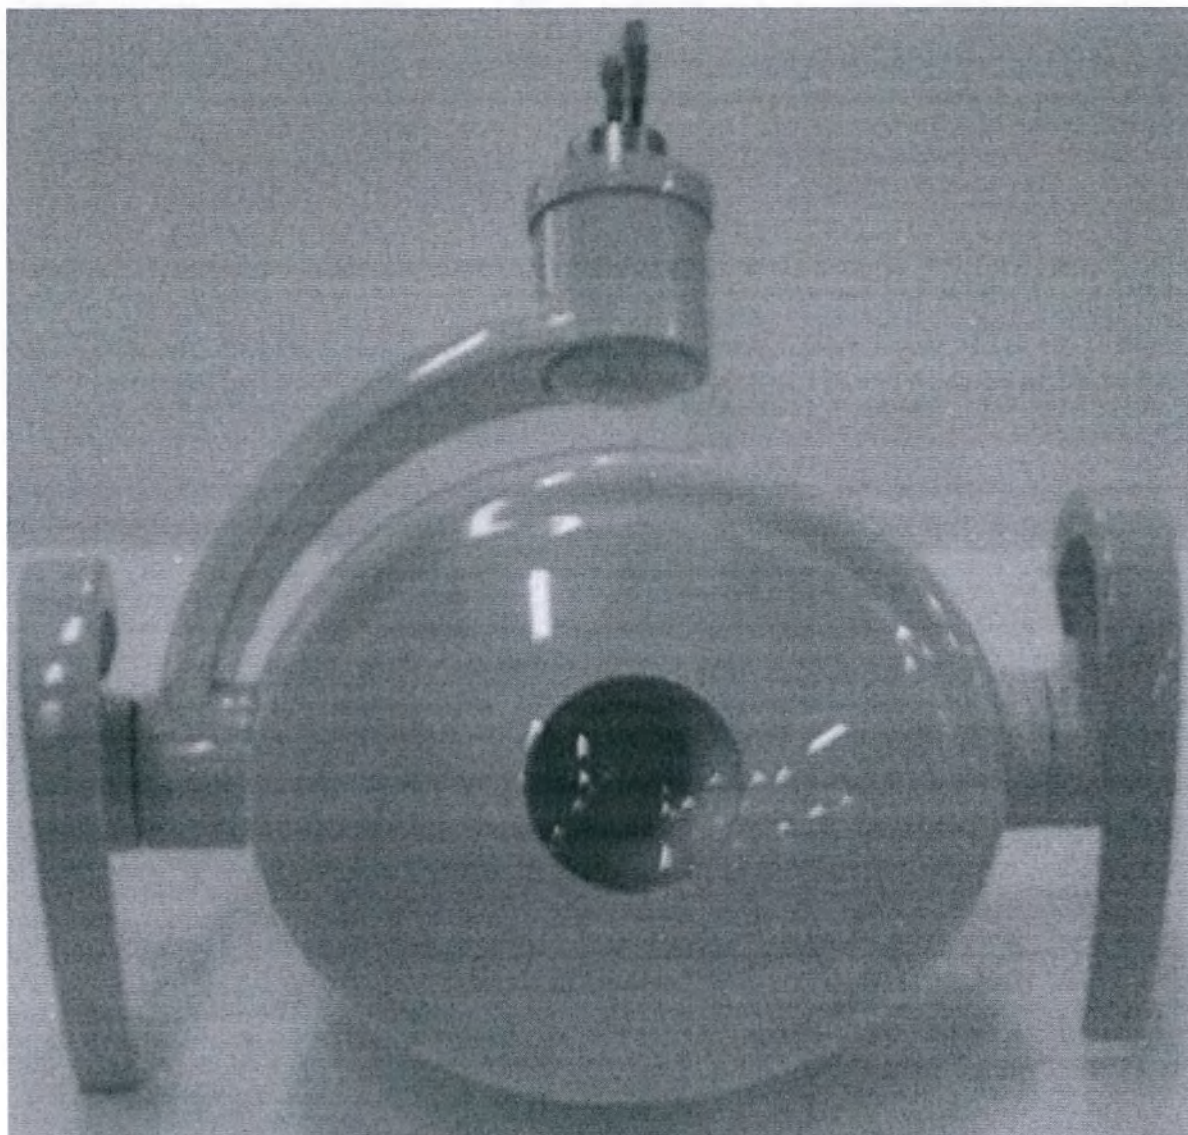


Стойка осветителя.

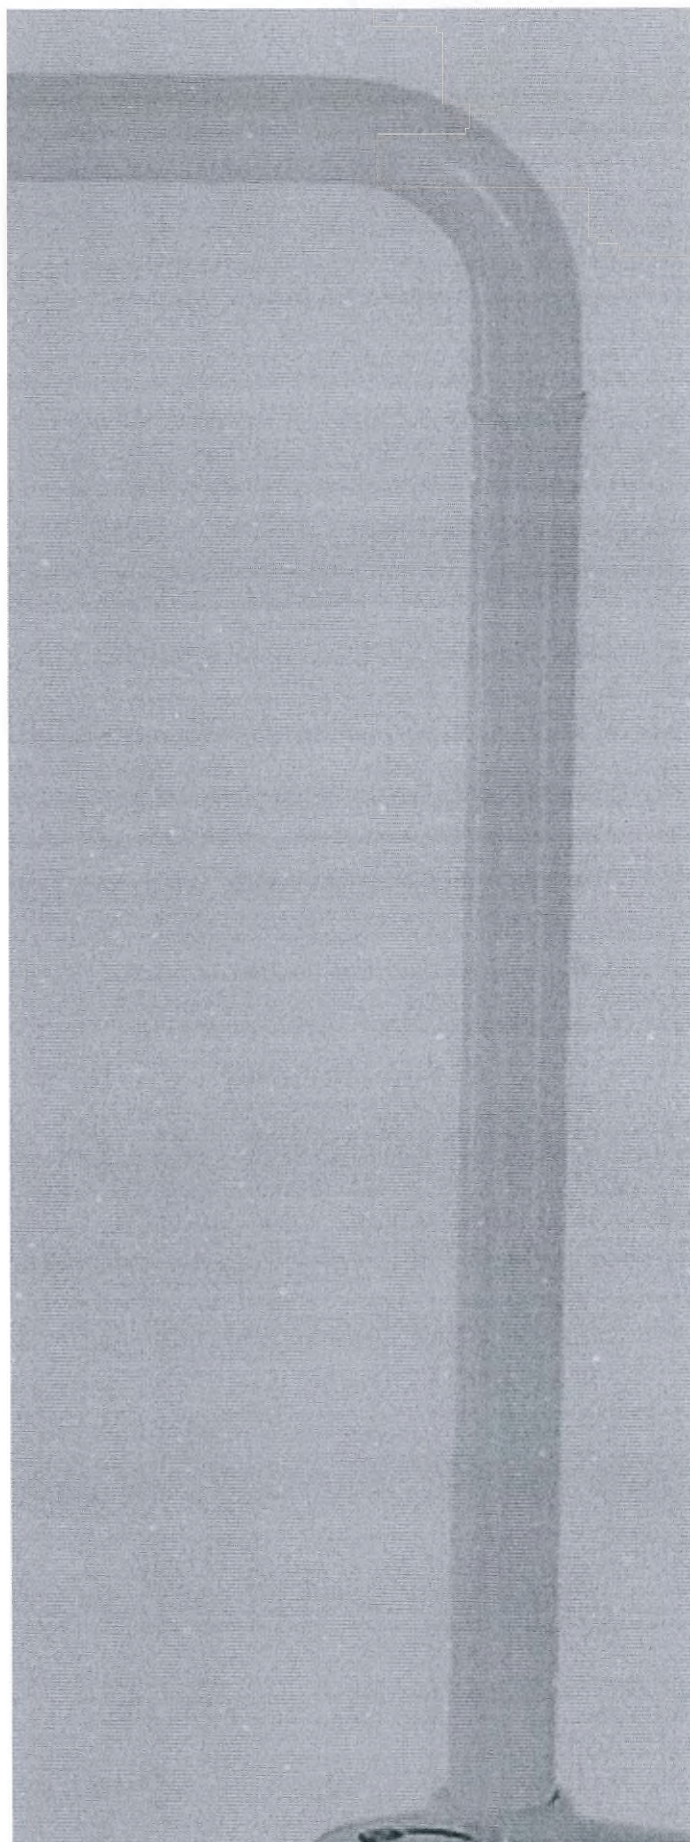


Рычаг осветителя.

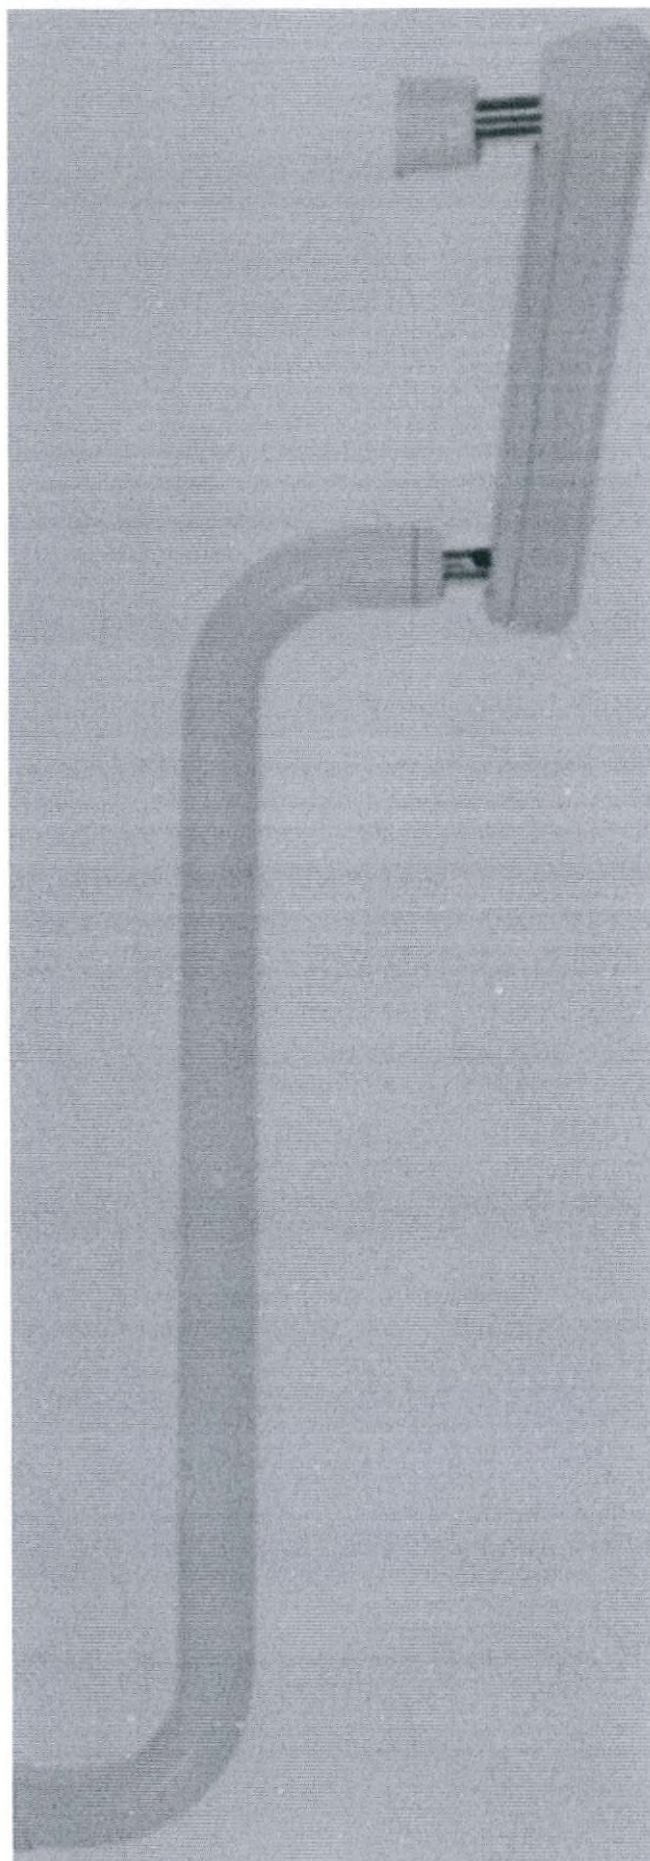


Распылитель лекарственных средств

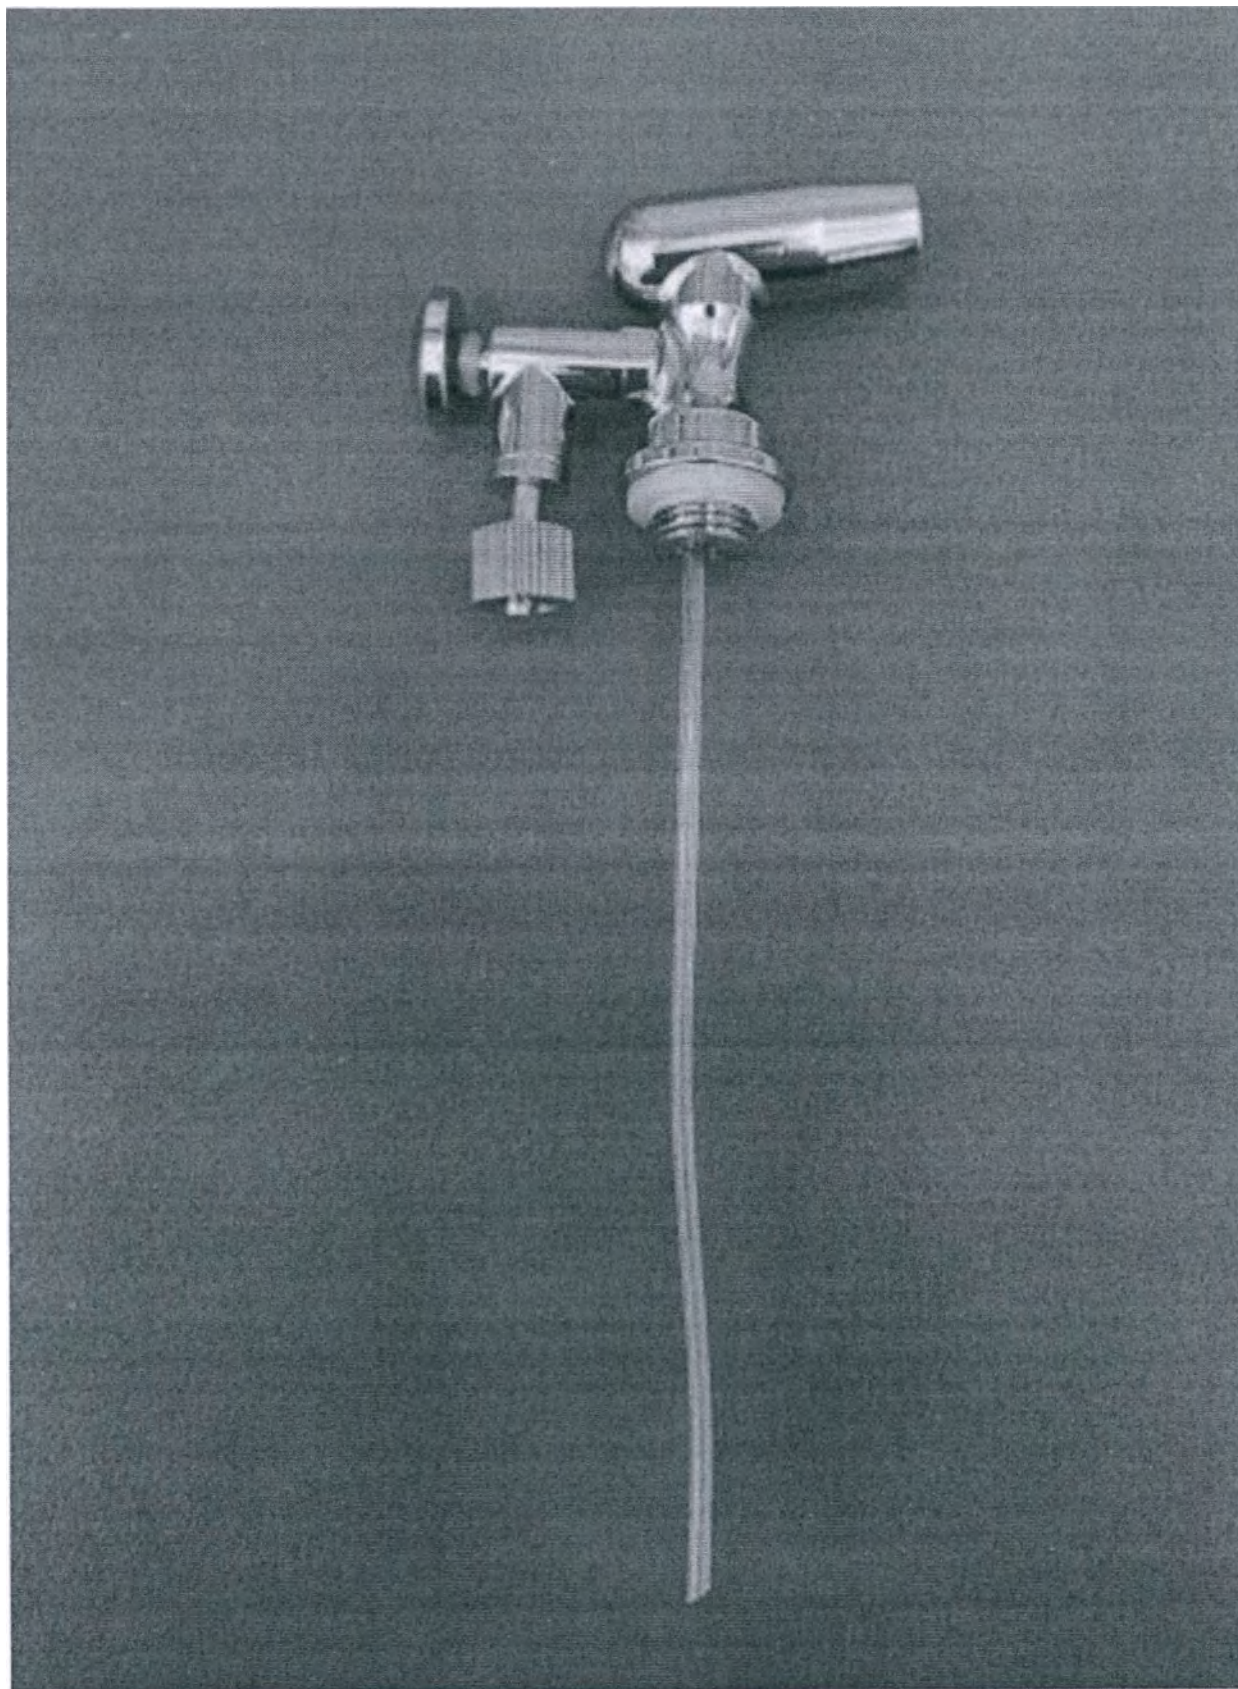


Наконечник (трубка-сопло) прямой для распыления медикаментов

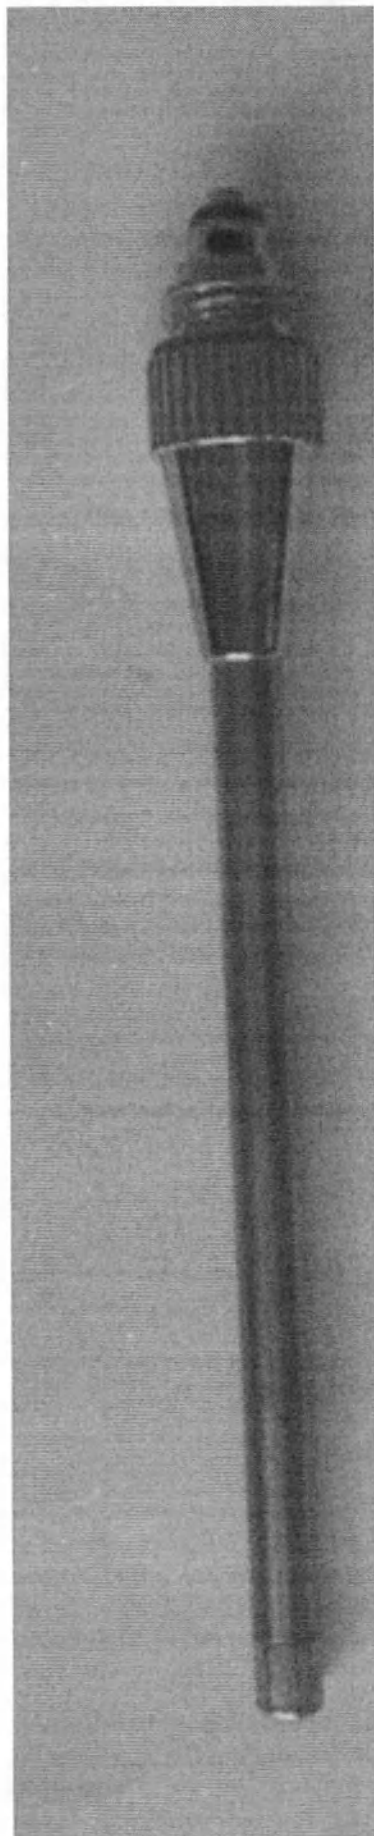


Наконечник (трубка-сопло) изогнутый для распыления медикаментов

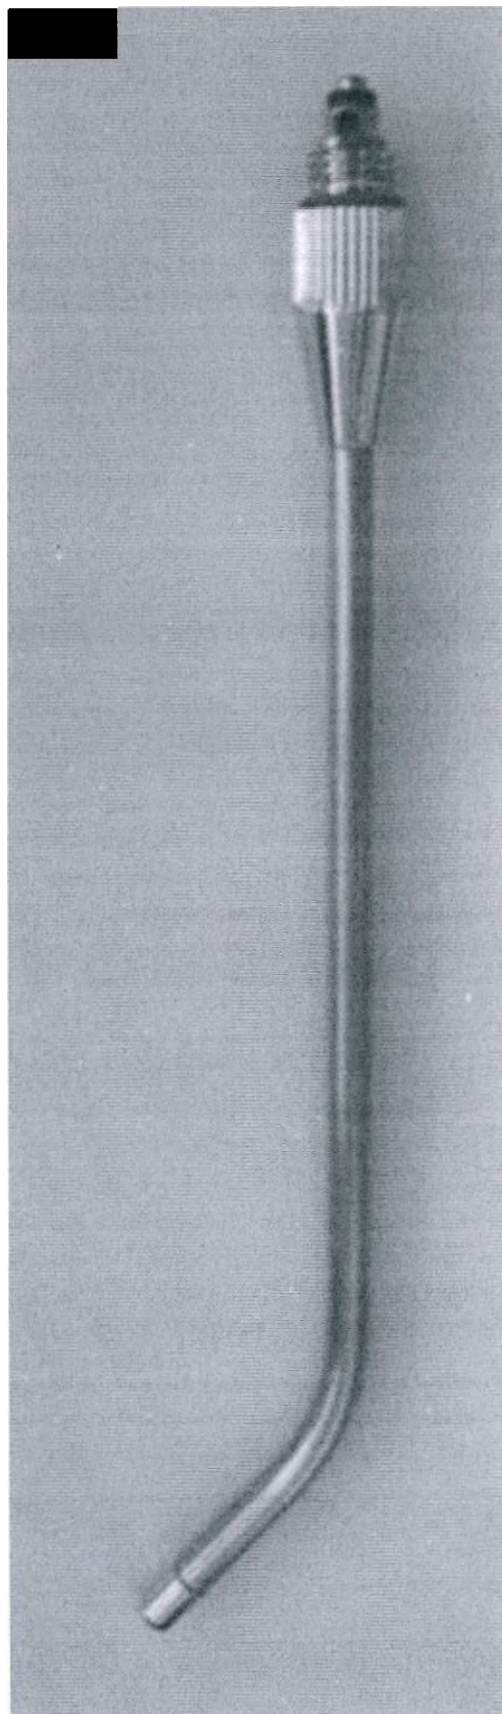


Колба пластиковая для медикаментов

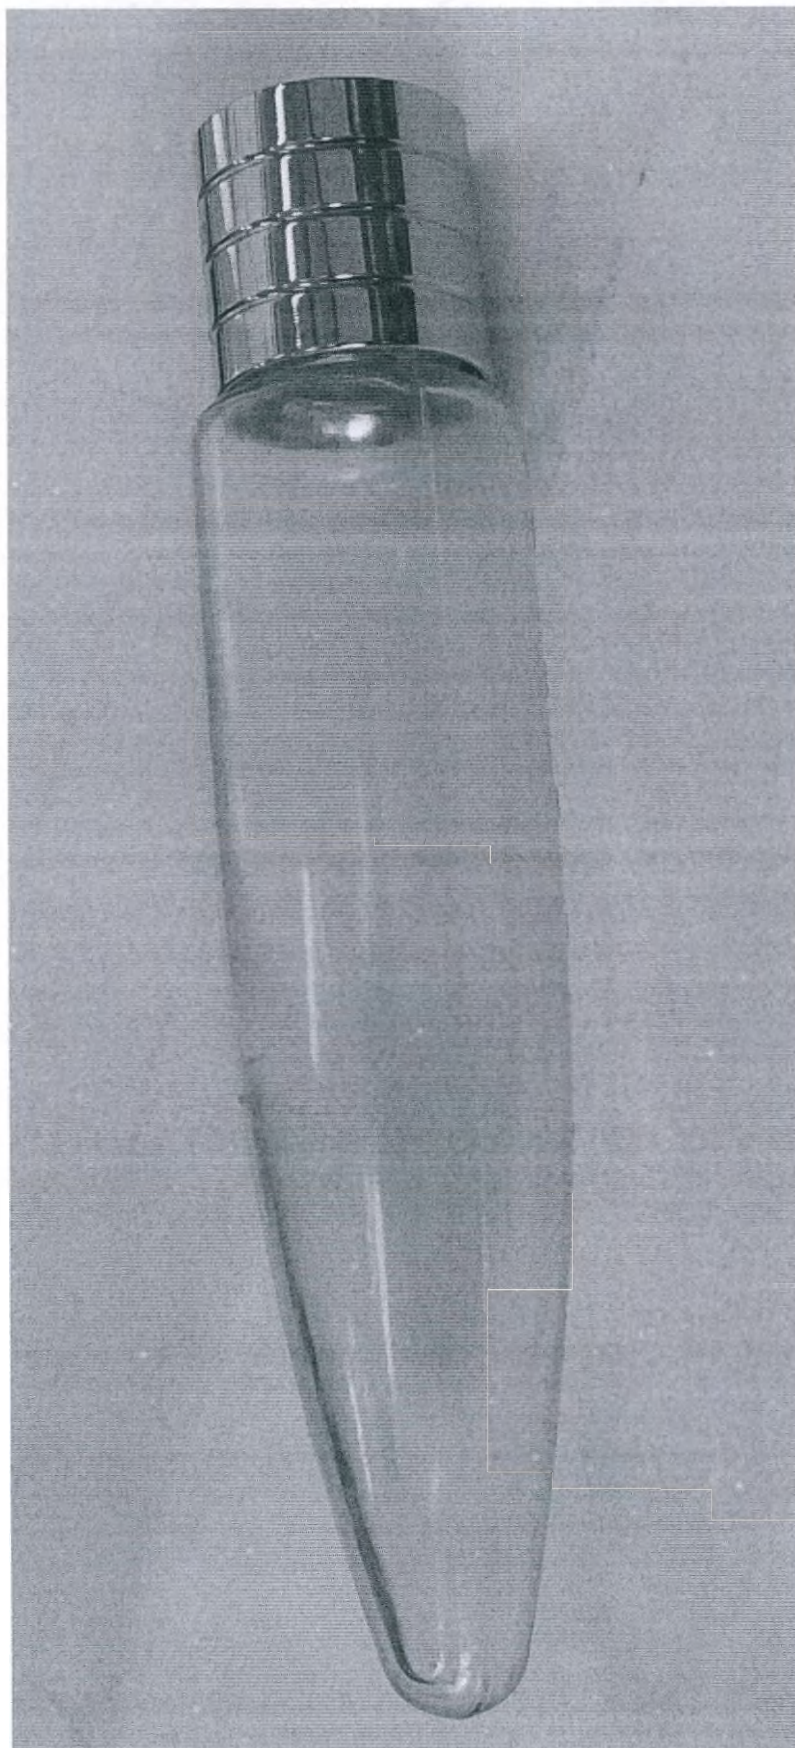

Трубка распылителя

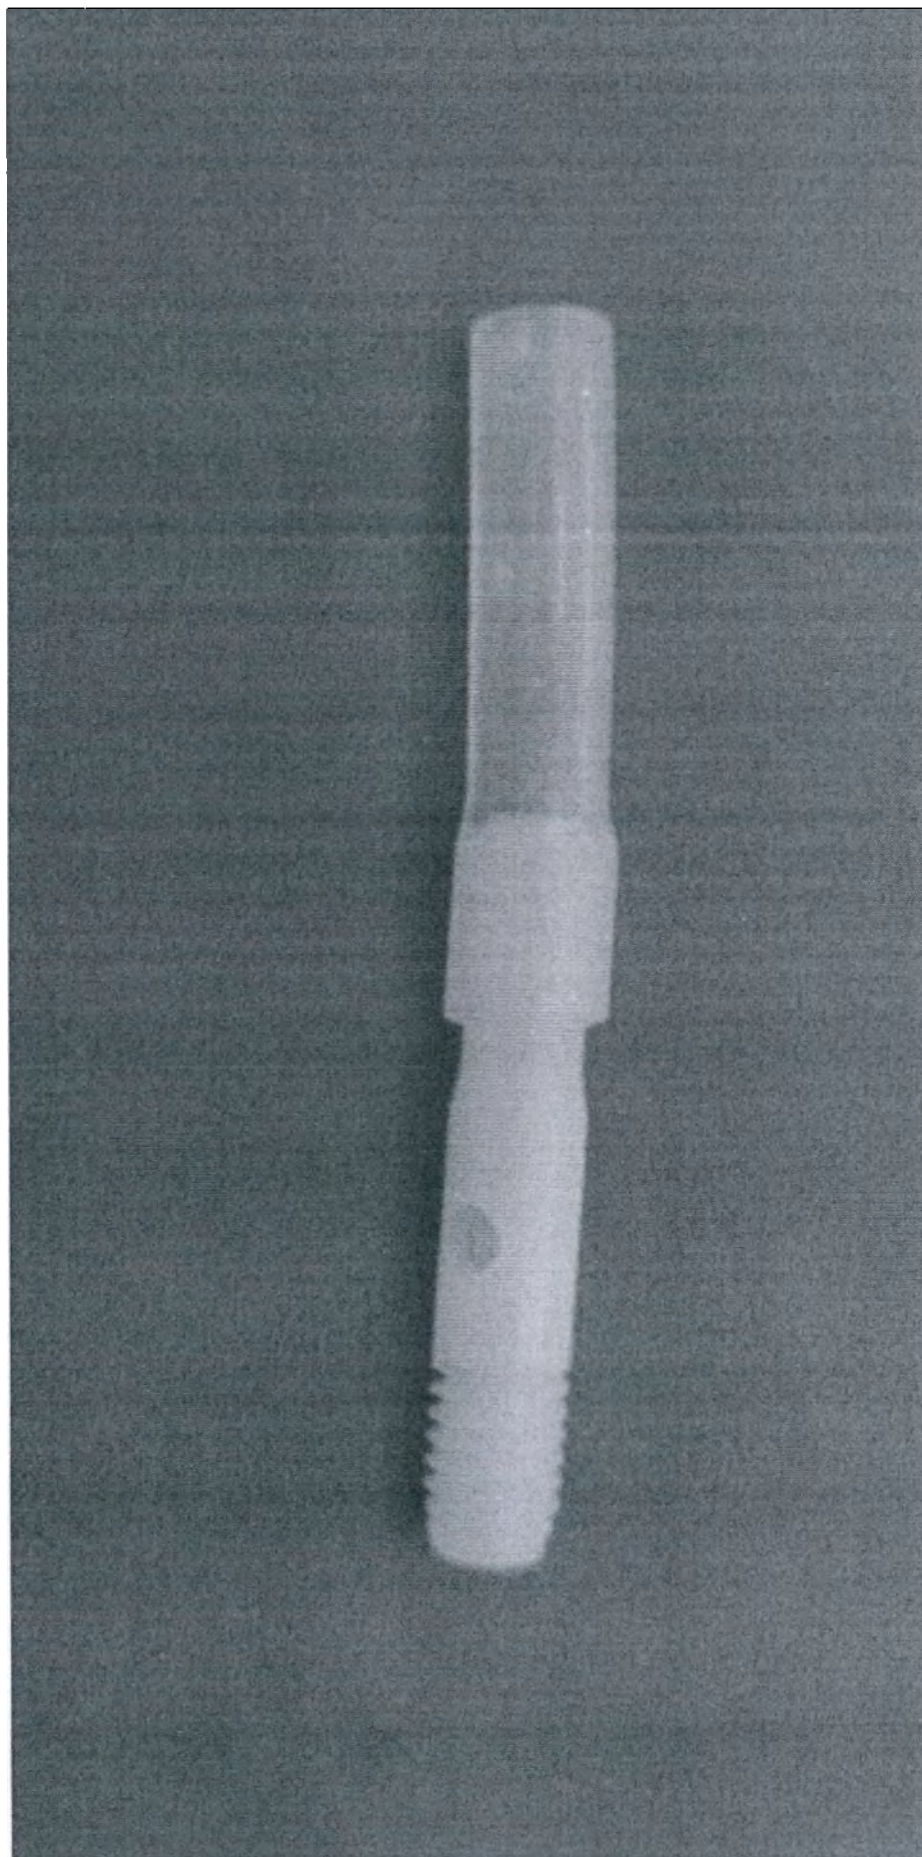


Соединительный шланг распылителя

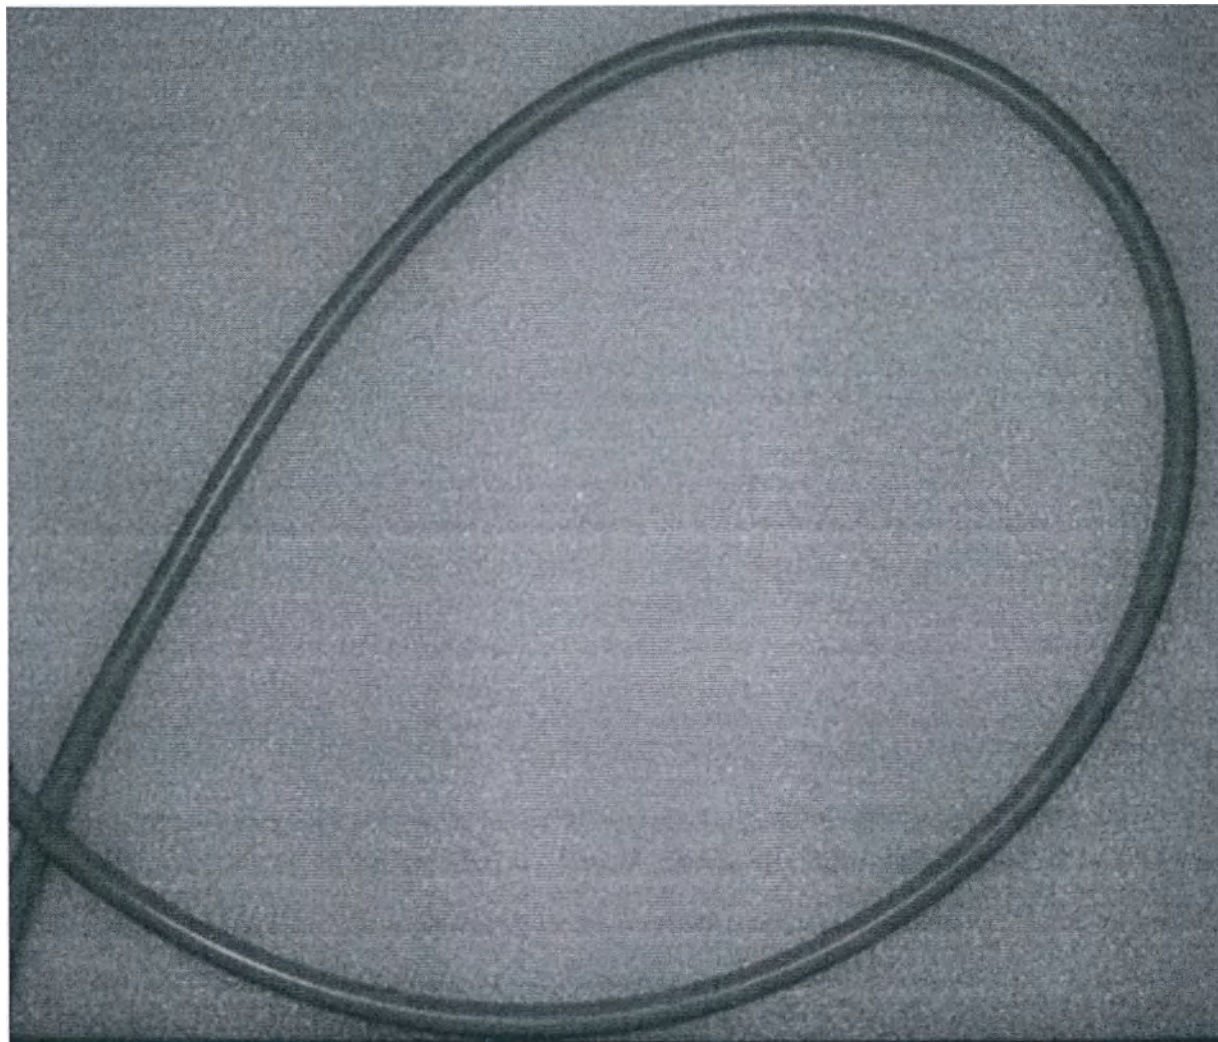


Ручка активации aspirатора




Наконечник аспиратора

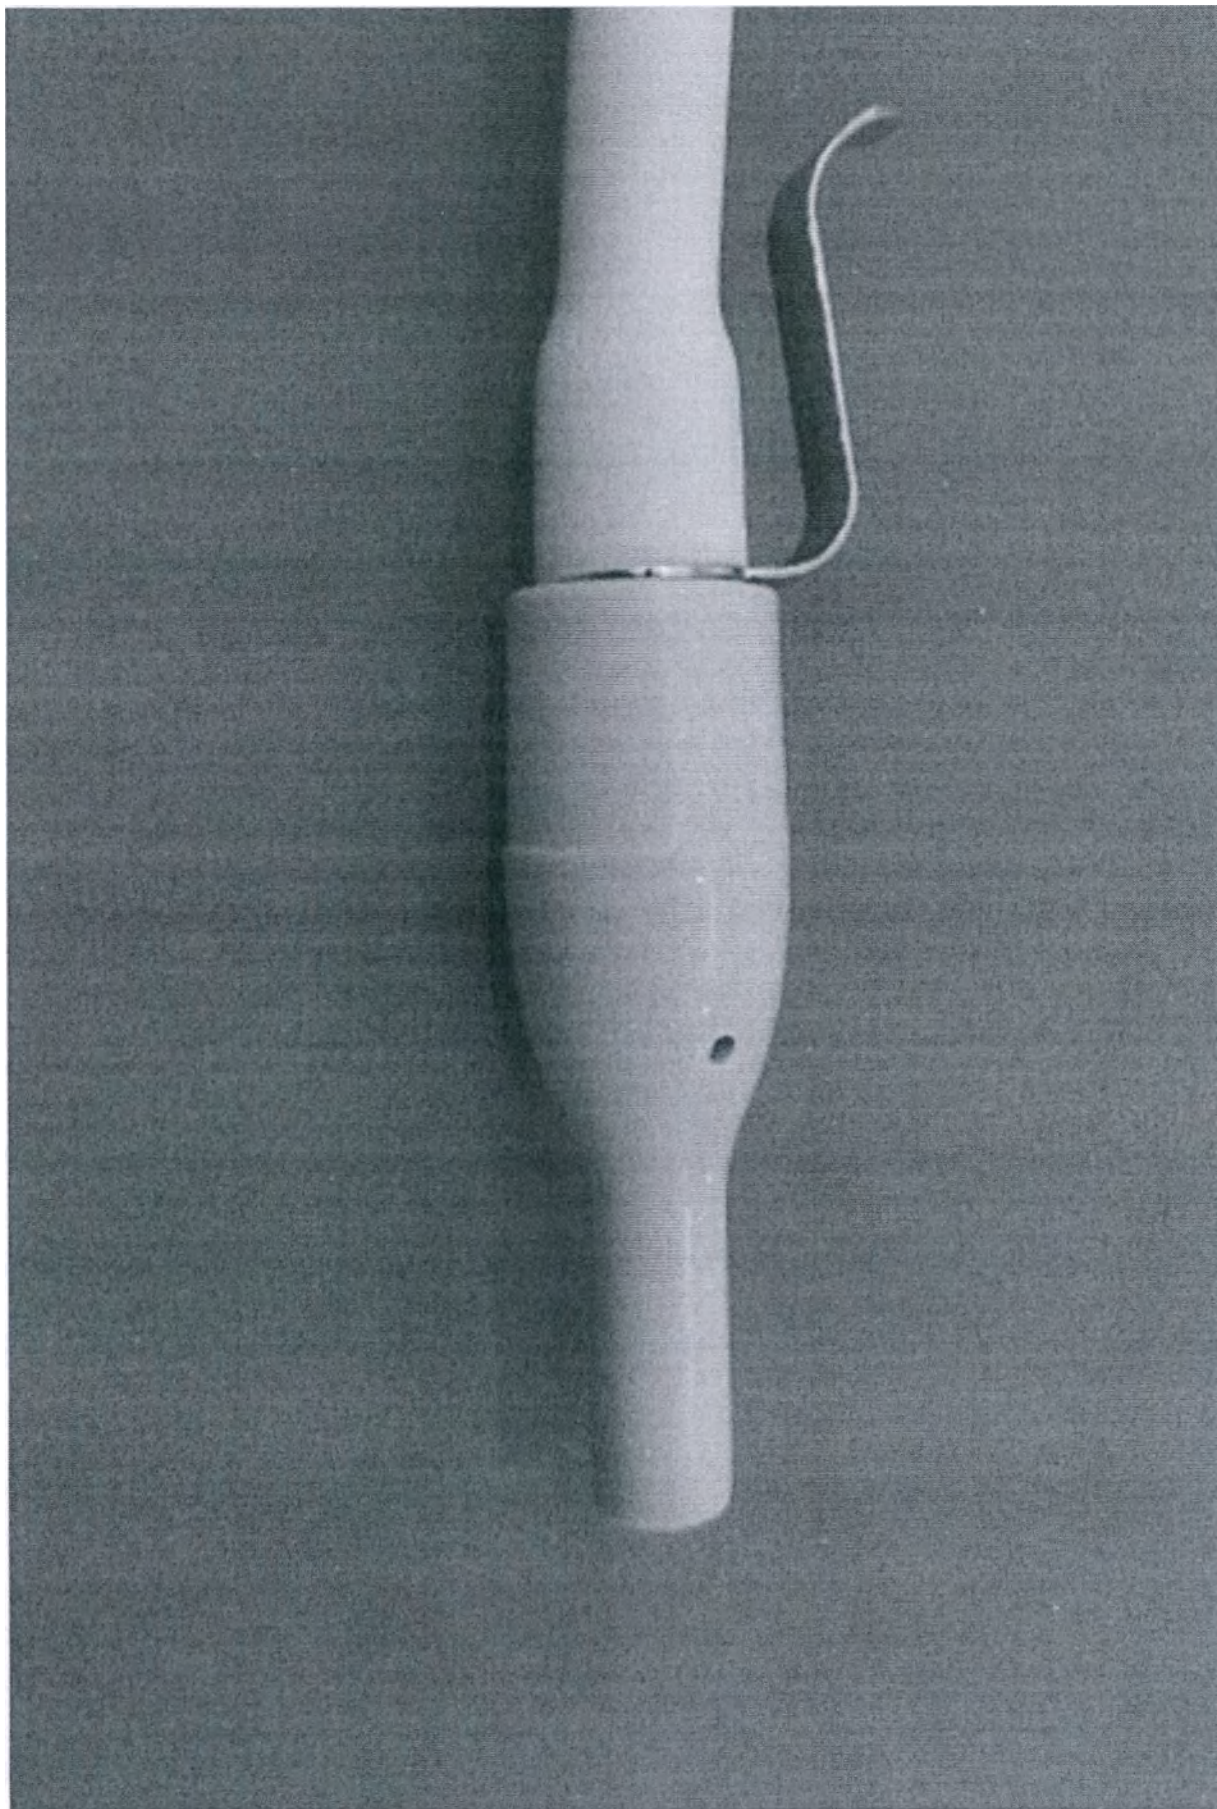


Шланг аспирационный.

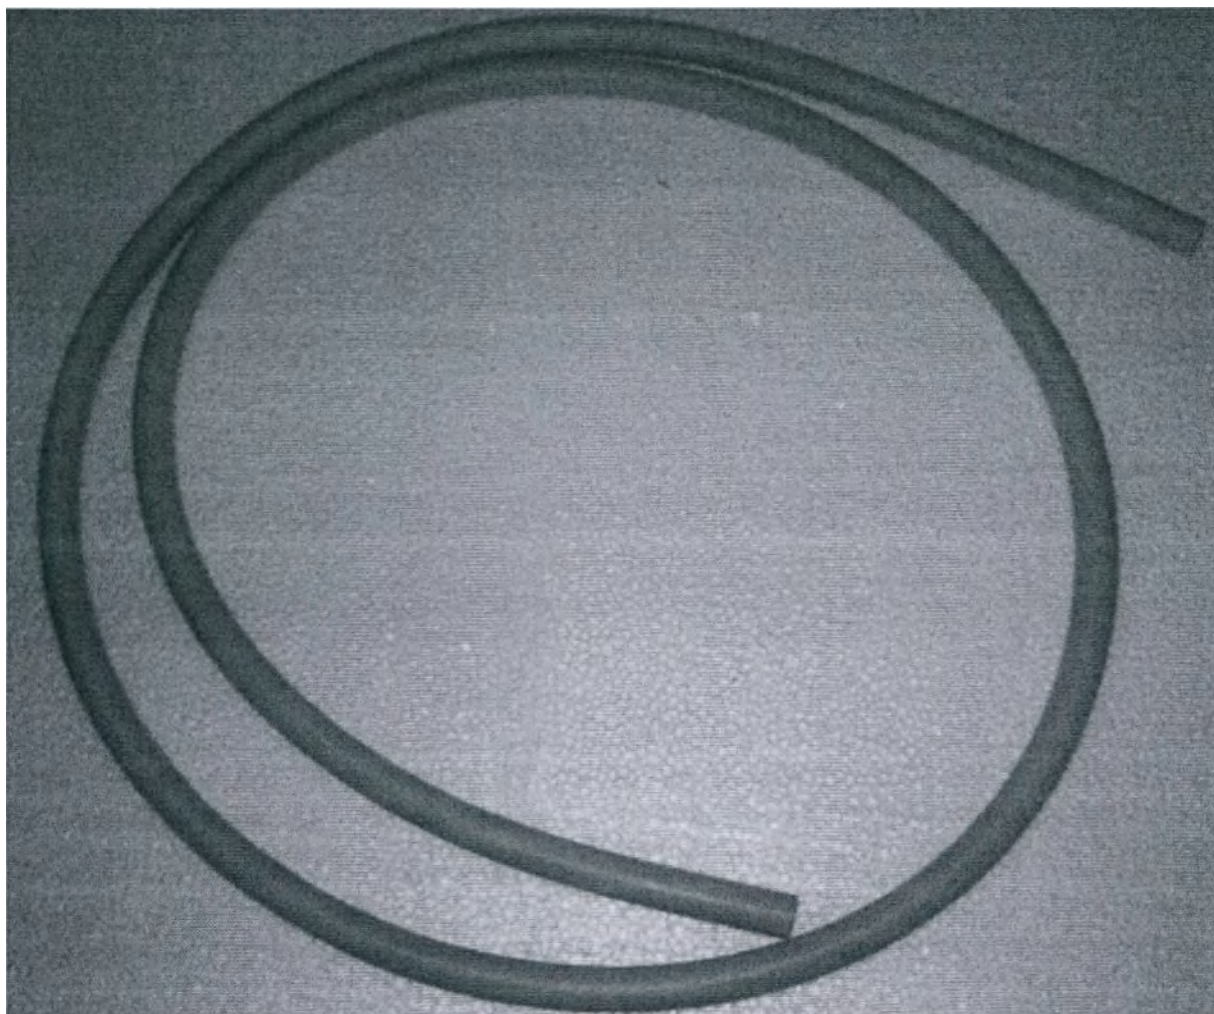


Устройство предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал.

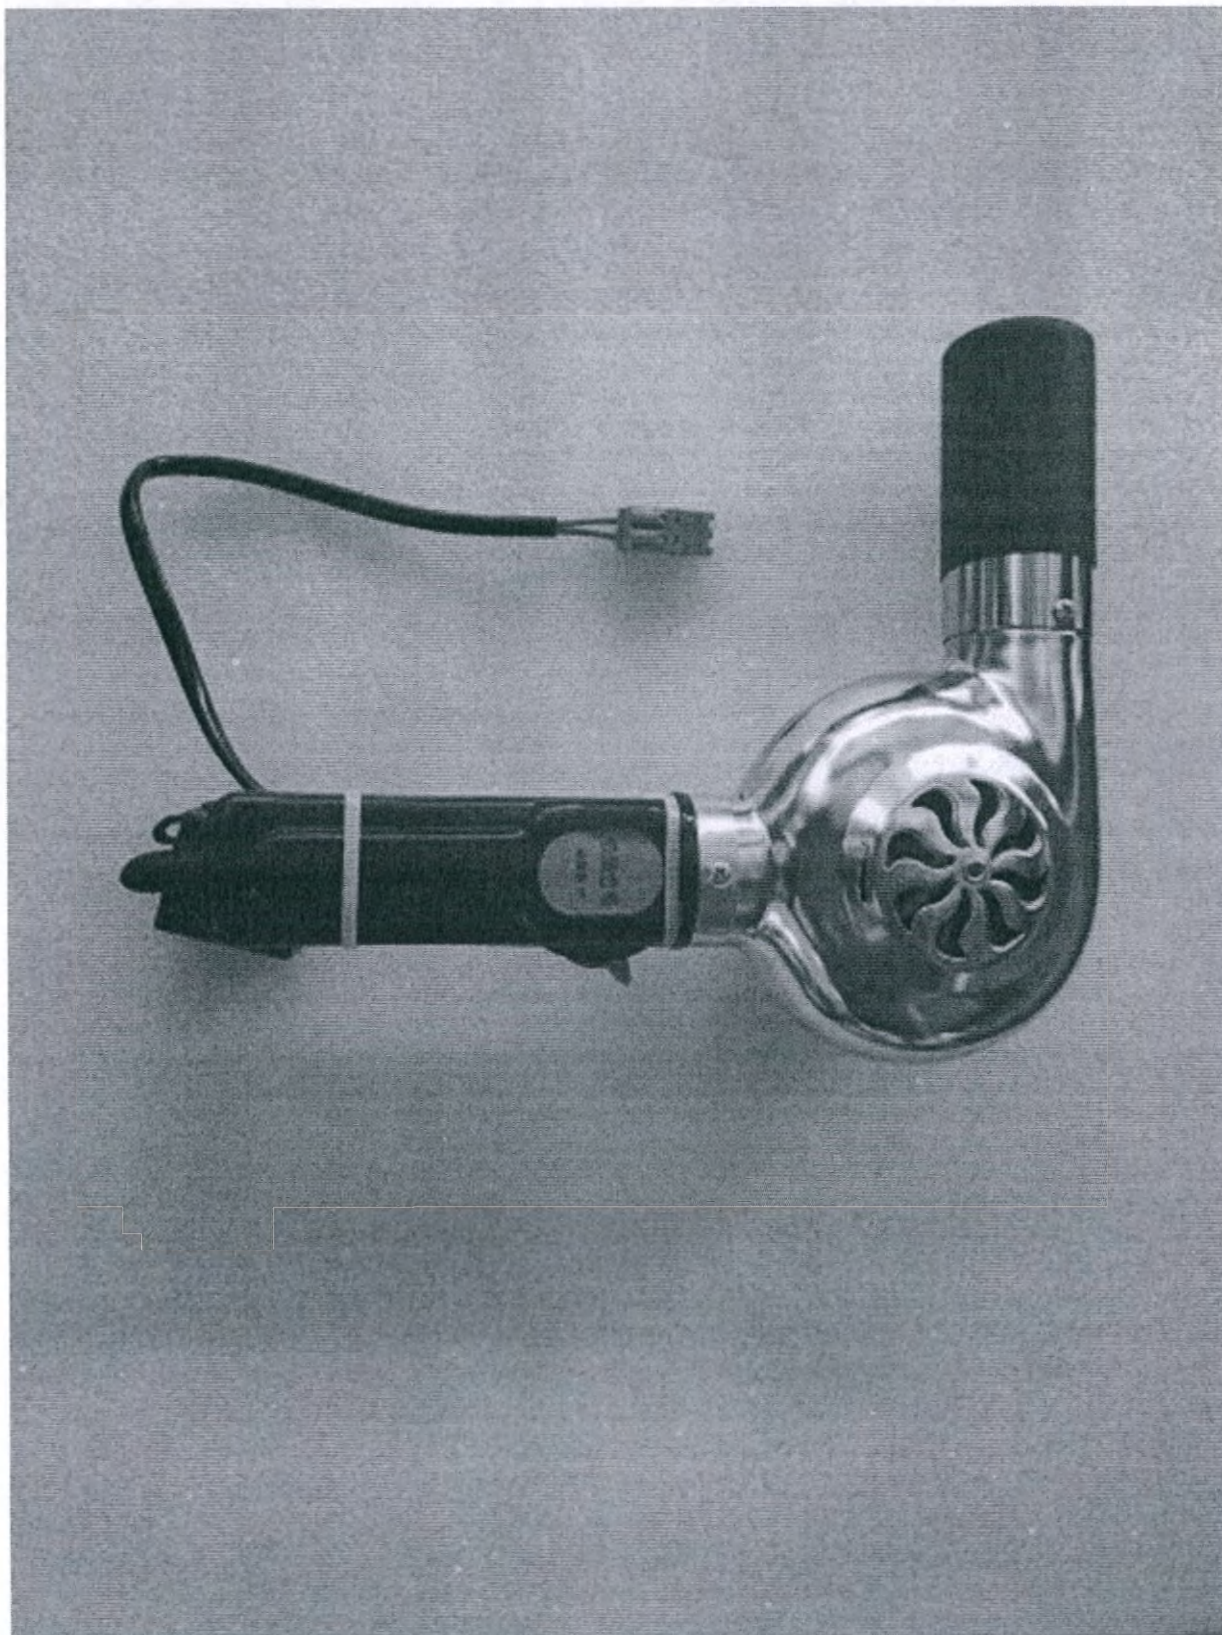


Заглушка для сетки устройства предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал

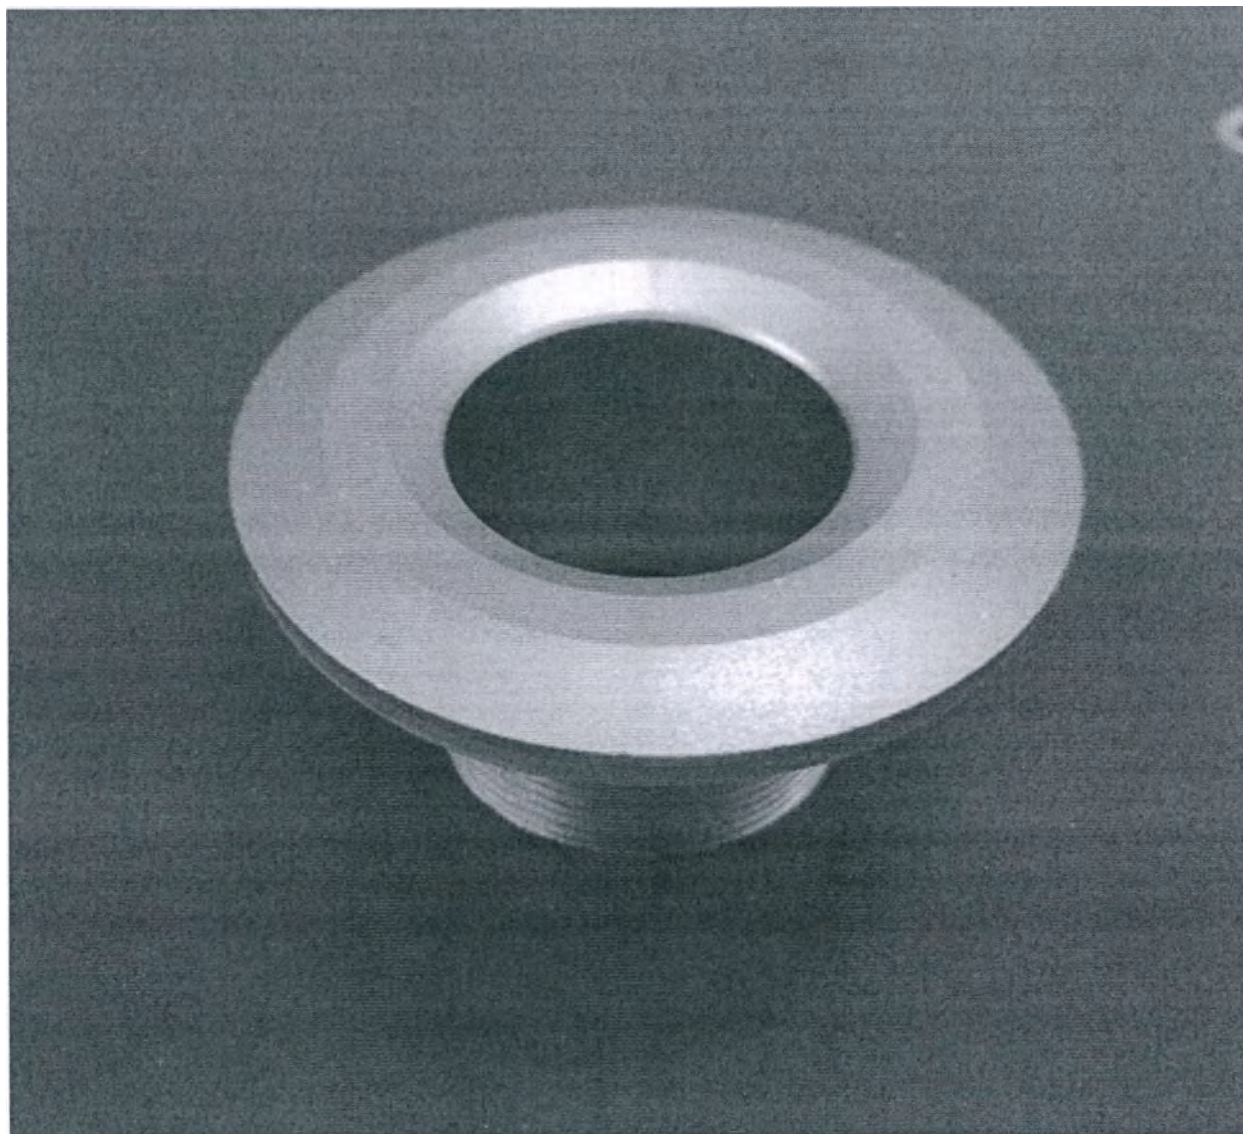

Ватодержатель из нержавеющей стали с крышкой

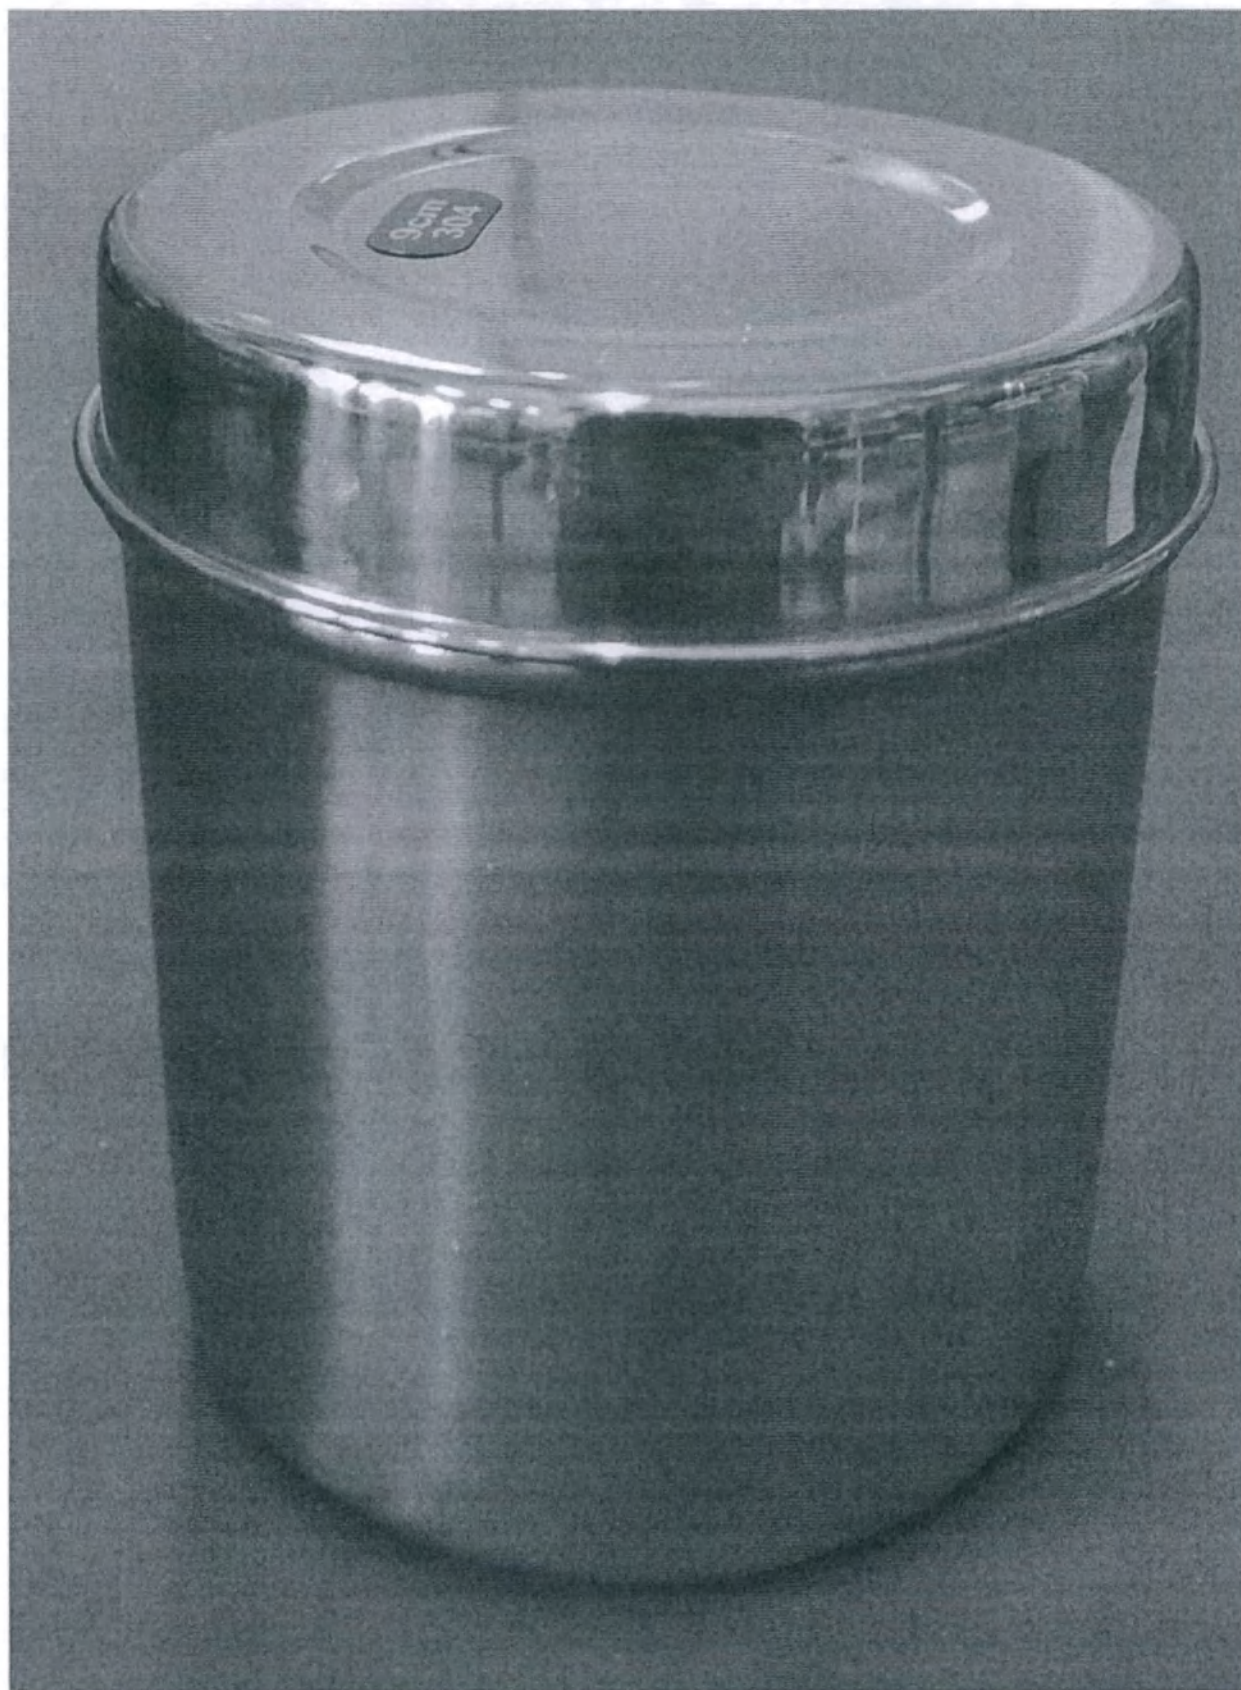


Медицинская бутылка для лекарственных средств .

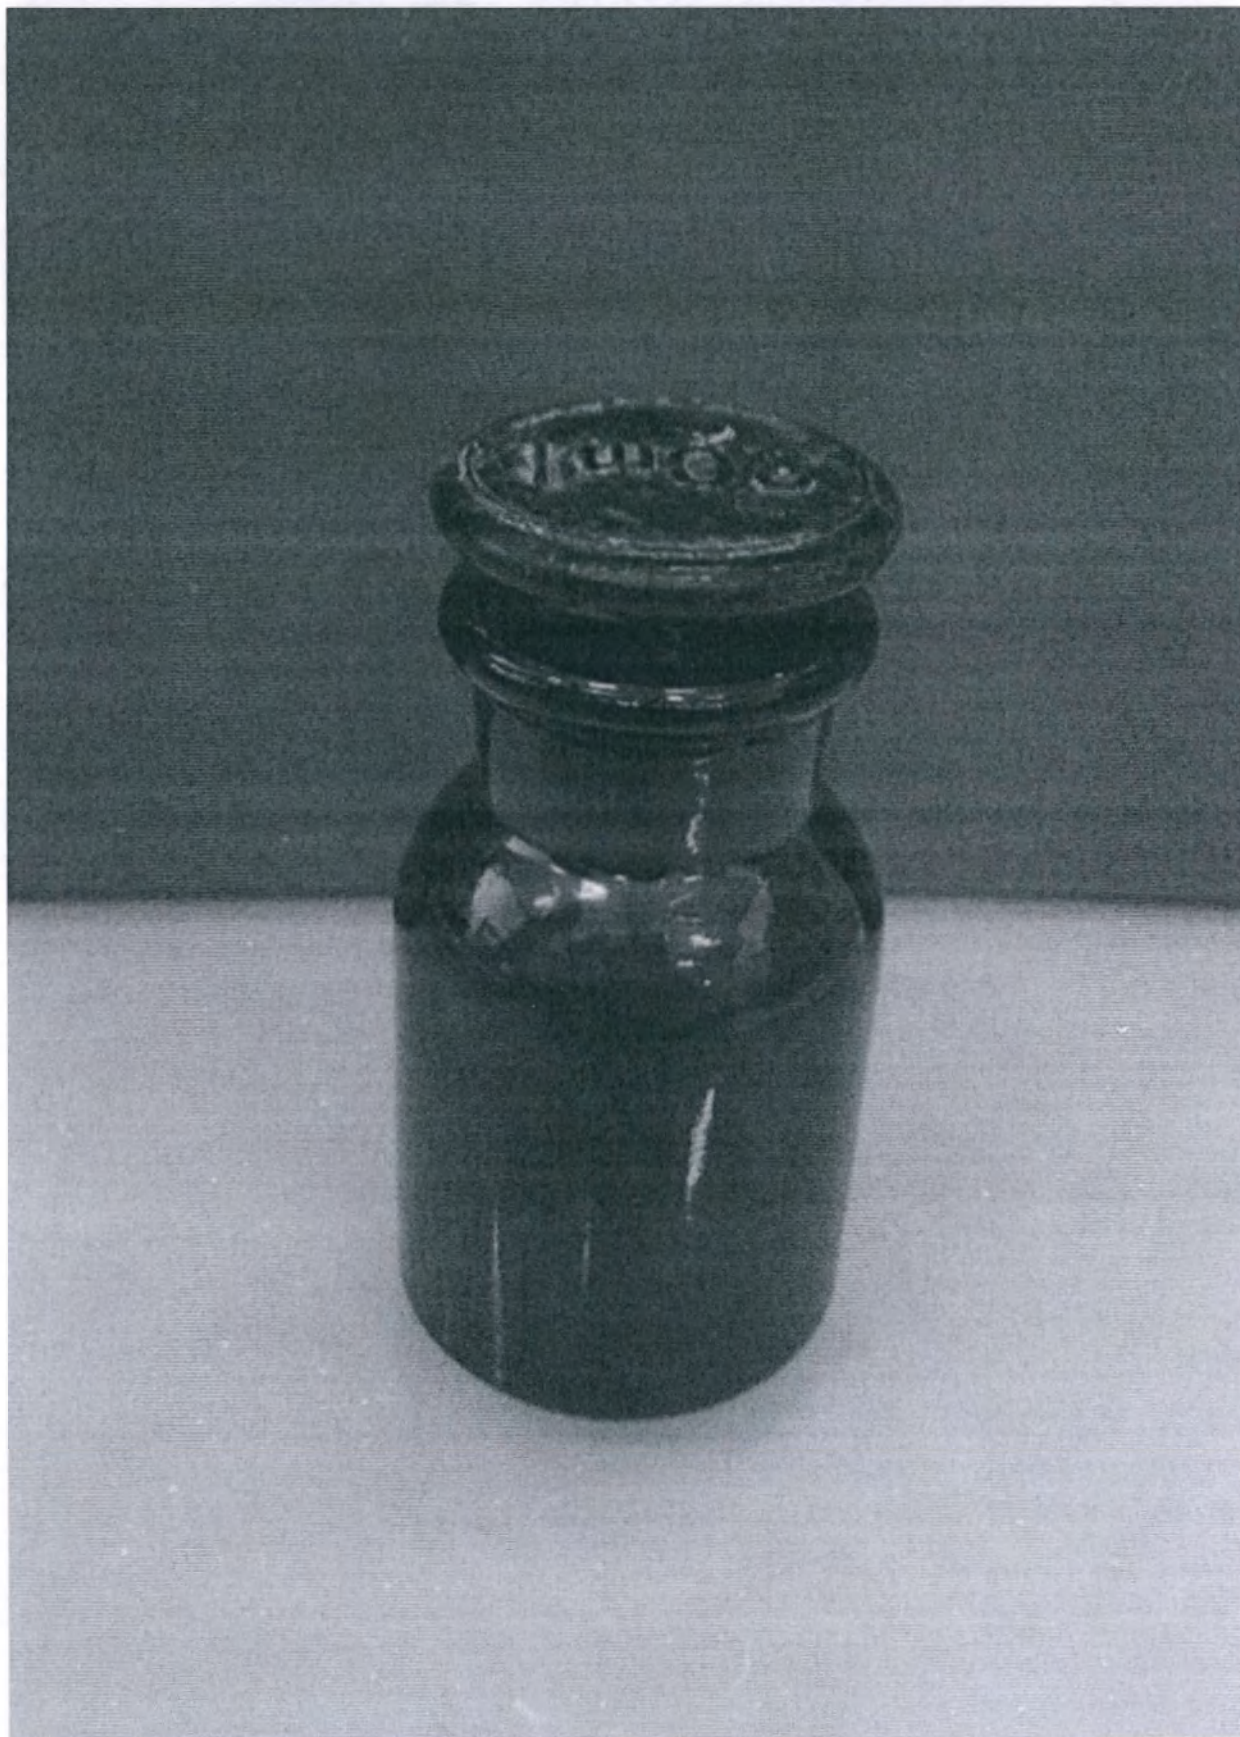


Вертикальный держатель для инструментов




Емкость для секрета, объем 2500 мл.

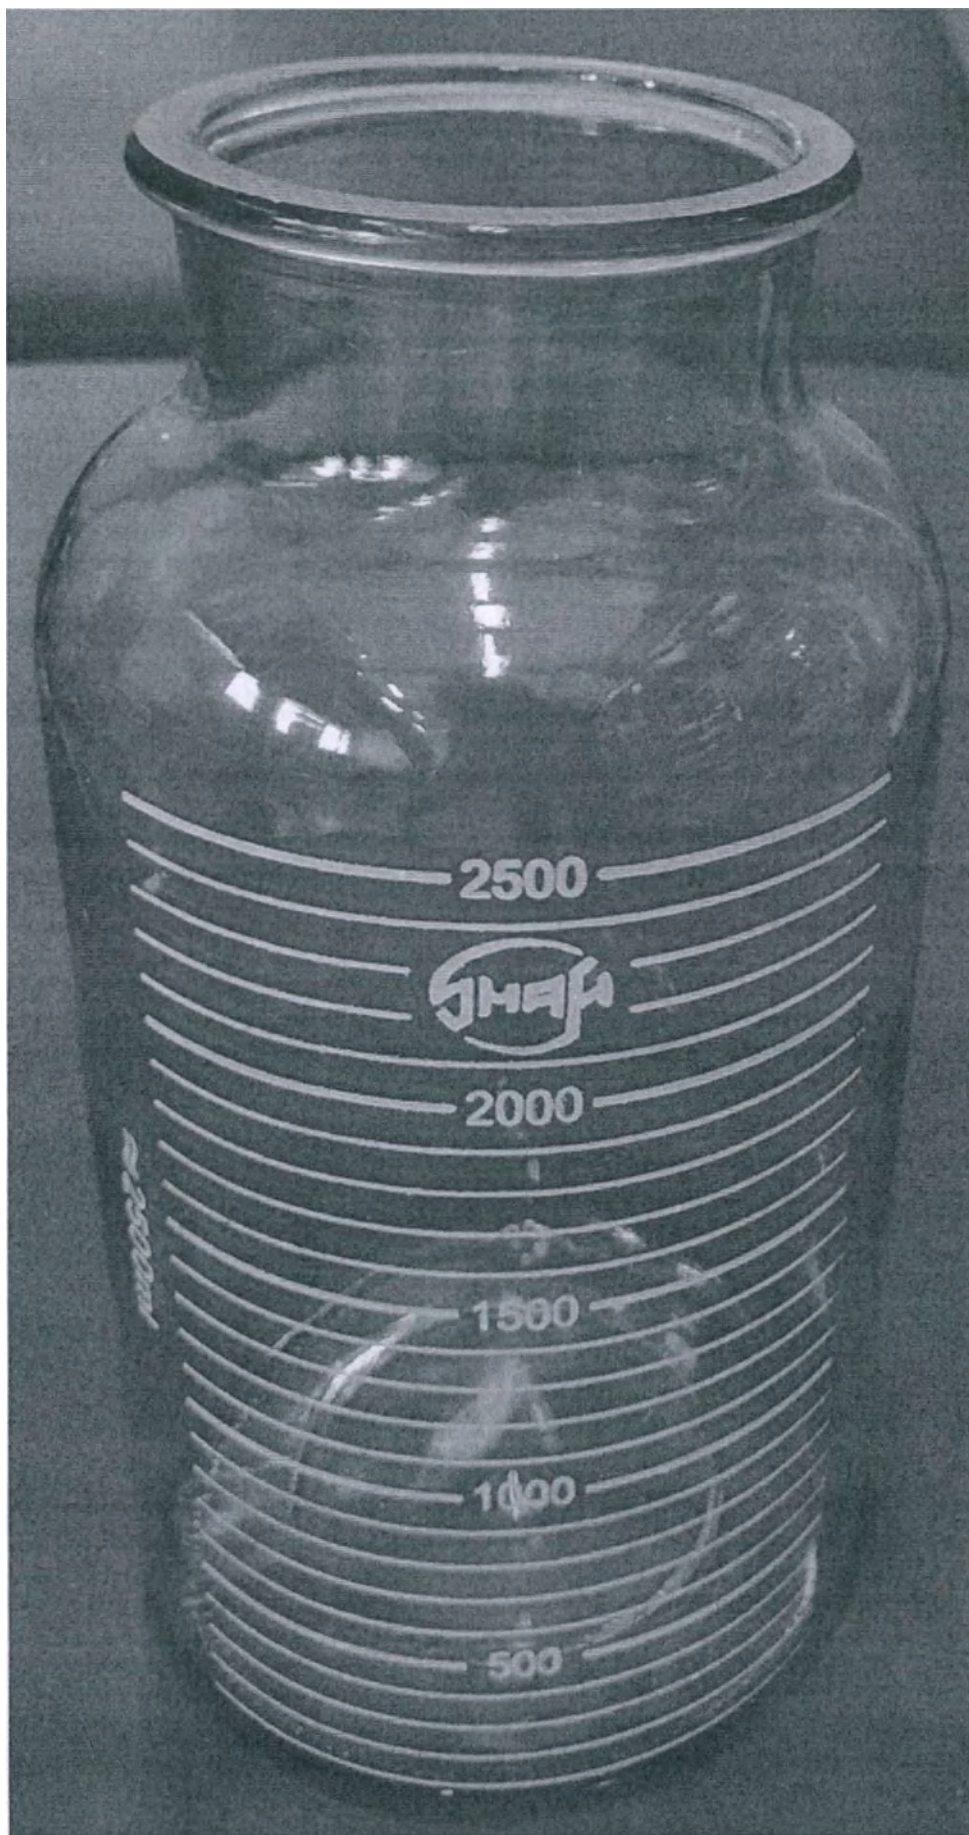


Лоток для инструментов с крышкой

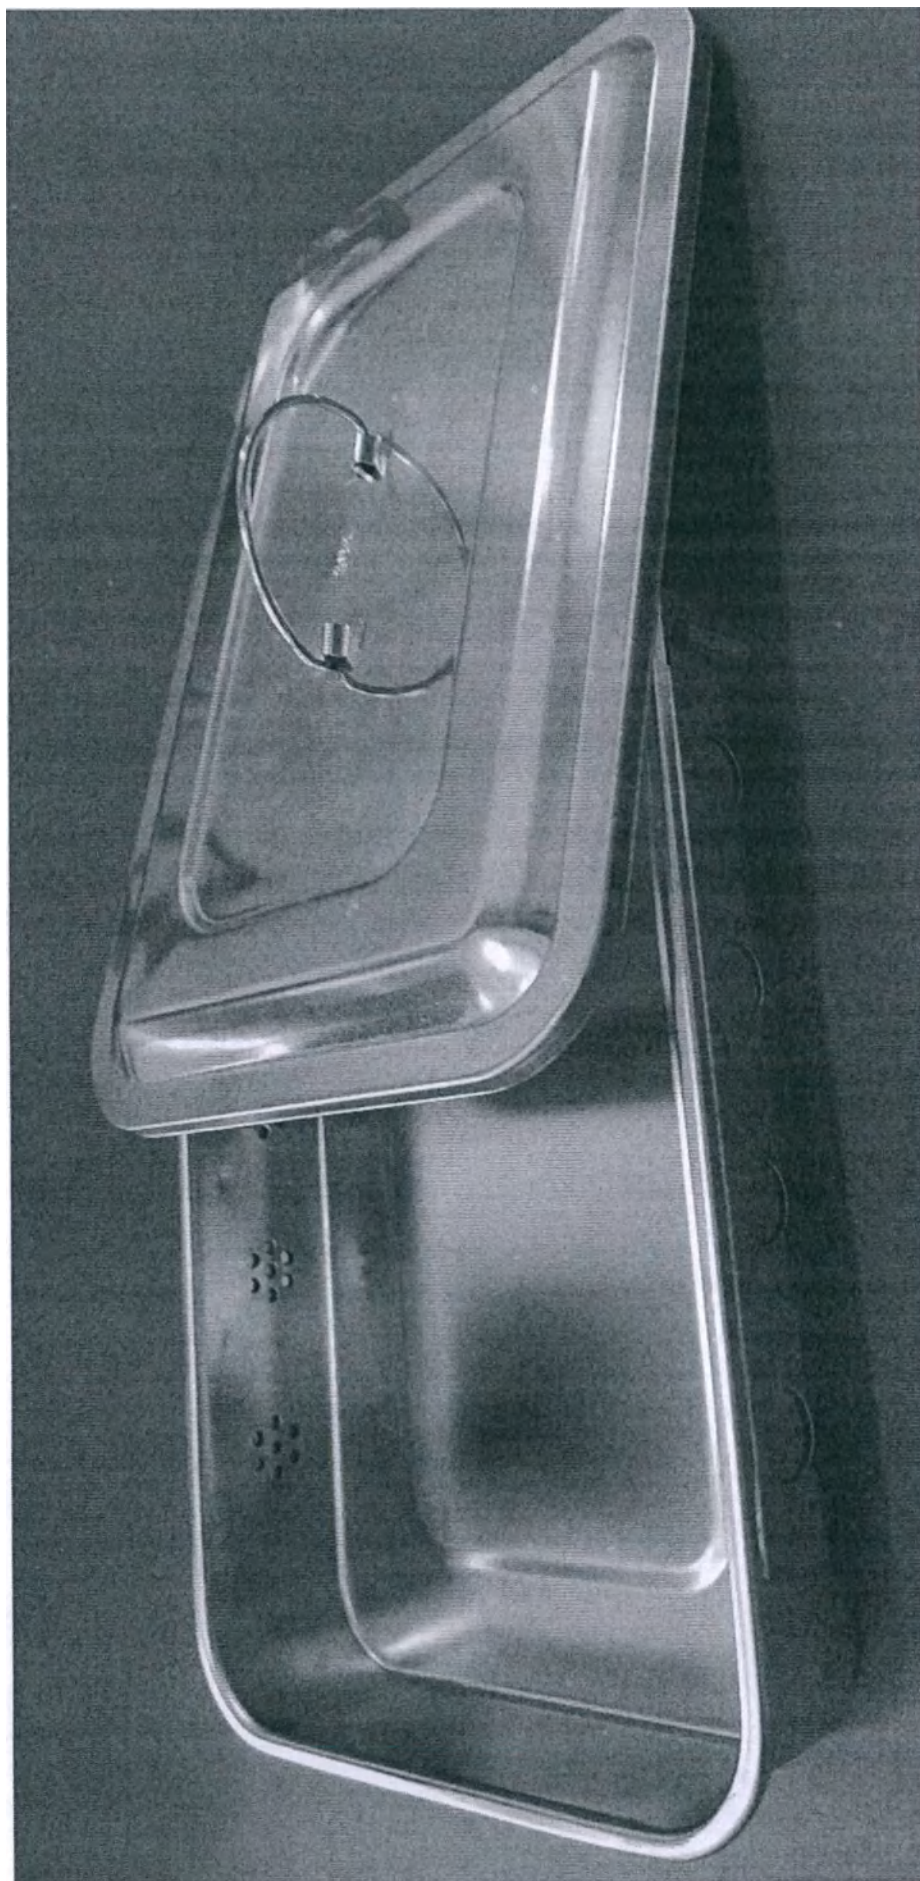


Кабель питания

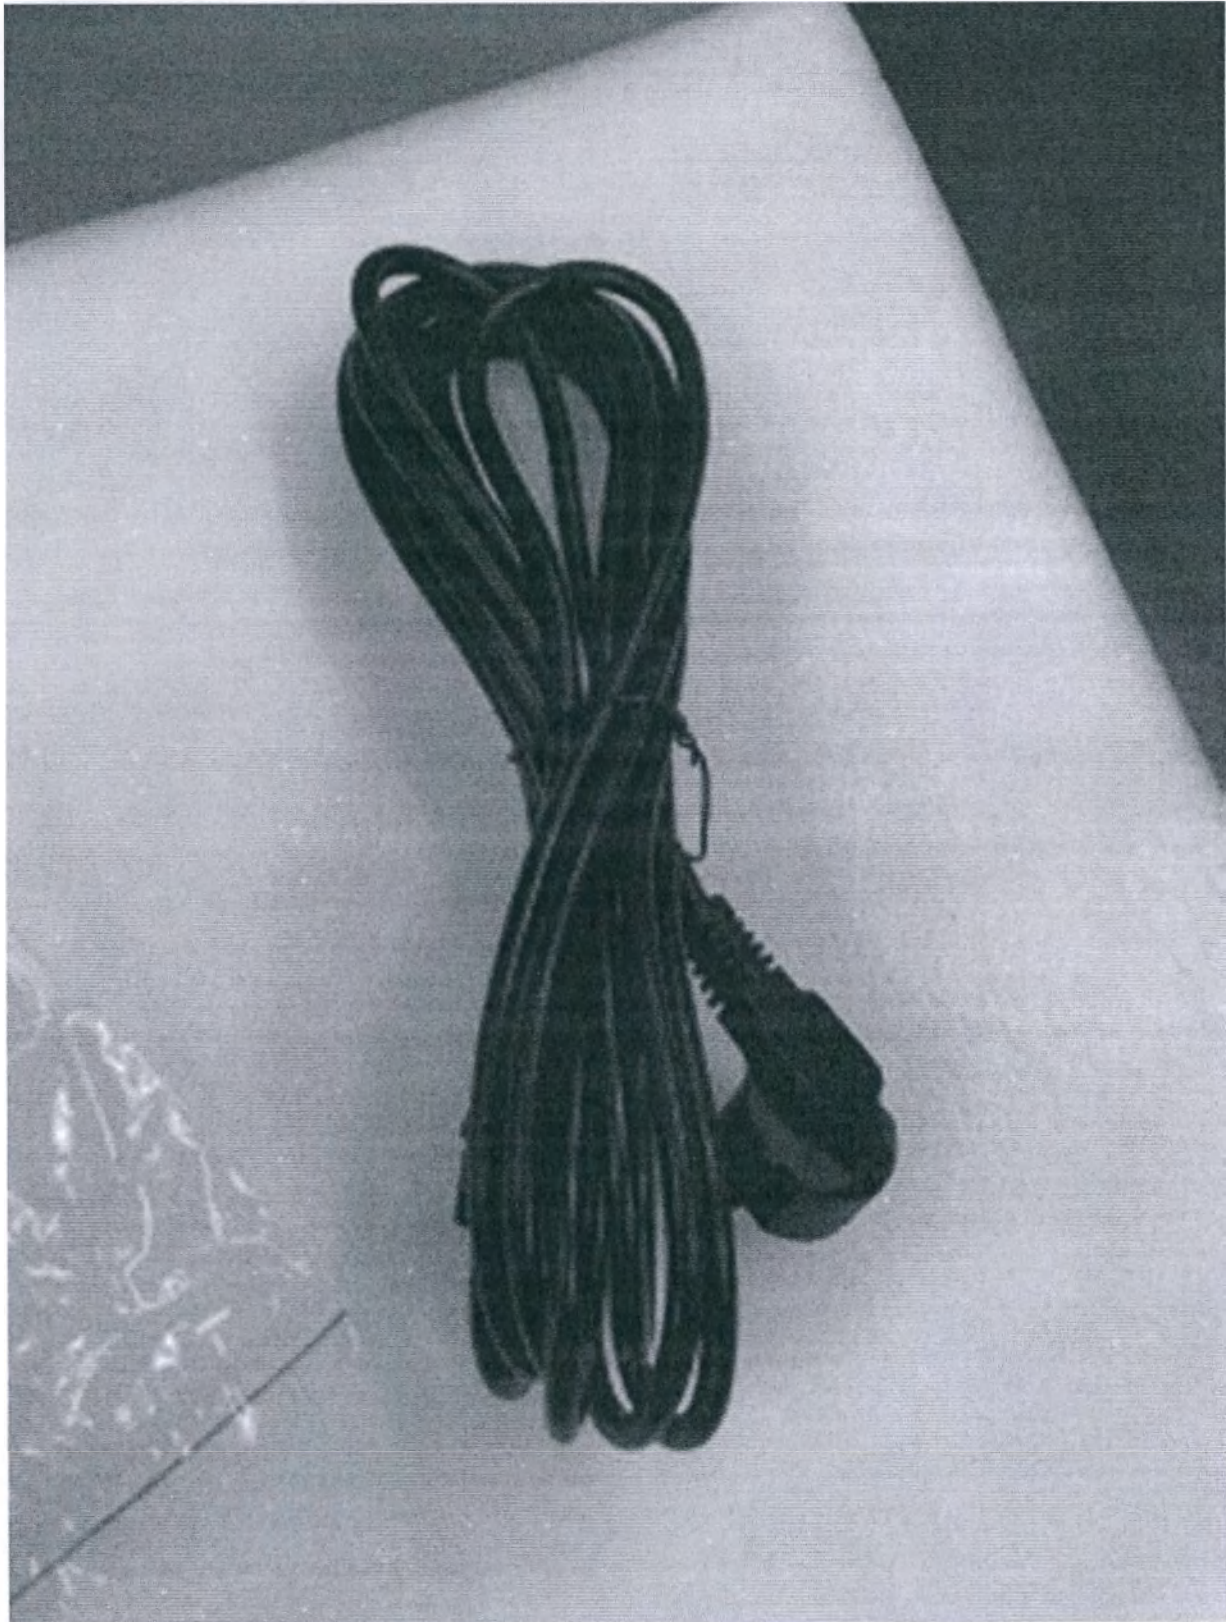


Панель управления встроенная.

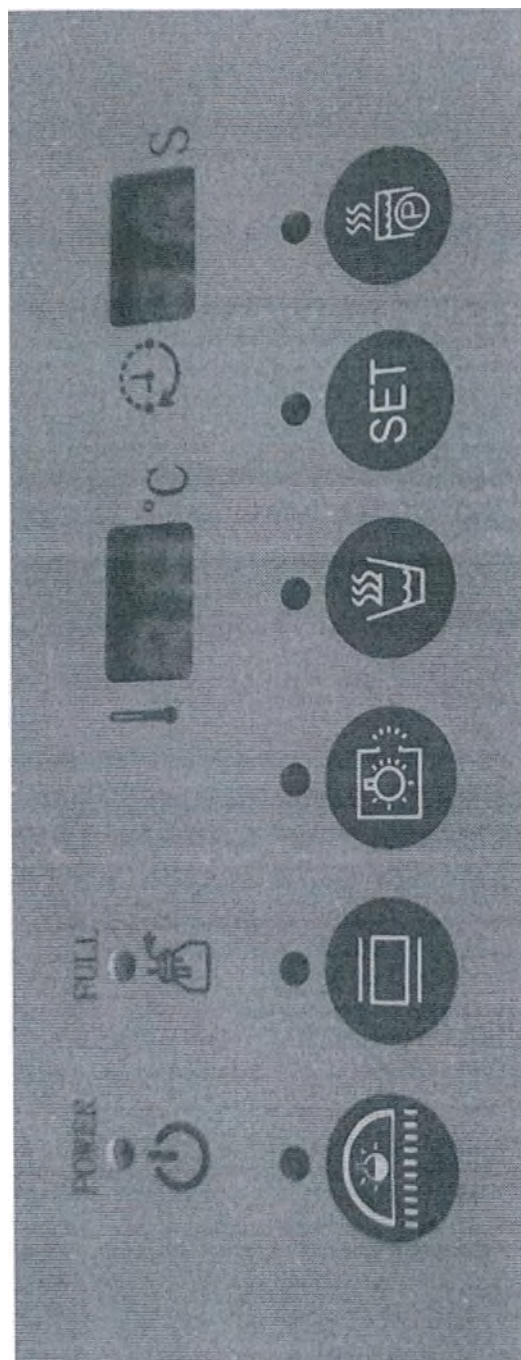


Насадка аспирационная узкая

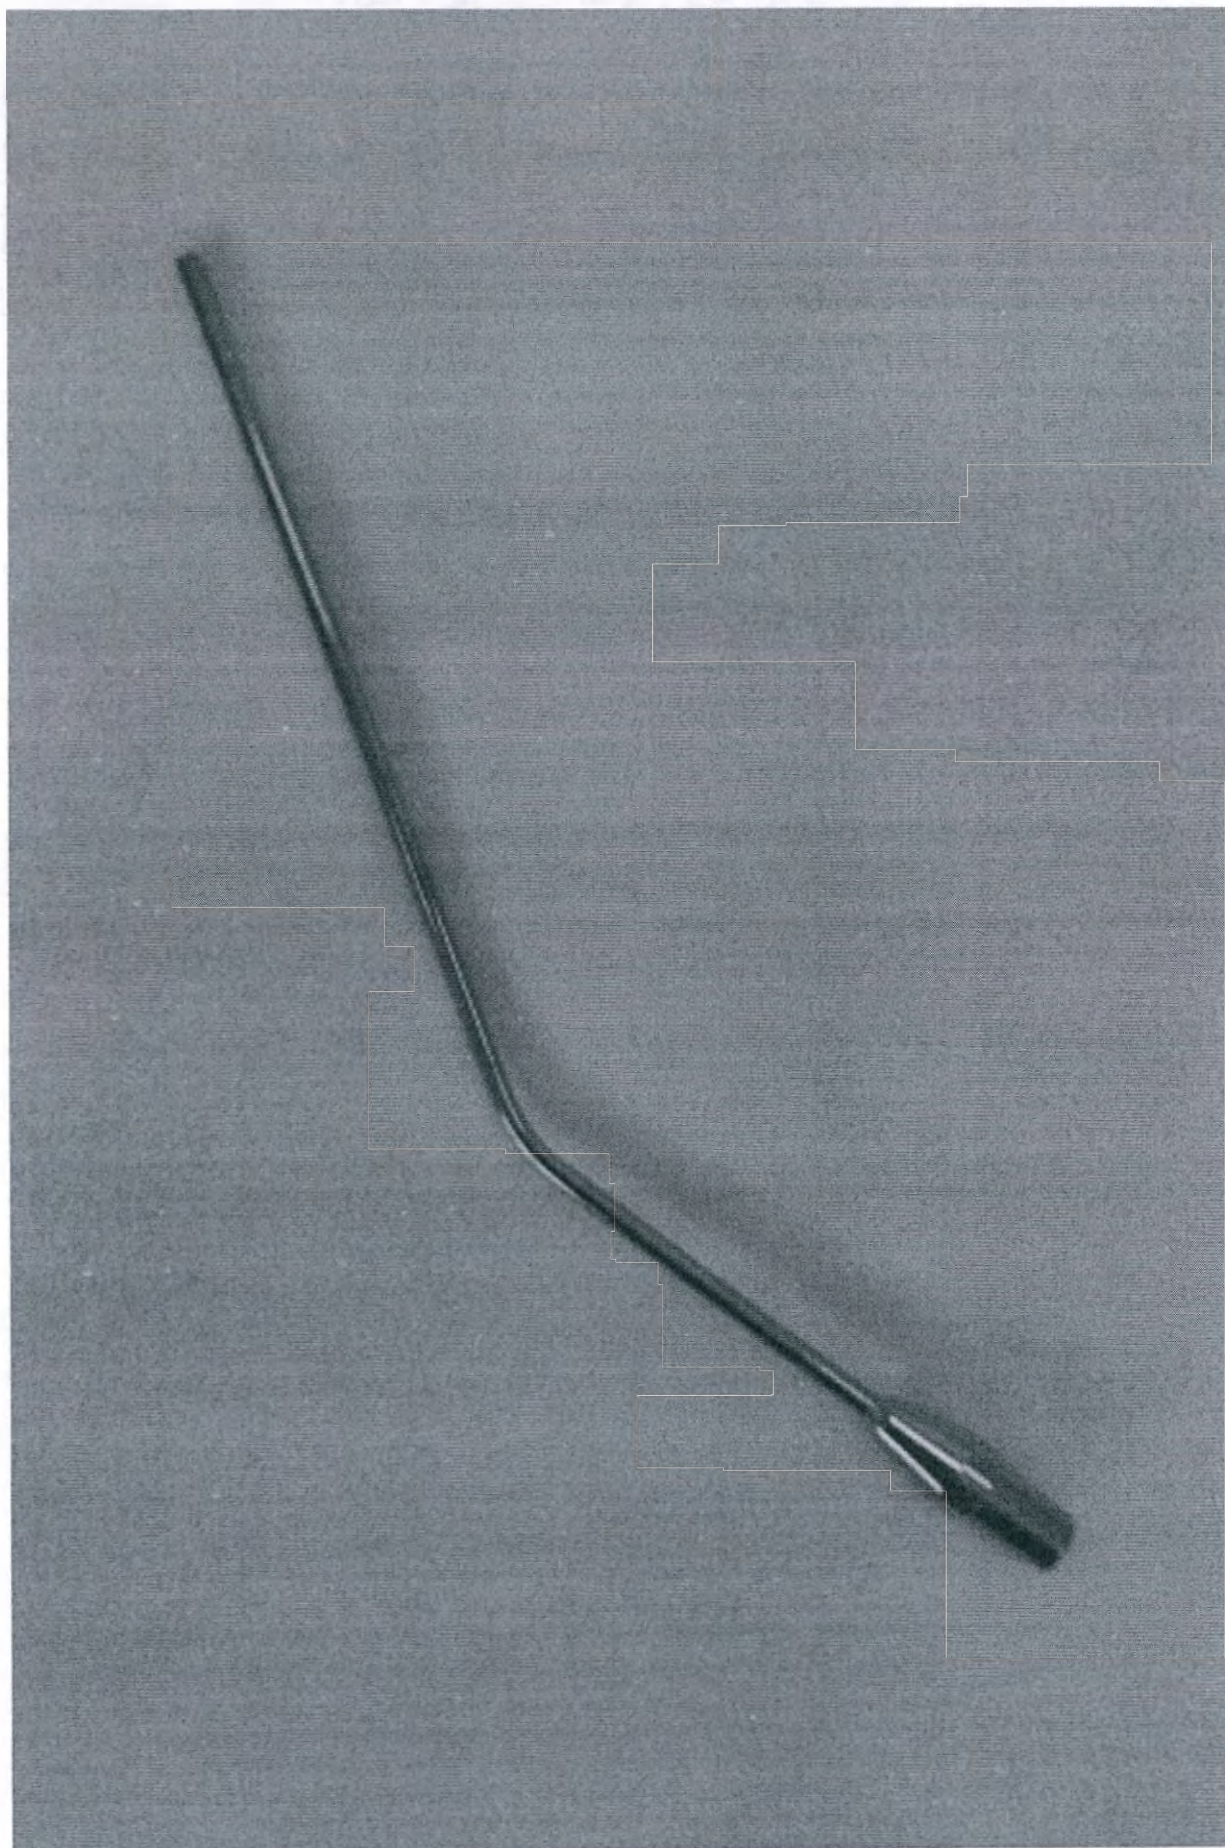

Насадка аспирационная широкая

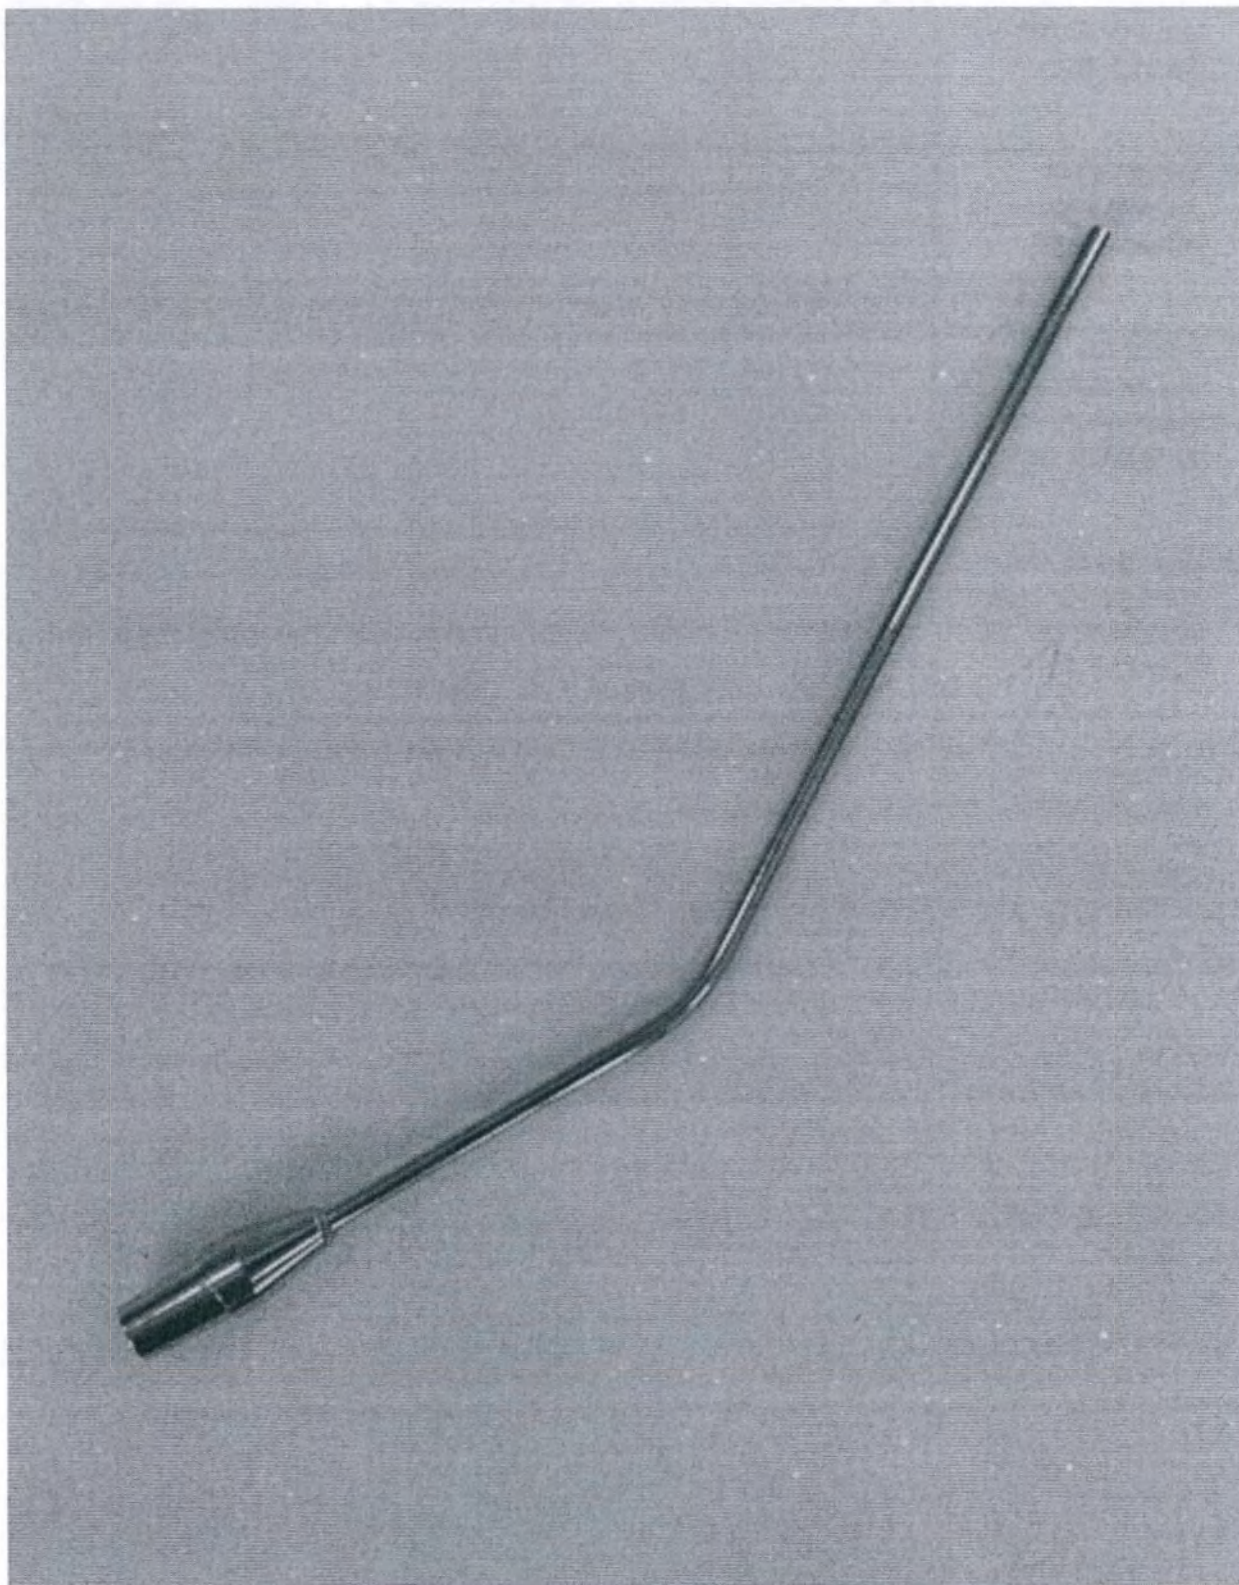


Фильтр воздушный

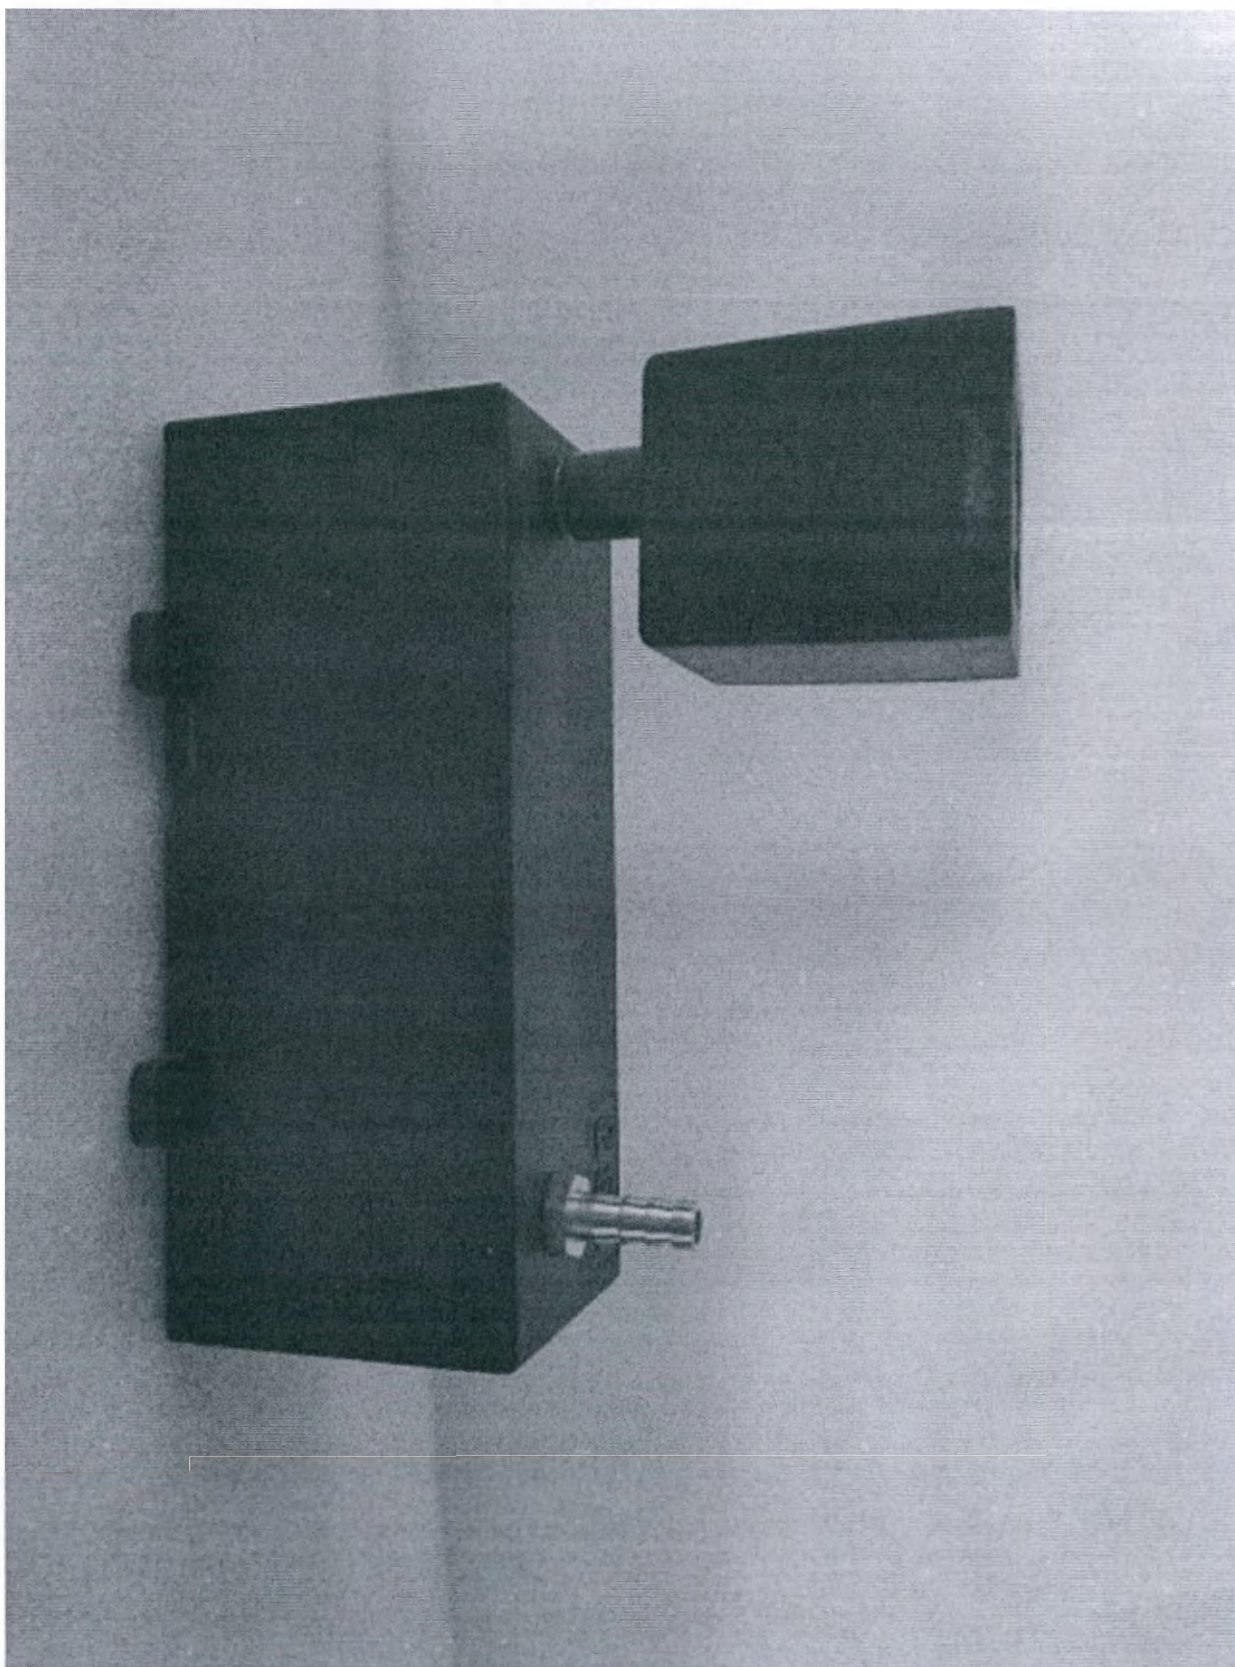


Фильтр водяной




Компрессор воздушный

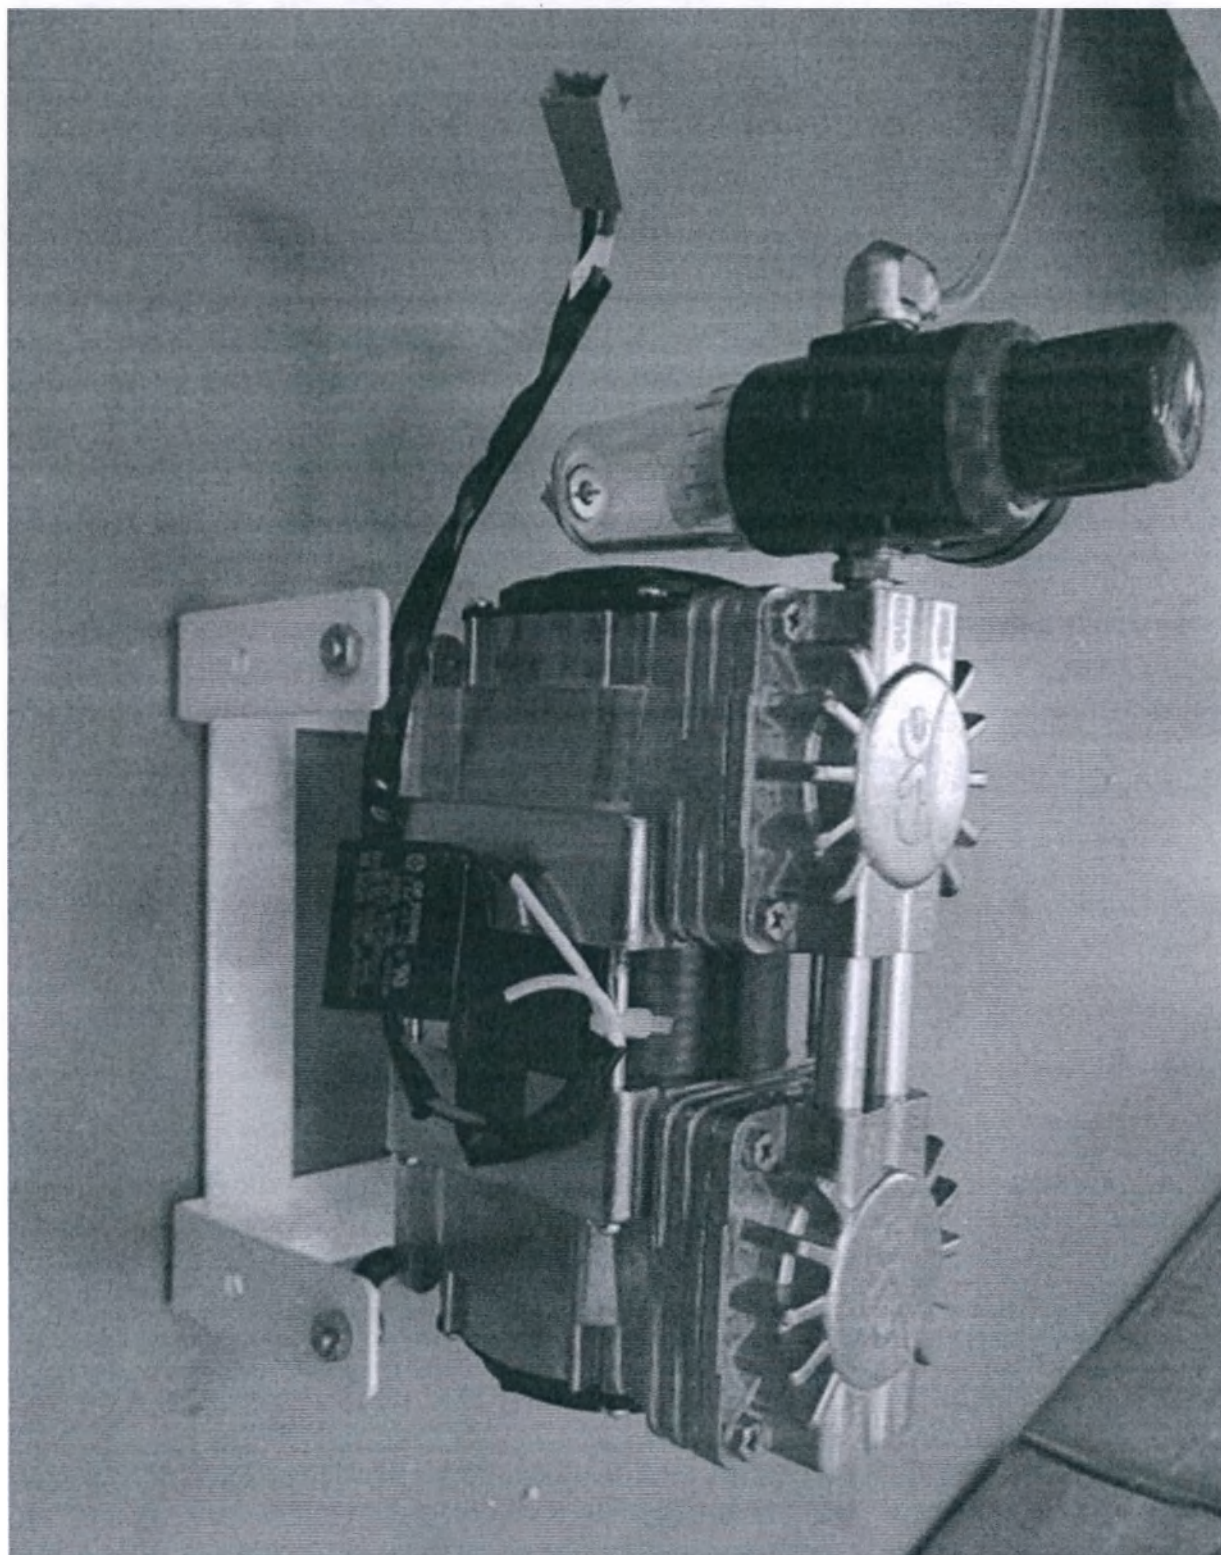


Насос вакуумный

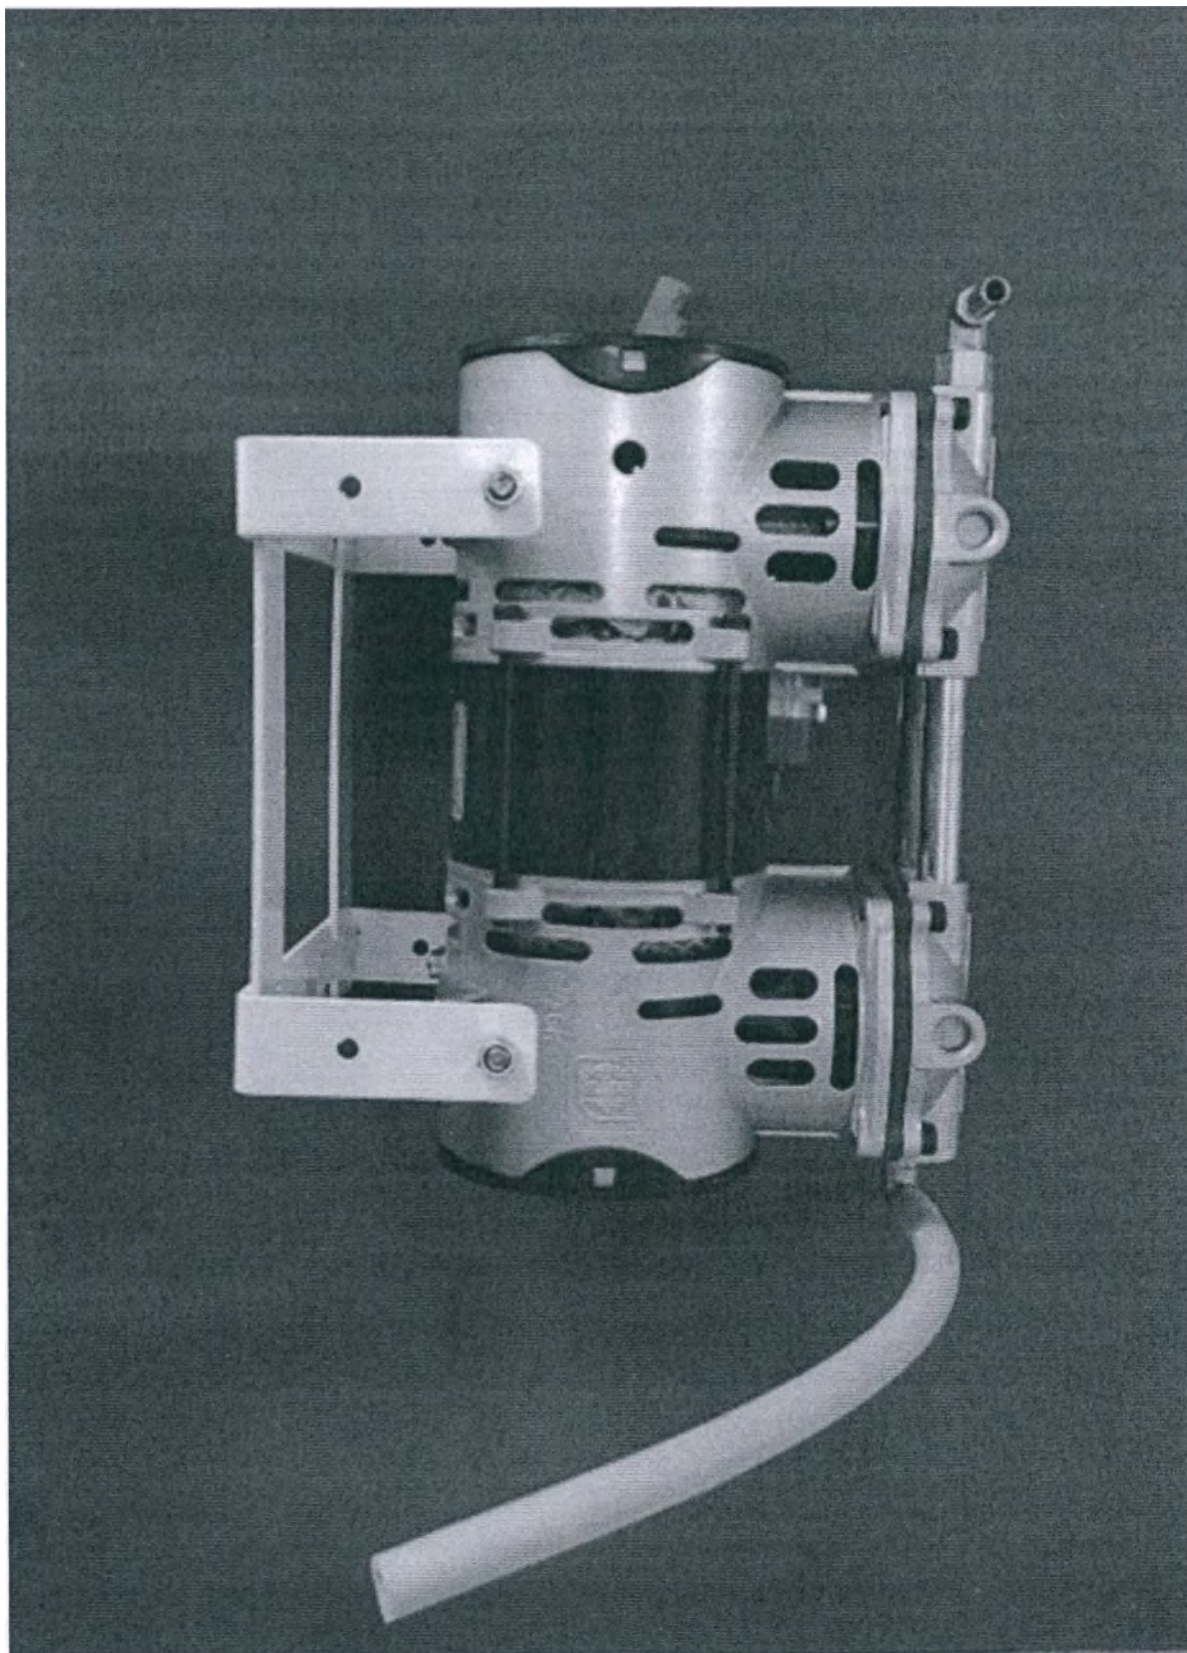


Крышка емкости для секрета объемом 2500 мл

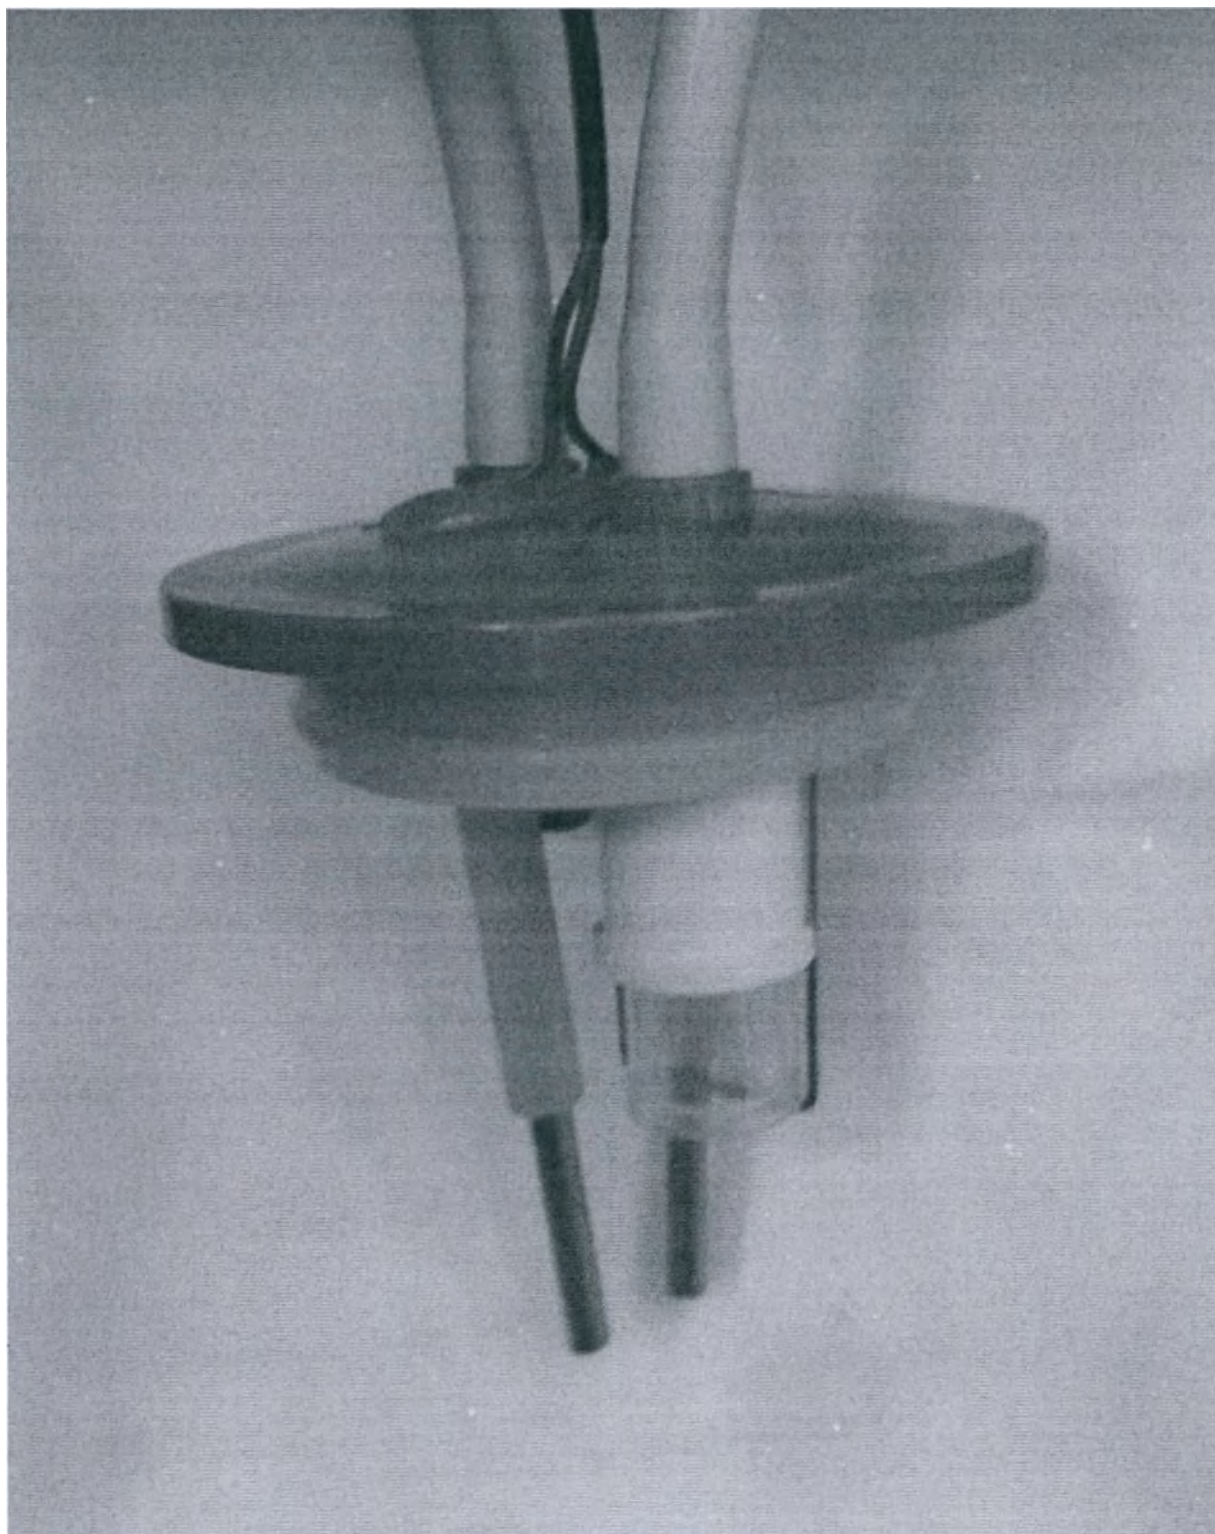


Крышка емкости для секрета объемом 500 мл

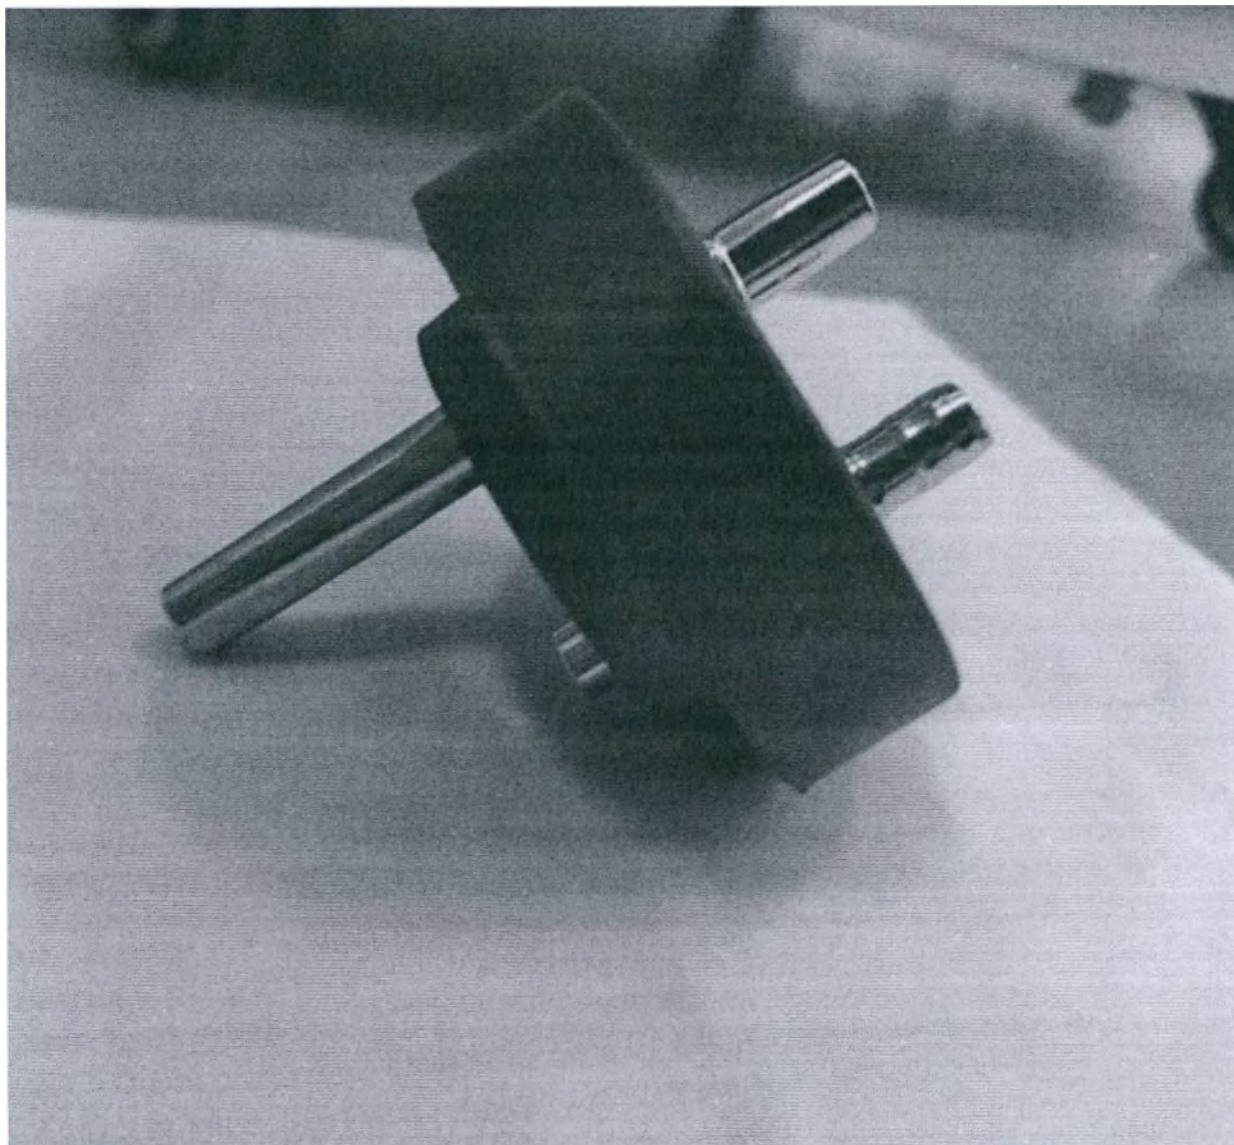


Коннектор

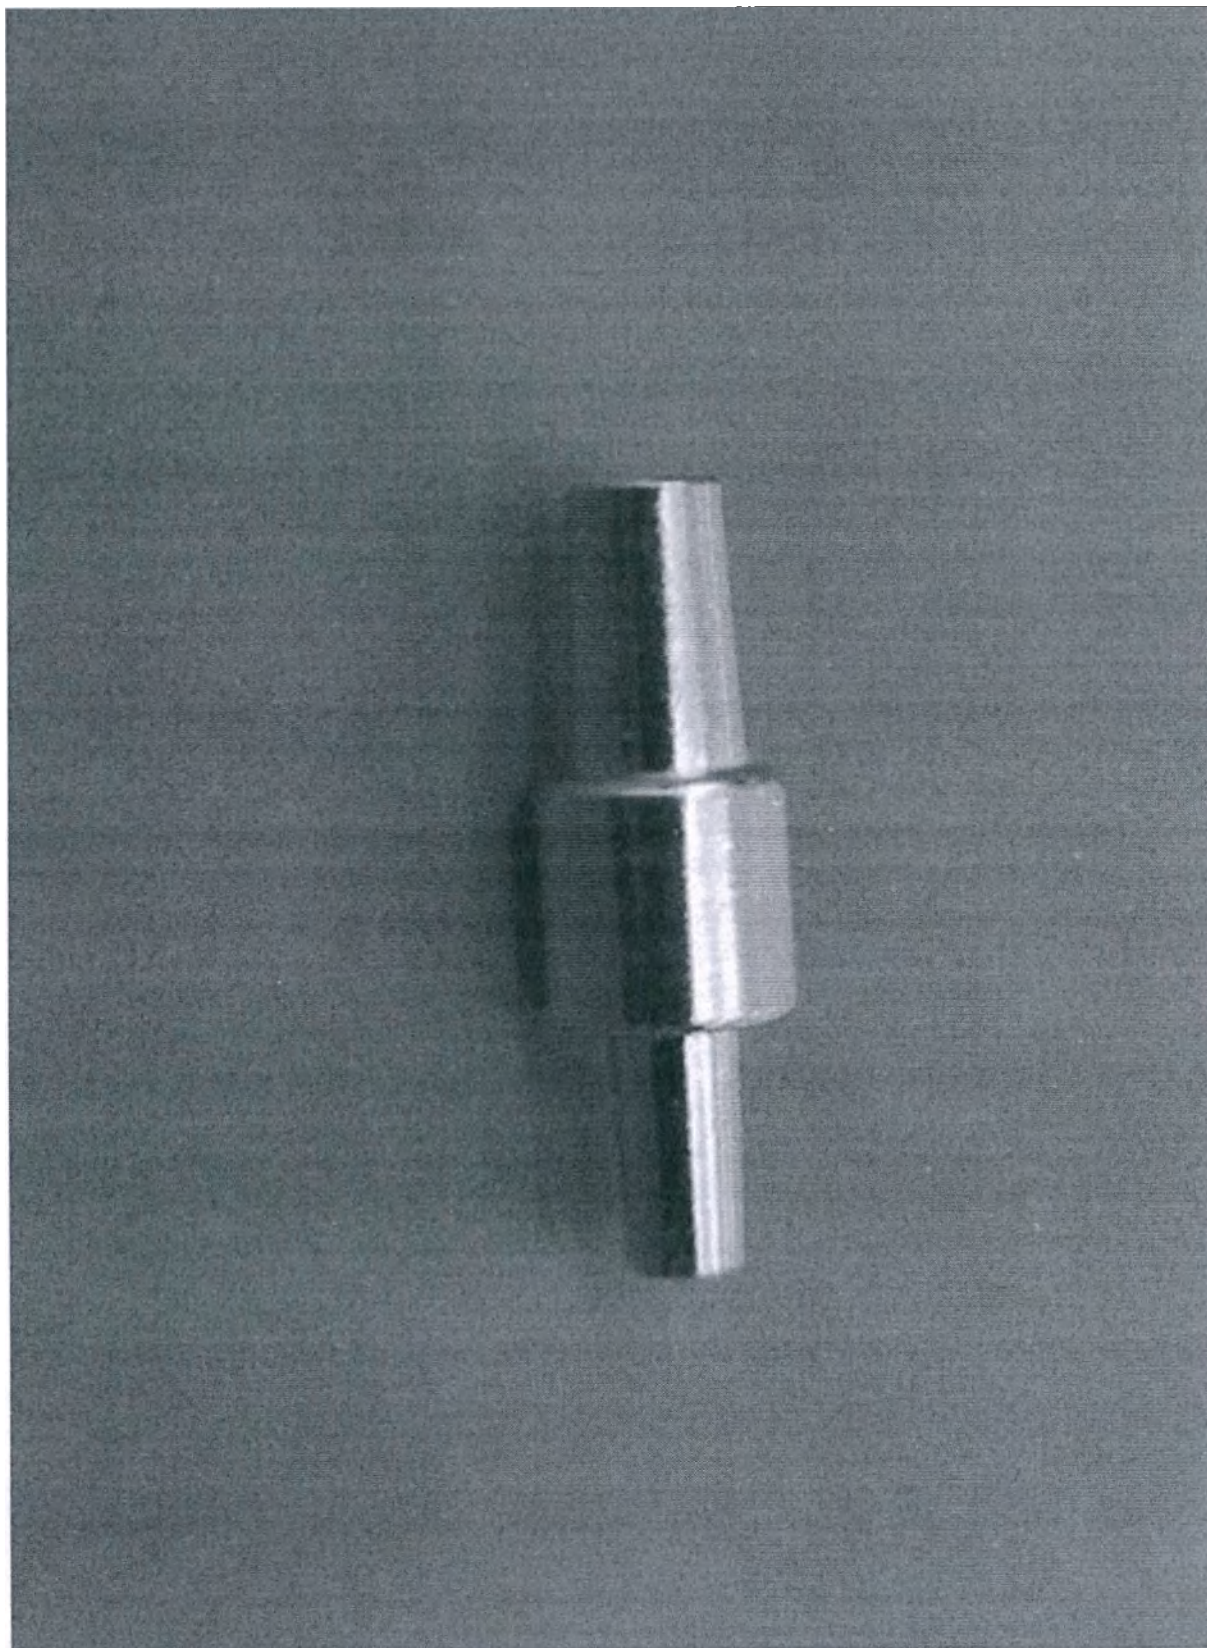


Индикатор давления воздушного потока.

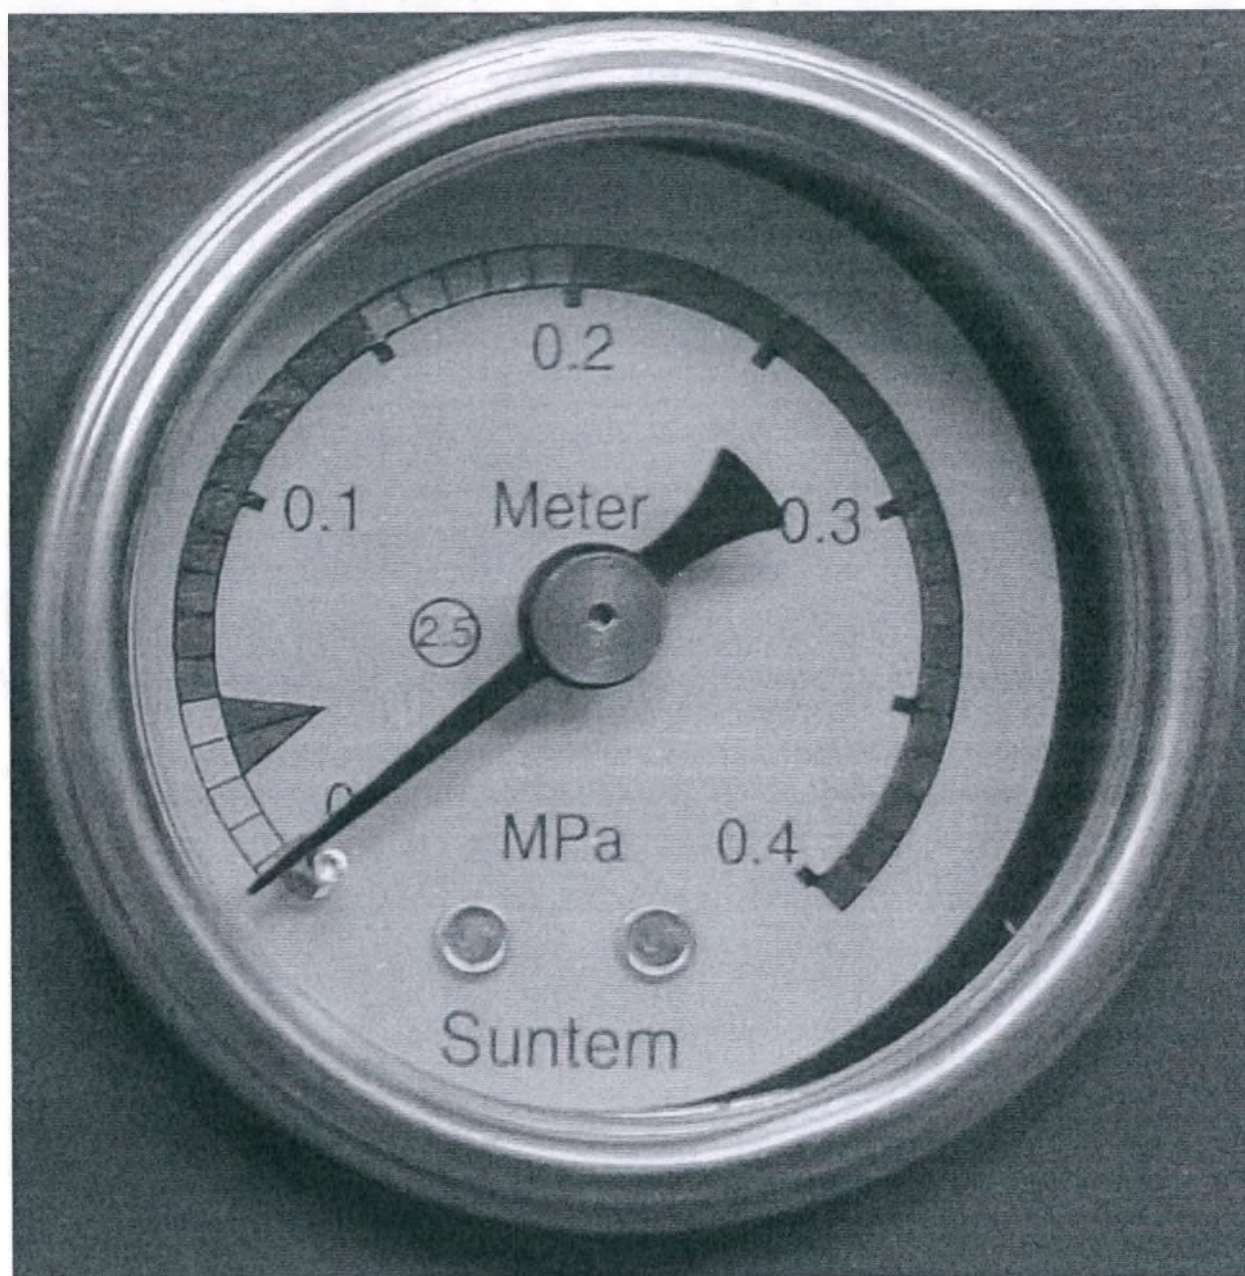

Крышка аспирационного отсека.

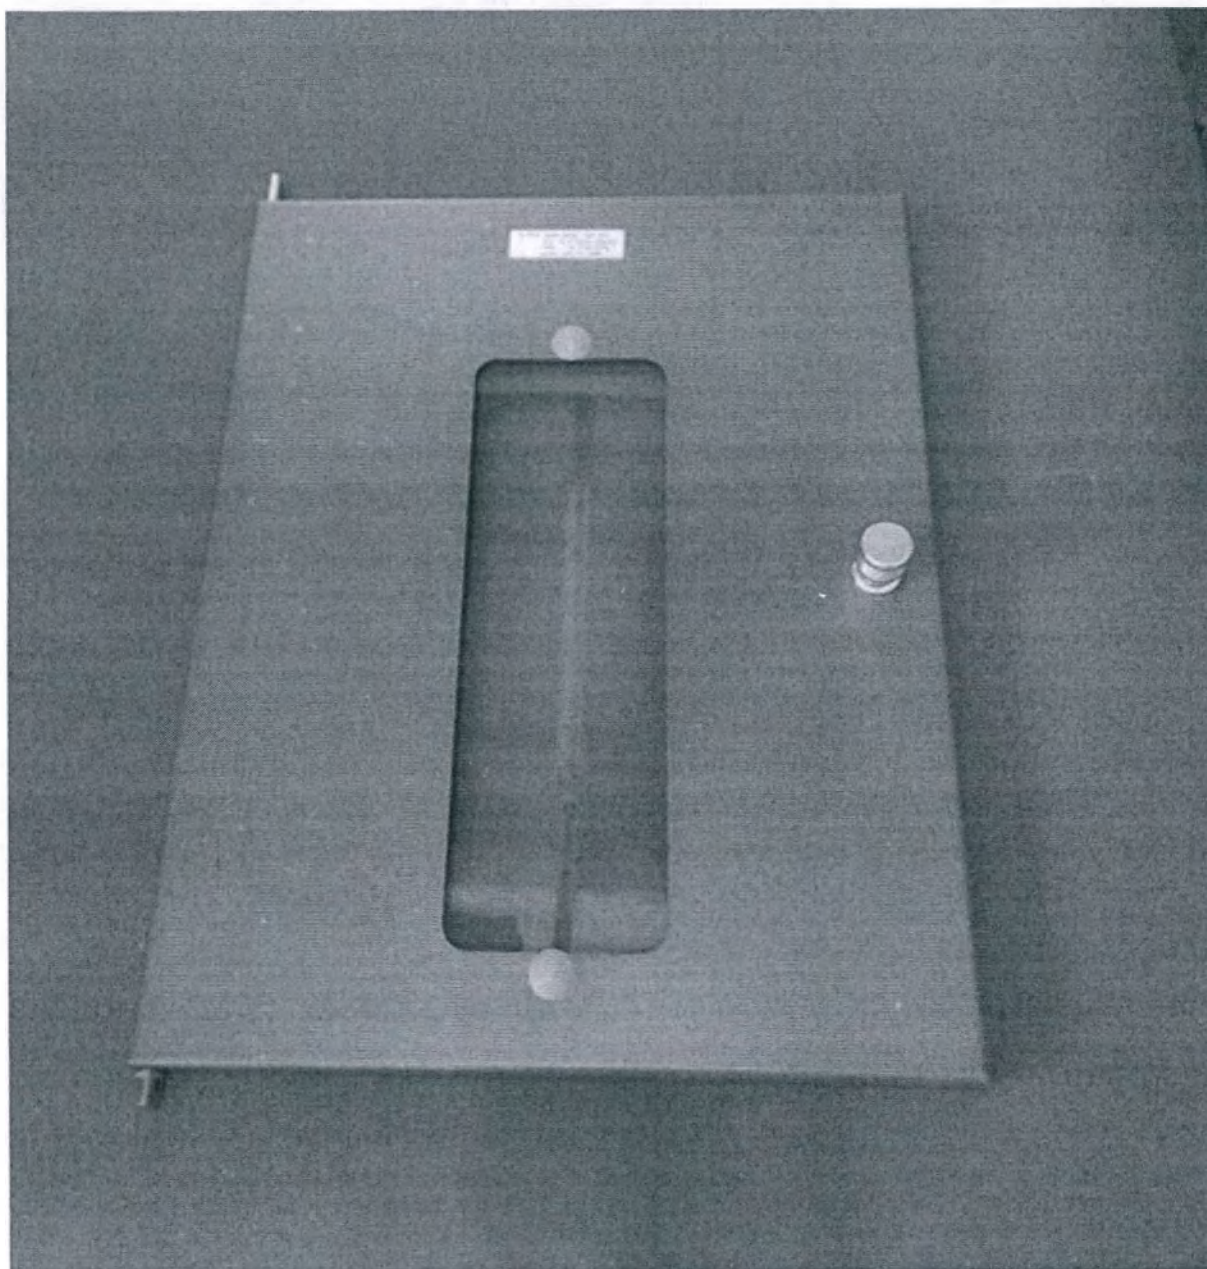

Сетка устройства предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал.

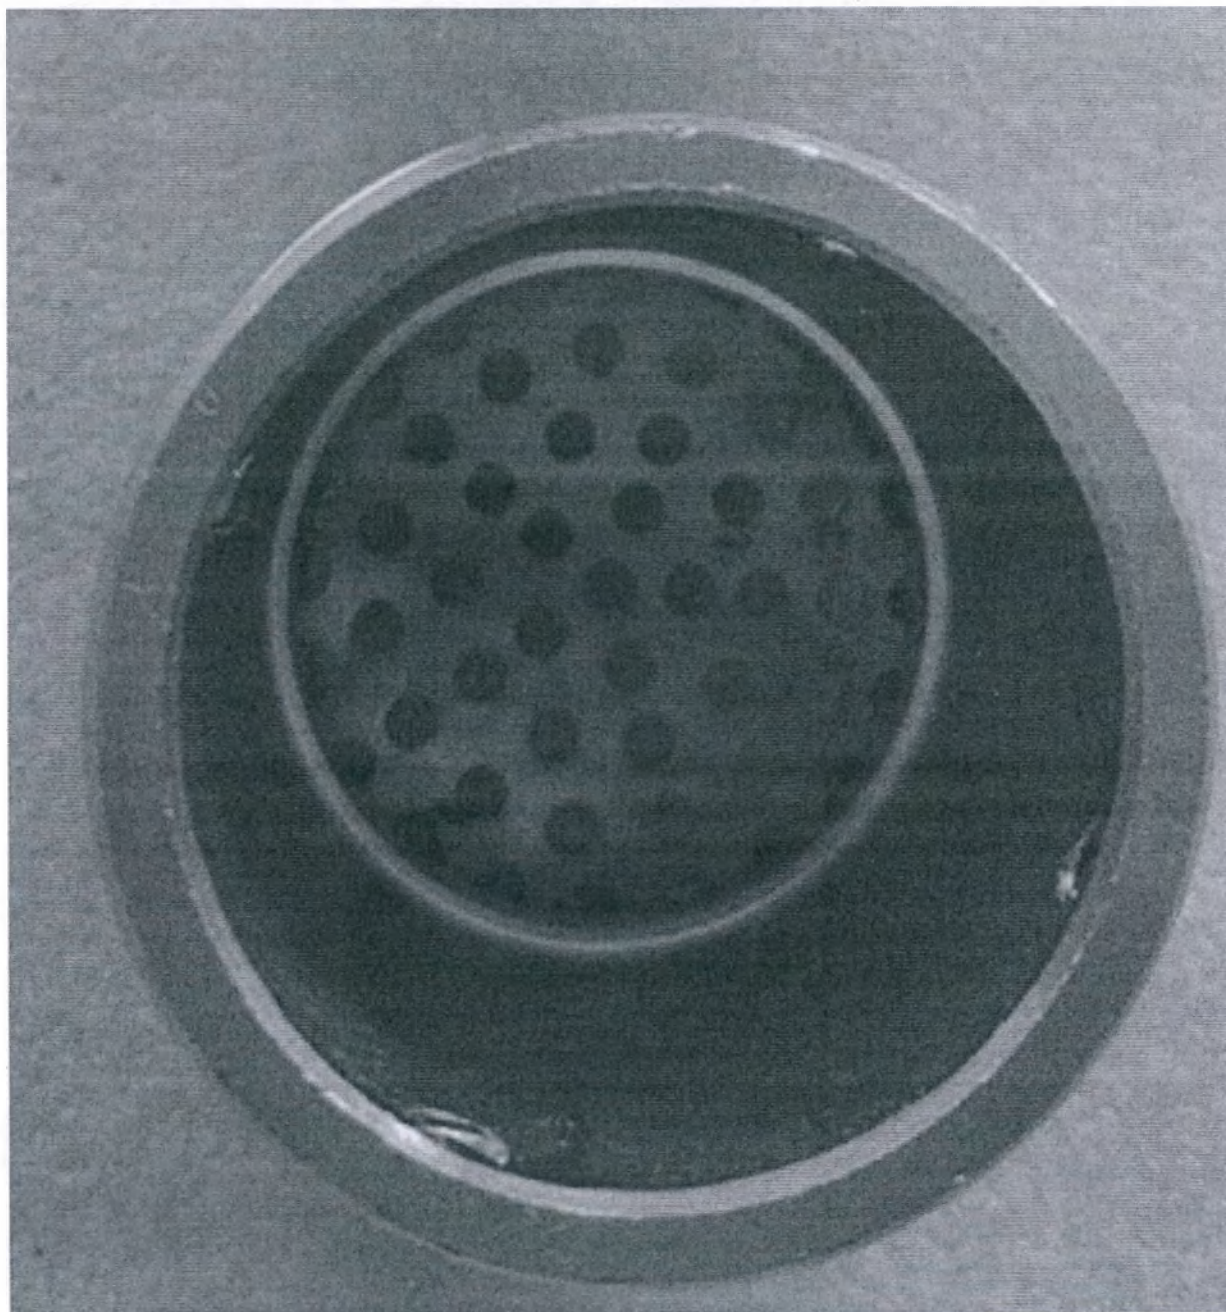

Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации


|

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА DIXION ST


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ DIXION ST-E500




Встроенный источник холодного света.

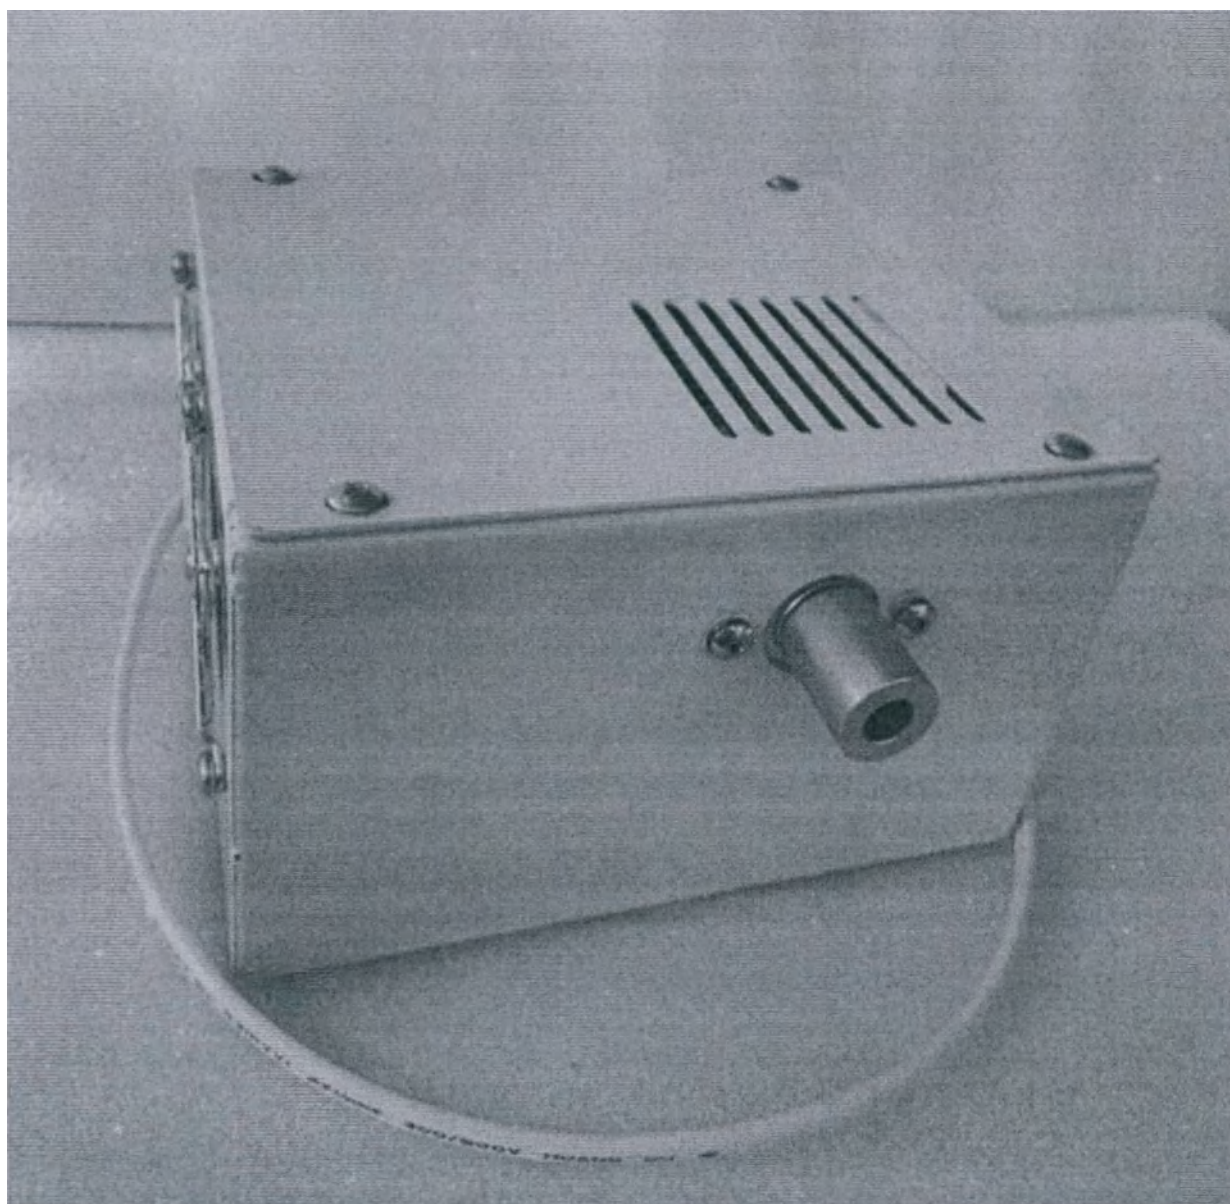


Негатоскоп специальный.

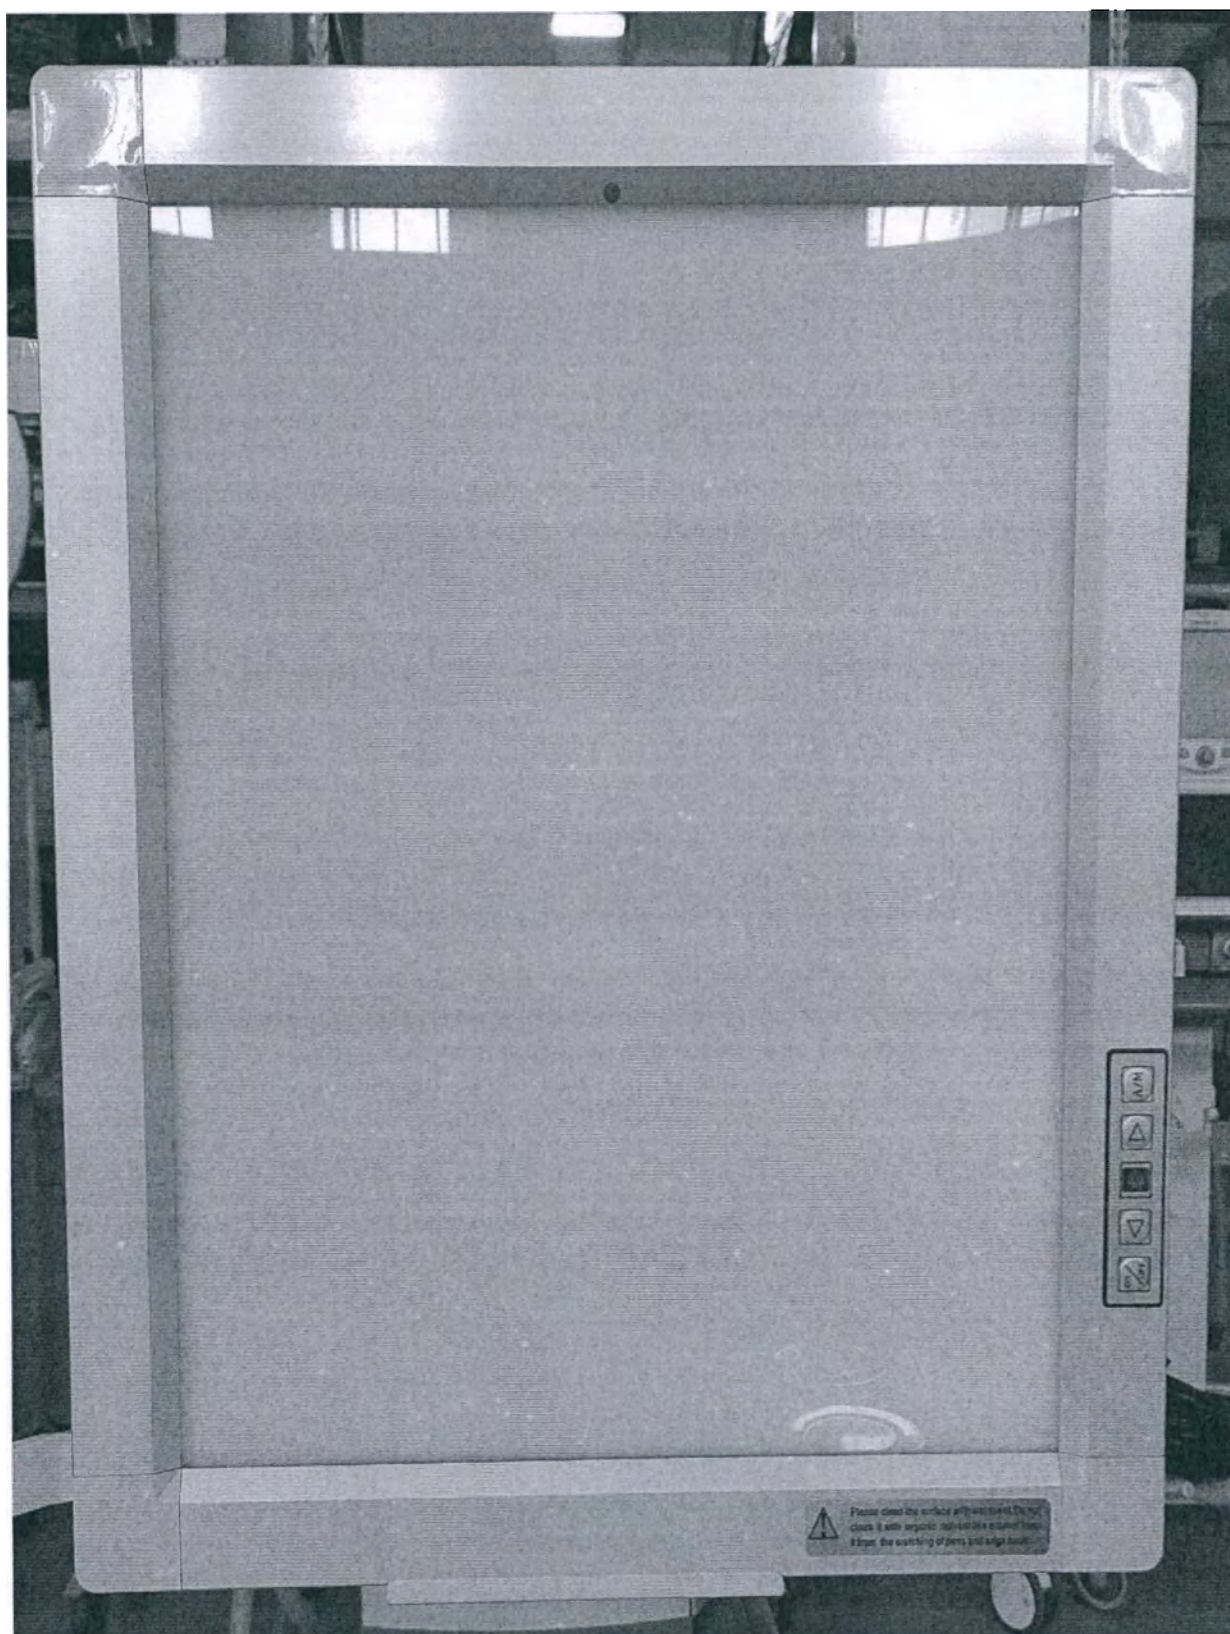


Держатель негатоскопа специального.

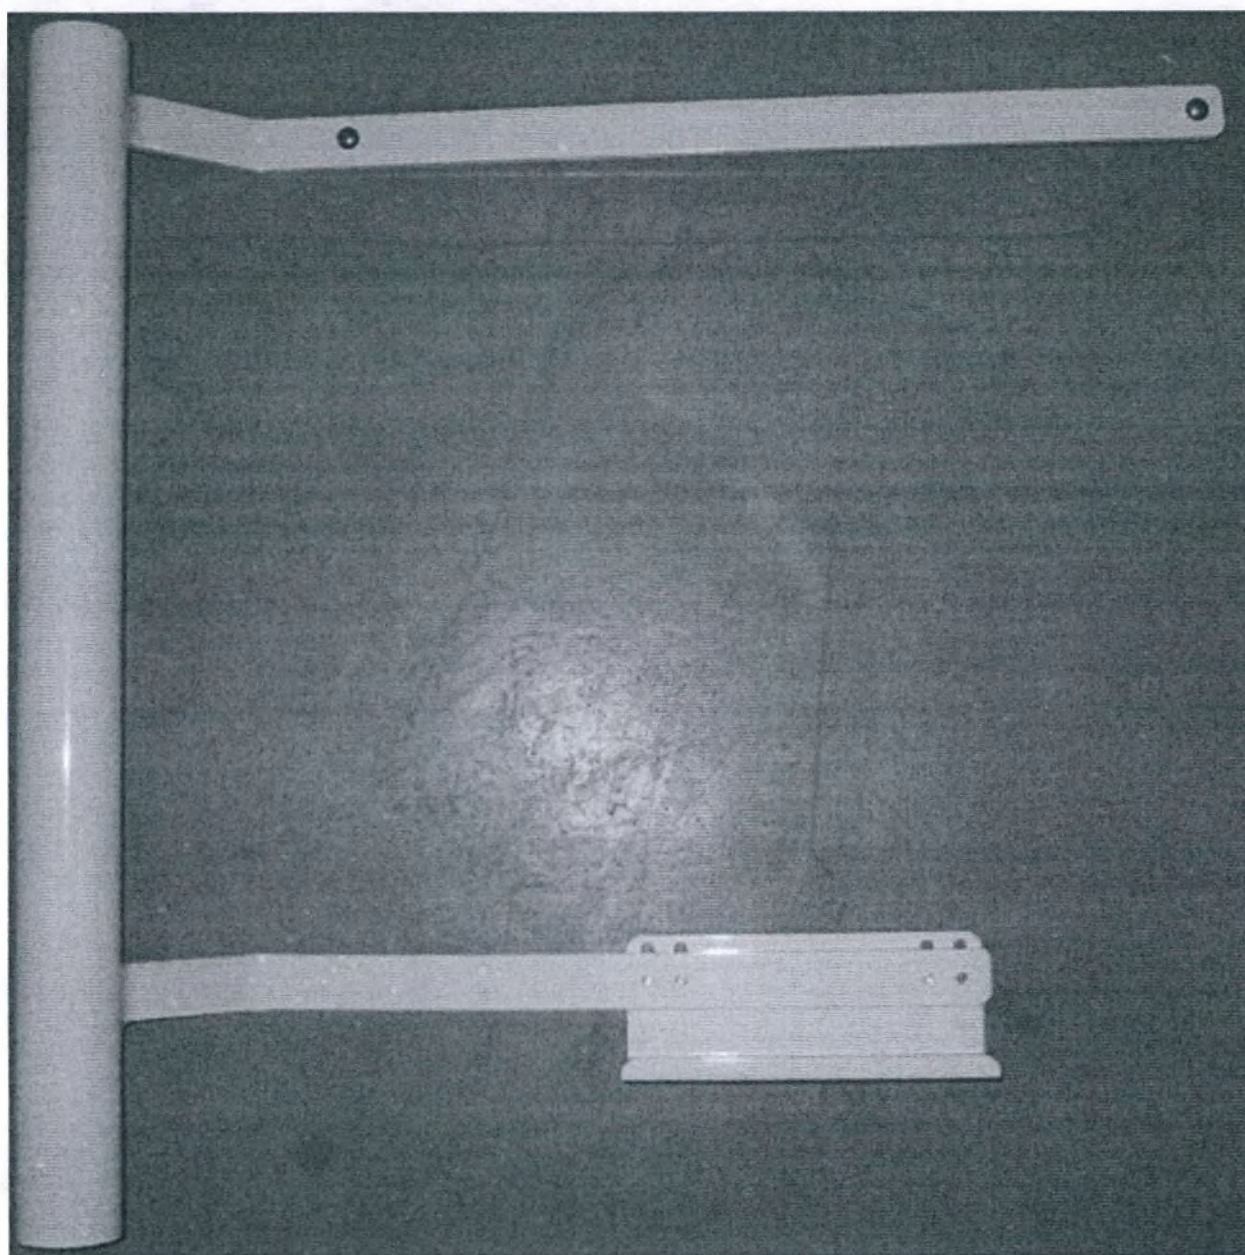


Прокладка

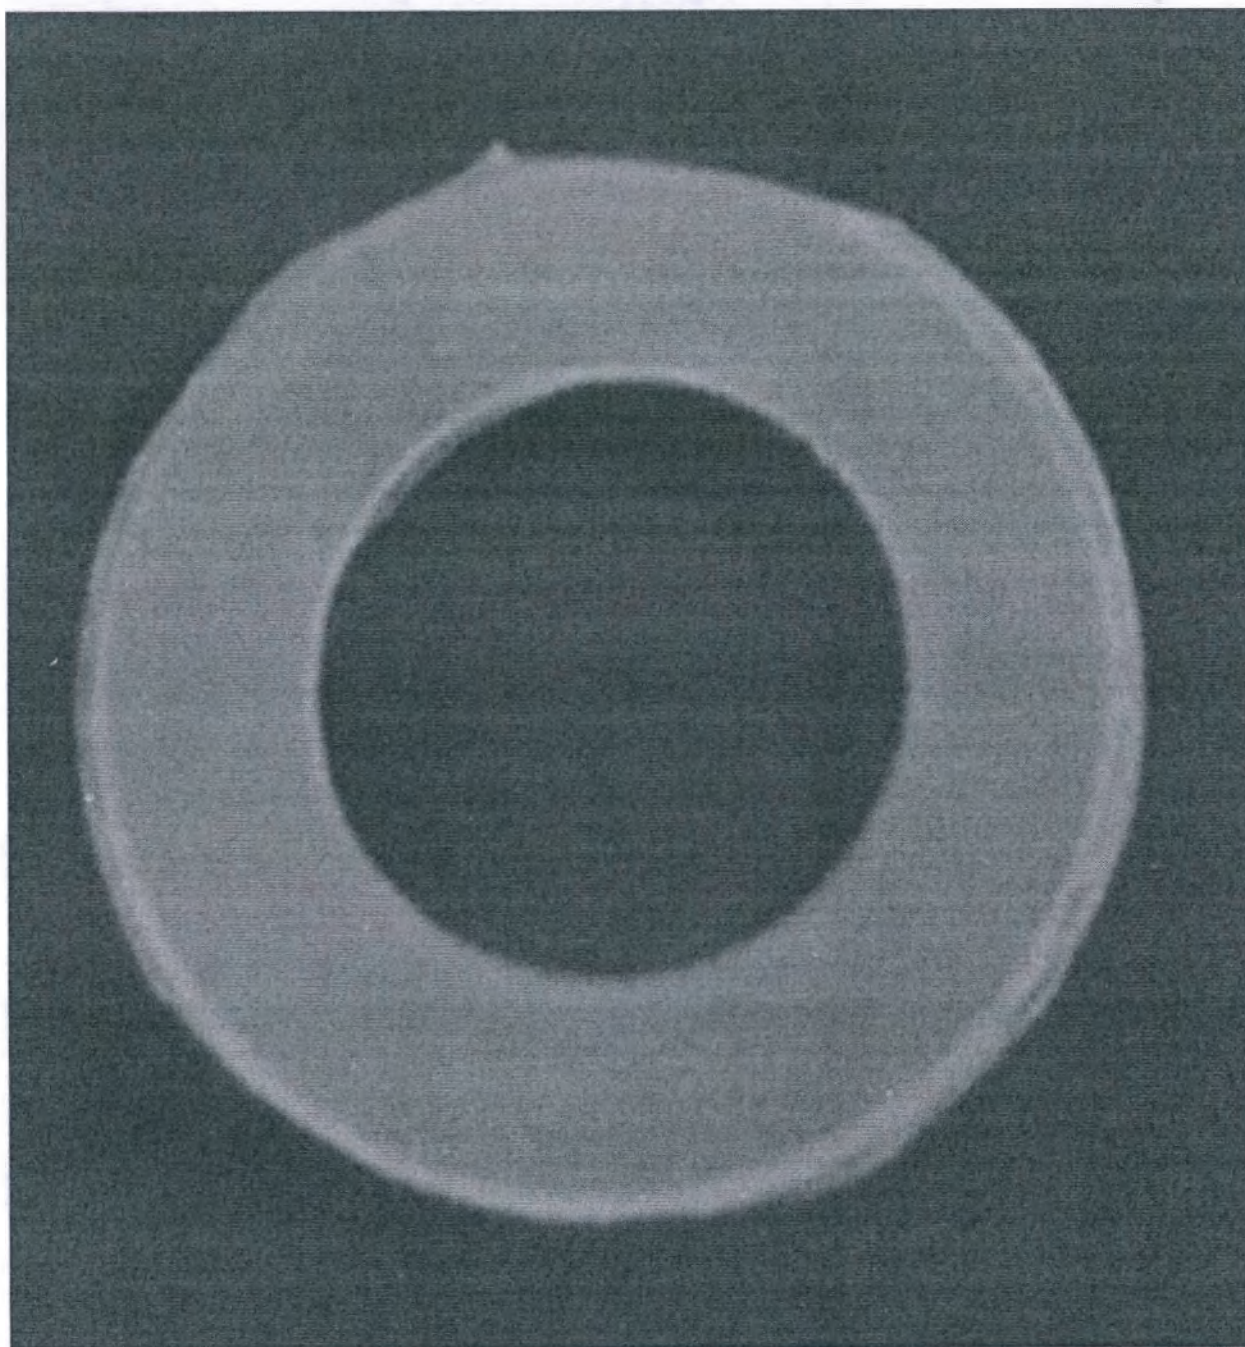


Клапан водяной.

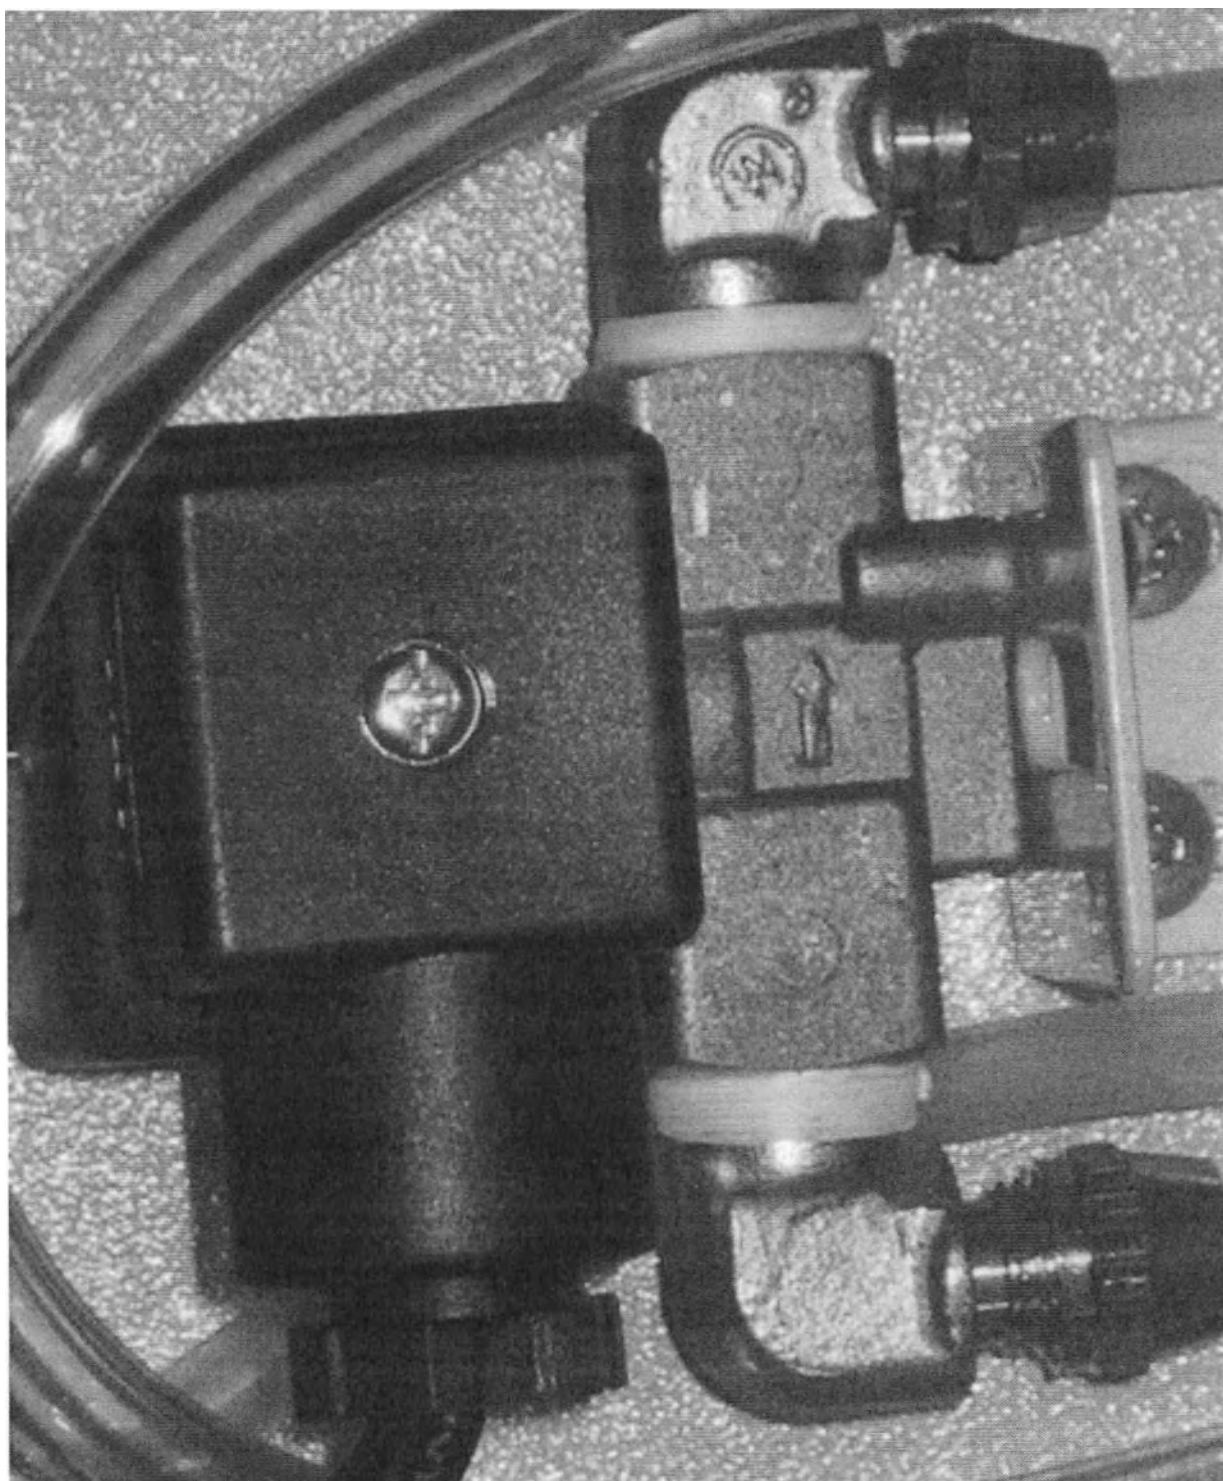


Клапан воздушный.

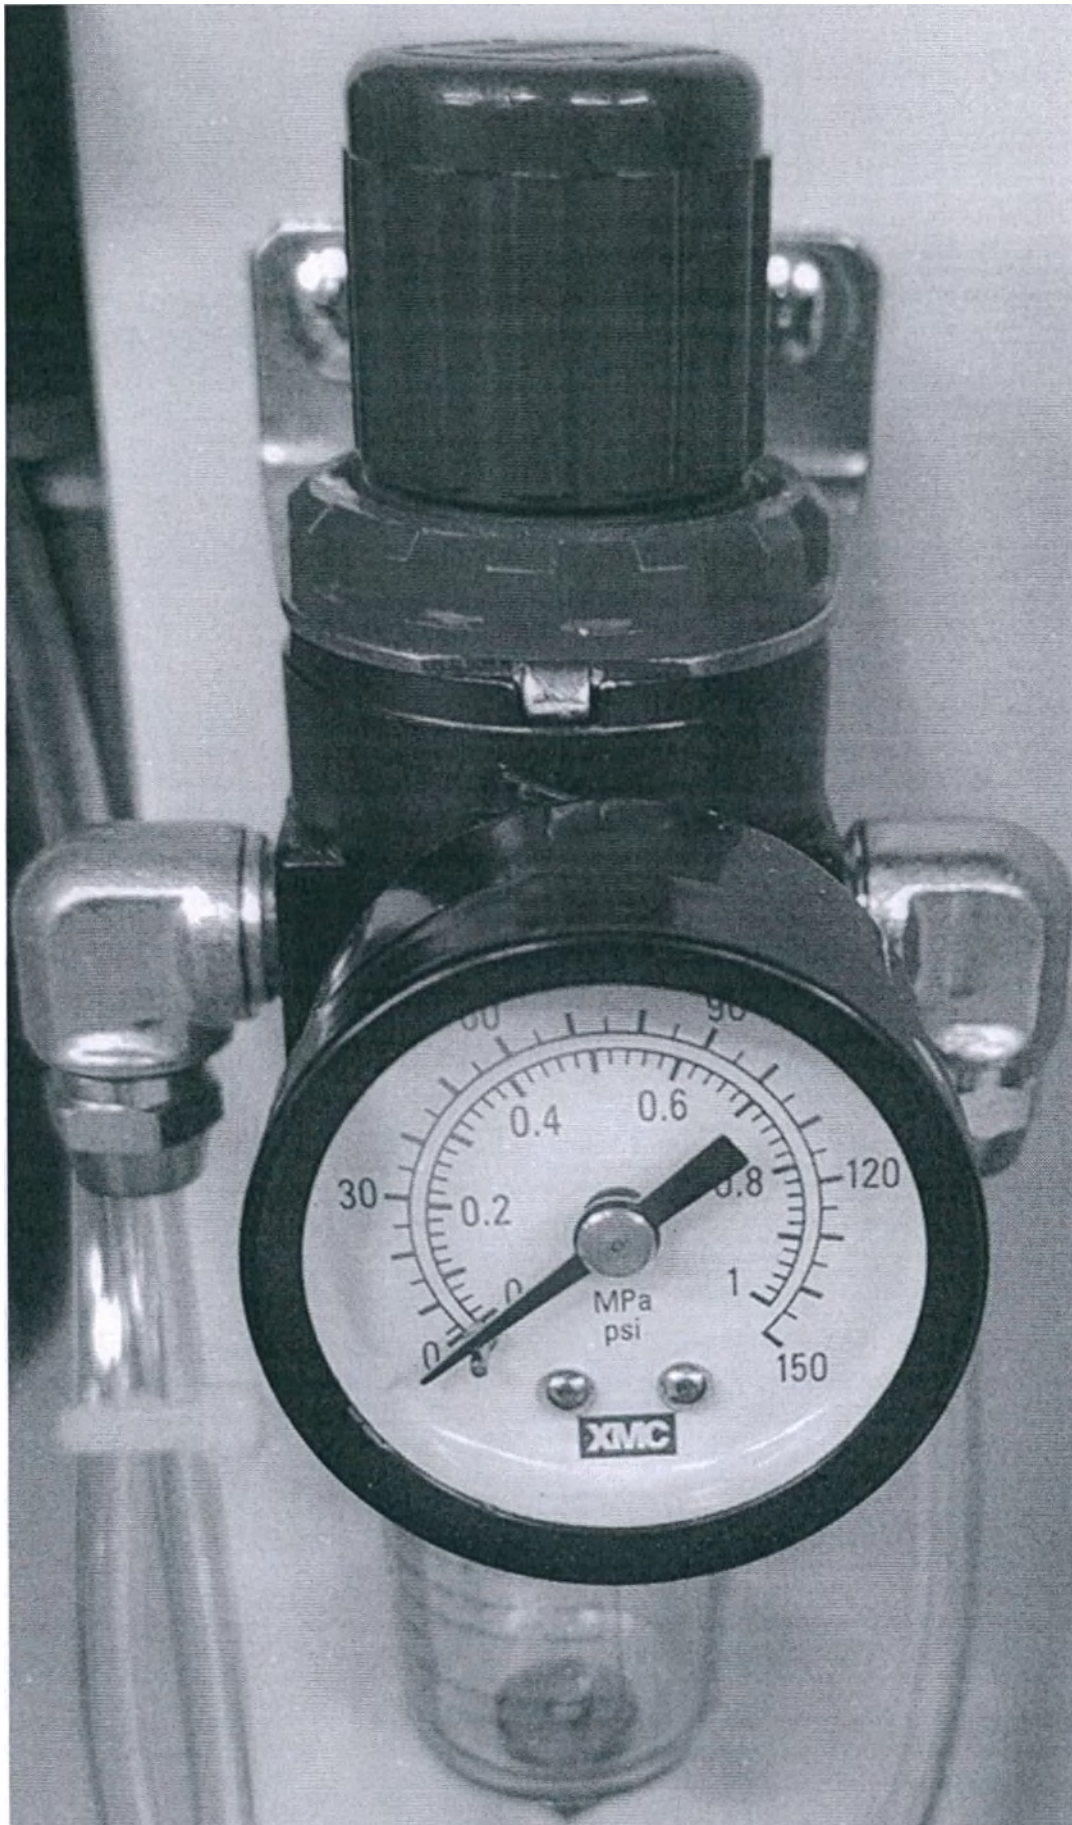


Датчик давления воздушного потока

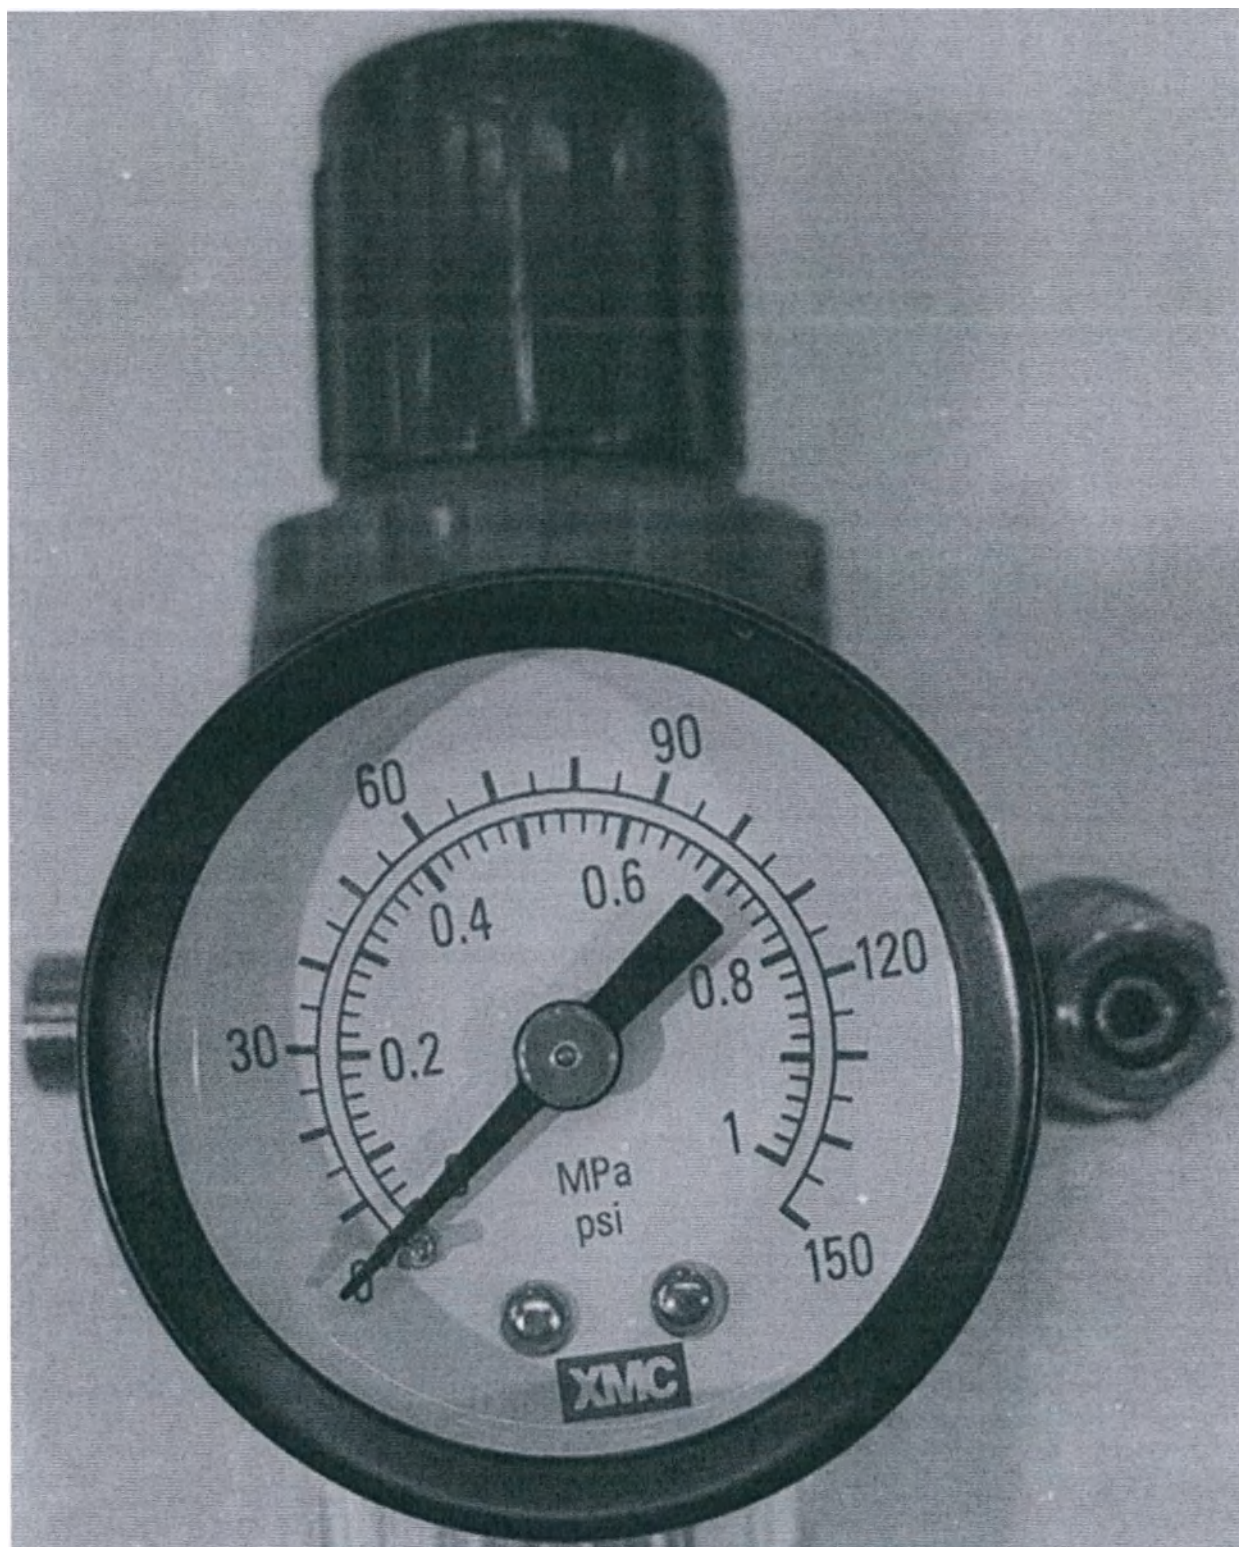

Нагревательный элемент.

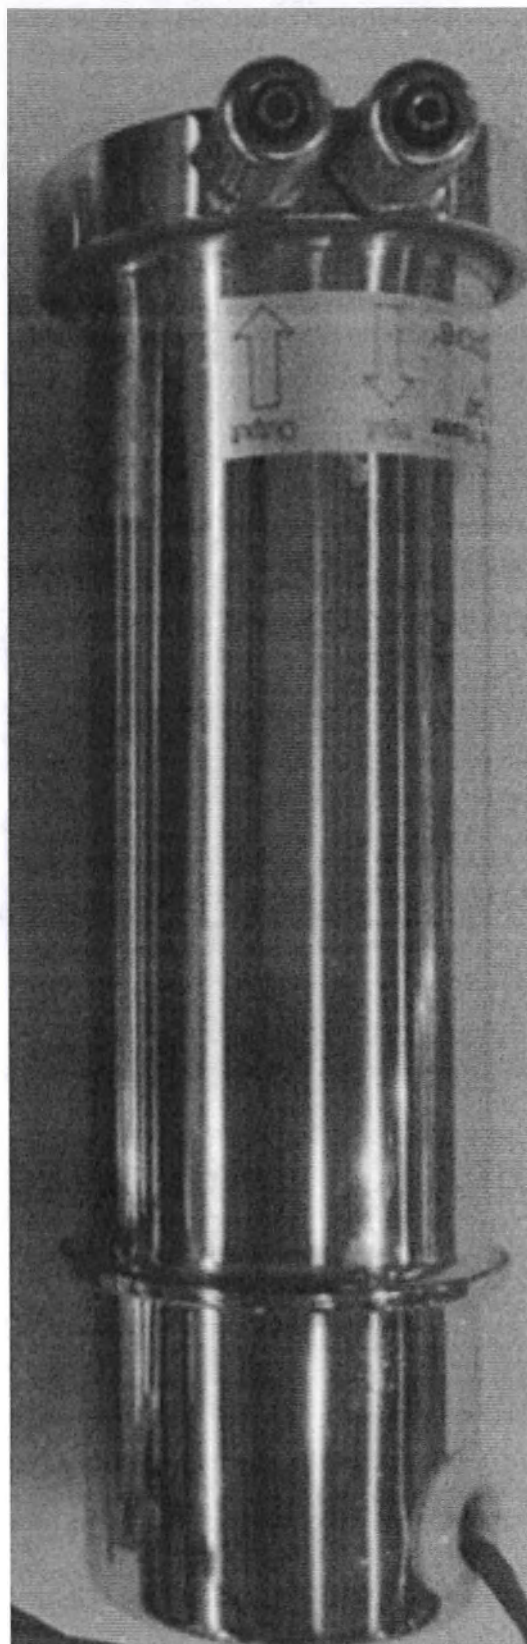

Гильза для отсоса

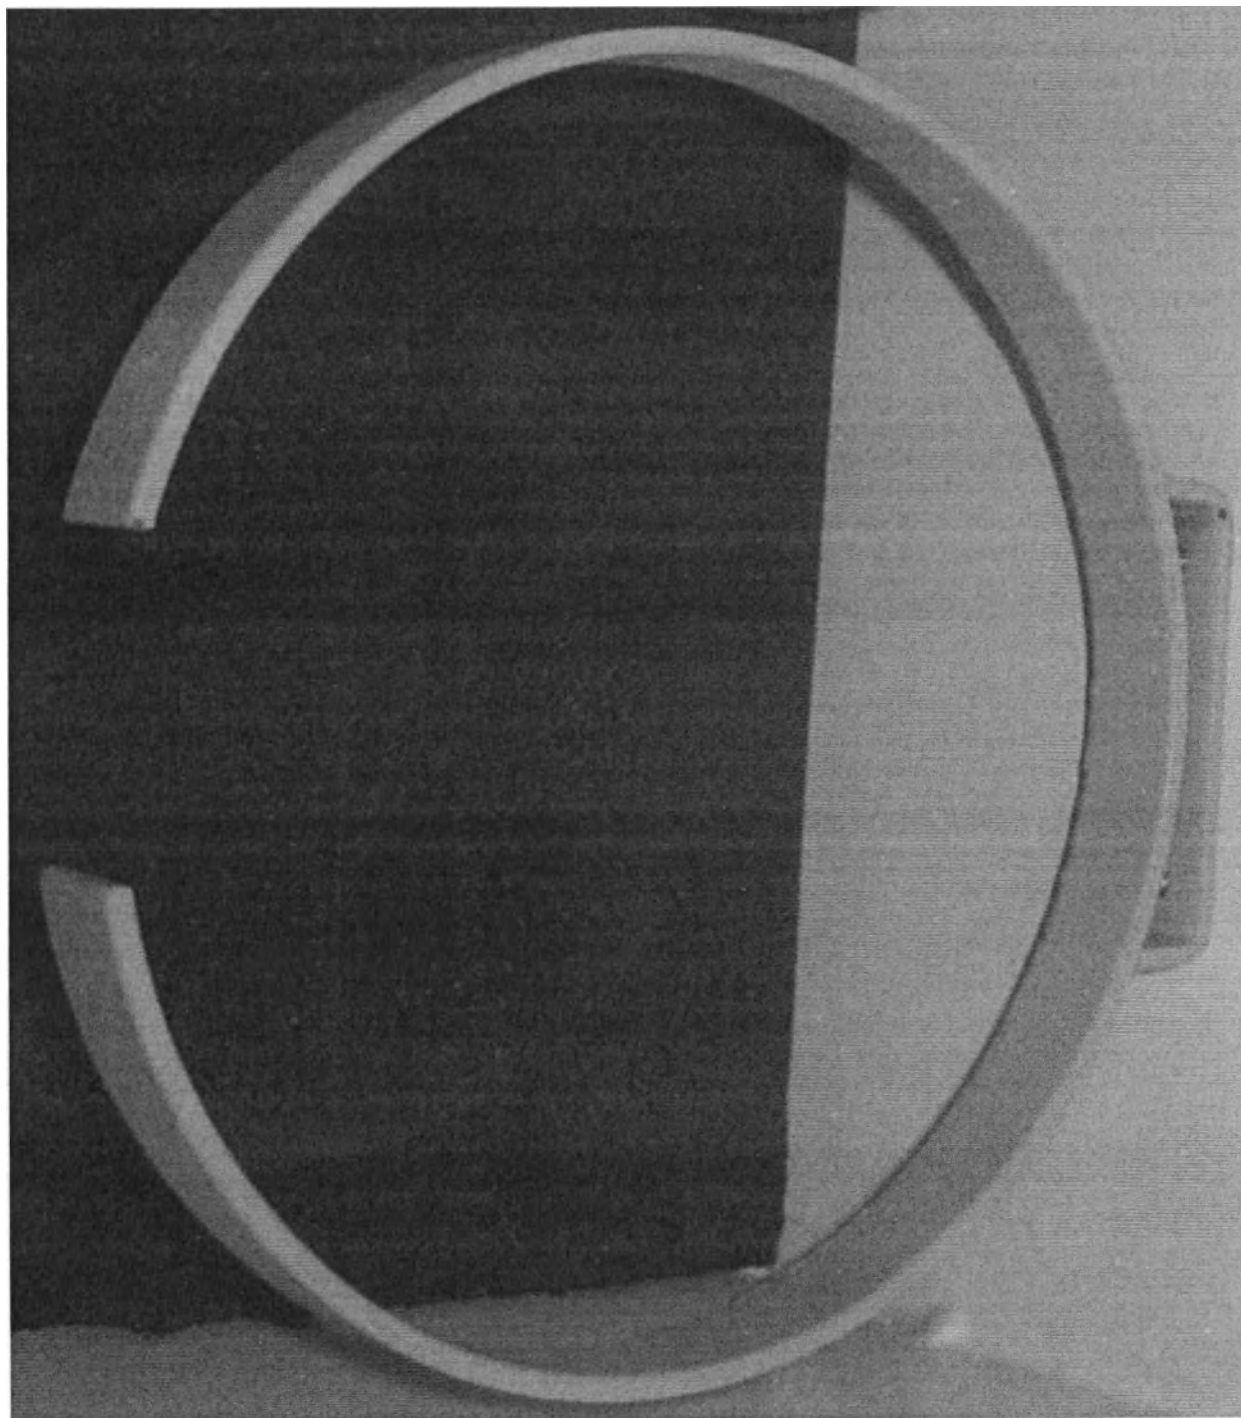


Кресло пациента Dixon ST-E250




Кресло врача.




Ножной переключатель положения кресла пациента.

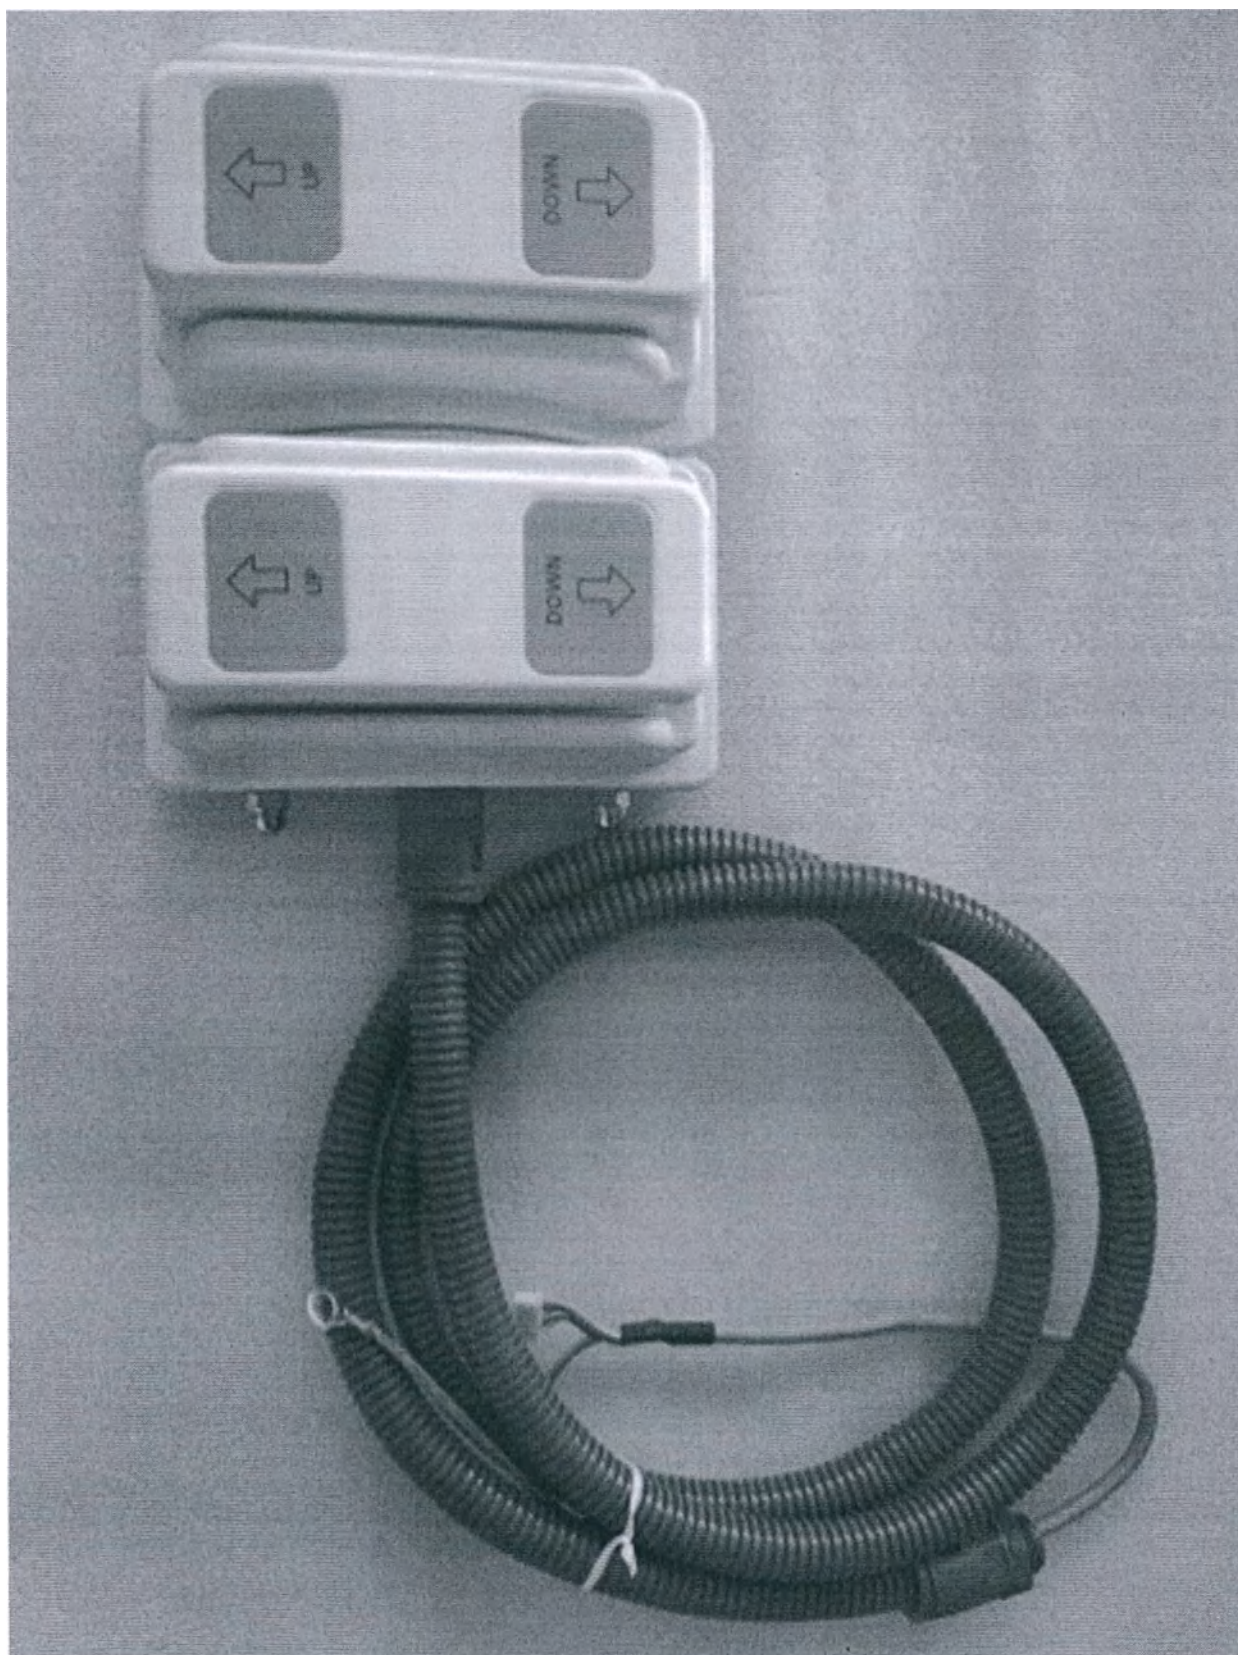


Подголовник отсоединяемый

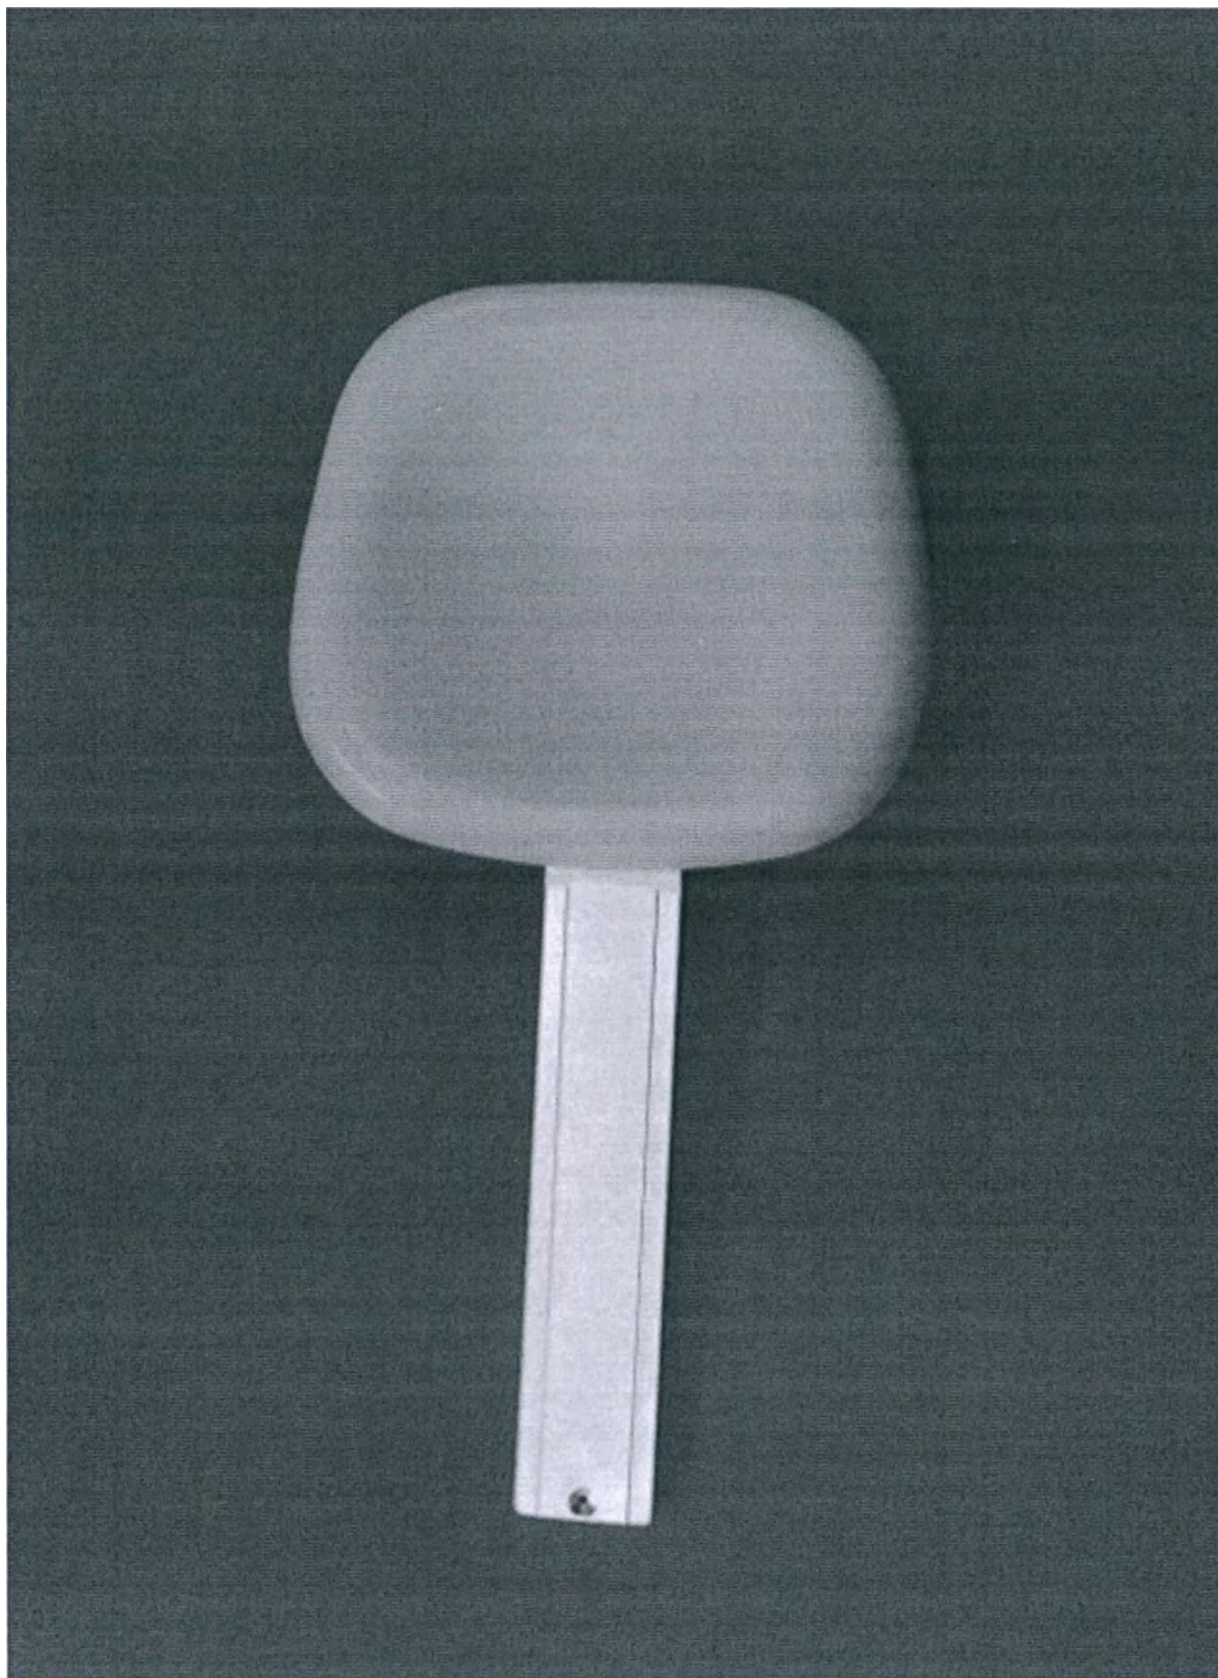


Кабель питания кресла пациента.

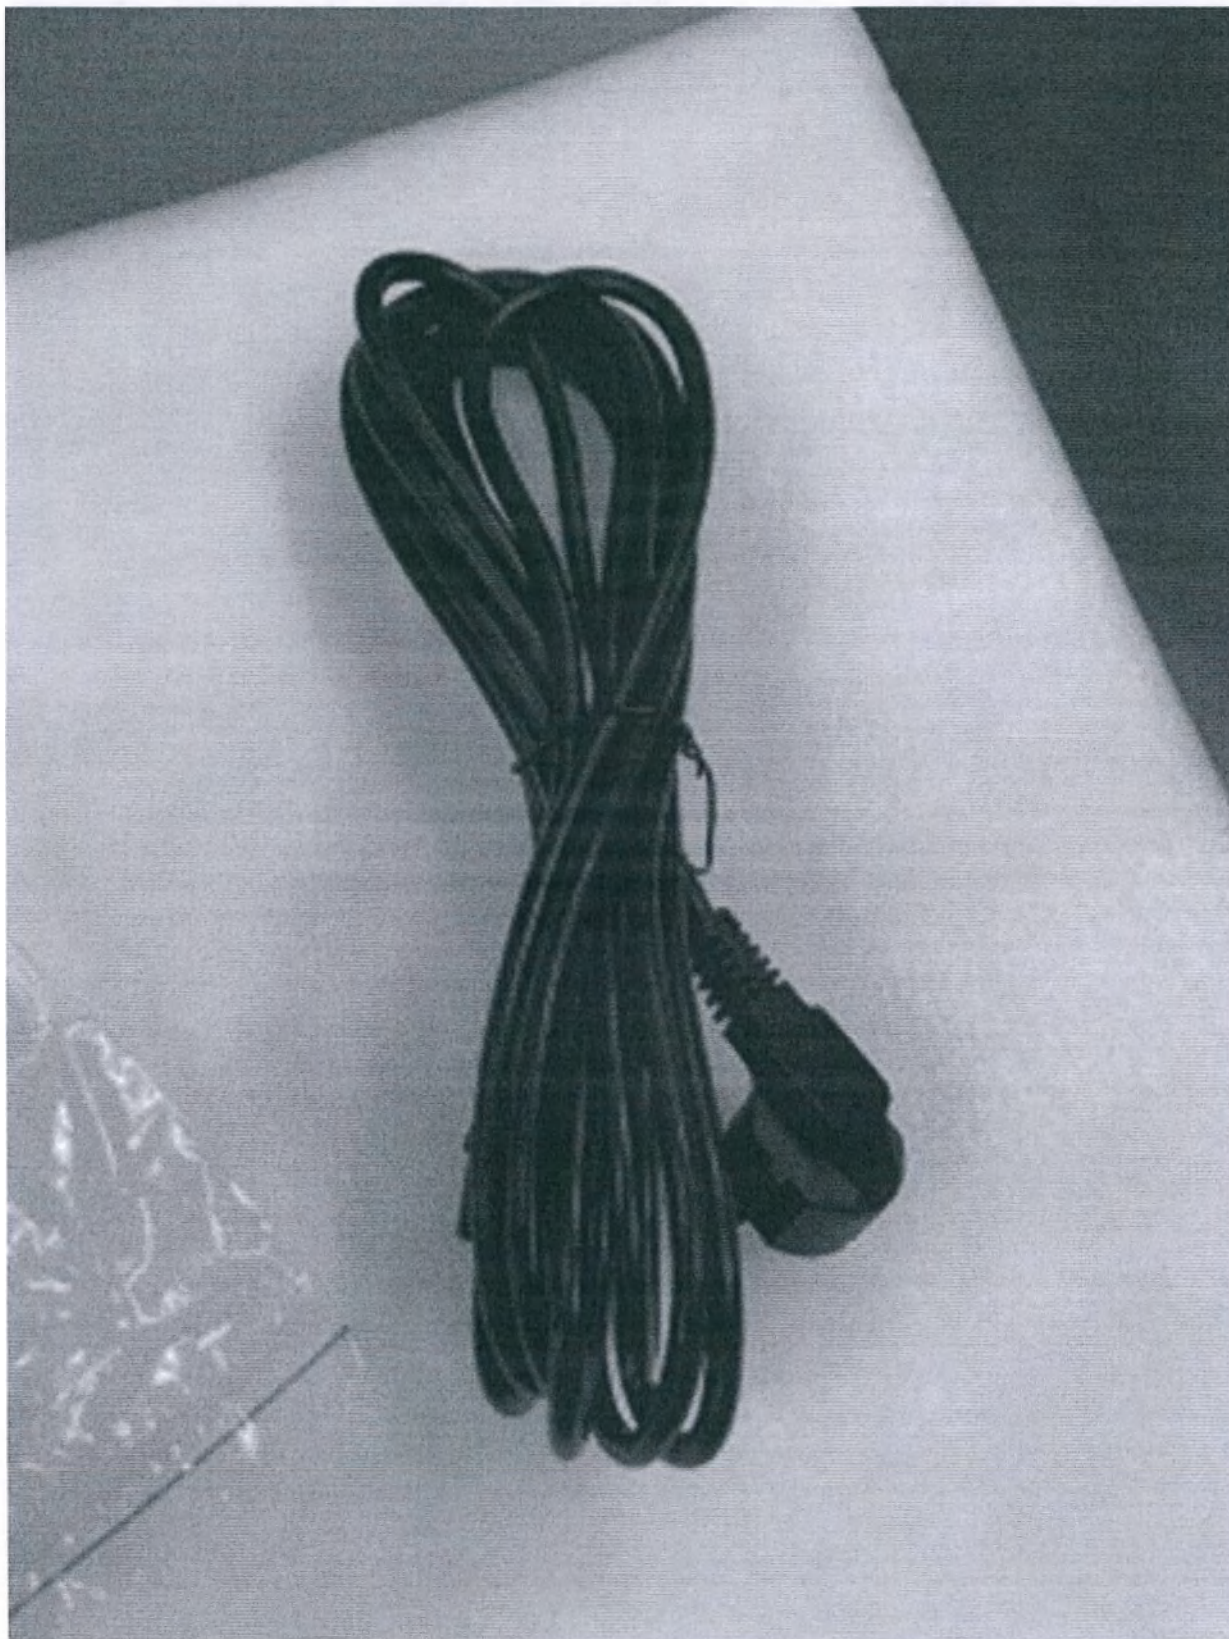


Подставка для ног для кресла пациента.

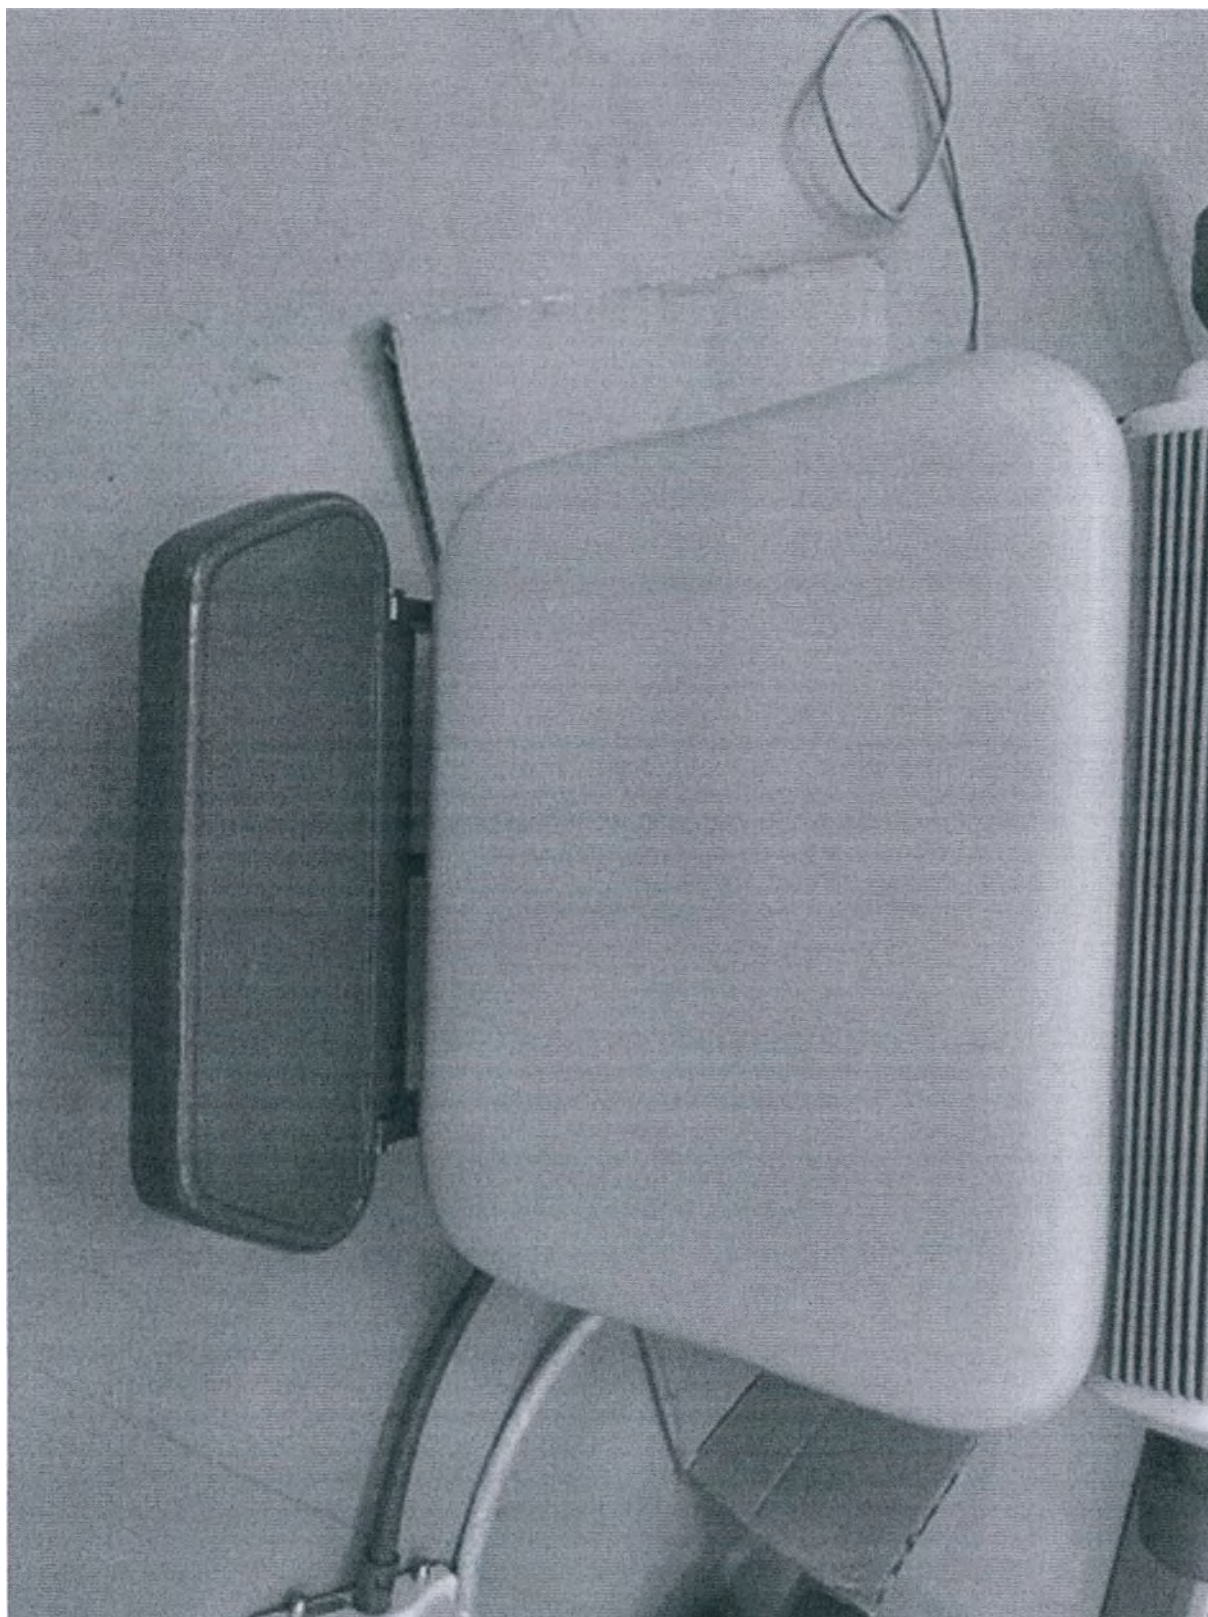


Осветитель налобный с холодным светом

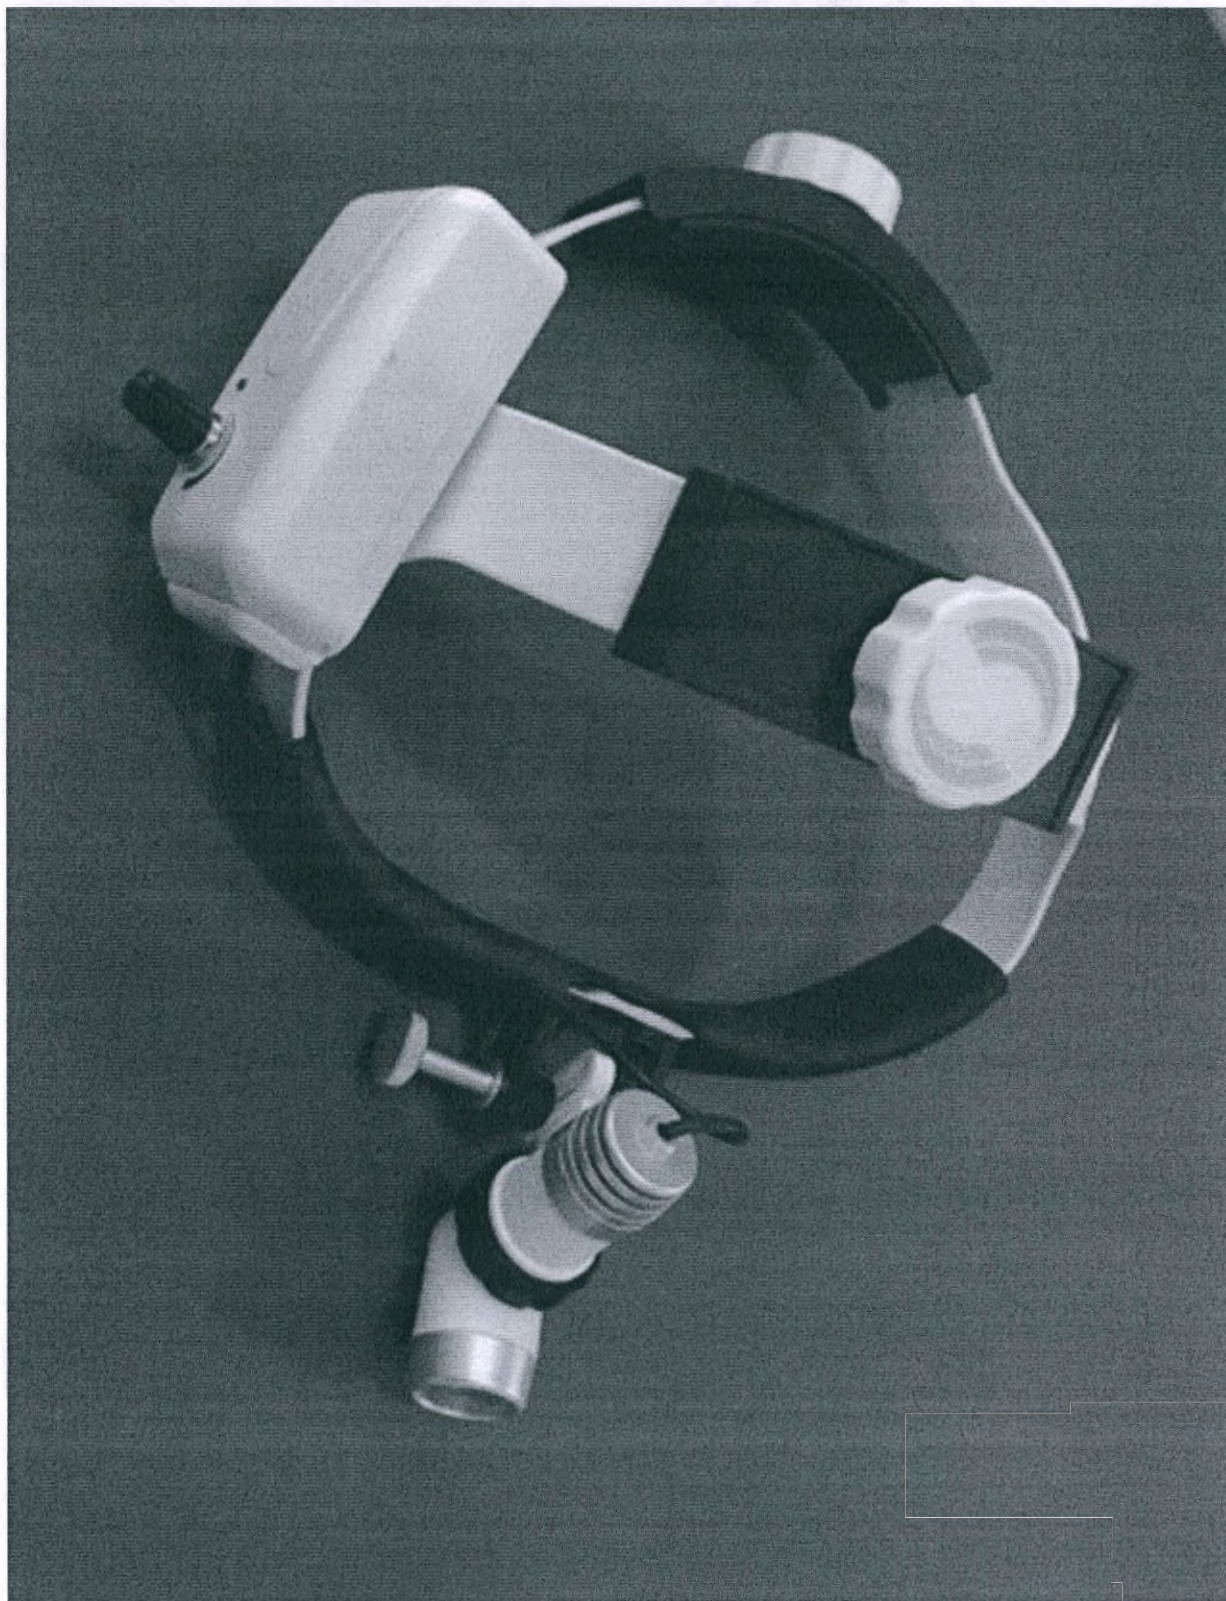


Осветитель налобный с теплым светом

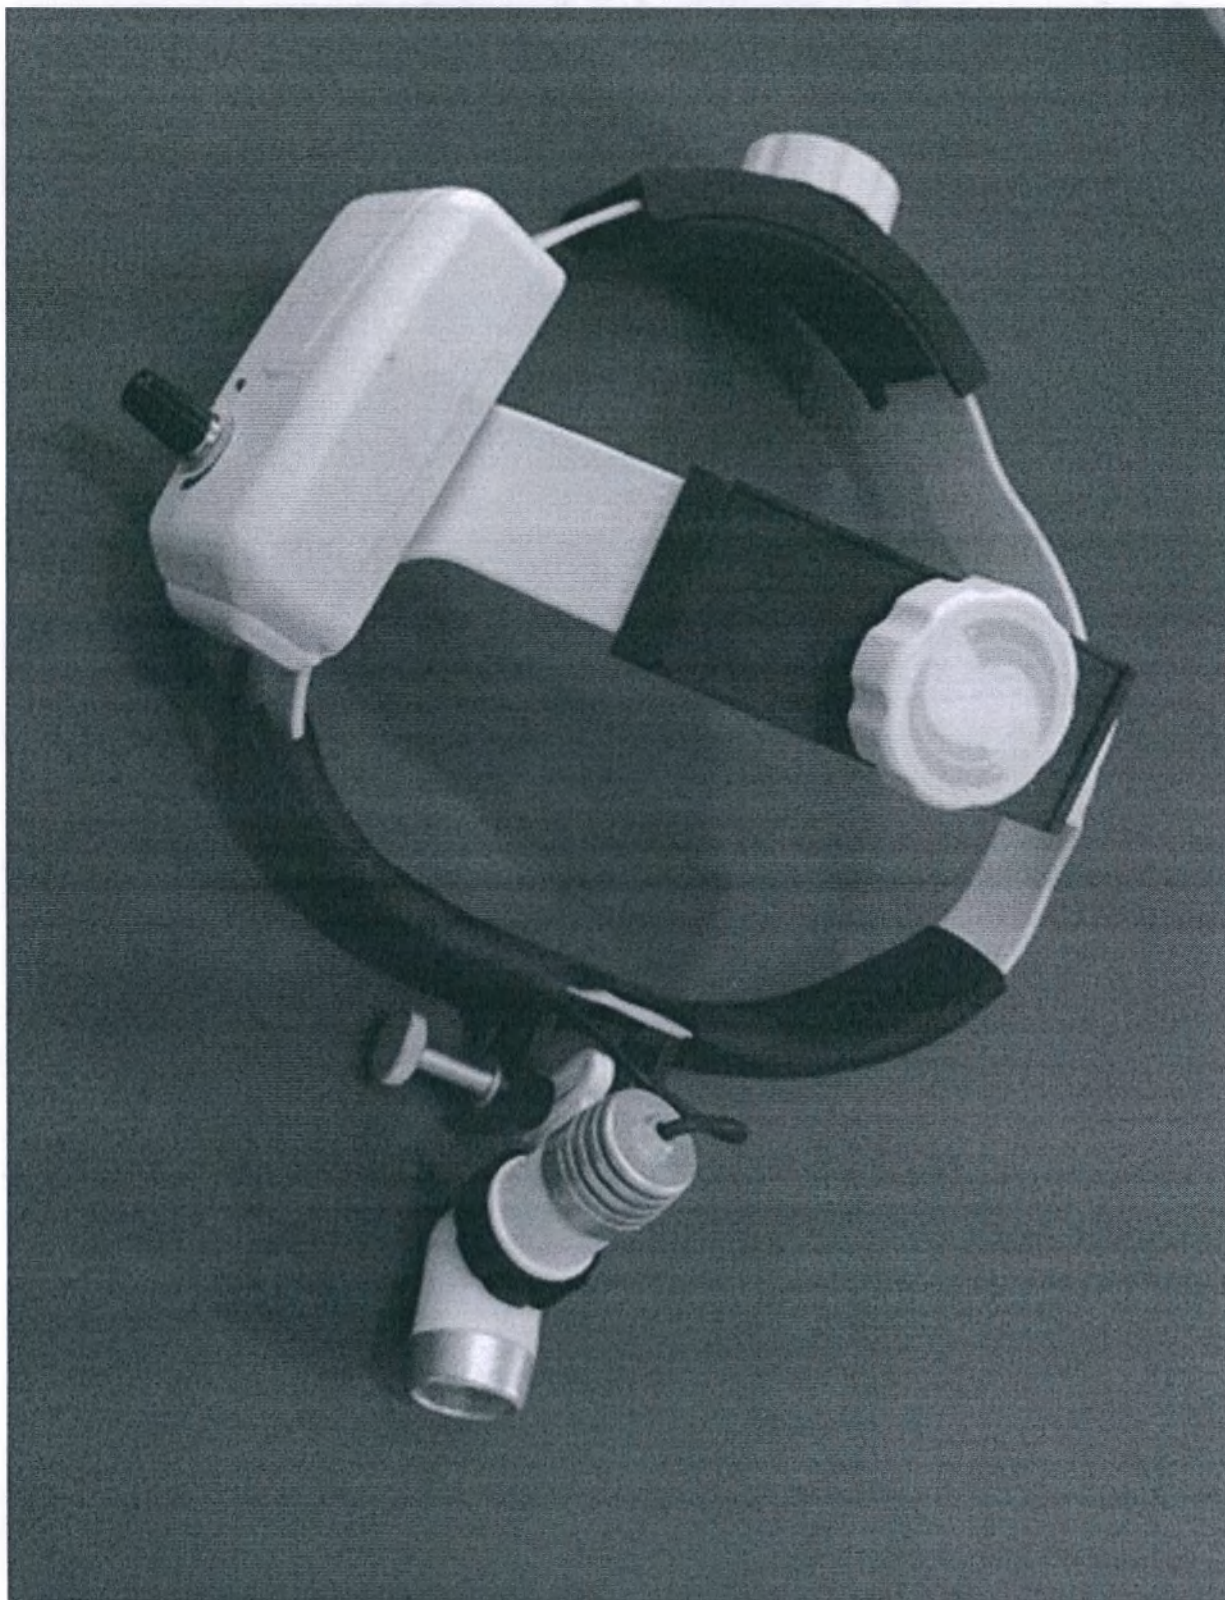

Аккумуляторная батарея для налобного осветителя

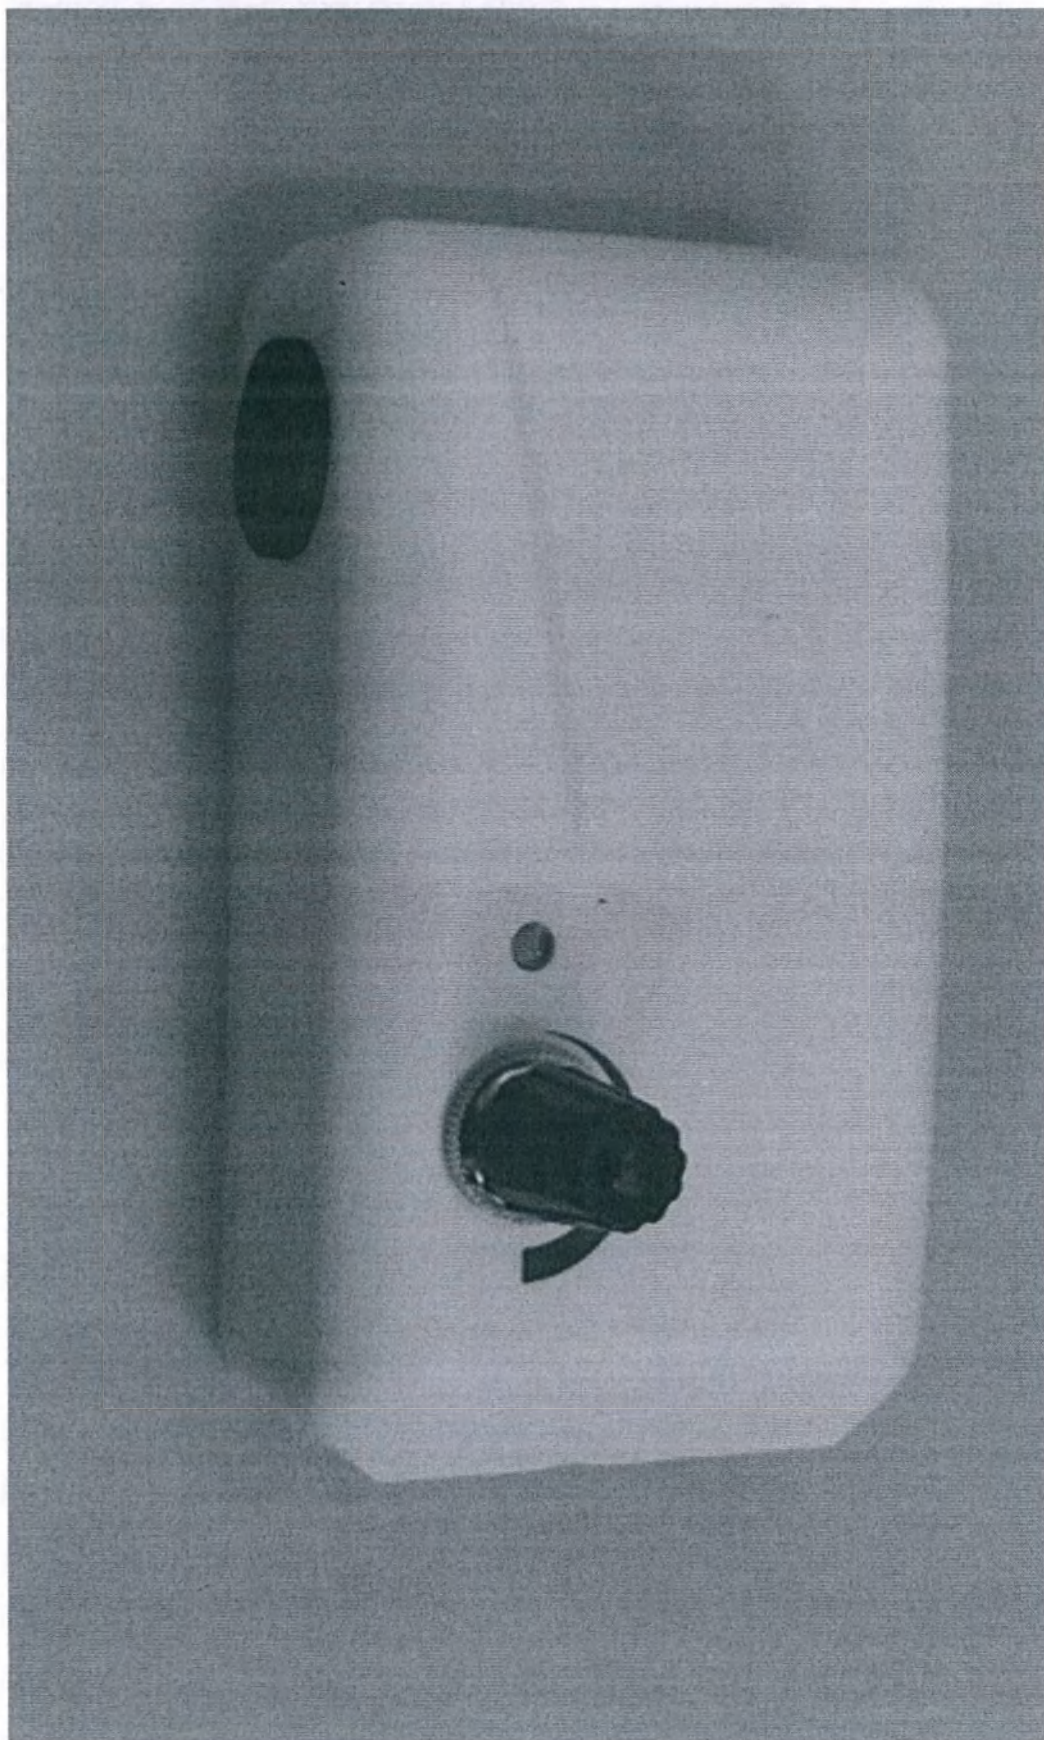


Аккумуляторная батарея дополнительная для налобного осветителя

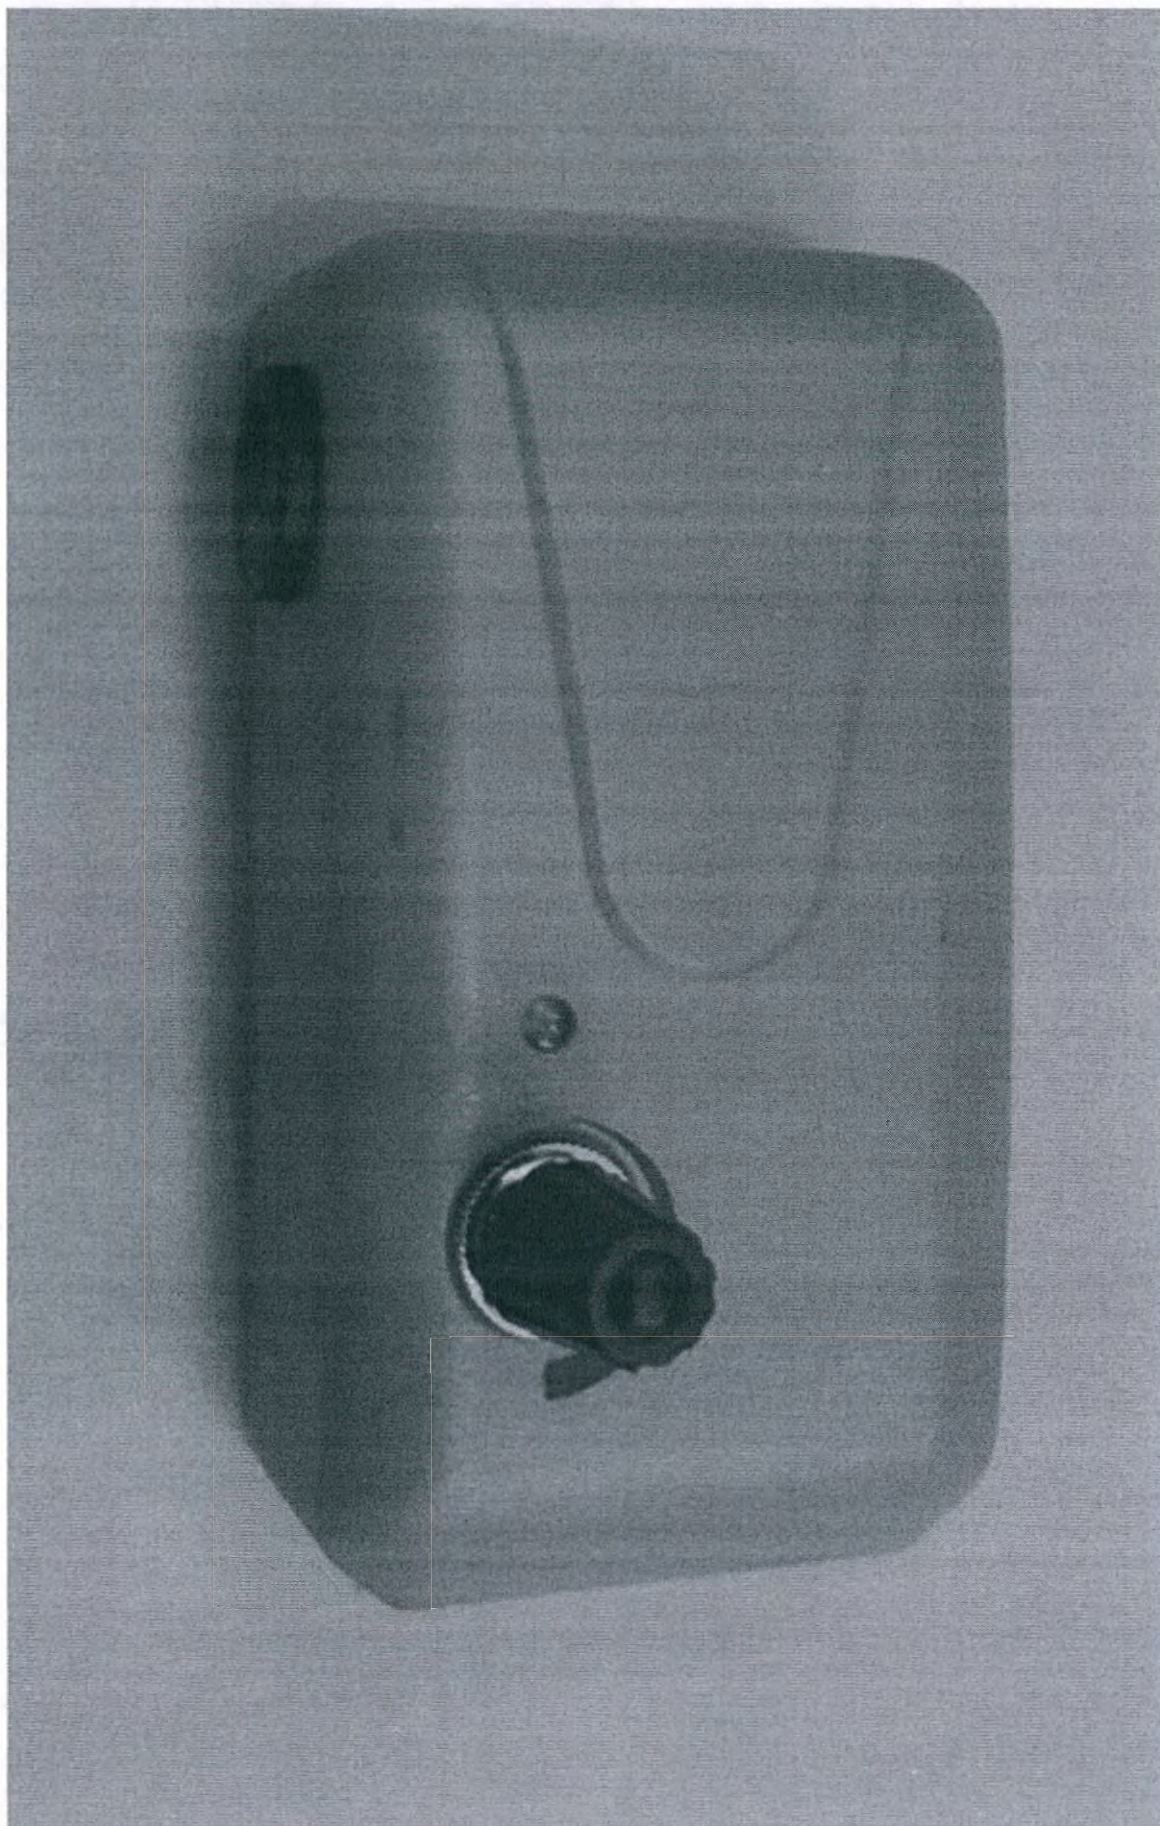


USB кабель для зарядки аккумуляторной батареи



Адаптер питания для зарядки аккумуляторной батареи

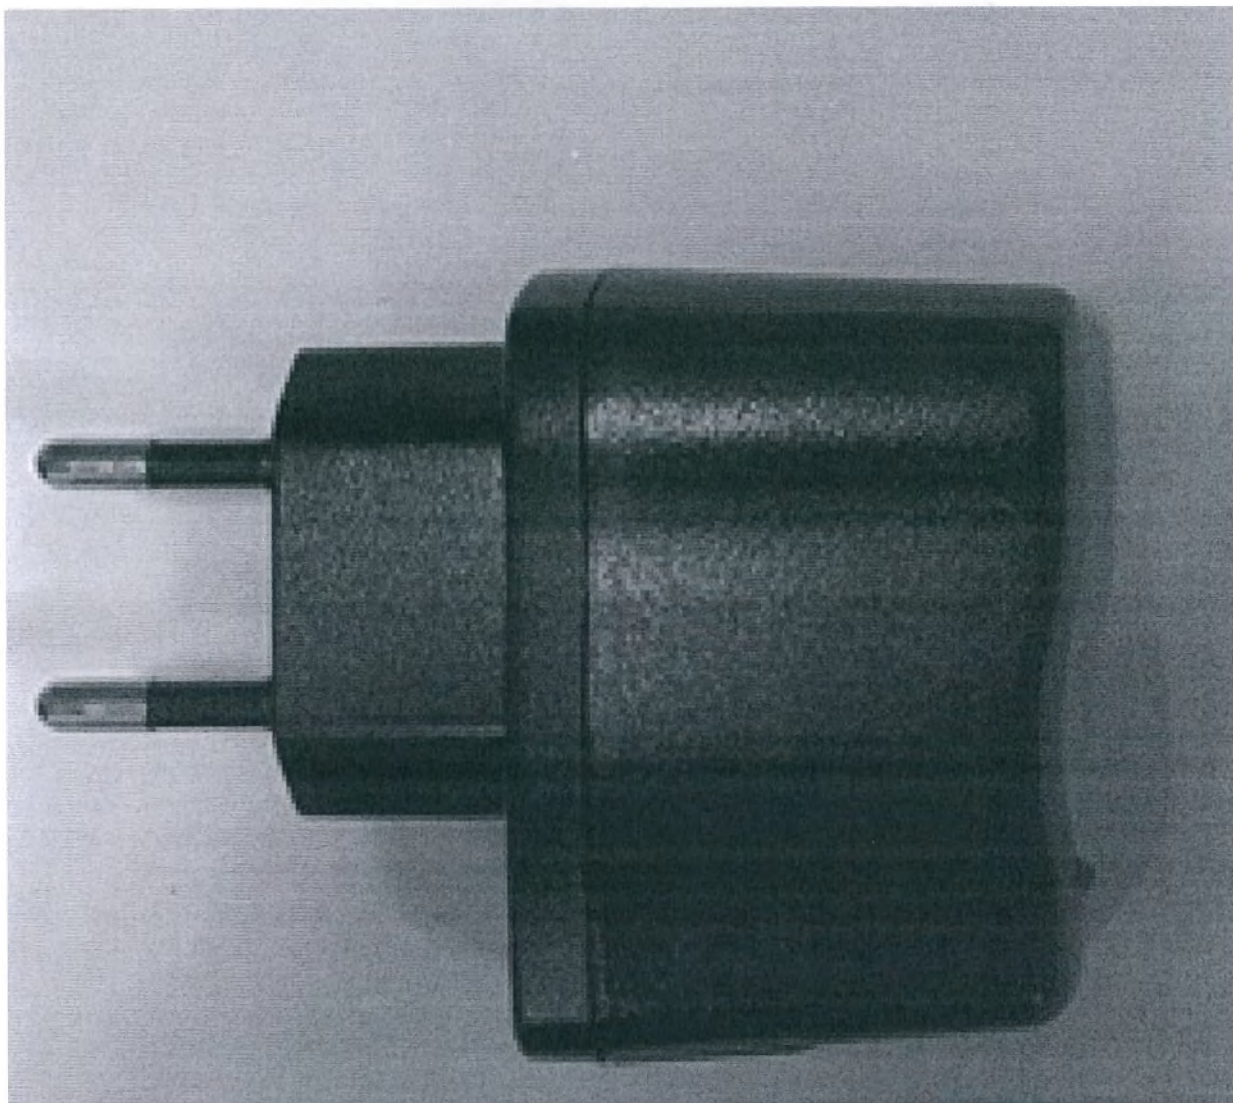

Держатель налобного осветителя.

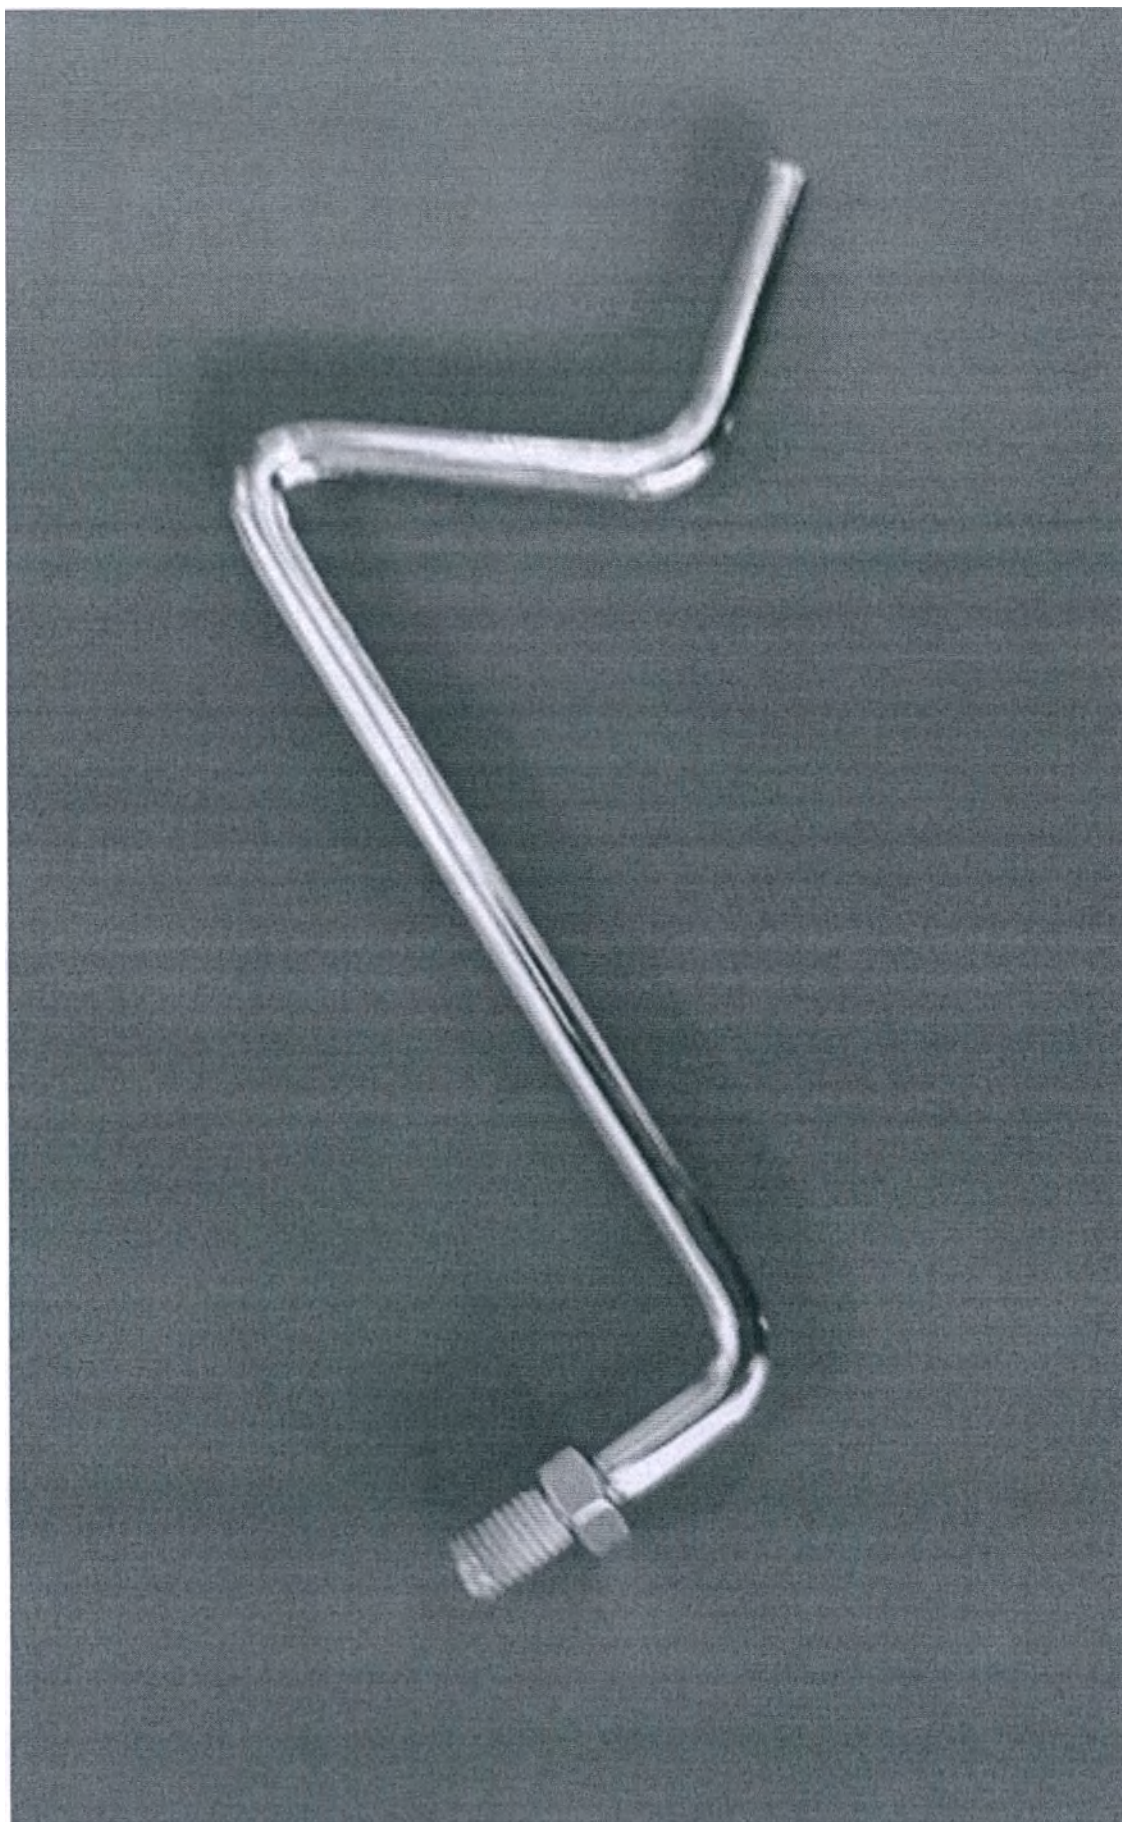


Блок промывания уха.




Тюльпан для промывания уха.




Шланг для тюльпана для промывки уха

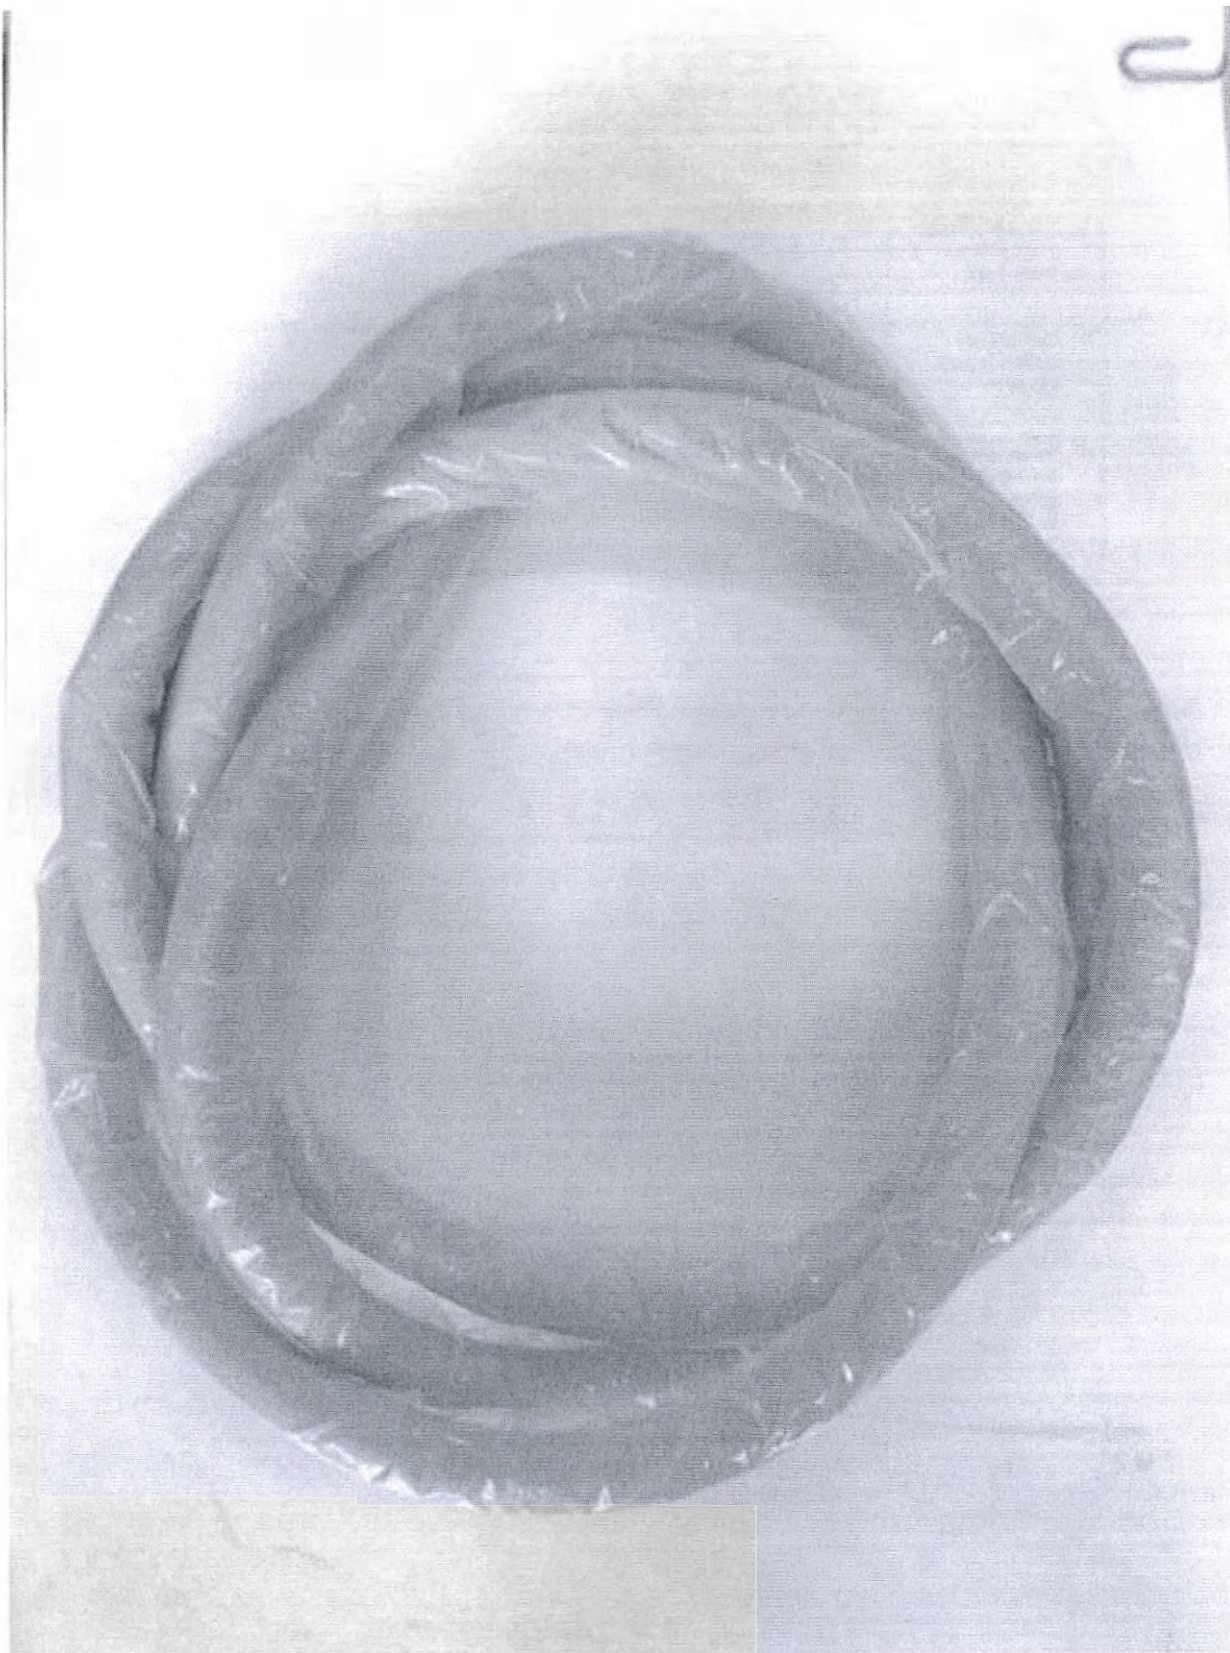

Кронштейн-держатель тюльпана для промывания уха.

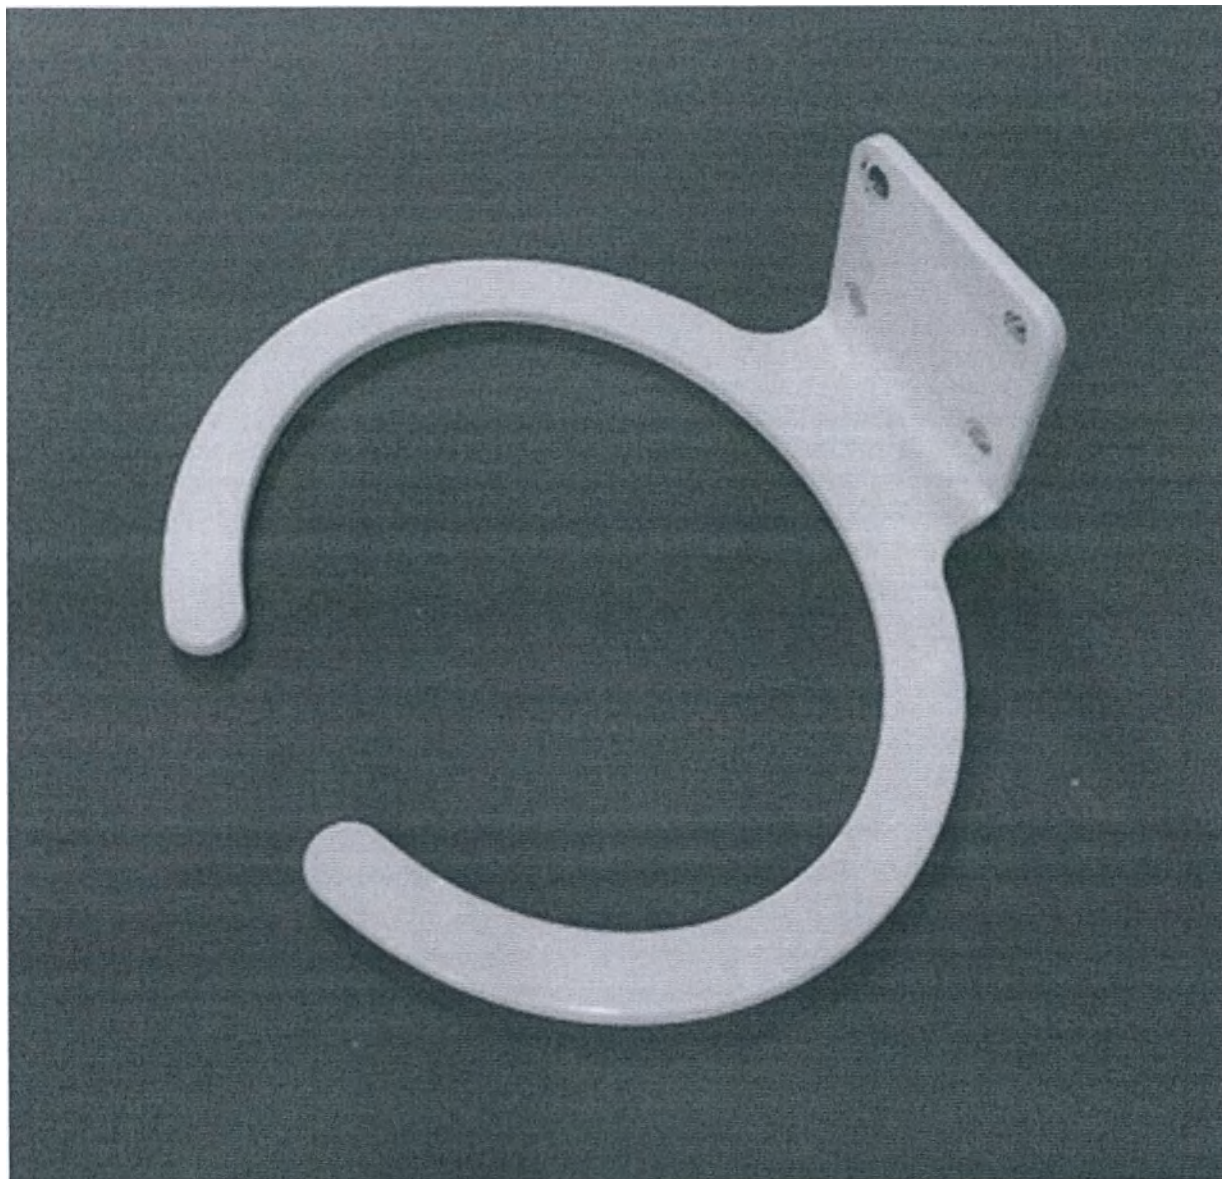


Штуцер для подключения к магистральному водоснабжению

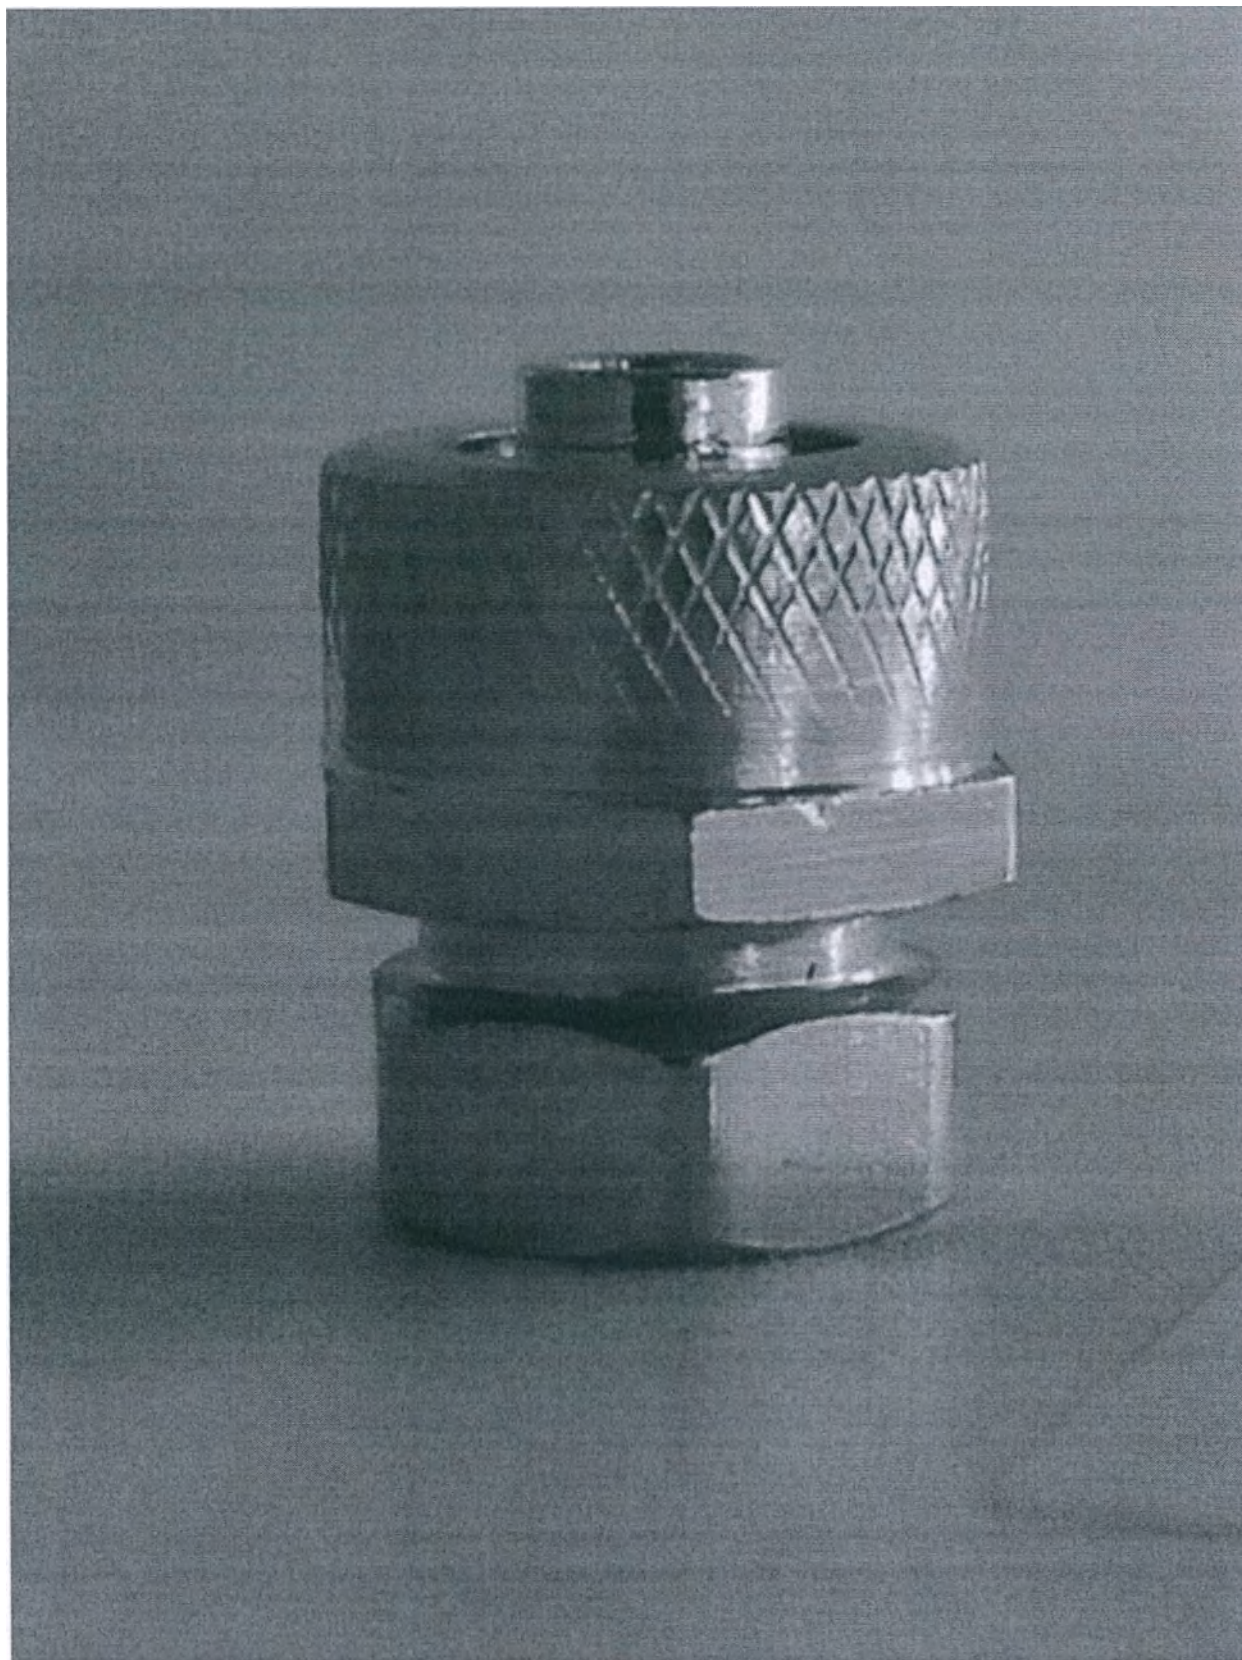


Рукоятка для подачи воды и воздуха.




Изогнутая насадка-сопло рукоятки для подачи воды и воздуха.

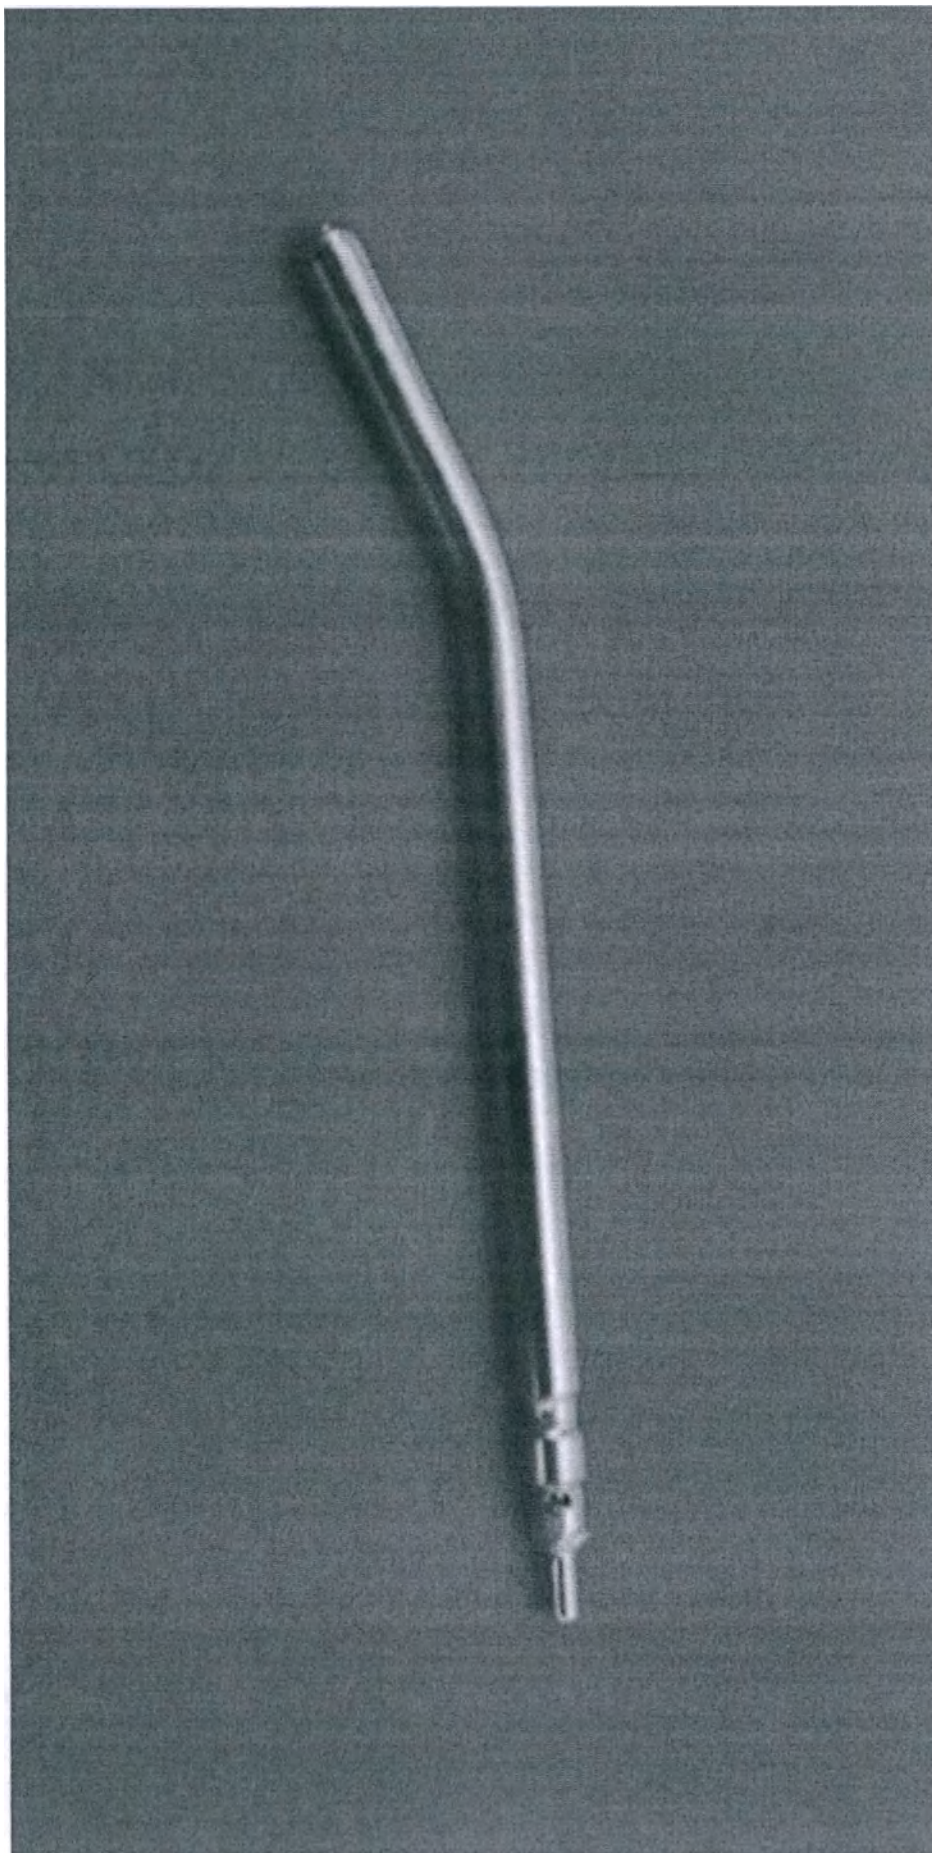

Прямая насадка-сопло рукоятки для подачи воды и воздуха .

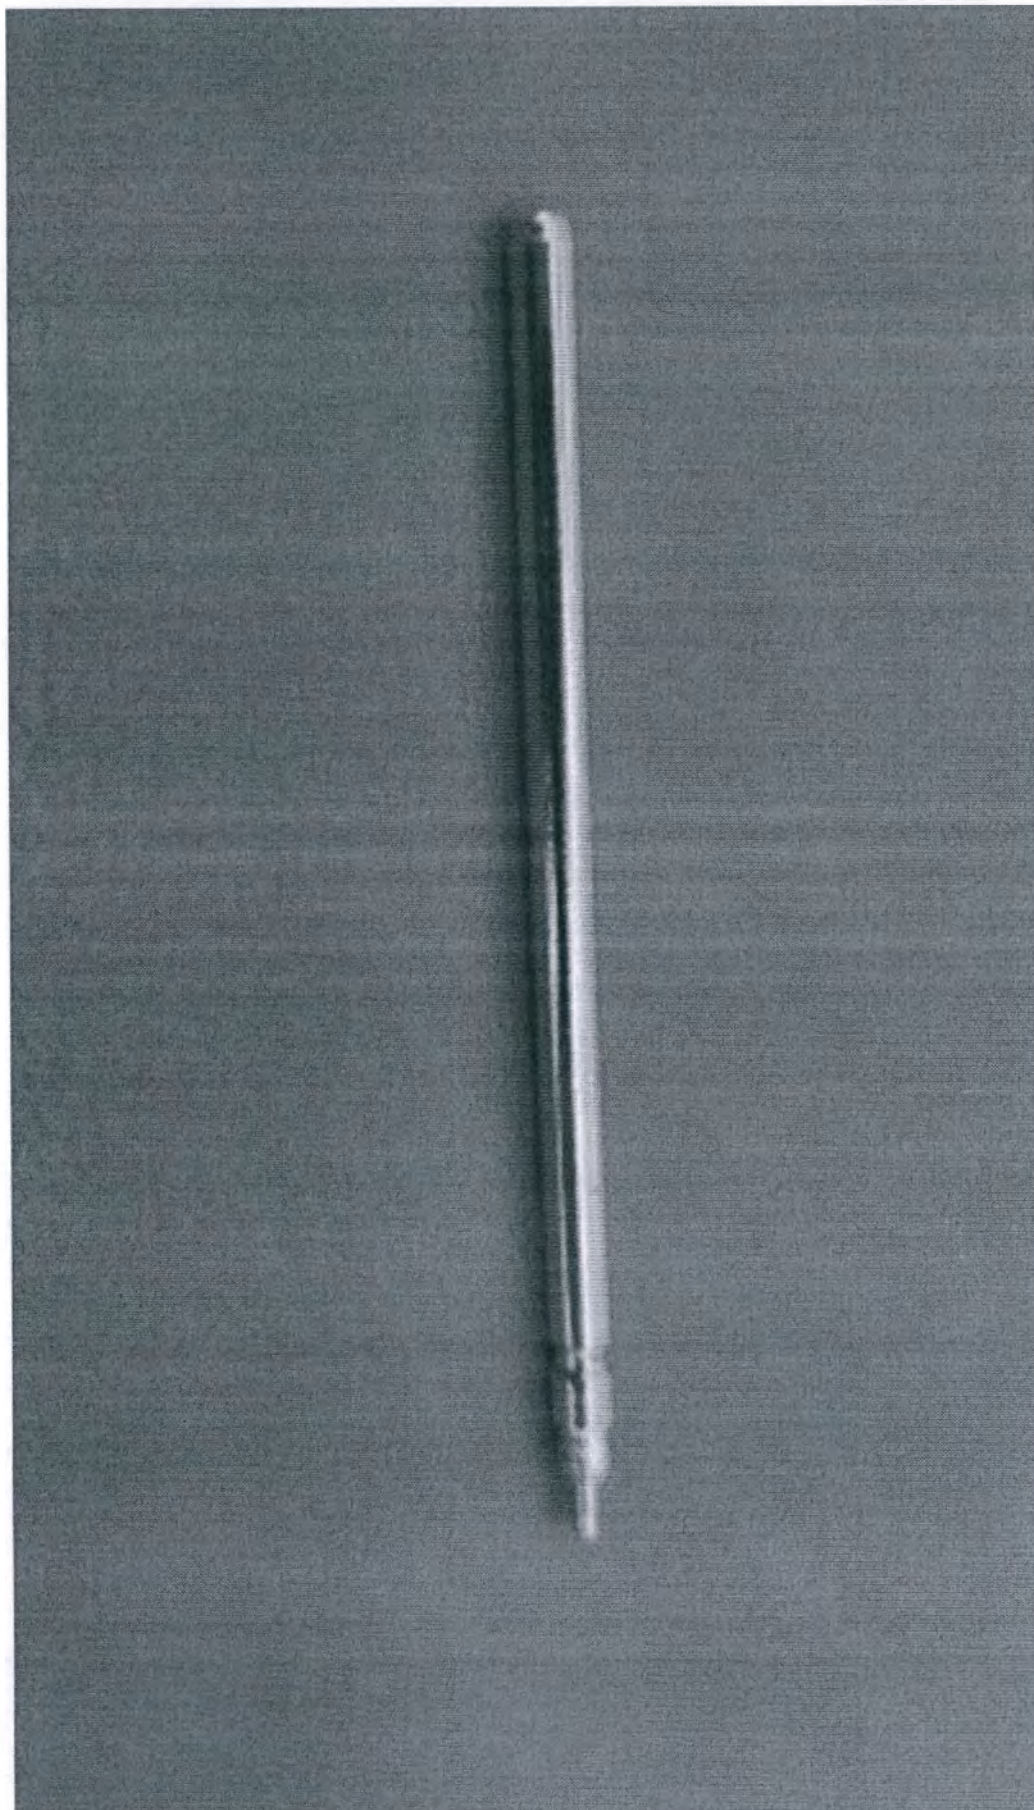


Шланг для подачи воды и воздуха

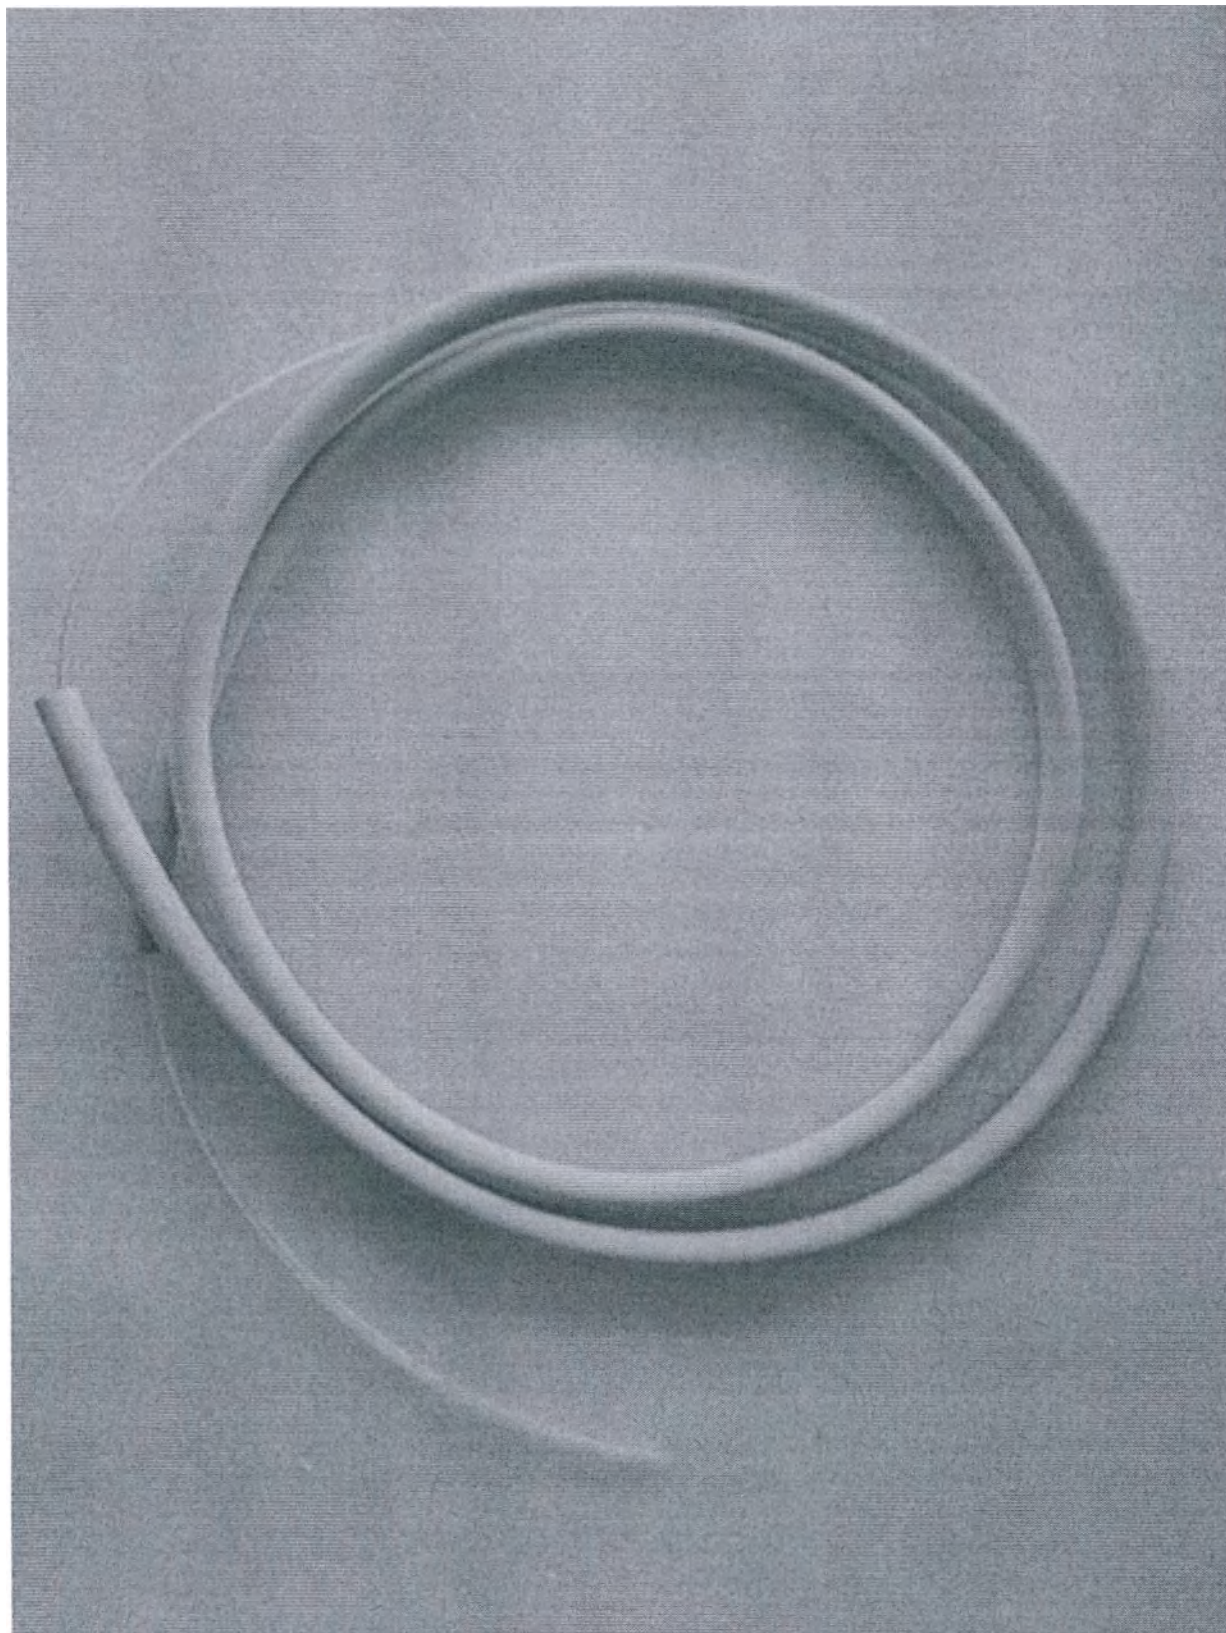


Световод волоконнооптический специальный.




Лоток для сброса использованных инструментов.

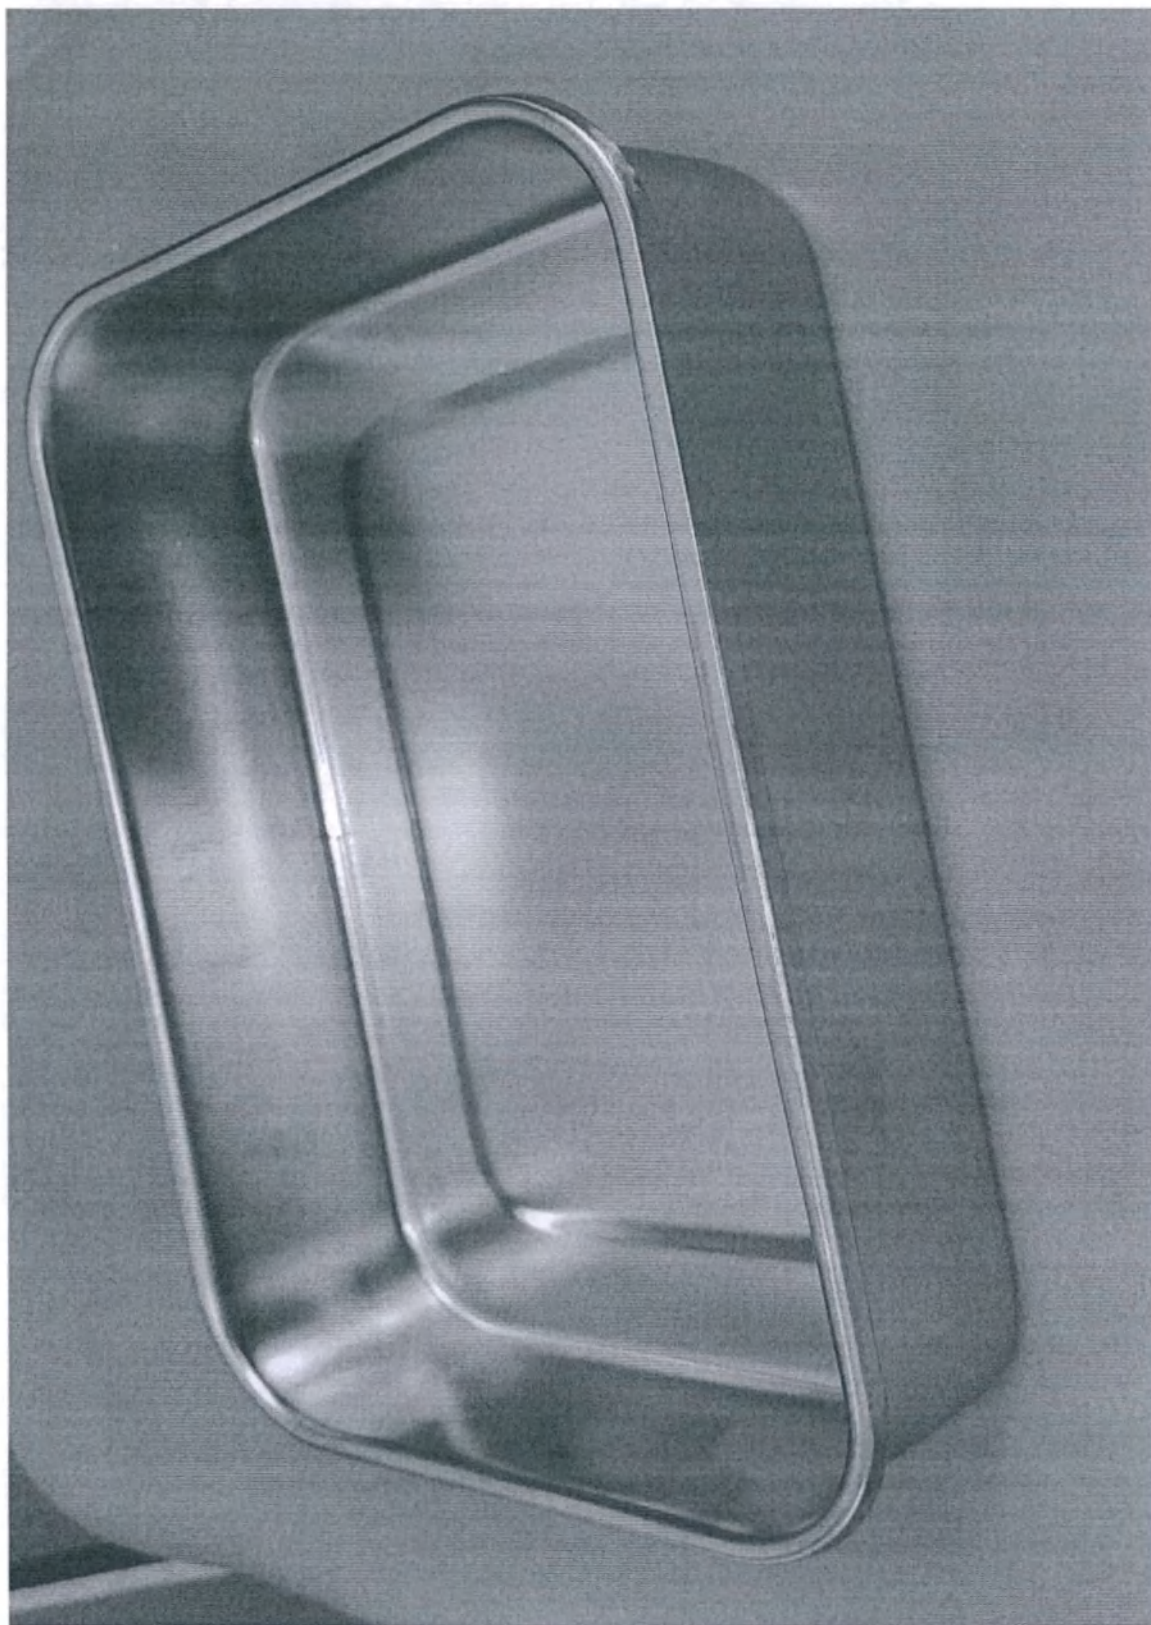


Емкость для сброса отходов.

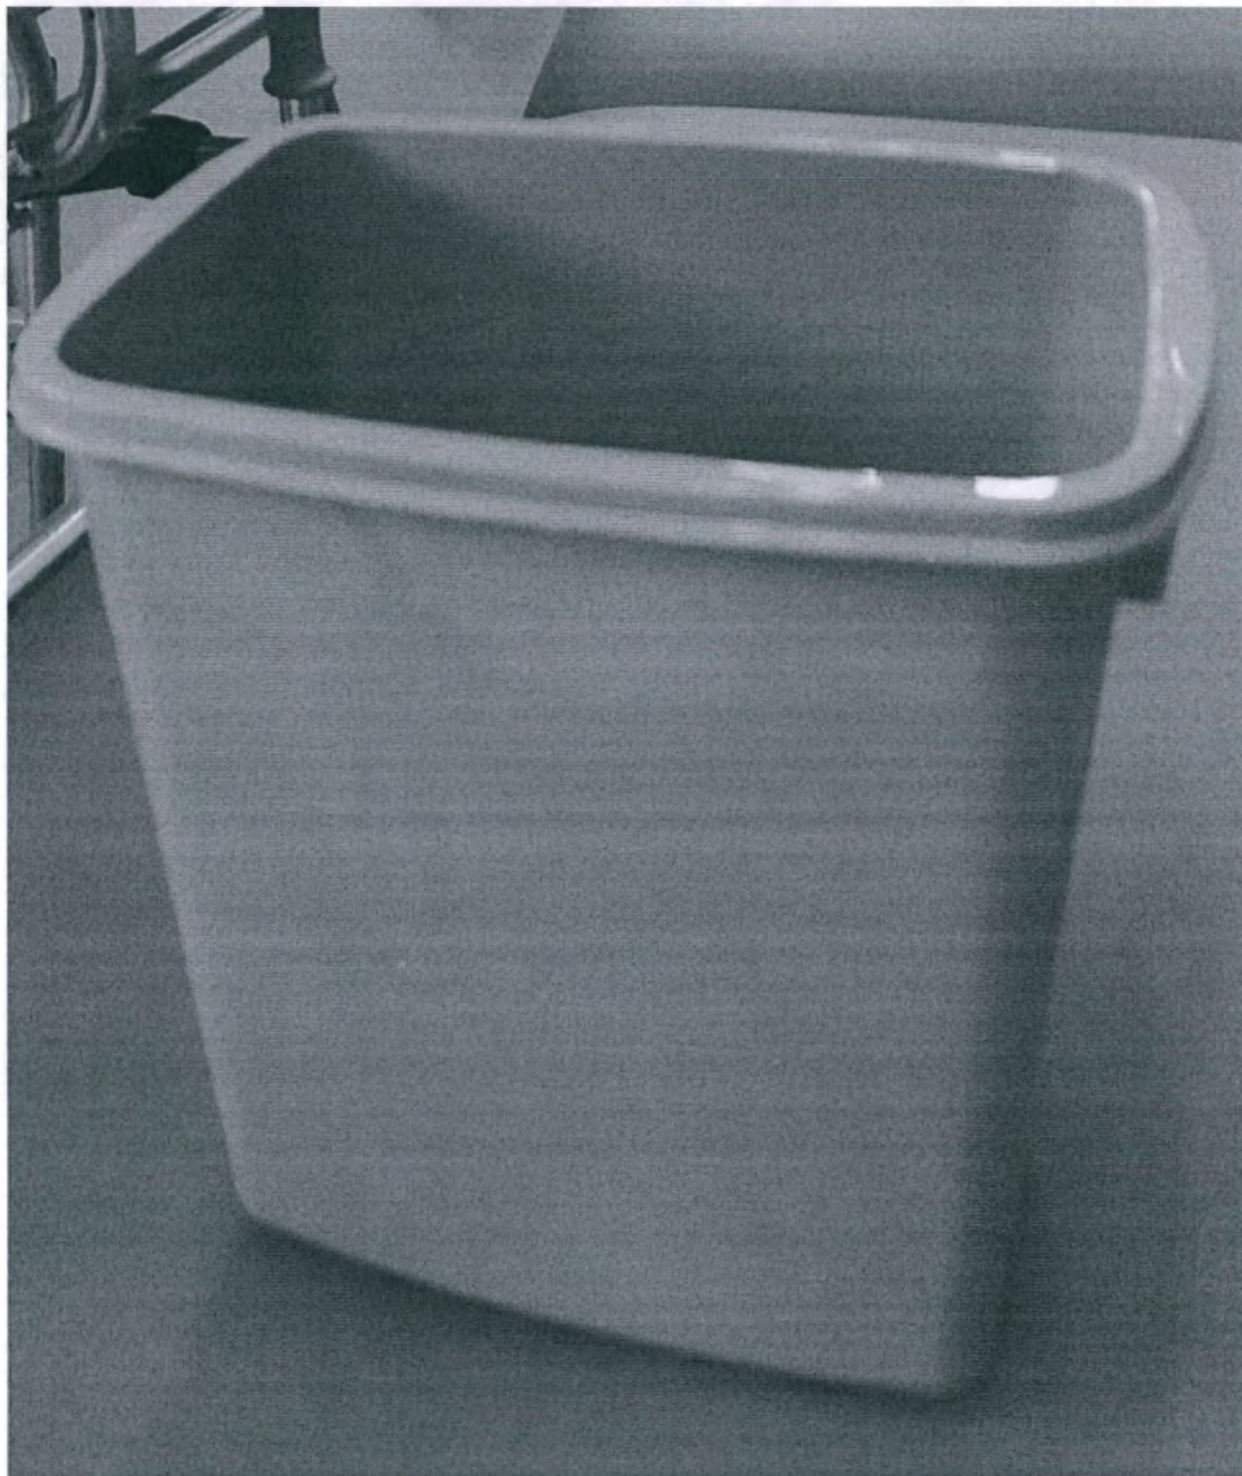


Жесткий ЛОР-эндоскоп-синускоп специальный.

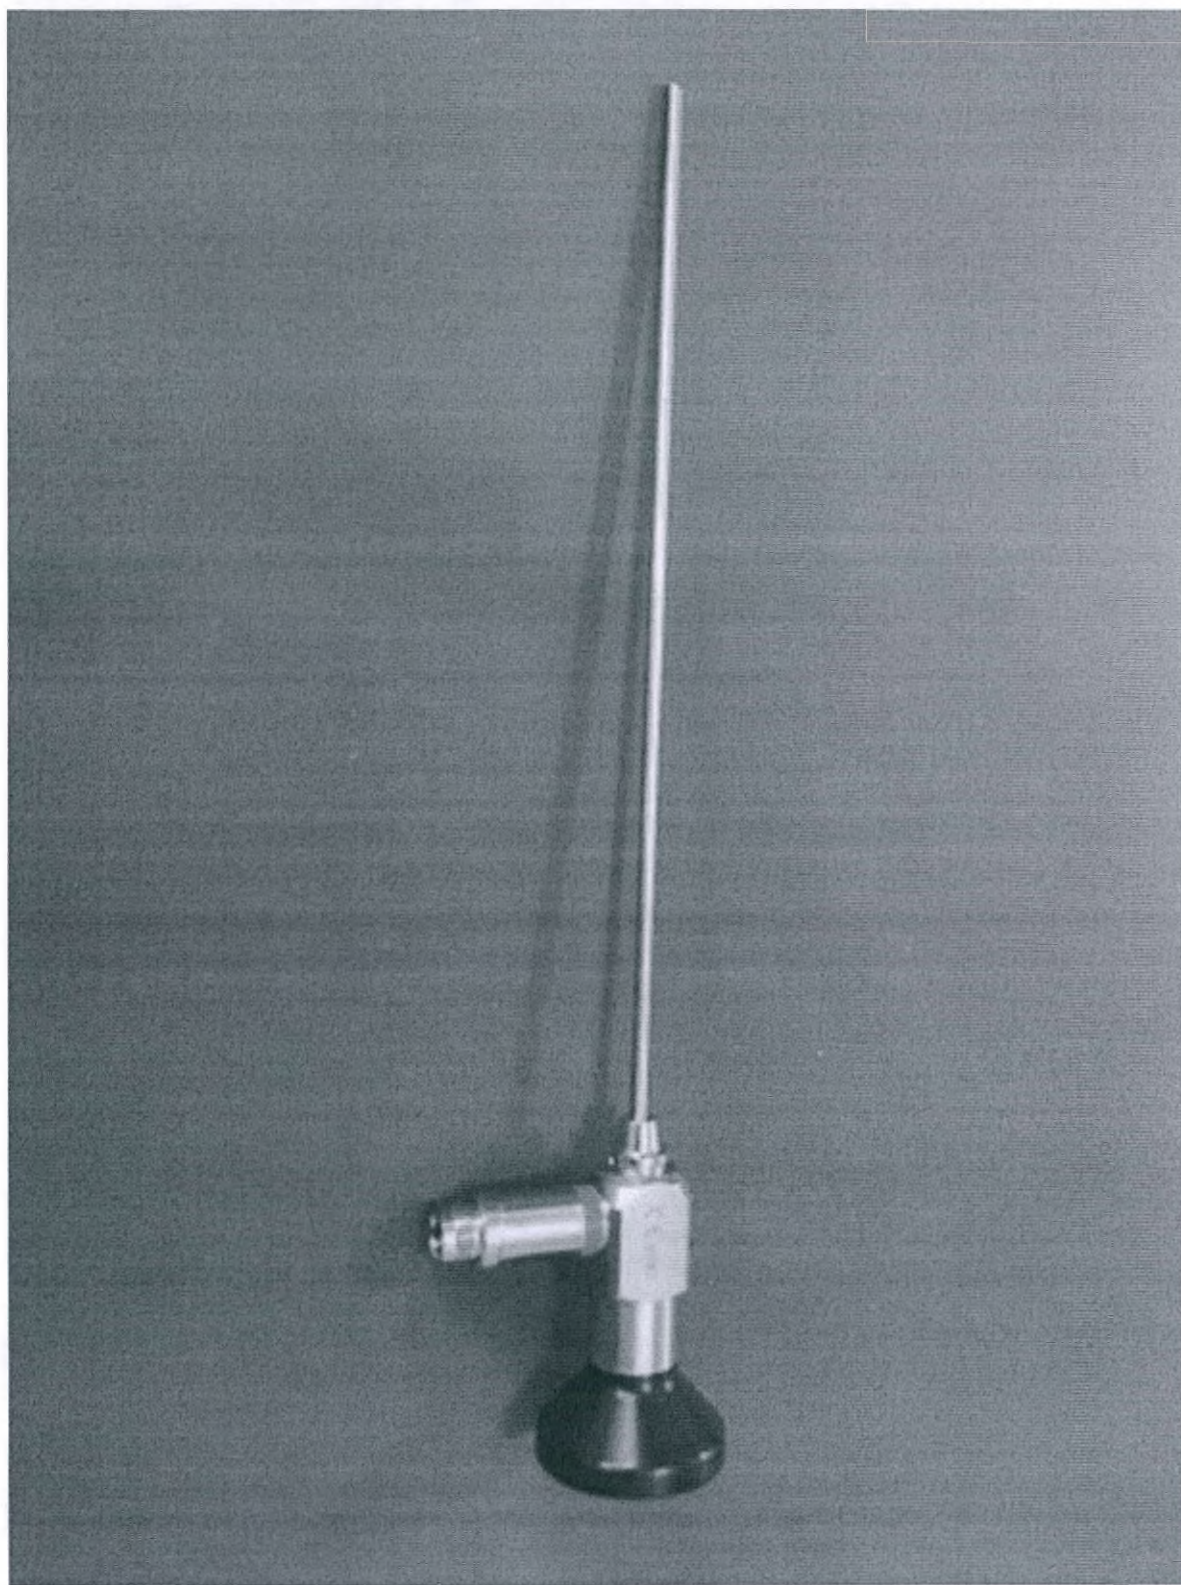


Жесткий ЛОР-эндоскоп-отоскоп специальный.

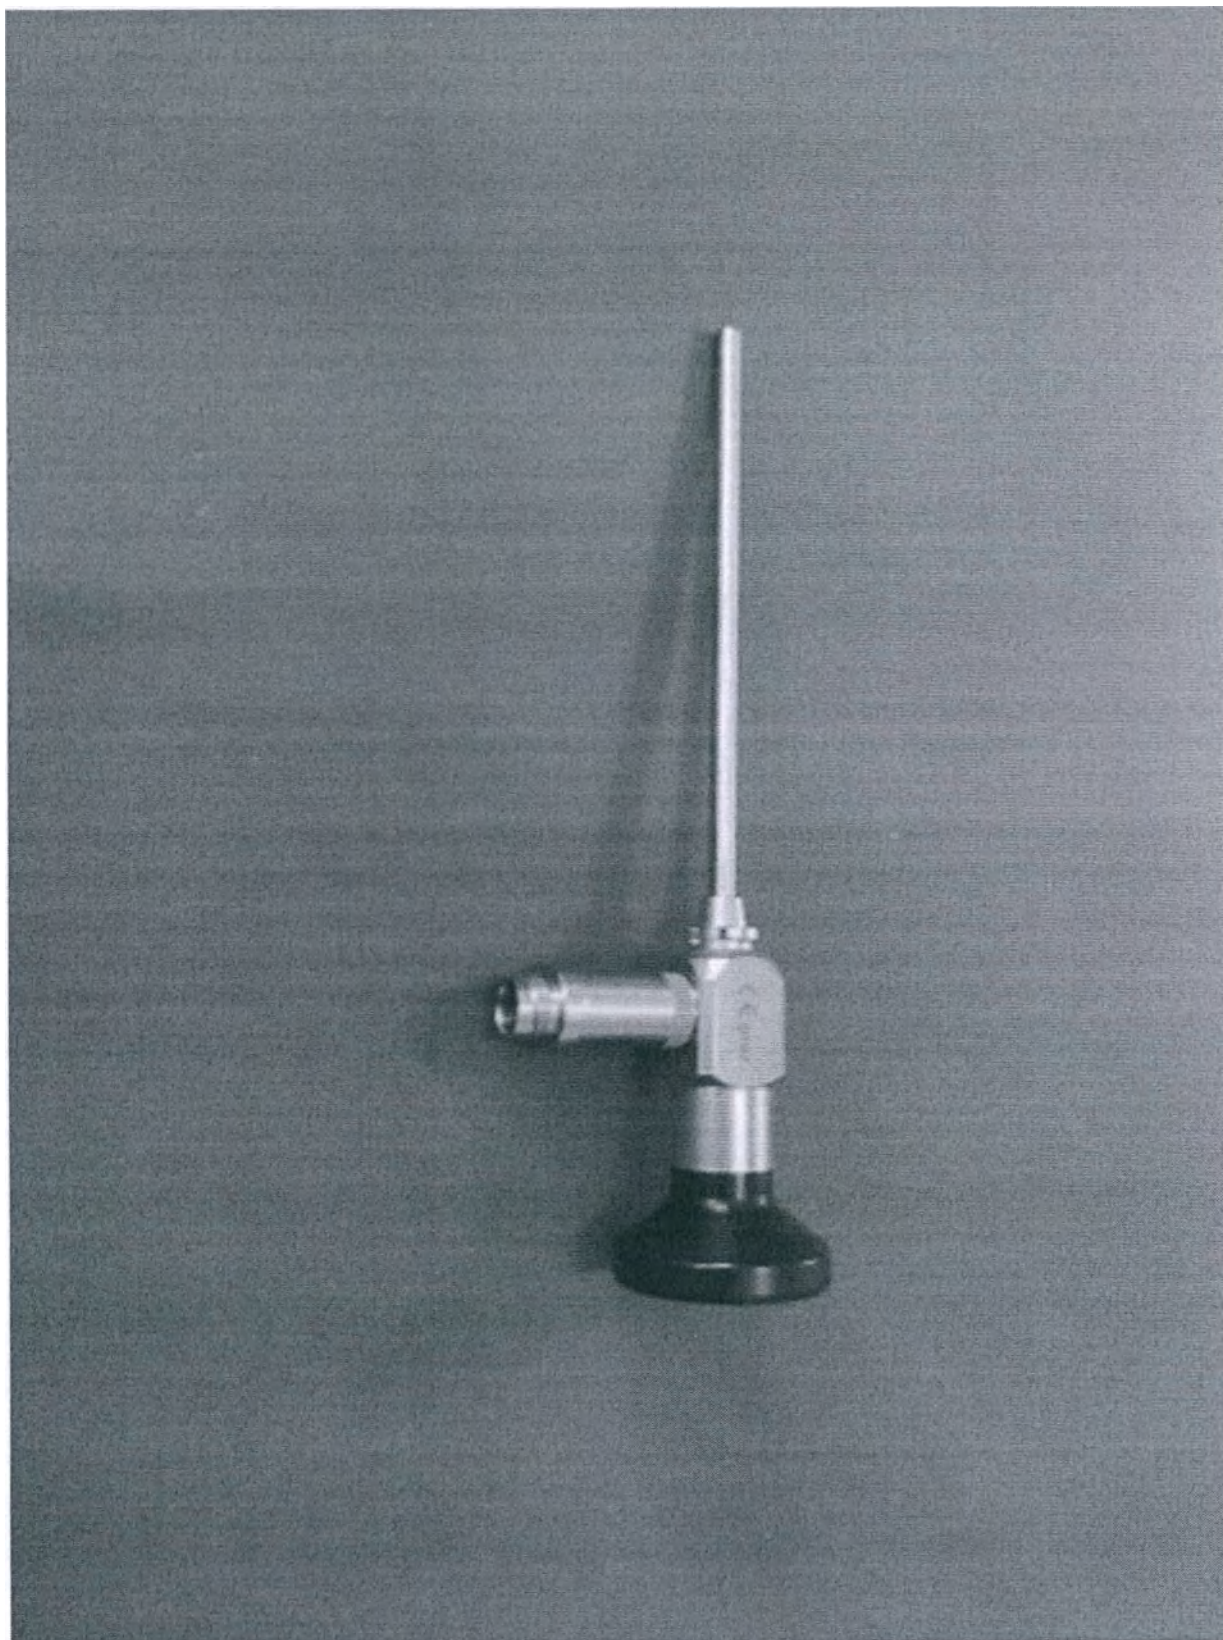


Жесткий ЛОР-эндоскоп-ларингоскоп специальный.

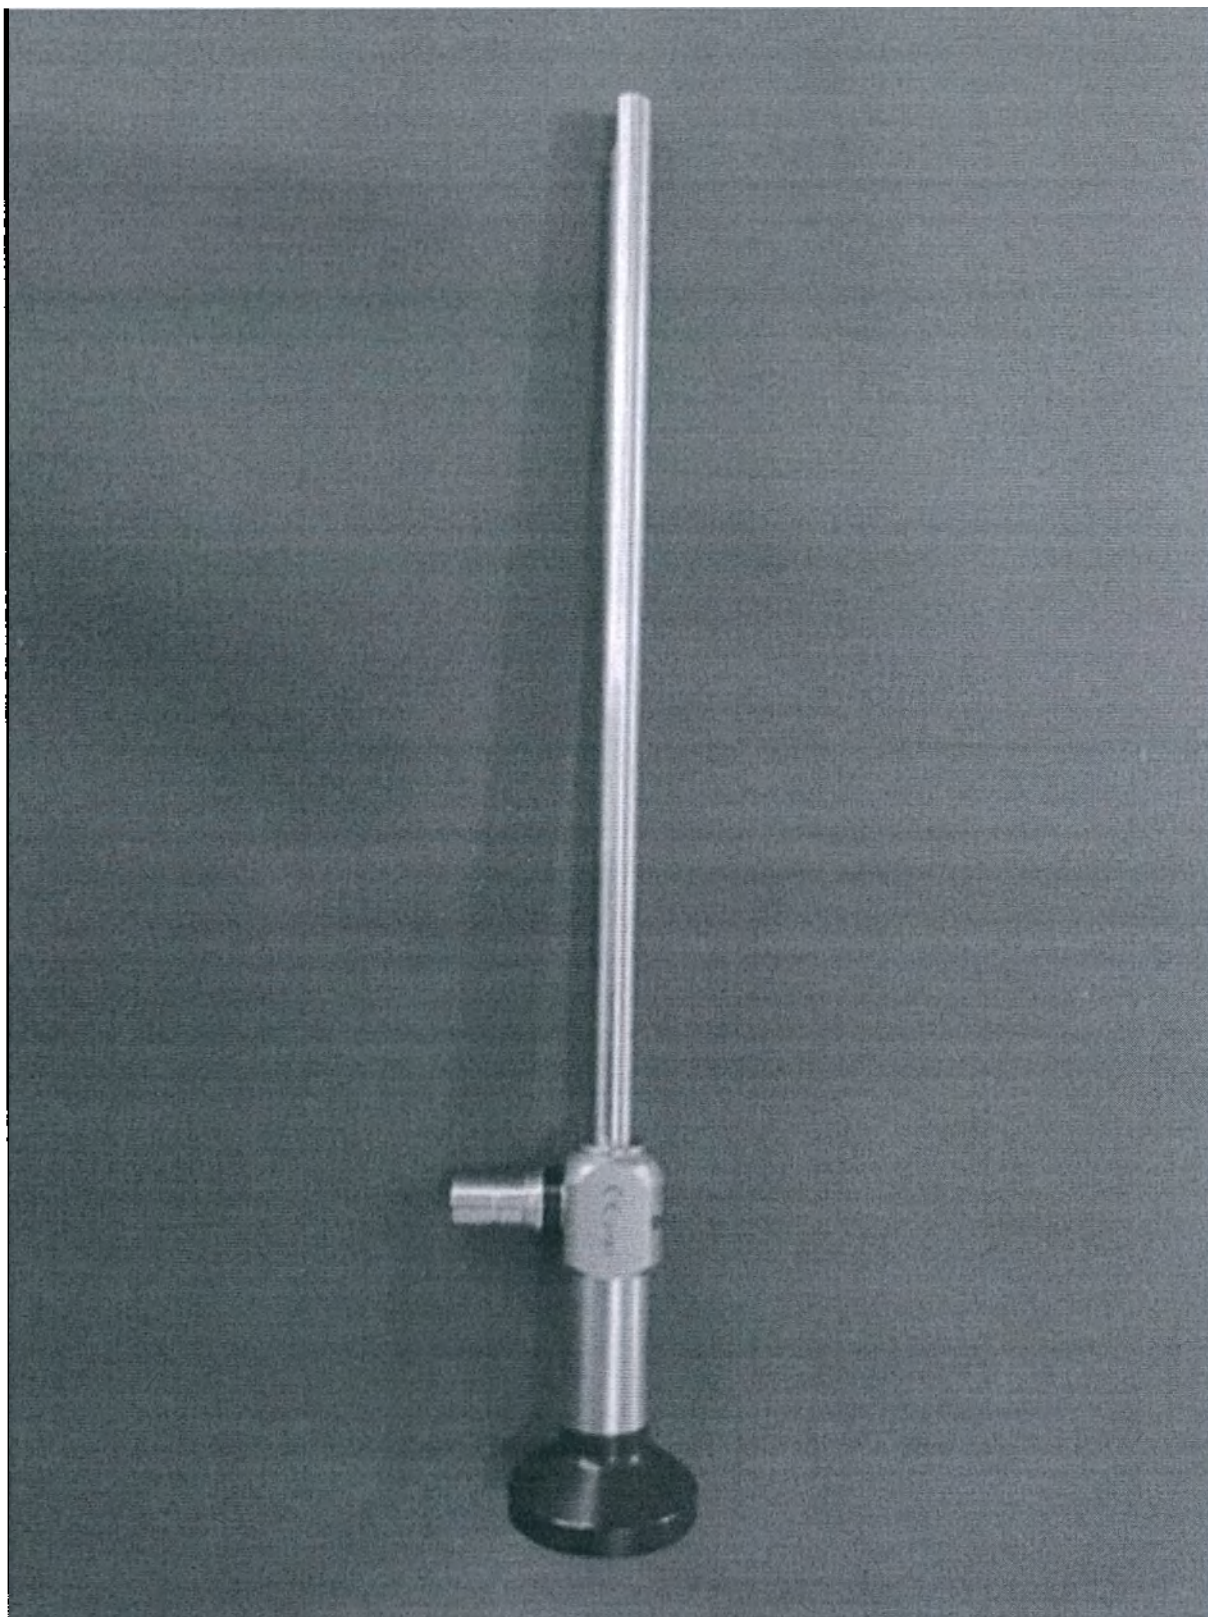


Инструментальная поверхность из стекла (черная).

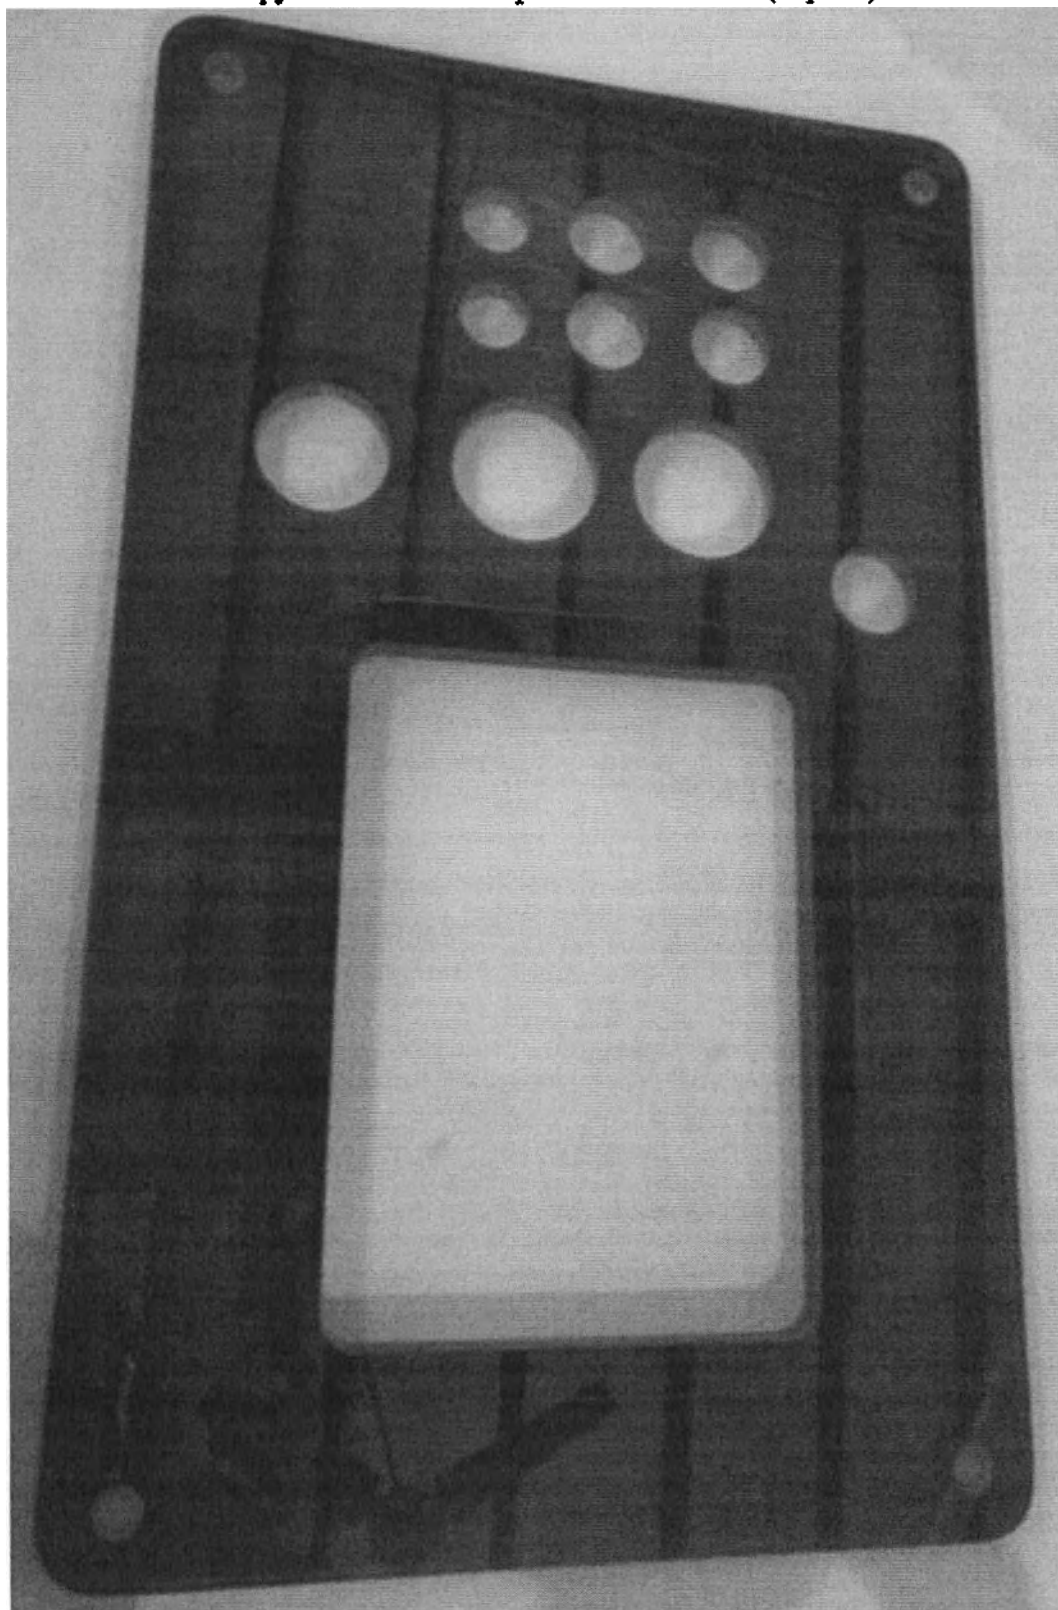

Инструментальная поверхность из стекла (белая).

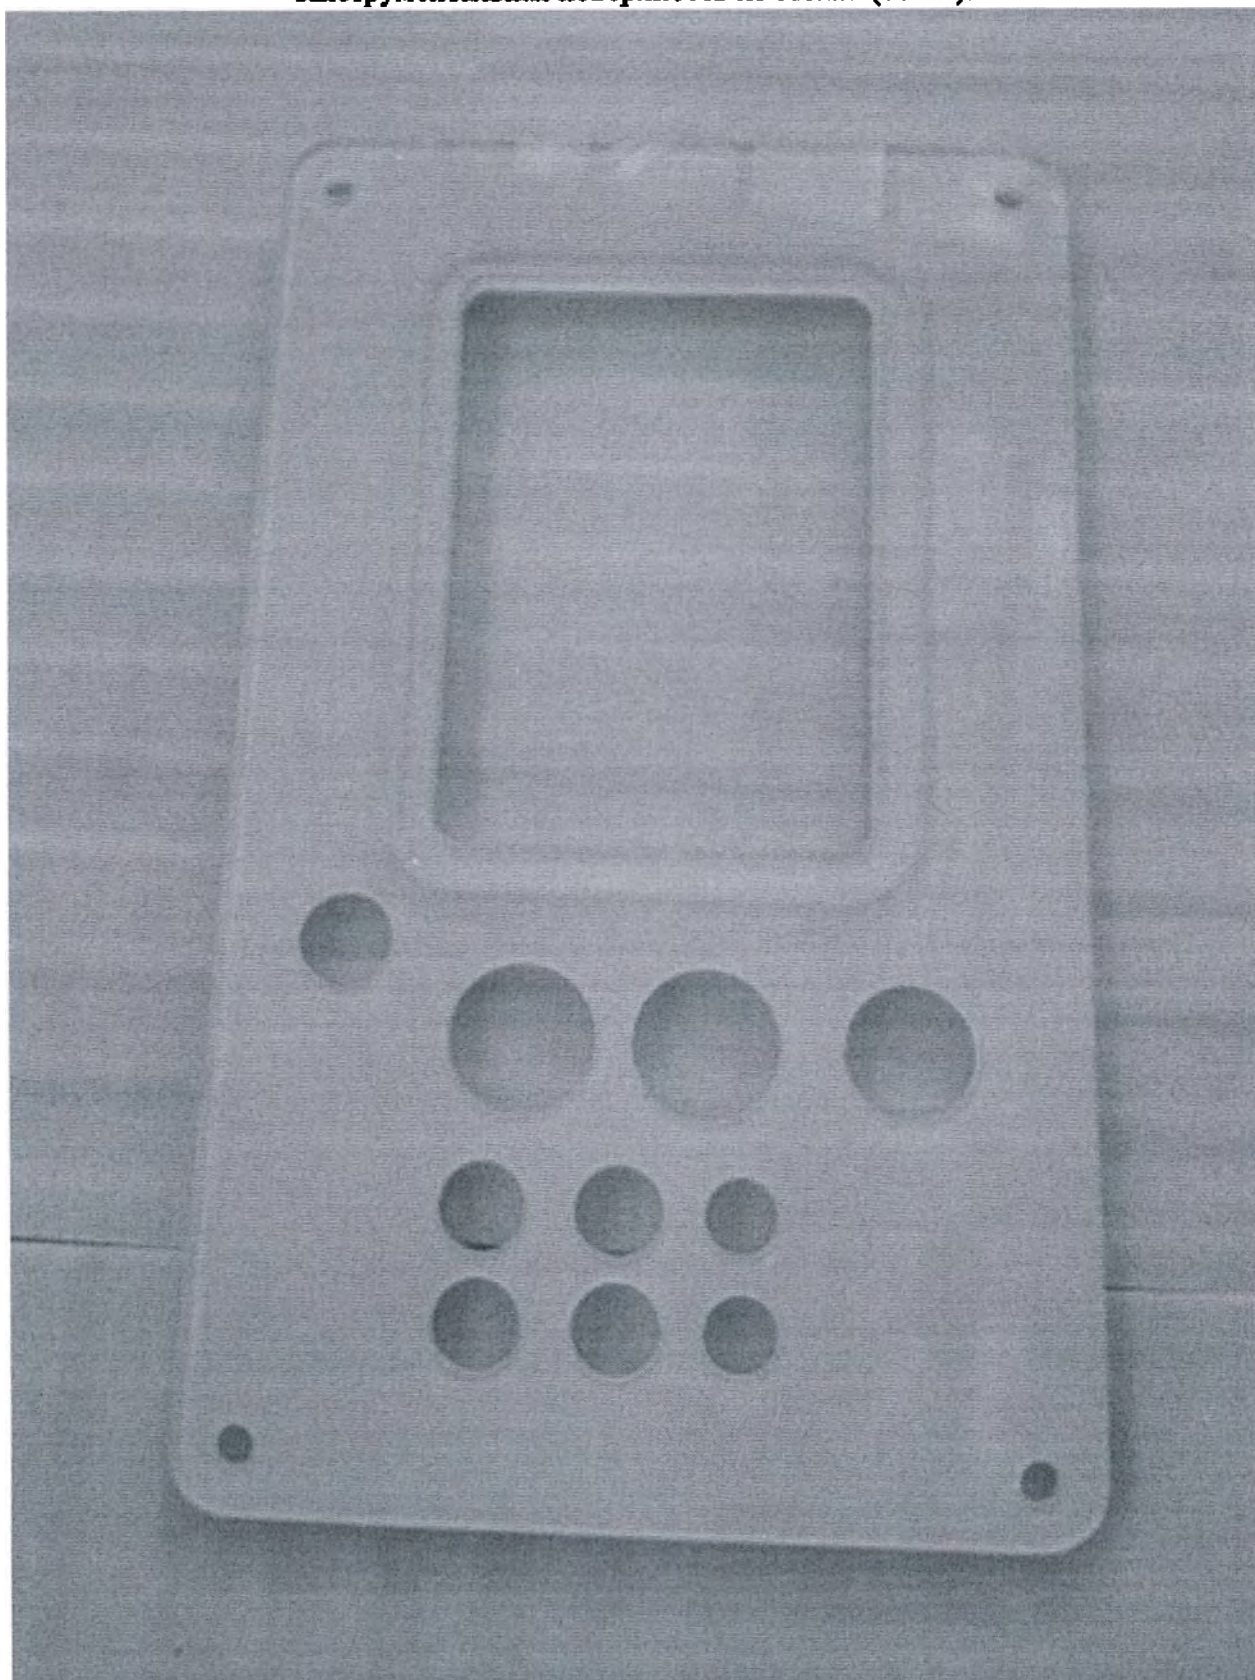


Болт фиксации инструментальной поверхности

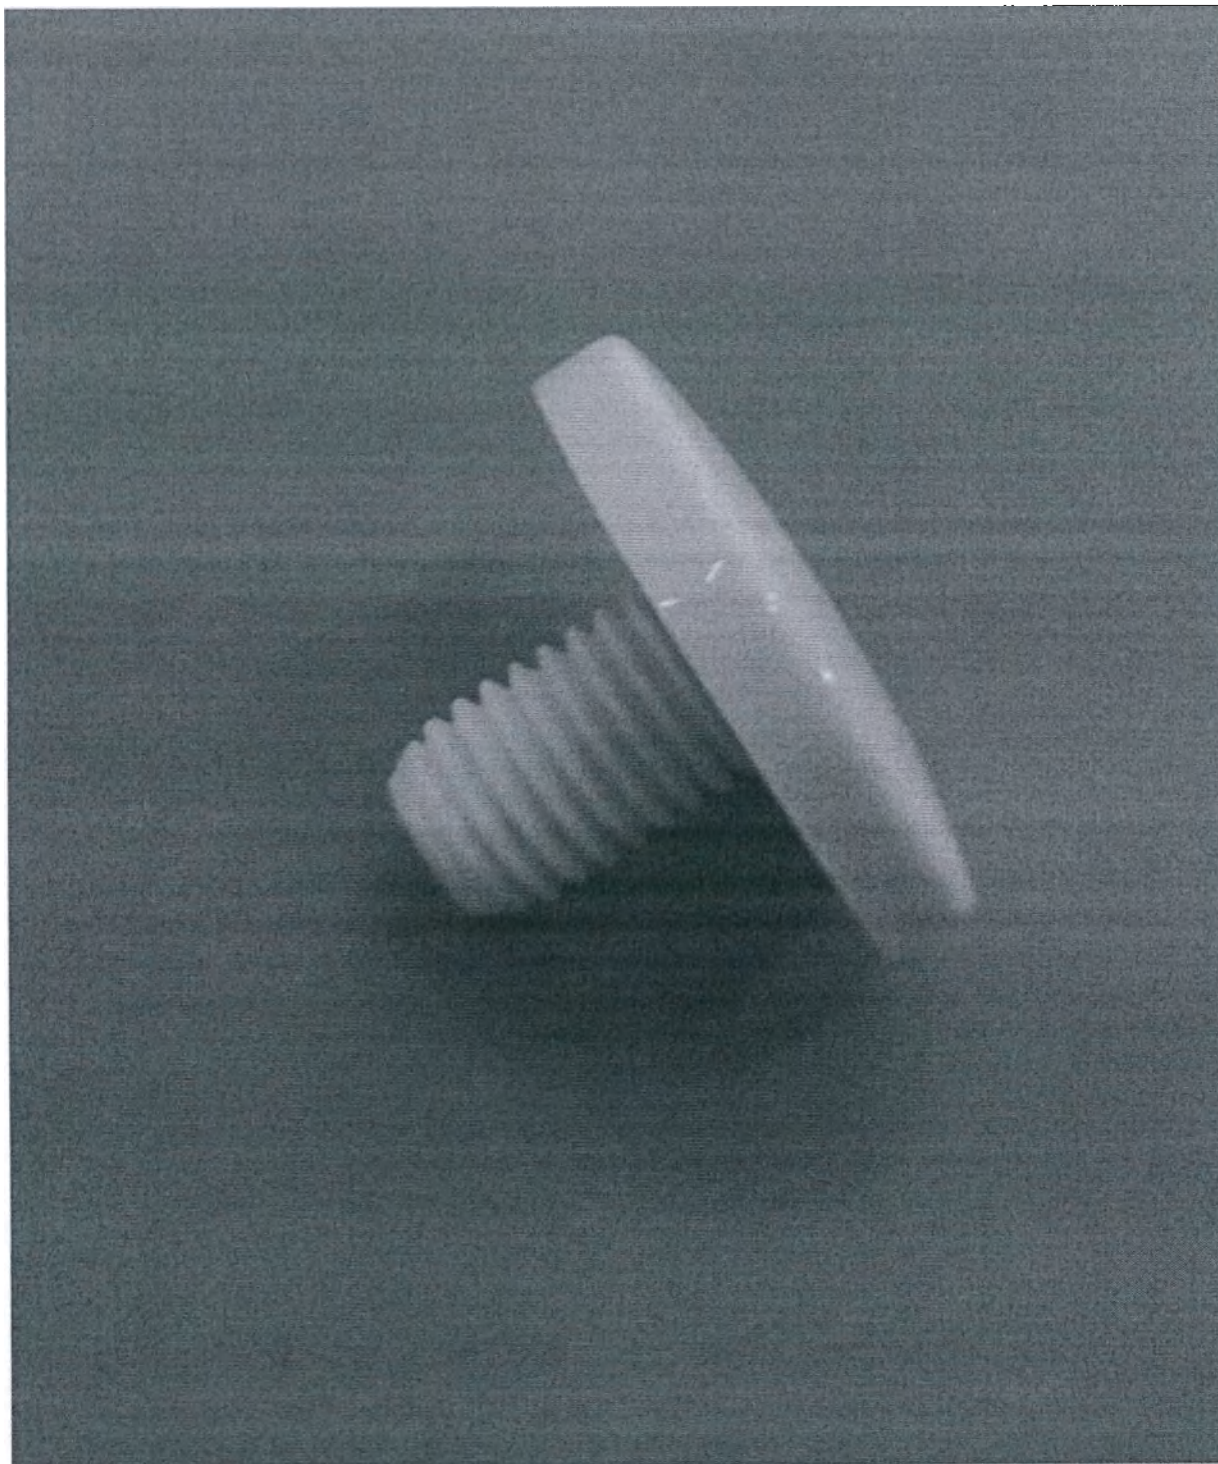

Держатель для ЛОР-эндоскопов специальных для дезинфекции и хранения эндоскопов специальных.



Емкость для секрета малая, объем 500 мл.

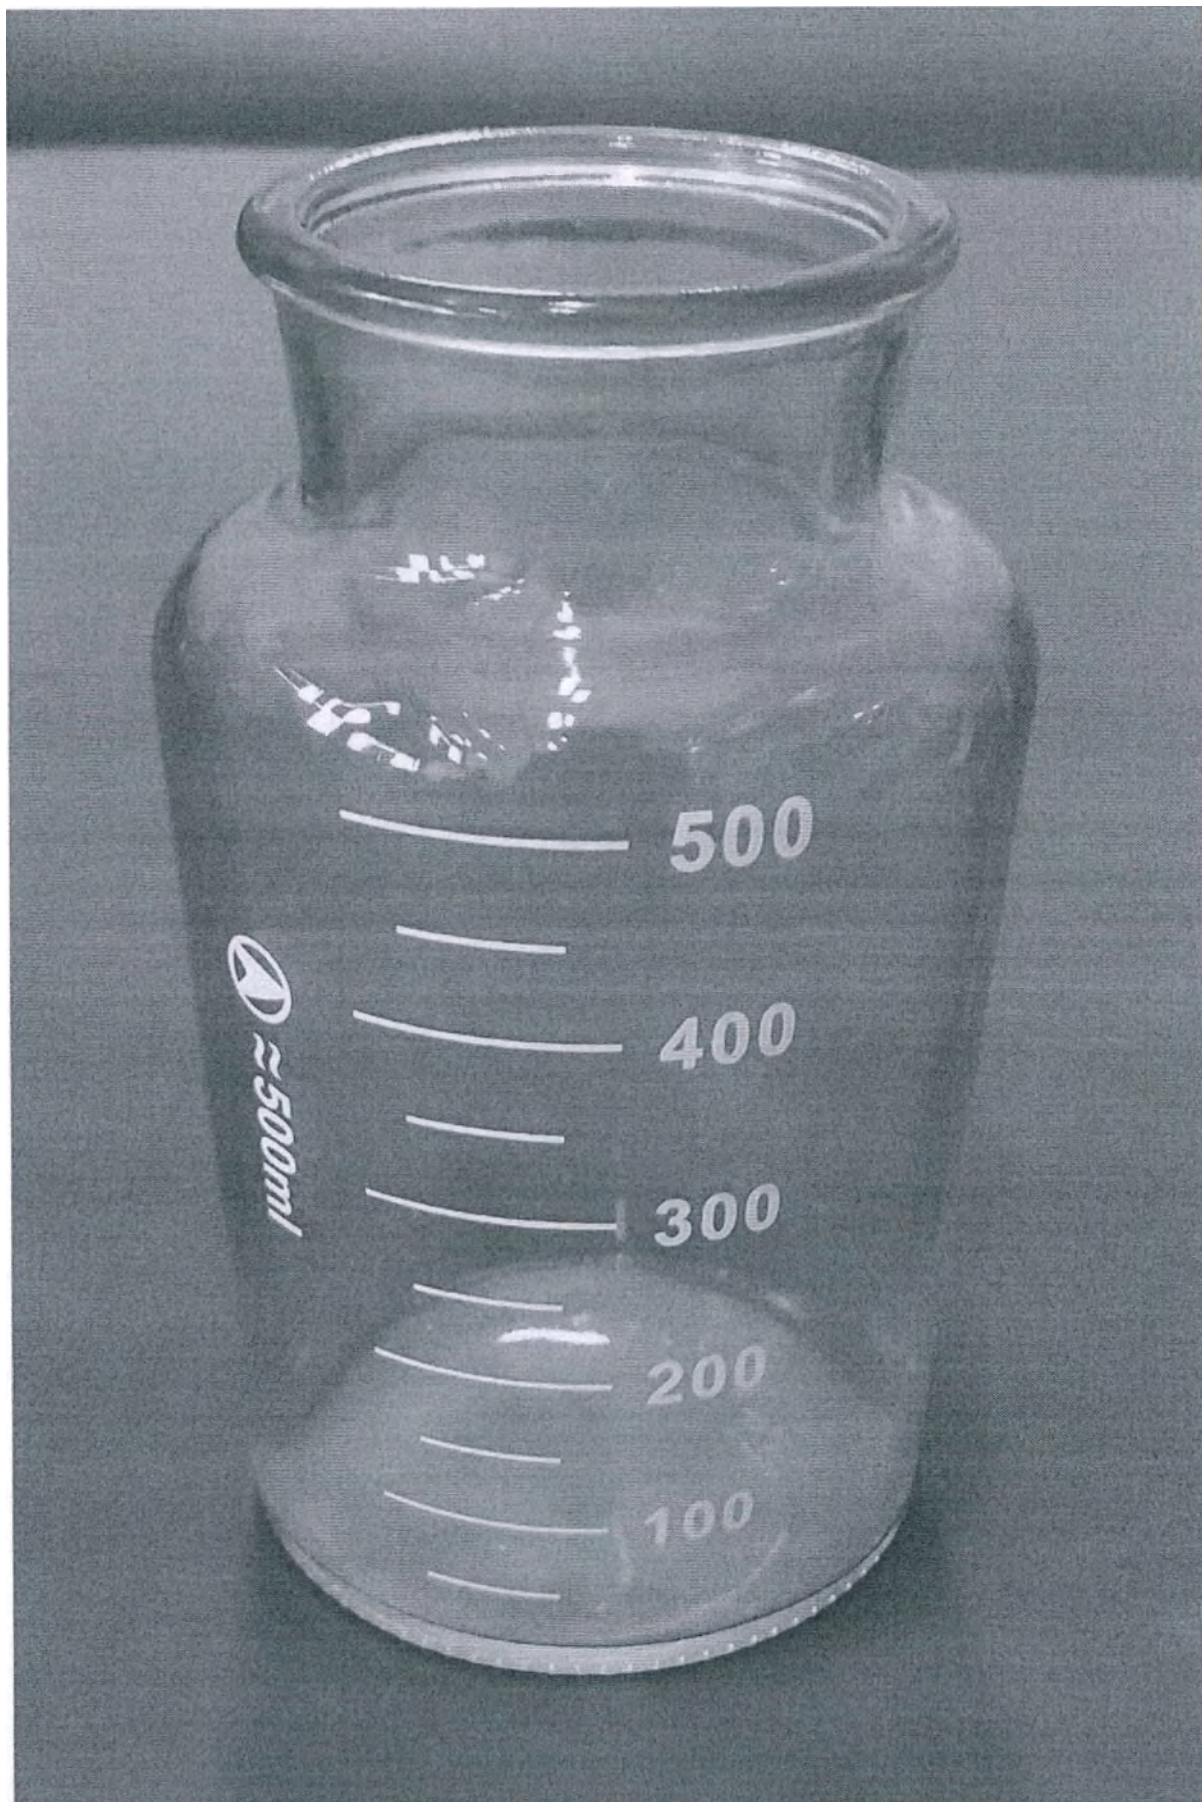


Олива Политцера пластиковая




Олива Политцера металлическая




Ролик для перемещения рабочего места

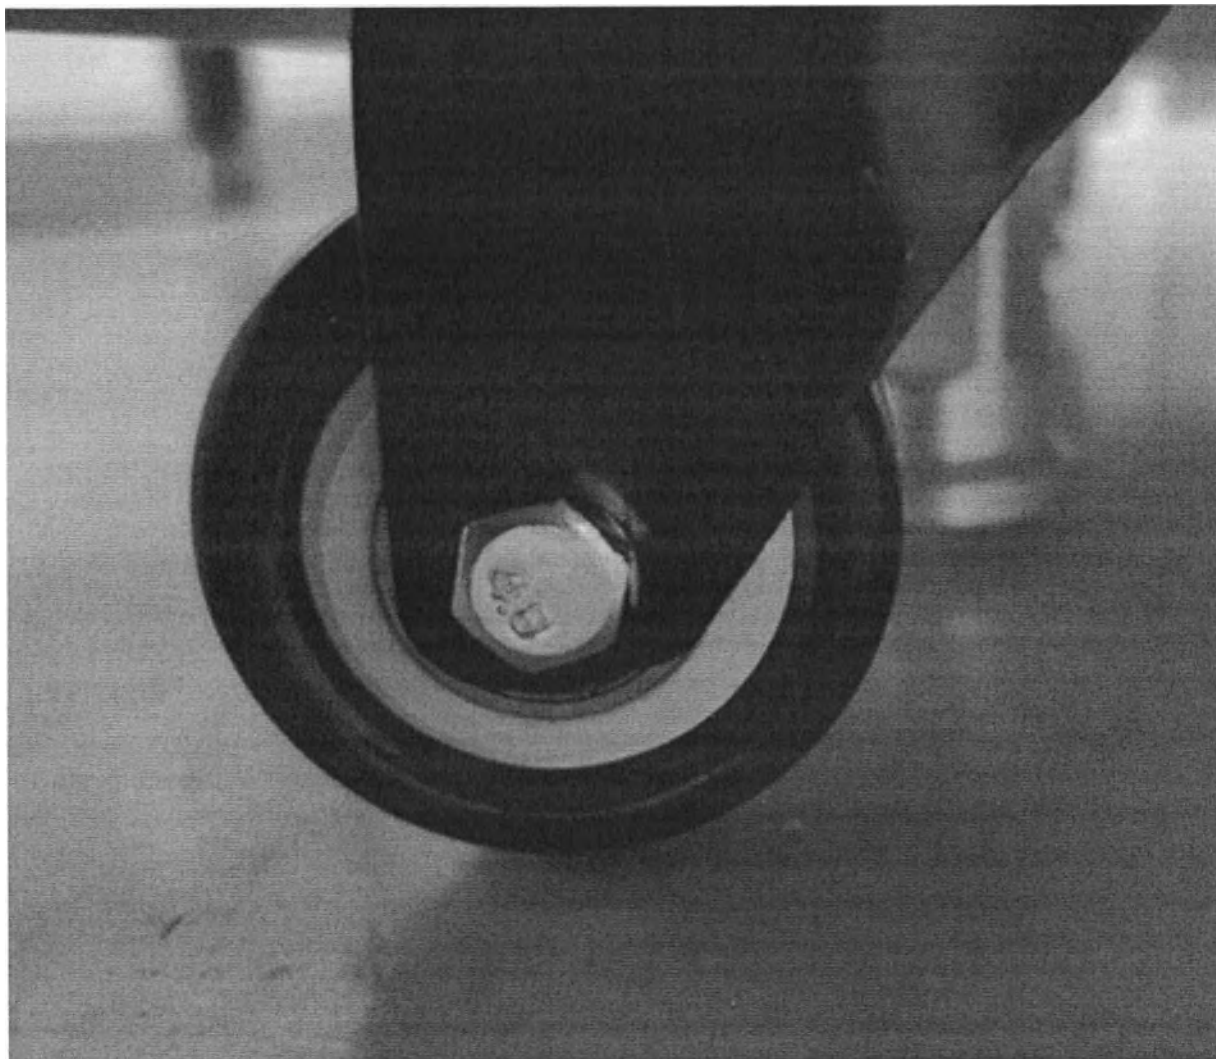

CCD – видеокамера специальная.

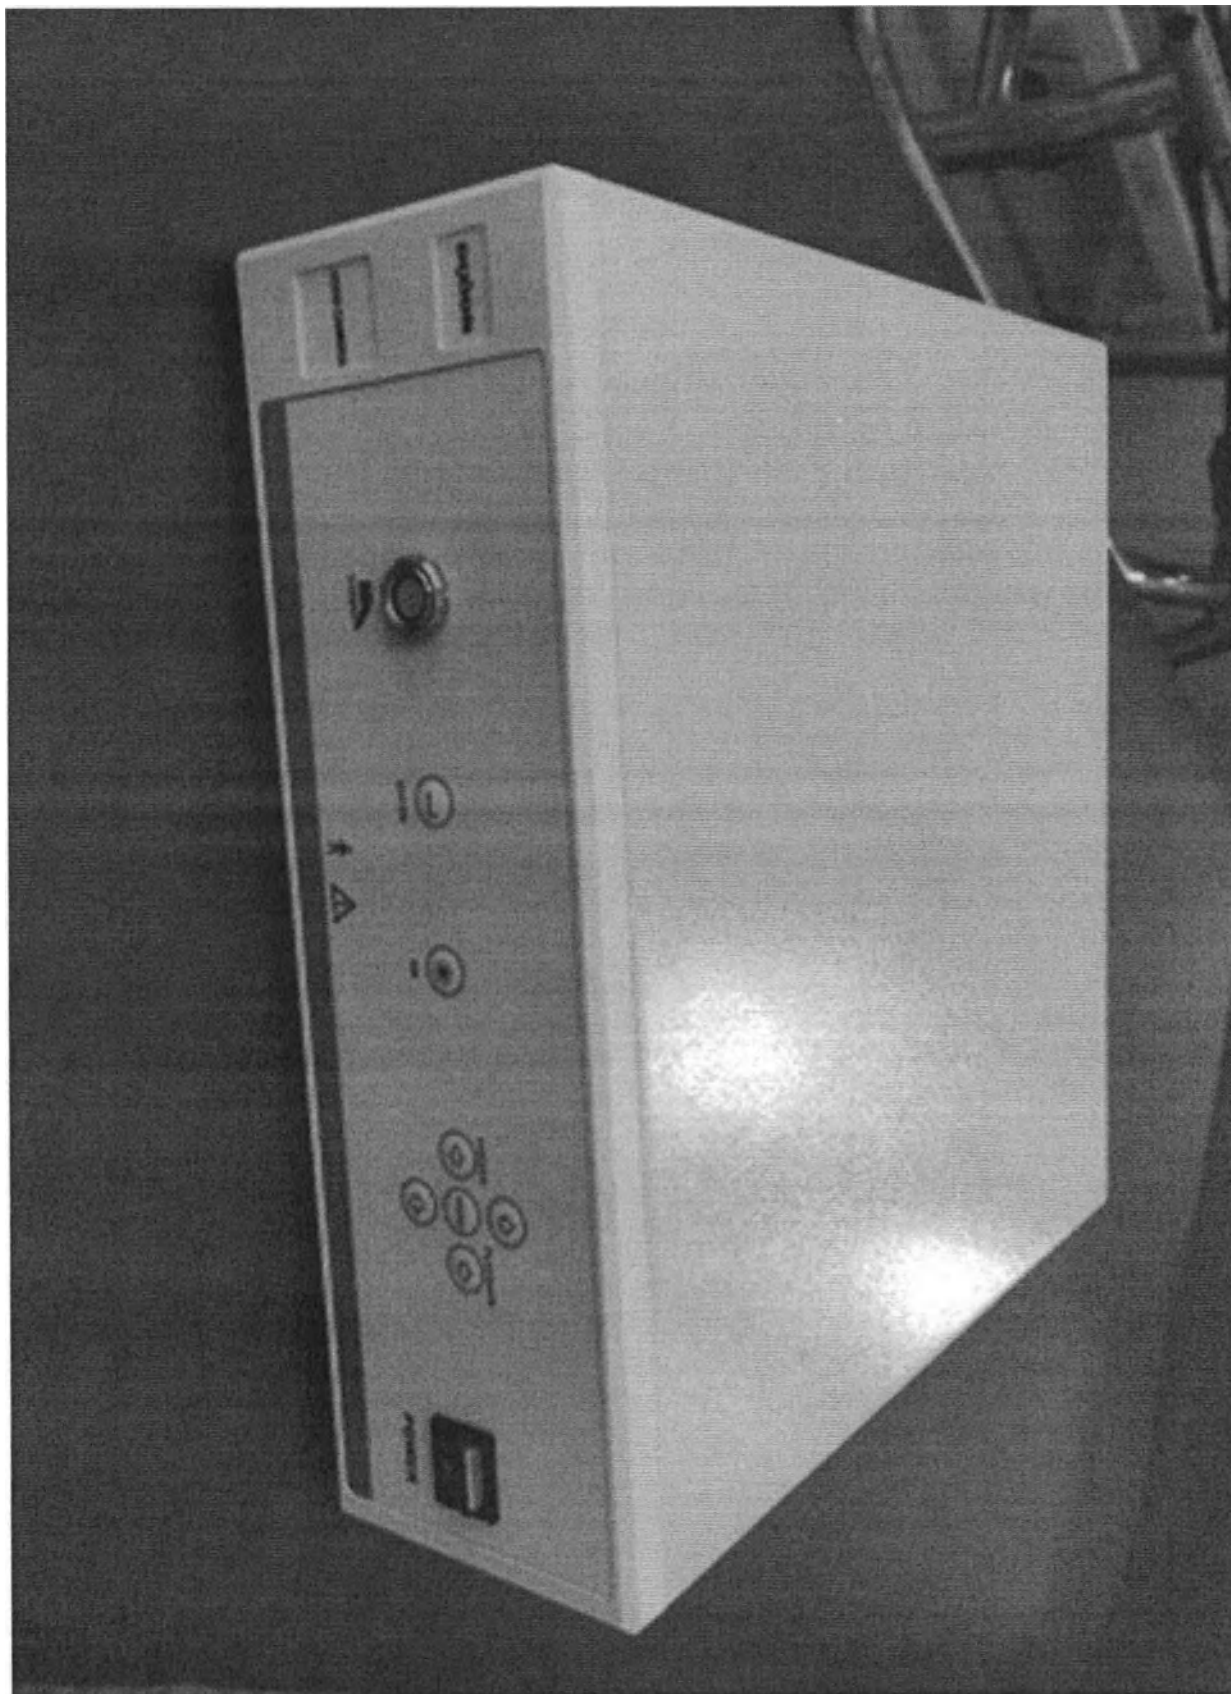


Кабель подключения CCD – видеокамеры специальной к монитору ЖК специальному

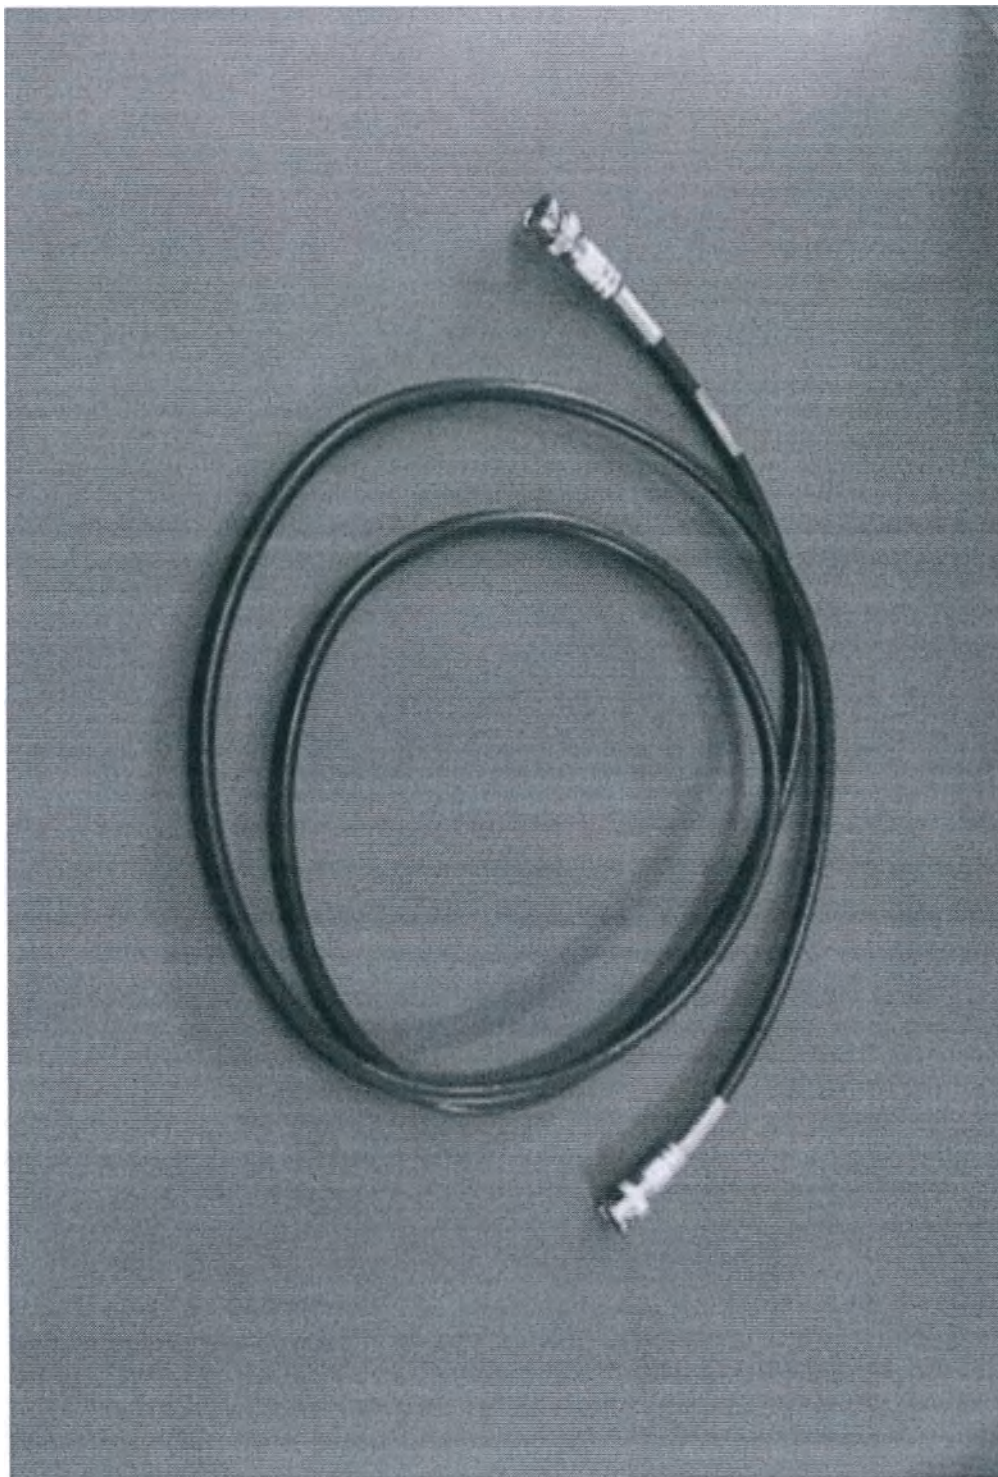


Головка CCD-видеокамеры специальной



Кабель питания для CCD – видеокамеры специальной

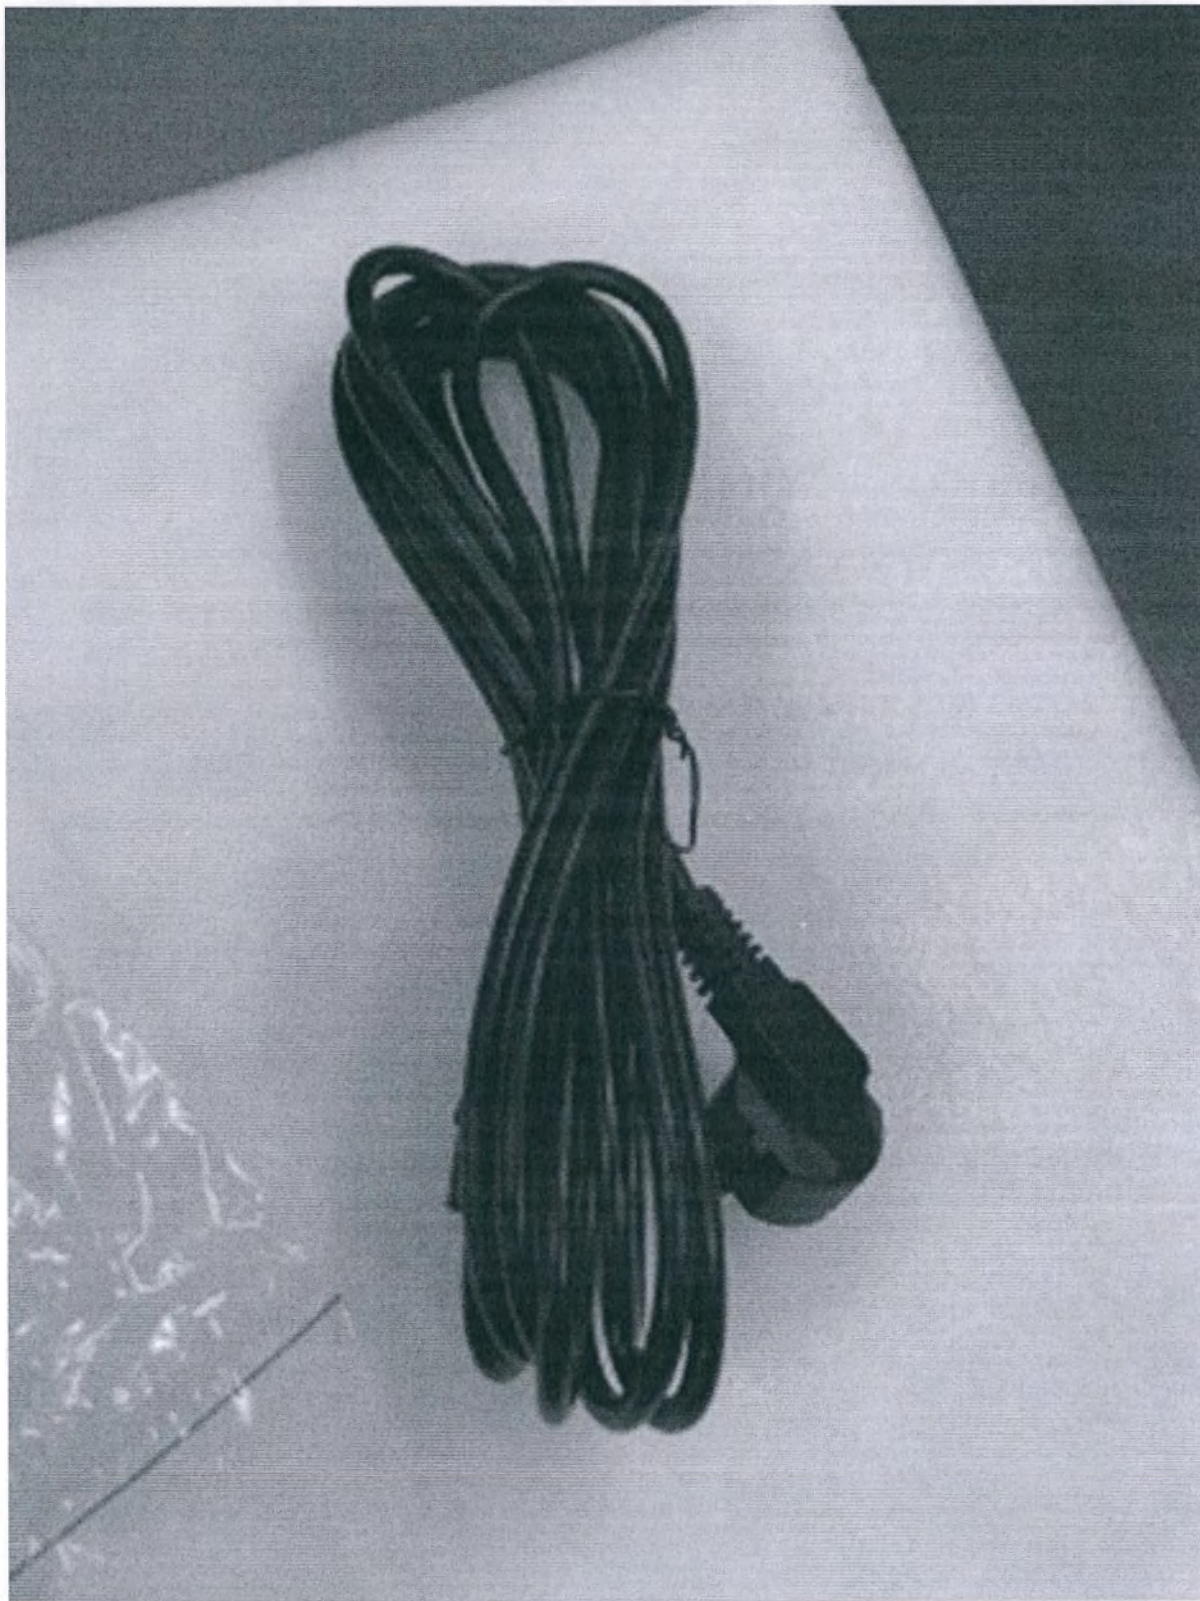


Монитор ЖК специальный для CCD – видеокамеры специальной.

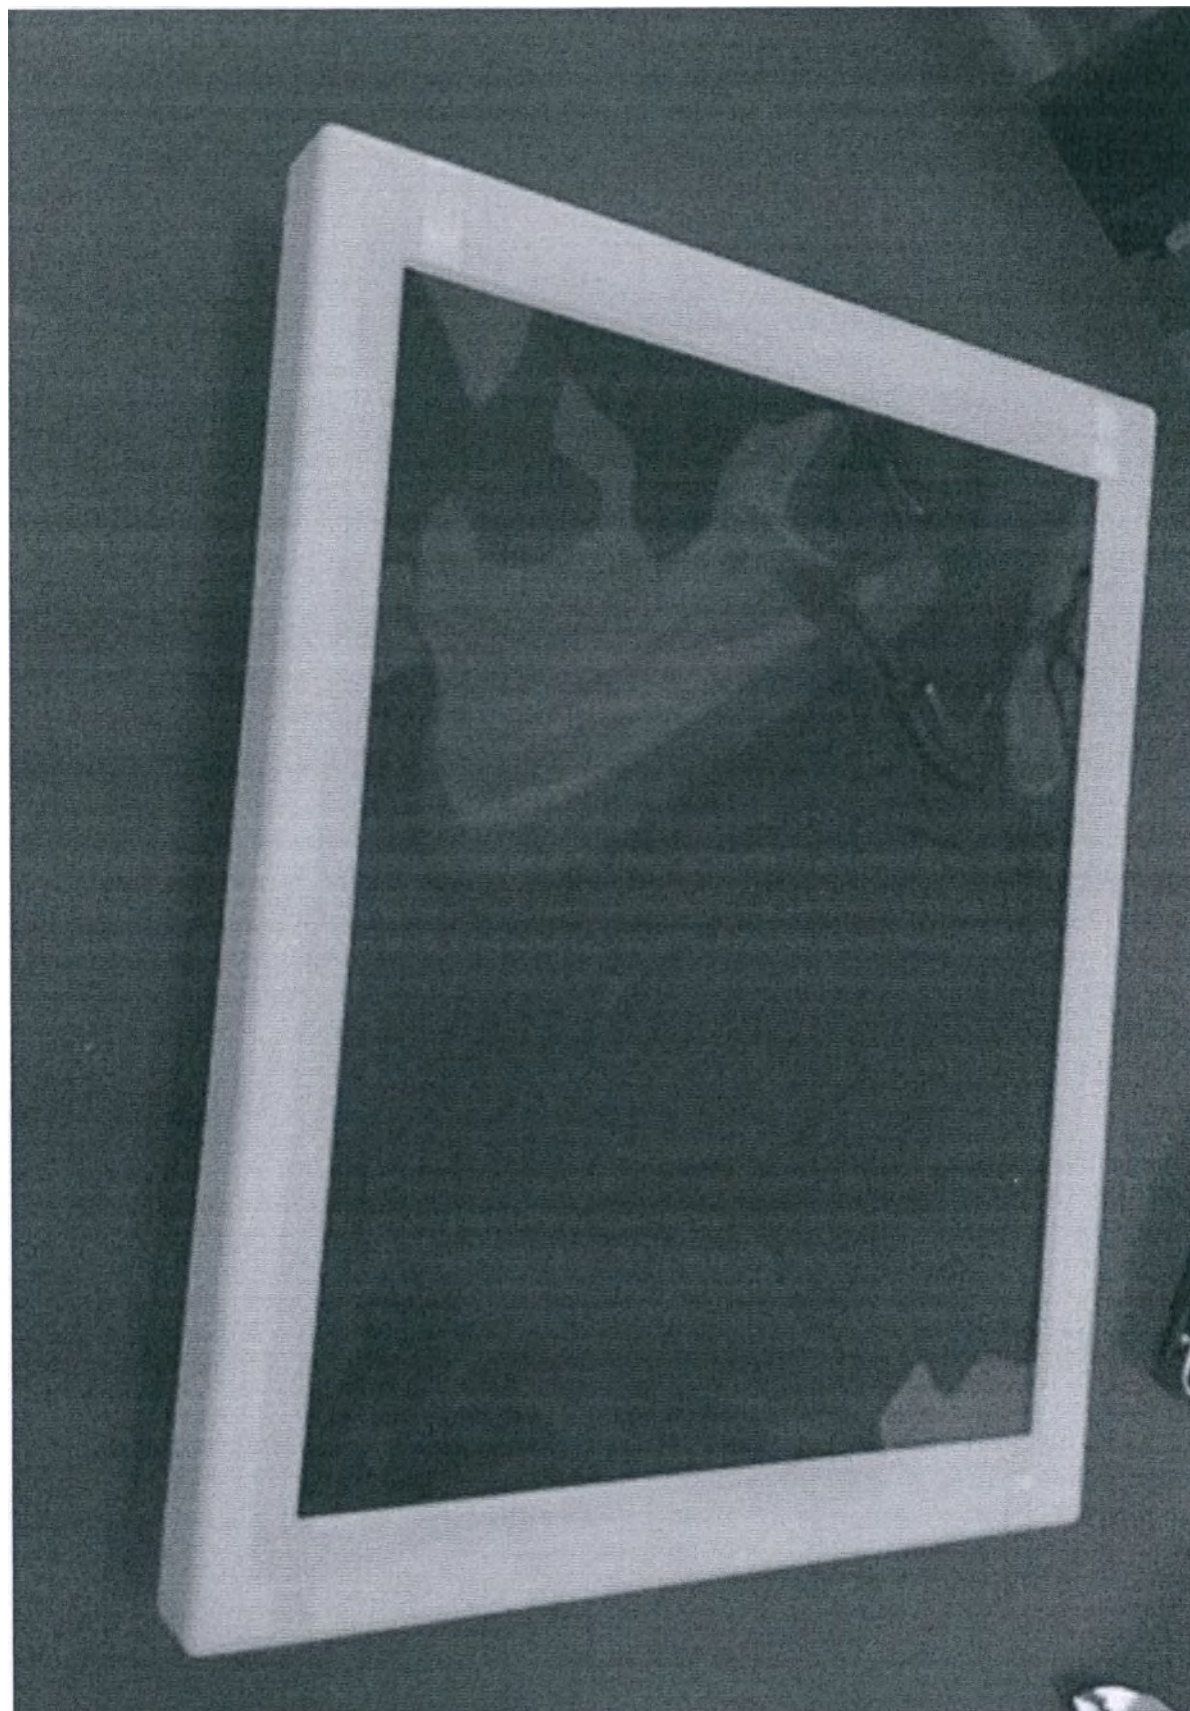


DVI- кабель для монитора ЖК специального



S-video кабель для монитора ЖК специального

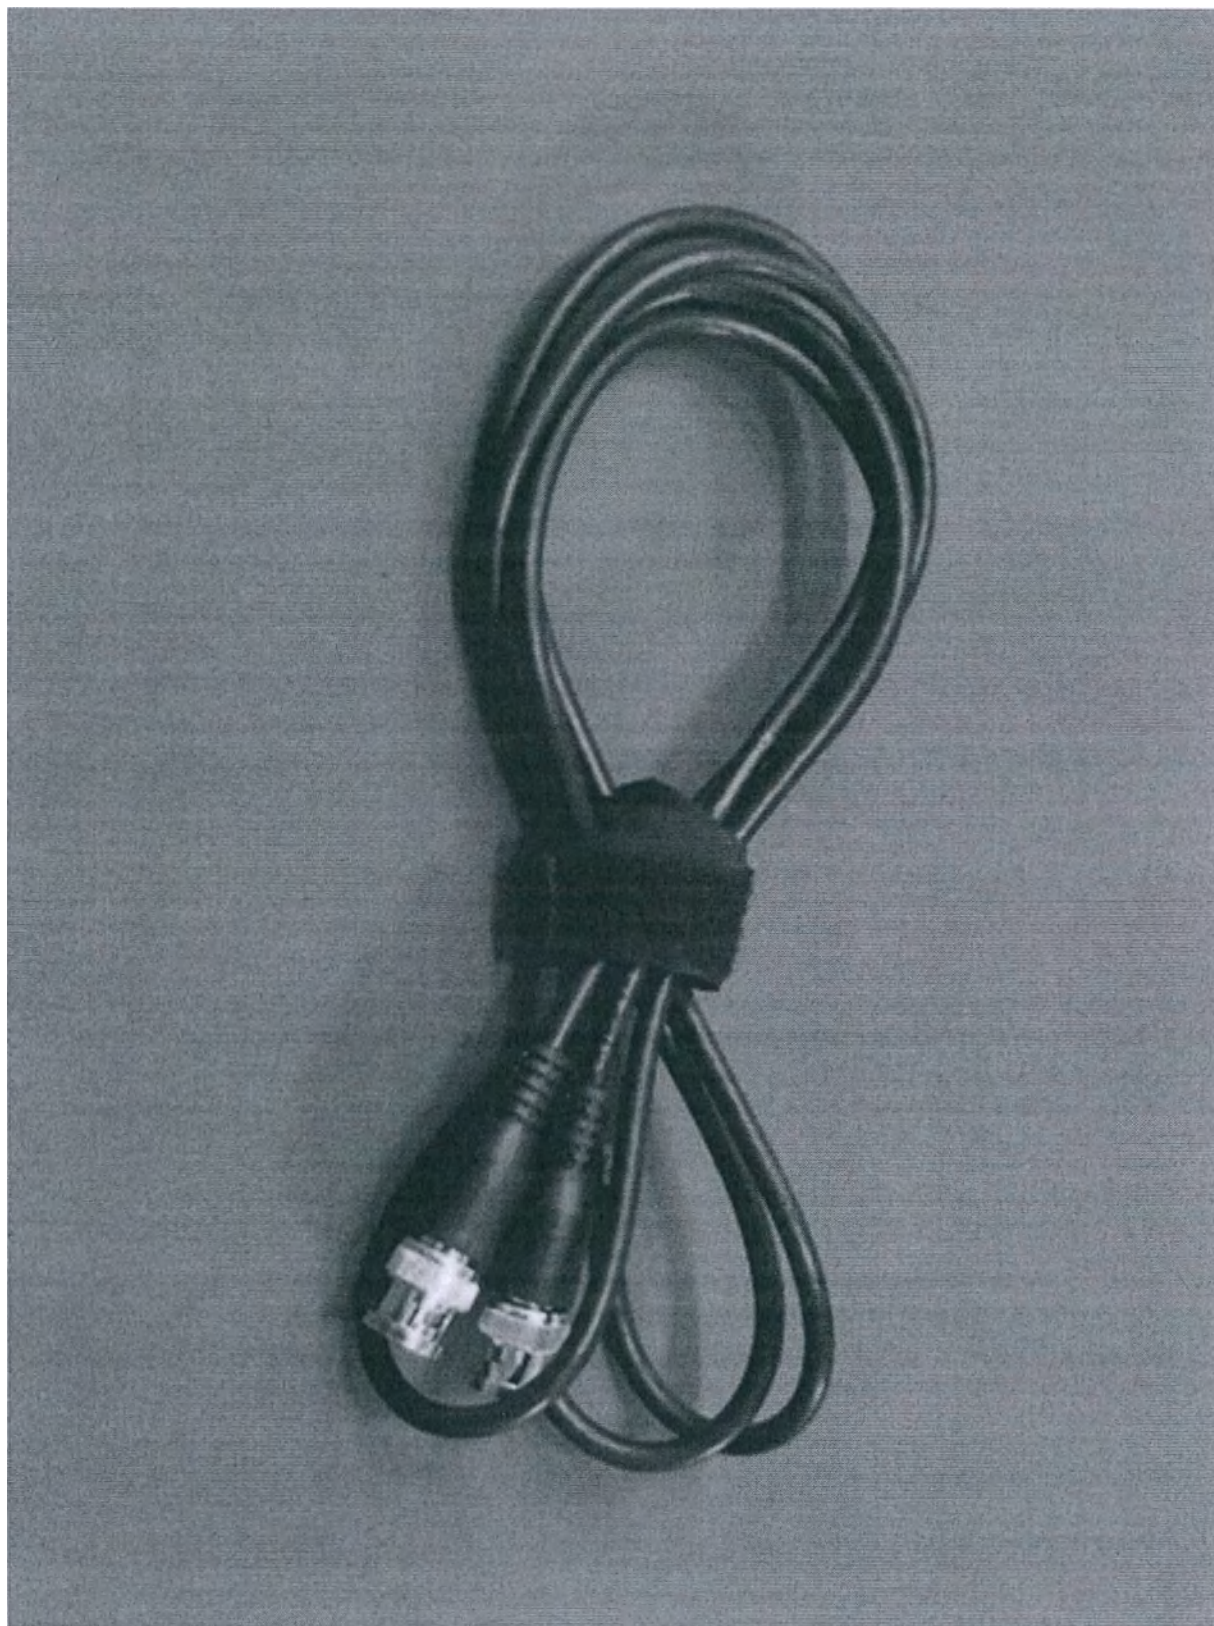


Кабель питания для монитора ЖК специального

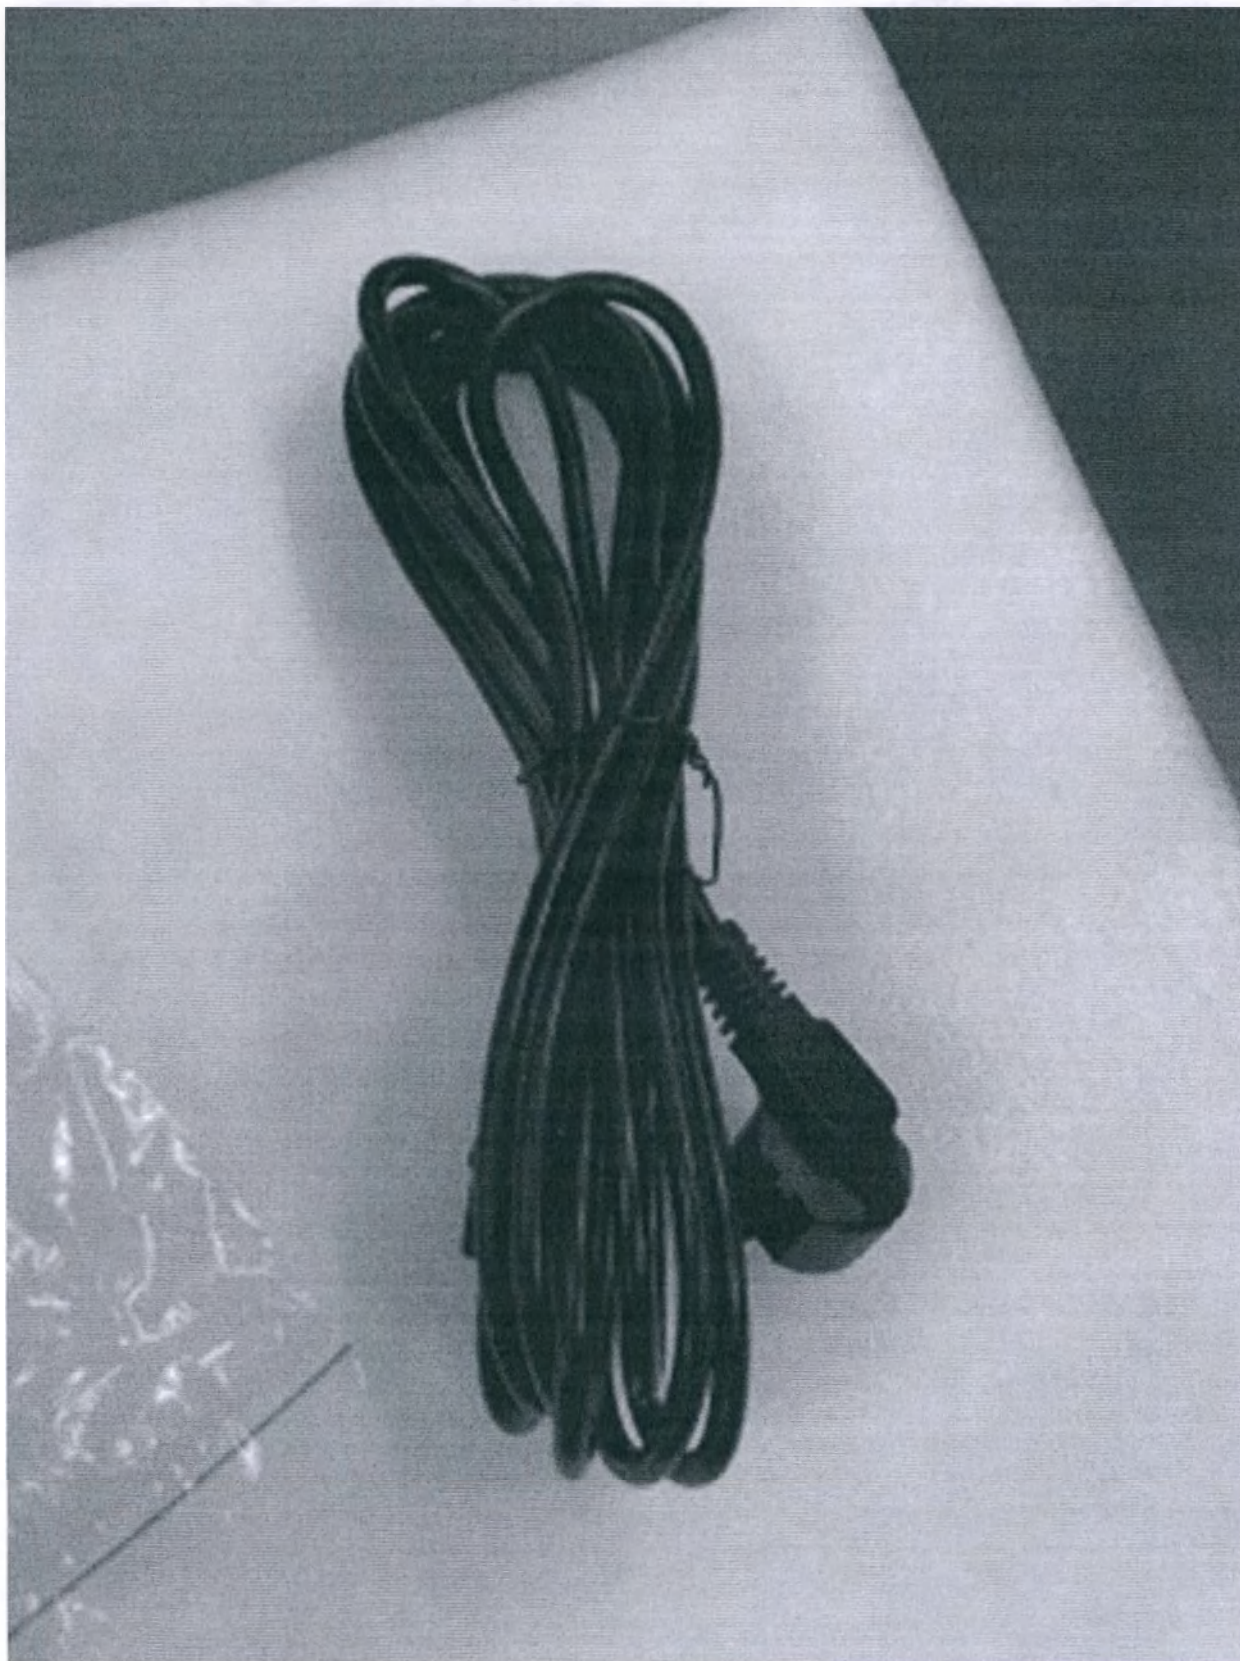

Держатель для CCD – видеокамеры специальной.



Кронштейн-держатель для монитора ЖК специального.

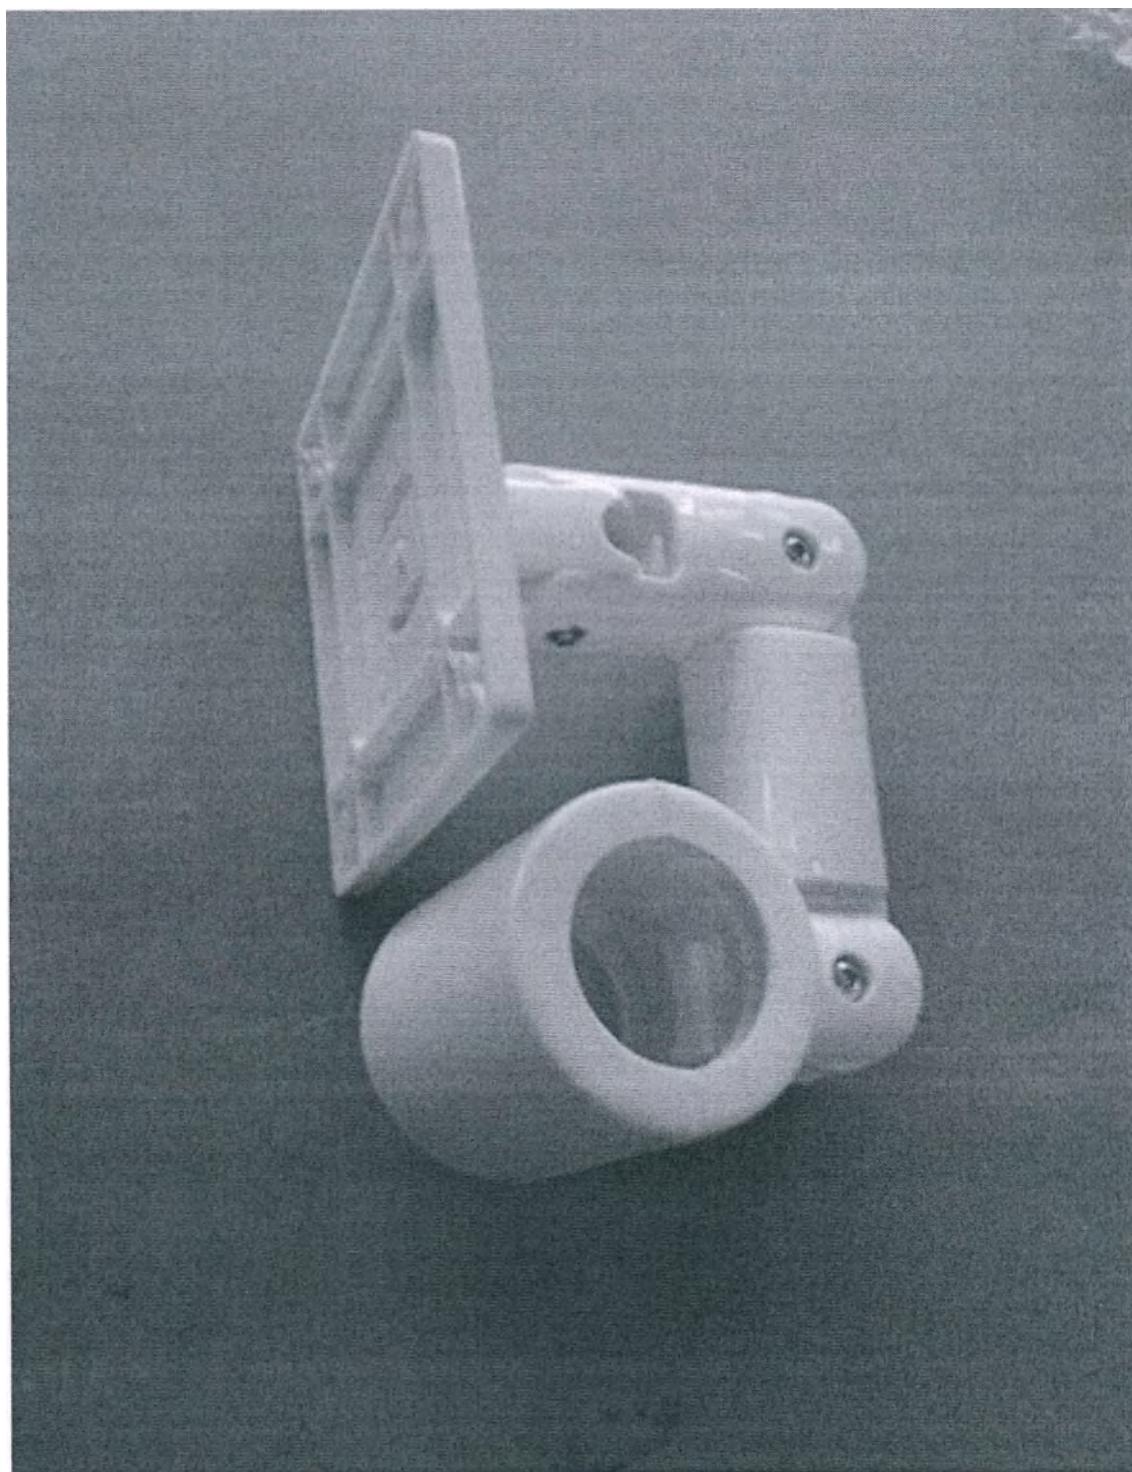

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
4 ЛИСТОВ



Генеральный директор
ООО «МТО Стормовь»
Брукс Е.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МТО «Стормовь»




Брукс Е.В.

20.08.2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА DIXION ST
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ DIXION ST-E600


Корпус с инструментальной поверхностью.

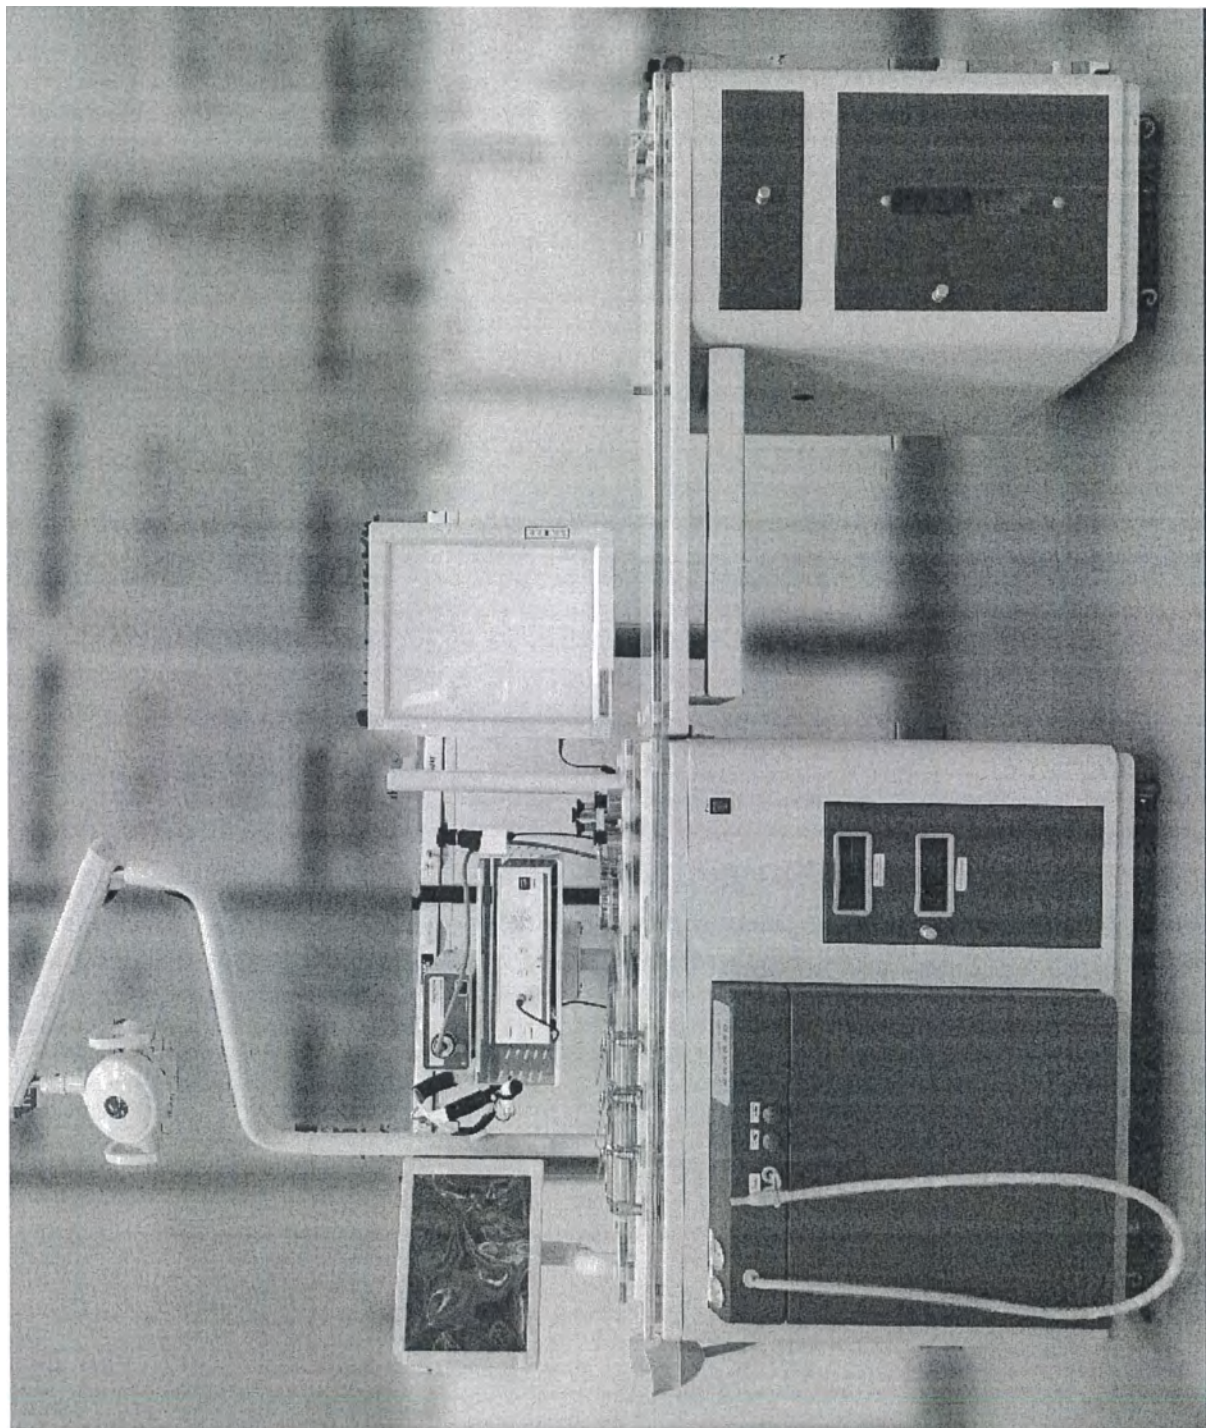


Осветитель.




Стойка осветителя.

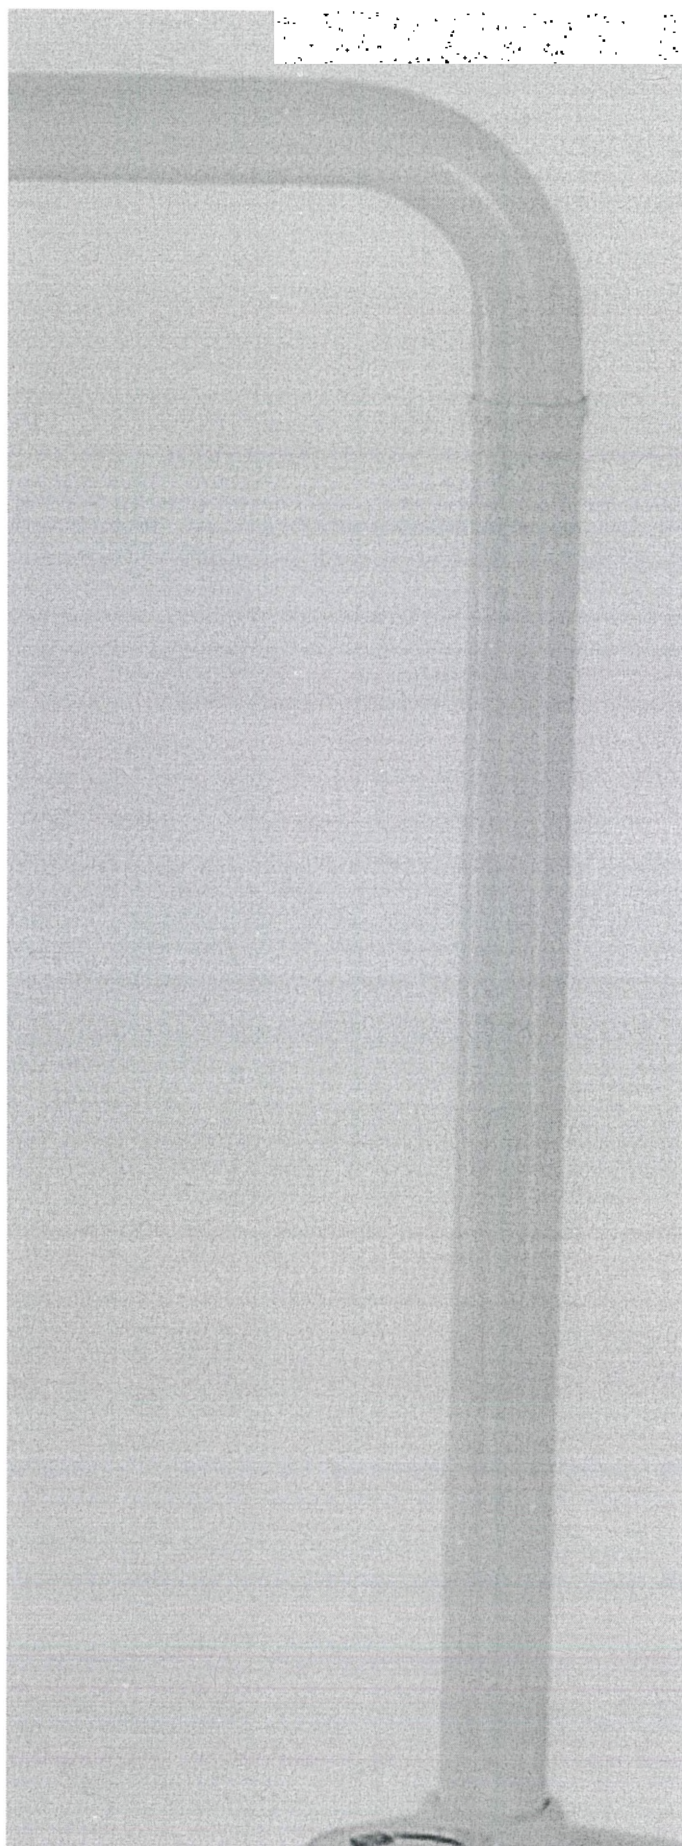


Рычаг осветителя.

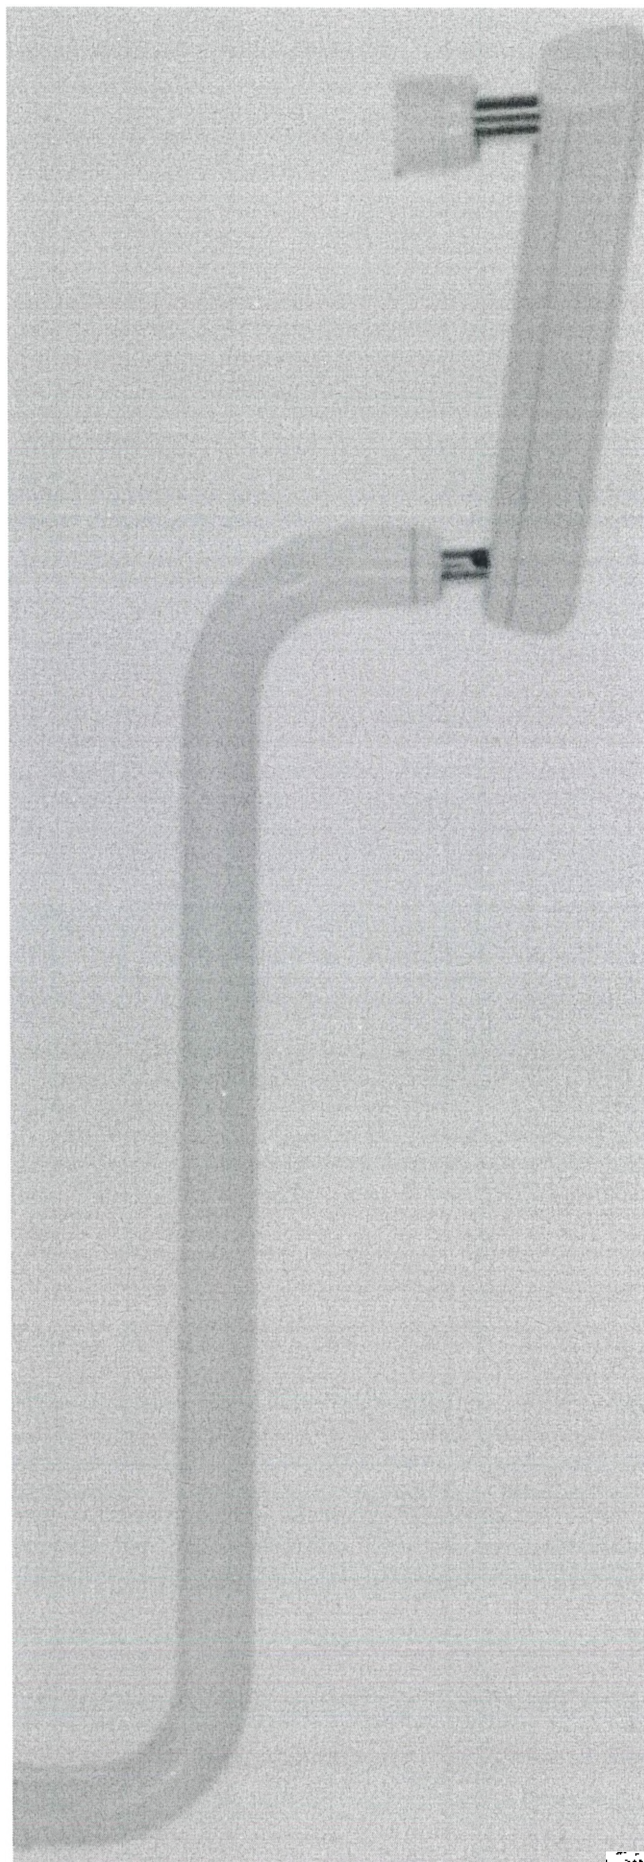


Распылитель лекарственных средств

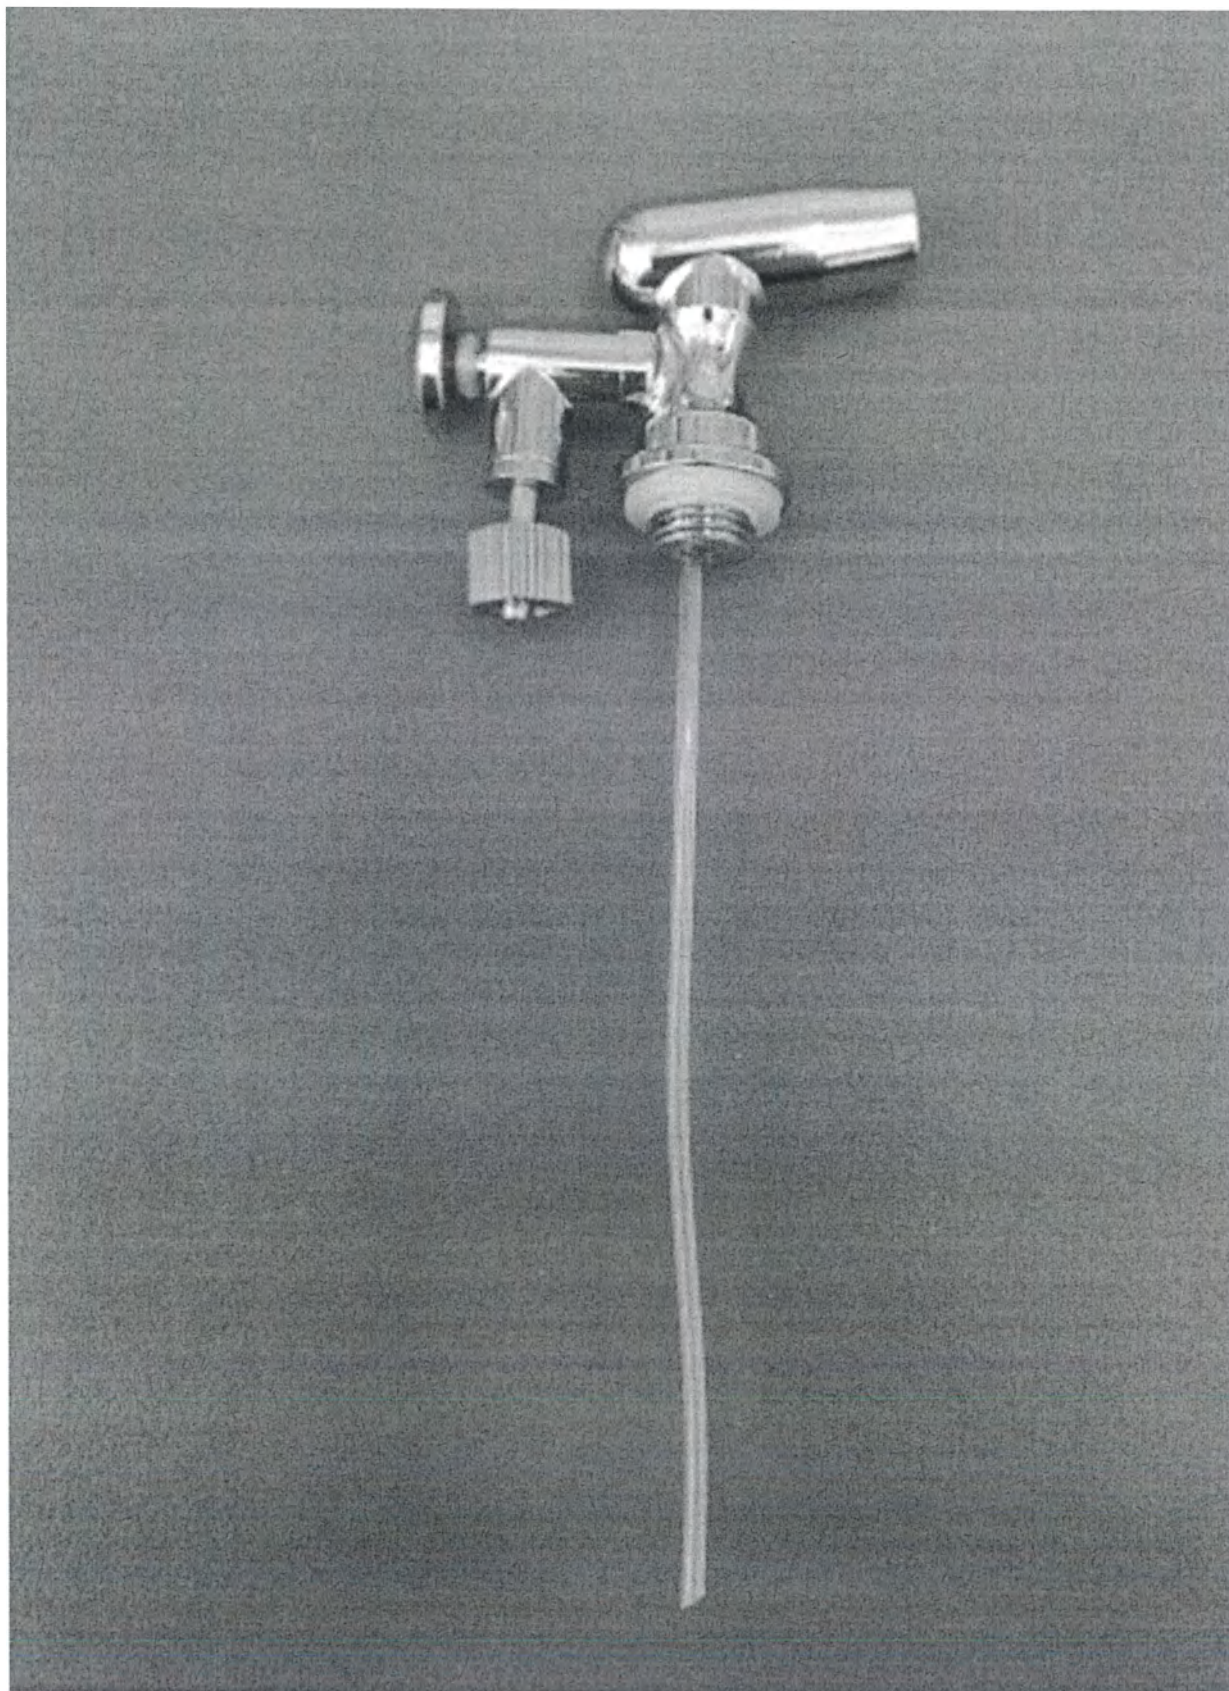


Наконечник (трубка-сопло) прямой для распыления медикаментов

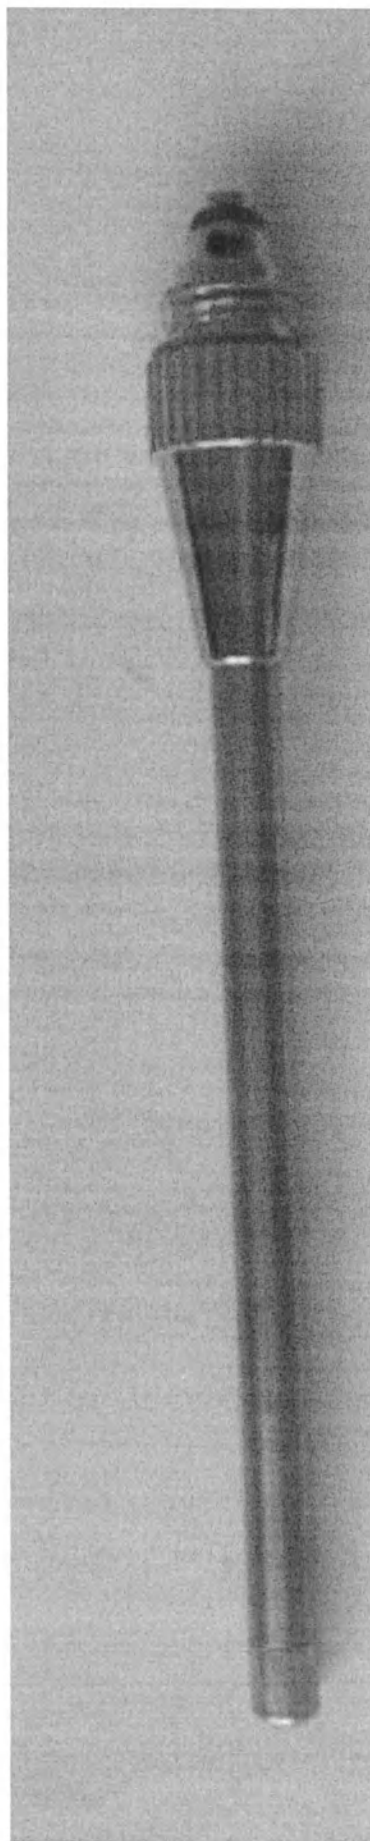


Наконечник (трубка-сопло) изогнутый для распыления медикаментов

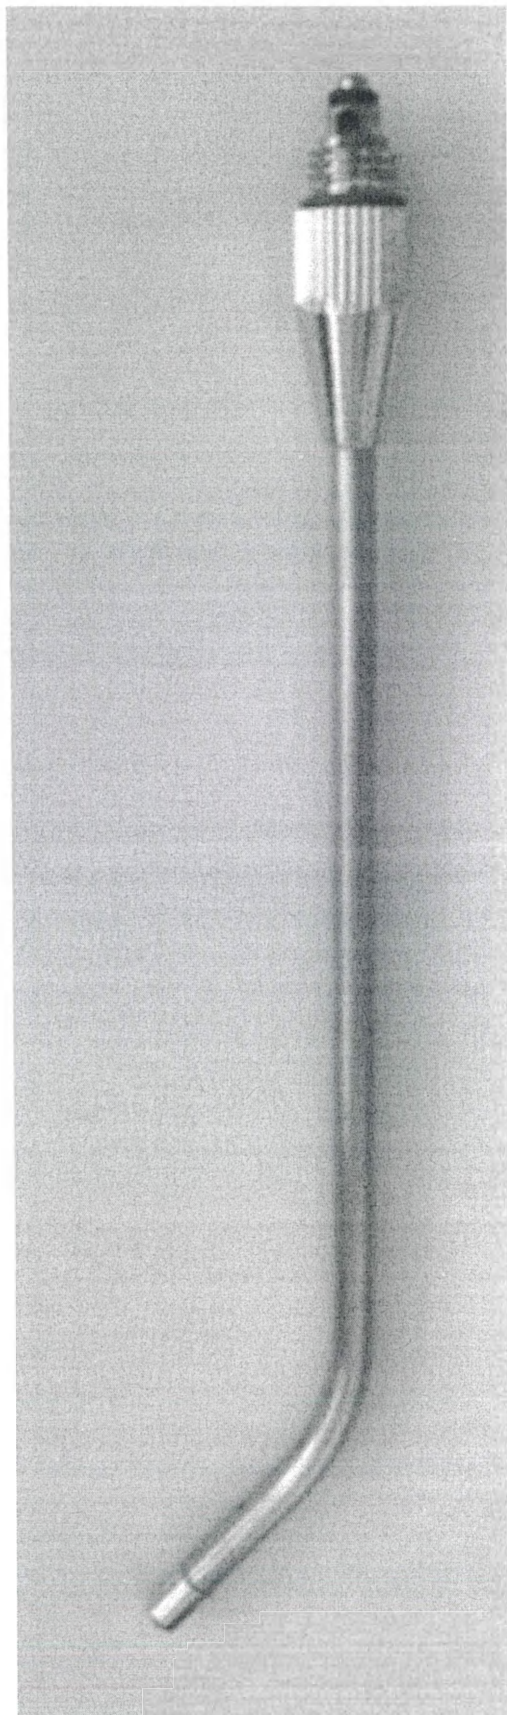


Колба пластиковая для медикаментов

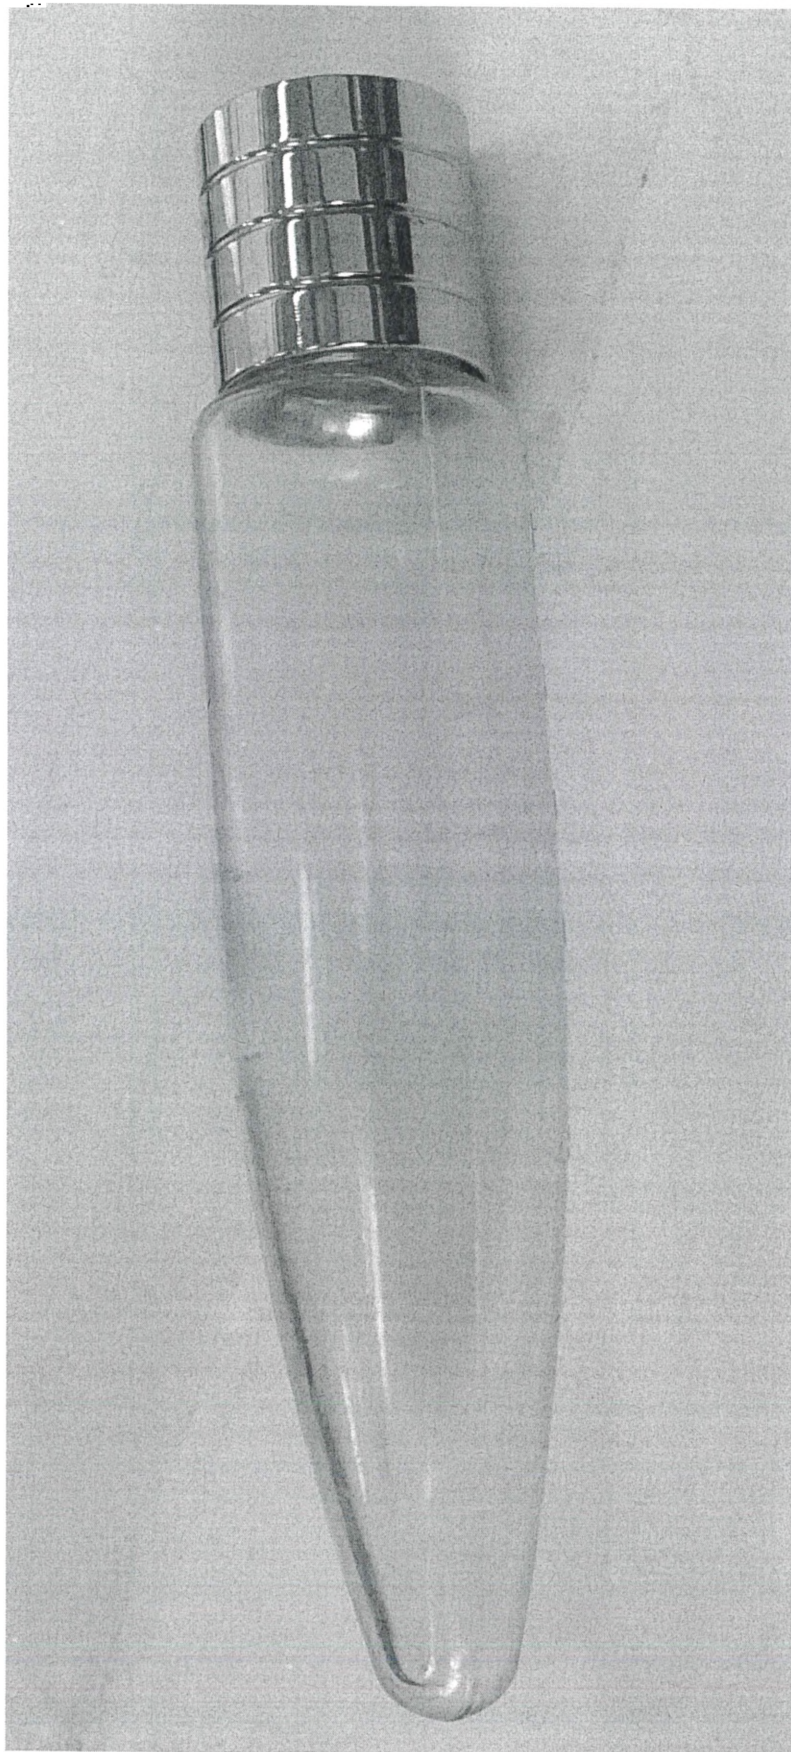

Трубка распылителя

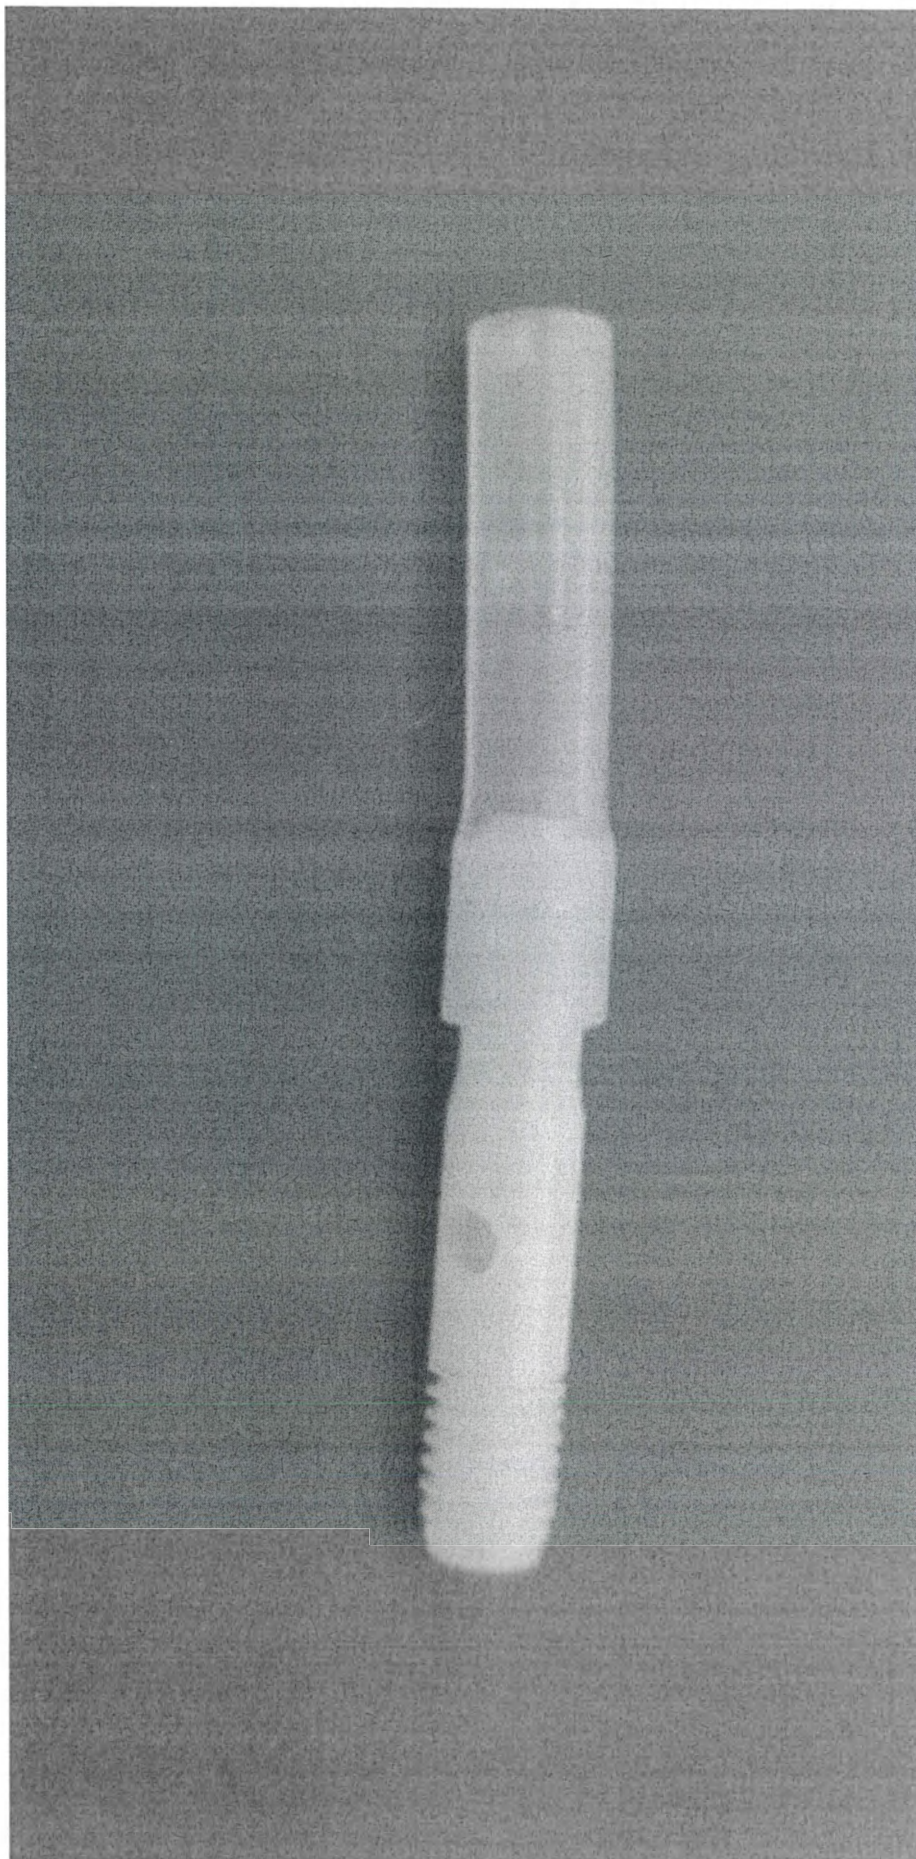


Соединительный шланг распылителя

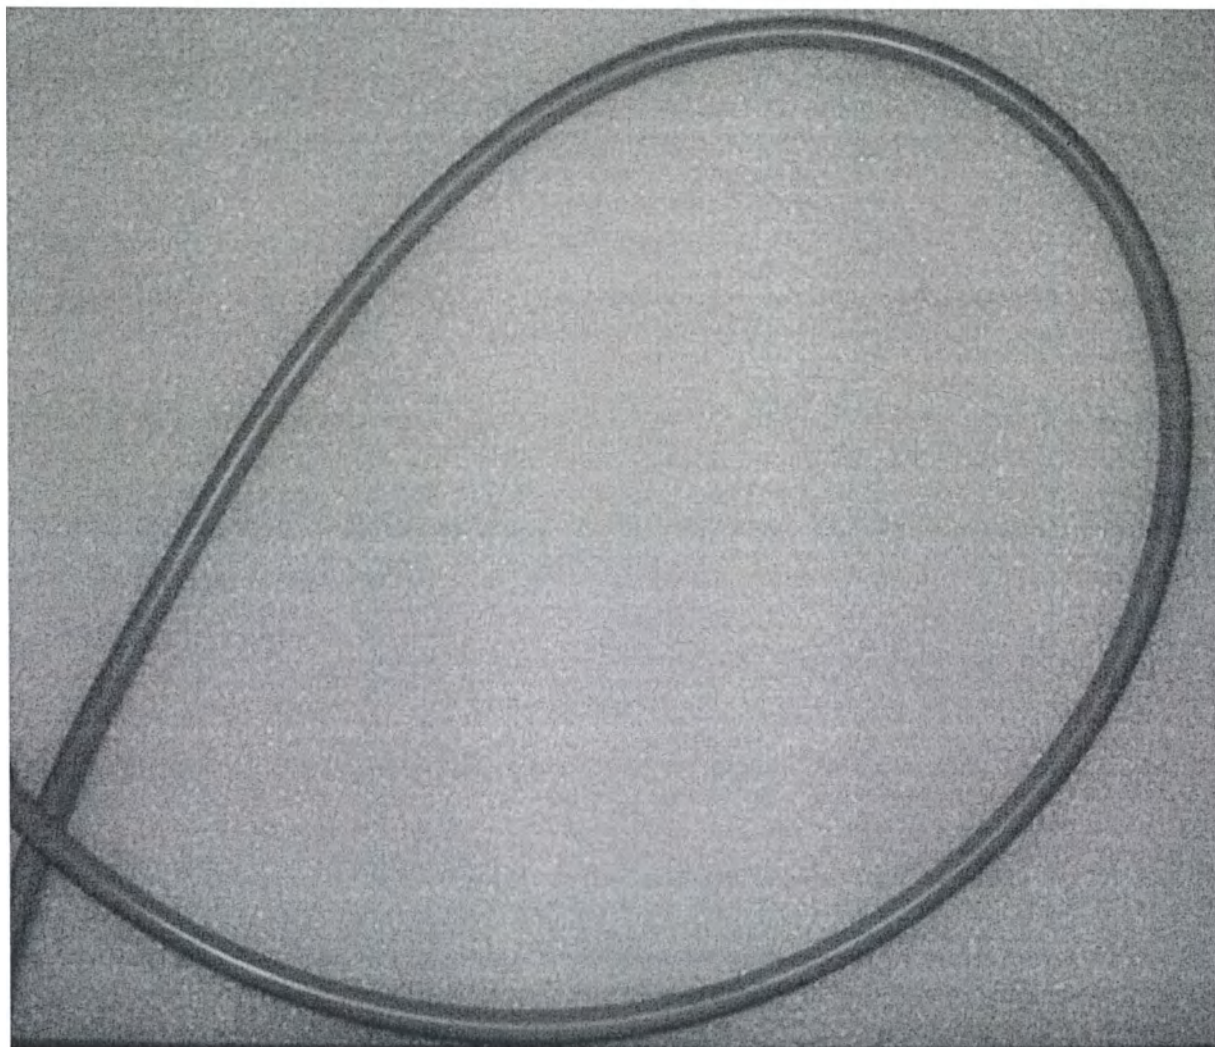


Ручка активации aspiratora




Наконечник аспиратора

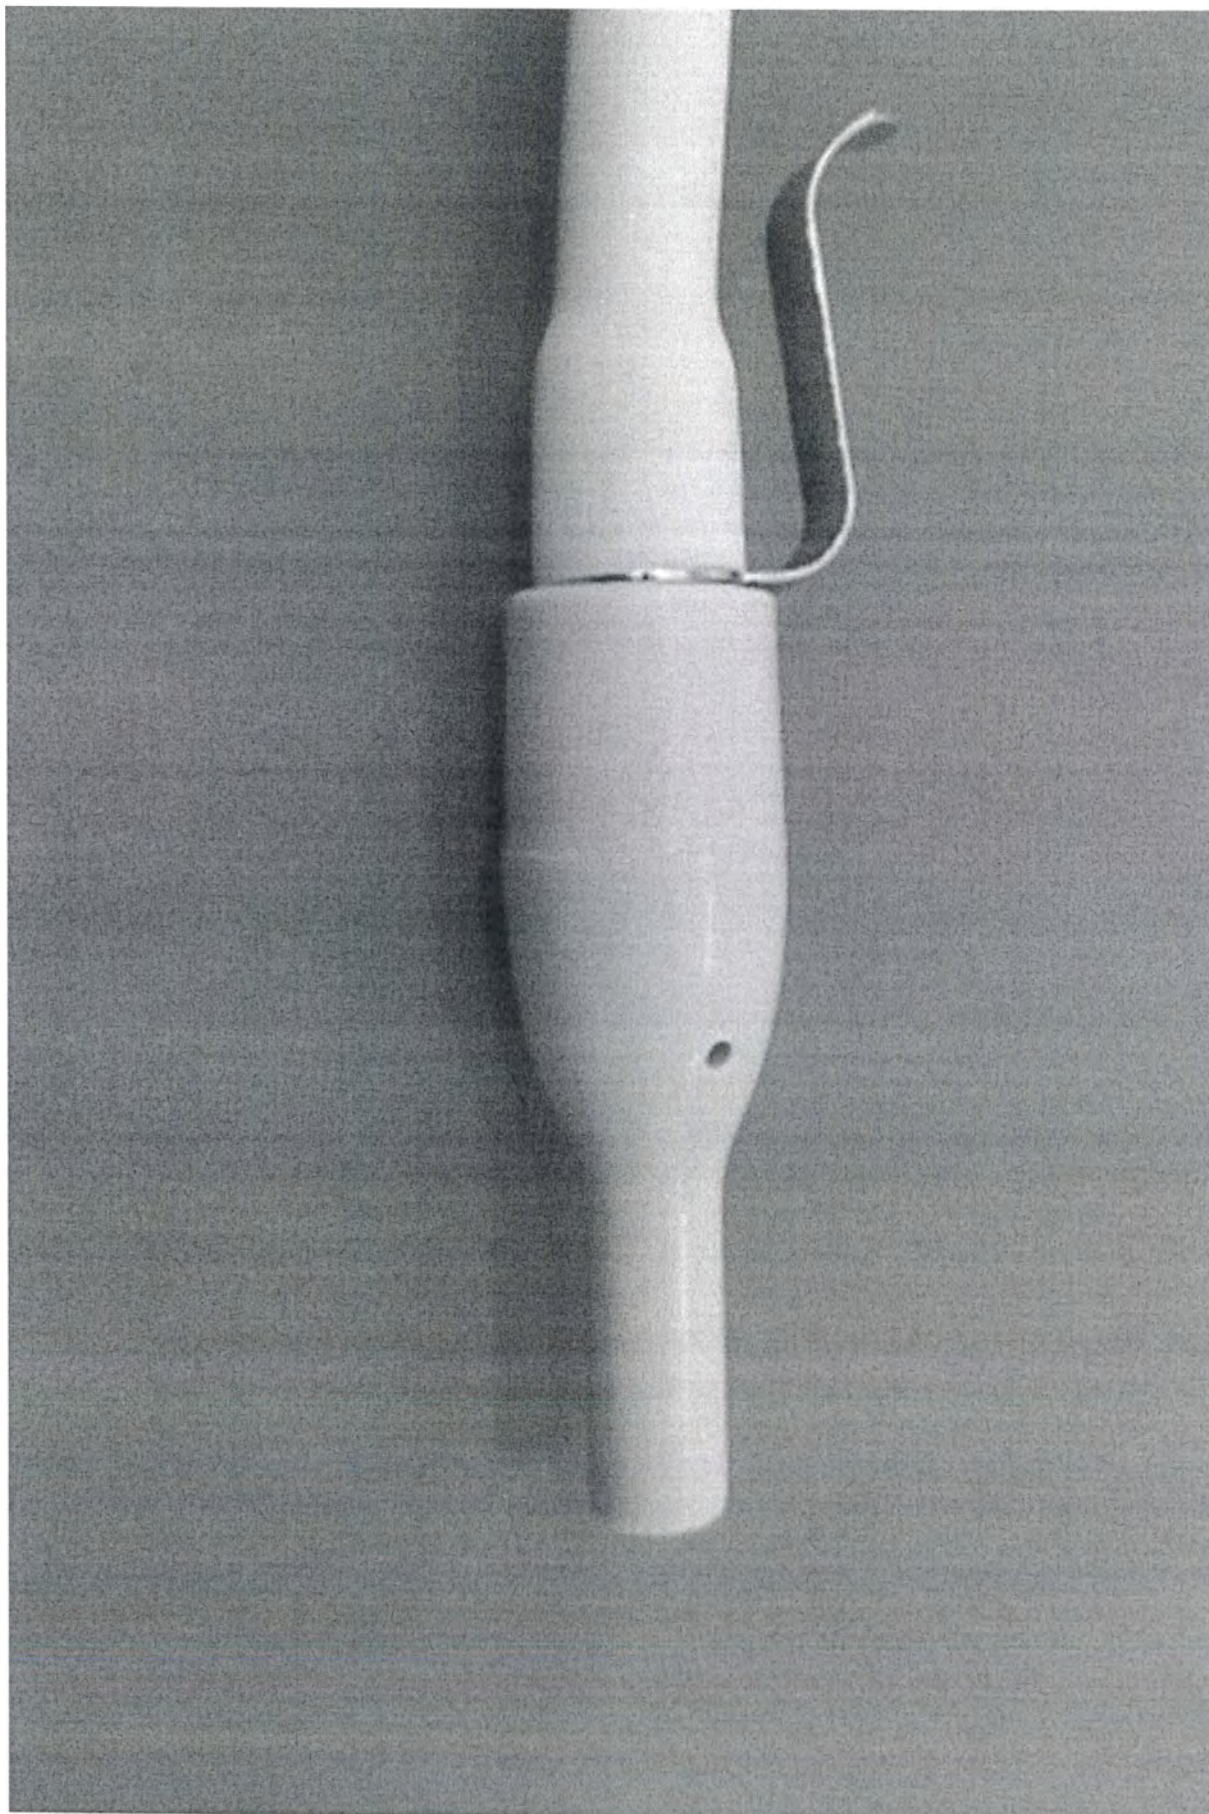


Шланг аспирационный.

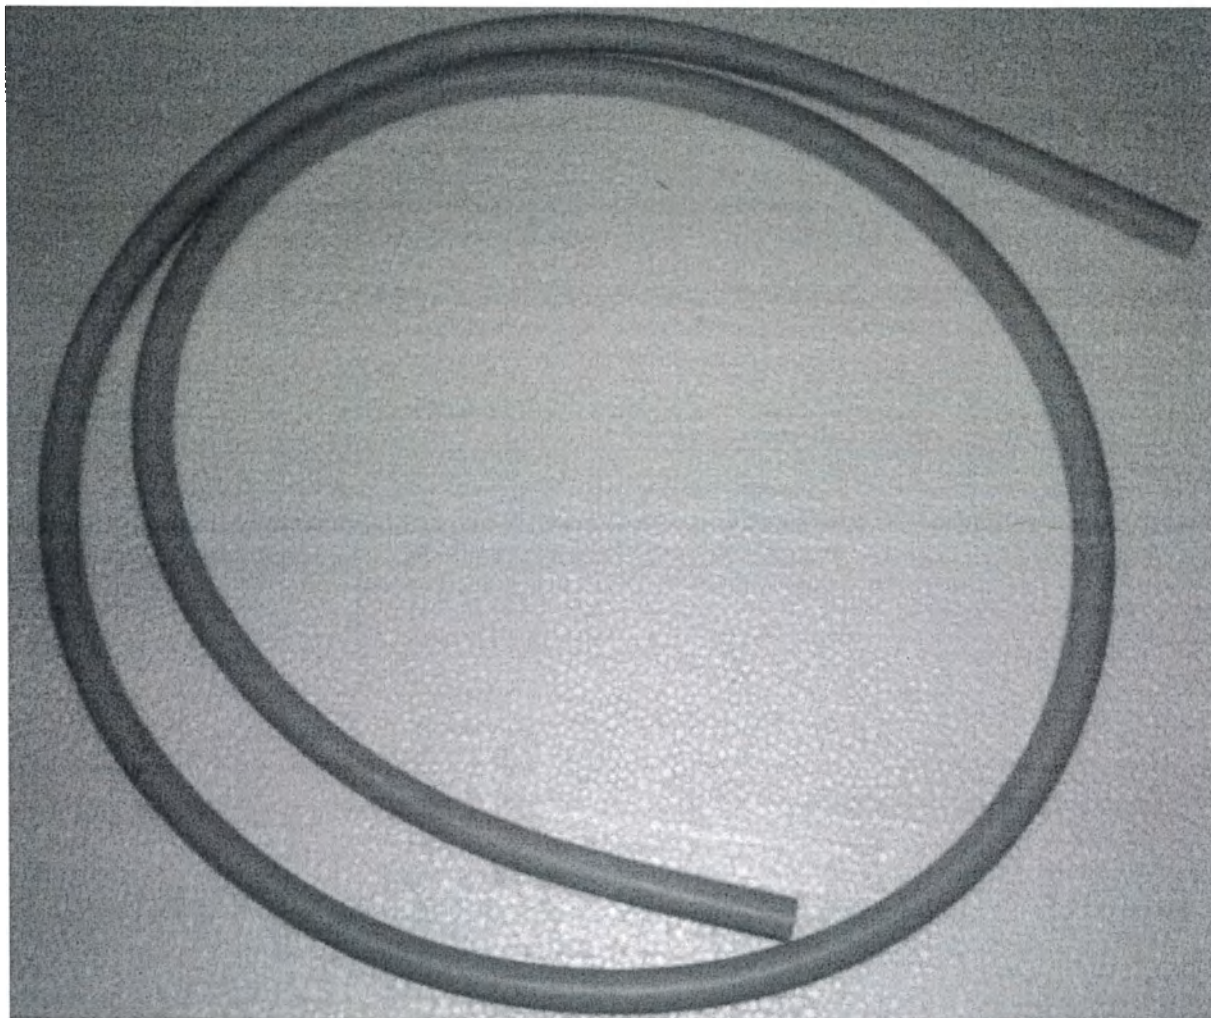

Устройство предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал.

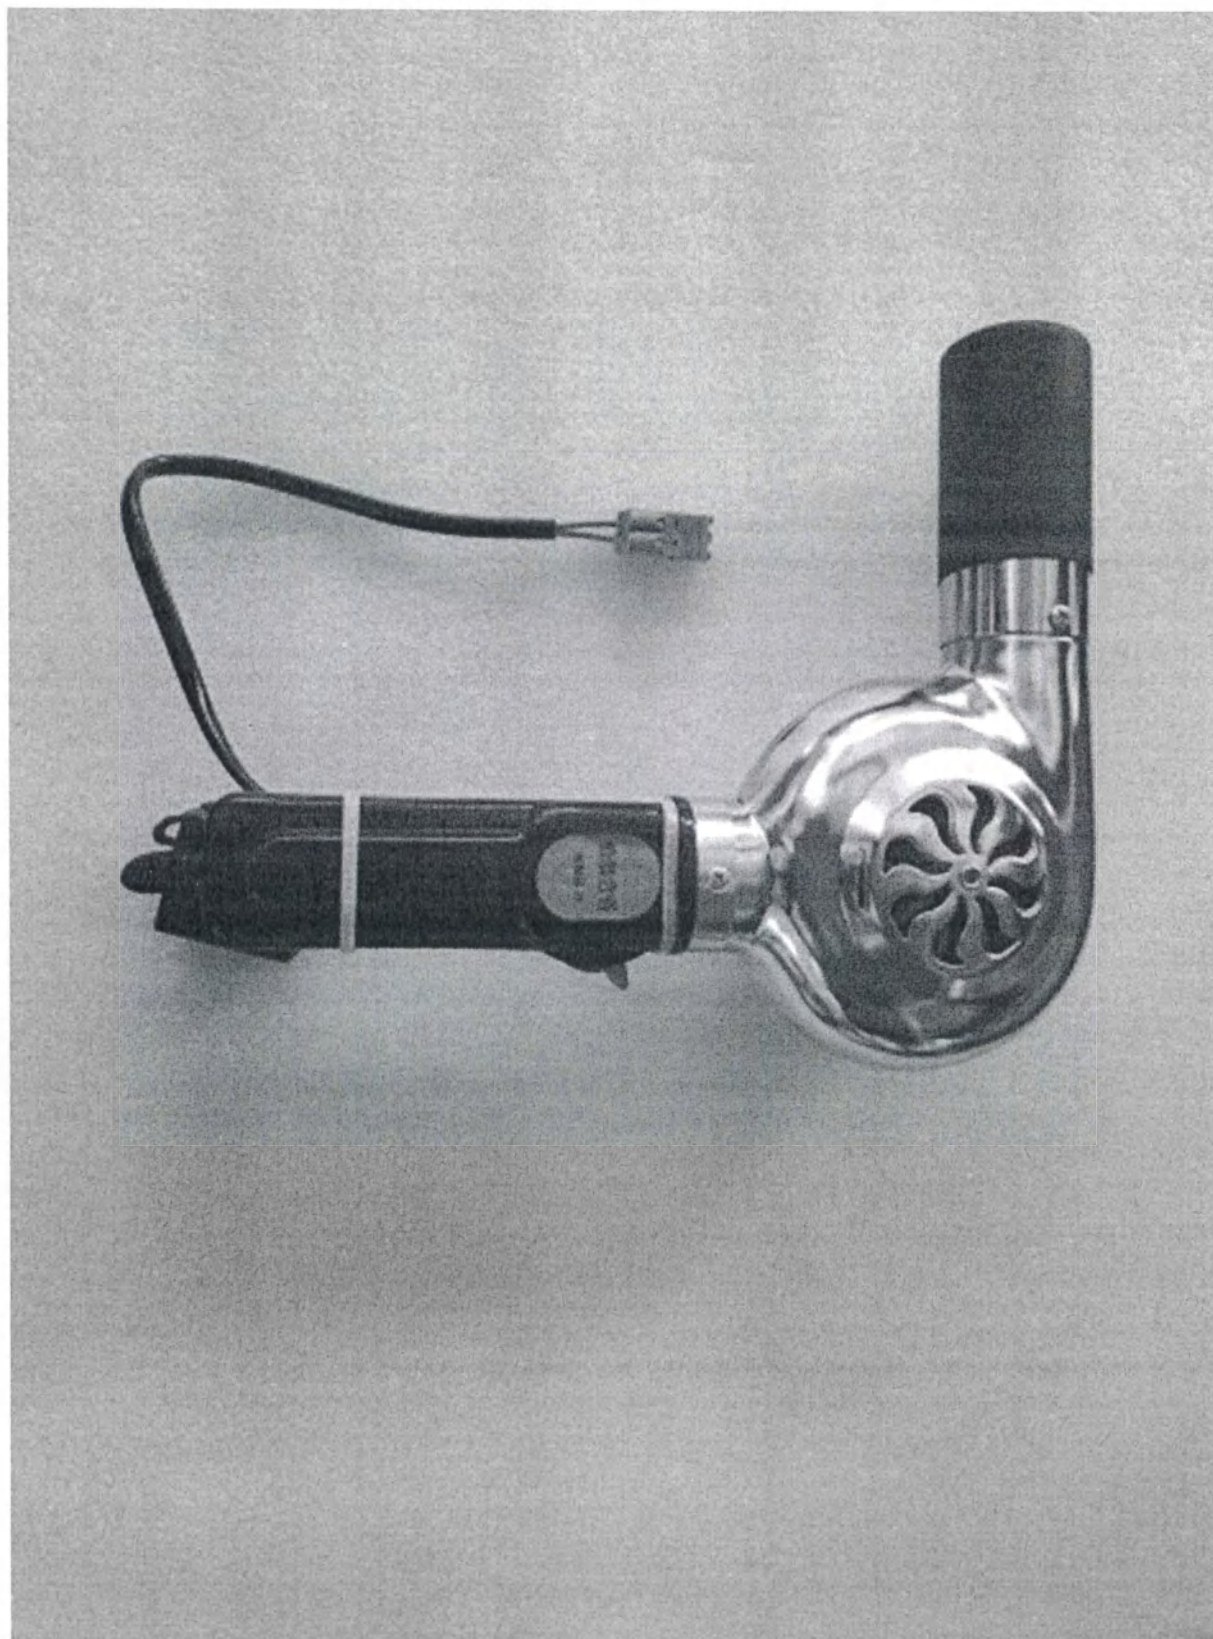


Заглушка для сетки устройства предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал

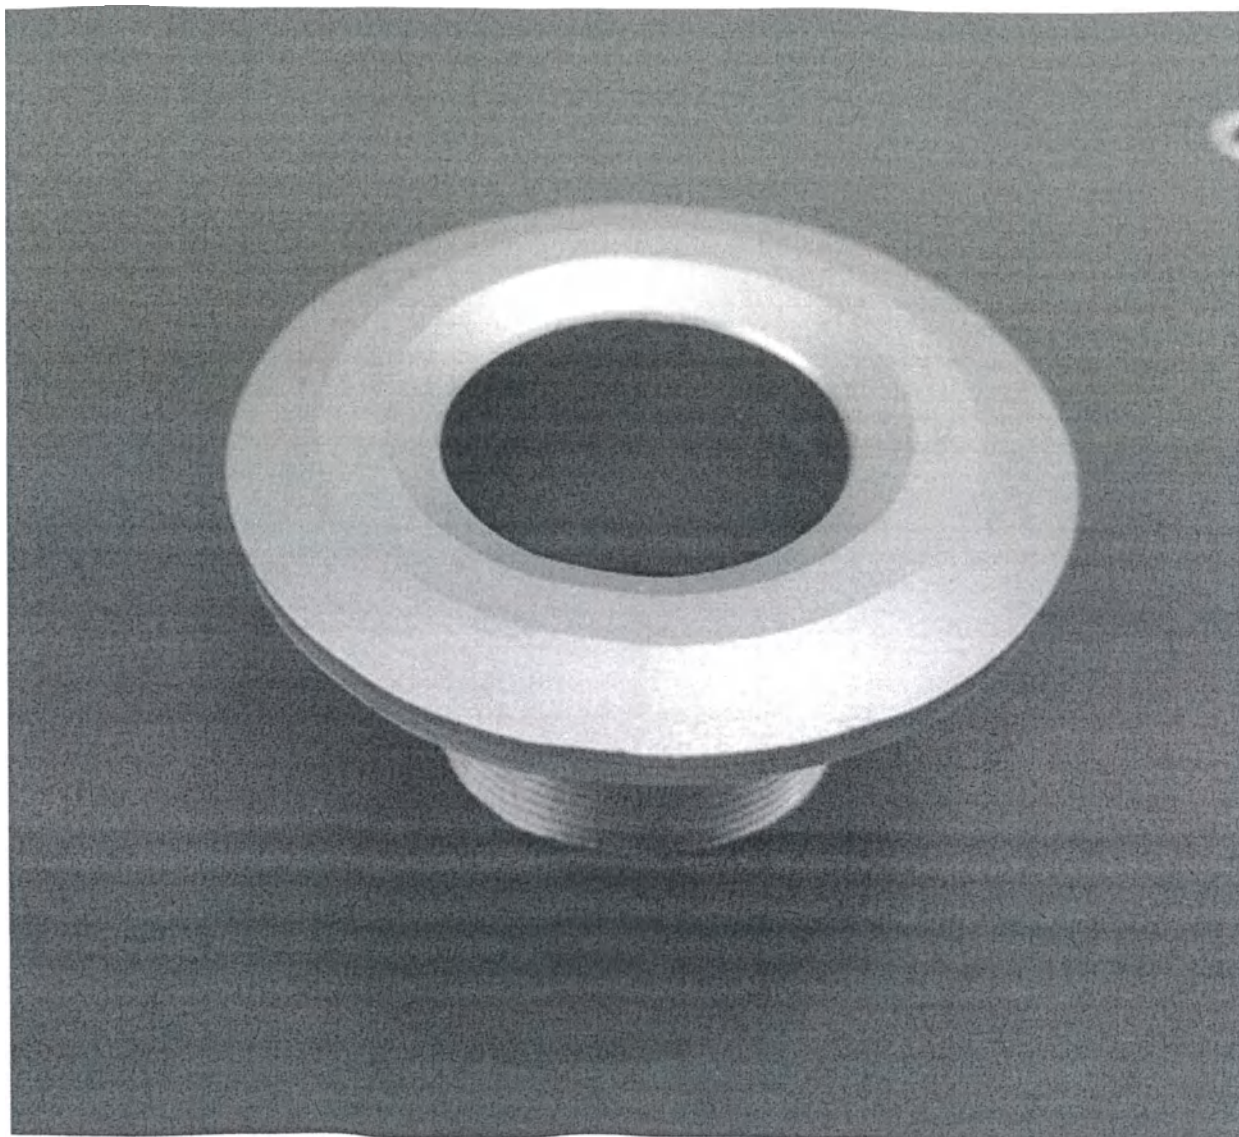


Ватодержатель из нержавеющей стали с крышкой




Медицинская бутылка для лекарственных средств

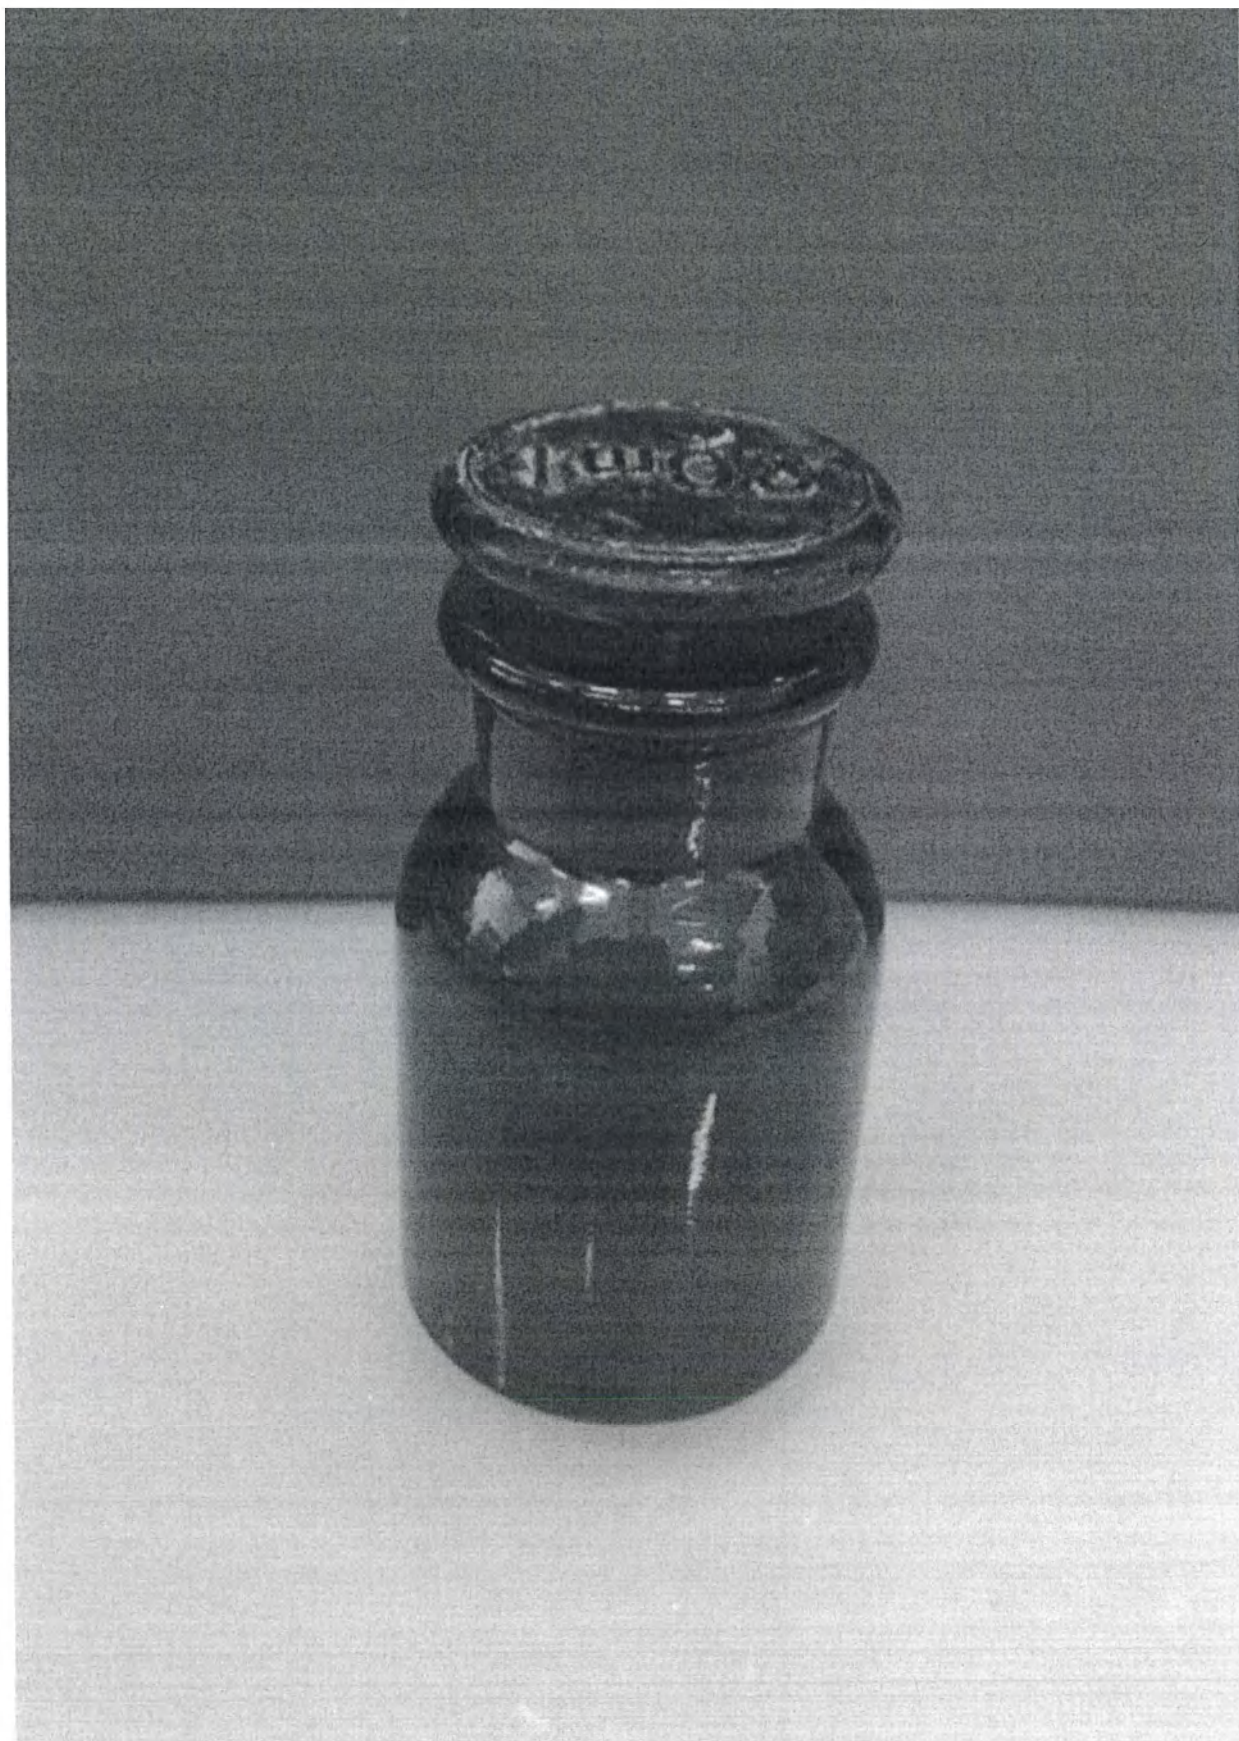


Вертикальный держатель для инструментов

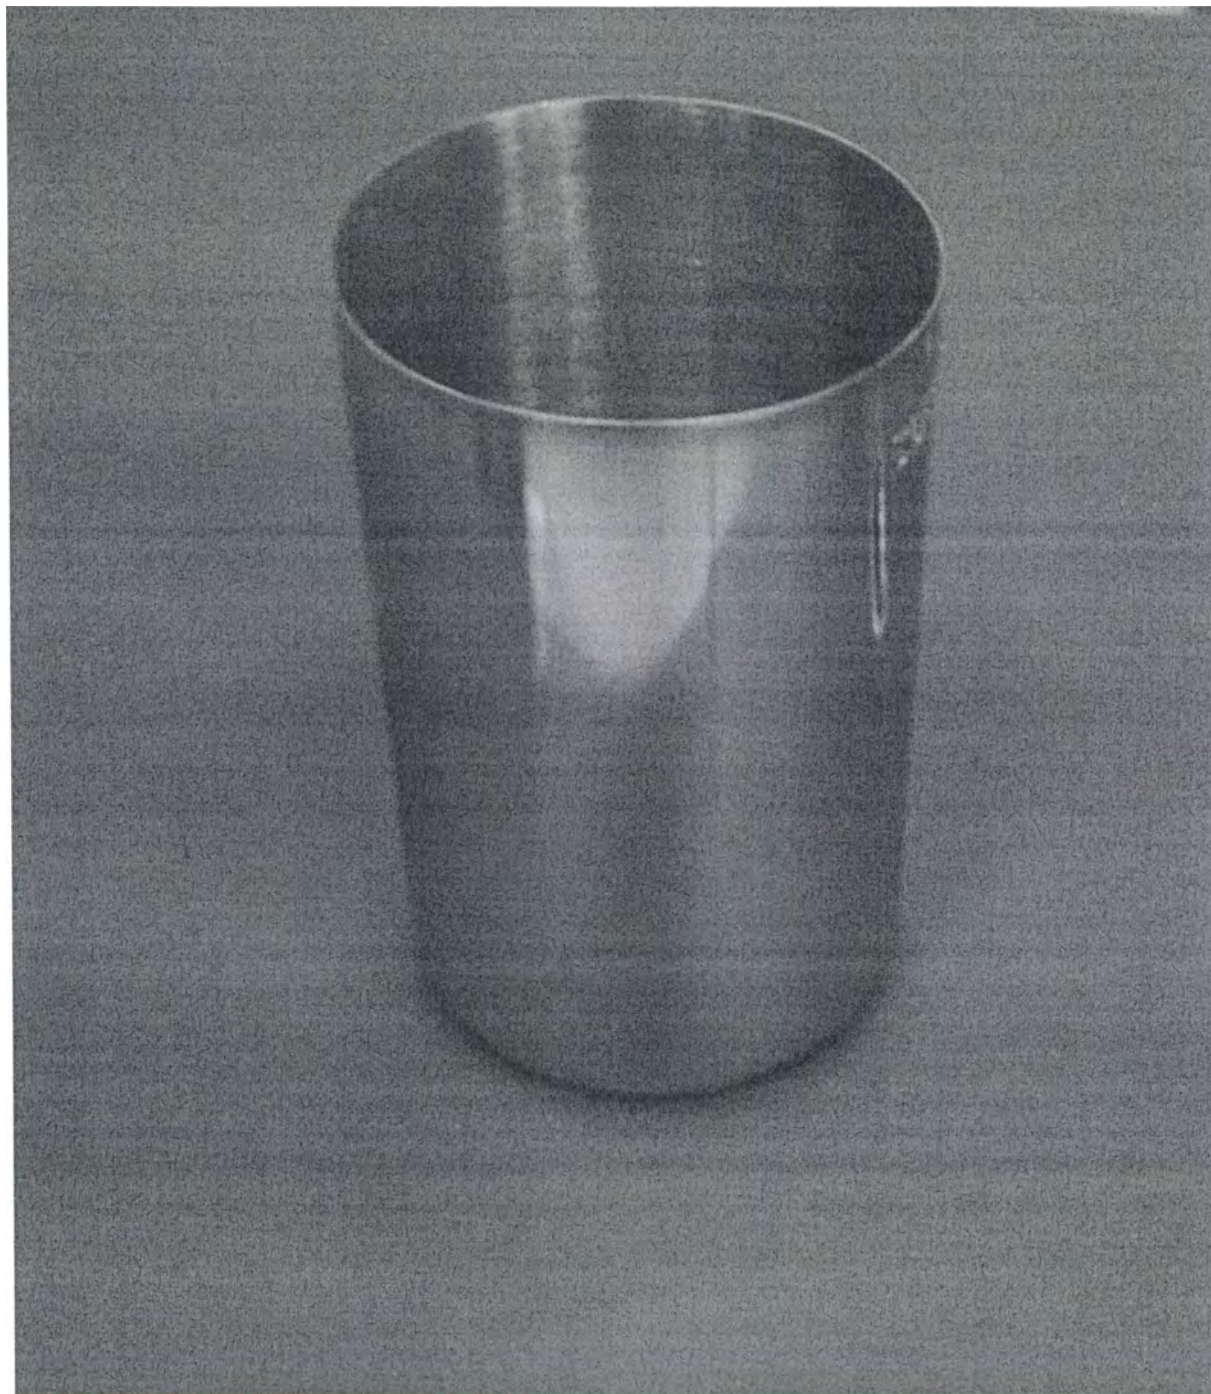


Емкость для секрета, объемом 2500 мл.

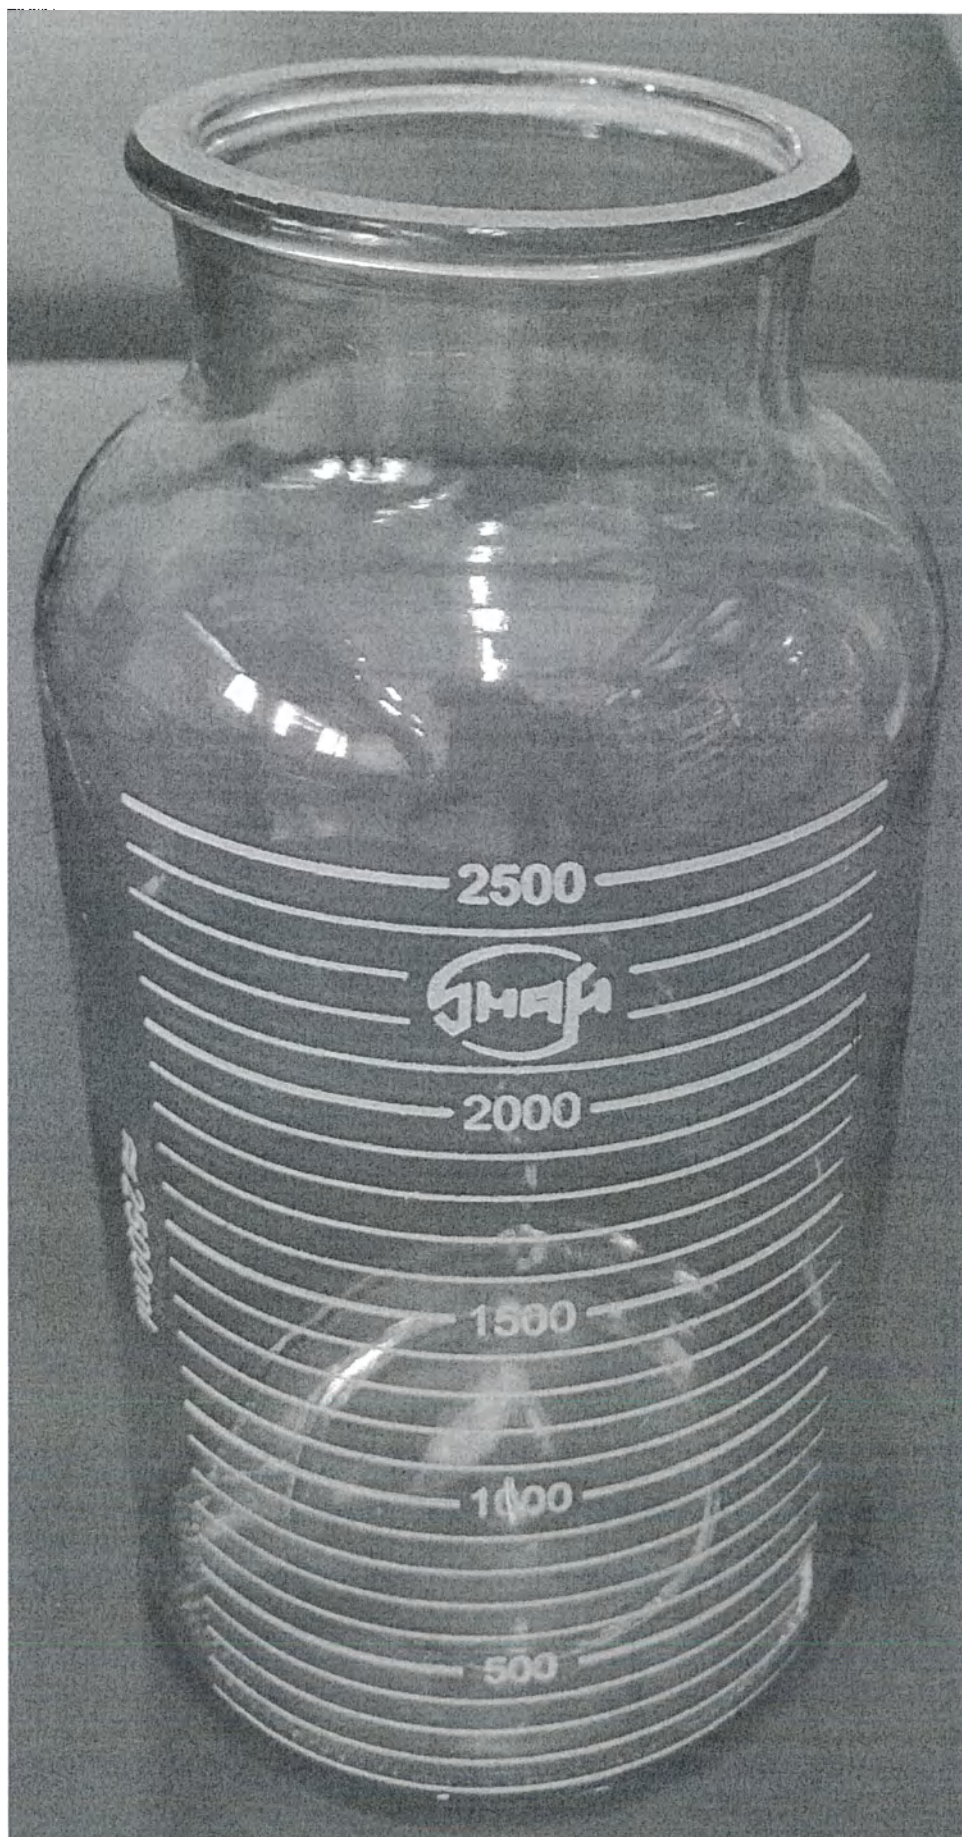


Лоток для инструментов с крышкой

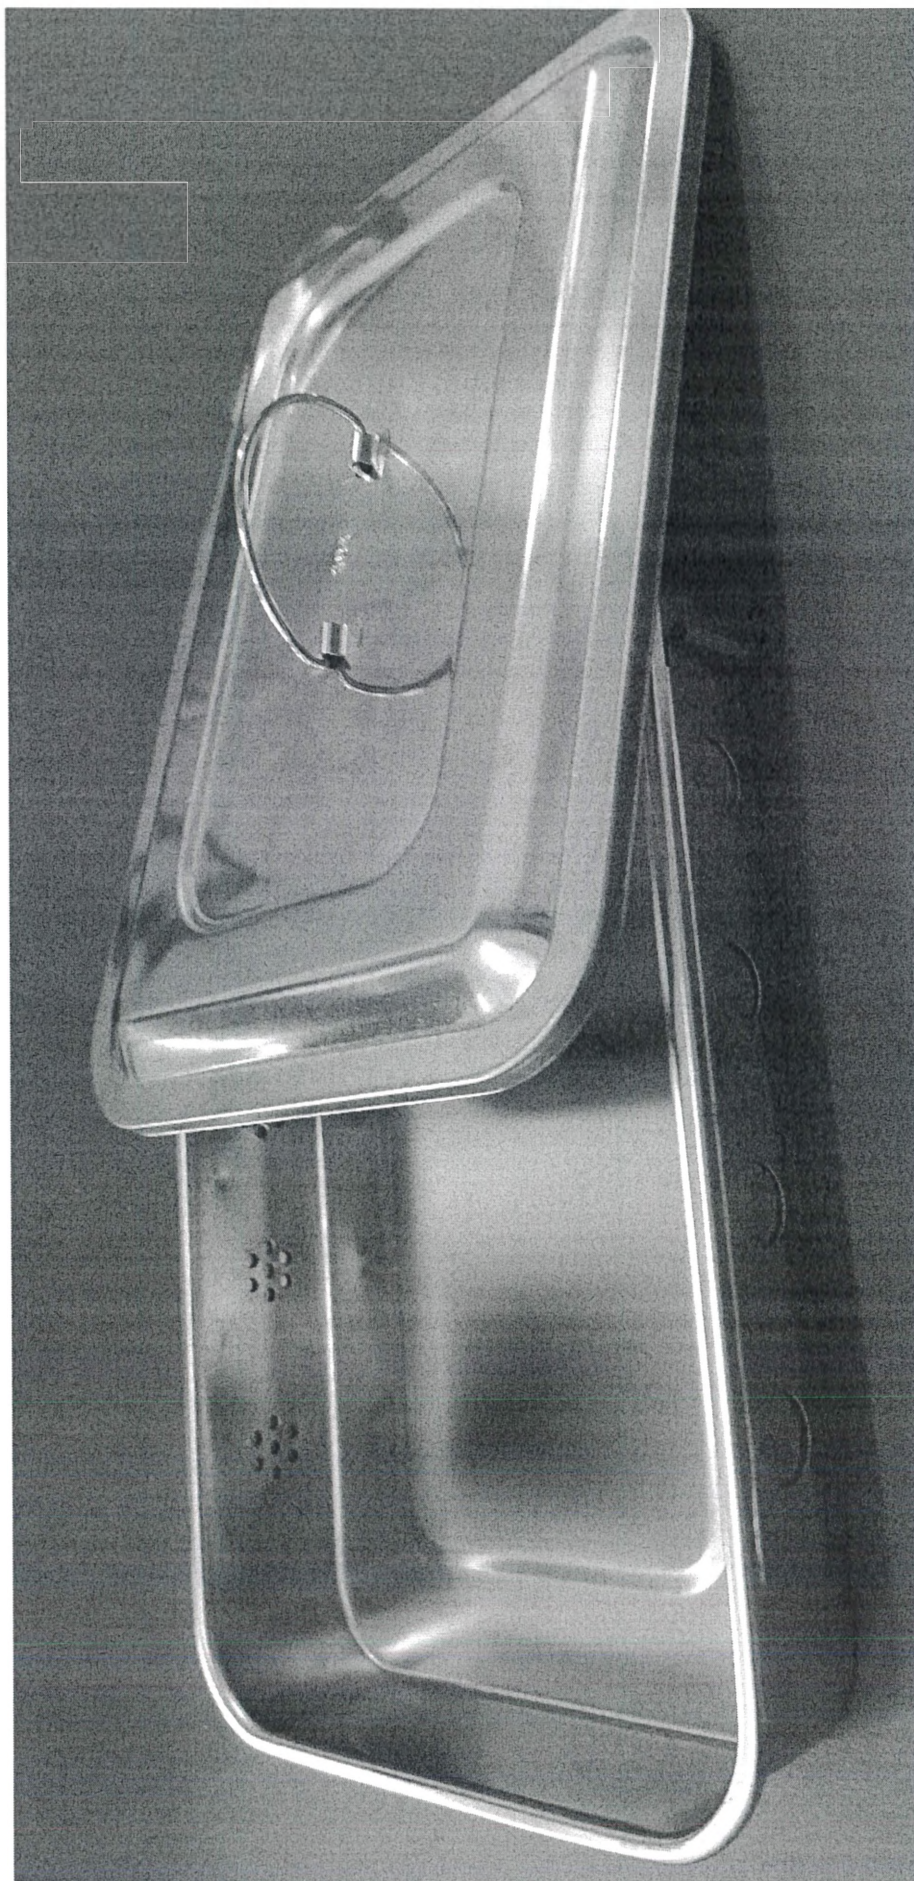


Кабель питания

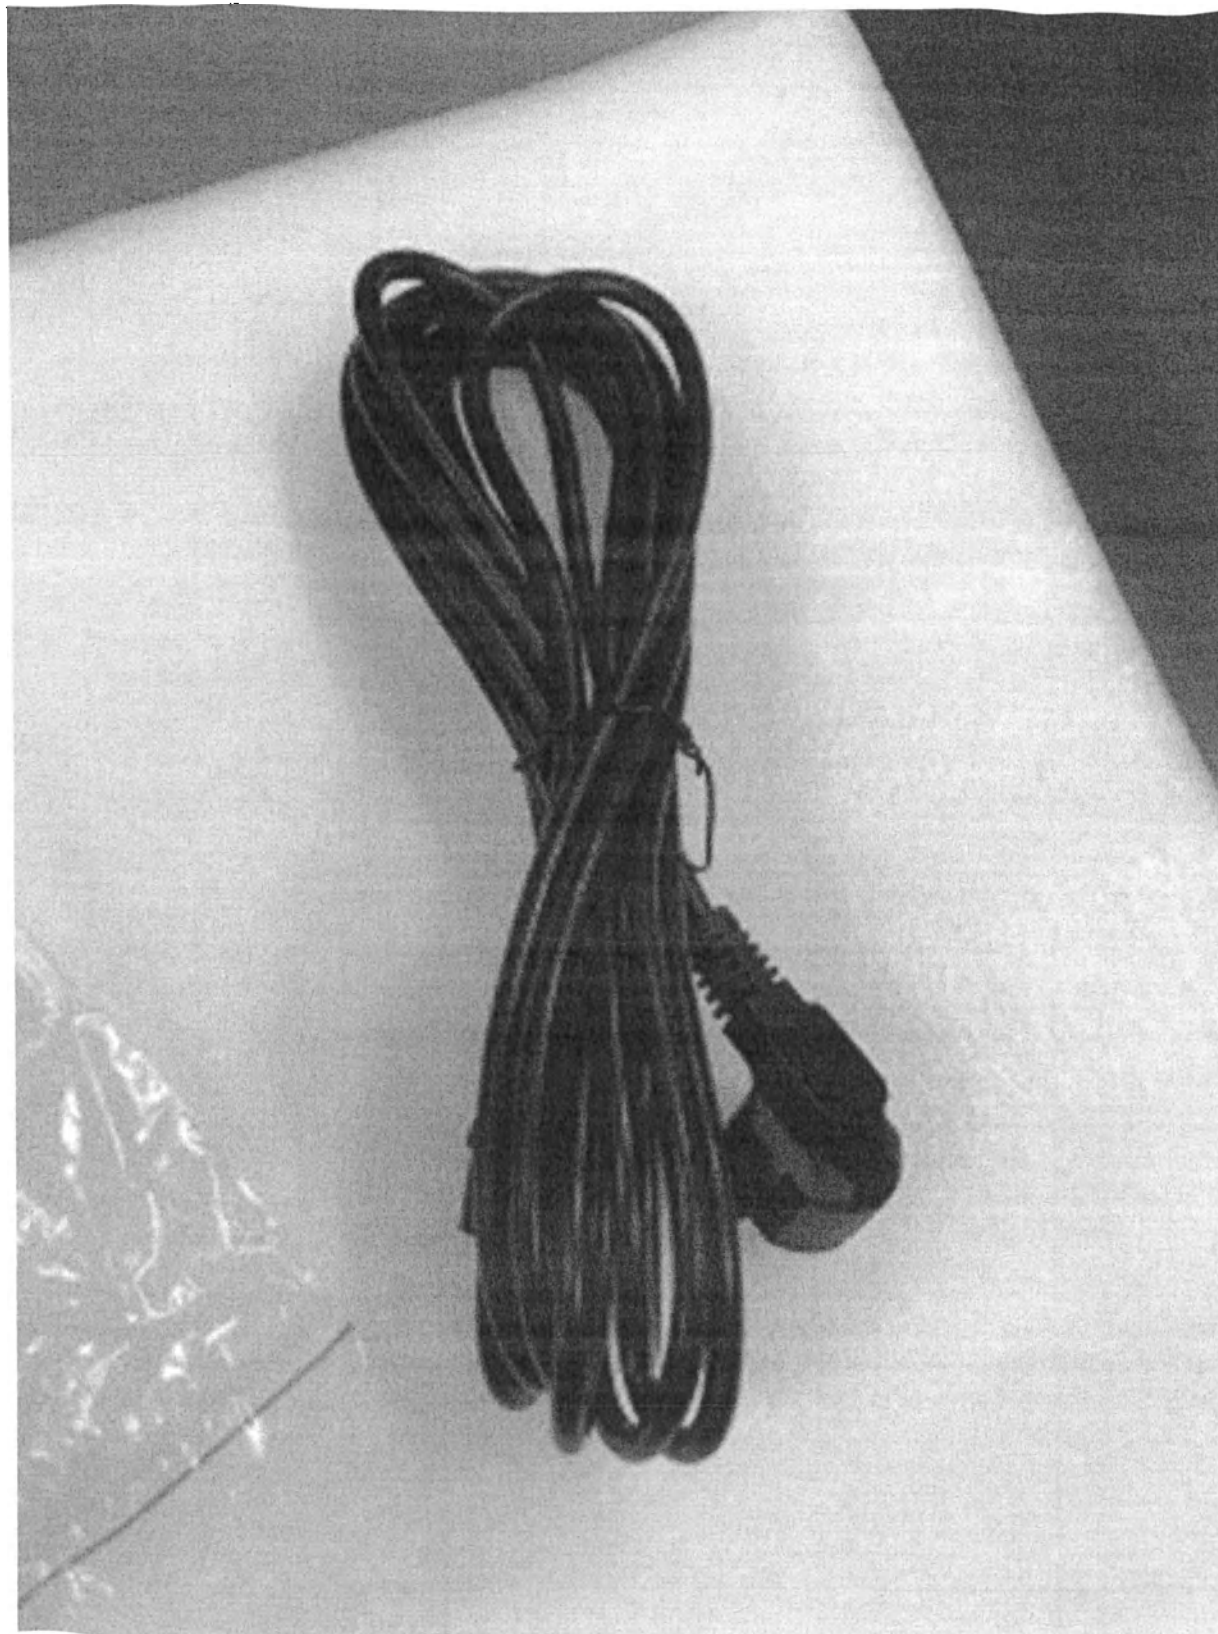


Панель управления встроенная.

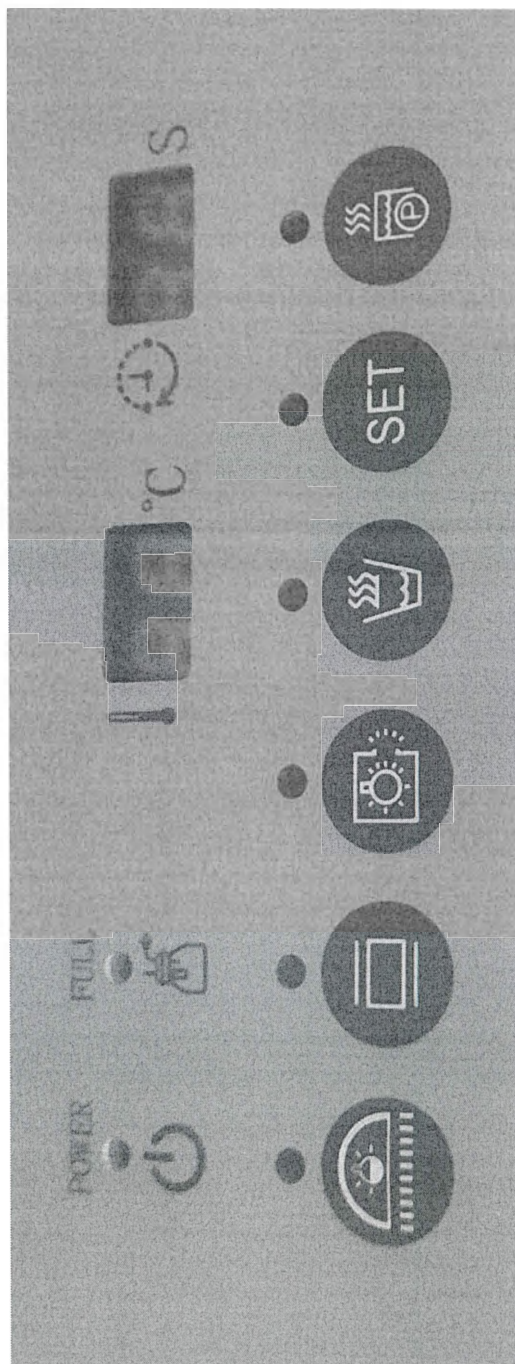


Насадка аспирационная узкая

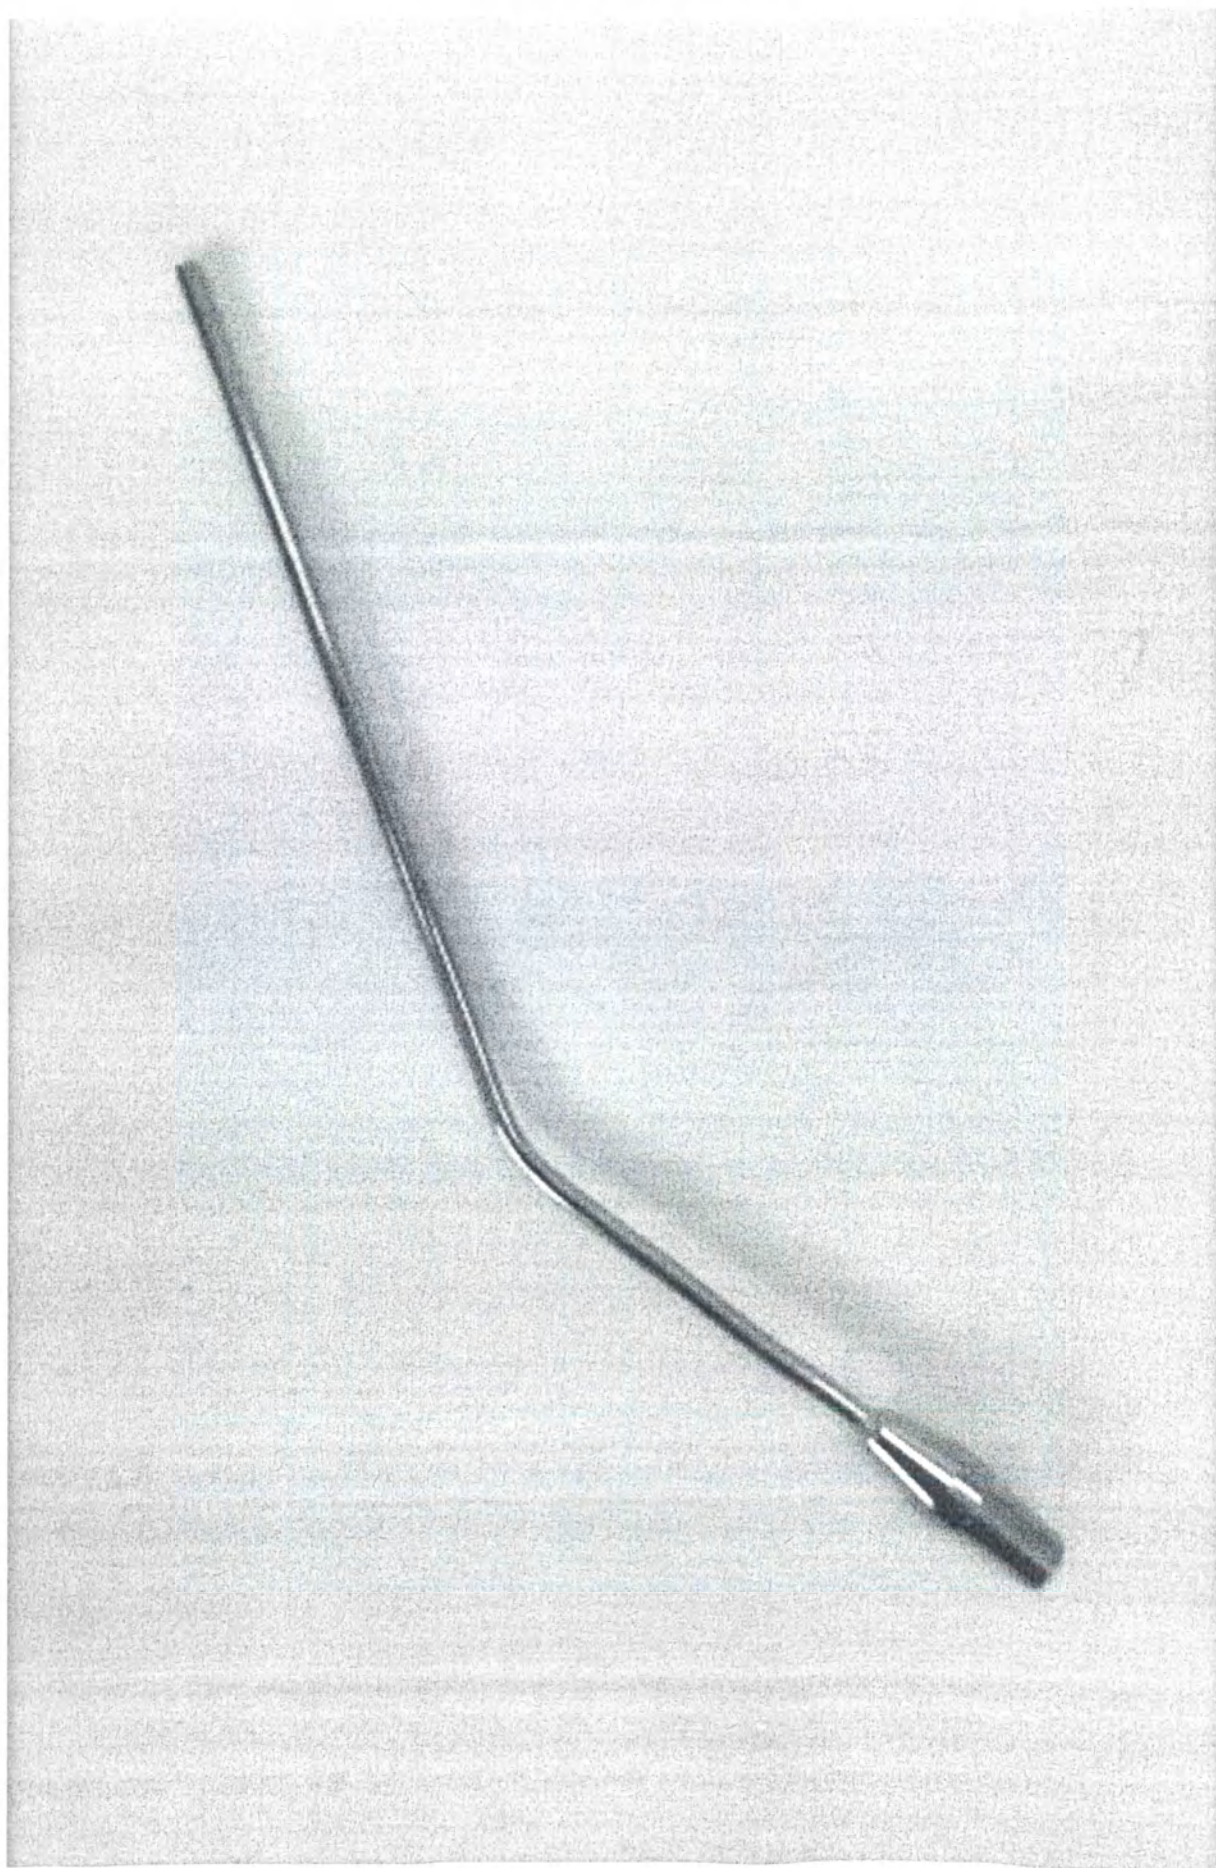


Насадка аспирационная широкая

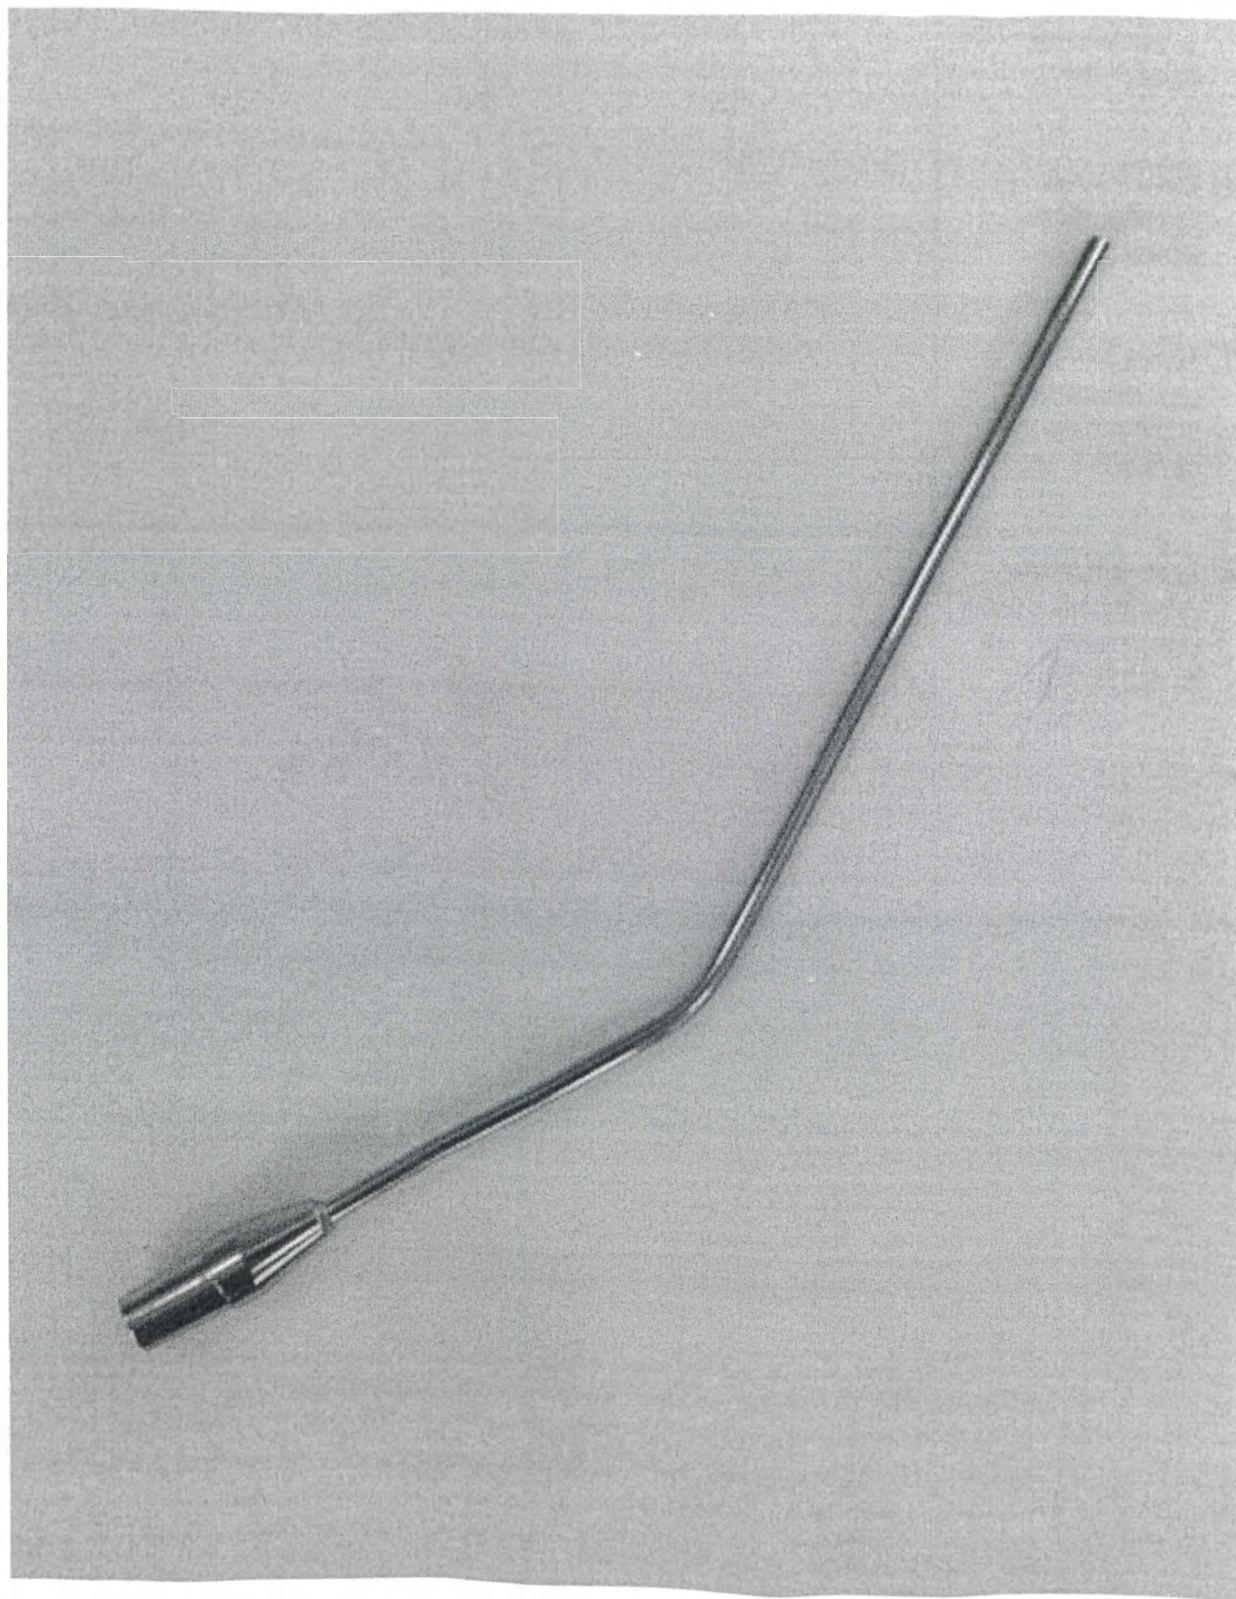


Фильтр воздушный

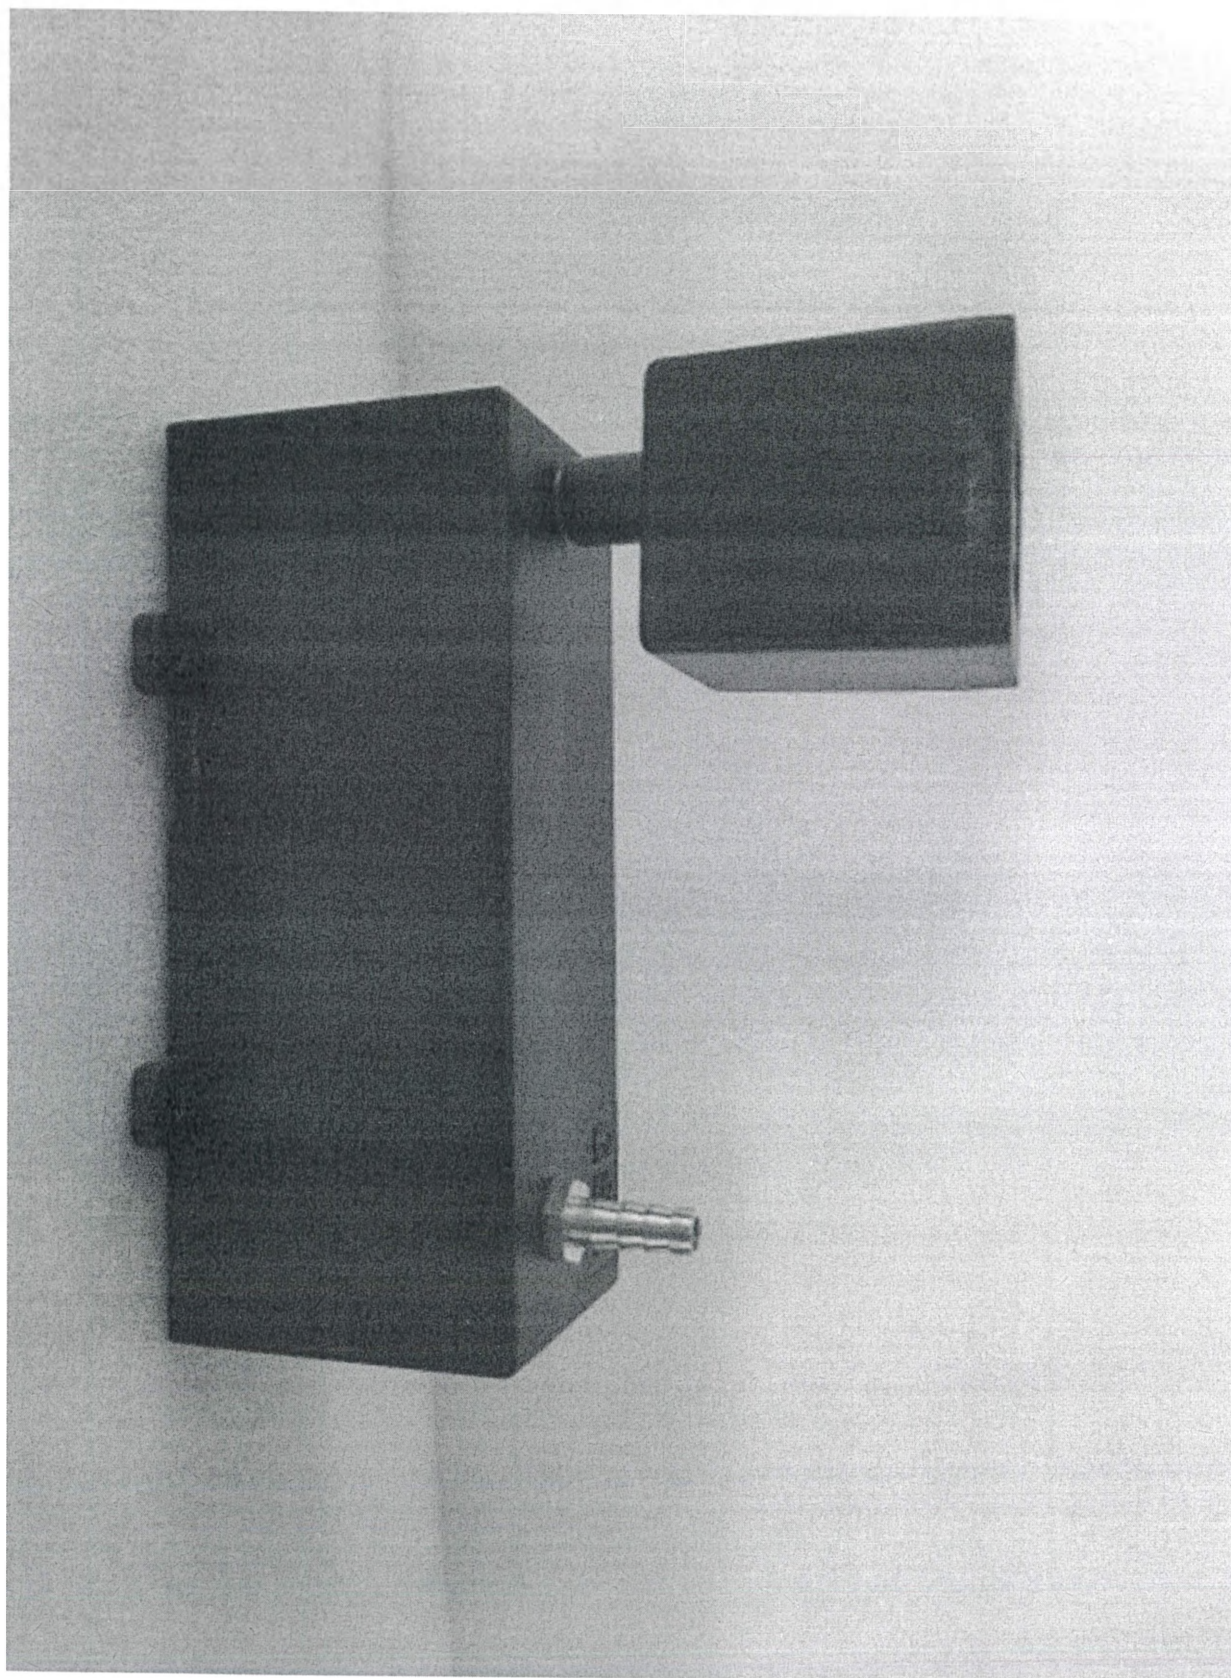


Фильтр водяной

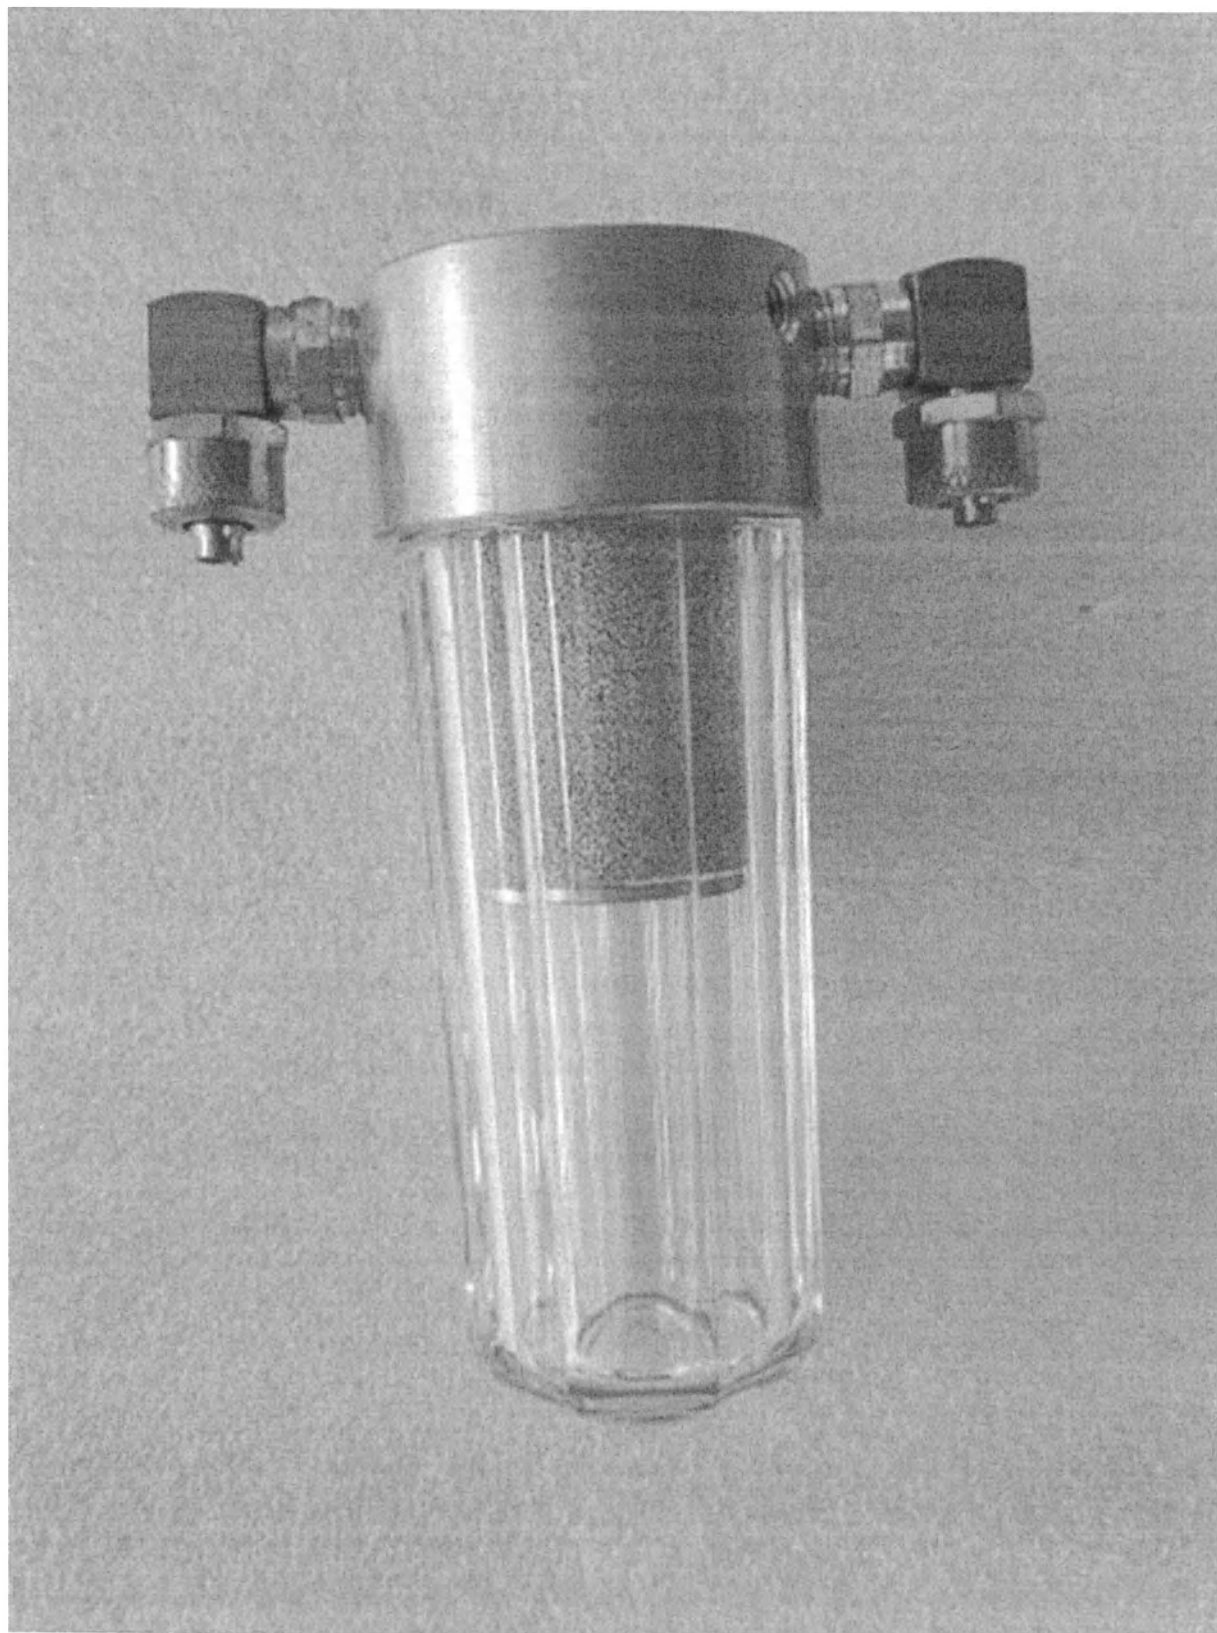


Компрессор воздушный

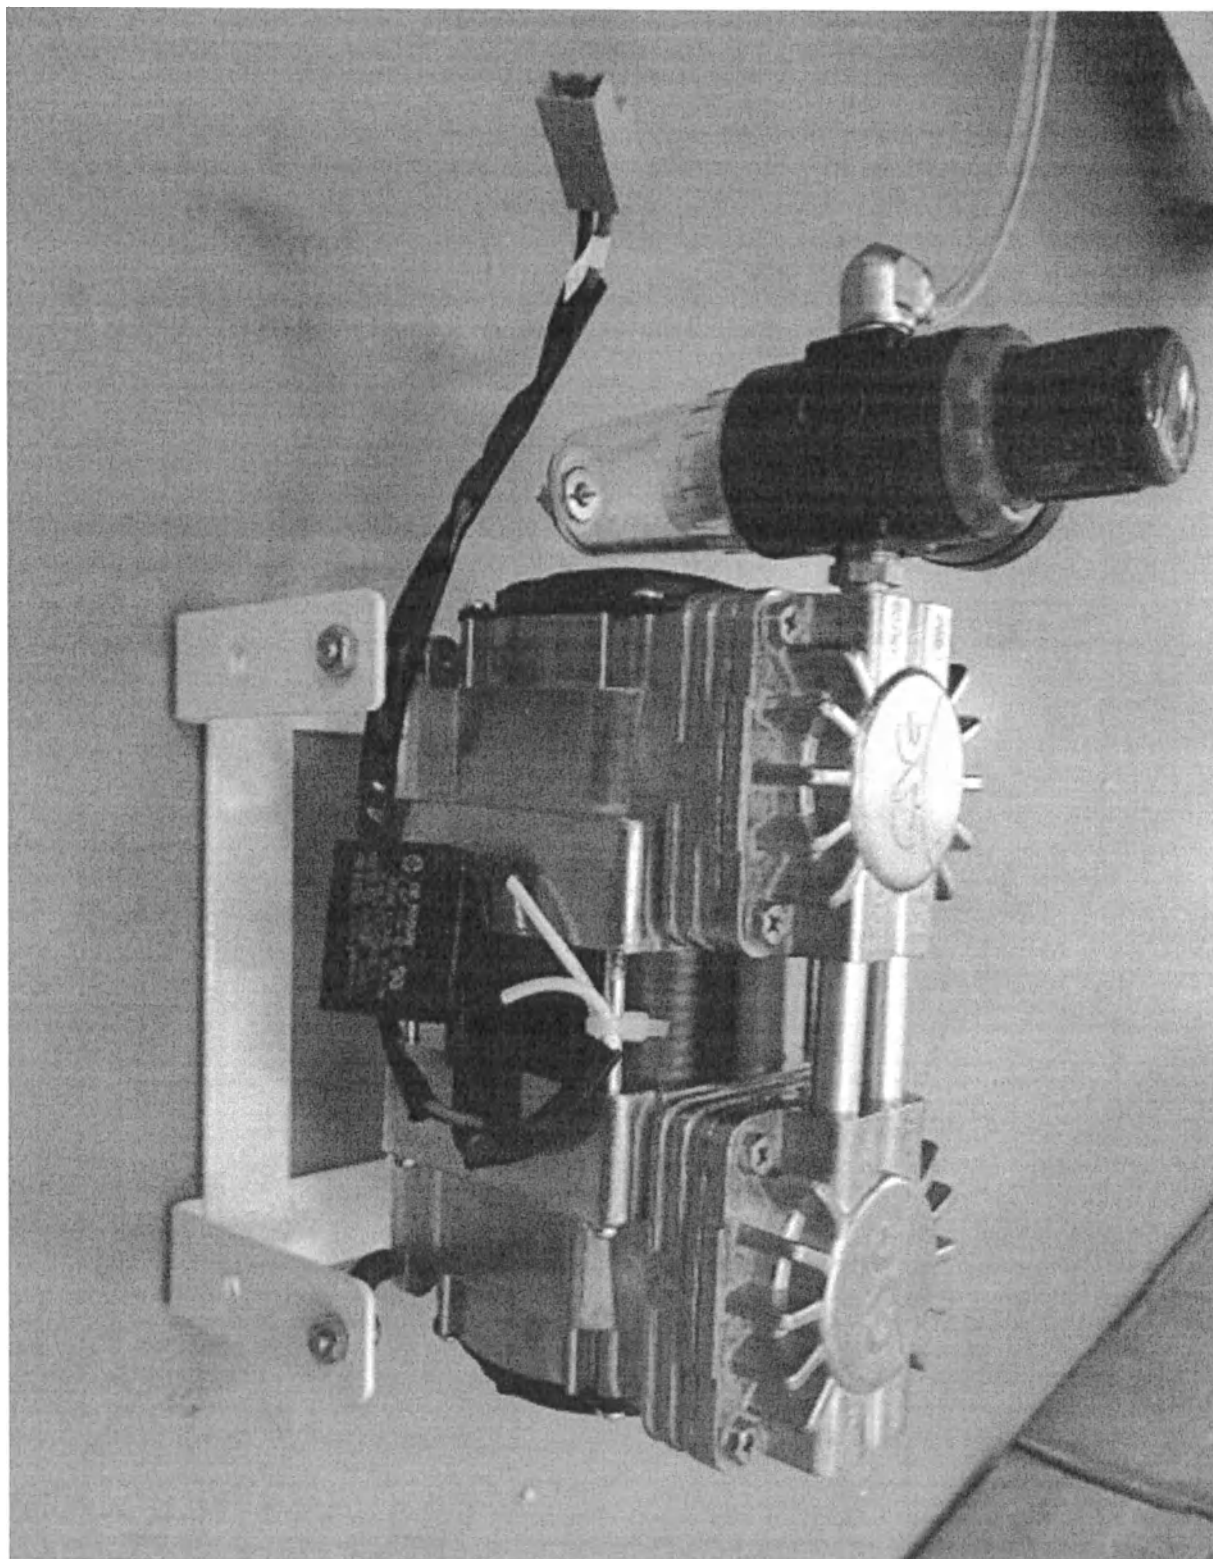


Насос вакуумный

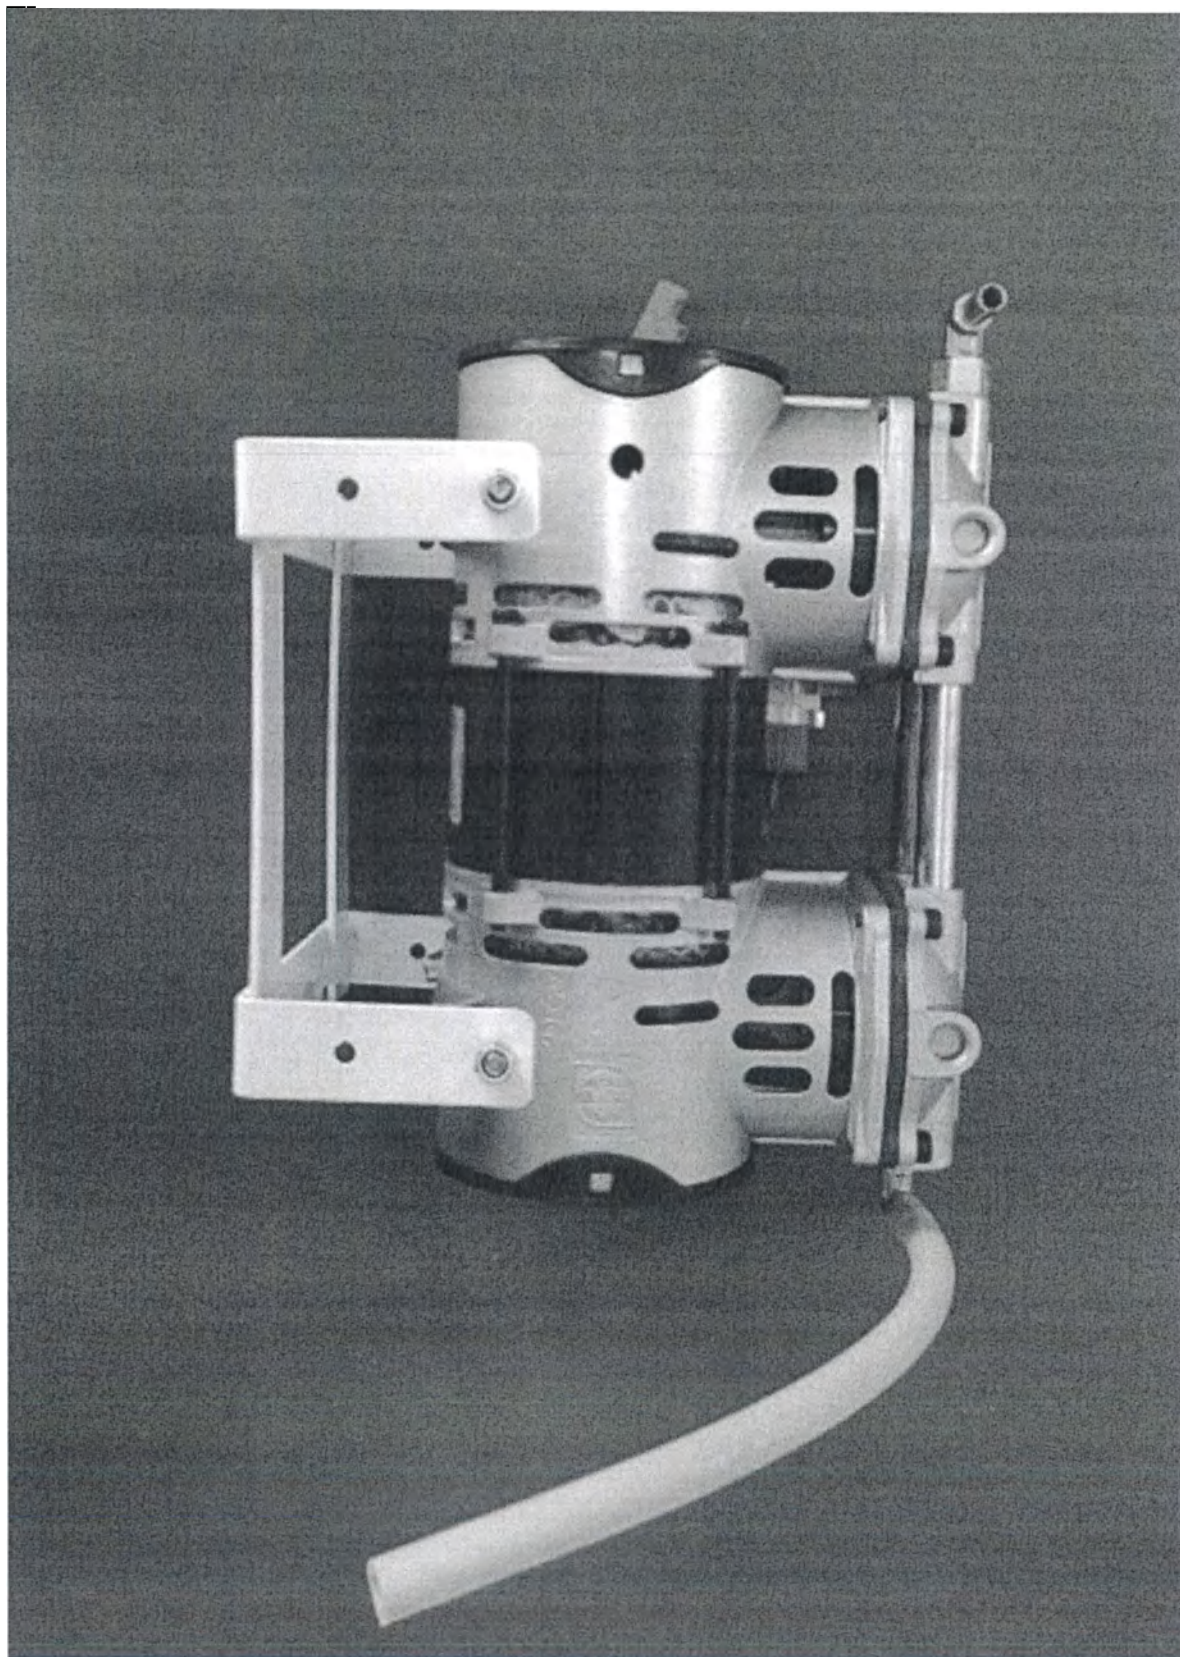


Крышка емкости для секрета объемом 2500 мл

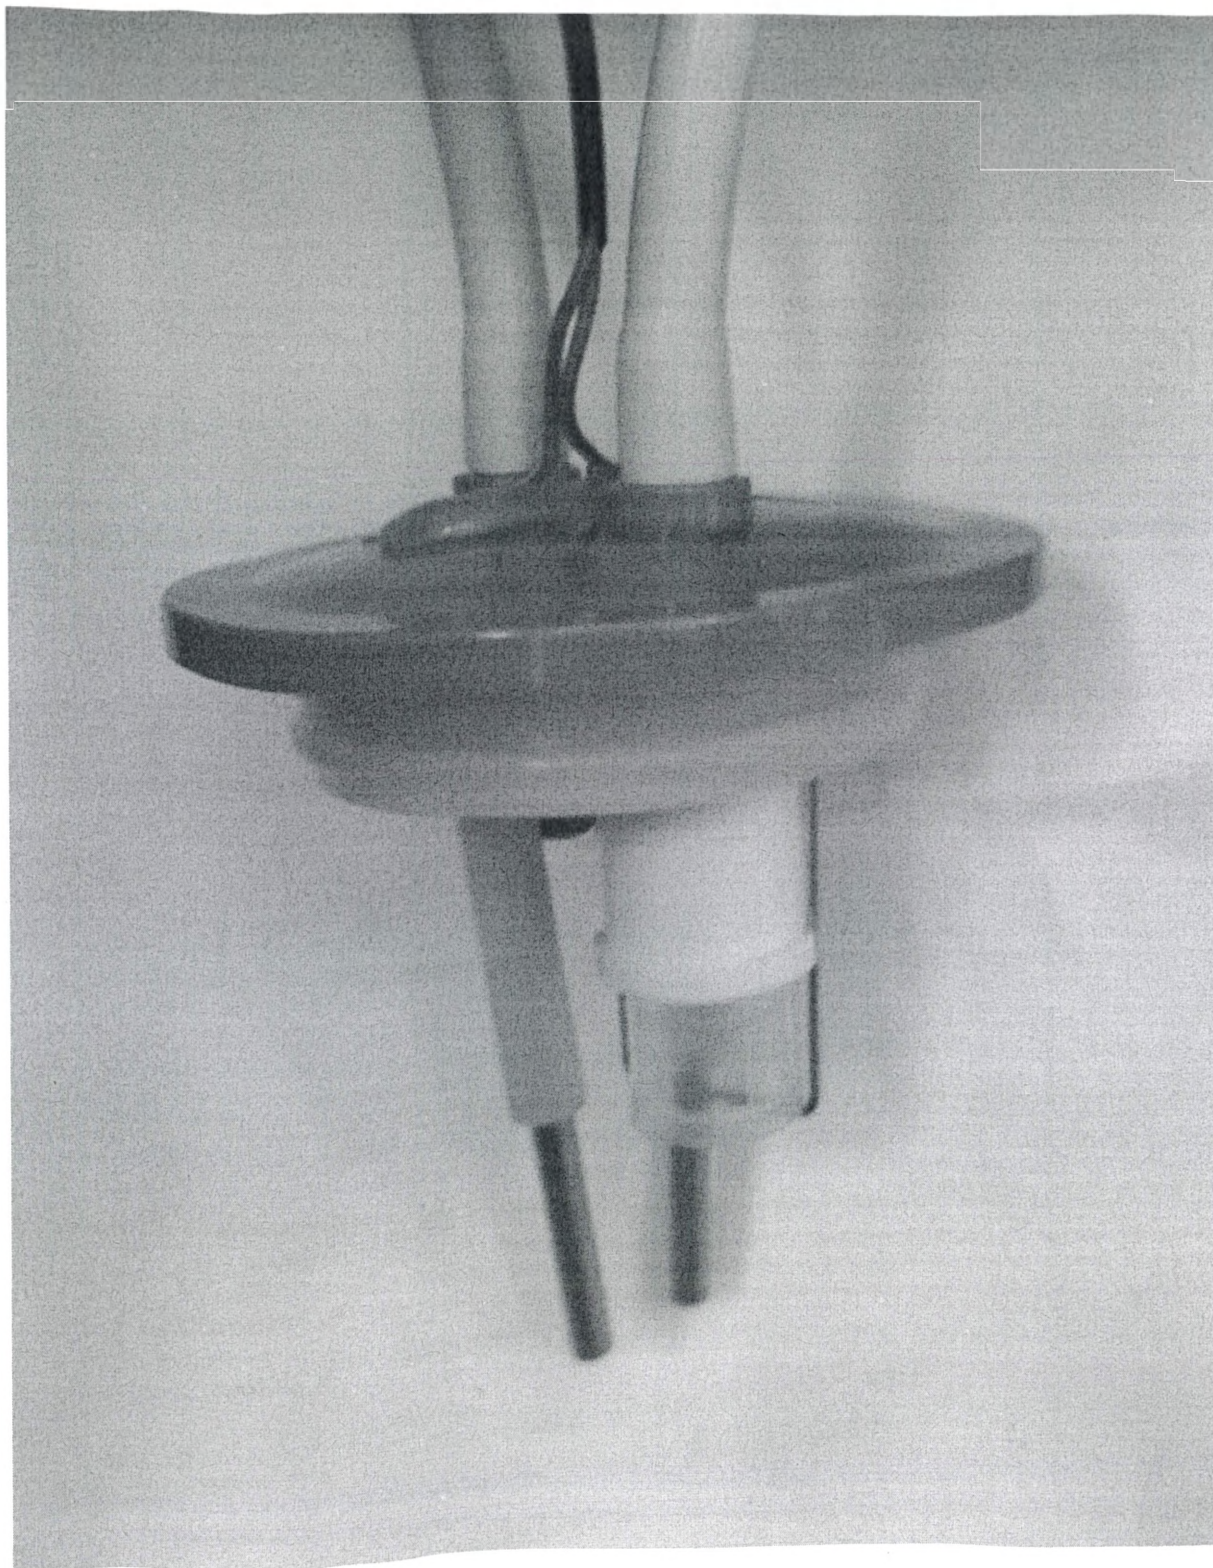


Крышка емкости для секрета объемом 500 мл

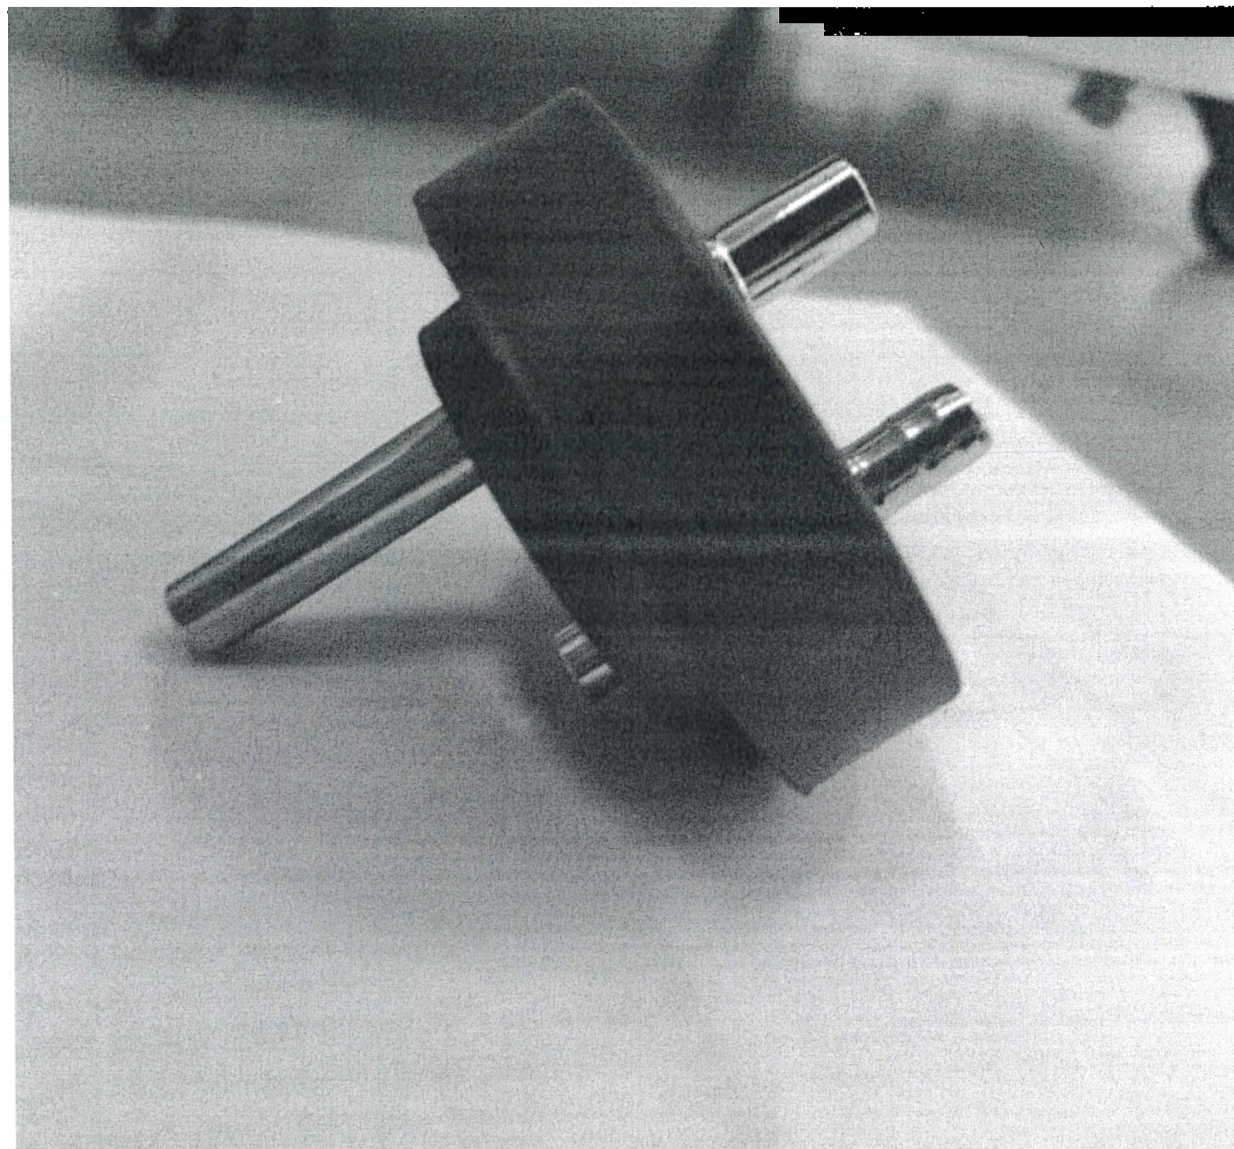


Коннектор

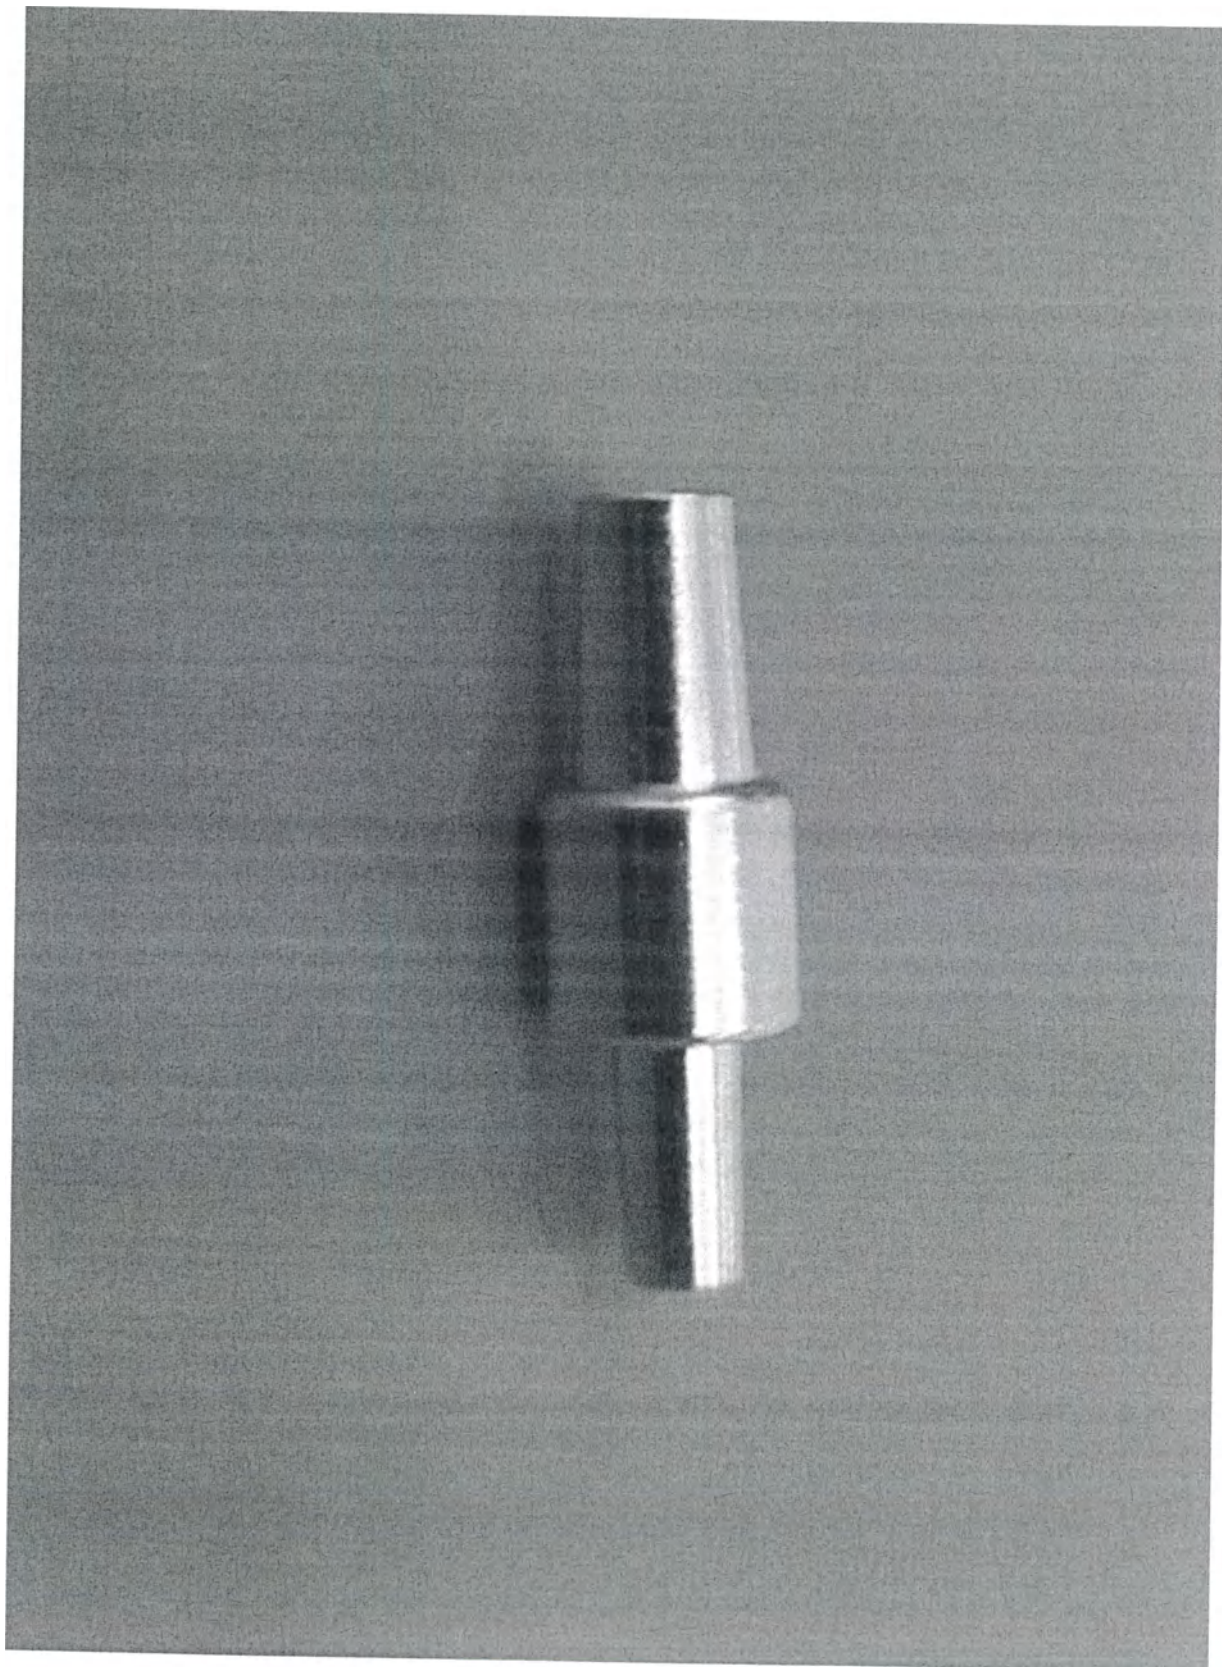


Ручка регулятора давления аспирационного потока.

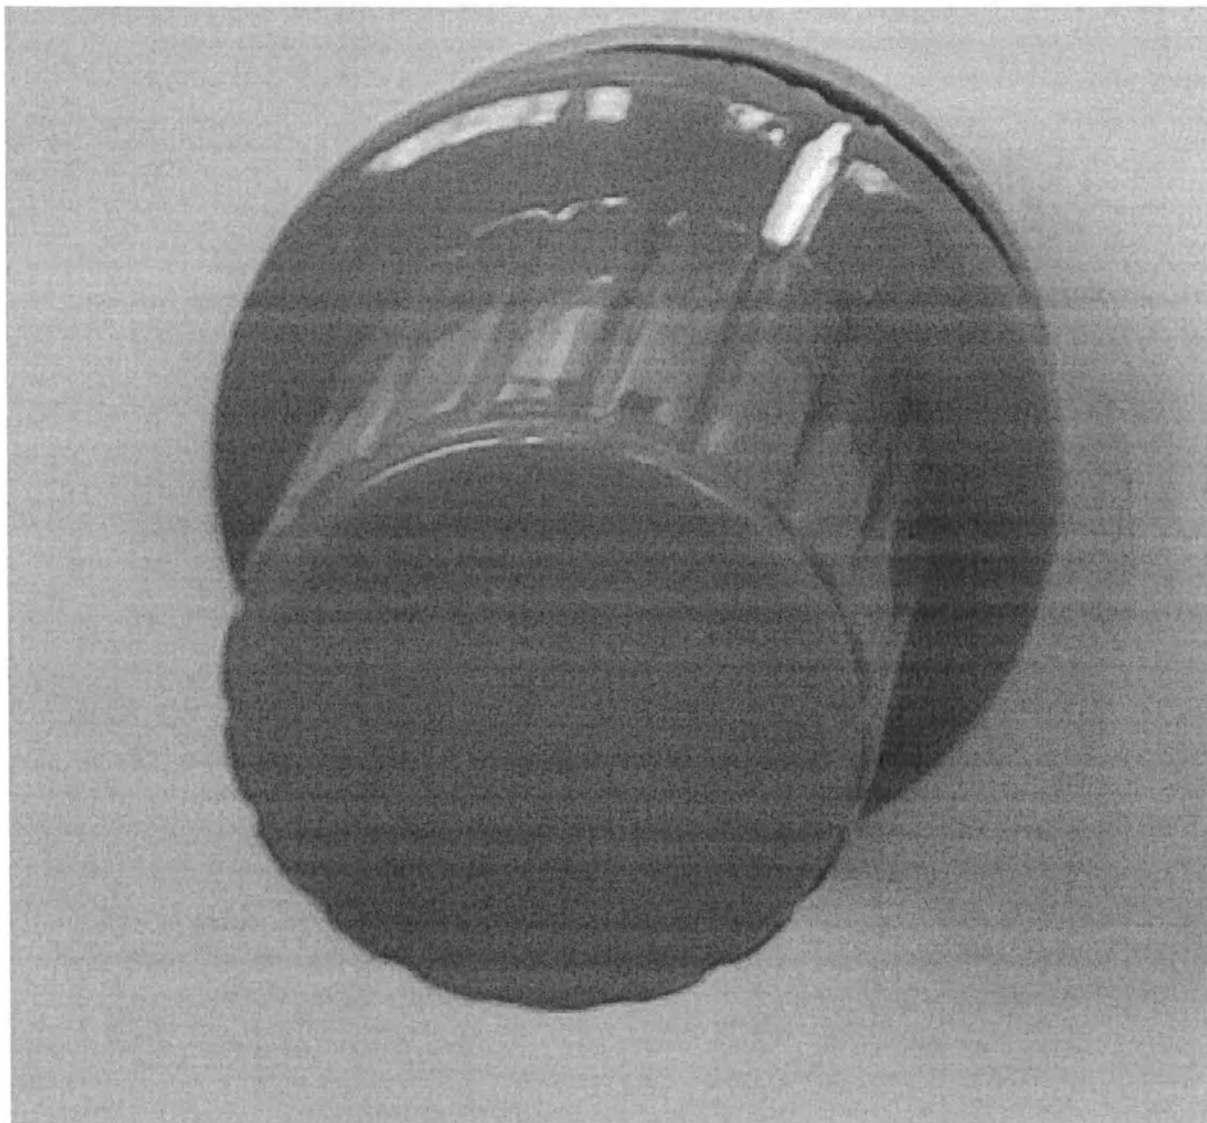


Индикатор давления аспирационного потока.

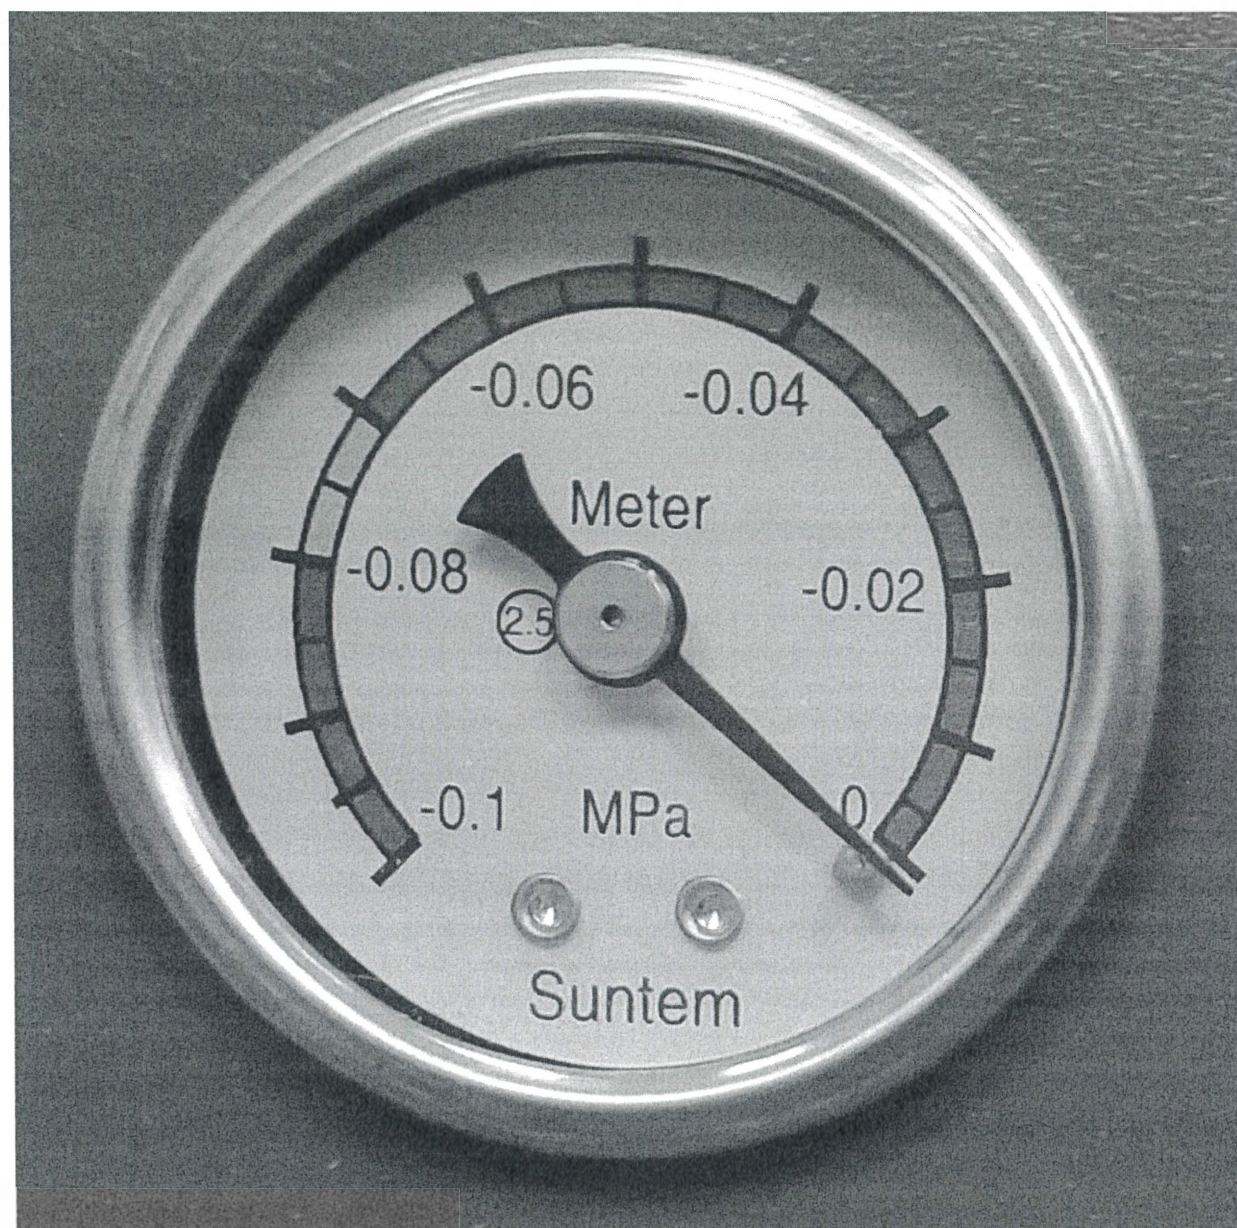


Ручка регулятора давления воздушного потока.

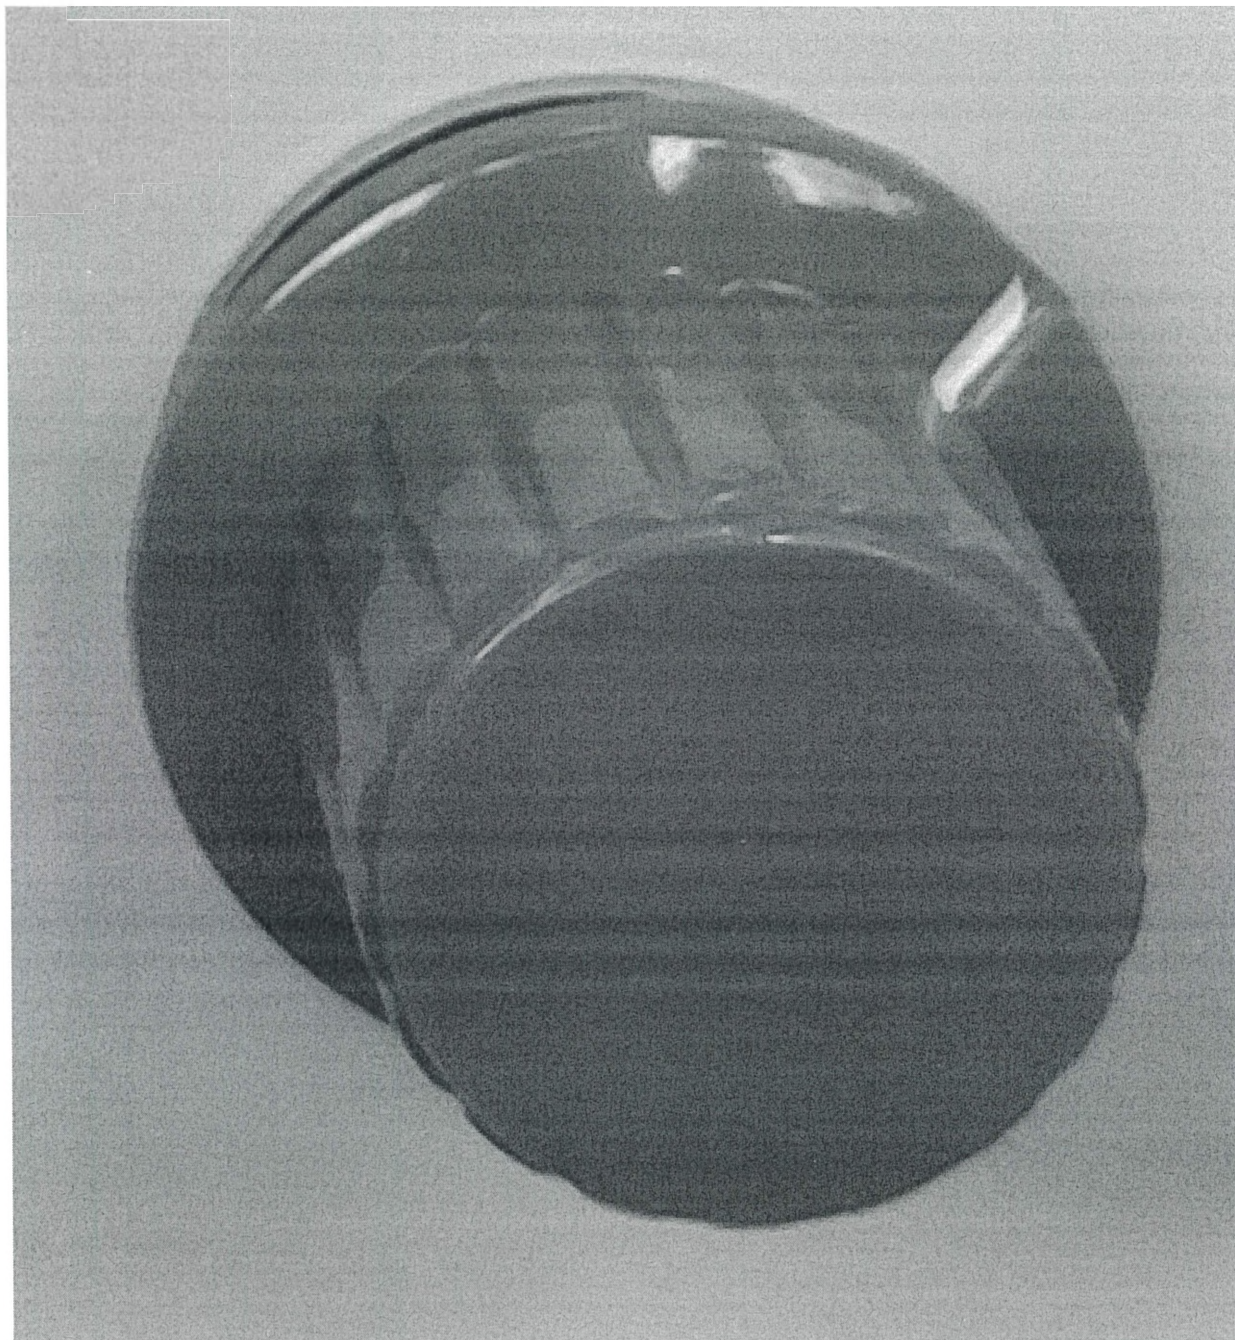


Индикатор давления воздушного потока.

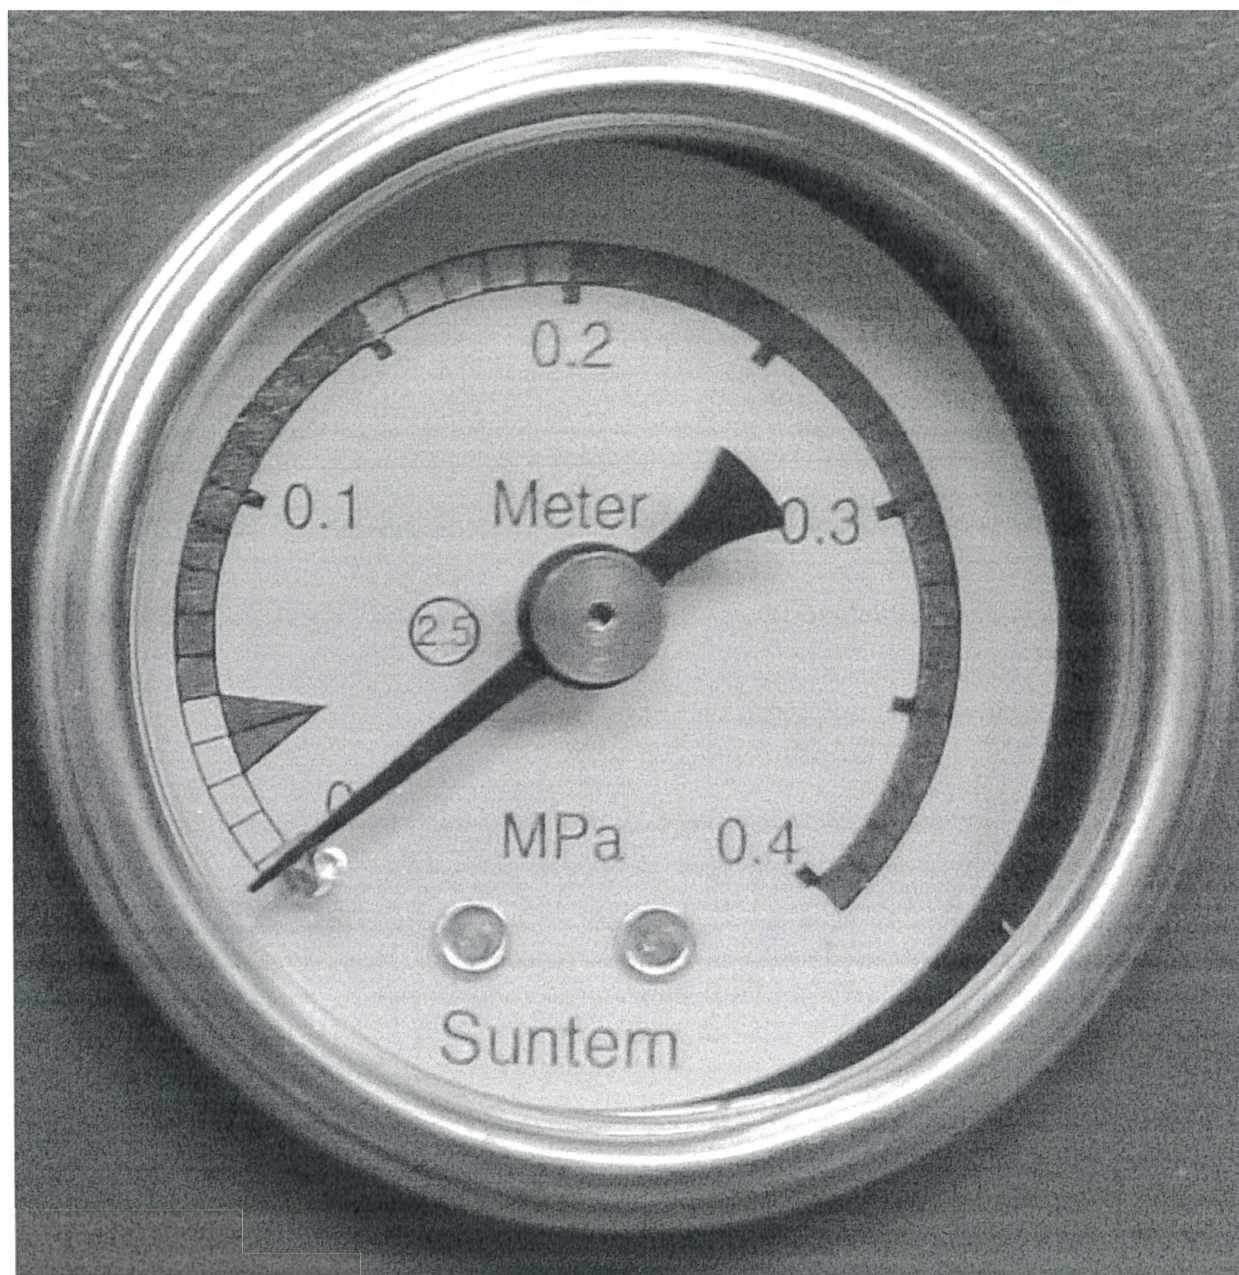

Крышка аспирационного отсека.

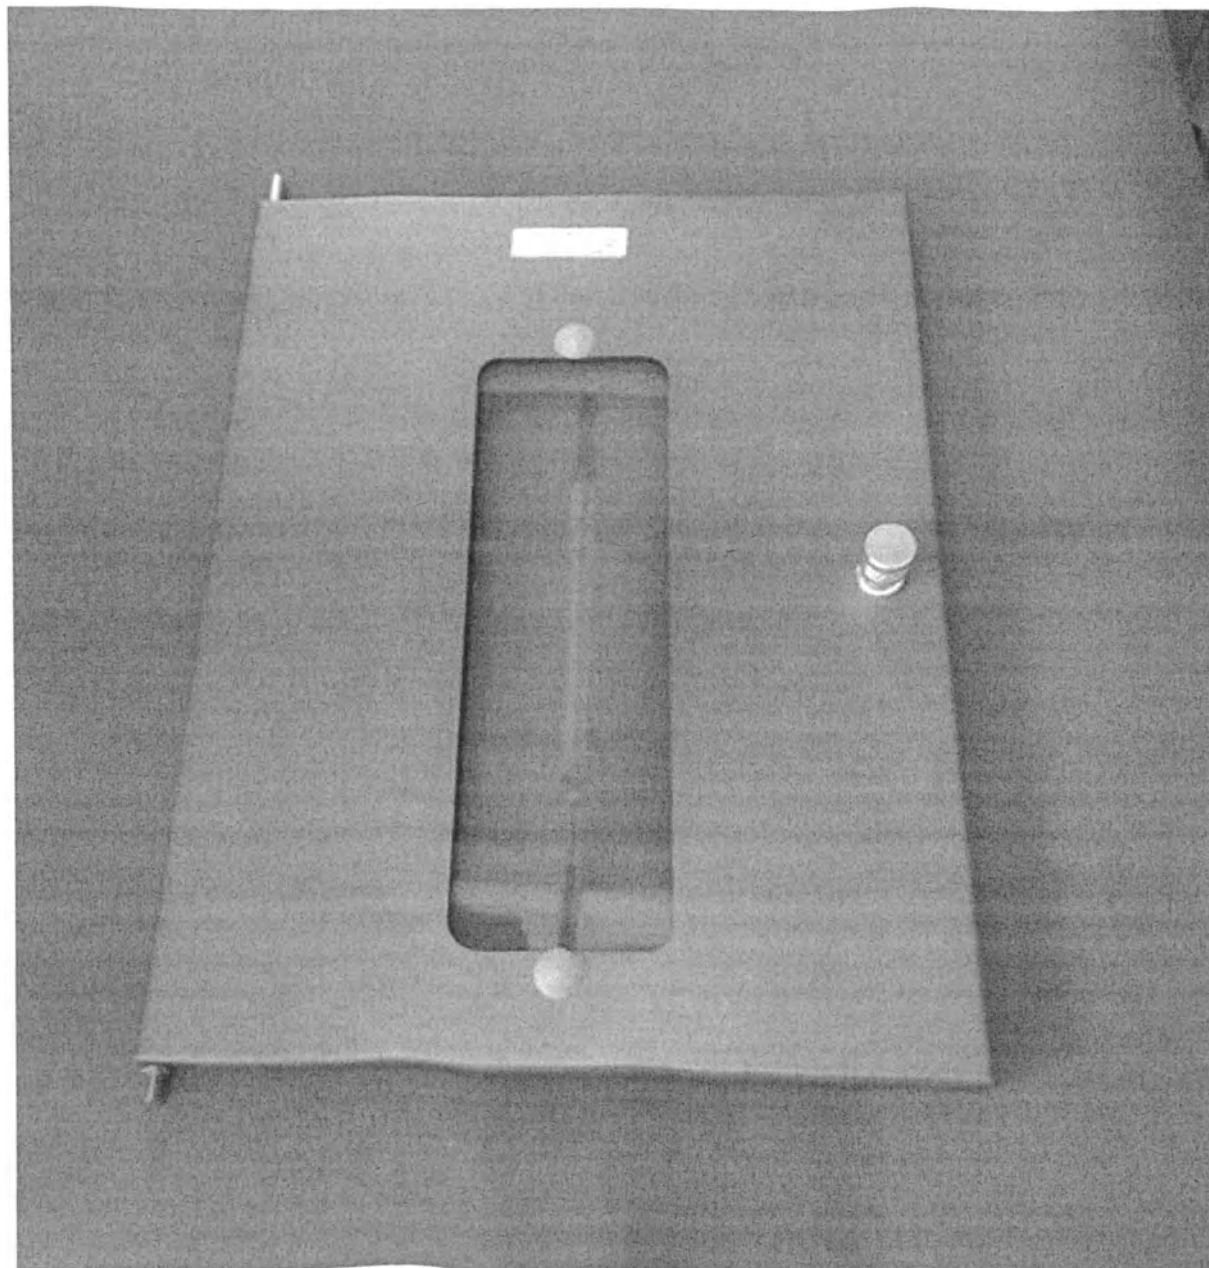


Сетка устройства предварительного нагрева инструментов, эндоскопов и зеркал.

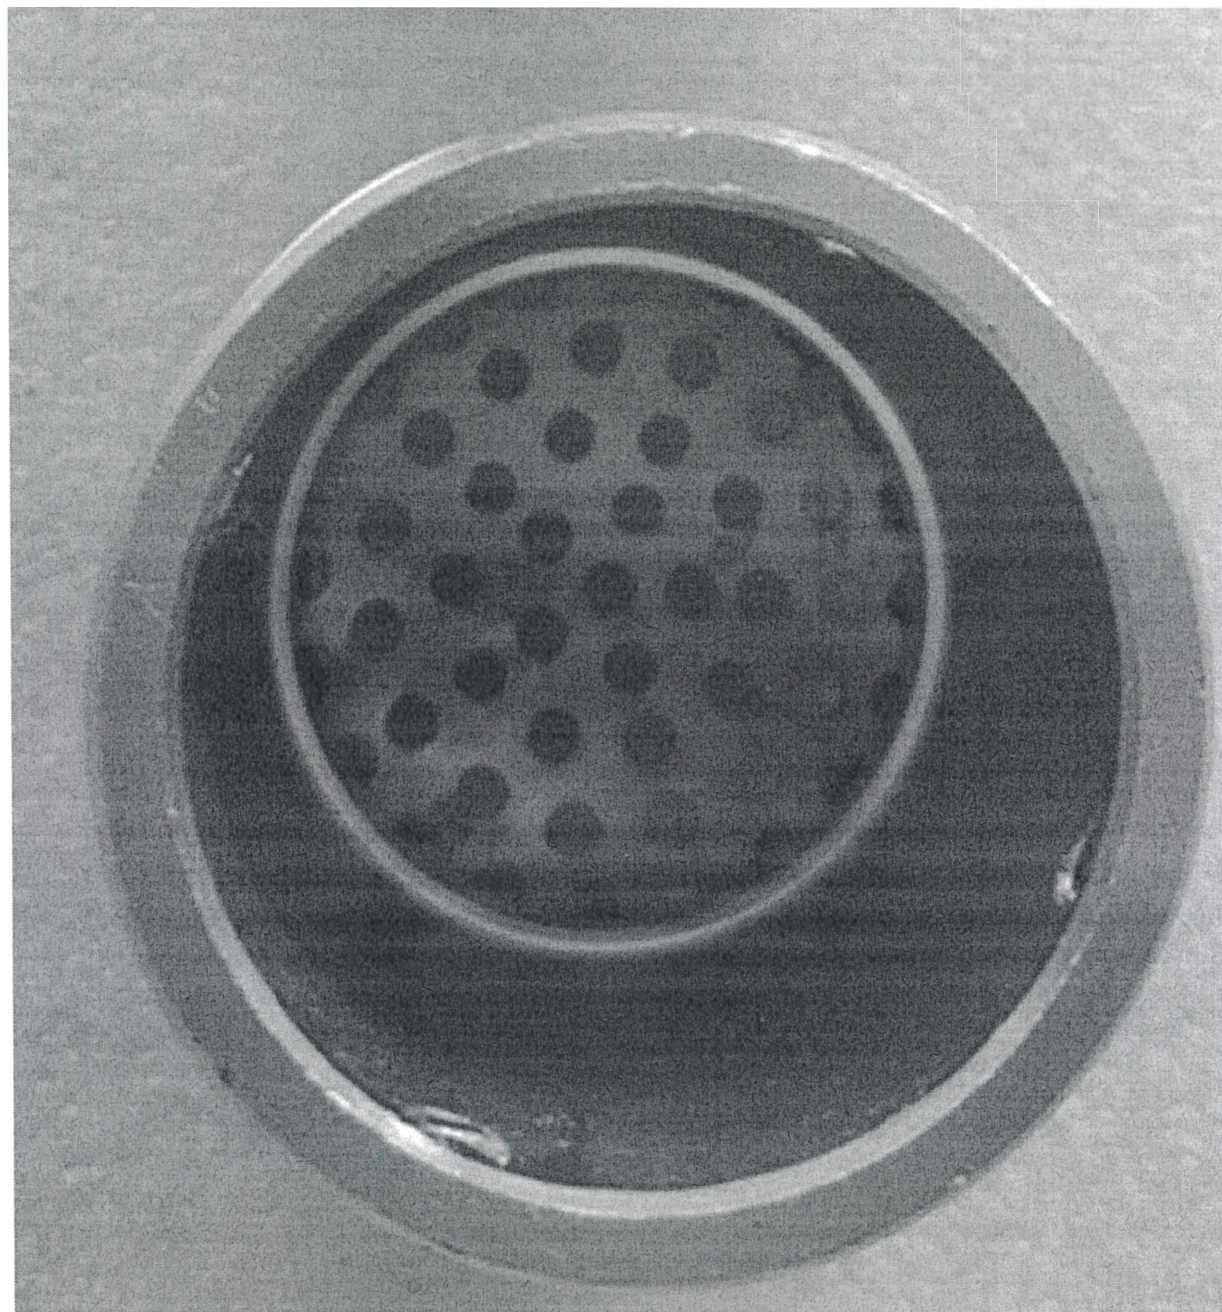


Руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА DIXION ST ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ DIXION ST-E600

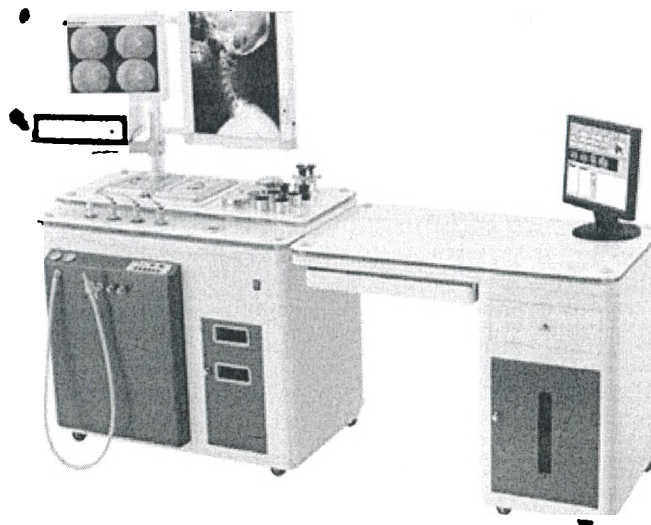


Встроенный источник холодного света.

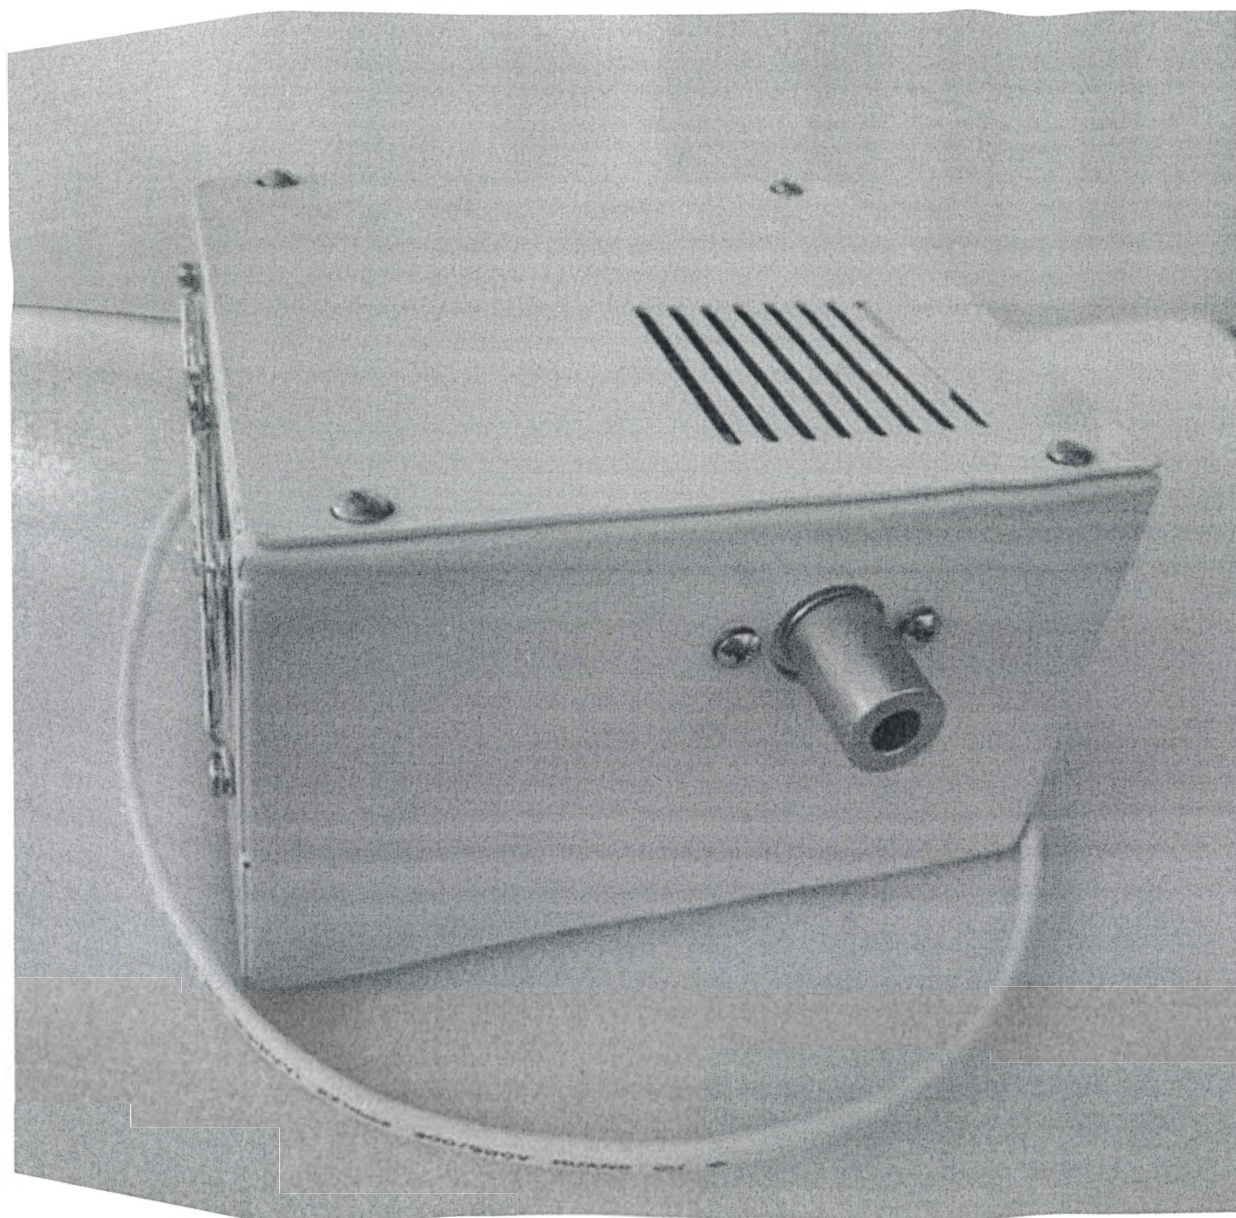


Источник холодного света специальный




Негатоскоп специальный.

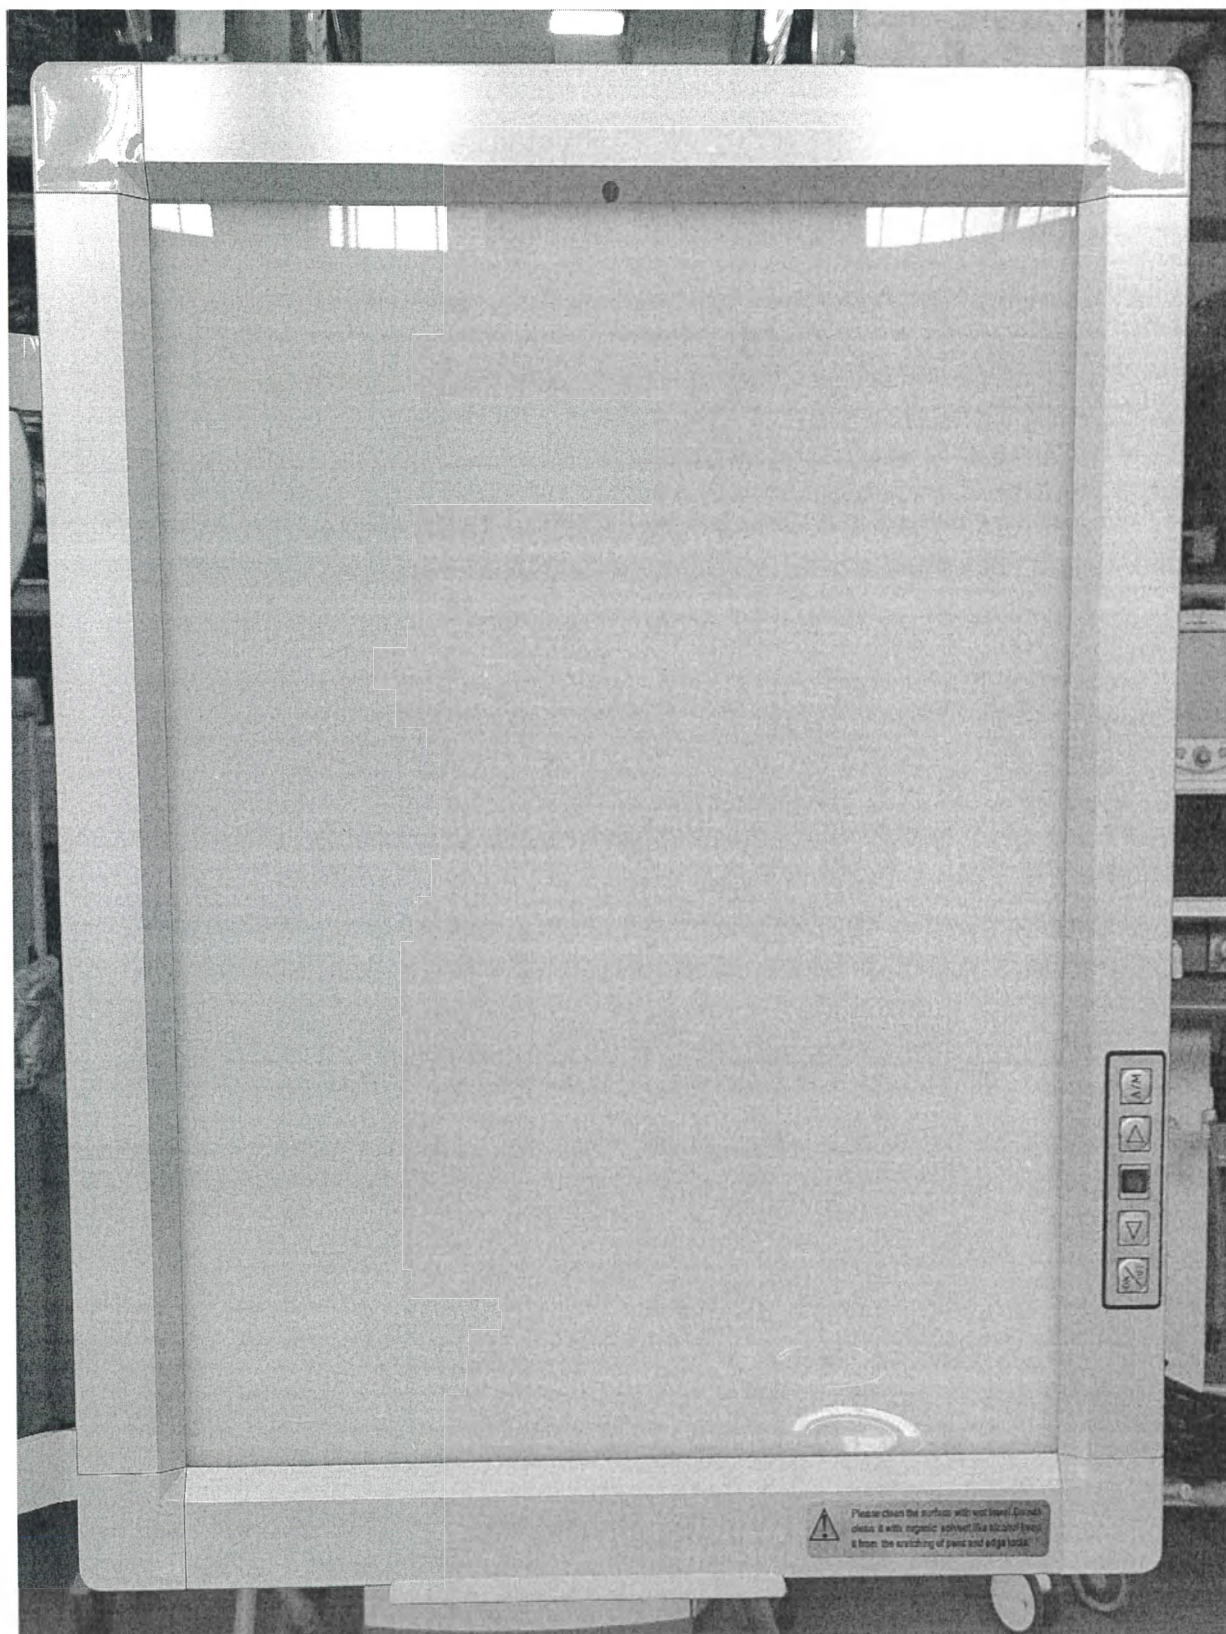


Держатель негатоскопа специального.

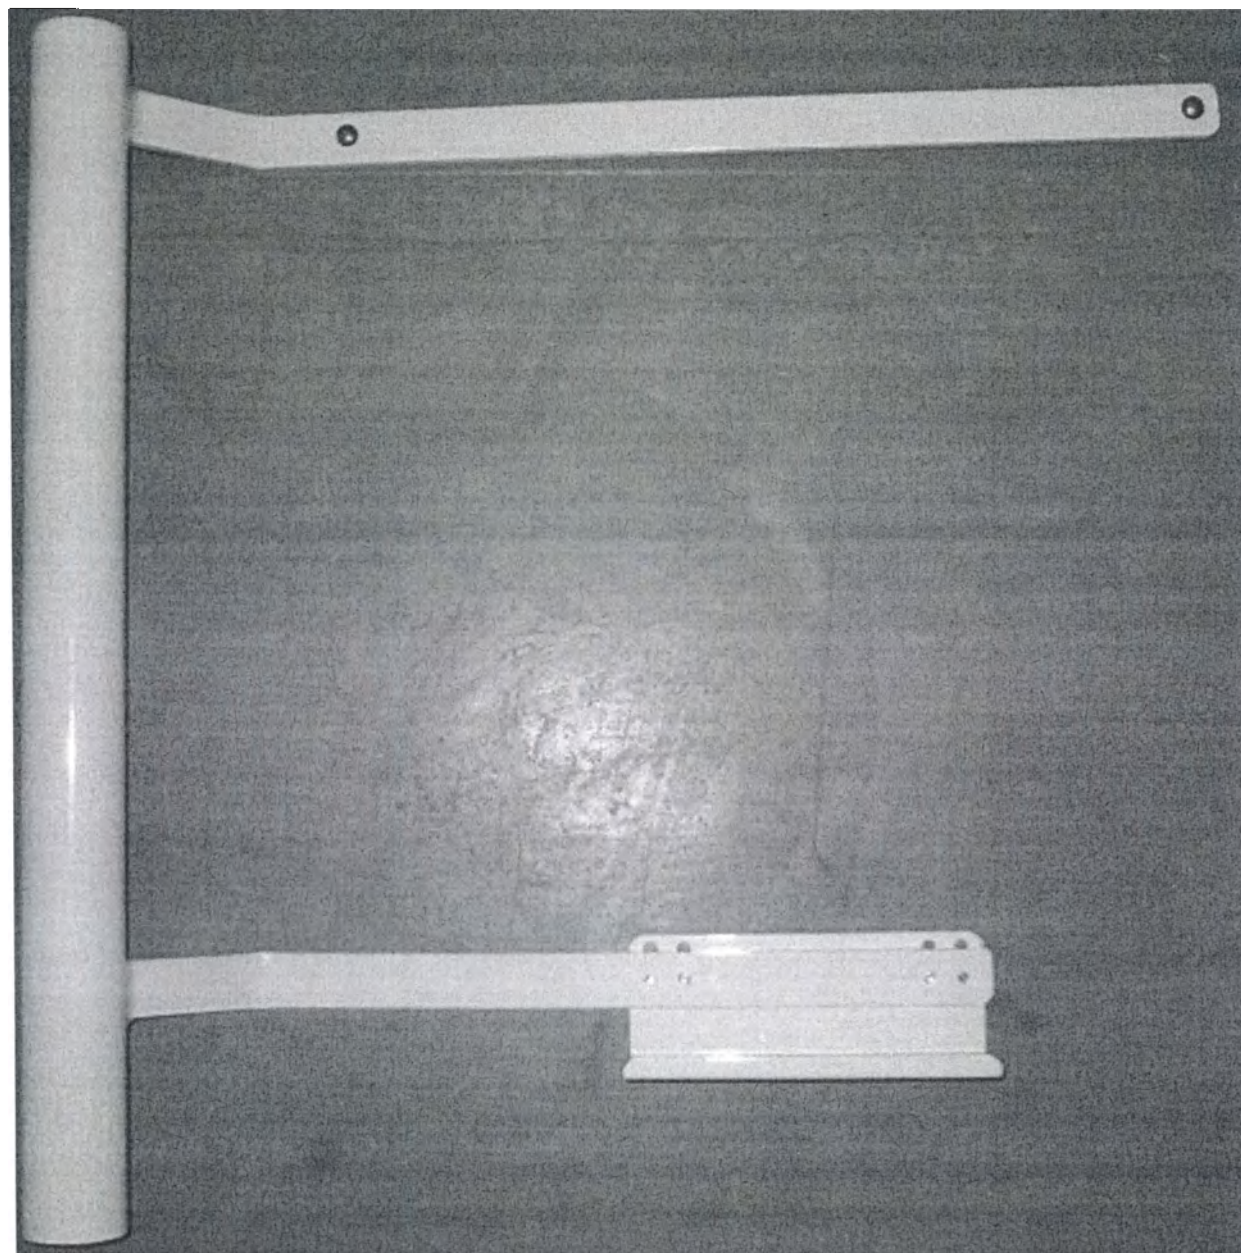


Прокладка

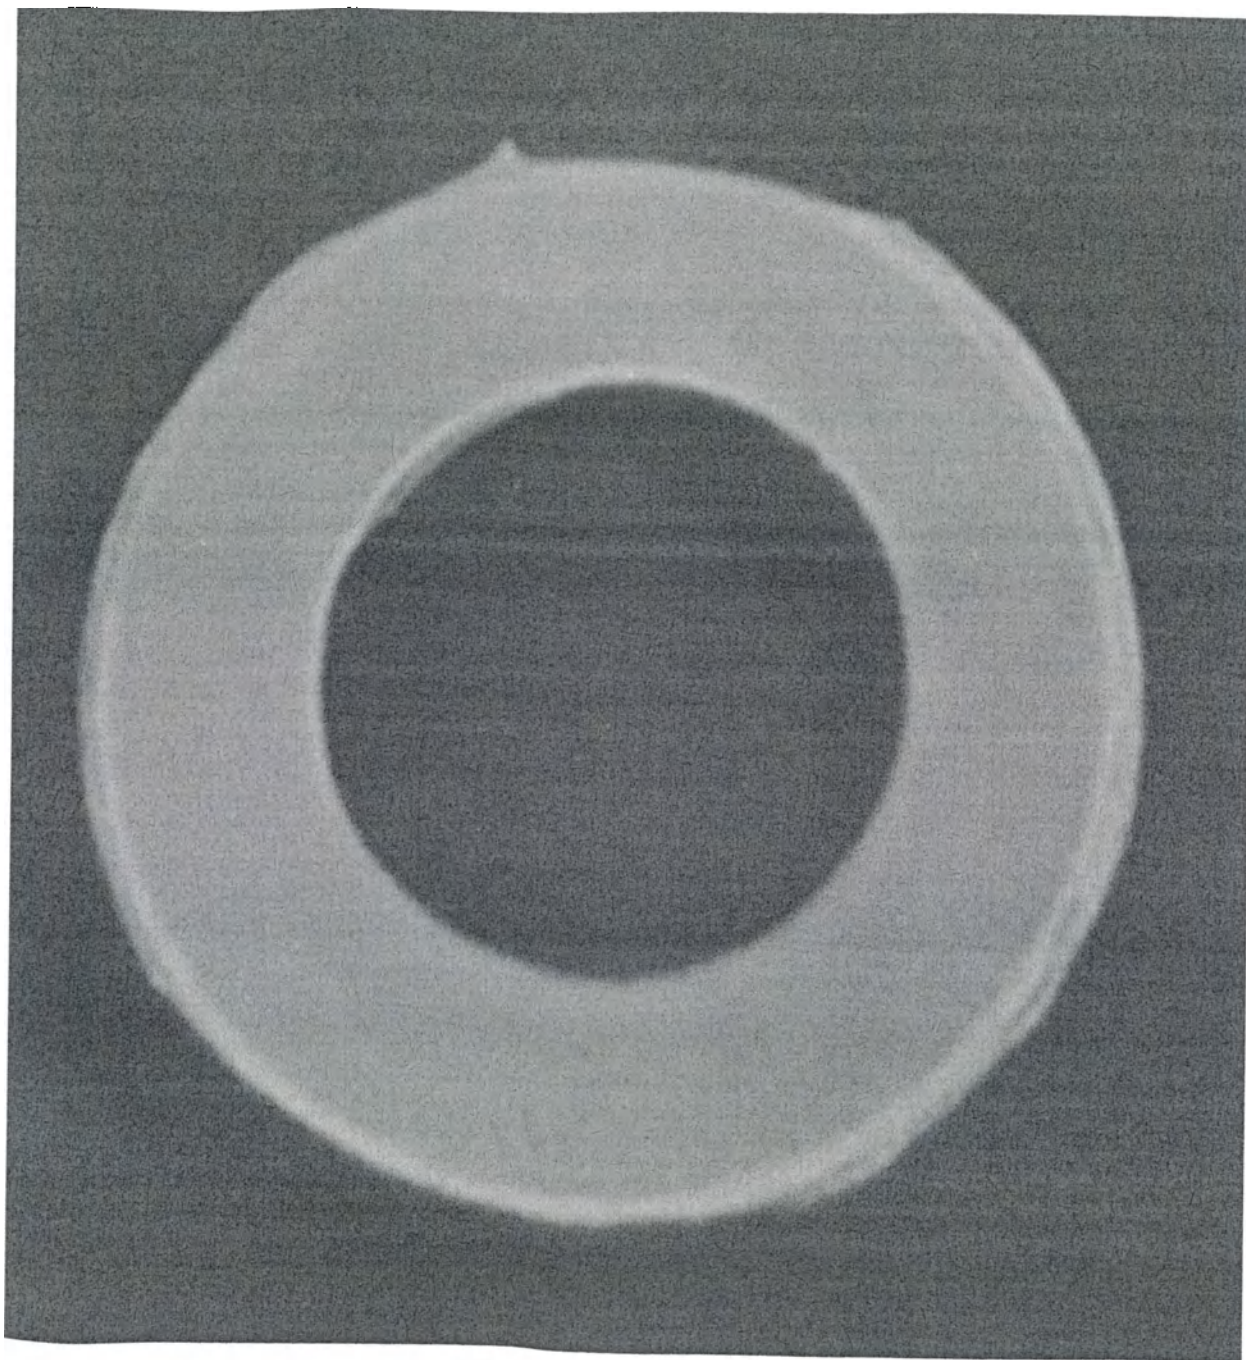


Клапан водяной.

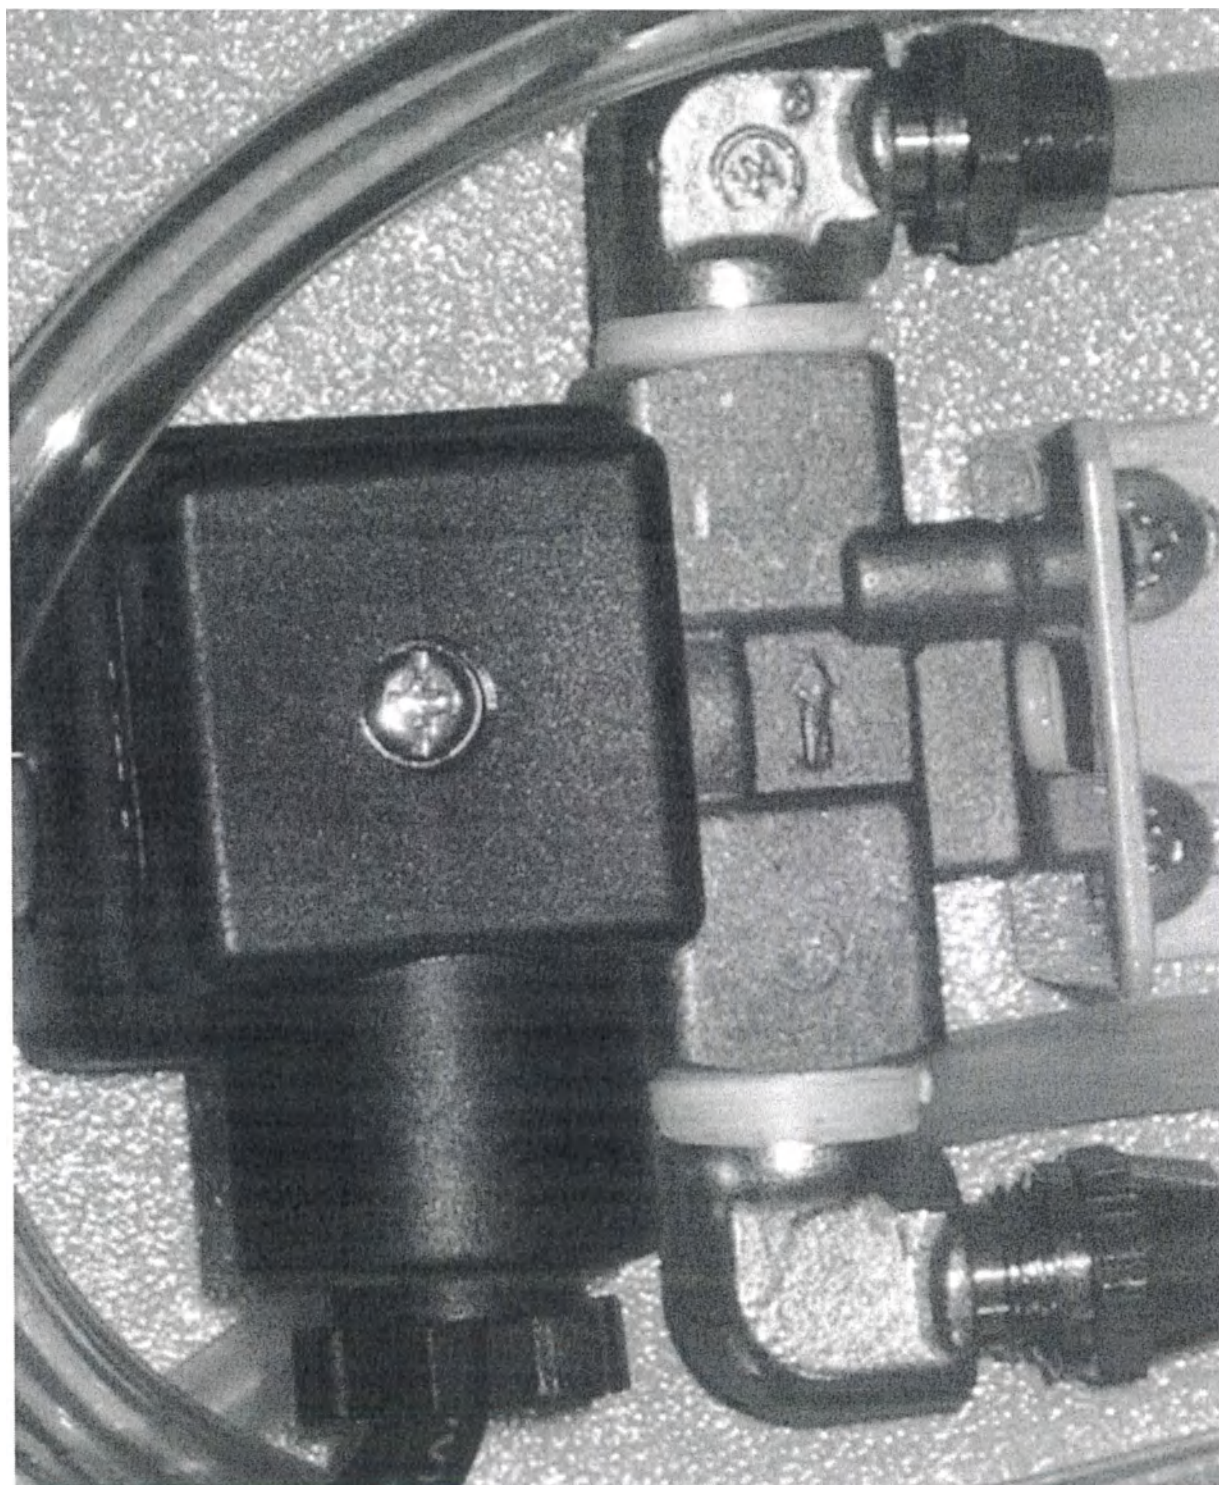


Клапан воздушный.

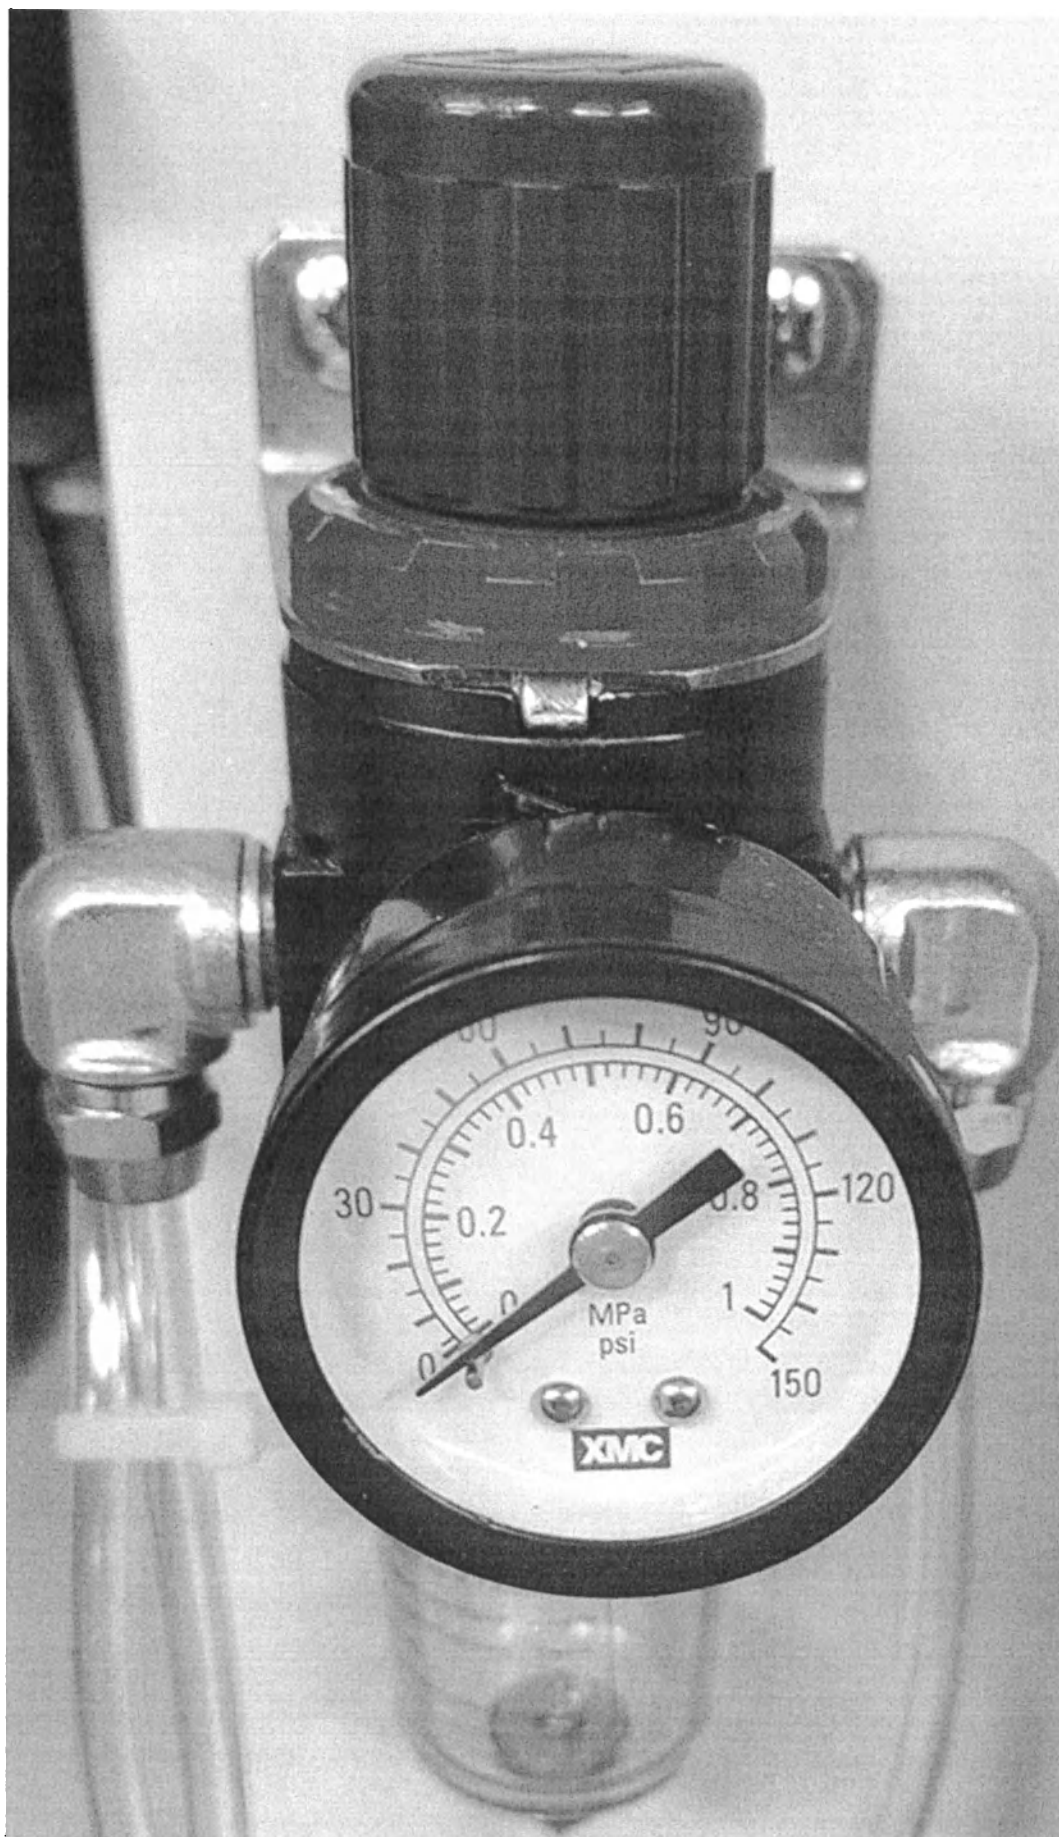


Датчик давления воздушного потока

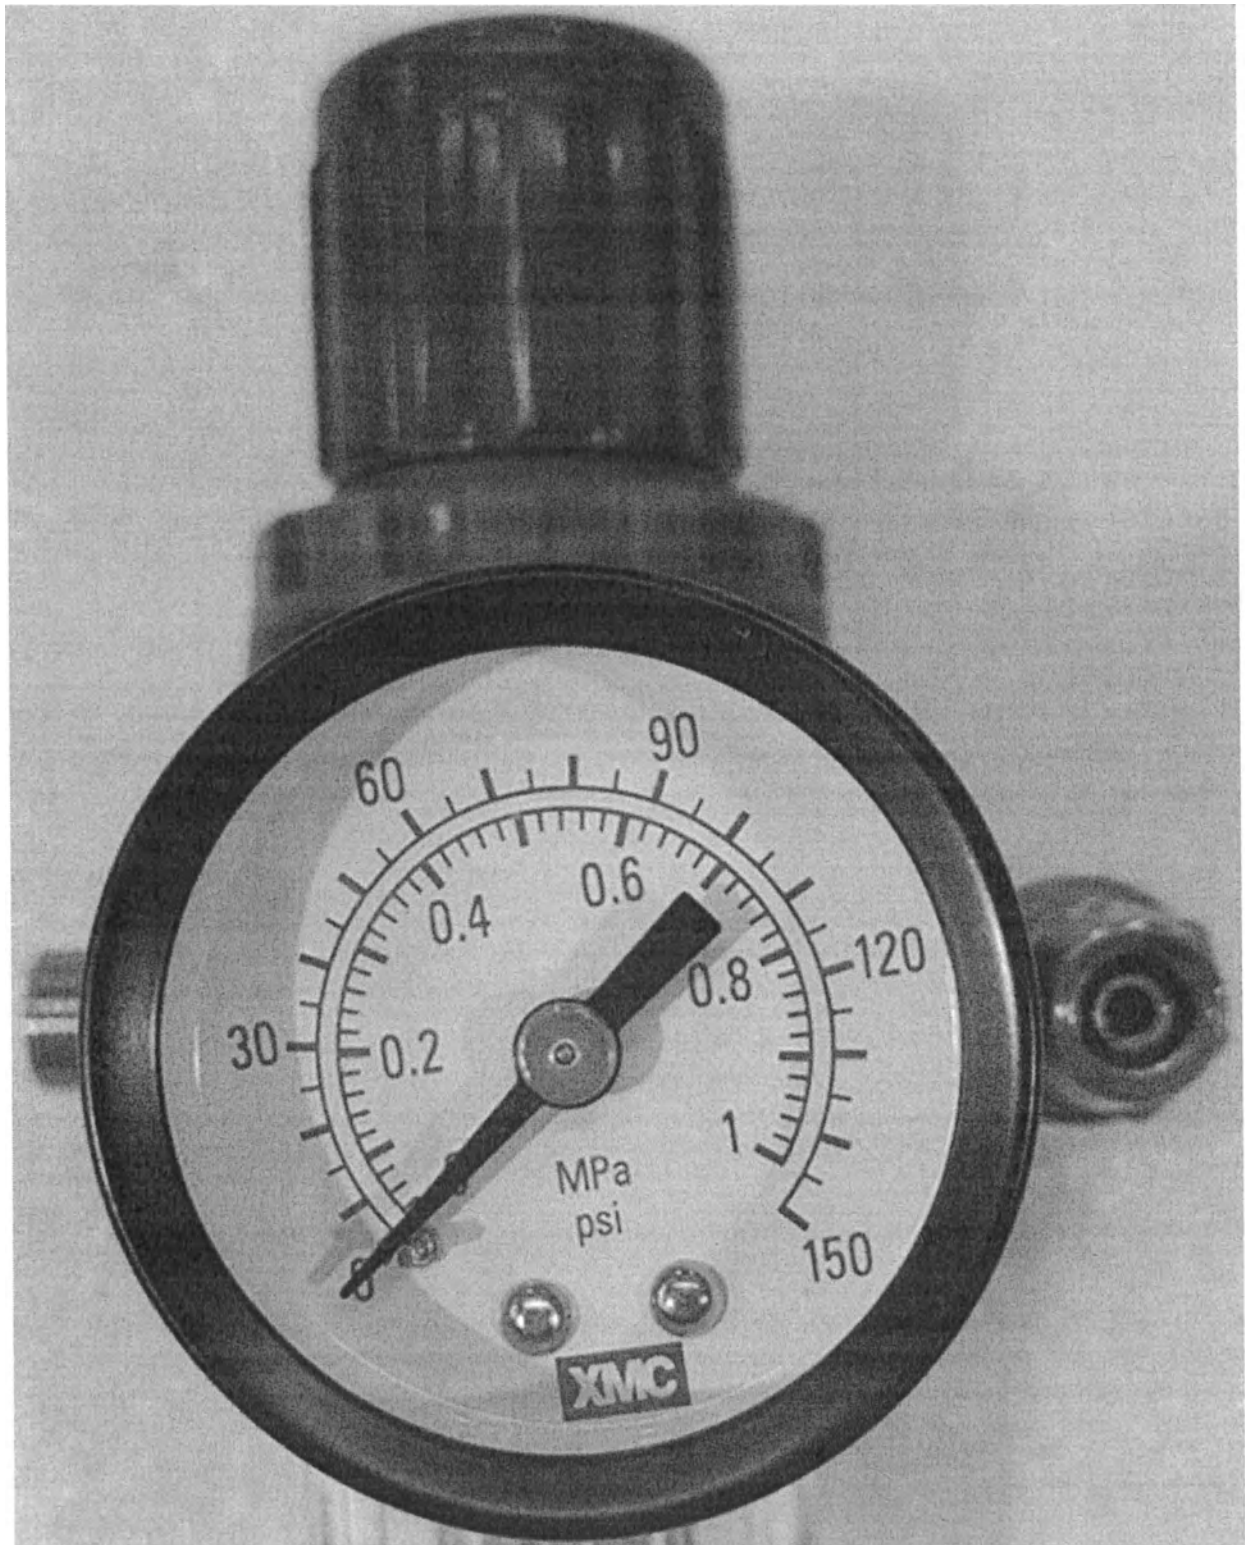

Нагревательный элемент.

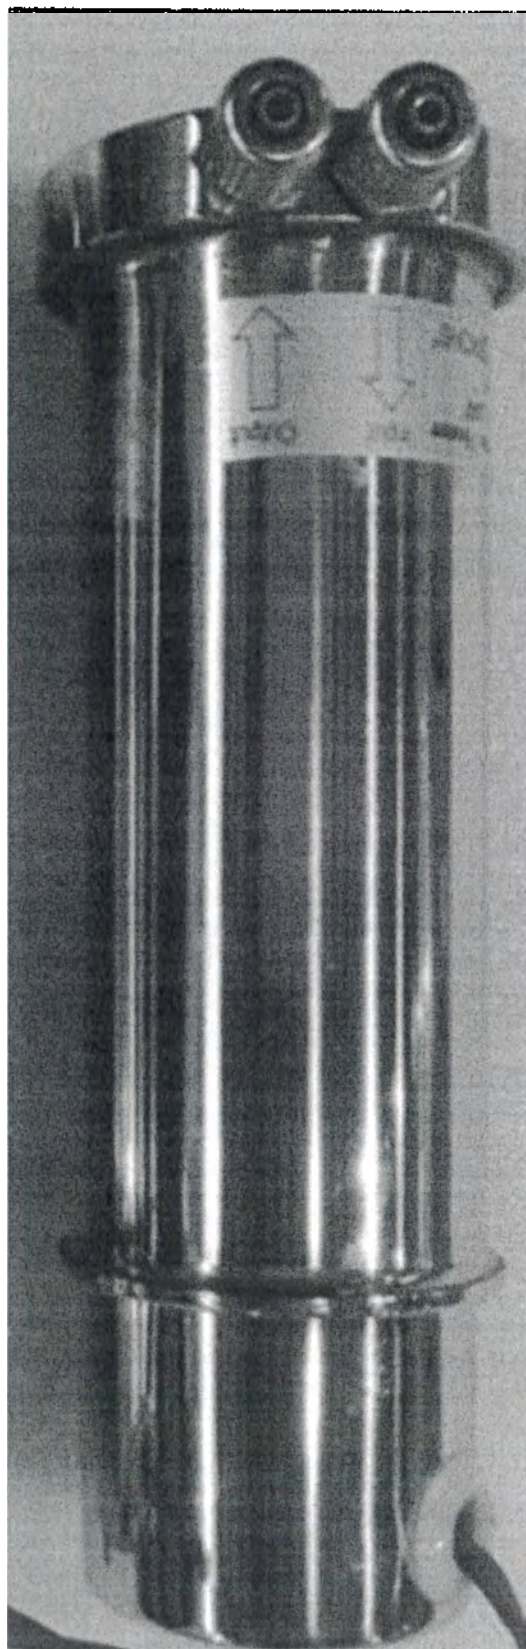

Гильза для отсоса

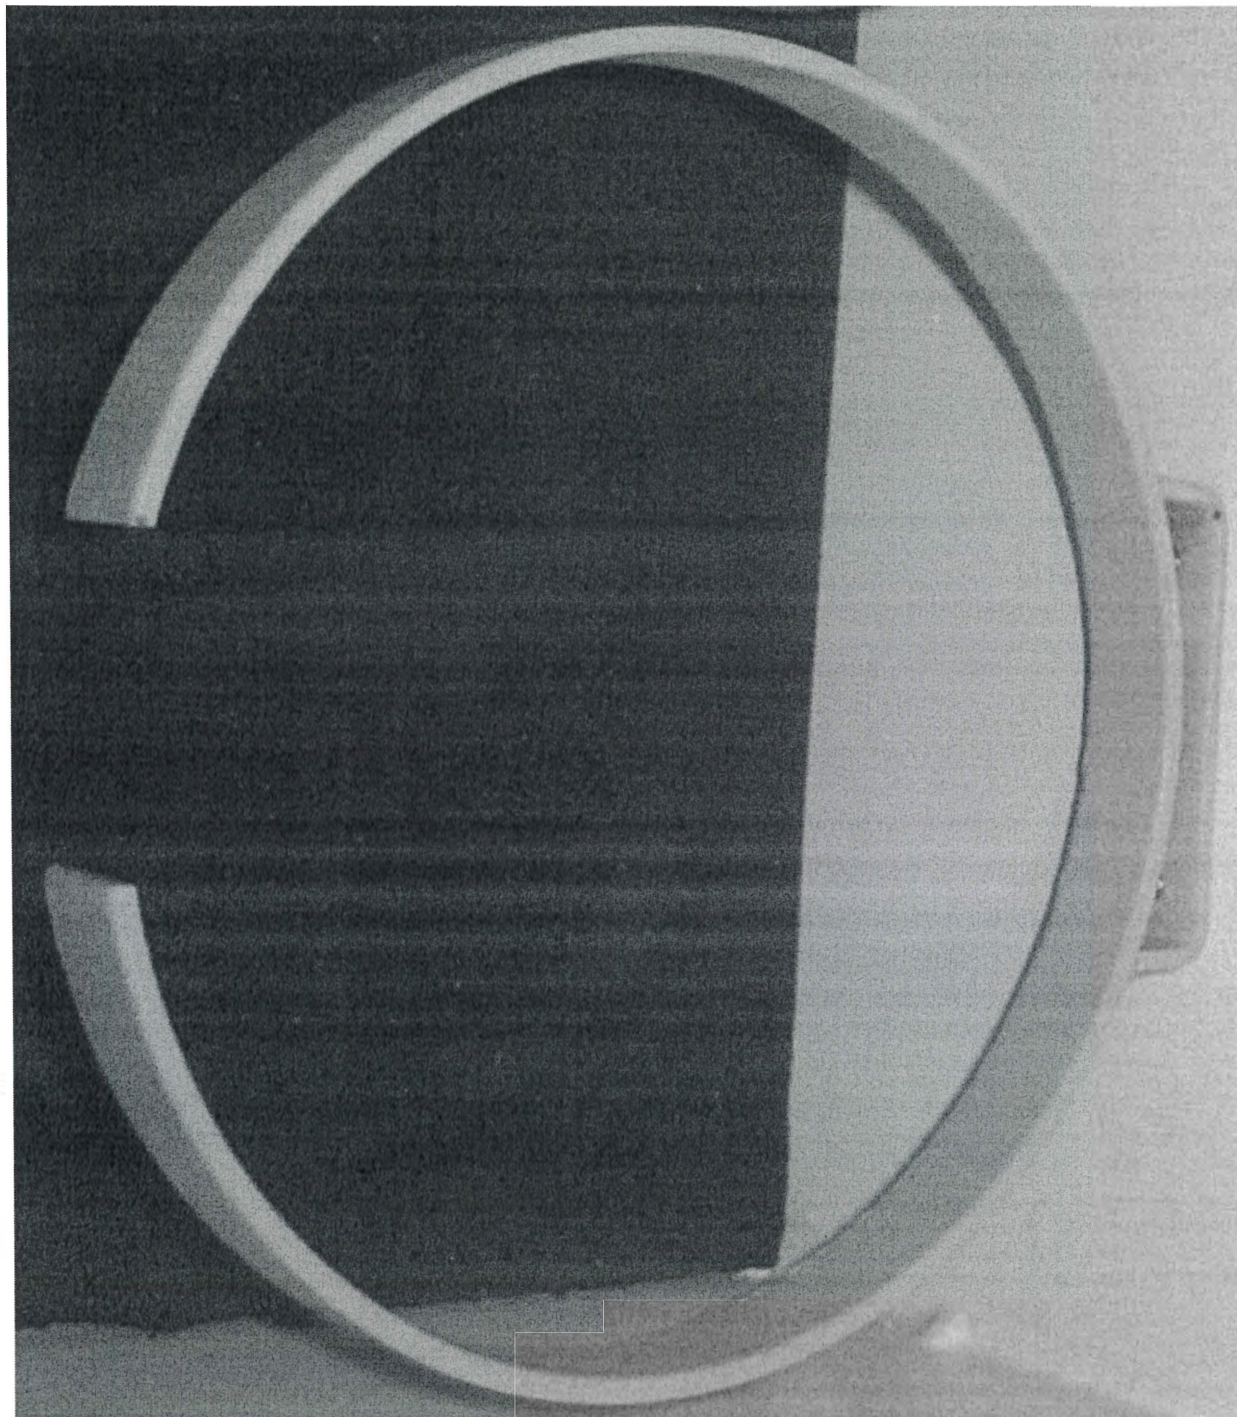


Кресло пациента Dixon ST-E250




Кресло врача.




Ножной переключатель положения кресла пациента.

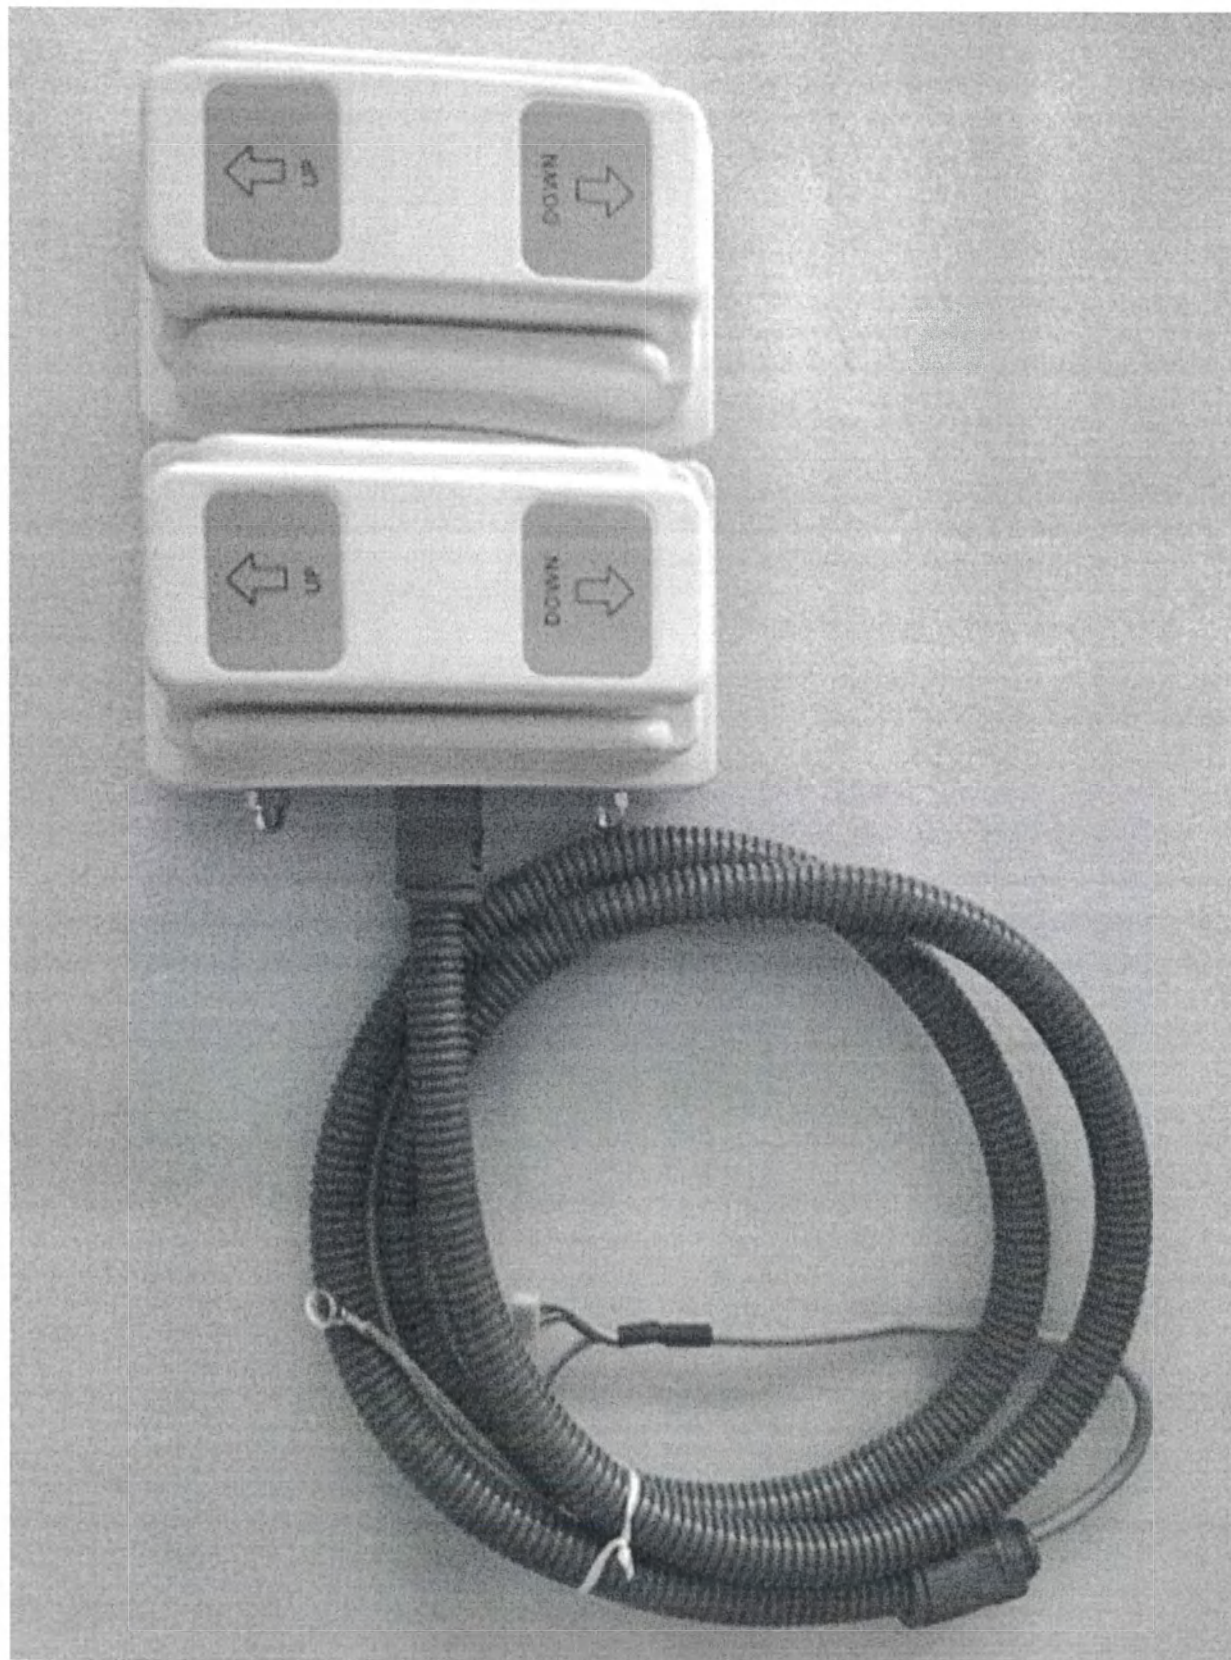


Подголовник отсоединяемый

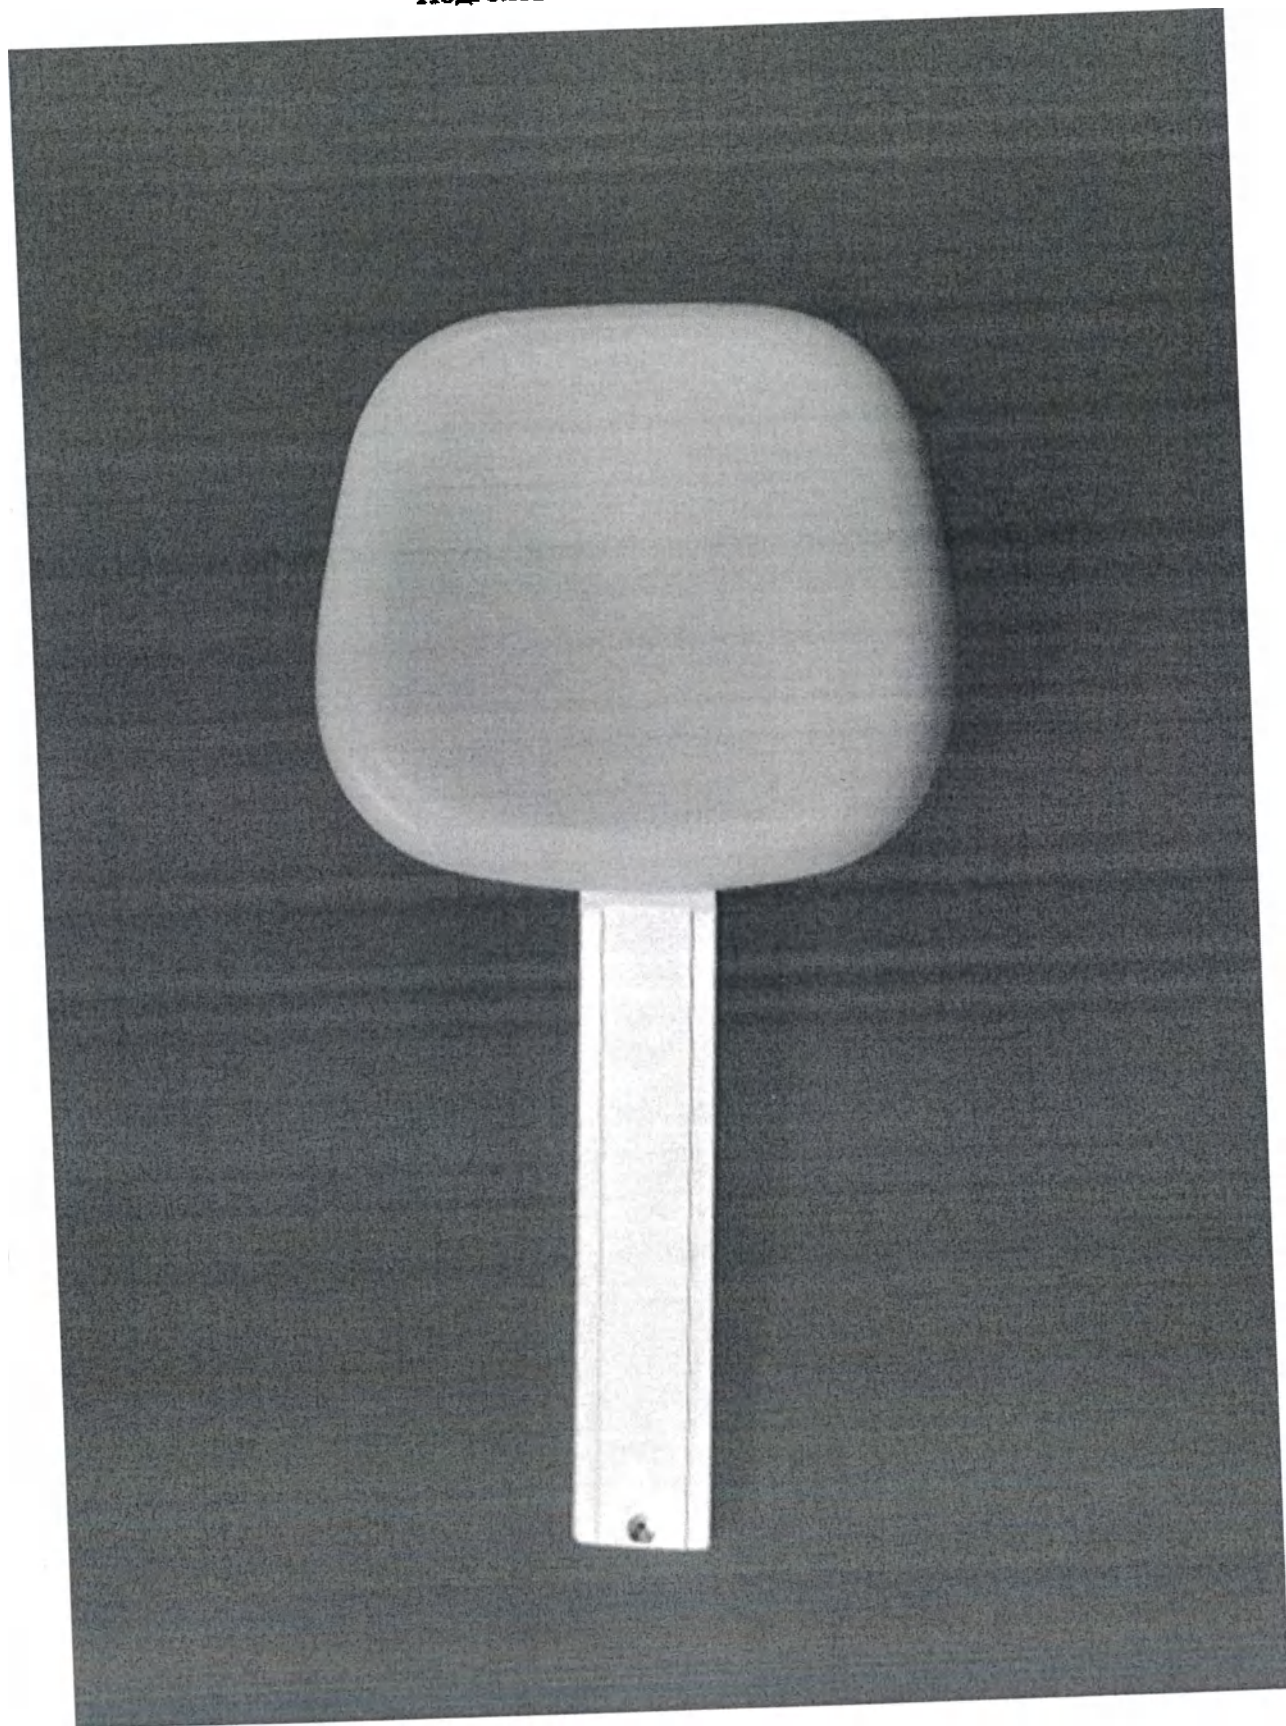

Кабель питания кресла пациента.

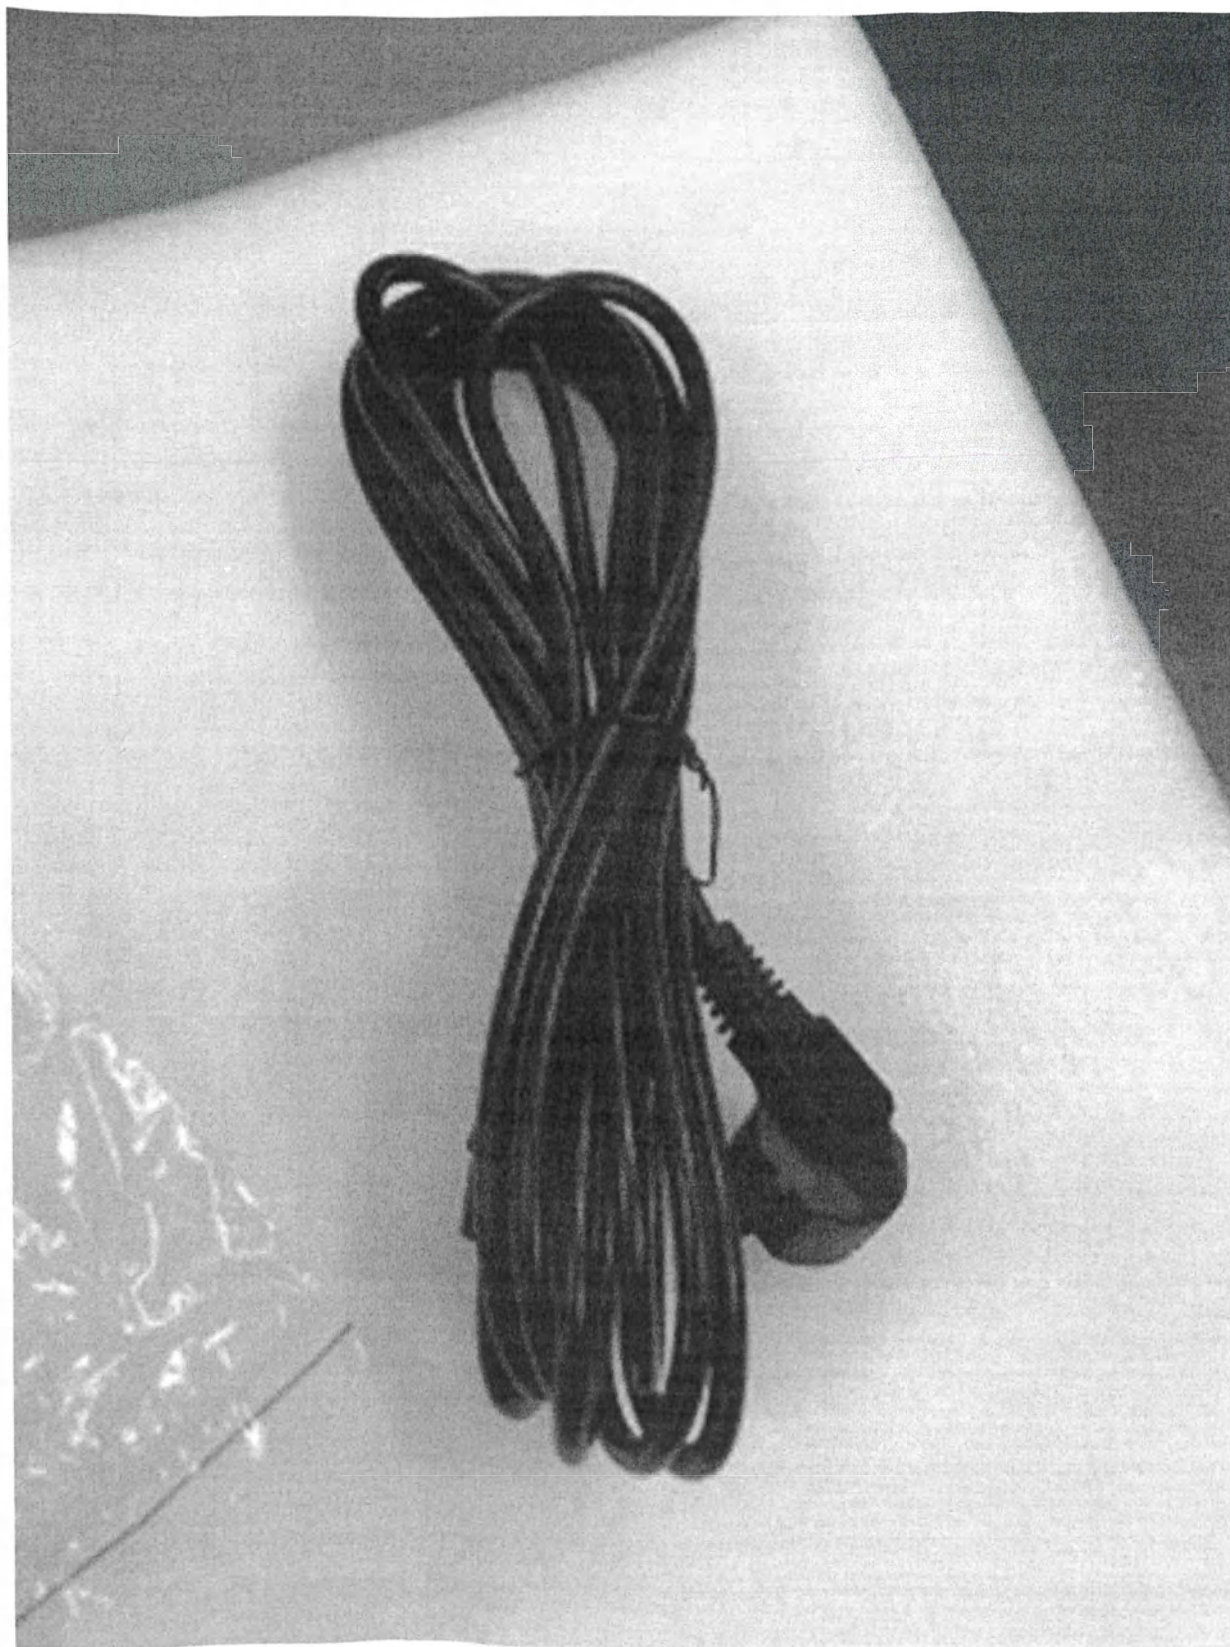

Подставка для ног для кресла пациента.

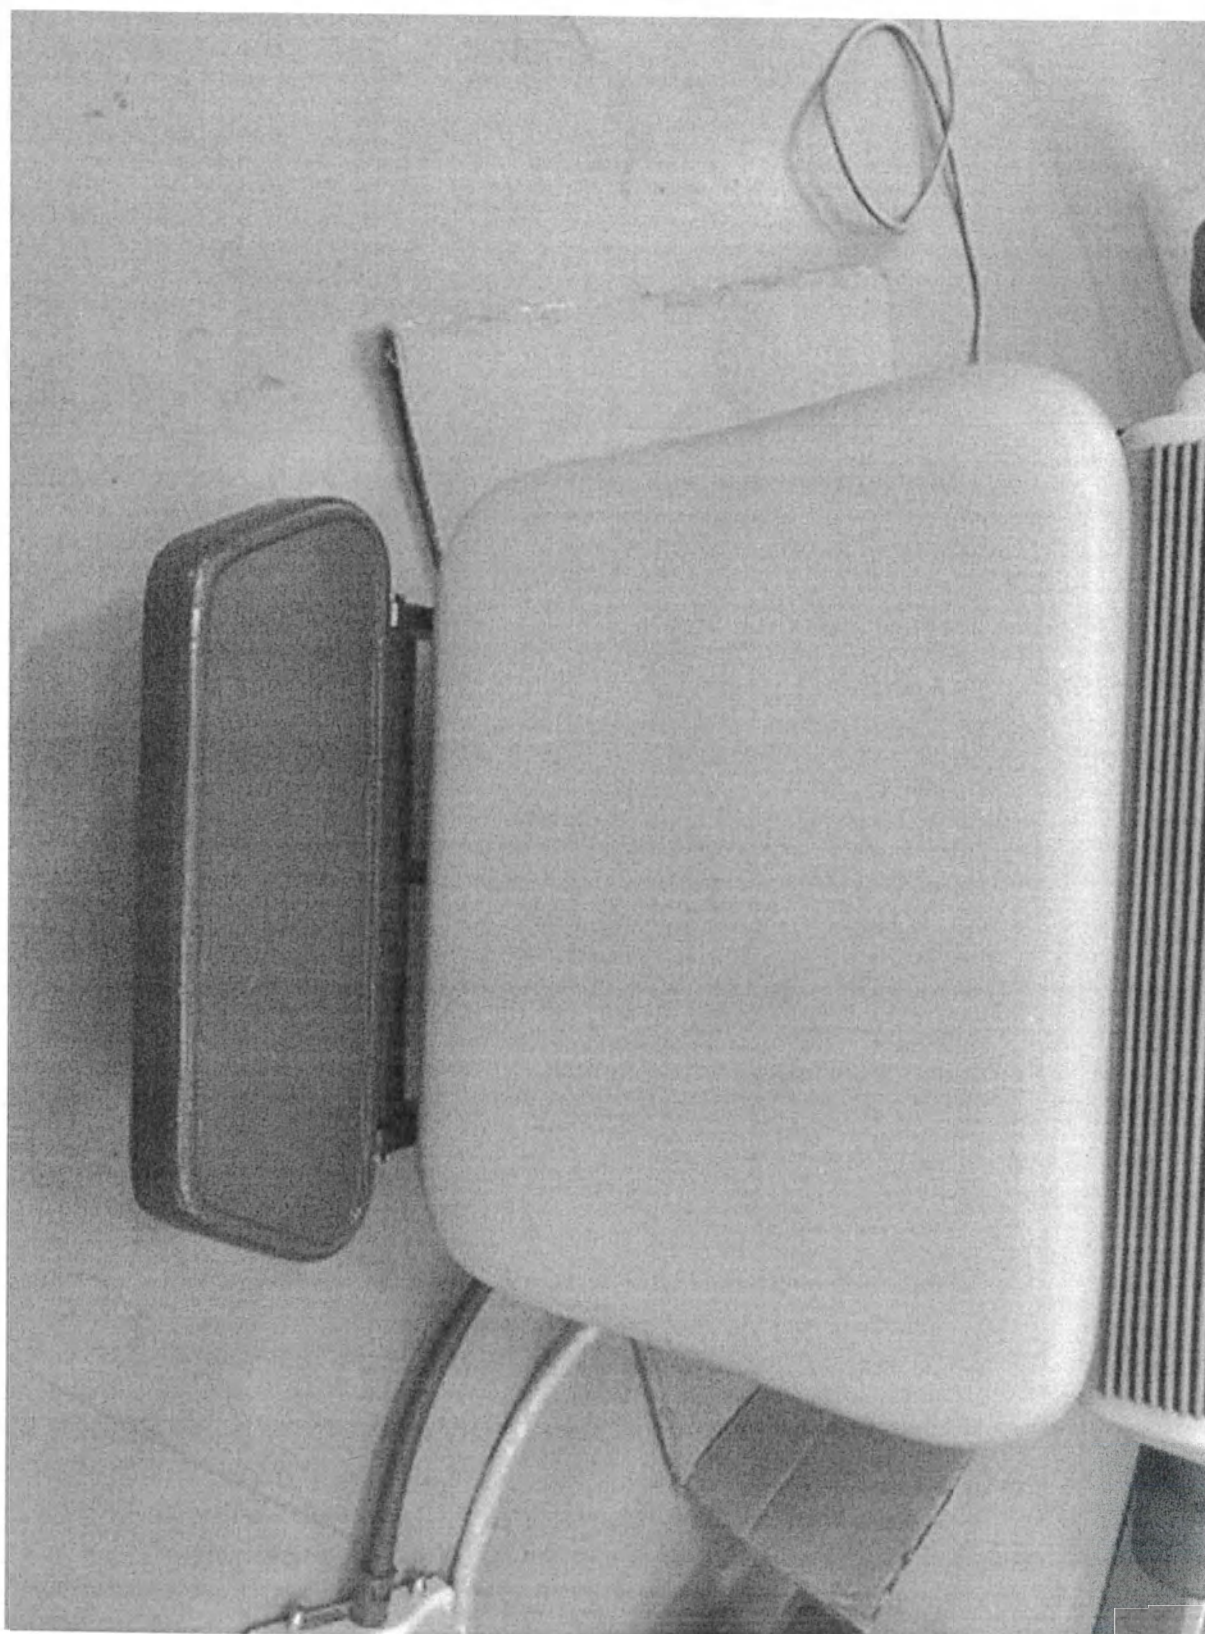


Осветитель налобный с холодным светом




Осветитель налобный с теплым светом



Аккумуляторная батарея для налобного осветителя

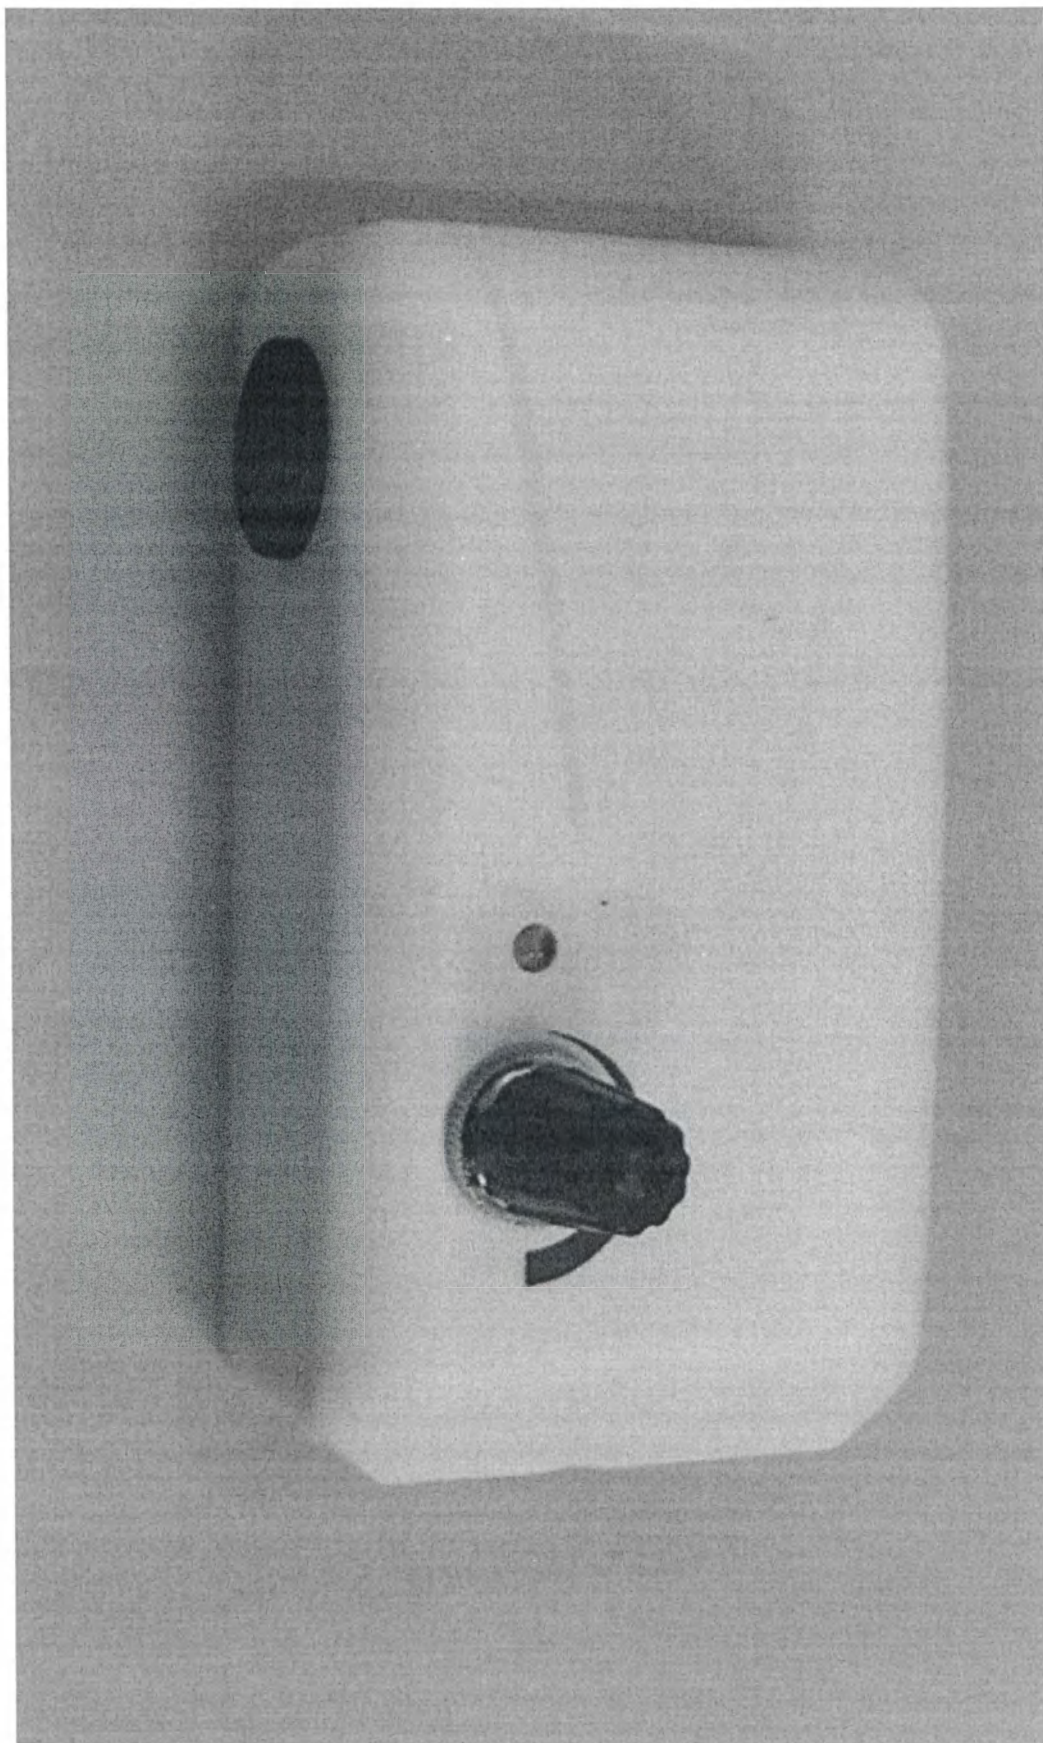


Аккумуляторная батарея дополнительная для налобного осветителя

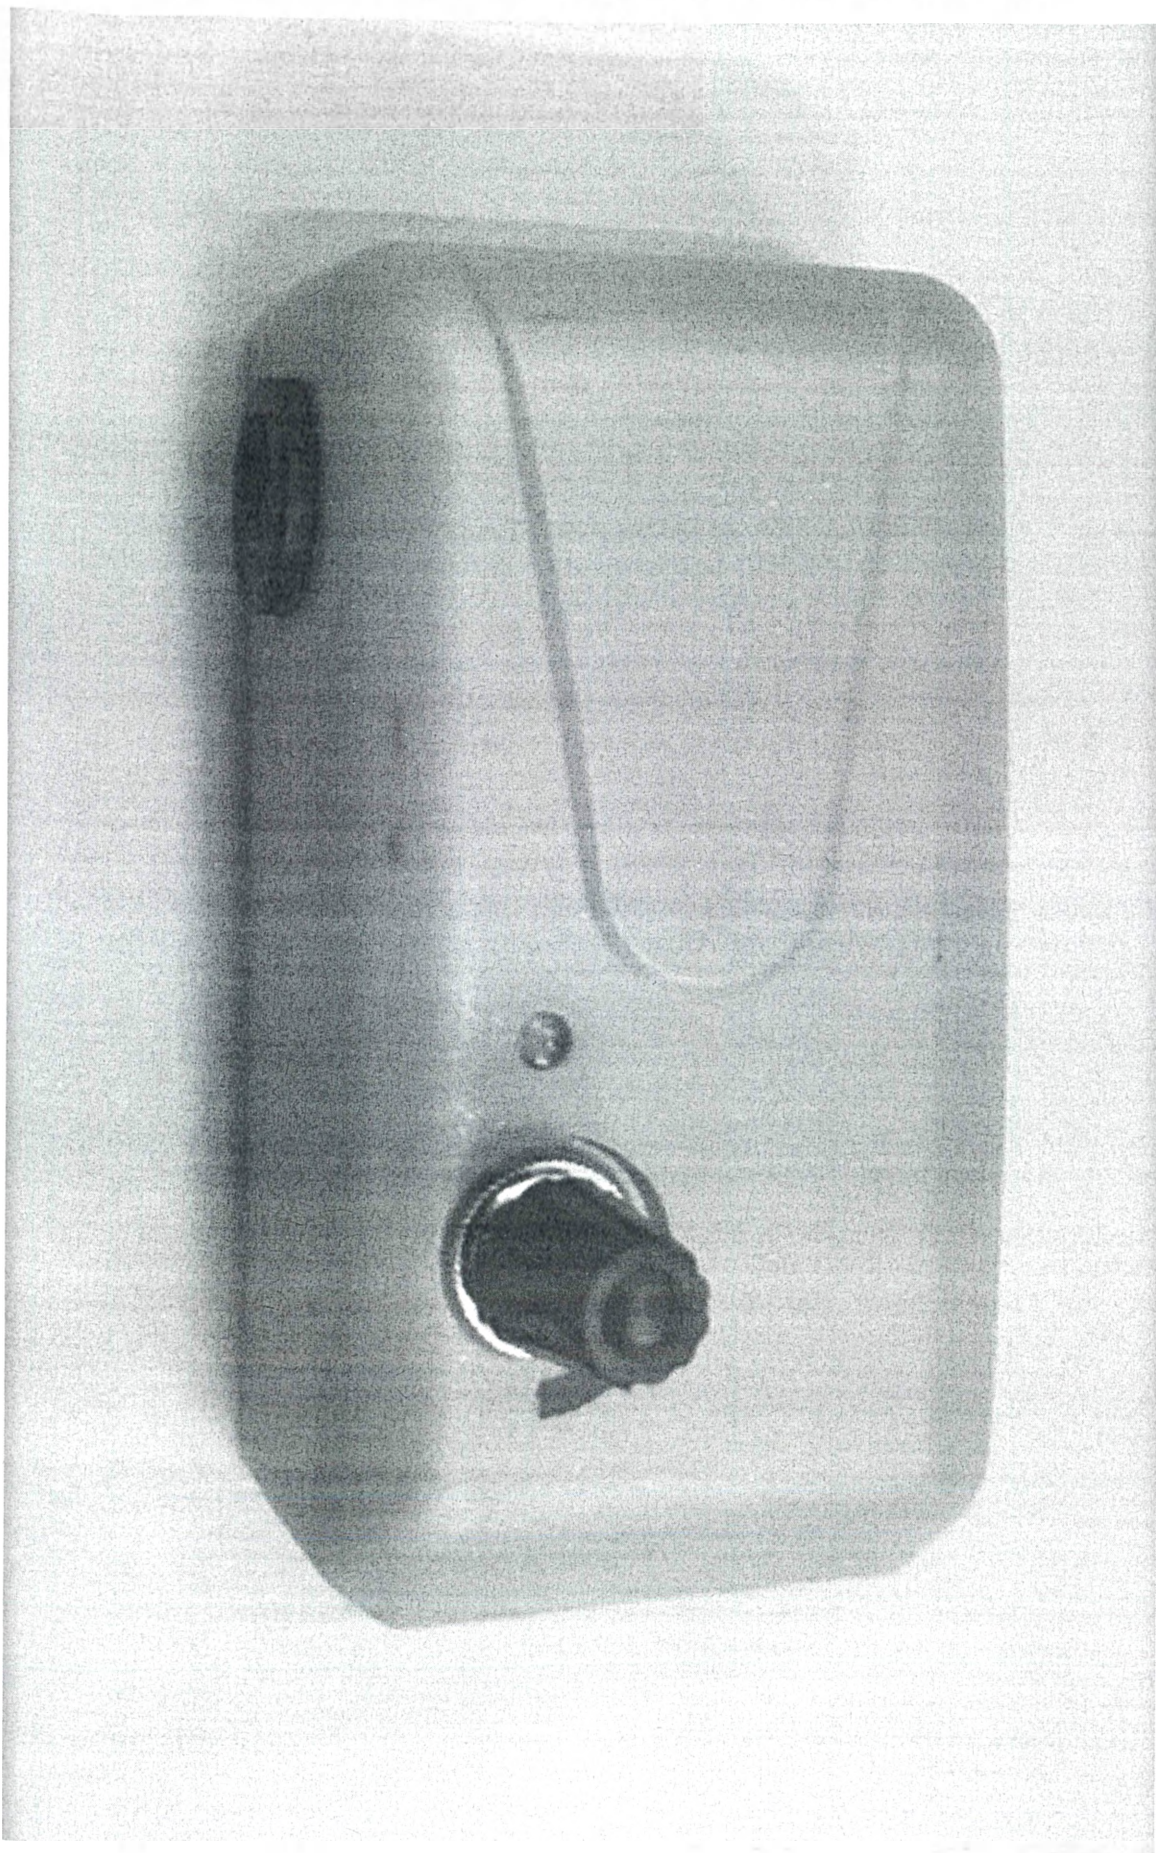


USB кабель для зарядки аккумуляторной батареи



Адаптер питания для зарядки аккумуляторной батареи

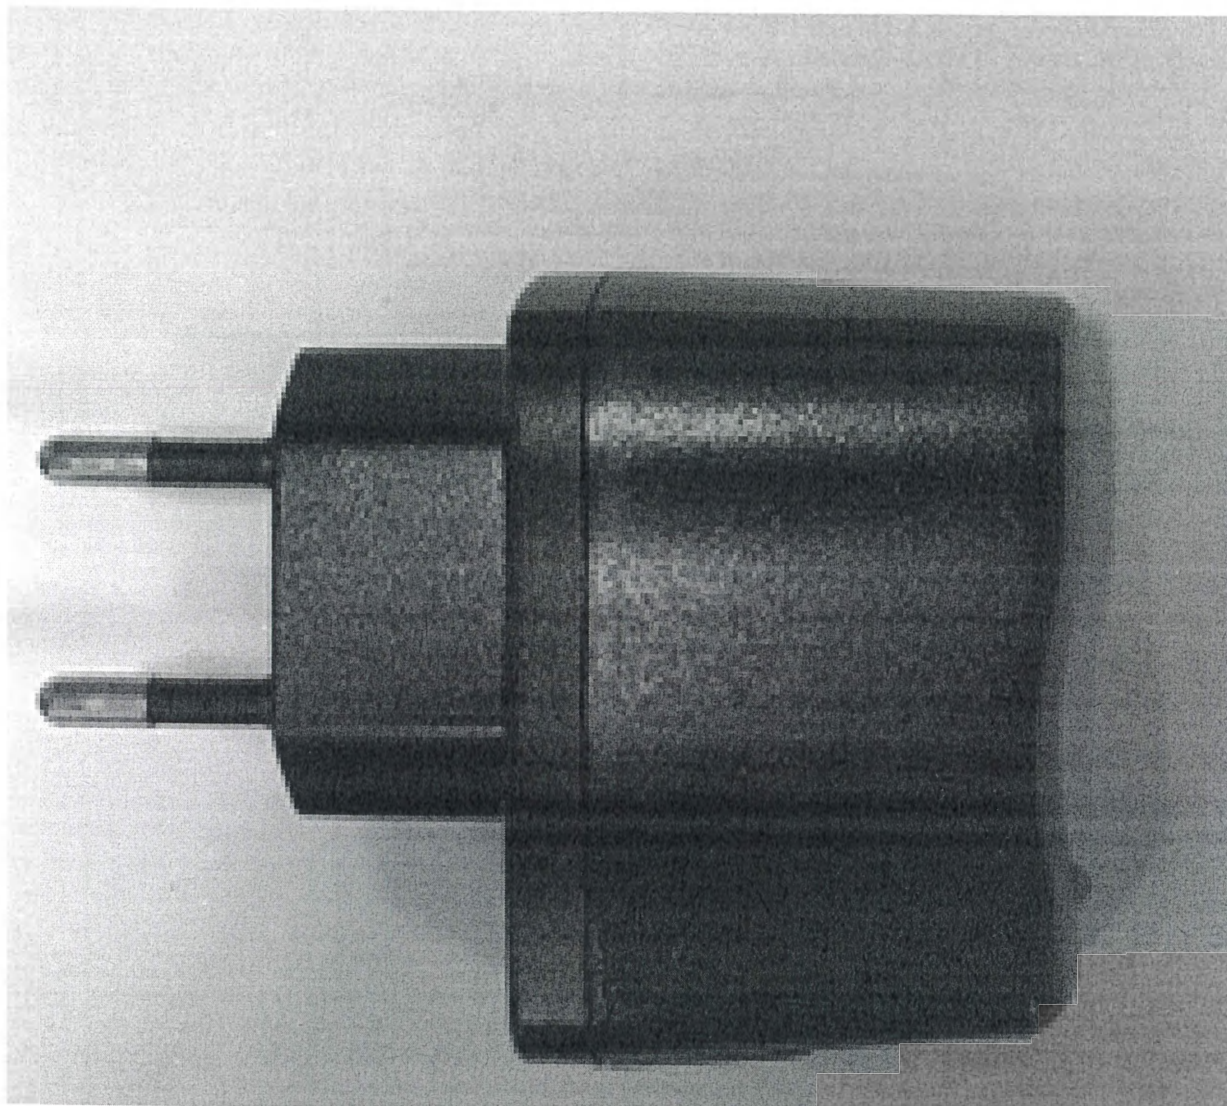


Держатель налобного осветителя.

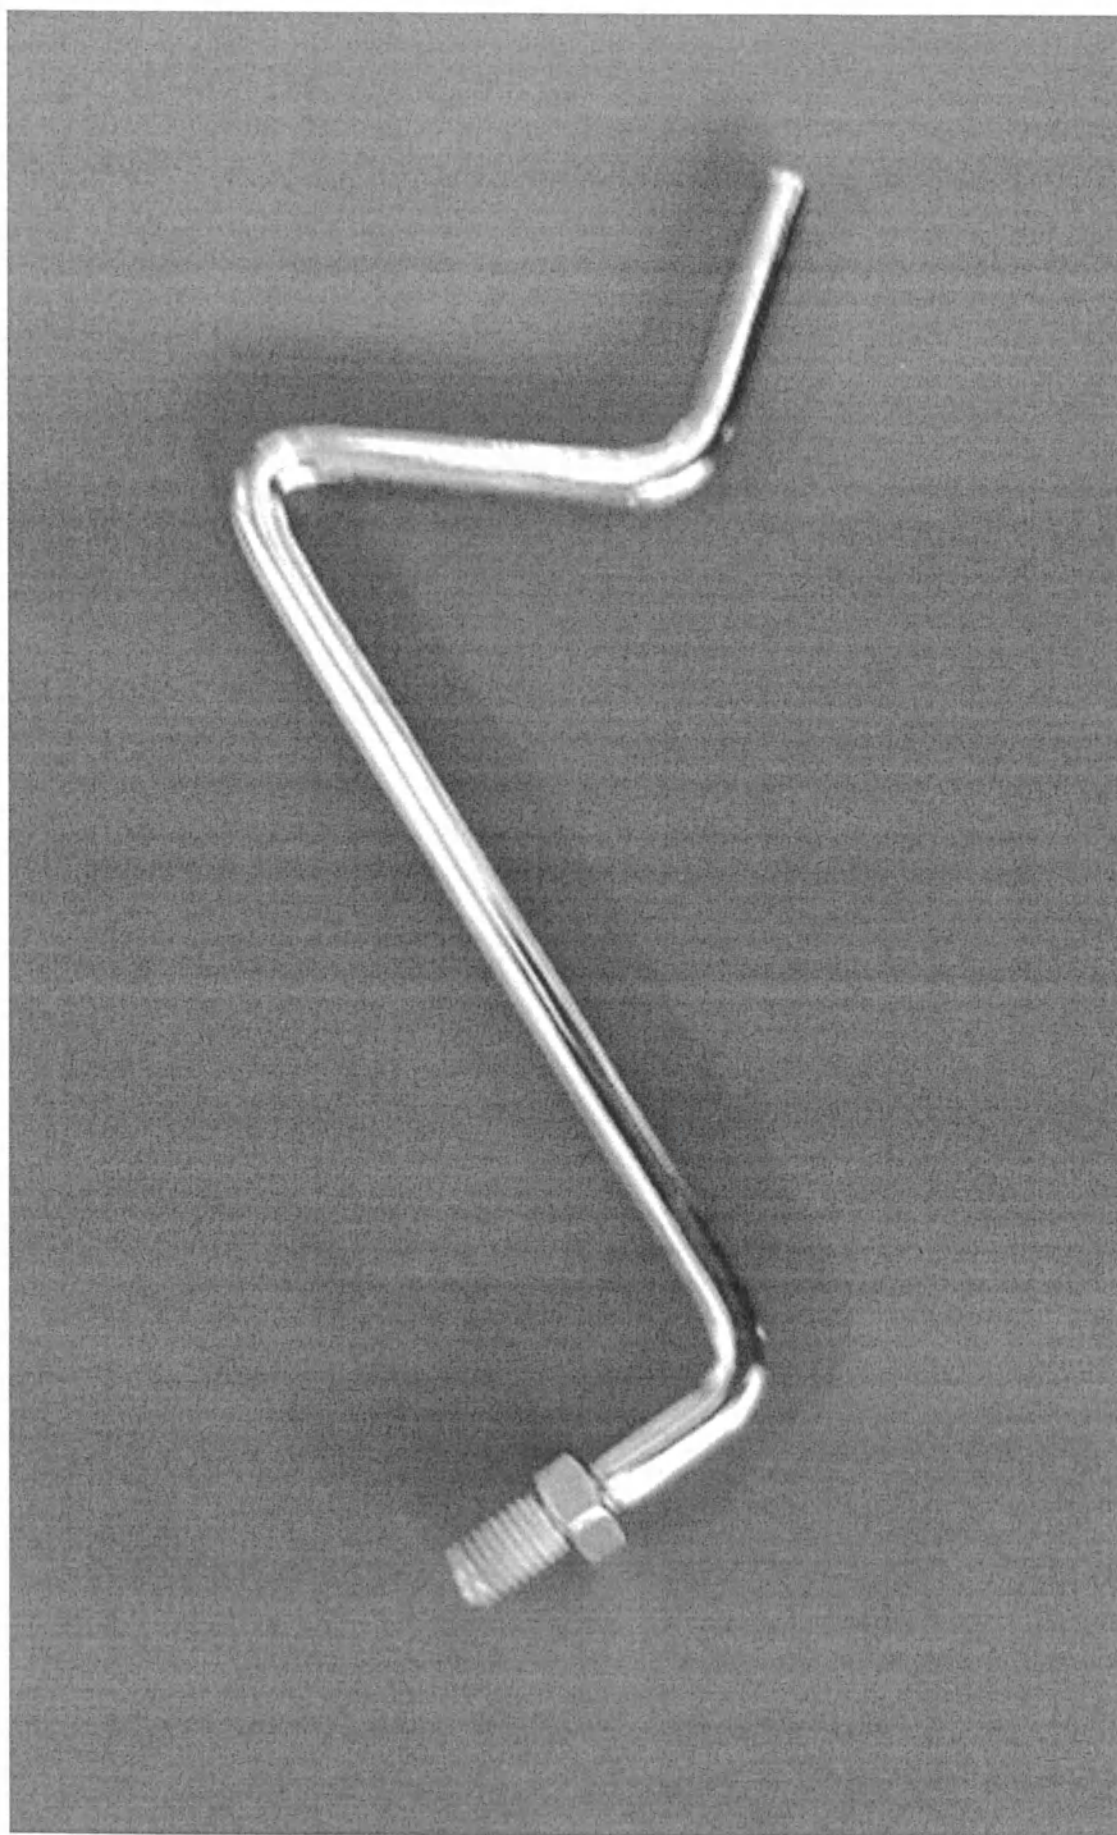

Блок промывания уха.




Тюльпан для промывания уха.

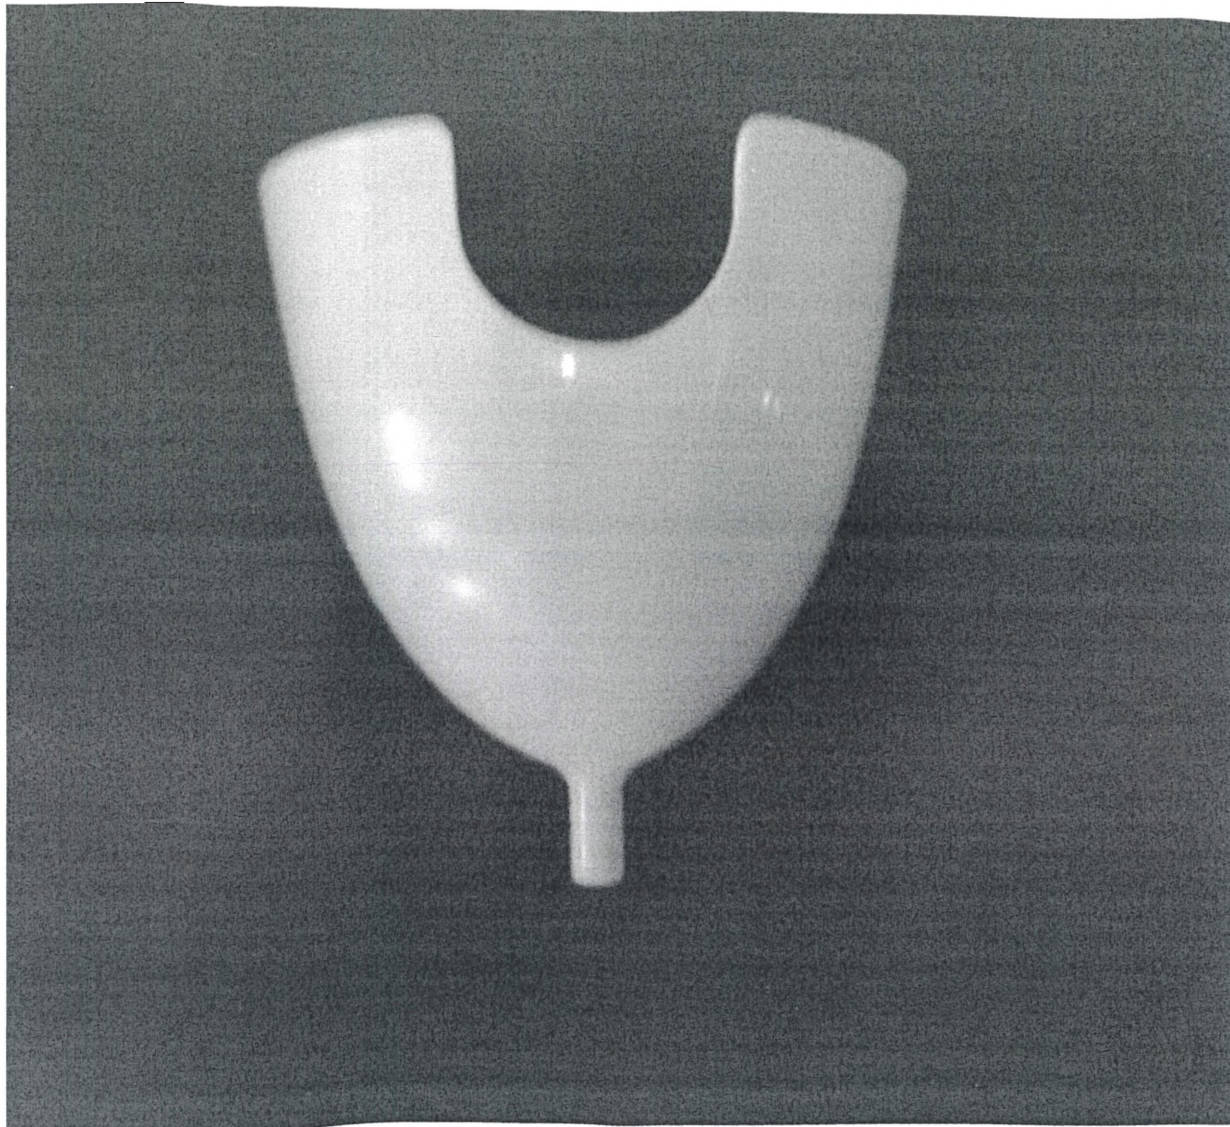


Шланг для тюльпана для промывки уха



Кронштейн-держатель тюльпана для промывания уха.

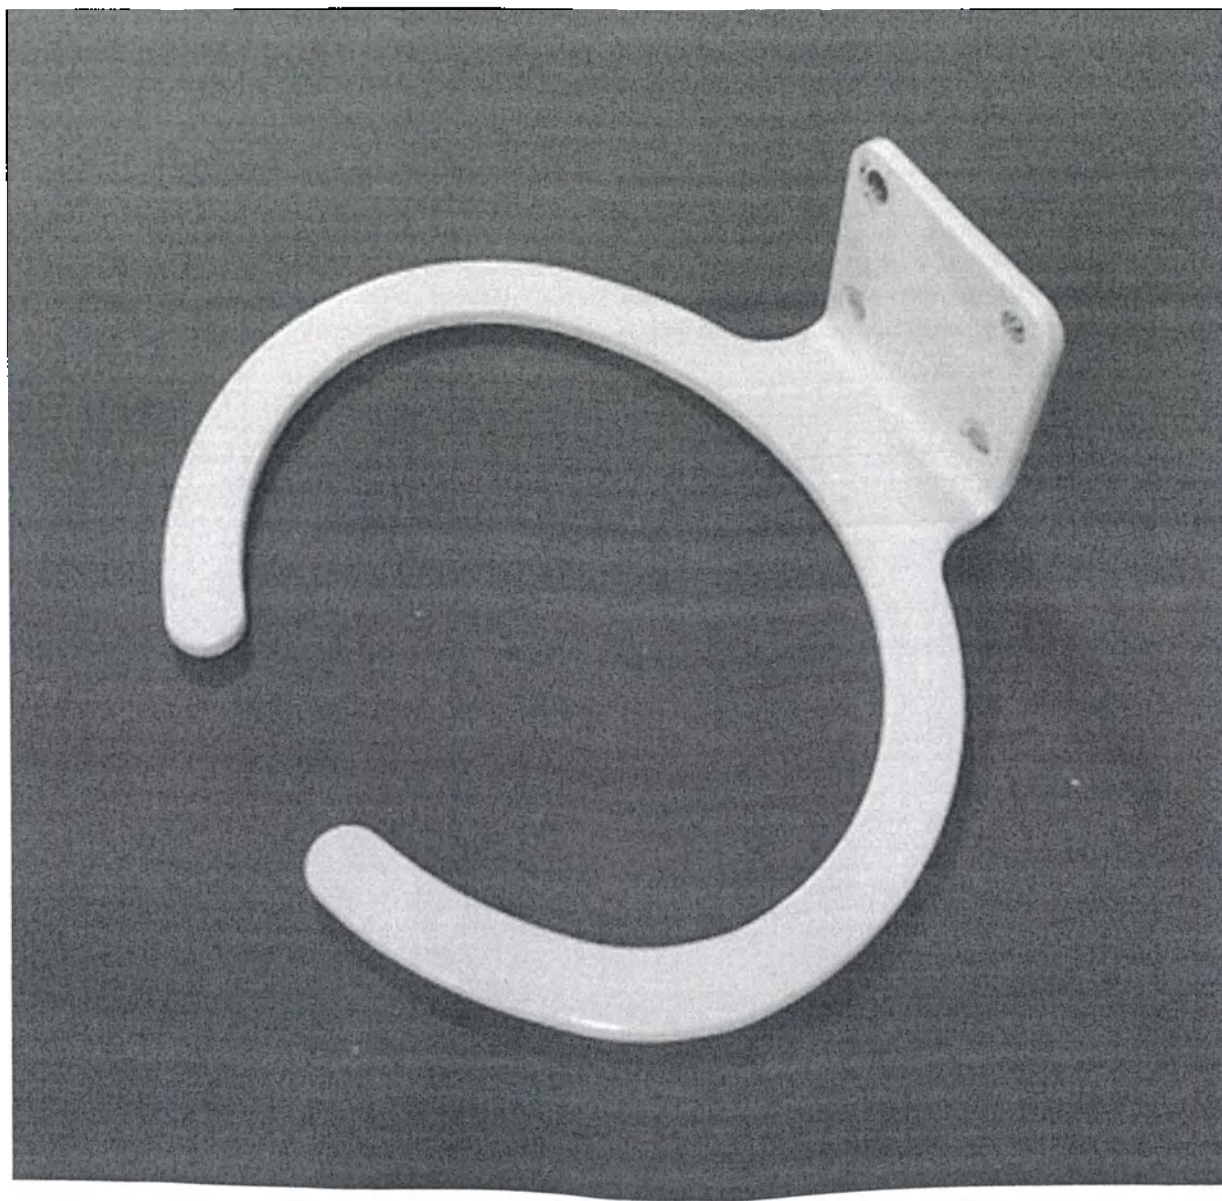


Штуцер для подключения к магистральному водоснабжению

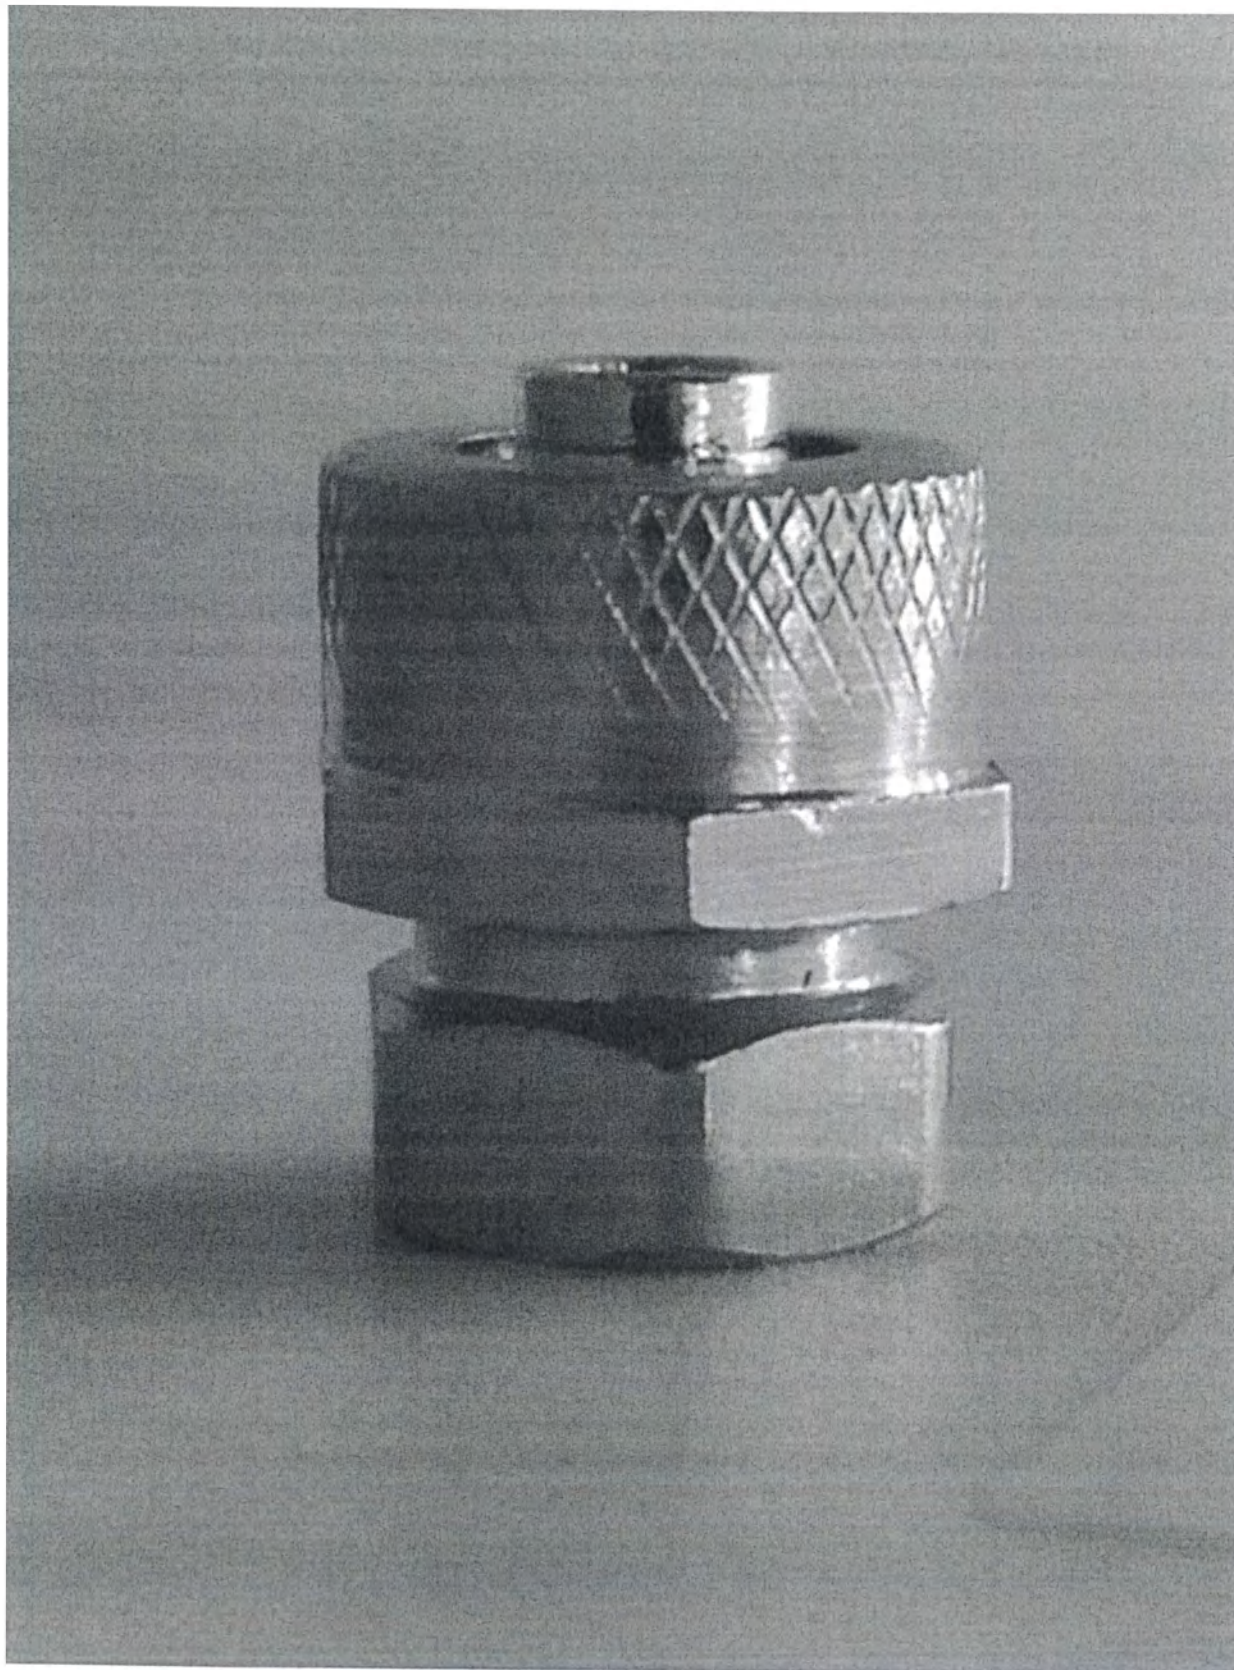


Рукоятка для подачи воды и воздуха.




Изогнутая насадка-сопло рукоятки для подачи воды и воздуха.

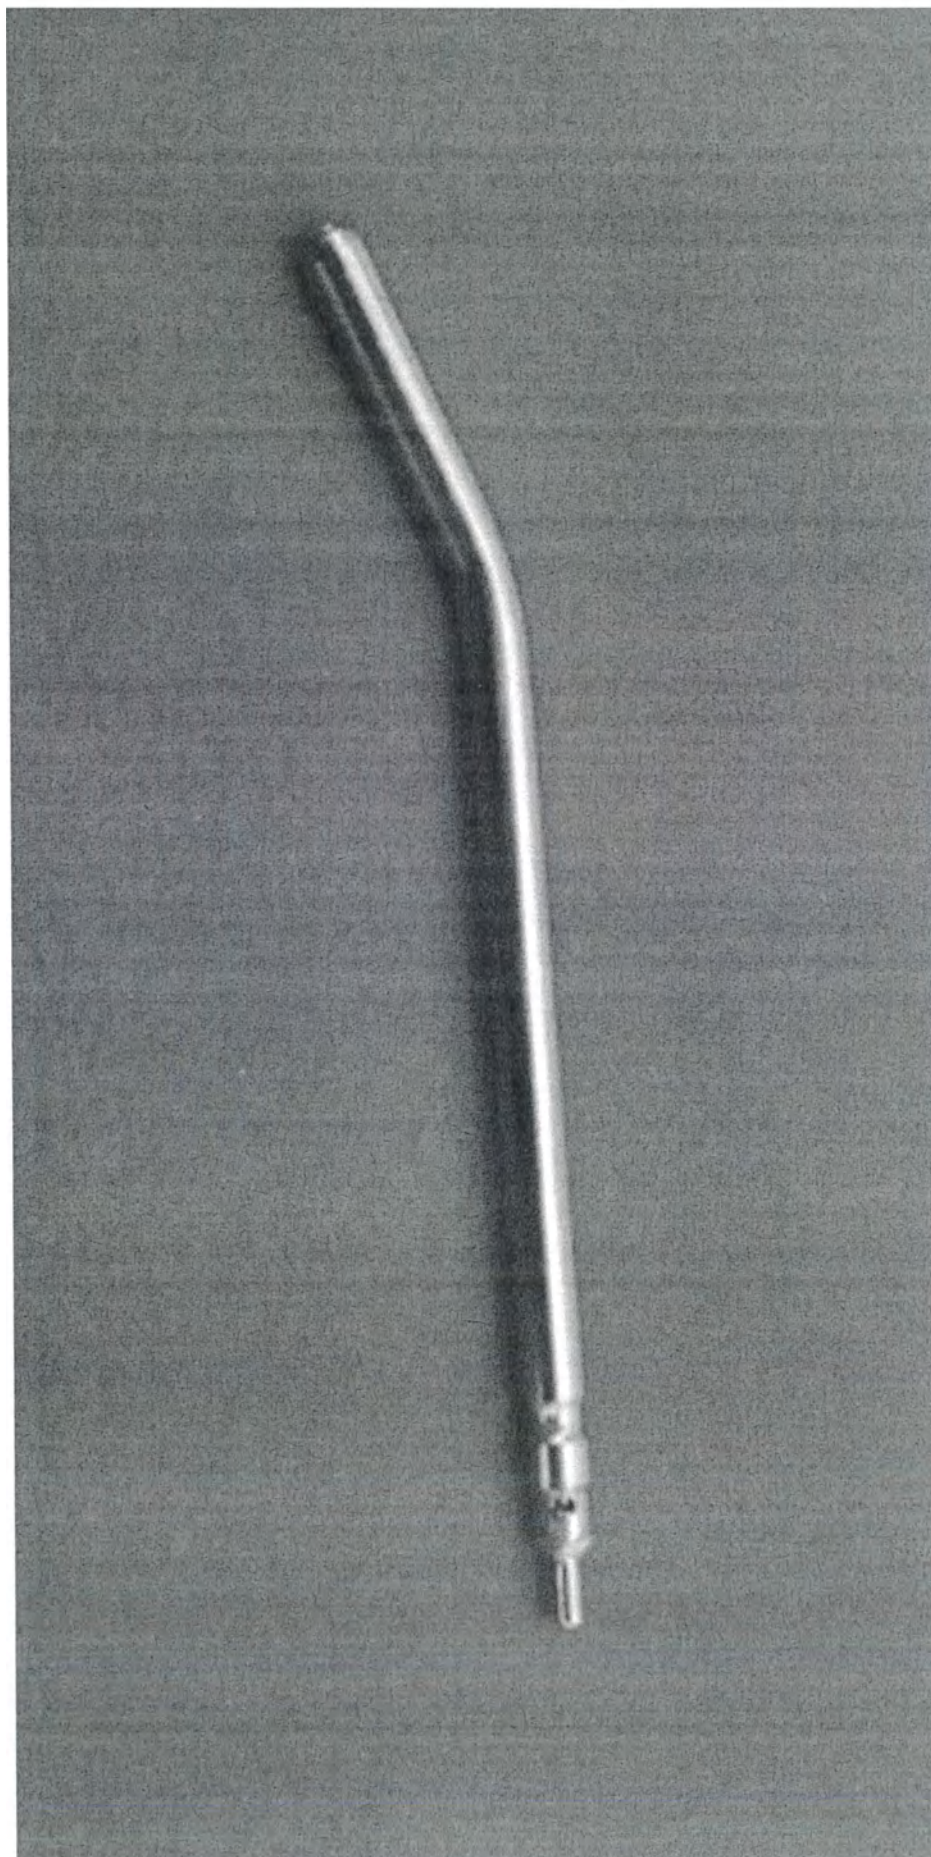


Прямая насадка-сопло рукоятки для подачи воды и воздуха .

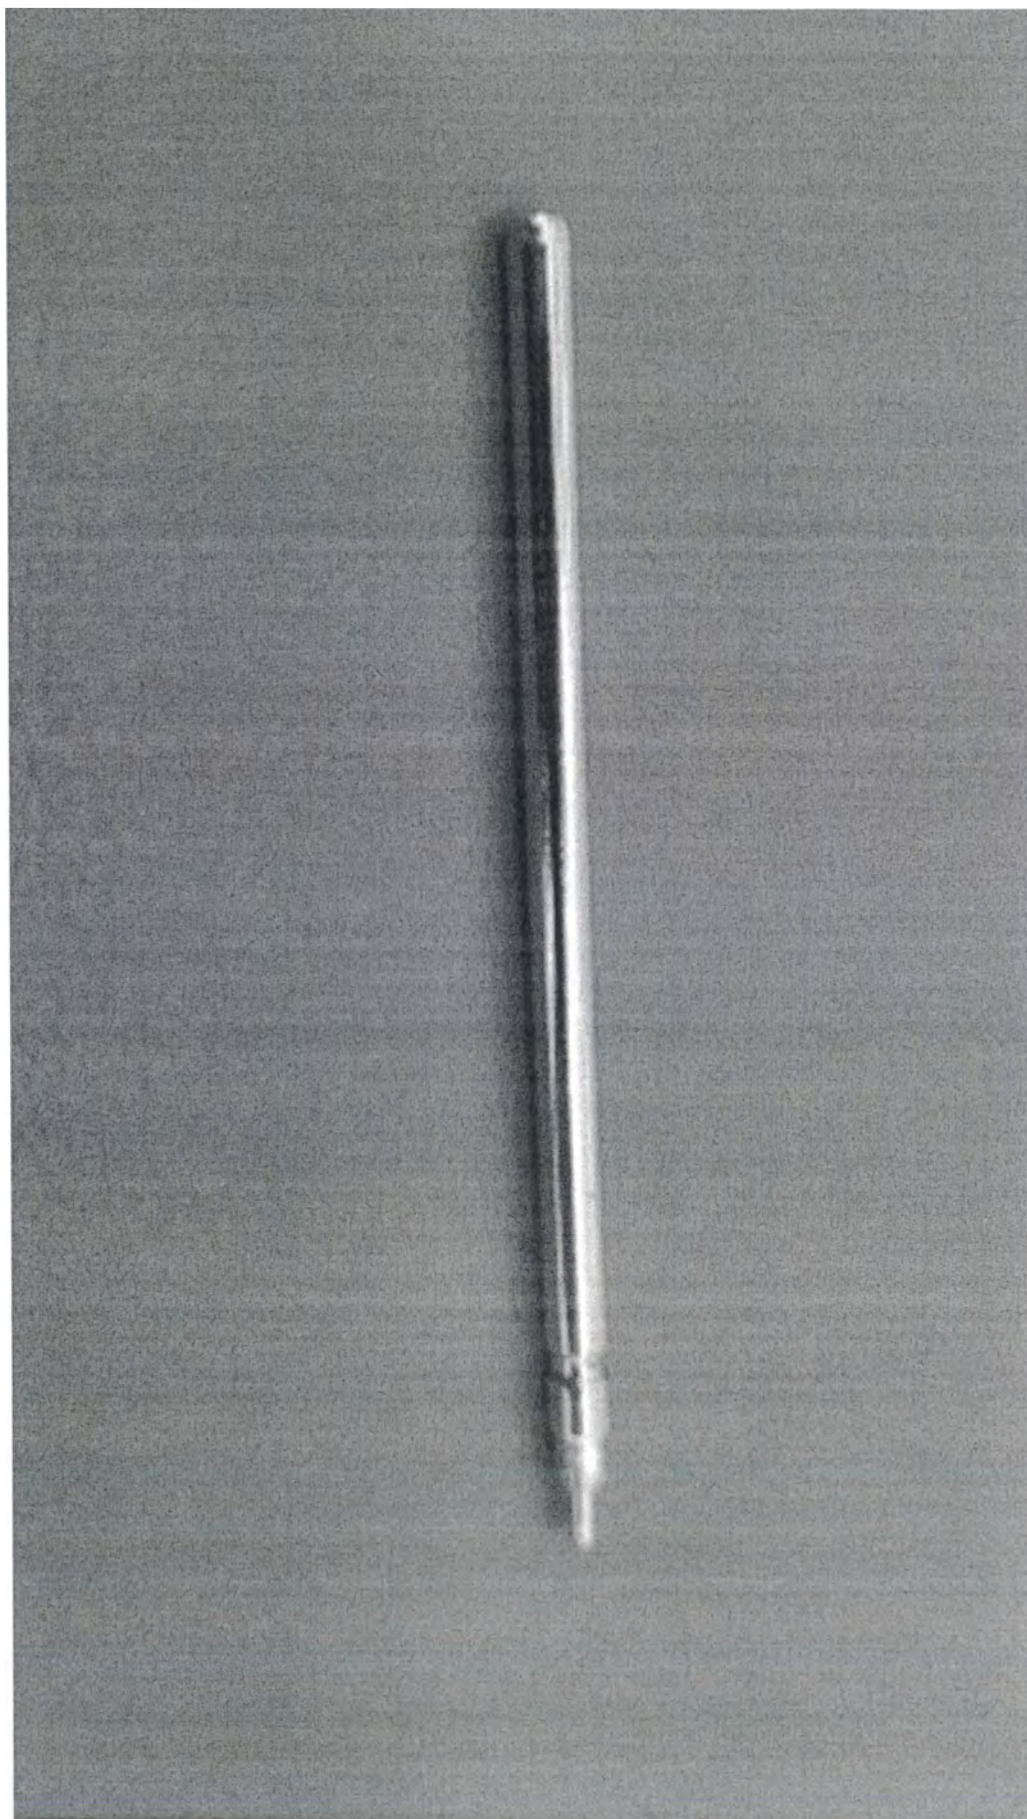


Шланг для подачи воды и воздуха

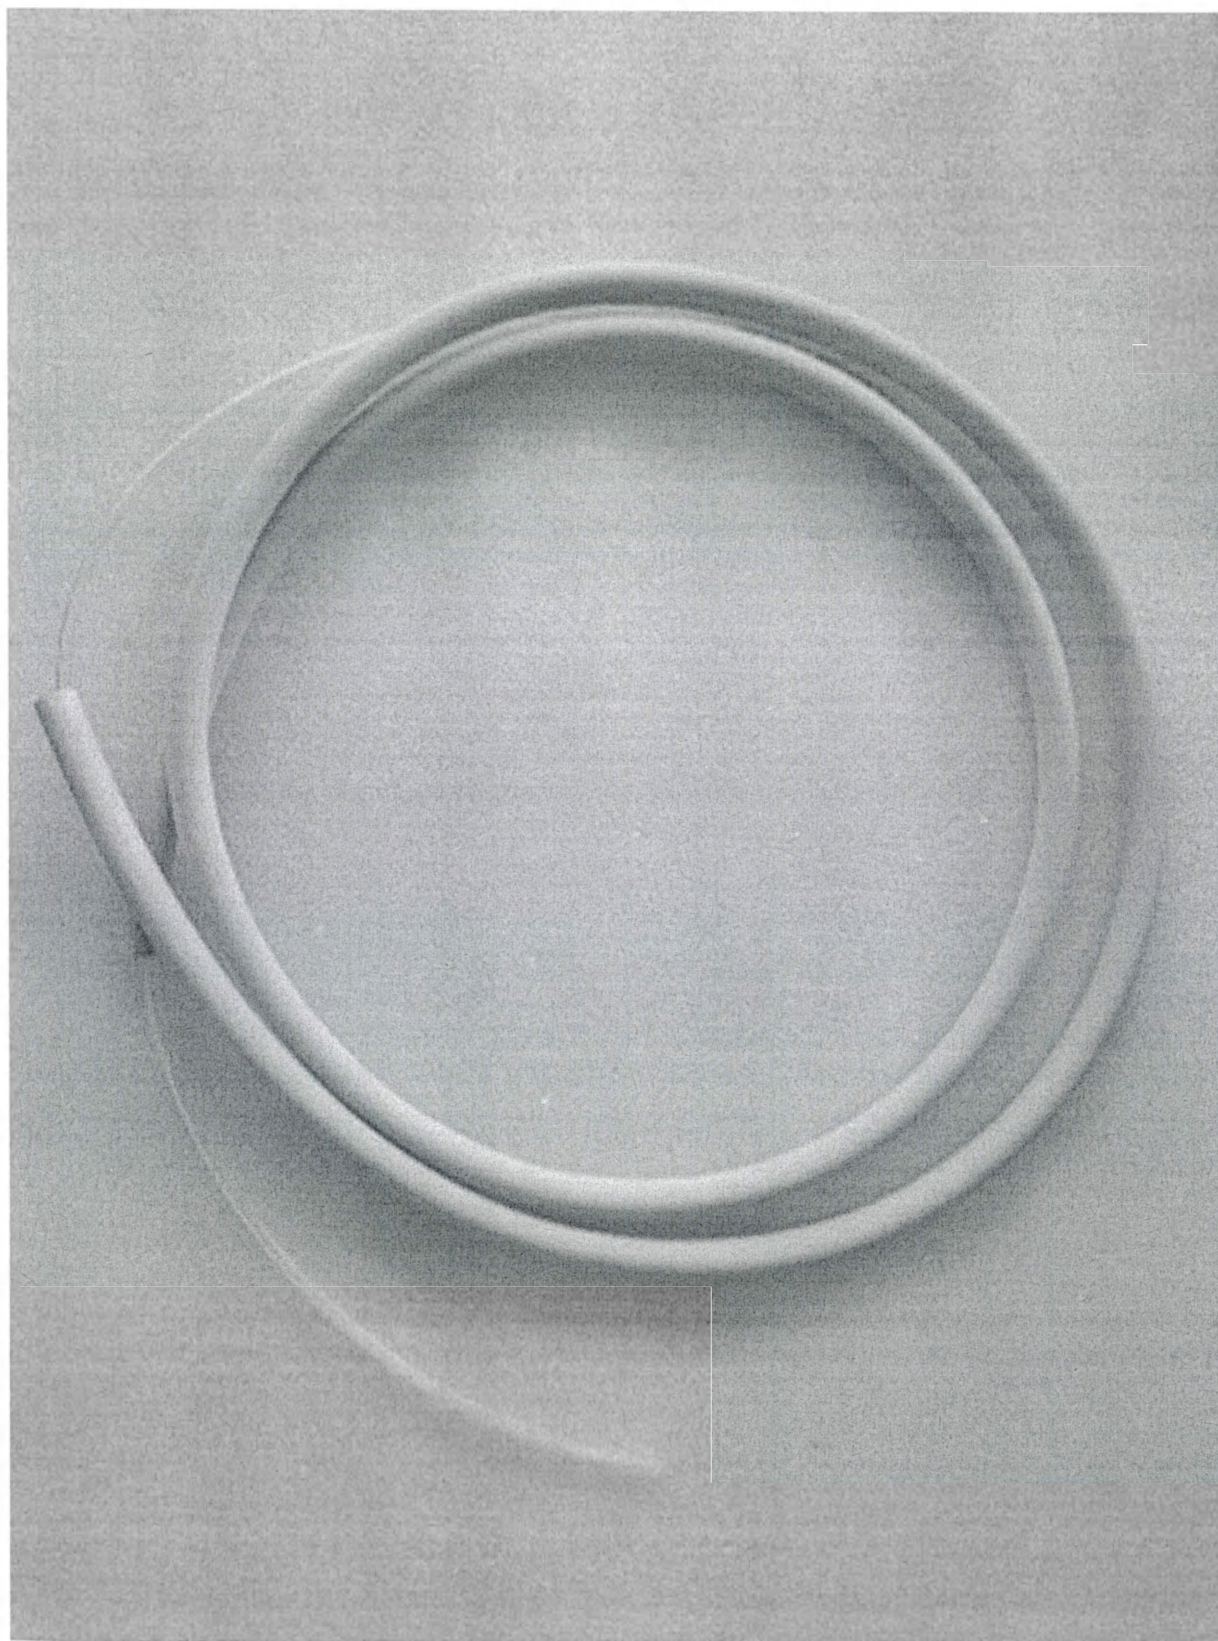


Световод волоконнооптический специальный.

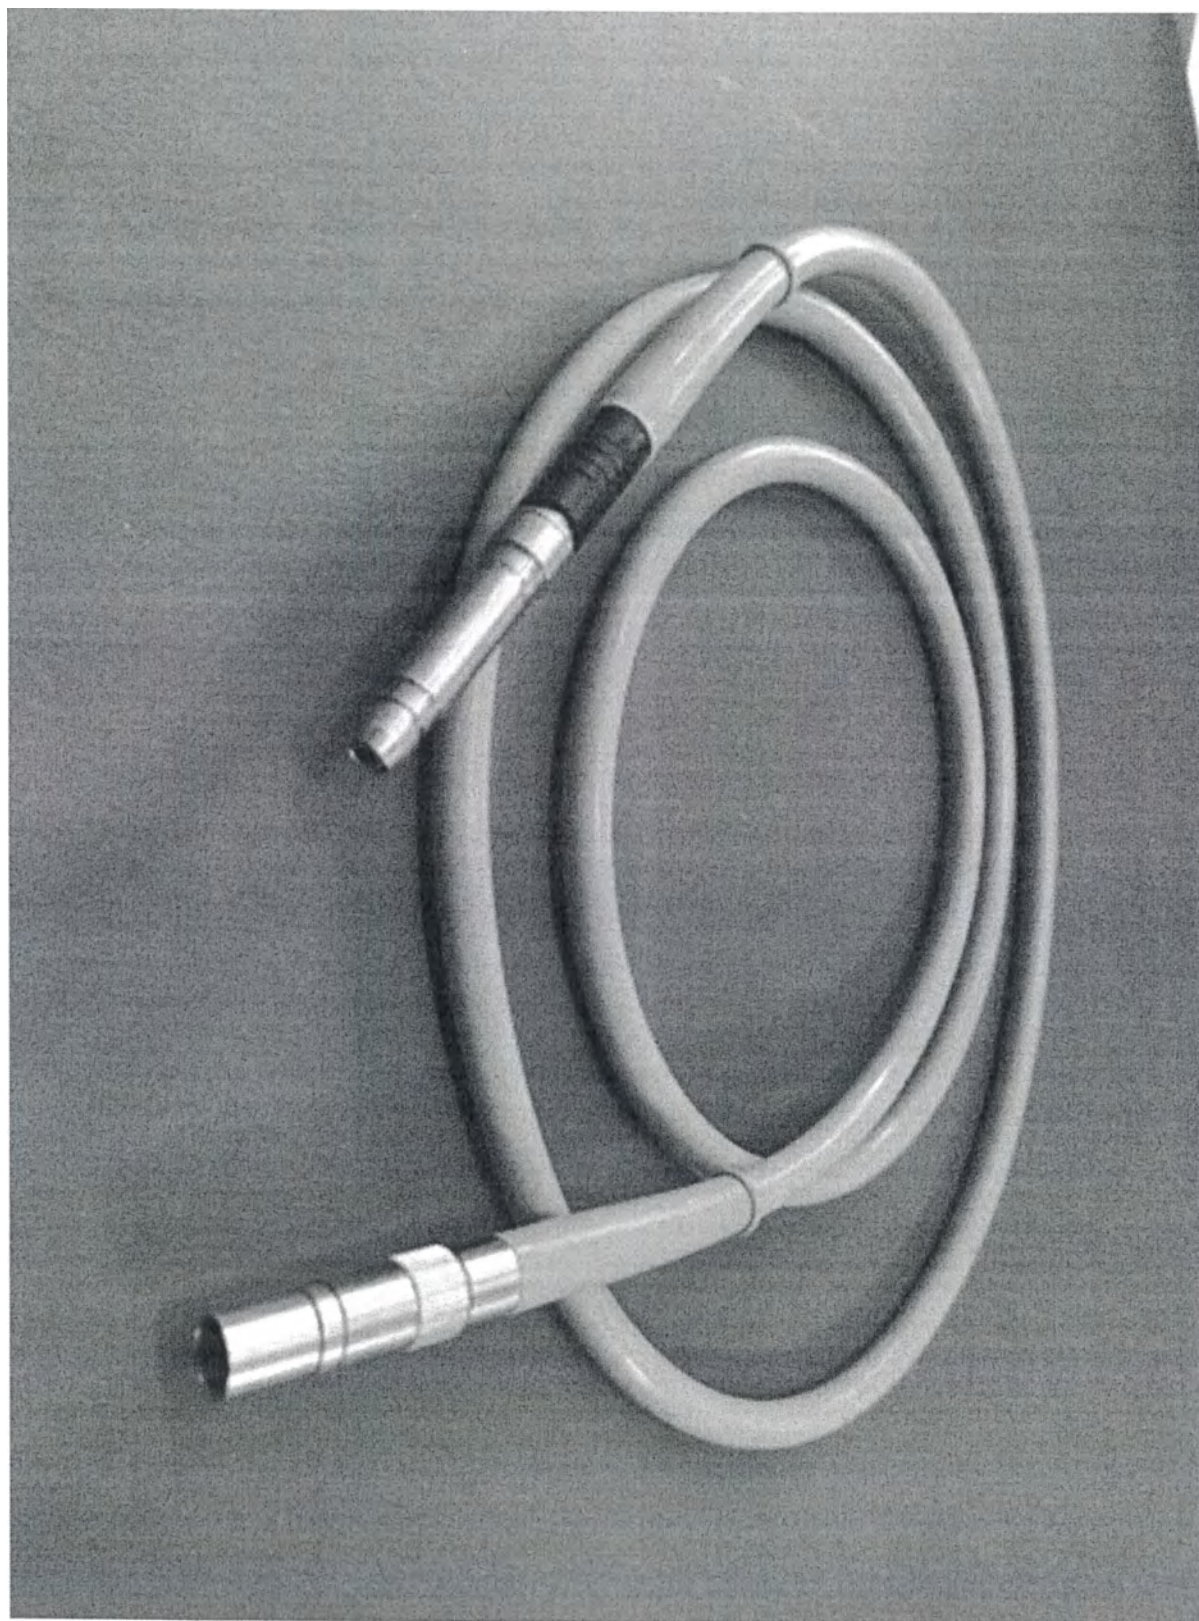


Лоток для сброса использованных инструментов.

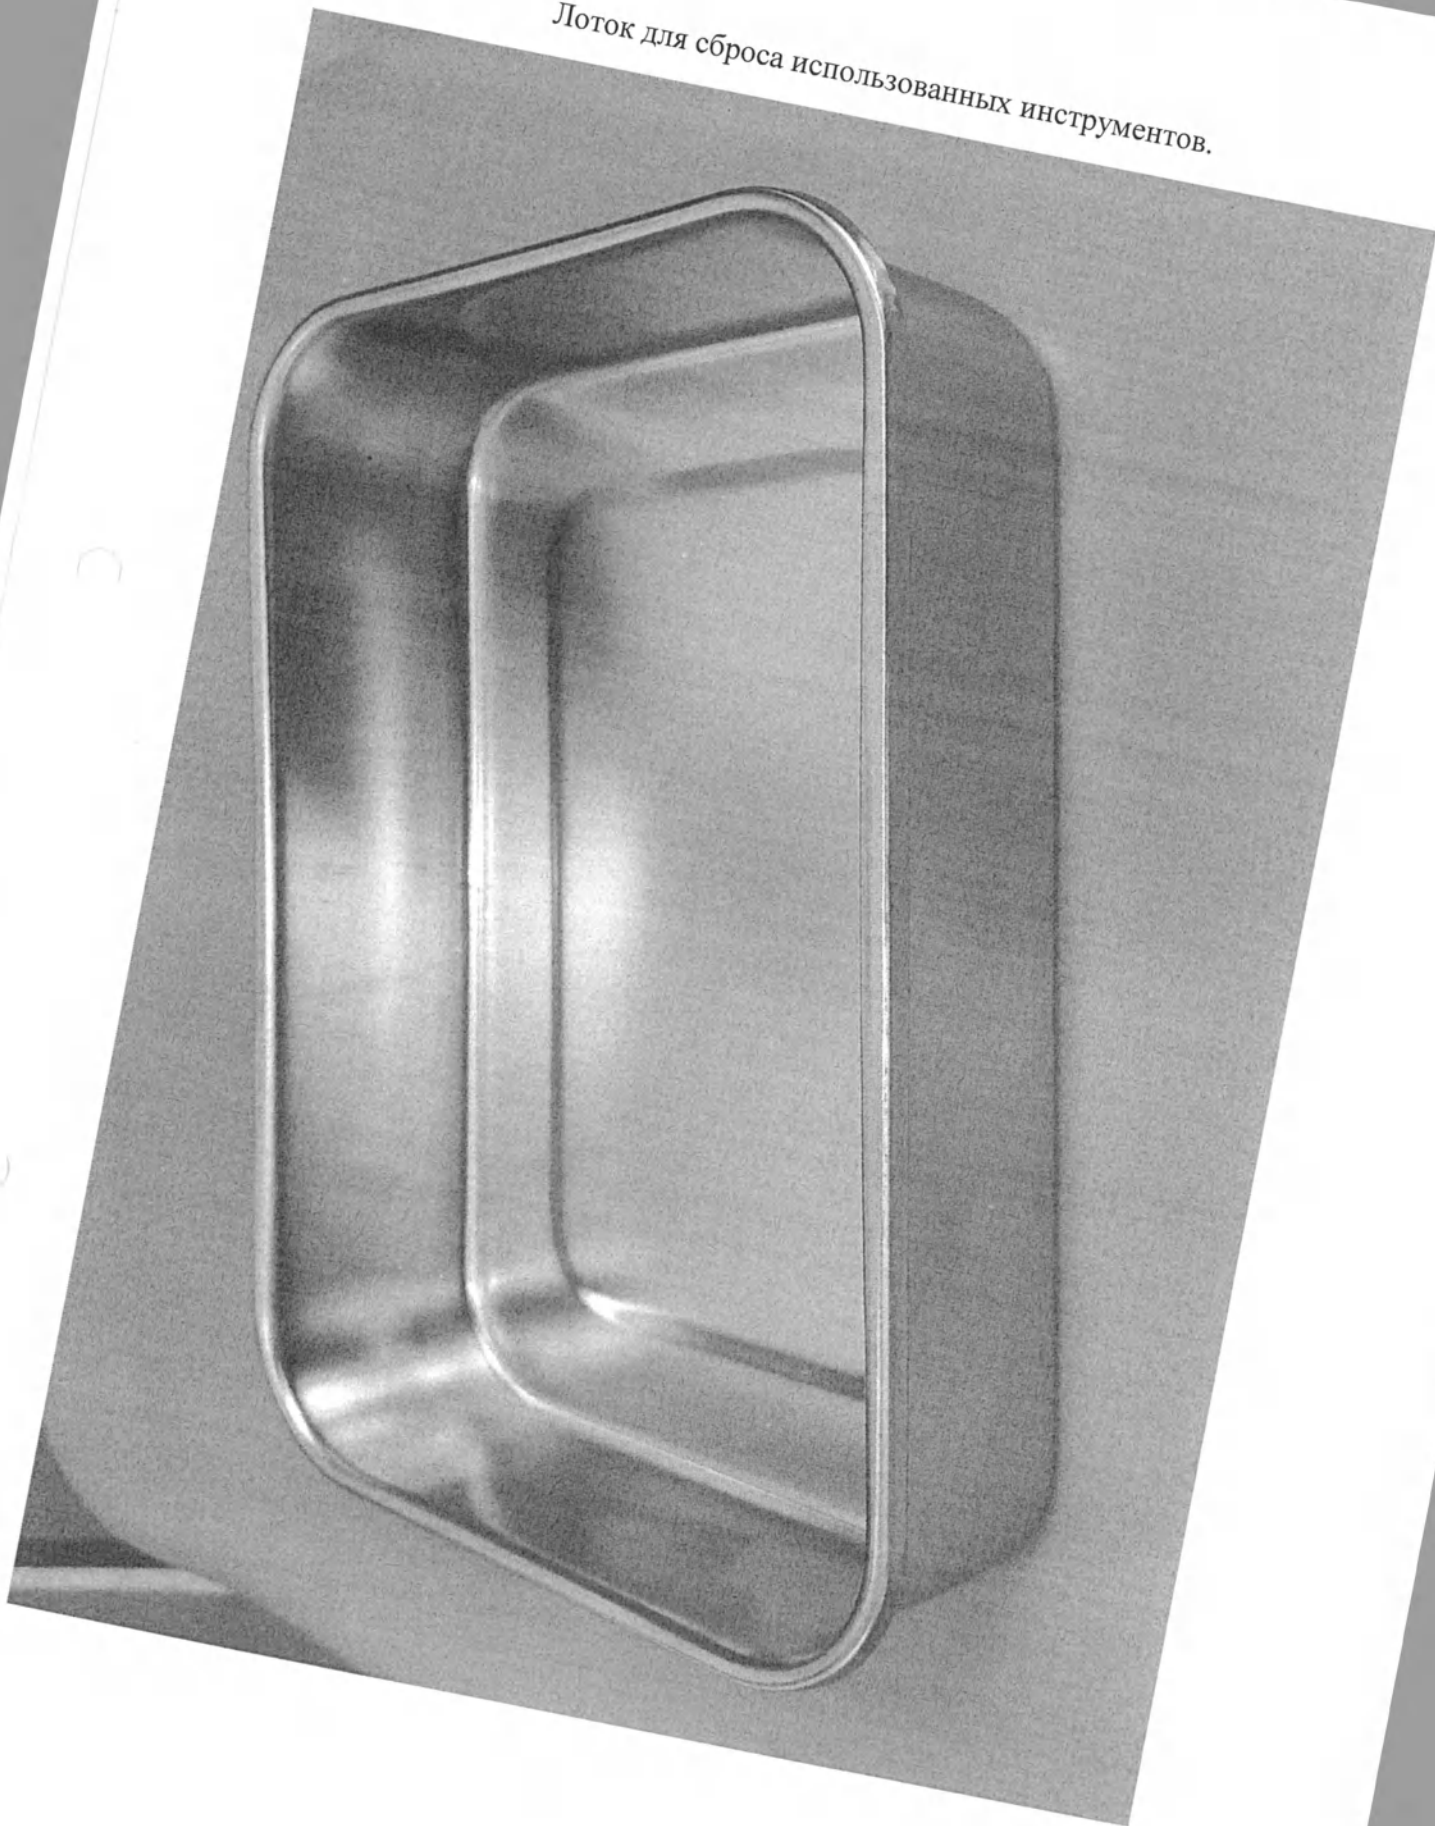


Емкость для сброса отходов.

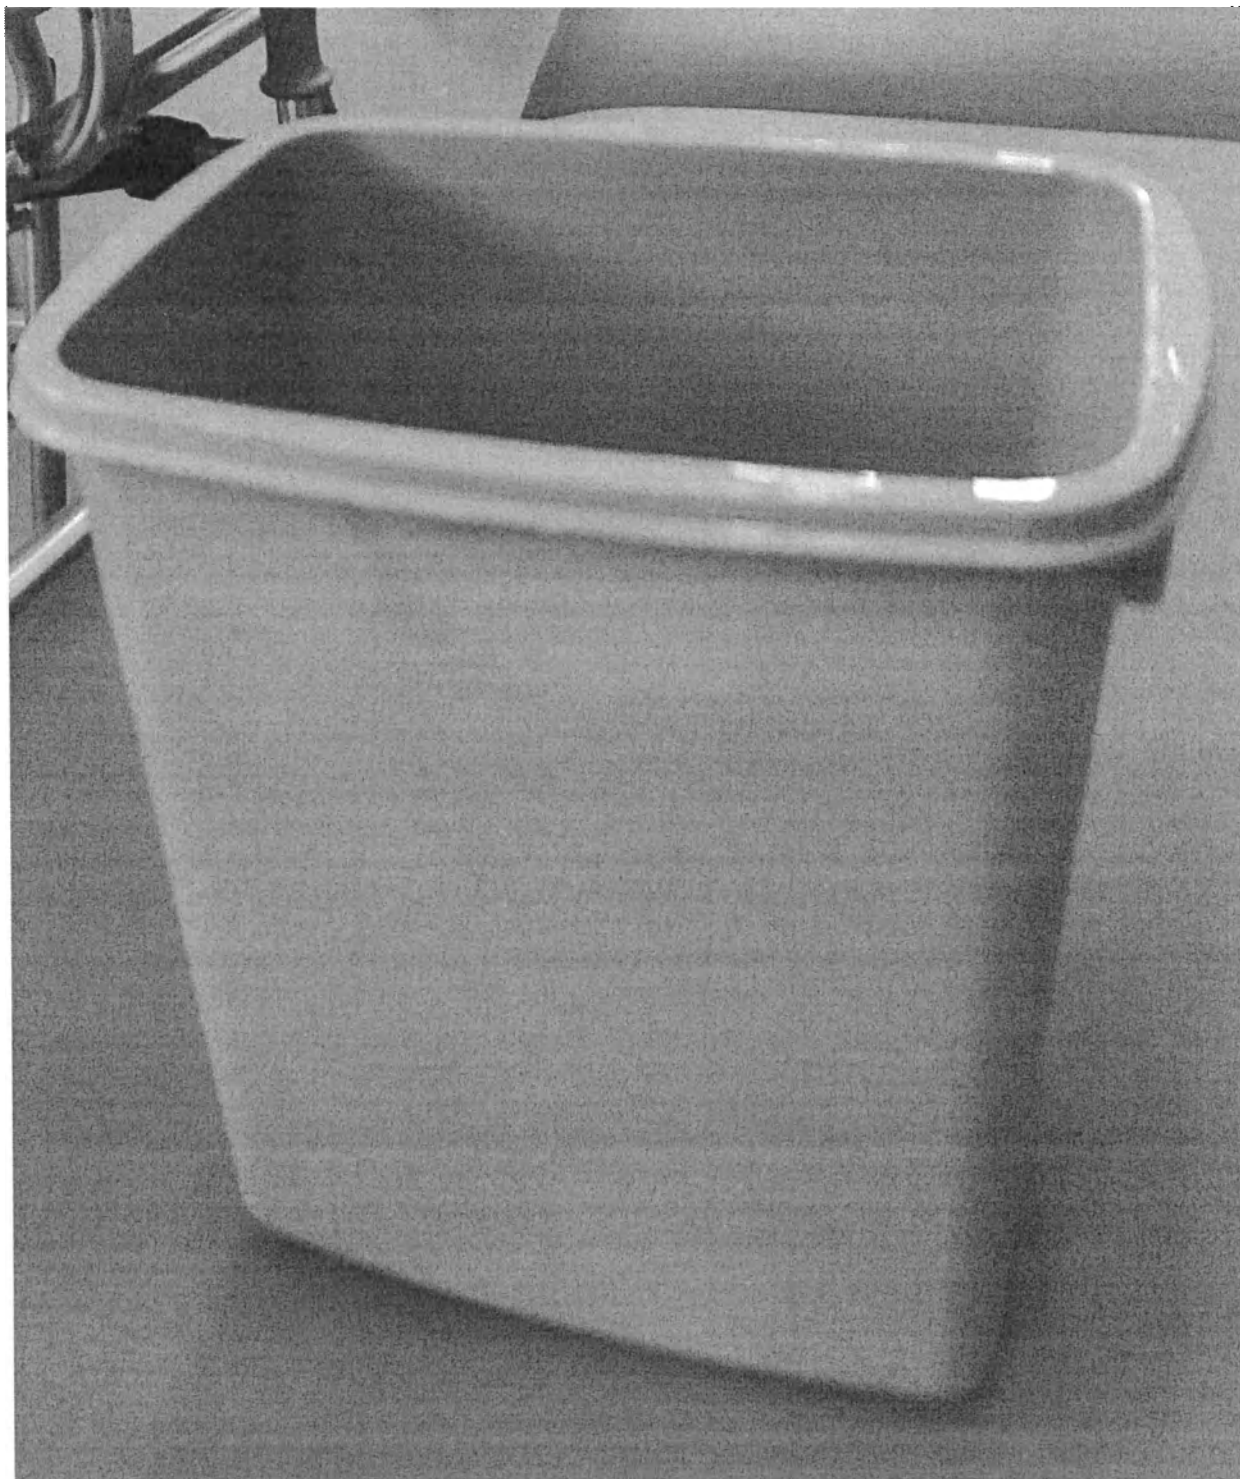


Жесткий ЛОР-эндоскоп-синускоп специальный.

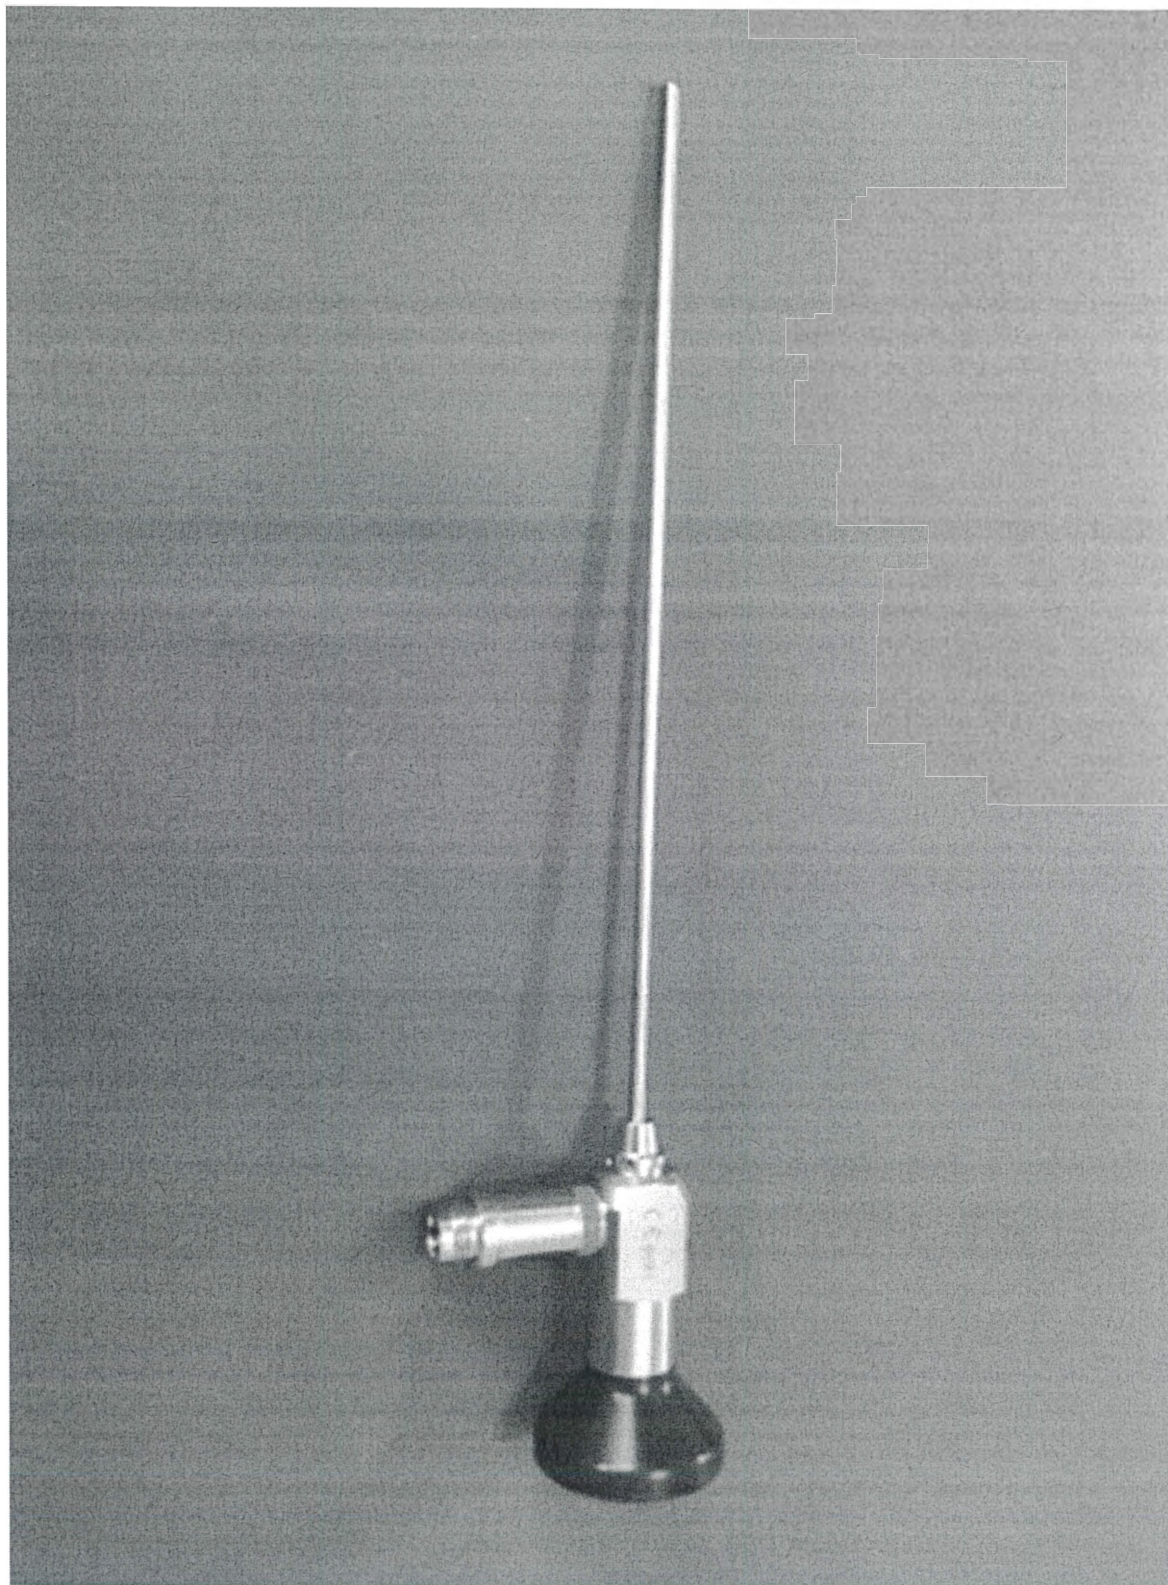


Жесткий ЛОР-эндоскоп-отоскоп специальный.

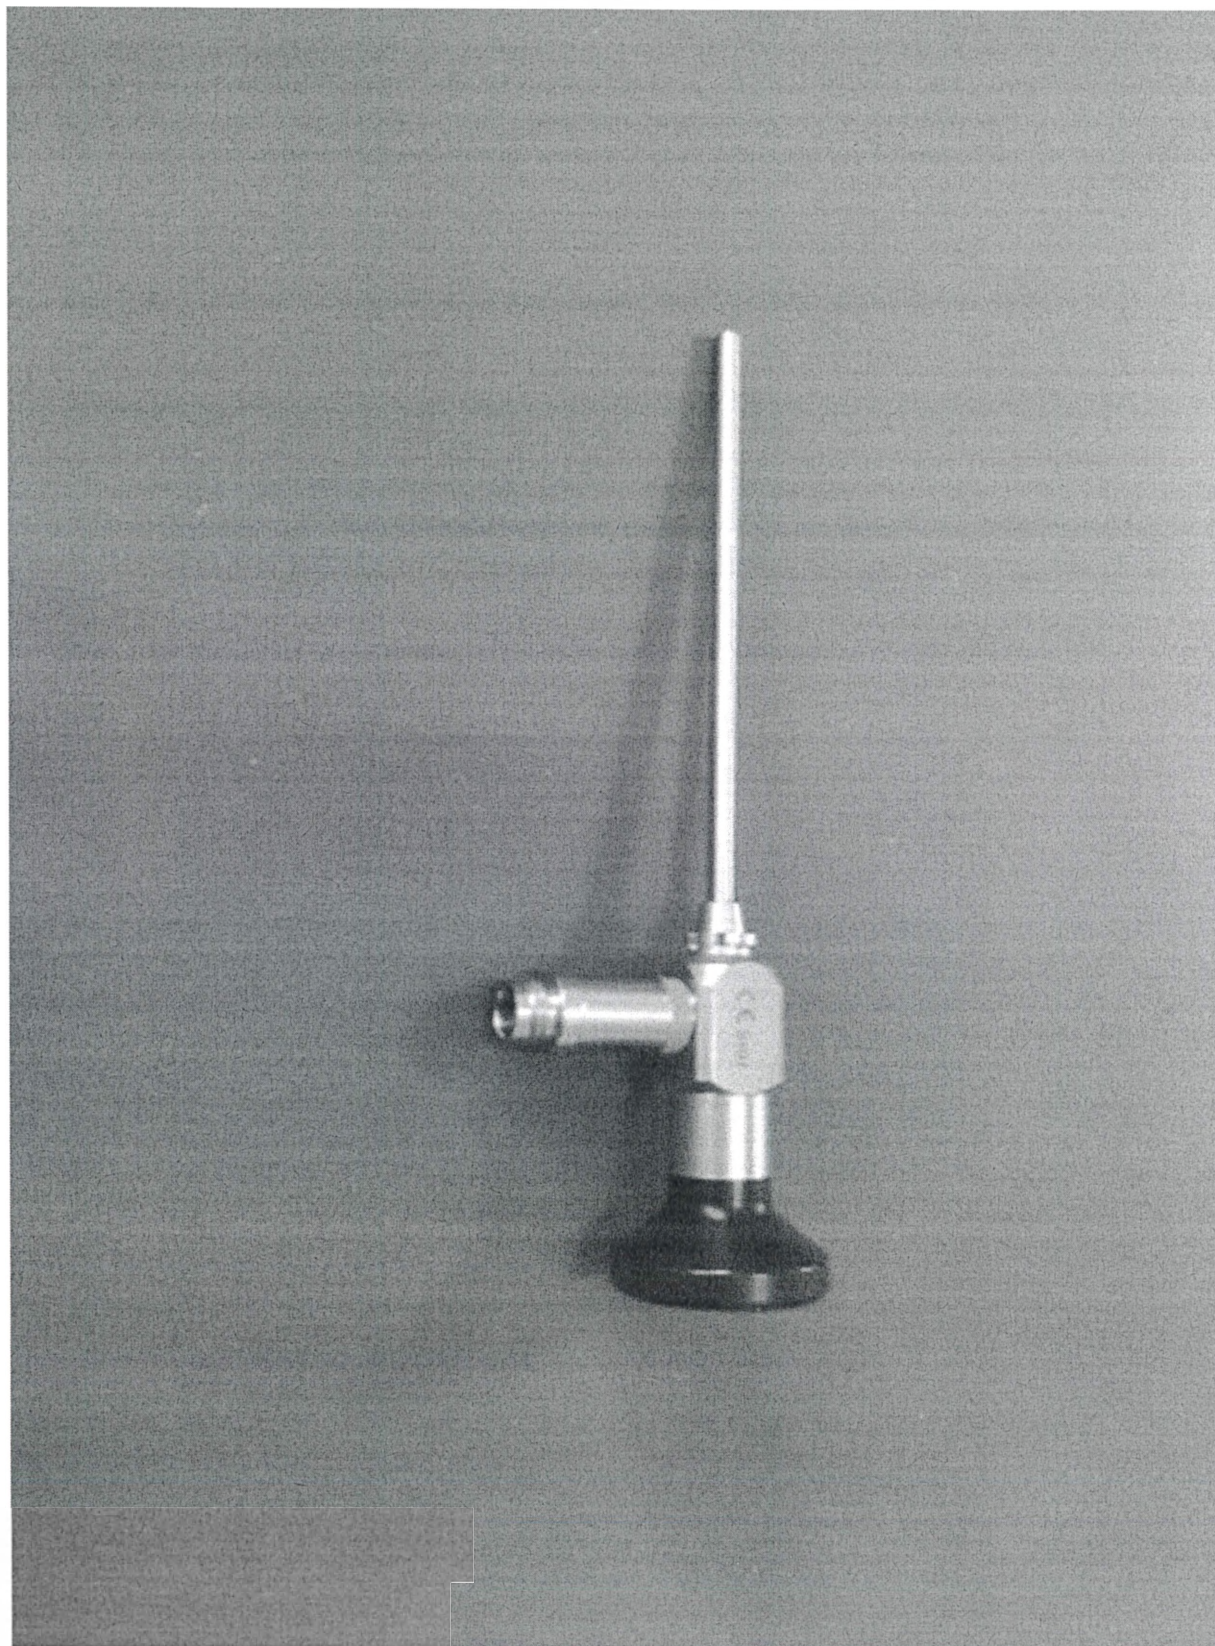


Жесткий ЛОР-эндоскоп-ларингоскоп специальный.

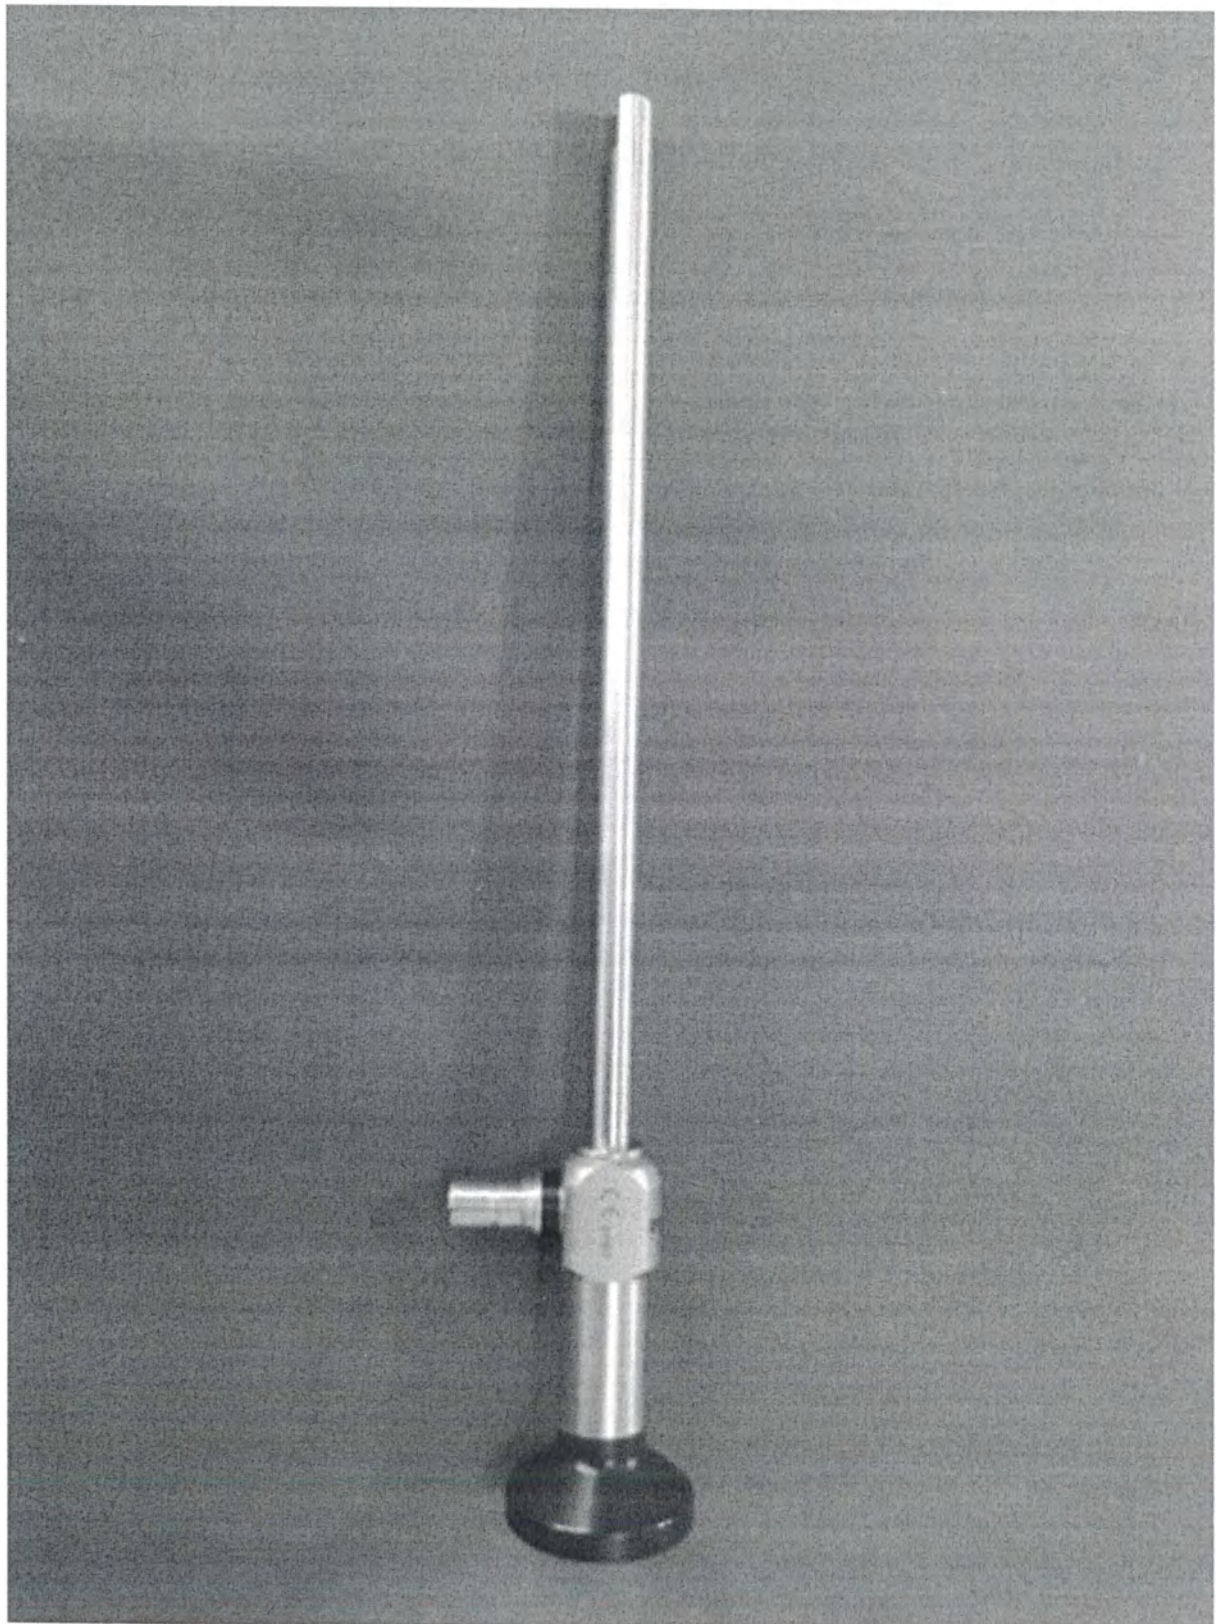

Инструментальная поверхность из стекла (черная).

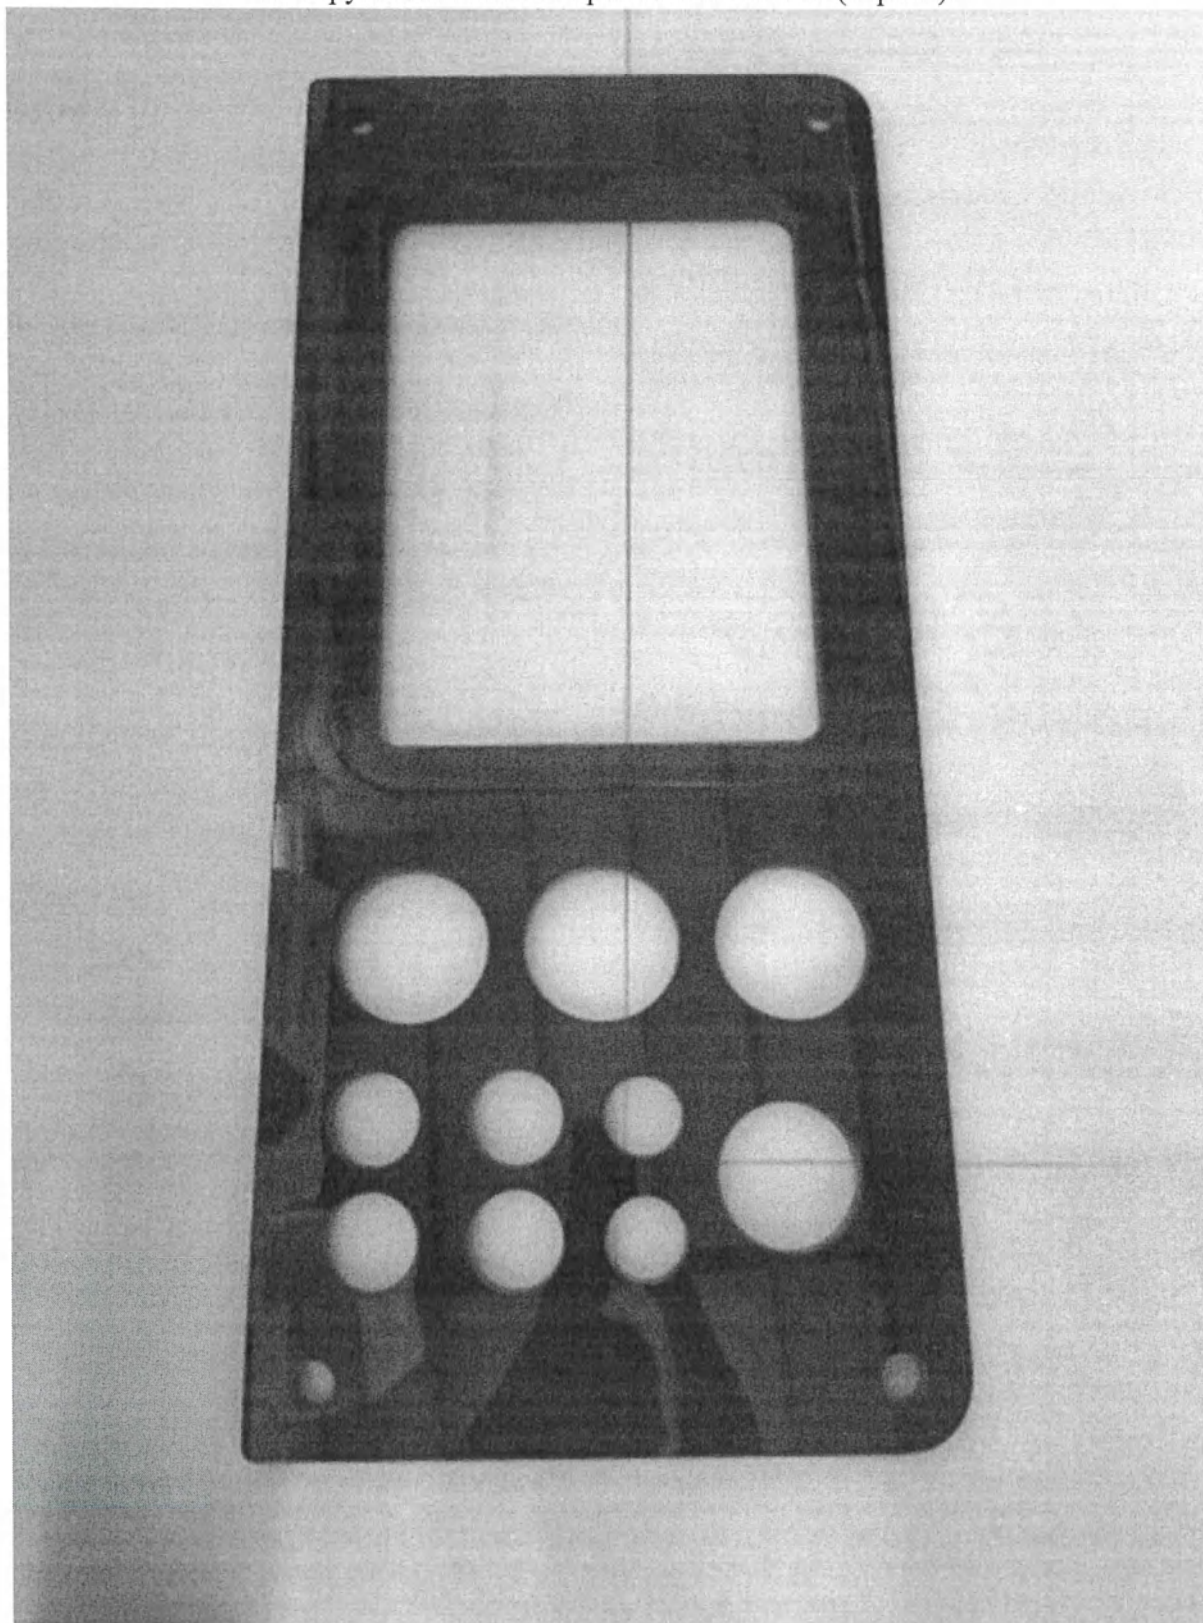


Вспомогательная поверхность из стекла (черная)

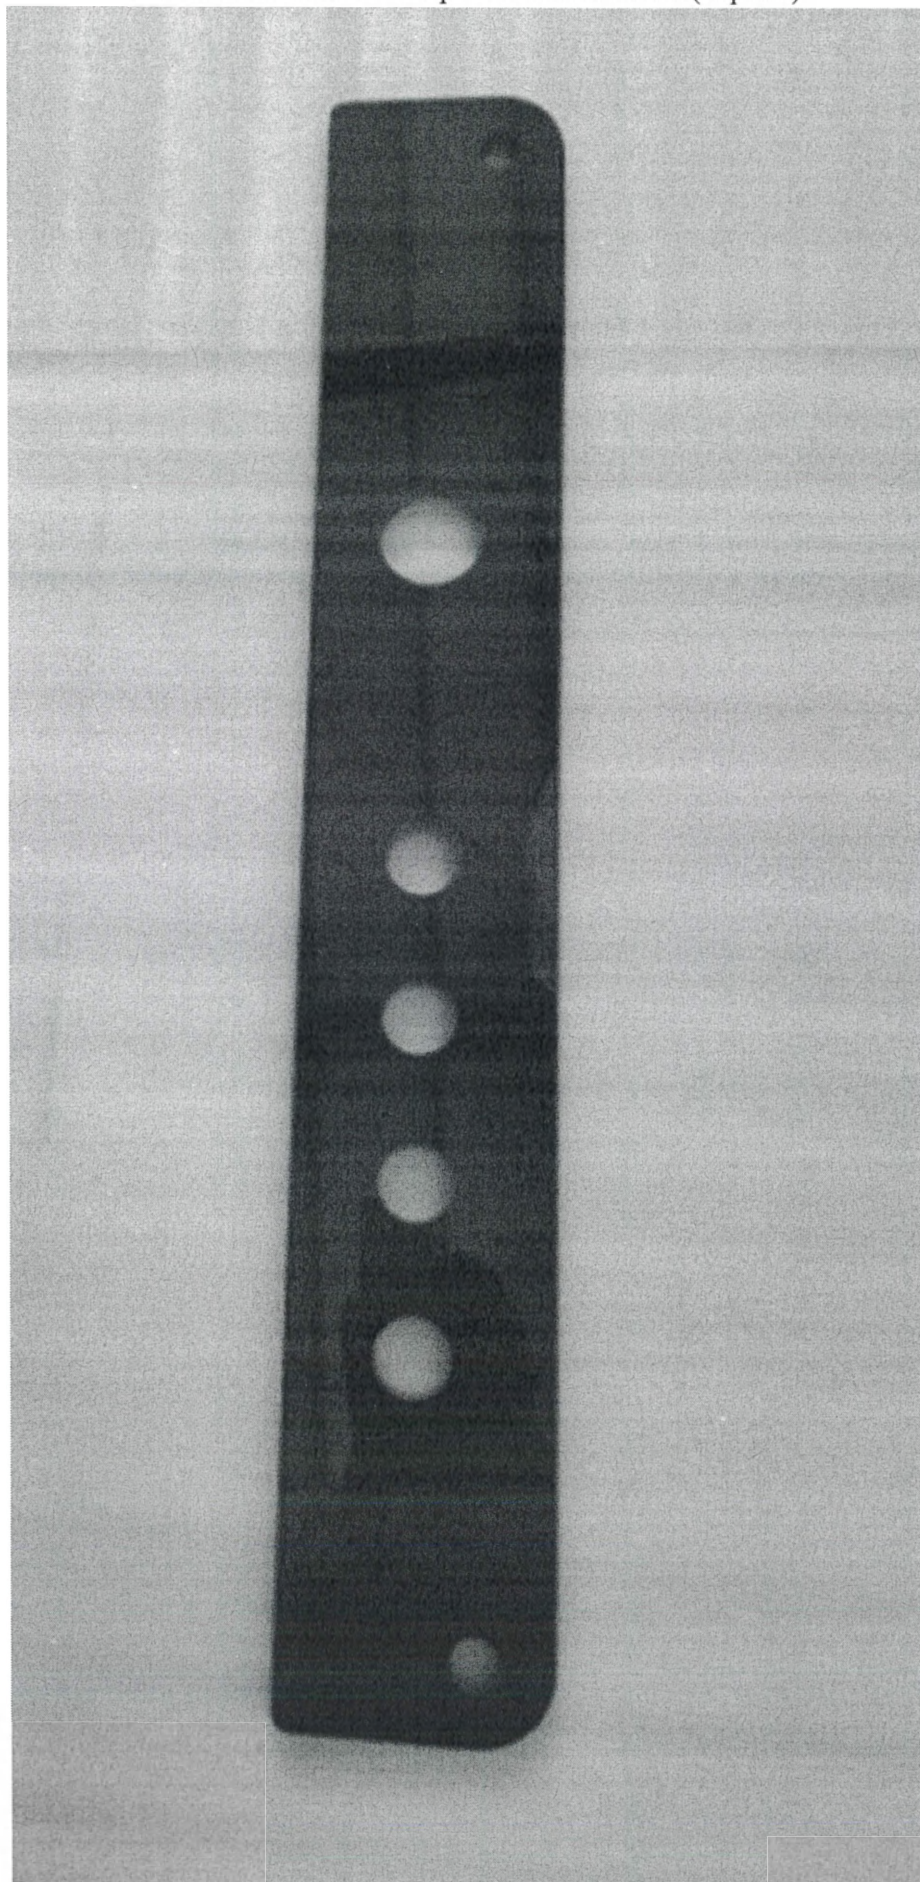


Инструментальная поверхность дополнительная из стекла (черная)




Инструментальная поверхность из стекла (белая).

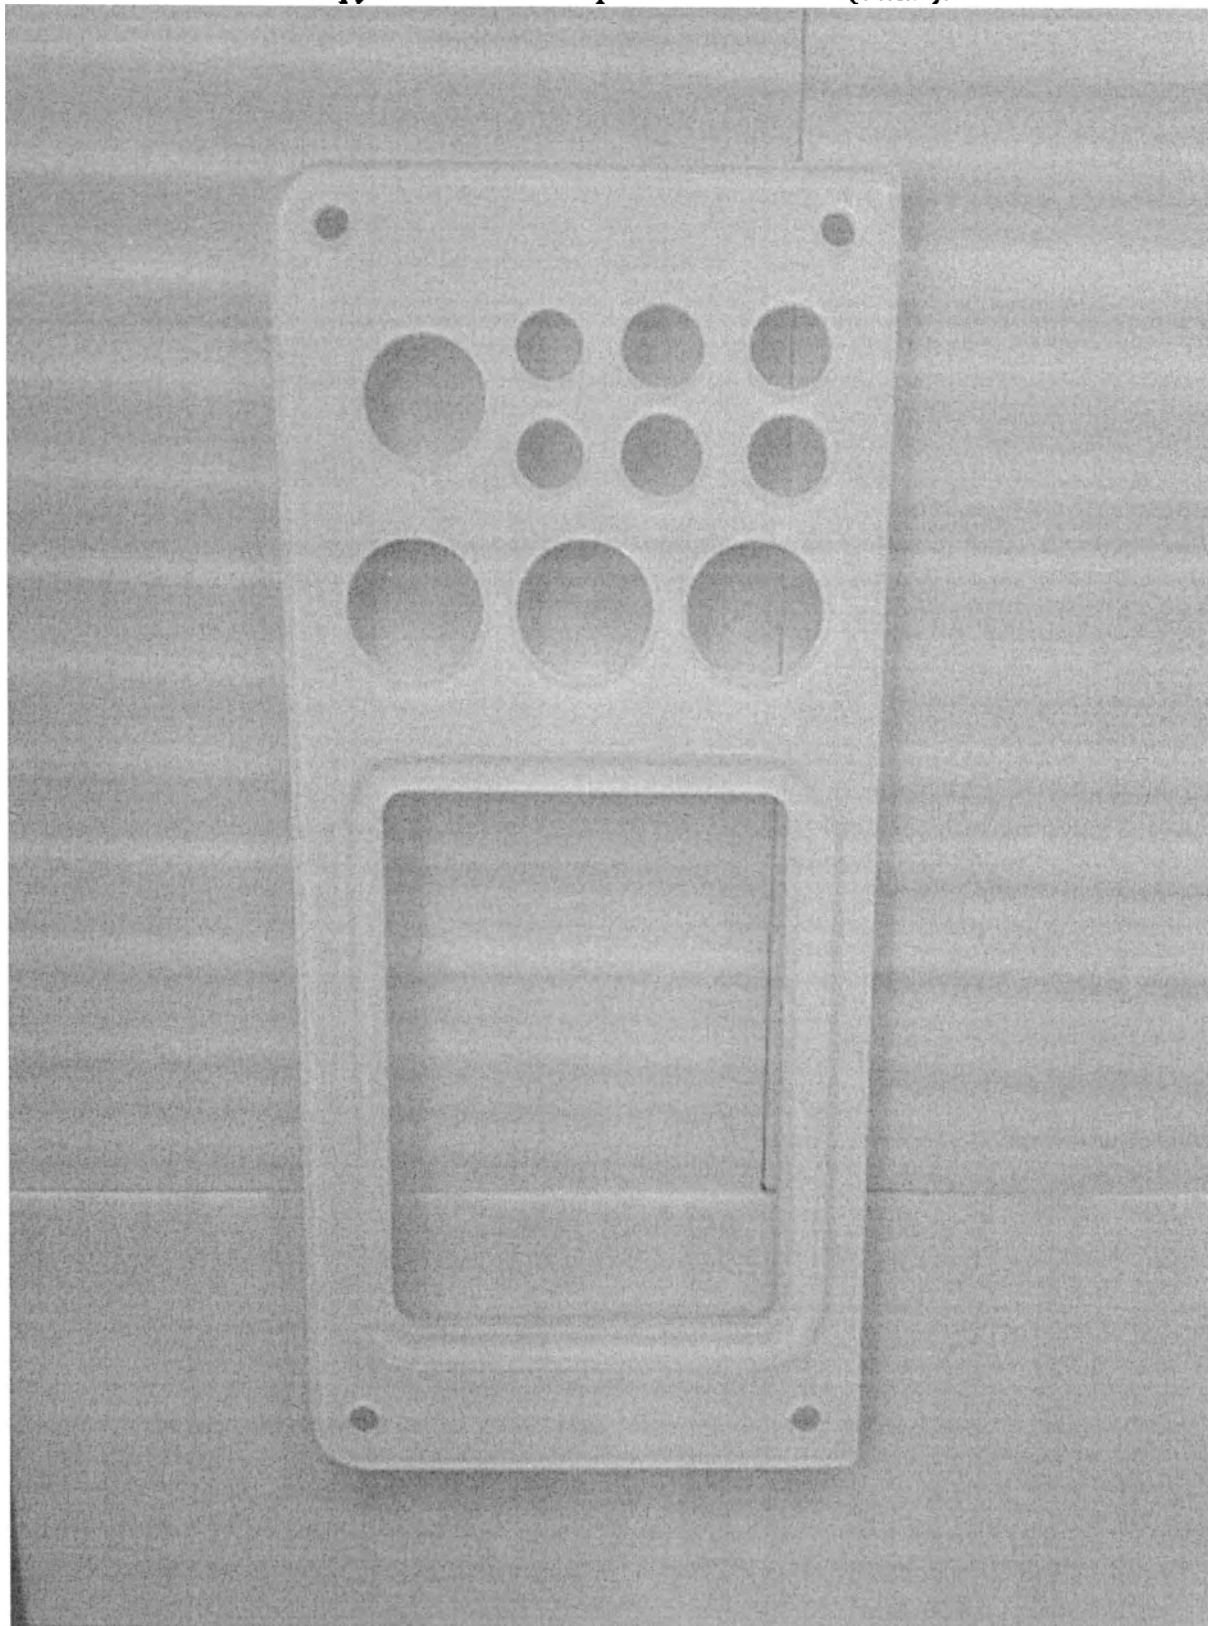


Вспомогательная поверхность из стекла (белая)

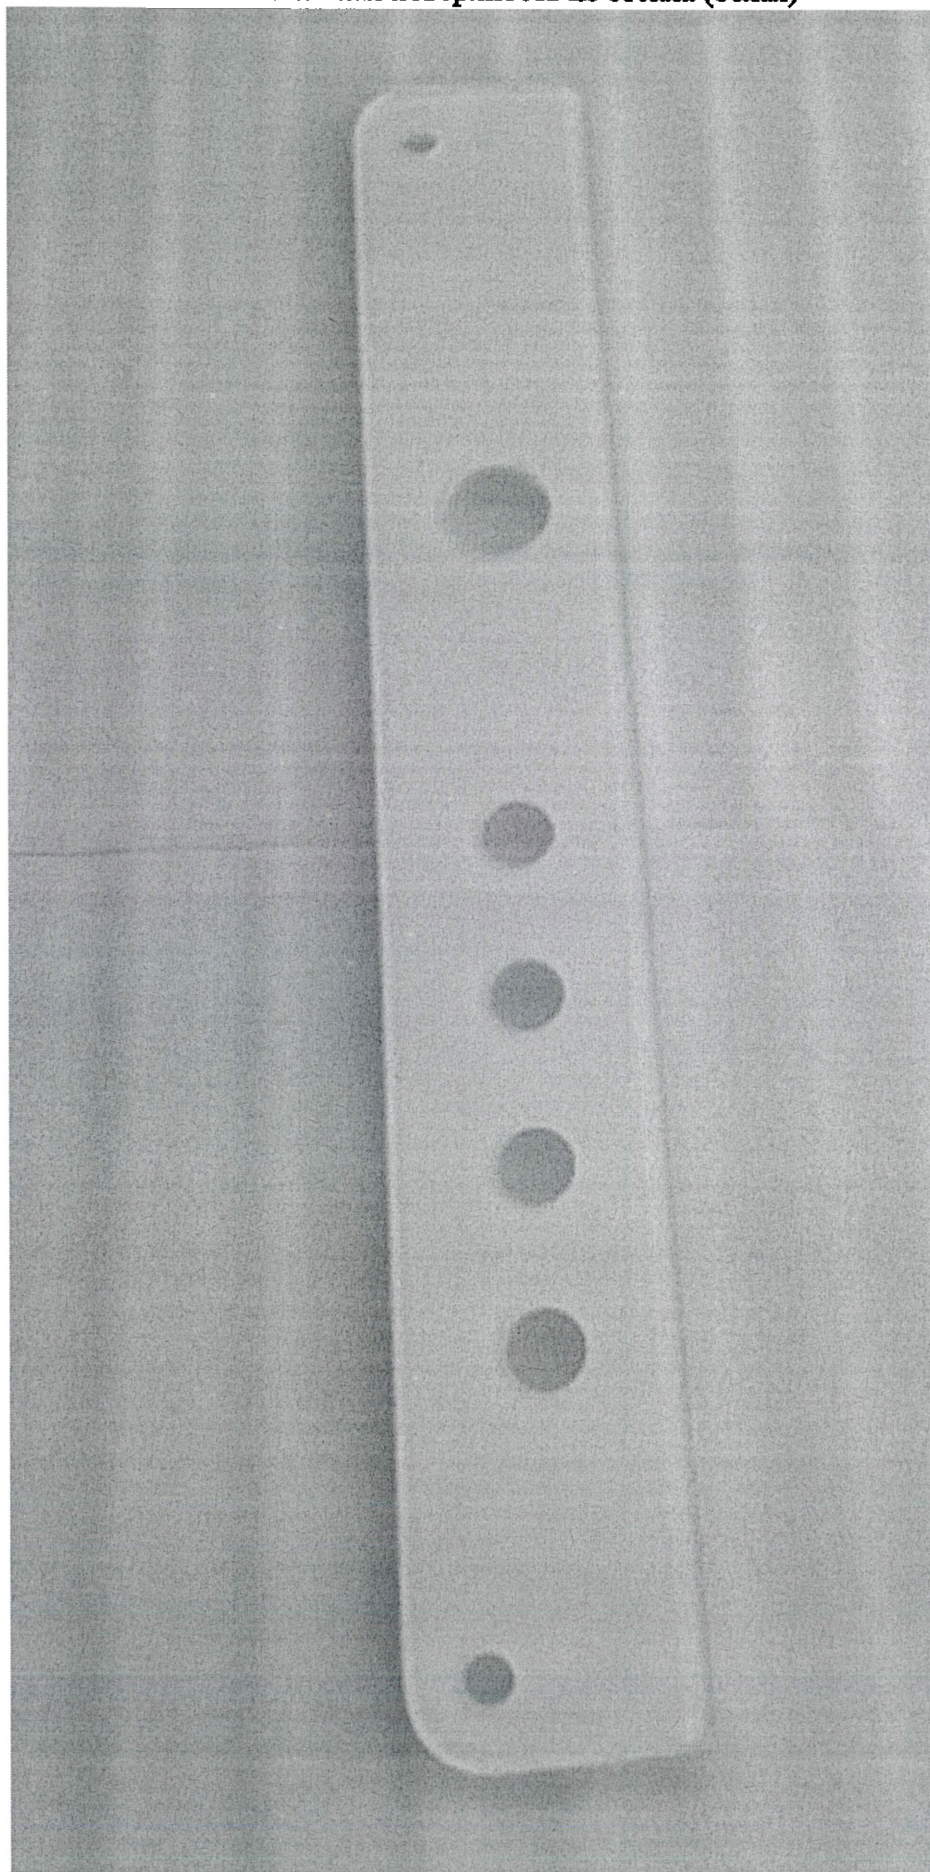

Инструментальная поверхность дополнительная из стекла (белая)

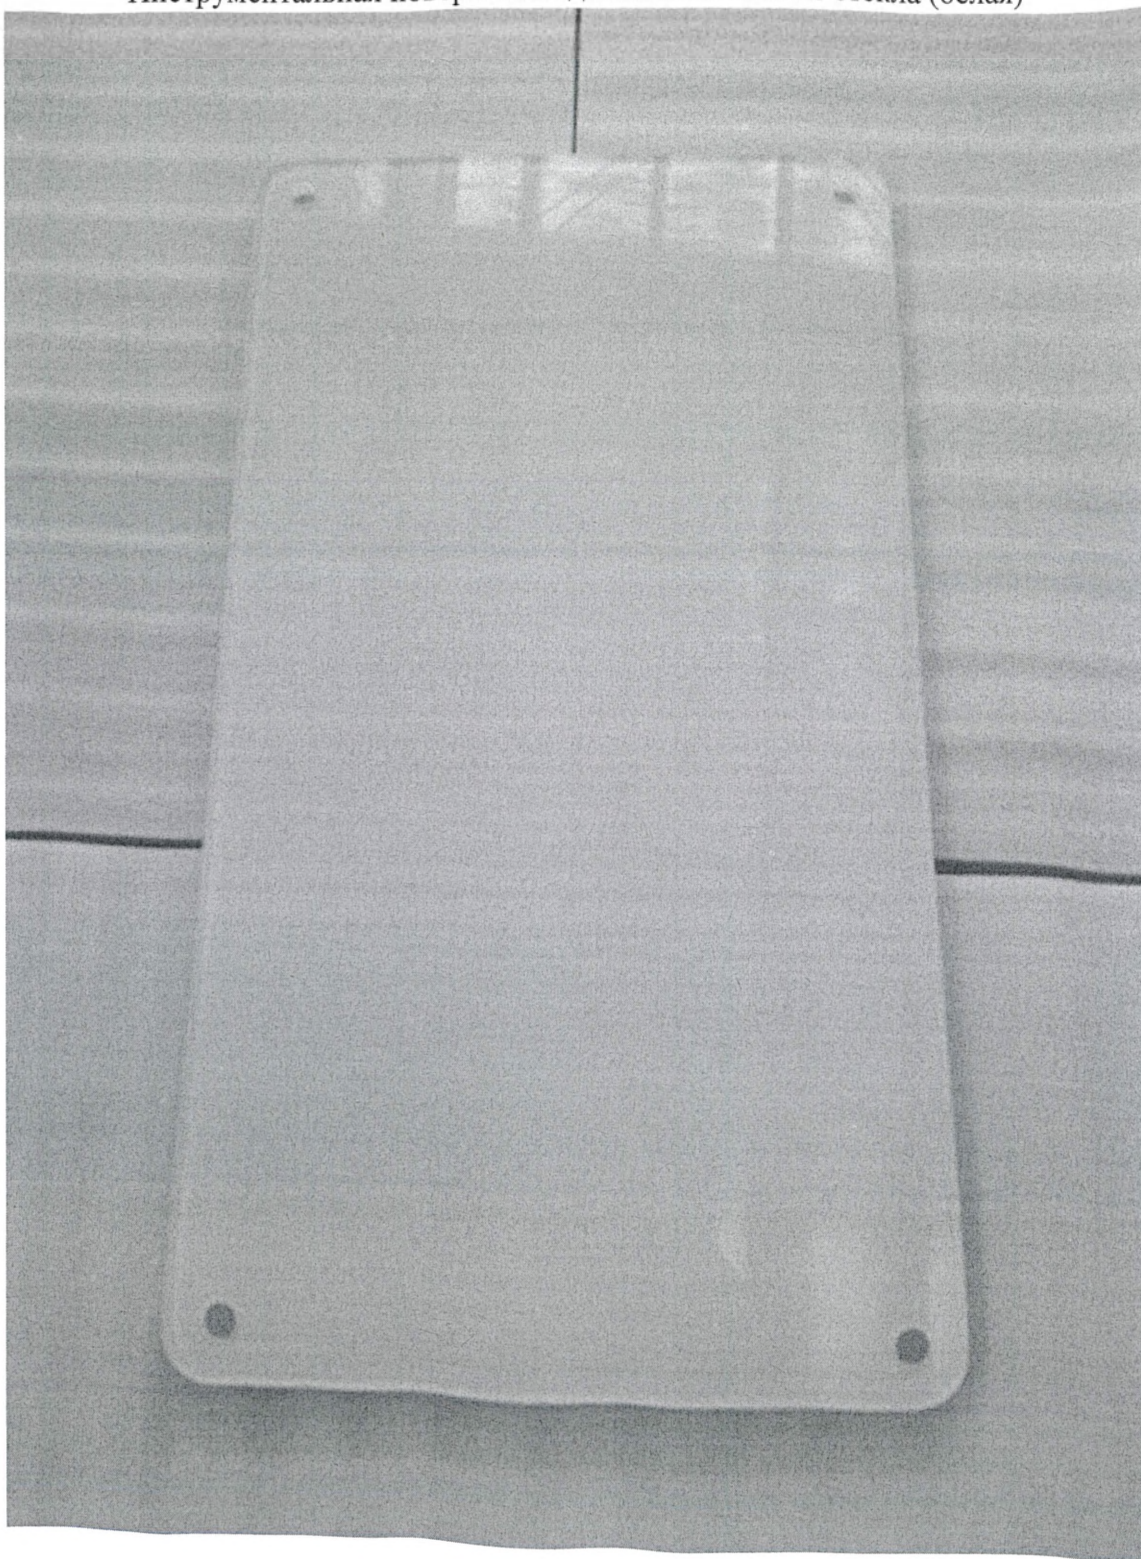


Болт фиксации инструментальной поверхности

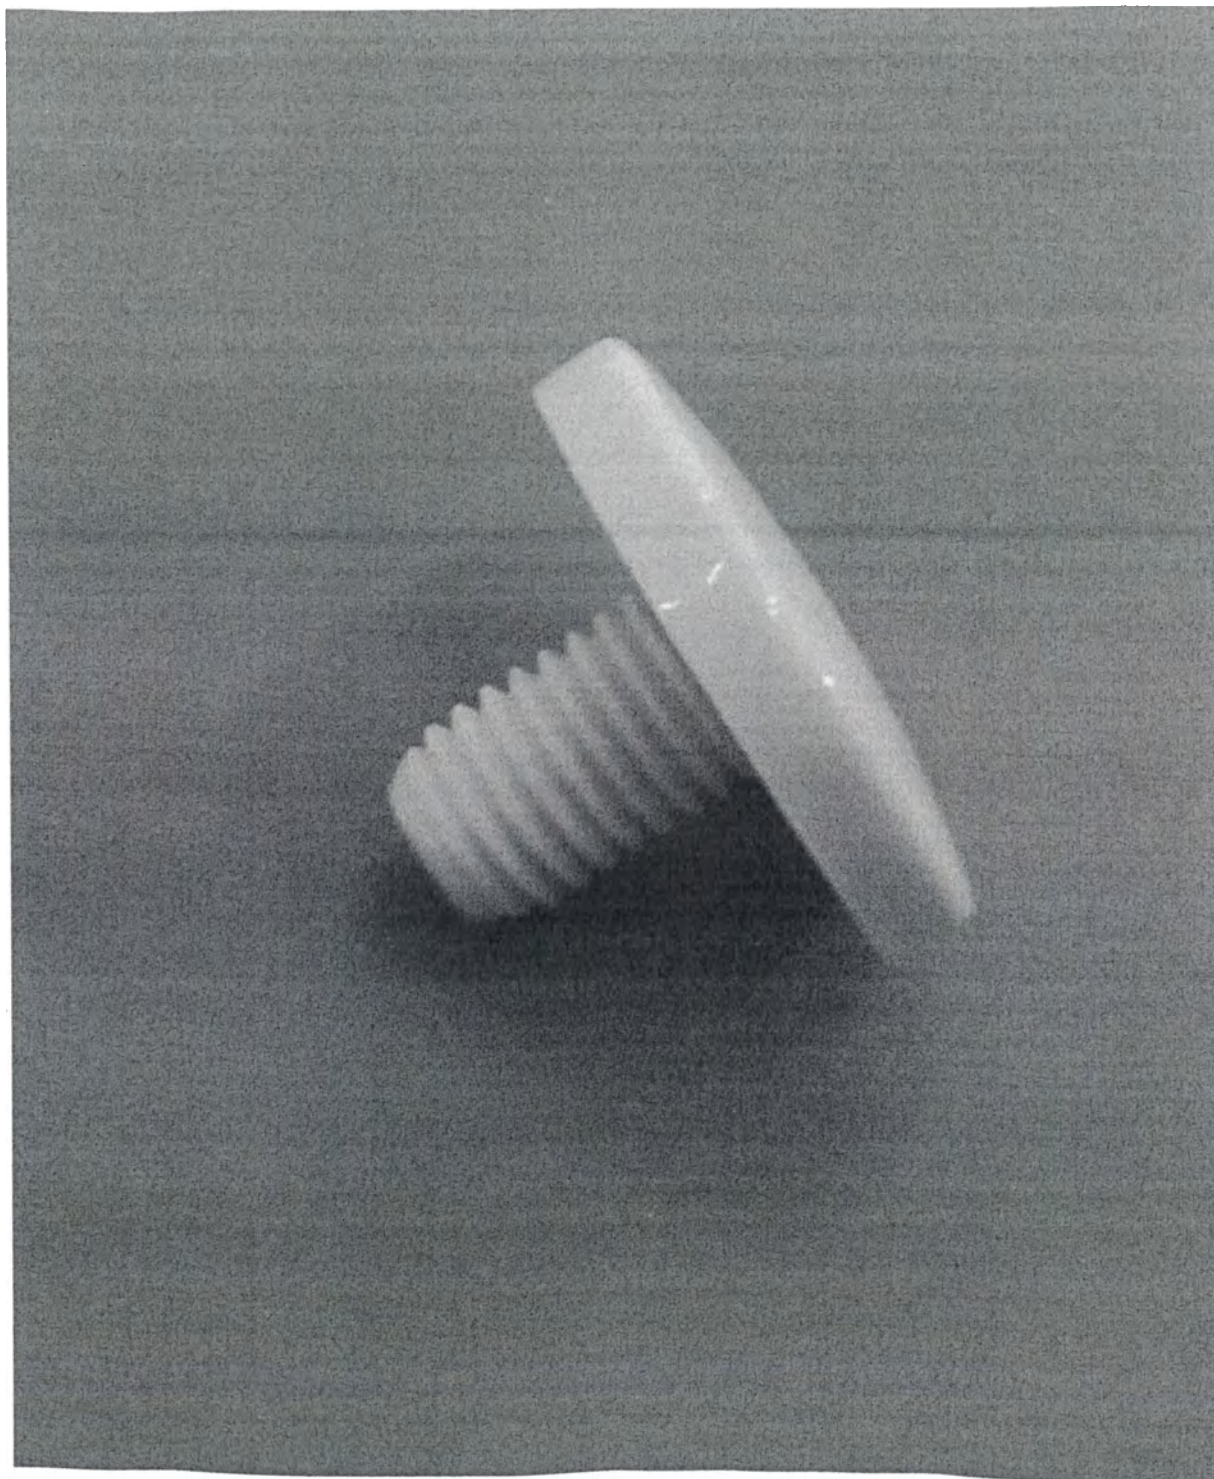

Держатель для ЛОР-эндоскопов специальных для дезинфекции и хранения эндоскопов специальных.



Емкость для секрета малая, объем 500 мл.

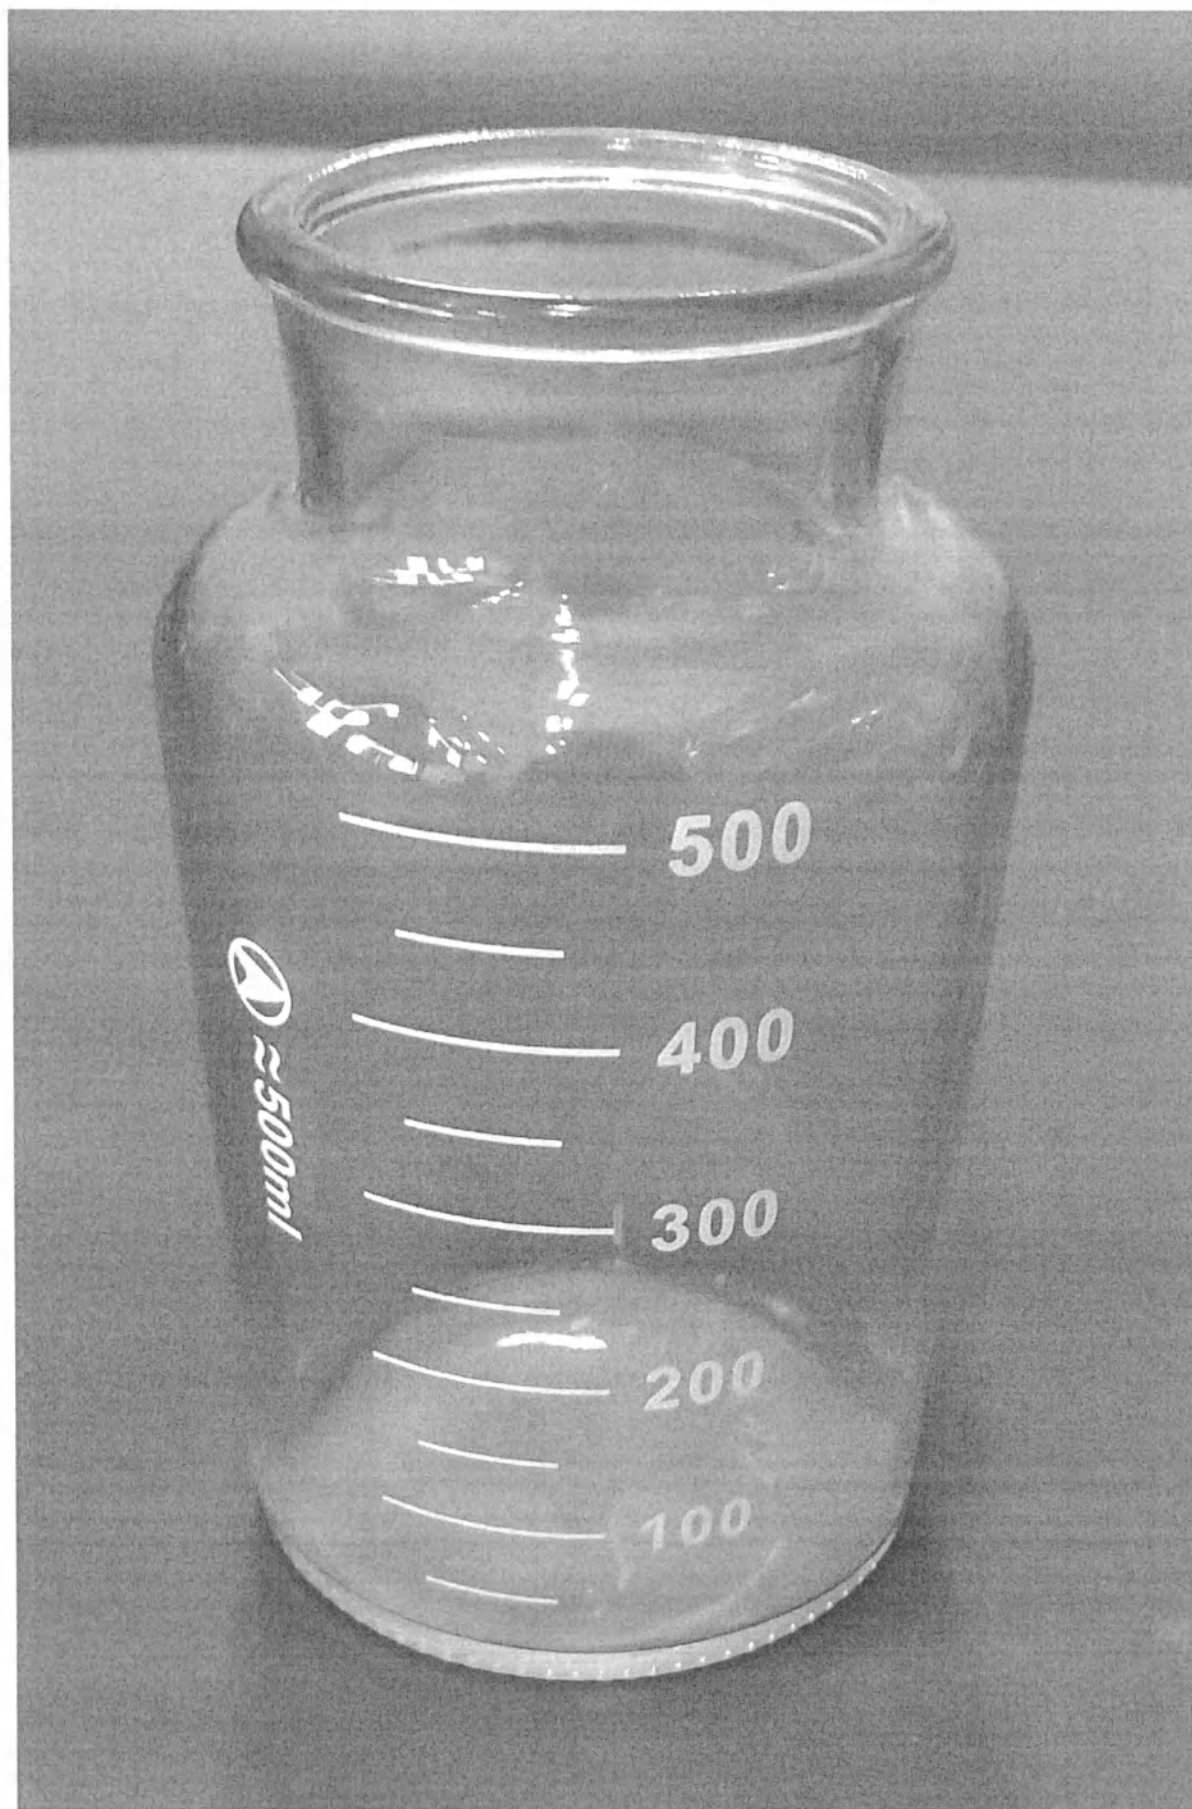


Олива Политцера пластиковая




Олива Политцера металлическая




Ролик для перемещения рабочего места

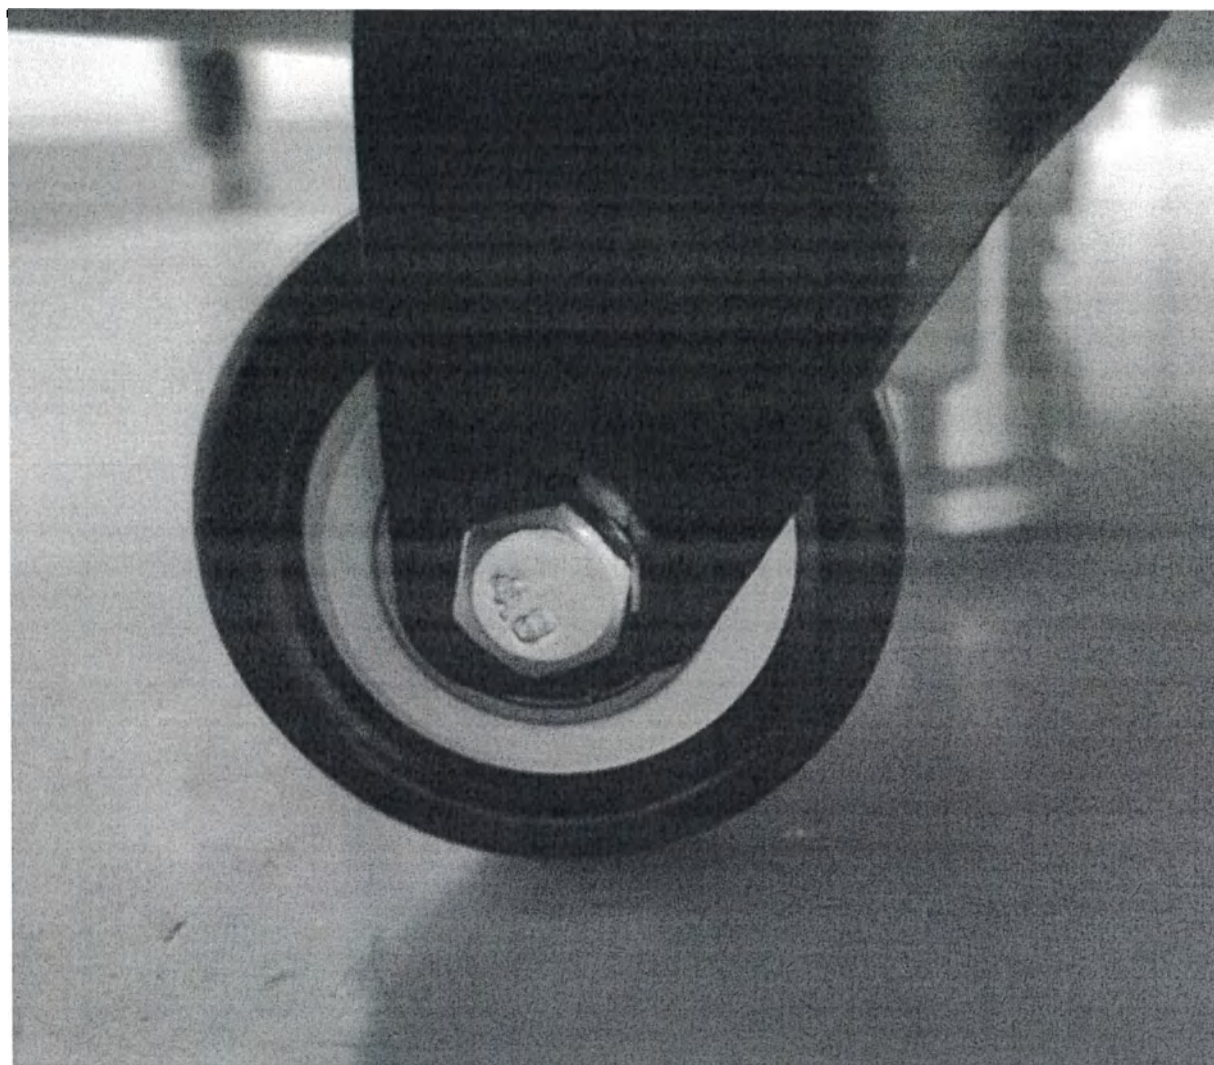

CCD – видеокамера специальная.

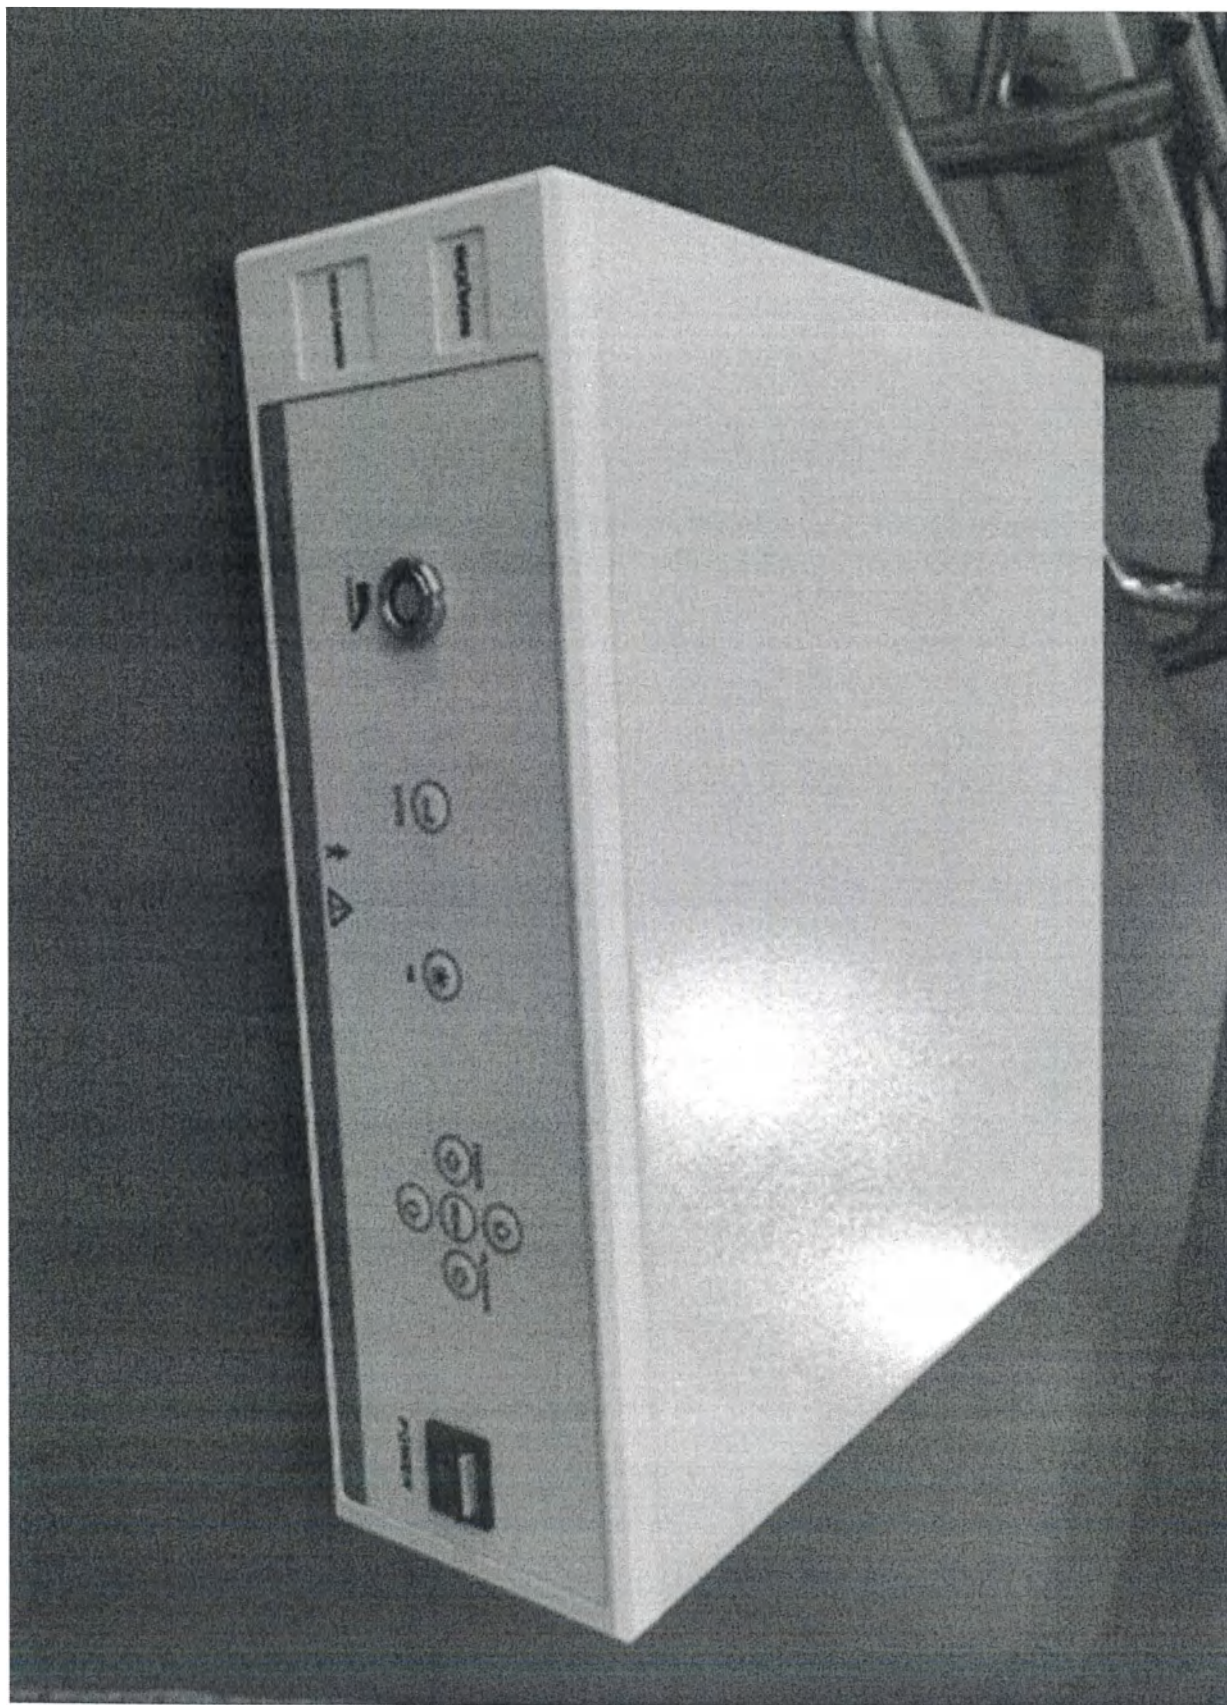

Кабель подключения CCD – видеокамеры специальной к монитору ЖК специальному

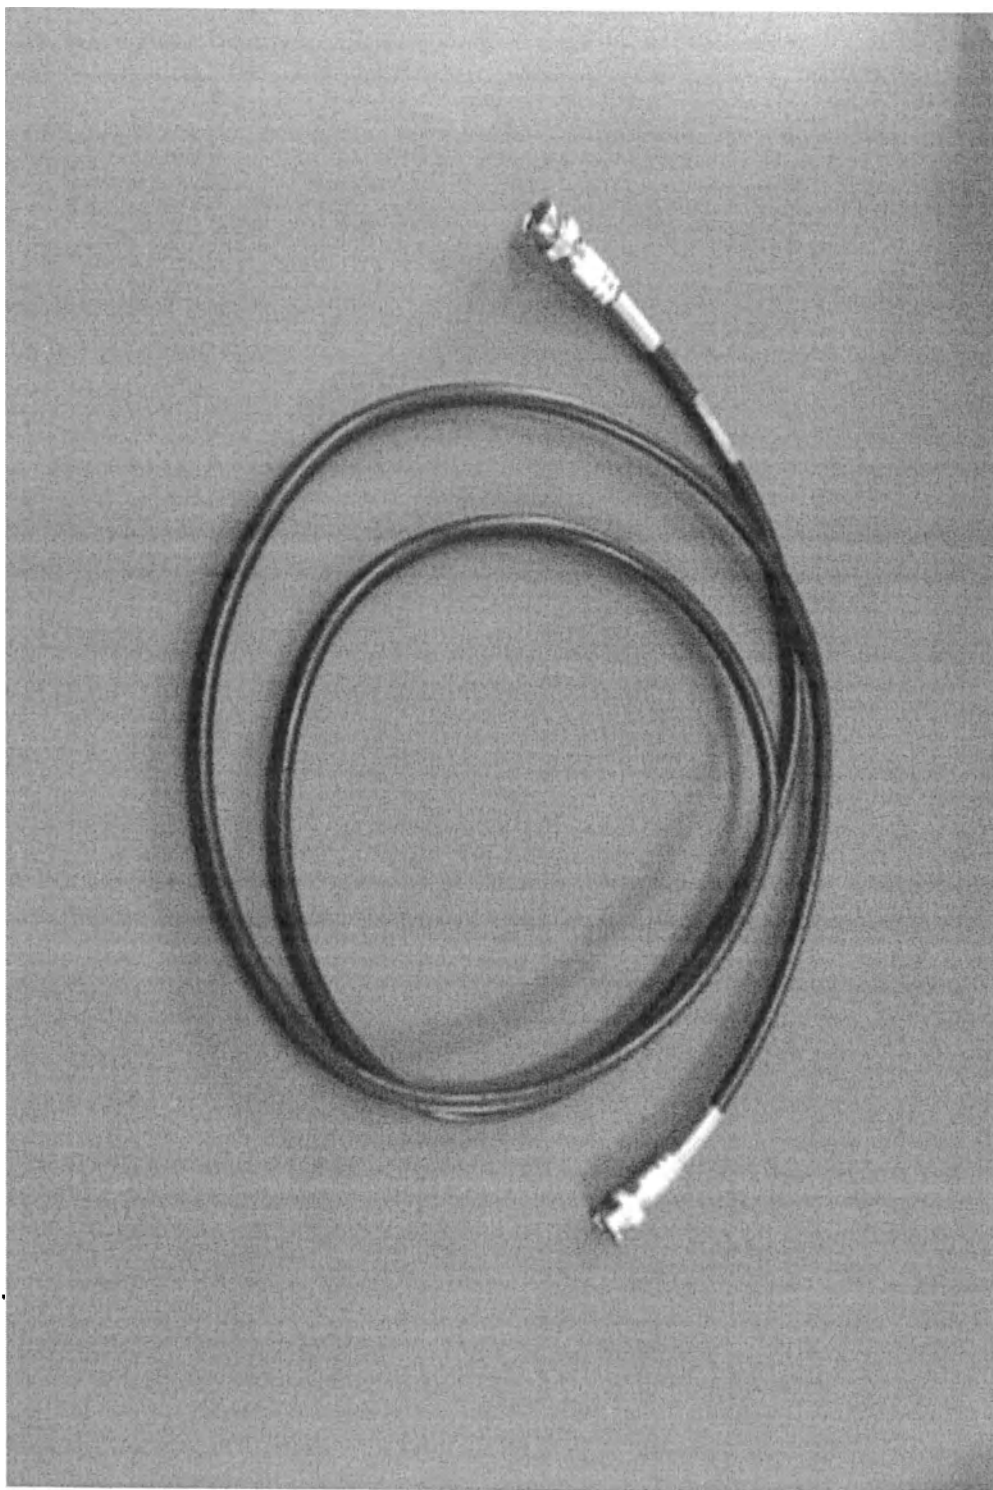

Головка CCD-видеокамеры специальной




Кабель питания для CCD – видеокамеры специальной




Монитор ЖК специальный для CCD – видеокамеры специальной.



DVI- кабель для монитора ЖК специального

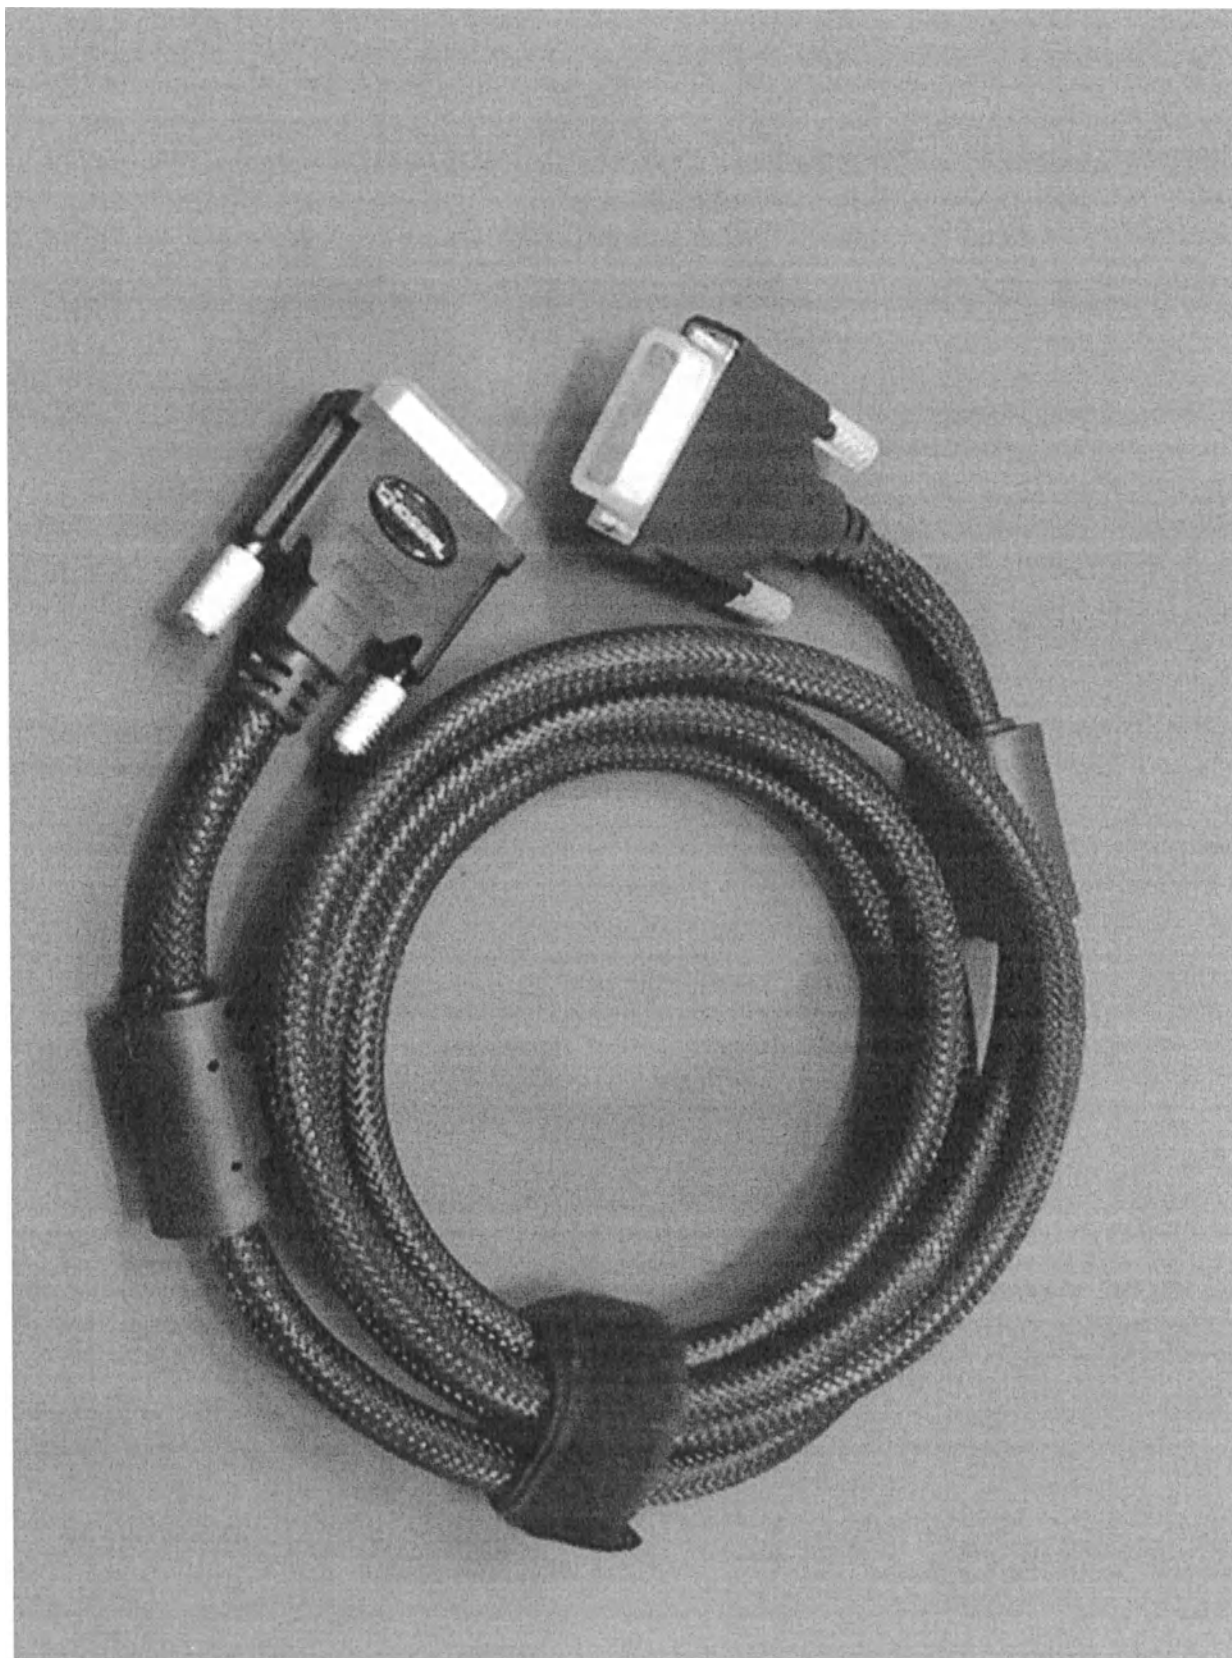


S-video кабель для монитора ЖК специального

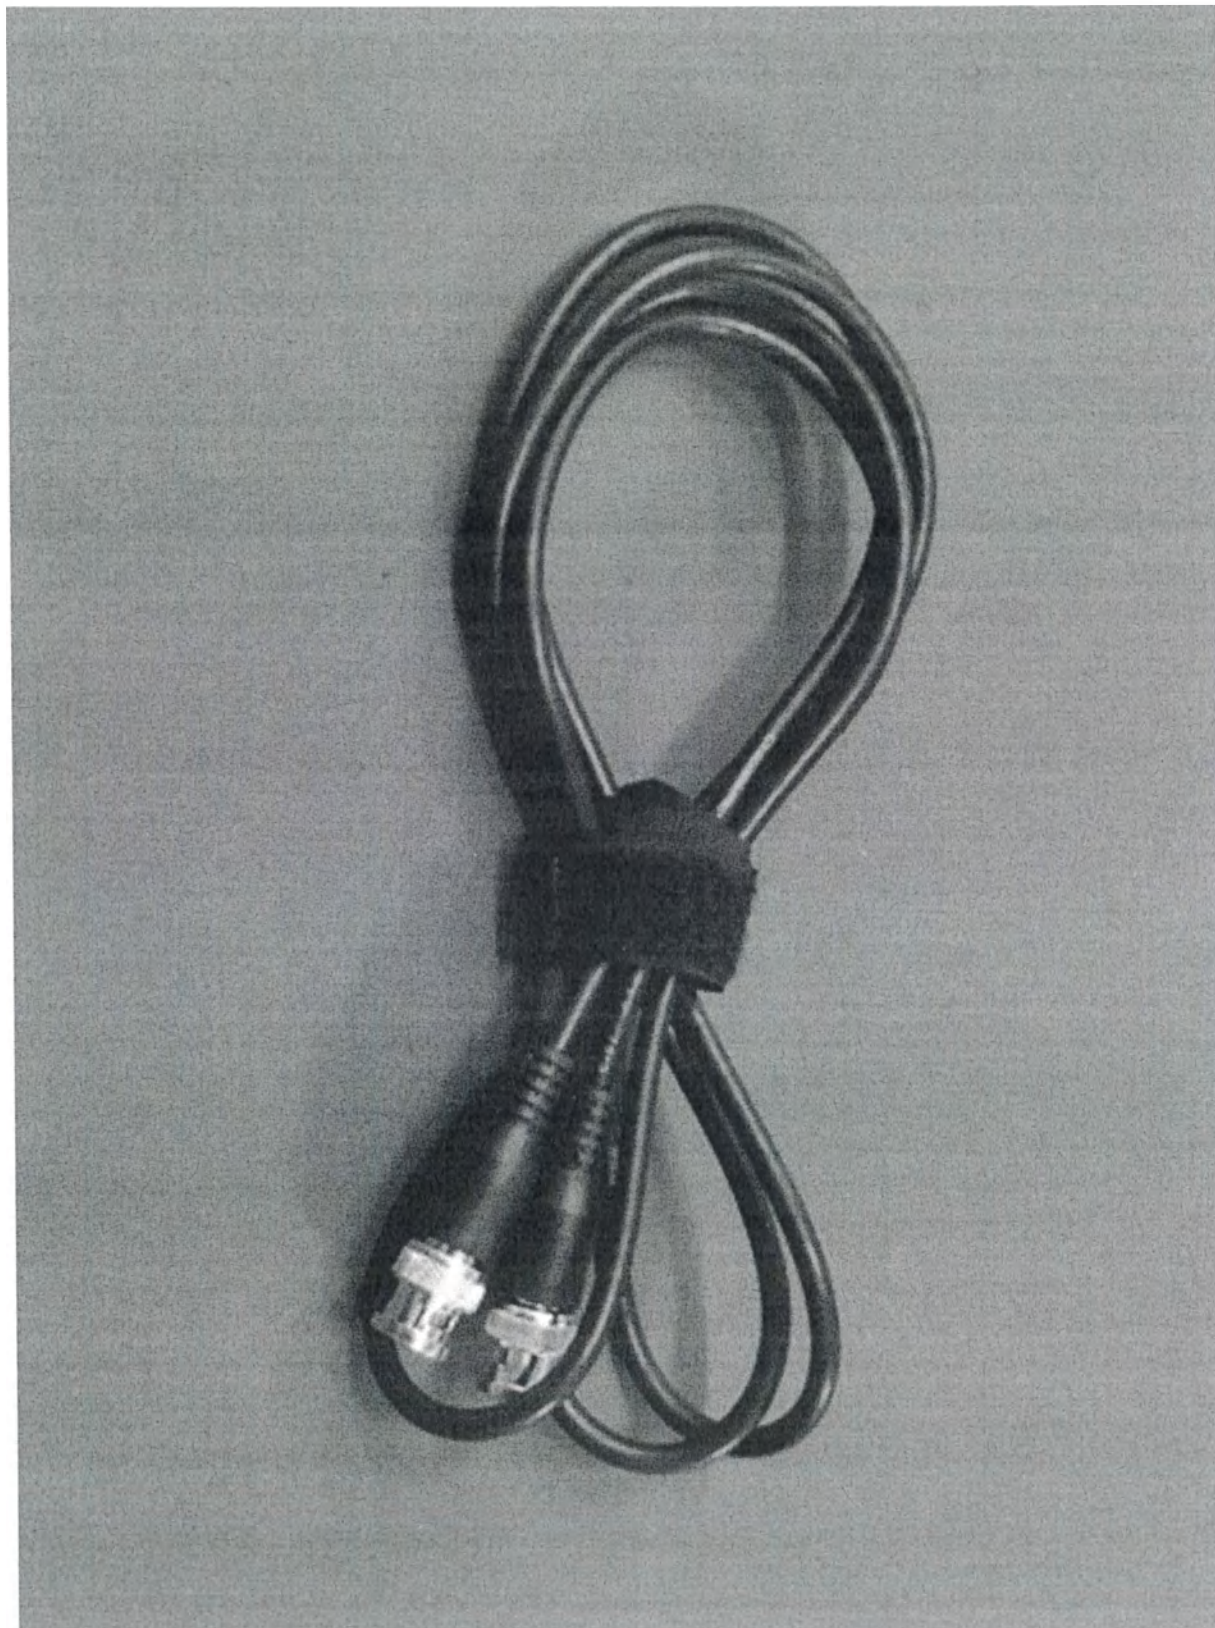

Кабель питания для монитора ЖК специального




Полка-держатель для ССD –видеокамеры специальной и источника холодного света специального.

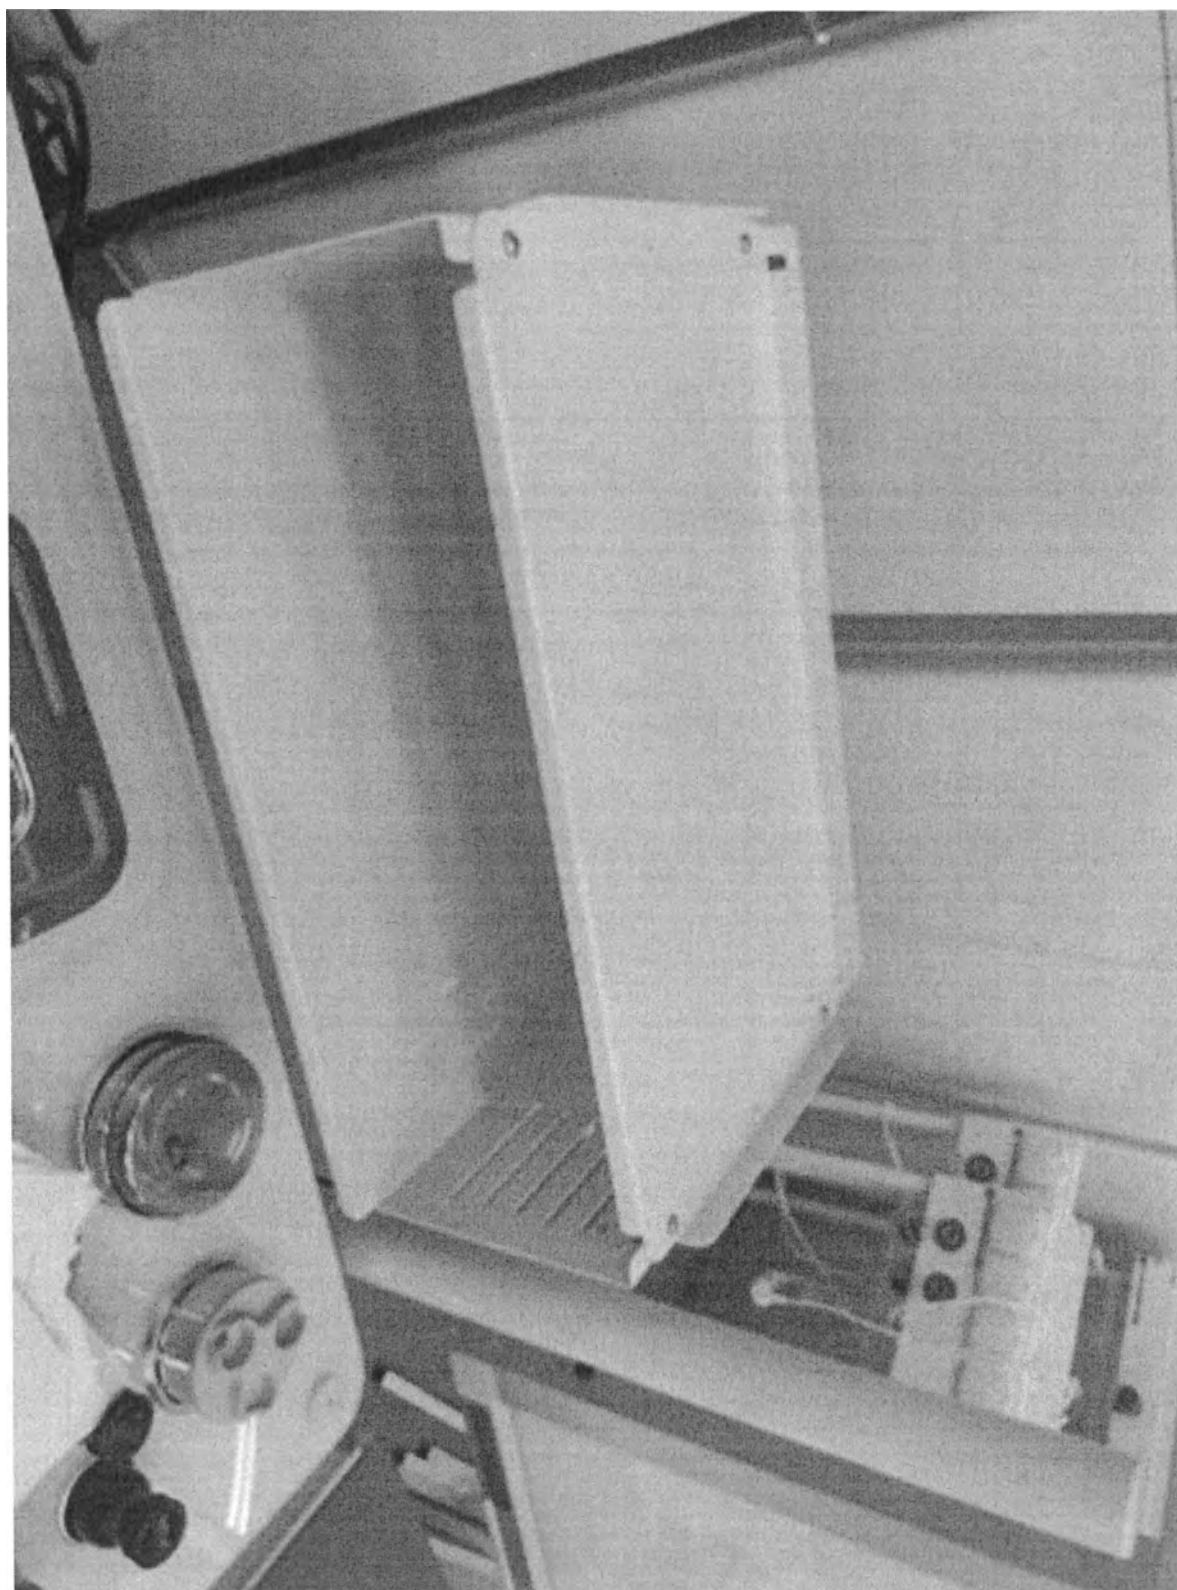

Кронштейн-держатель для монитора ЖК специального.



Поверхность выдвижная

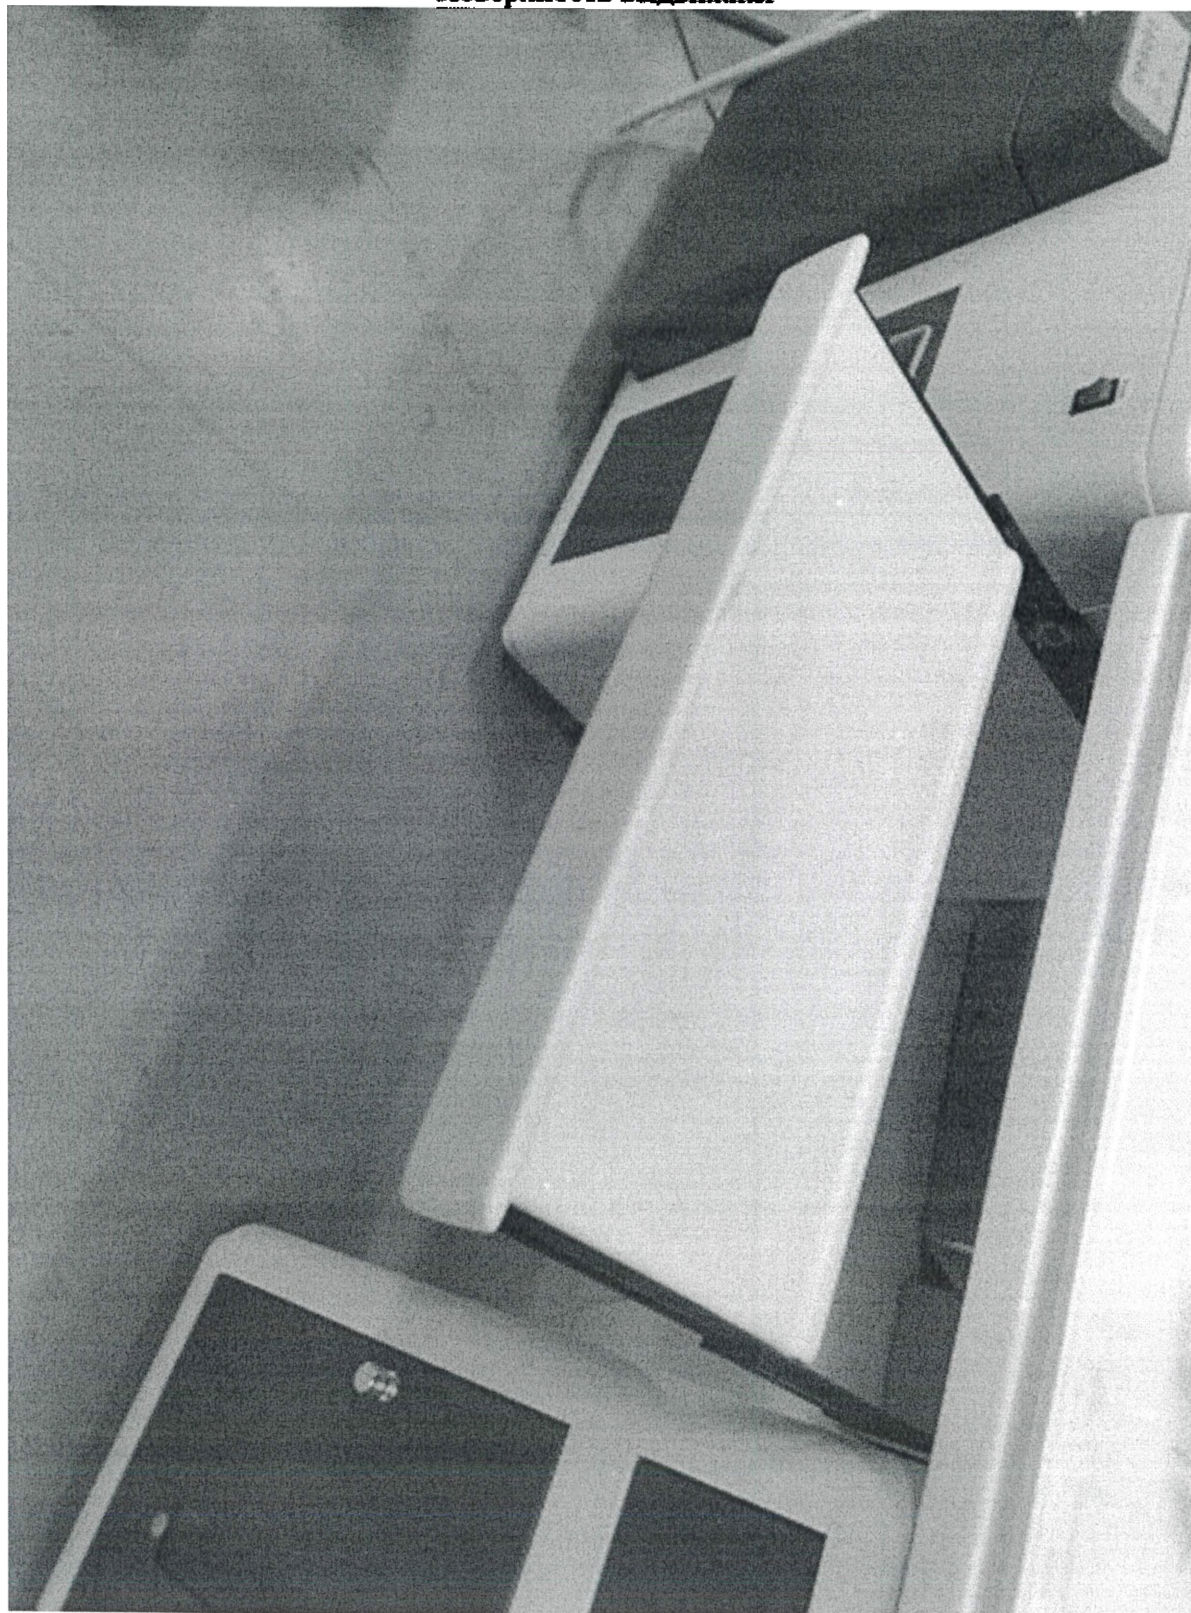



Решение для жизни

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
104 ЛИСТОВ



Генеральный директор
ООО «МТО «Стормоз»
Брукс Е.В.
"Стормоз"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МТО «Сормовь»




Брукс Е.В.


20.08.2021 г.

Фотографические изображения маркировки медицинского изделия

**РАБОЧЕЕ МЕСТО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА DIXION ST
С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ**

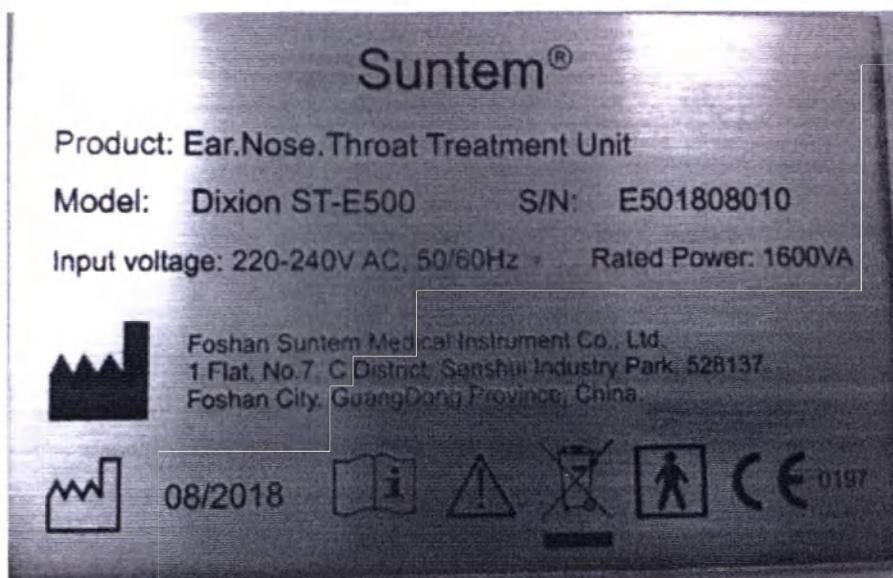


Фотографическое изображение маркировки прибора модели ST-E500

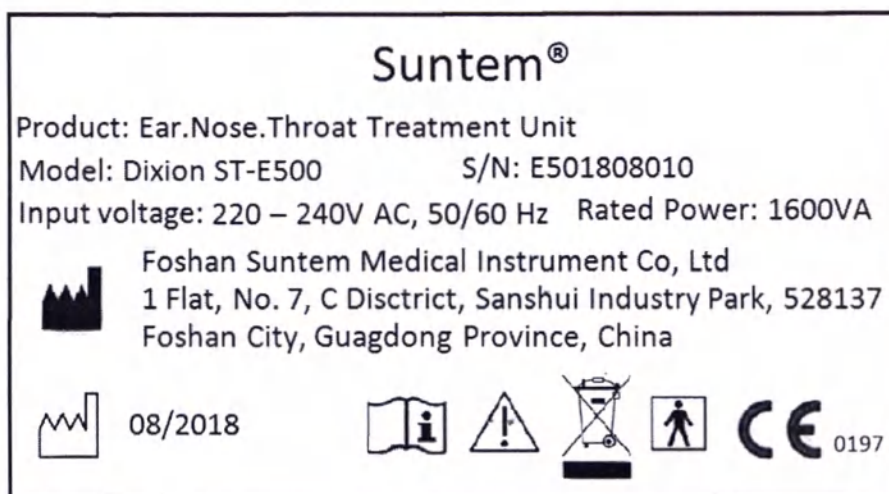


Внешний вид макета маркировки прибора модели ST-E500



Перевод на русский язык макета маркировки прибора модели ST-E500

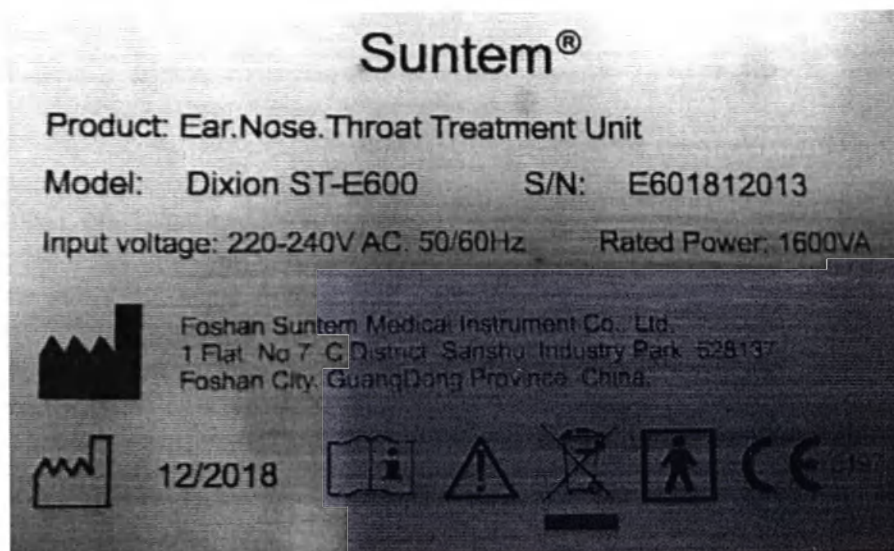

Фотографическое изображение маркировки прибора модели ST-E600

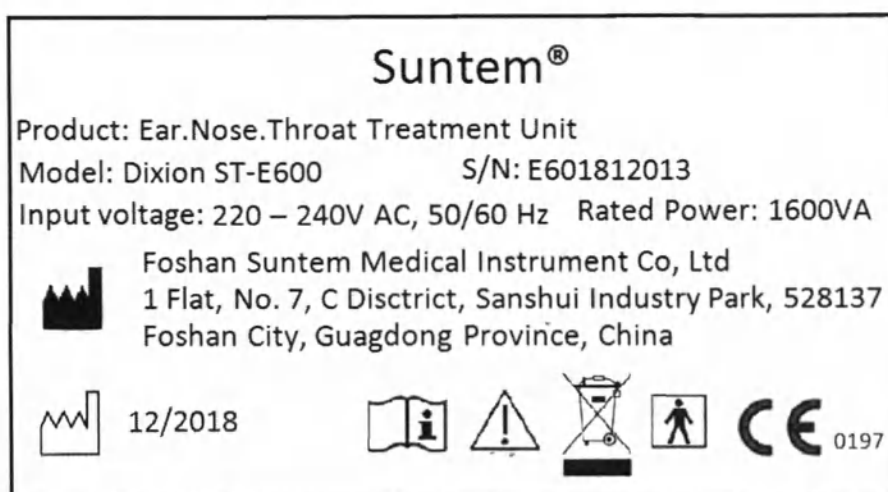

Внешний вид макета маркировки прибора модели ST-E600



Перевод на русский язык макета маркировки прибора модели ST-E600

На медицинское изделие Рабочее место оториноларинголога Dixon ST с принадлежностями нанесена маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение типа;
- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- номинальное значение напряжение сети питания;
- номинальное значение частоты тока питающей сети;
- потребляемая мощность при номинальном режиме работы;
- наименование и адрес производителя;
- дата изготовления (месяц и год);

-  - обратитесь к сопроводительной документации (Руководству по эксплуатации);

-  - Инструкция по эксплуатации/обратитесь к инструкции по эксплуатации


-  - Не утилизировать с бытовыми отходами

-  - Рабочая часть типа BF


-  - Дата производства

-  - Места производства

-  ⁰¹⁹⁷ - Соответствие стандартам качества и безопасности Европейского союза.

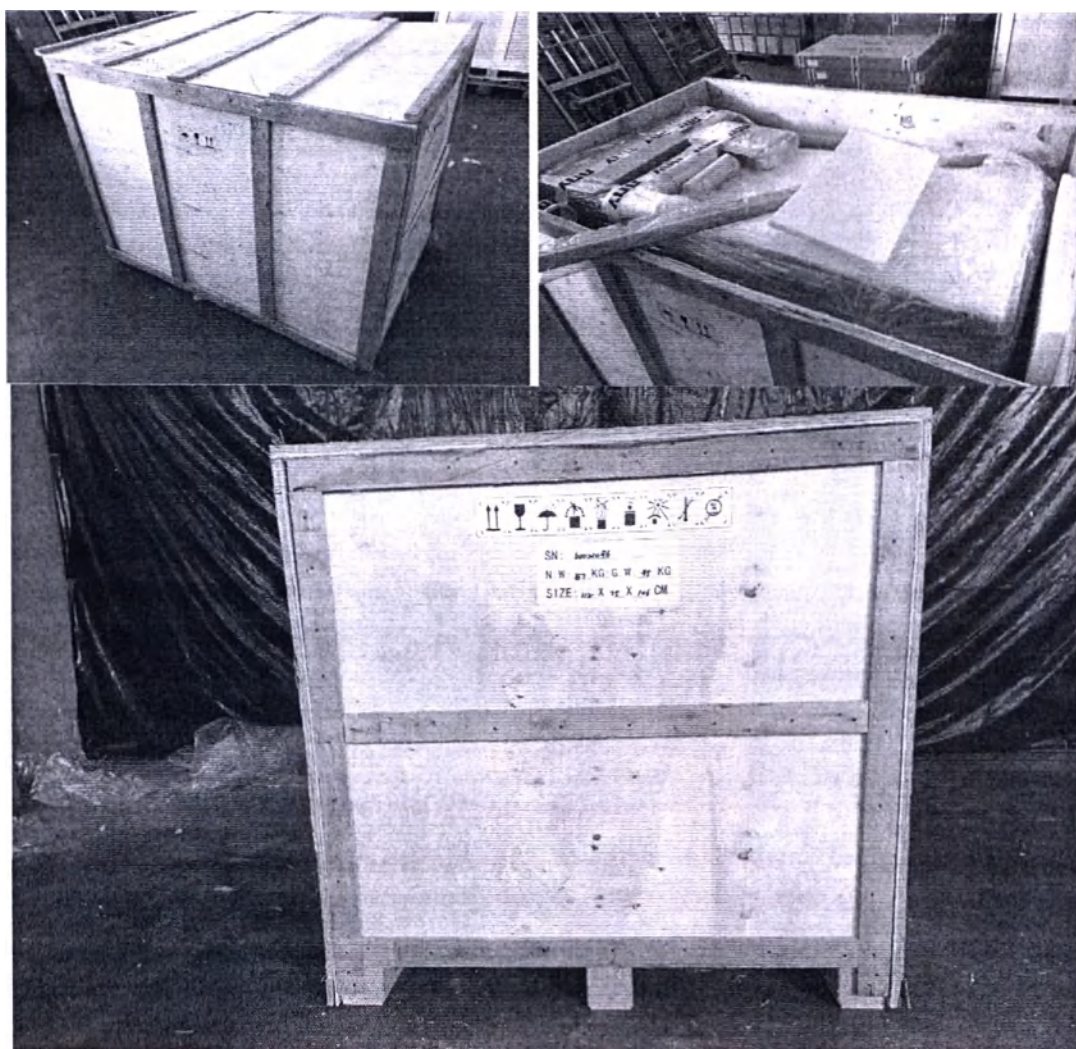

Фотографическое изображение транспортной упаковки МИ «Рабочее место оториноларинголога Dixon ST с принадлежностями»

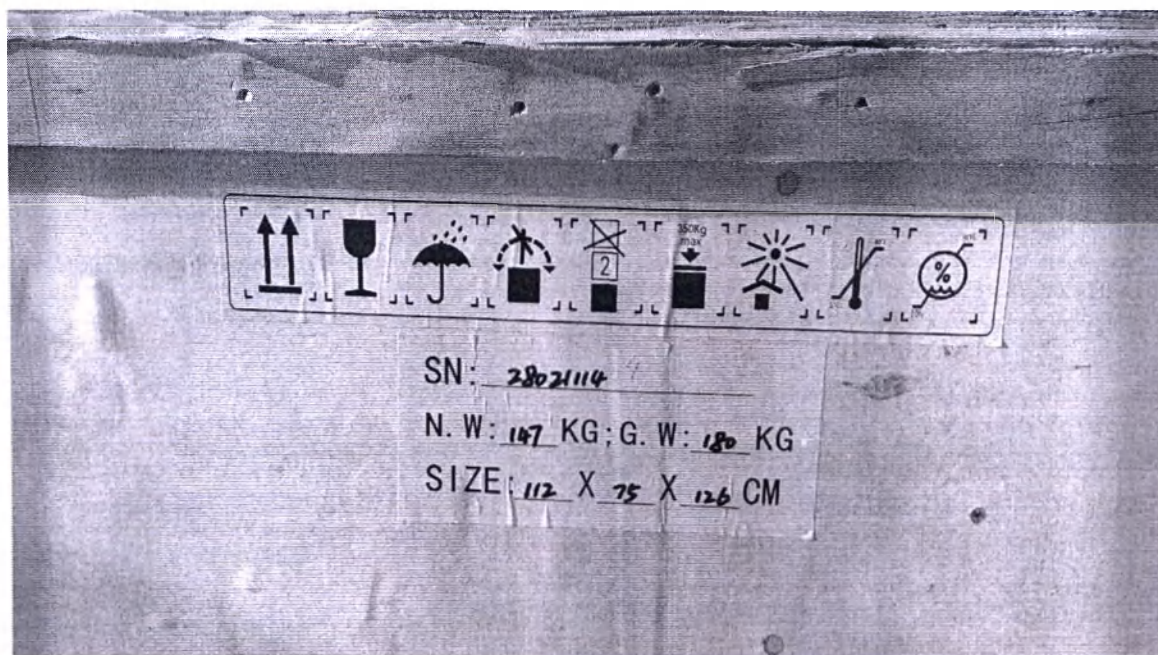

Фотографическое изображение маркировки упаковки МИ «Рабочее место оториноларинголога Dixon ST с принадлежностями»

SN: _____

N.W: _____KG; G.W: _____KG

SIZE: _____X_____X_____CM

Внешний вид макета транспортной маркировки

Таблица параметров коробов для МИ Рабочее место оториноларинголога Dixon ST с принадлежностями:

Модель	ST-500
Серийный номер	E501808010
Вес	193 кг
Размер	135x93x106 см


Модель	ST-600 (основной блок)
Серийный номер	E601812013
Вес	193 кг
Размер	135x93x106 см

Модель	ST-600 (дополнительный блок)
Серийный номер	E601812013
Вес	193 кг
Размер	135x93x106 см

Модель	ST-250 (кресло пациента)
Серийный номер	E2520070041
Вес	180 кг
Размер	112x75x126 см

Маркировка упаковки нанесена на транспортную упаковку и содержит следующую информацию:

- адрес производителя;
- наименование изделия;
- серийный номер;
- символы и манипуляционные знаки:

	Указывает правильное вертикальное положение груза
	Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом. Указывает, что медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно
	Беречь от влаги. Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от влаги
	Не кантовать. Транспортную упаковку нельзя кантовать
	Предел по количеству ярусов в штабеле. Максимальное количество одинаковых грузов, которые можно штабелировать один на другой, где n - предельное количество
	Предел штабелирования по массе. Указывает максимальную нагрузку при штабелировании, допущенную для размещения на транспортной упаковке
	Не допускать воздействия солнечного света. Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света
	Температурный диапазон. Указывает температурный диапазон, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется
	Диапазон влажности. Указывает диапазон влажности, в пределах которого медицинское изделие надежно сохраняется

Suntem®

Продукт: Установка для лечения уха, носа, горла

Модель: _____ Серийный номер: _____

Вес нетто: _____ кг

Вес брутто: _____ кг

Габаритные размеры: _____ х _____ х _____ см



Foshan Suntem Medical Instrument Co, Ltd
1 Flat, No. 7, C District, Sanshui Industry Park, 528137
Foshan City, Guangdong Province, China

Макет маркировки на русском языке

На Регистрационного удостоверения:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТОРМОВЬ»
(ООО «МТО «СТОРМОВЬ»)

143401, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 4, корпус 1, пом.ХХ, этаж 8, комната 7.

Телефон/факс: +7 (495) 780-07-90

Сайт: www.stormoff.ru E-mail: info@stormoff.com

Дополнительная маркировка с информацией об уполномоченном представителе на территории Российской Федерации и номером Регистрационного удостоверения

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО

____ ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «МТО-Стормовь»

Брукс Е.В.

Медико-техническое
объединение
"Стормовь"

