

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Набор для недериватизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2
(NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»**

Официальный производитель:

Wallac Oy (Валлак Ою)
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)
Тел: 358-(0)2-267 8111
Факс: 358-(0)2-267 8357

Наименование и адрес места производства:

Wallac Oy (Валлак Ою),
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)

Уполномоченный представитель в ЕАЭС:

Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
109028, г. Москва, Певческий переулок, дом 4, строение 1, помещение I, комната 10
Телефон/факс: +7 (495) 937-45-94/ +7 (495) 937-45-92
Адрес электронной почты: info@pribori.com

Утверждено:

Полное имя	Ефимов Леонид Николаевич
Должность:	Генеральный директор
Компания:	Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
Подпись:	
Дата:	
Печать:	




Упаковка «Набор для неderivатизированной tandemной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»

10


[illegible][illegible][illegible]

Reg MS (Brasil) 10298910147
 Resp. Técnica Silvia Claudia A. Bello,
 CRF SP 15678


 $2^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$

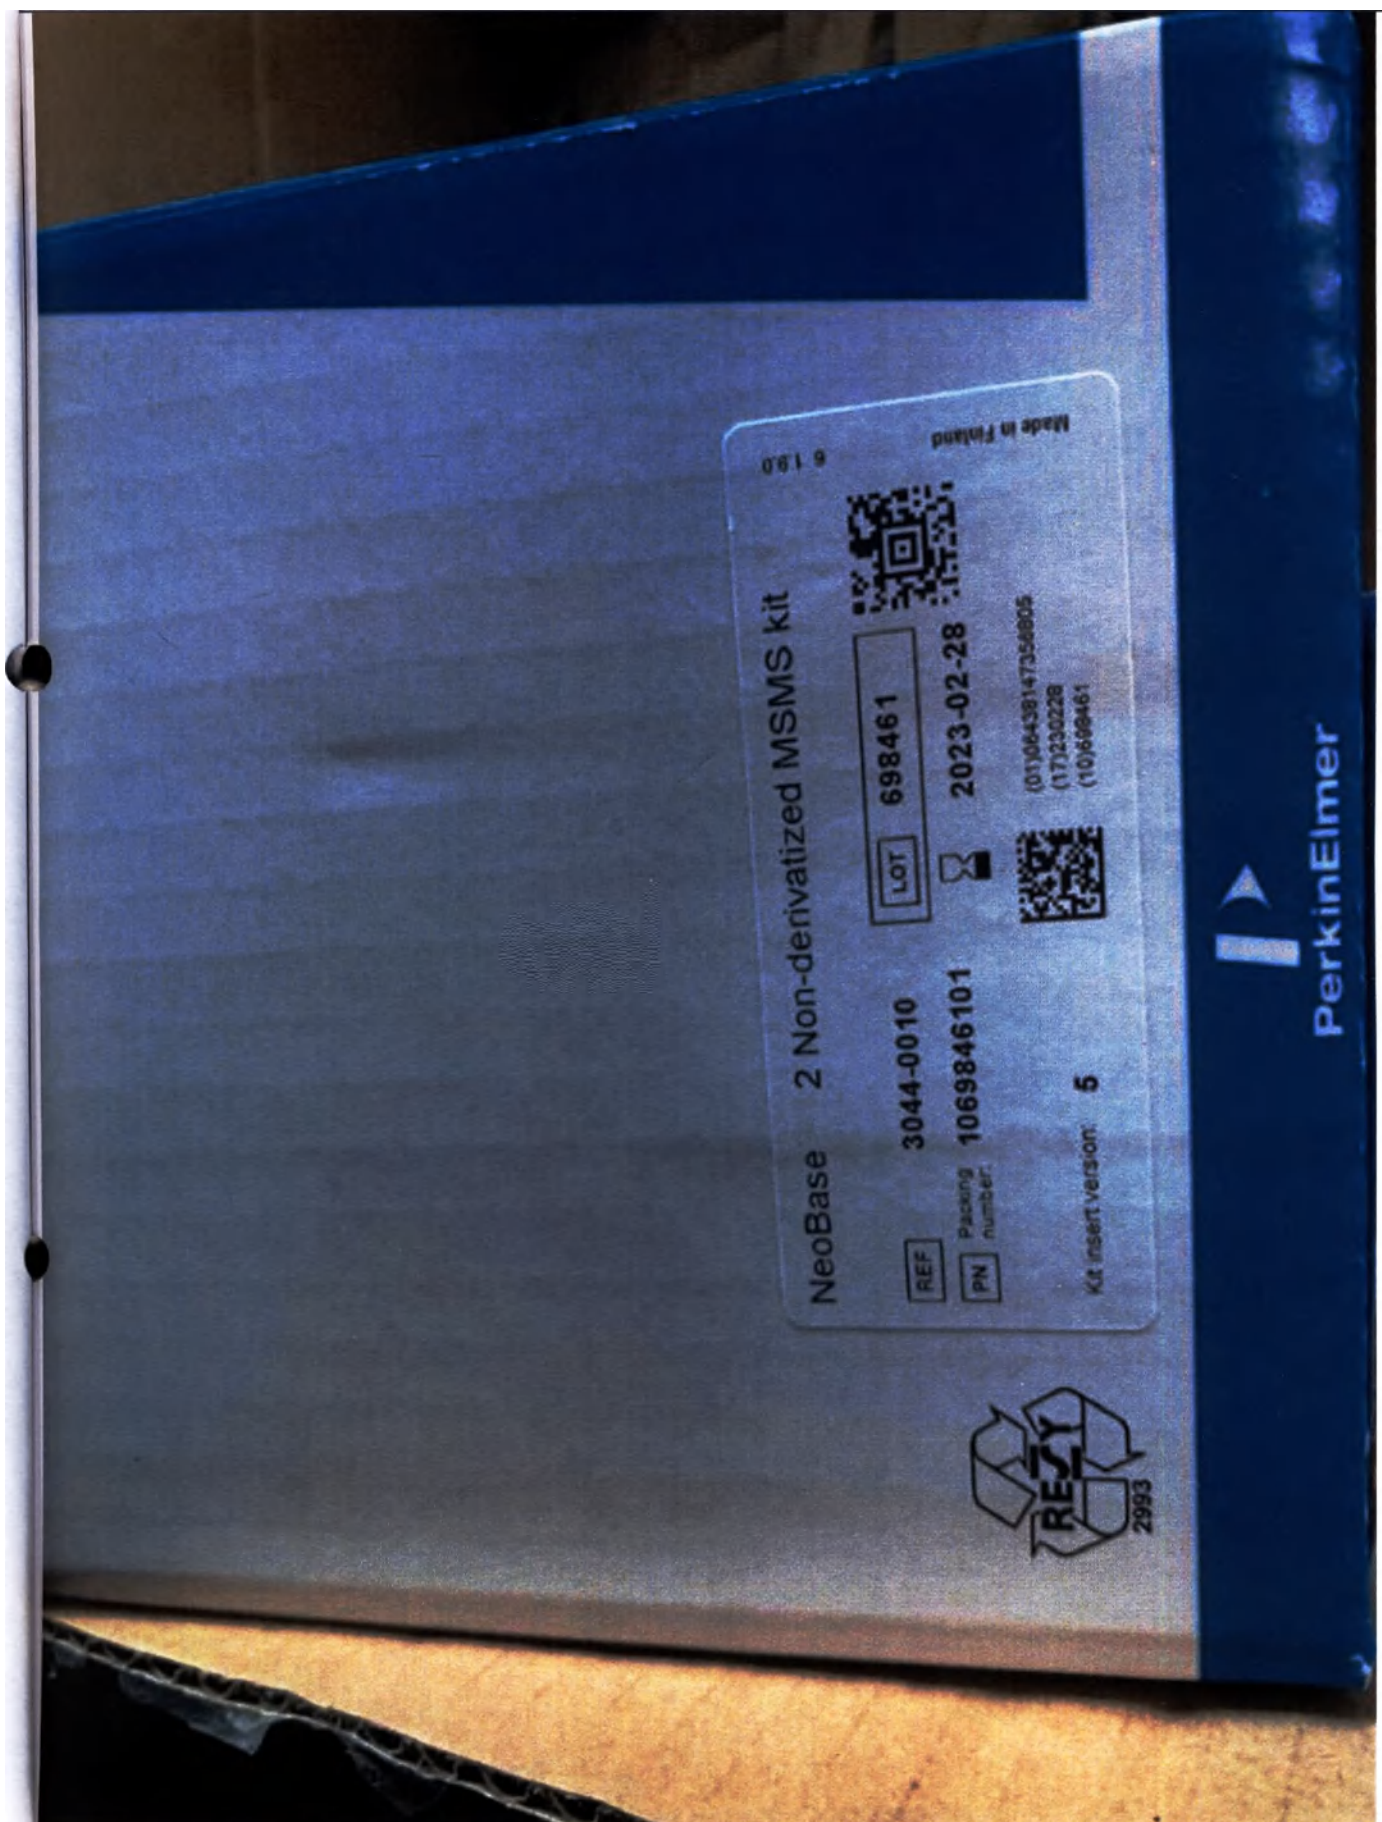


«Набор для неderivатизированной тандемной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)». Маркировка упаковки

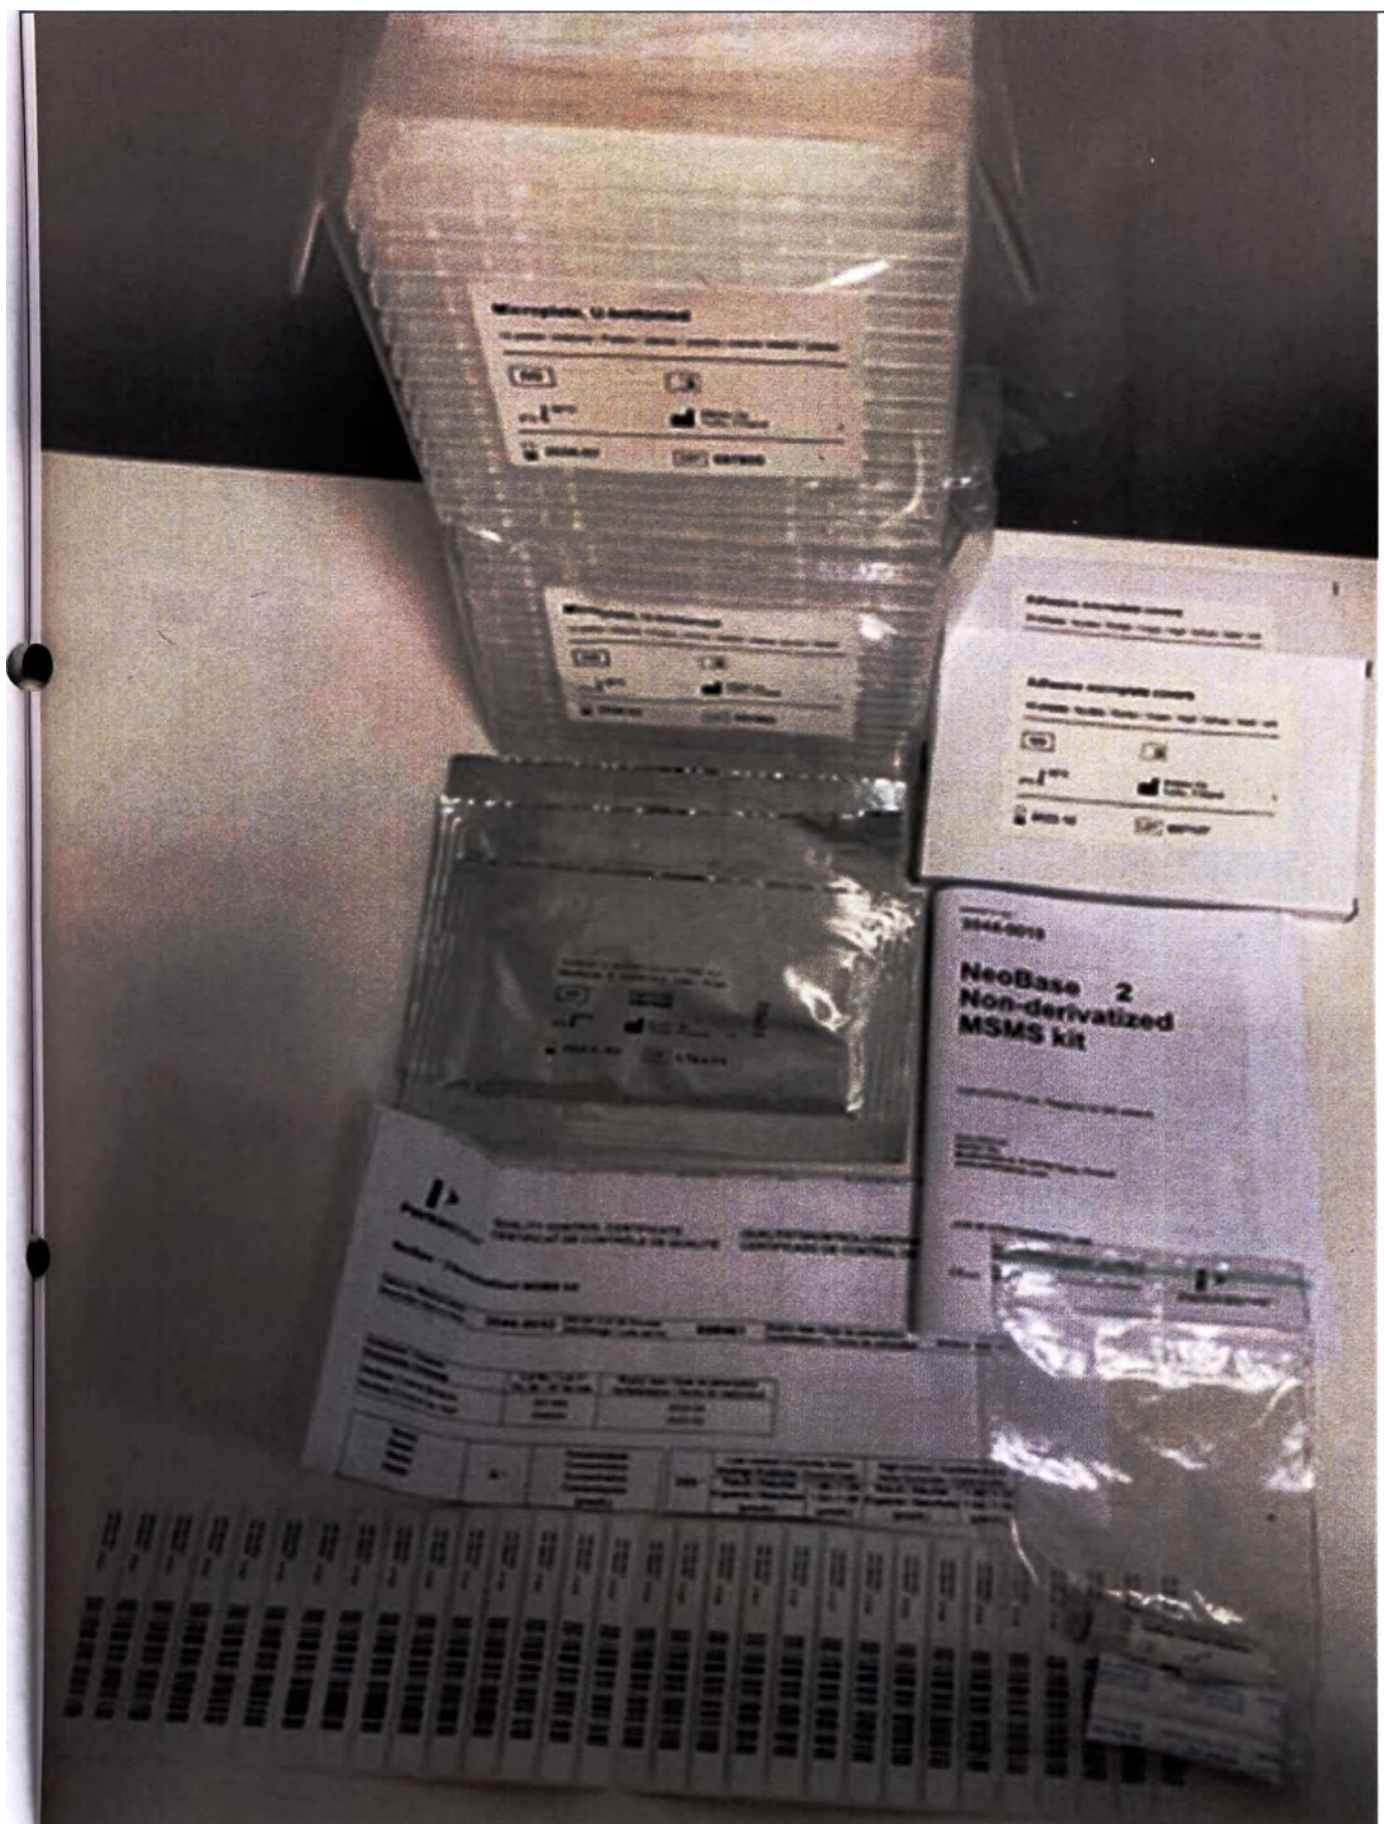


Общий вид «Набор для неderivатизированной тандемной масс-спектрометрии NeoBase 2 (NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit)»

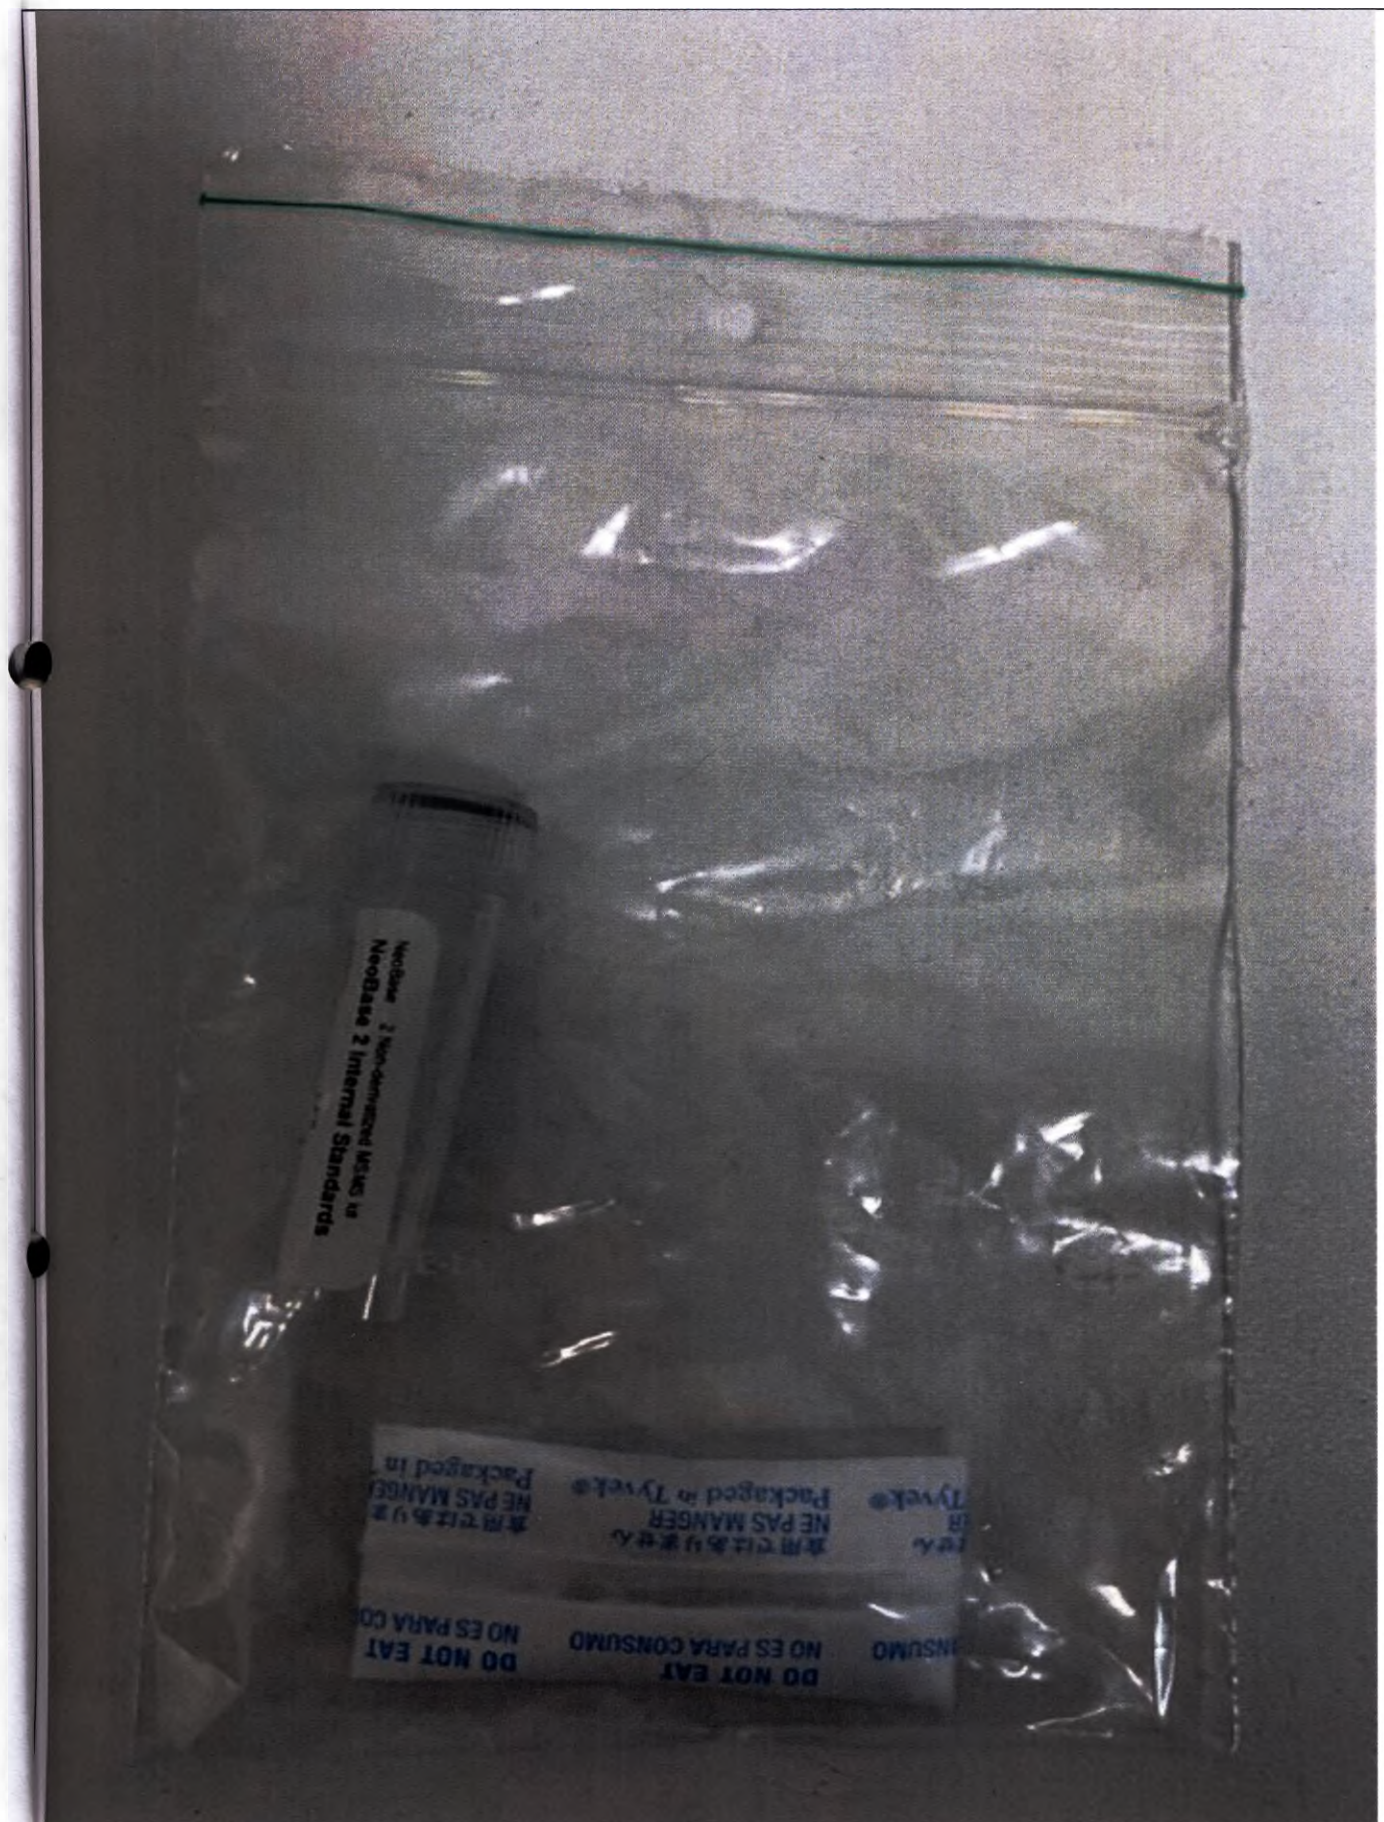

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 1. Внутренние стандарты NeoBase 2 (NeoBase 2 Internal Standards)

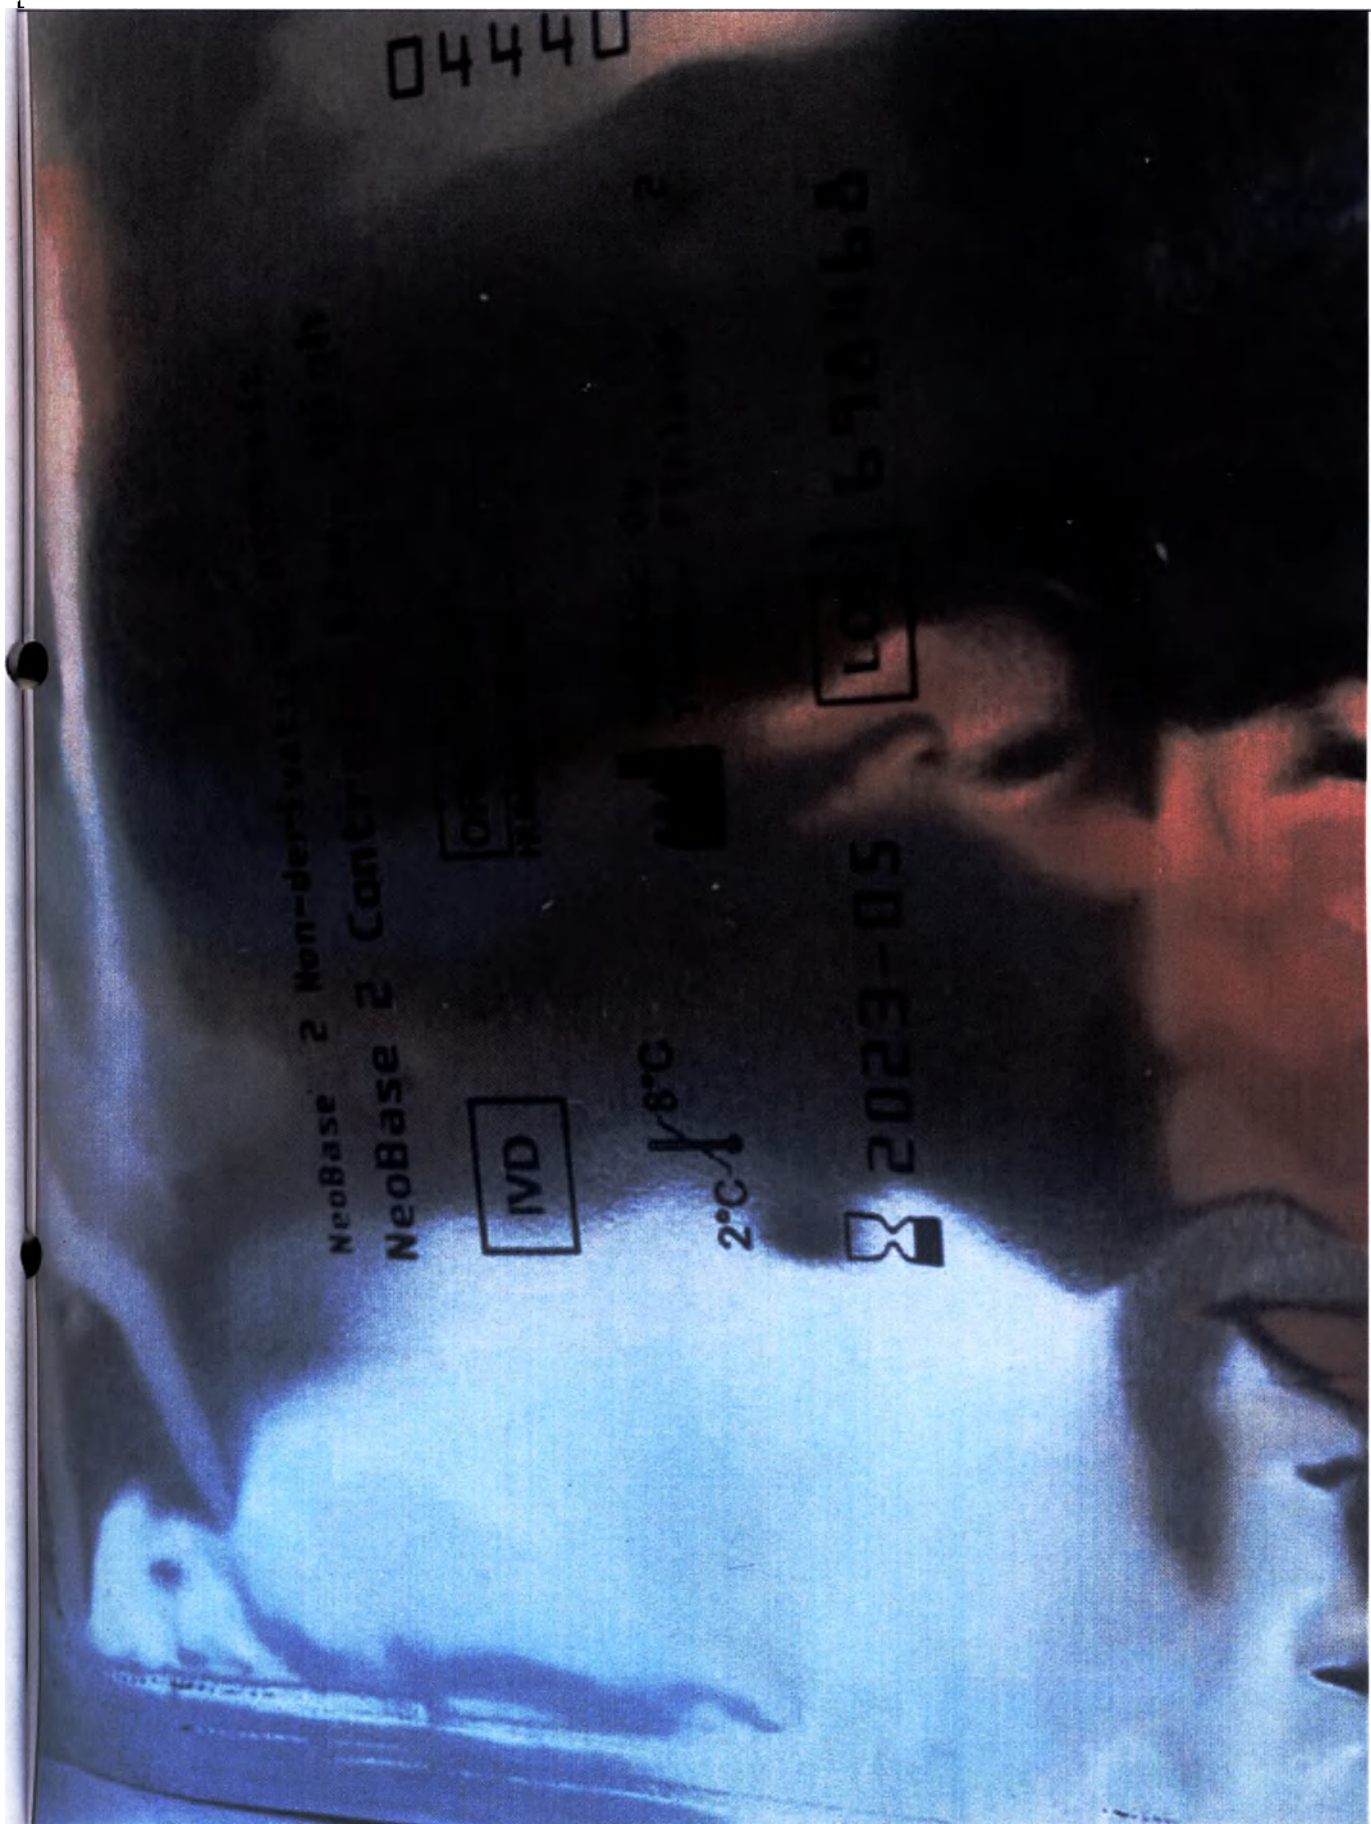

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 2. Контроли низкого, высокого уровней NeoBase 2 (NeoBase 2 Controls Low, High)

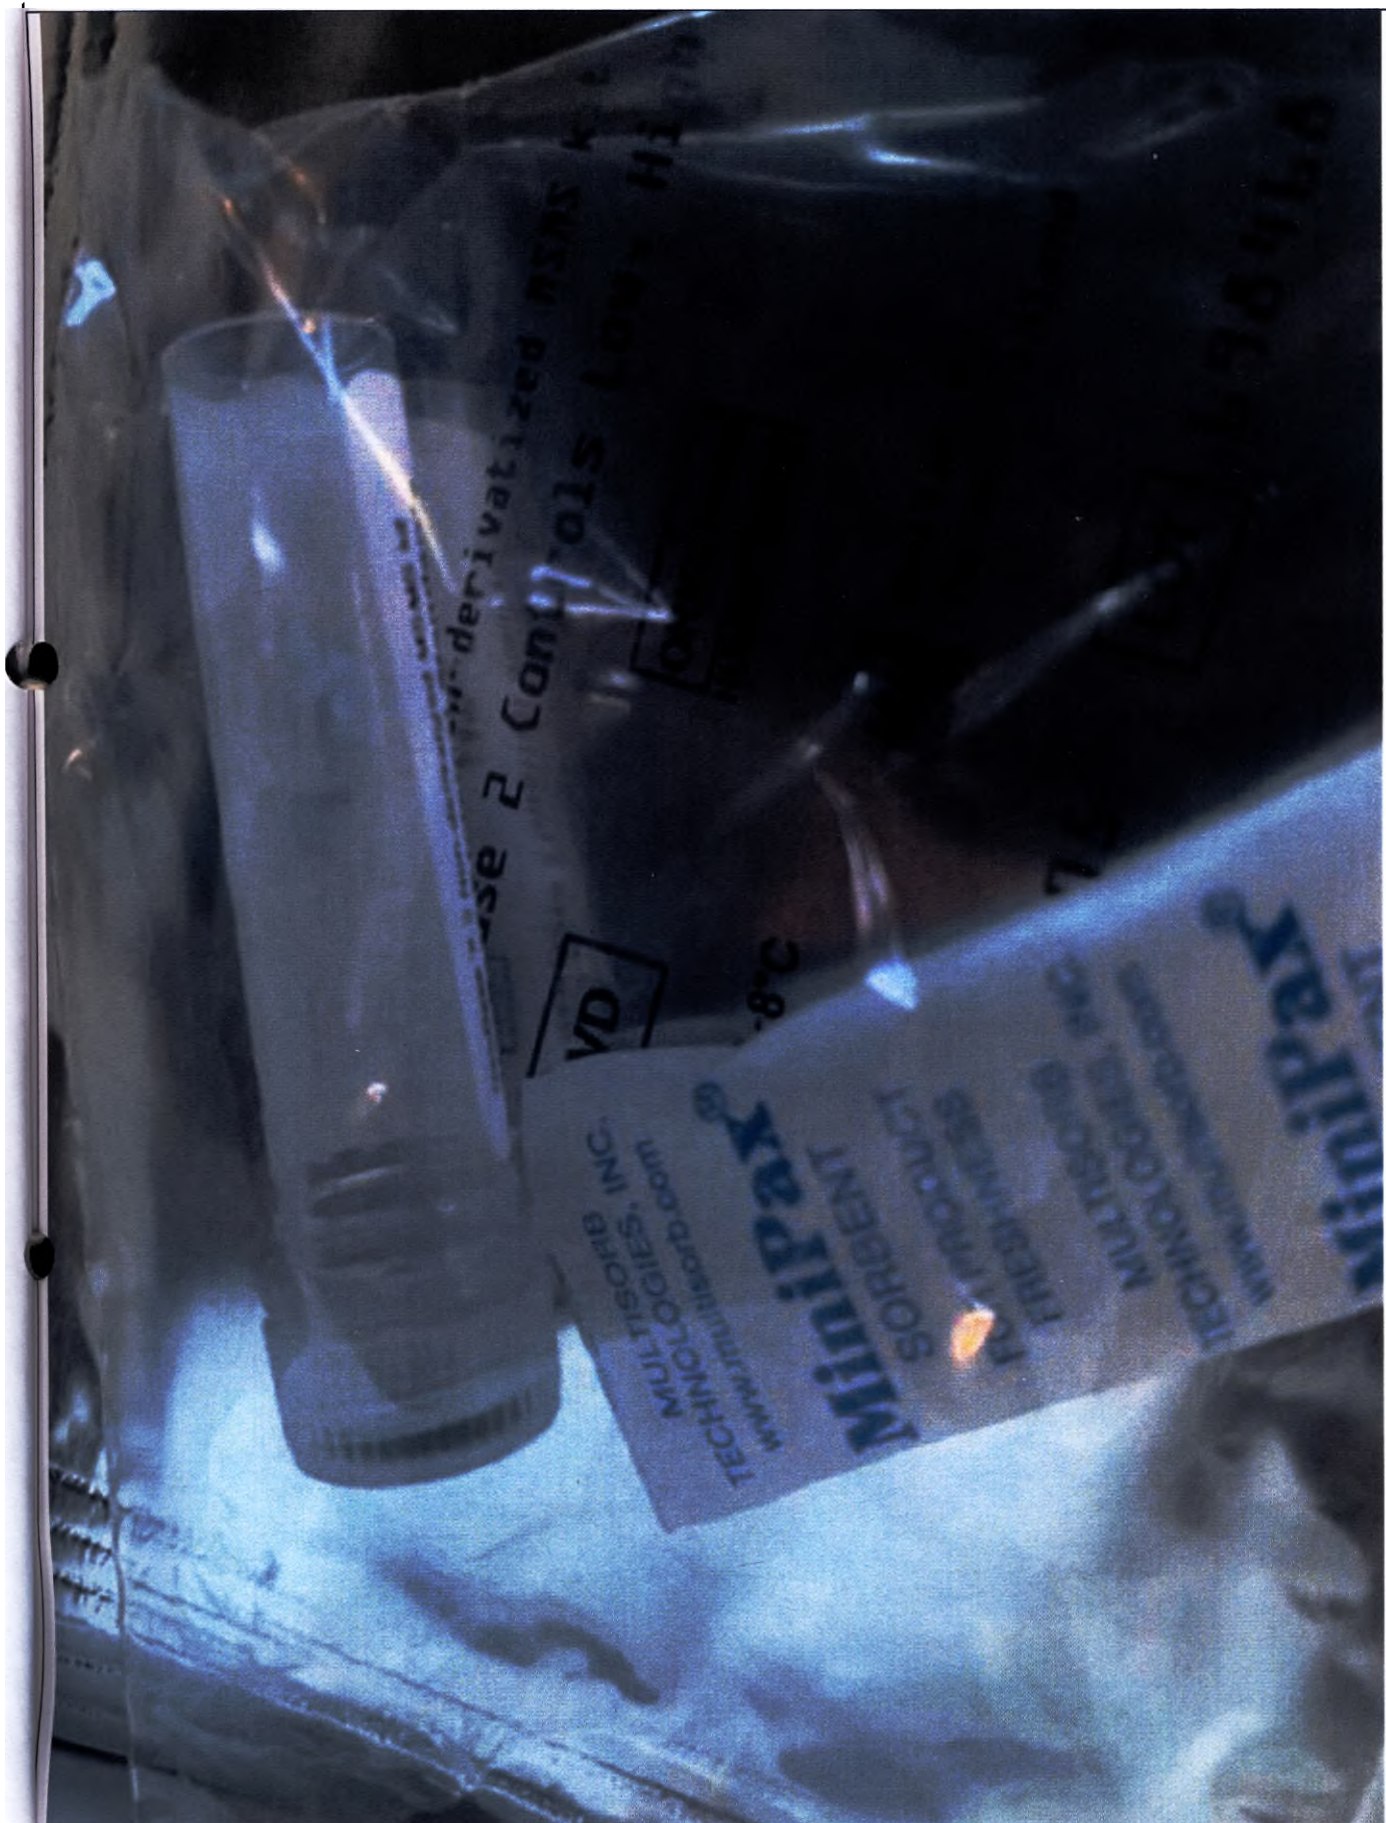

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 2. Контроли низкого, высокого уровней NeoBase 2 (NeoBase 2 Controls Low, High)

Microplate, U-bottomed

10 plates / plaques / Platten / placas / piastre / placas / plattor / plader

IVD



2°C / 30°C



Wallac Oy
Turku, Finland

1

2026-07

LOT 697805

Microplate, U-bottomed

10 plates / plaques / Platten / placas / piastre / placas / plattor / plader

IVD



2°C / 30°C



Wallac Oy
Turku, Finland

1

2026-07

LOT 697805

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 3. Микропланшеты. U-образные (Microplate. U-bottomed)

Adhesive microplate covers

10 sheets / feuilles / Karten / hojas / fogli / folhas / blad / ark

IVD



2°C / 30°C



Wallac Oy
Turku, Finland

1



2023-12

LOT

697127

Adhesive microplate covers

10 sheets / feuilles / Karten / hojas / fogli / folhas / blad / ark

IVD



2°C / 30°C



Wallac Oy
Turku, Finland

1




2023-12

LOT

697127

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 4. Клеящиеся пленки для микропланшетов
(Adhesive microplate covers)

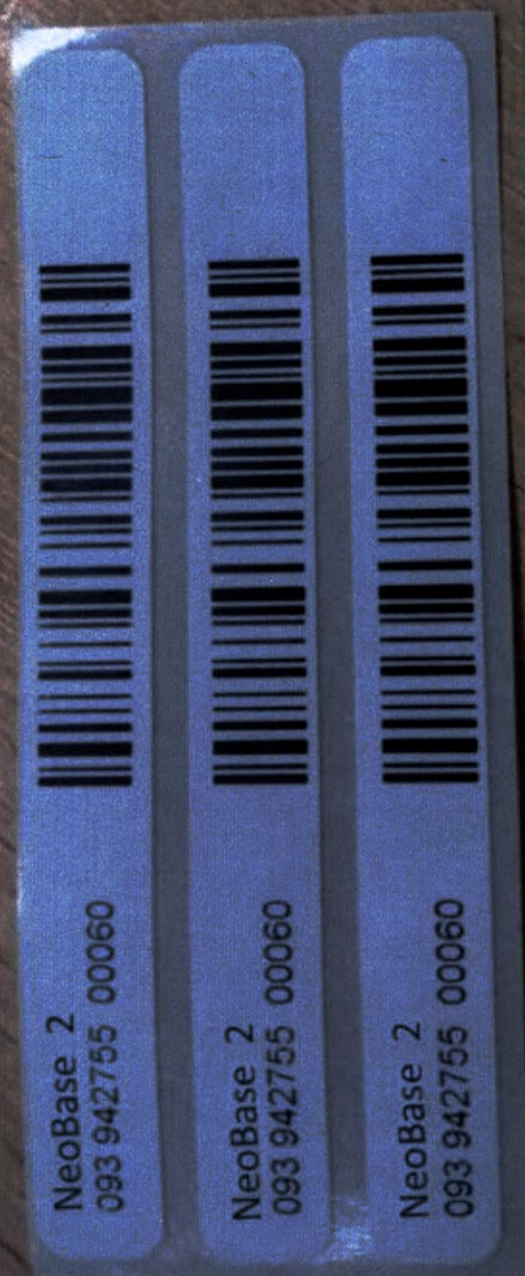

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 5. Этикетки со штрихкодами для планшетов (Barcode labels for the plates)

PerkinElmer
NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit
 QUALITY CONTROL CERTIFICATE
 CERTIFICAT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
 QUALITÄTSKONTROLLZERTIFIKAT
 CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

Kit lot / Lot de trousses Kits-Charges / Lote del kit	3044-0010	698461	Expiry date / Date de péremption Verfallsdatum / Fecha de caducidad	2023-02-28
--	-----------	--------	--	------------

Component / Composant Komponente / Componente	Lot No. / Lot n° Ch. Nr. / N° de lote	Expiry date / Date de péremption Verfallsdatum / Fecha de caducidad
NeoBase 2 Intra Standards	697908	2023-04
NeoBase 2 Control Low, High	698054	2023-02

Standard Standard Standard Estándar	IS *	Concentration Concentration Konzentration Concentración ($\mu\text{mol/L}$)	DBS *	Low control / Contrôle faible Niedrige Kontrolle / Control bajo Result / Résultat Ergebnis / Resultado ($\mu\text{mol/L}$)	High control / Contrôle élevé Hohe Kontrolle / Control alto Result / Résultat Ergebnis / Resultado ($\mu\text{mol/L}$)
	SE 1			1 SD / 1 DS 1 SA / 1 DE	1 SD / 1 DS 1 SA / 1 DE

Компонент NeoBase 2 Non-derivatized MSMS kit – 6. Сертификат контроля качества партии (Lot-specific quality control certificate)

Прошито и скреплено печатью

13

листов

Генеральный директор АО «Приборы»

Ефимов Л.Н.

