

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения
исследований in vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической
идентификации аналитов с применением tandemной масс-спектрометрии и ультра
высокоэффективной жидкостной хроматографии»**

Официальный производитель:

«Валлак Ою» (Wallac Oy)
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)
Тел: 358-(0)2-267 8111
Факс: 358-(0)2-267 8357

Наименование и адрес места производства:

«Валлак Ою» (Wallac Oy),
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)

Уполномоченный представитель в ЕАЭС:

Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
109028, г. Москва, Певческий переулок, дом 4, строение I, помещение I, комната 10
Телефон/факс: 8 (495) 937-45-94/ 8 (495) 937-45-92
Адрес электронной почты: info@pribori.com


Утверждено:

Полное имя Ефимов Леонид Николаевич
Должность: Генеральный директор
Компания: Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
Подпись:
Дата:
Печать:





1. Масс-спектрометр QSight 225 MD (QSight 225 MD Mass spectrometer)

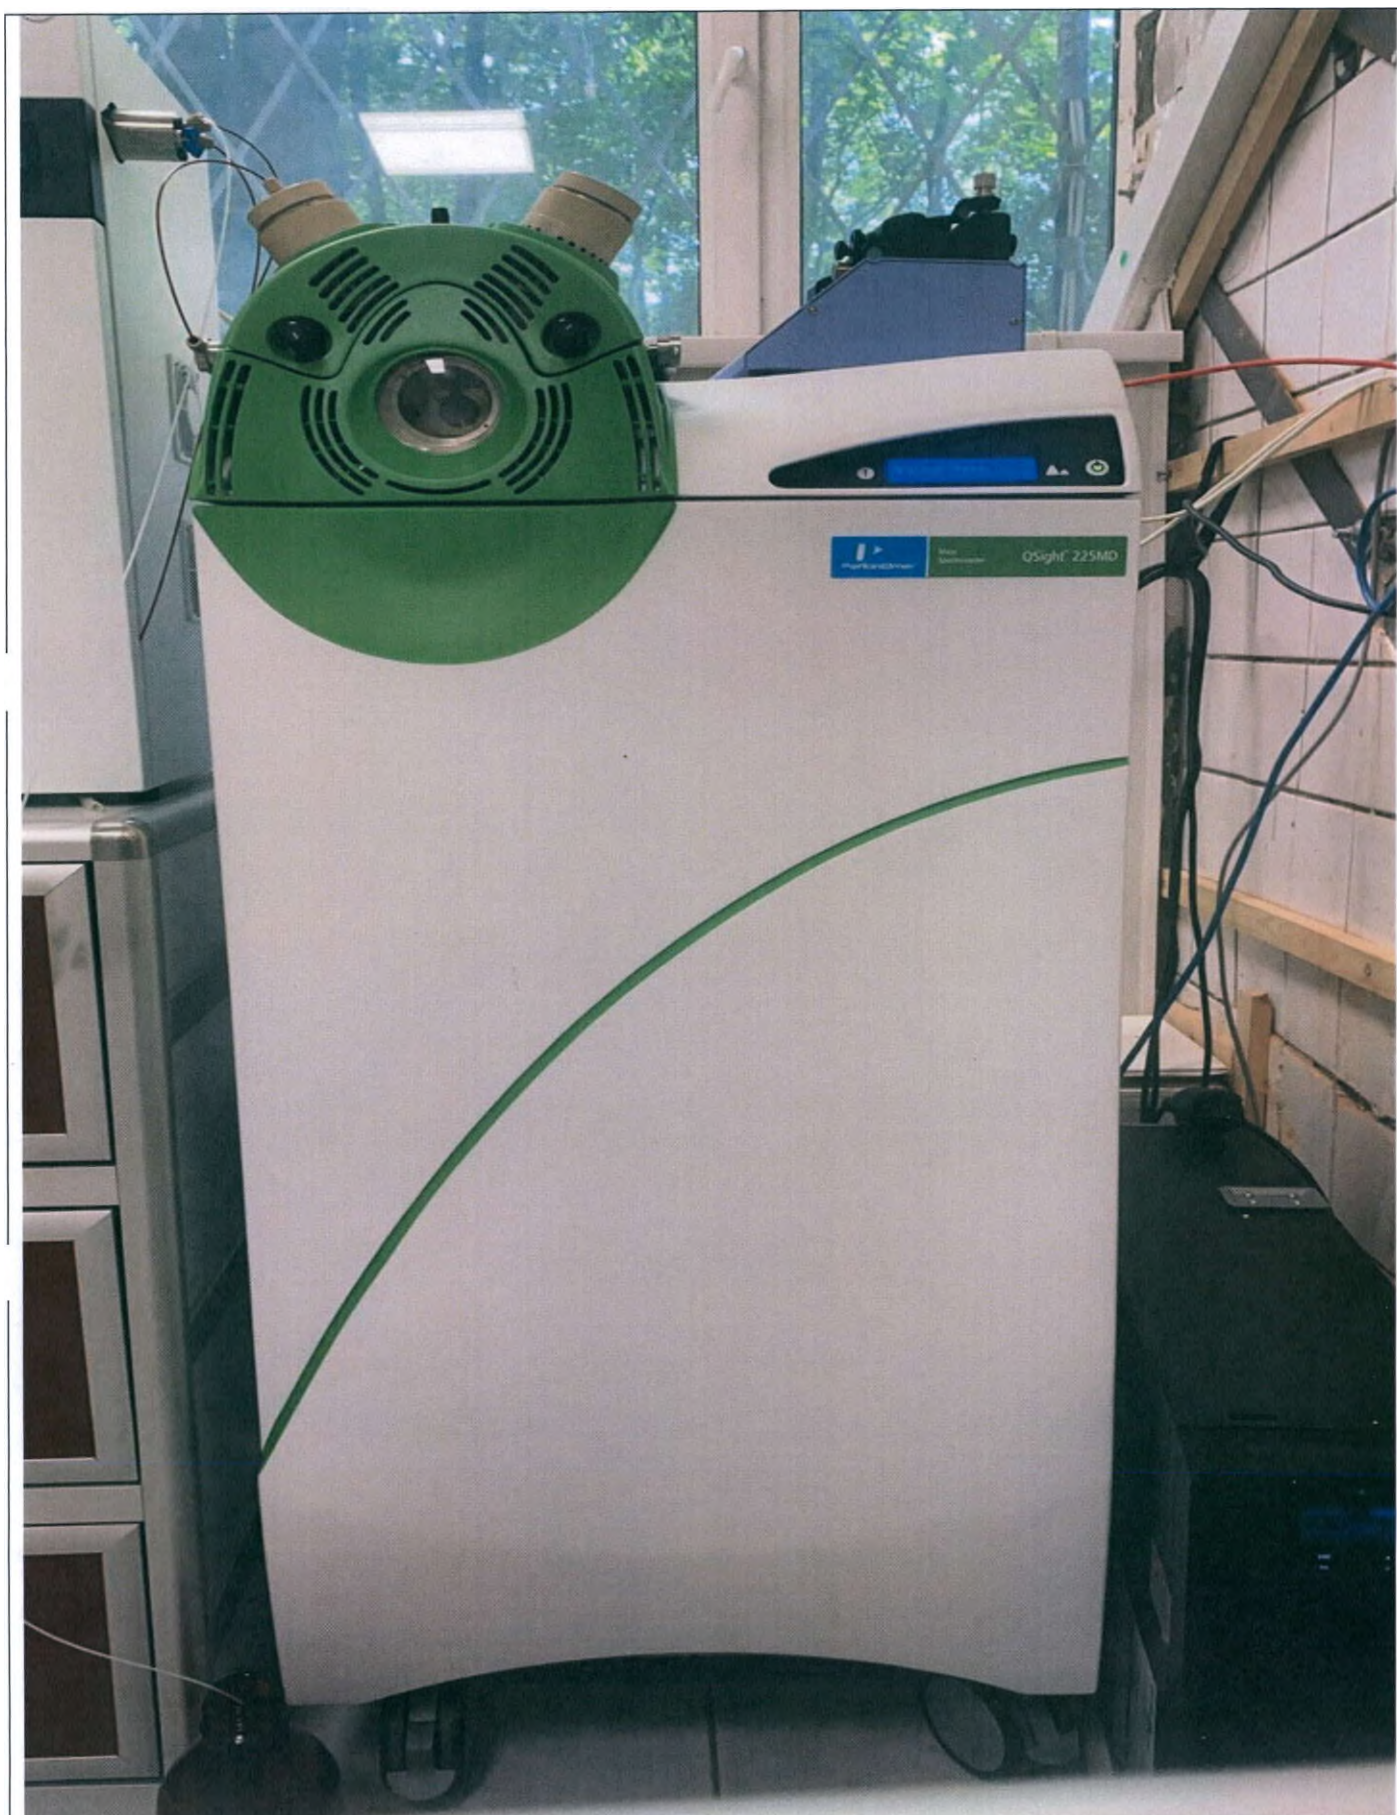

1. Масс-спектрометр Q-Sight 225 MD (Q-Sight 225 MD Mass spectrometer)

1. Масс-спектрометр QSight 225 MD (QSight 225 MD Mass spectrometer)



USER WARNING

INSTRUMENT TO BE
OPENED BY QUALIFIED
PERKINELMER
PERSONNEL ONLY

AVERTISSEMENT À L'UTILISATEUR

INSTRUMENT À OUVRIR
UNIQUEMENT PAR DU
PERSONNEL QUALIFIÉ
DE PERKINELMER



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSiht MD (QSiht MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSiht MD (QSiht MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)



3. Насос для УВЭЖХ QSight 225 MD (QSight MD UHPLC Pump)



3. Насос для УВЭЖХ QSight 225 MD (QSight MD UHPLC Pump)

Q Sight MD UHPLC Pump



PerkinElmer

Q Sight 225 MD UHPLC Screening System

REF

11700161

SN

210072



100-240V~ 450VA 50/60Hz

3. Насос для УВЭЖХ Q Sight 225 MD (Q Sight MD UHPLC Pump). Маркировка



3. Насос для УВЭЖХ QSight 225 MD (QSight MD UHPLC Pump). Маркировка



4. Колоночный термостат QSiht MD (QSiht Column Oven MD)




4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD)




4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD)



4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD). Маркировка

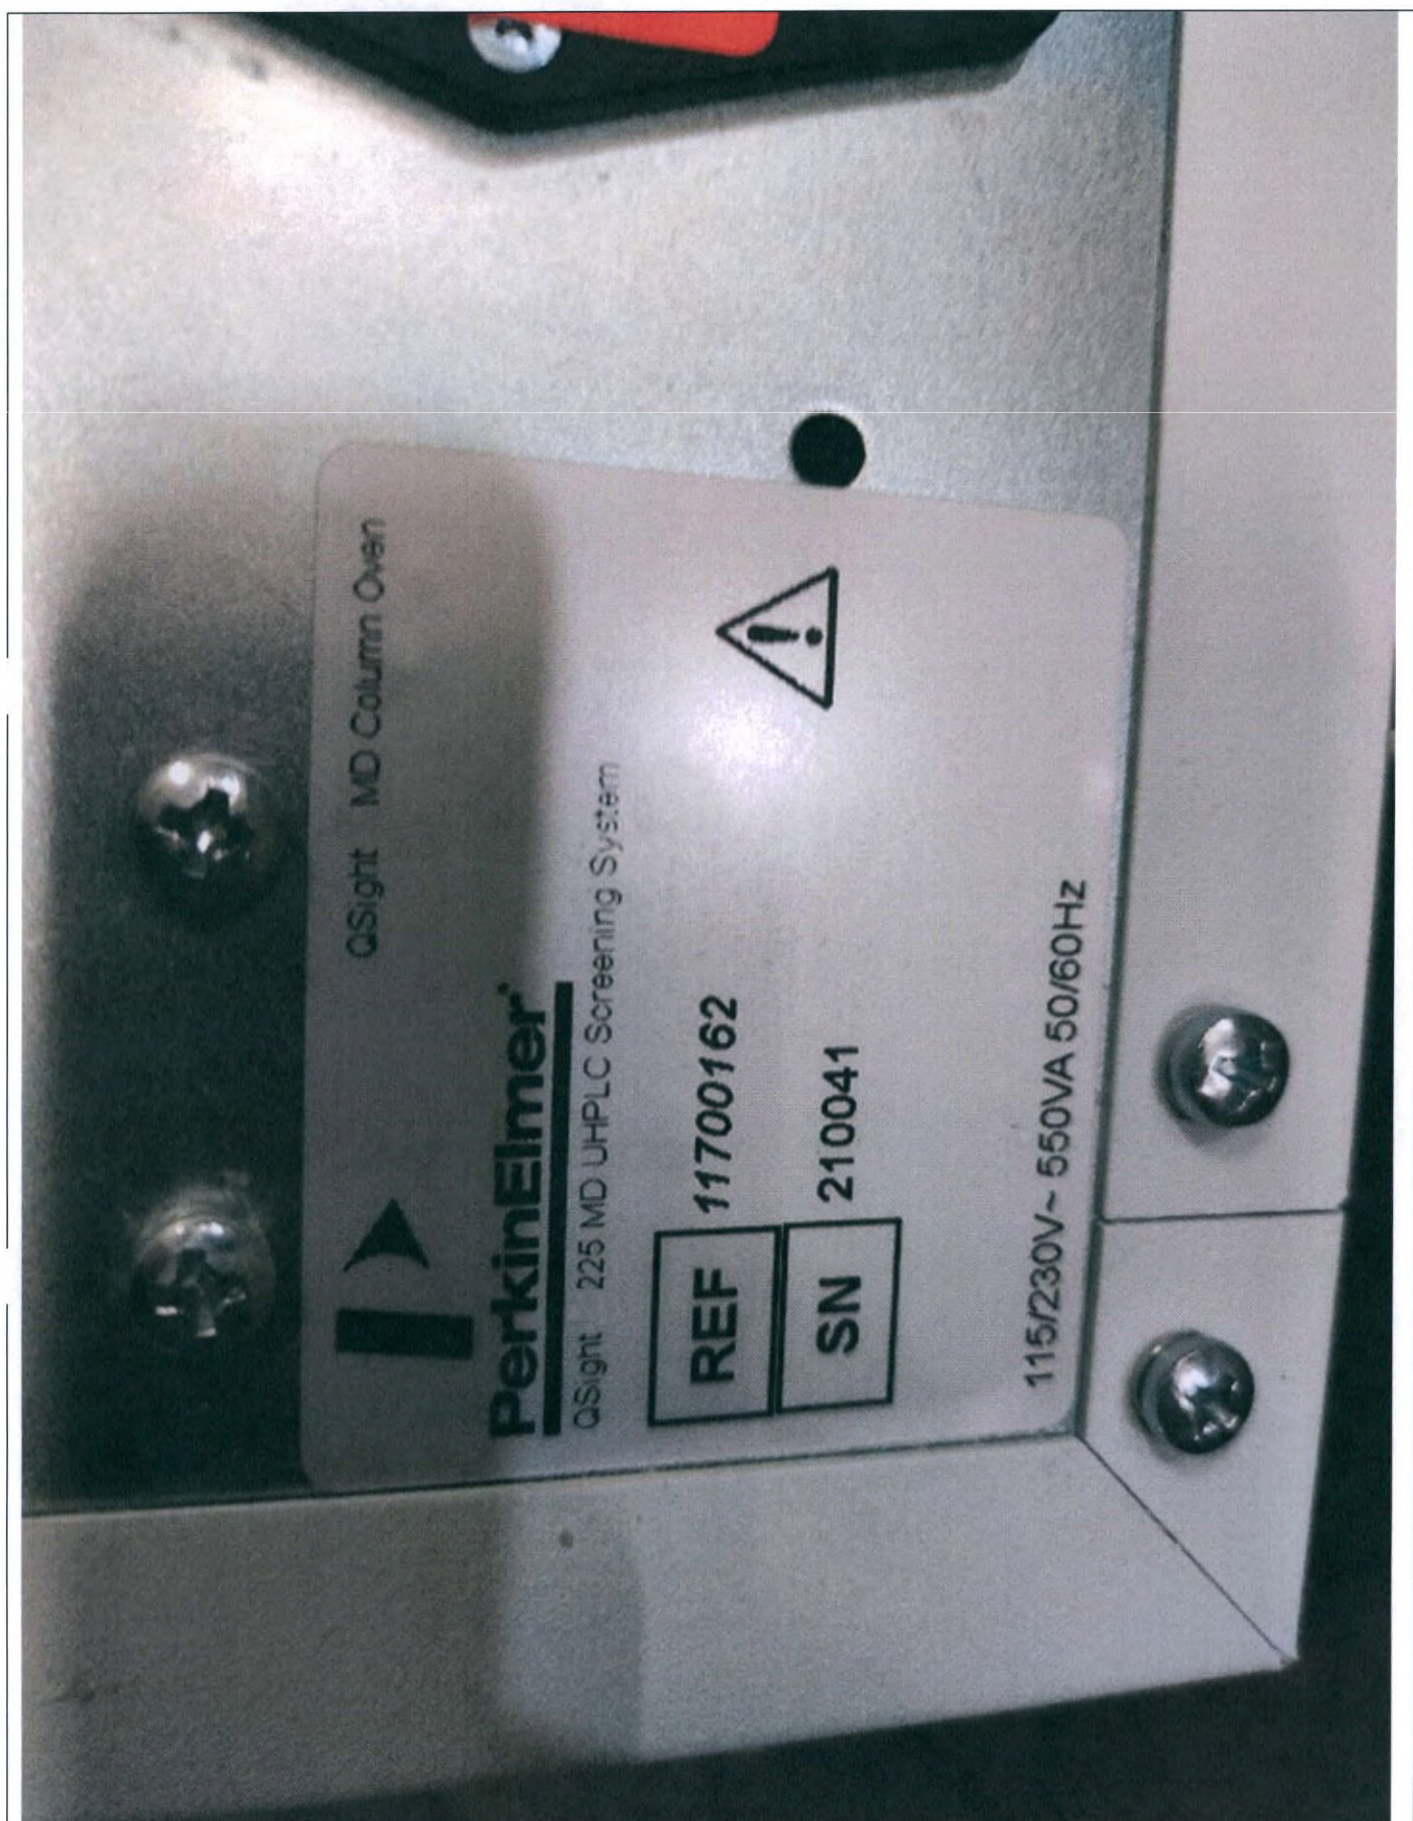

4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD). Маркировка

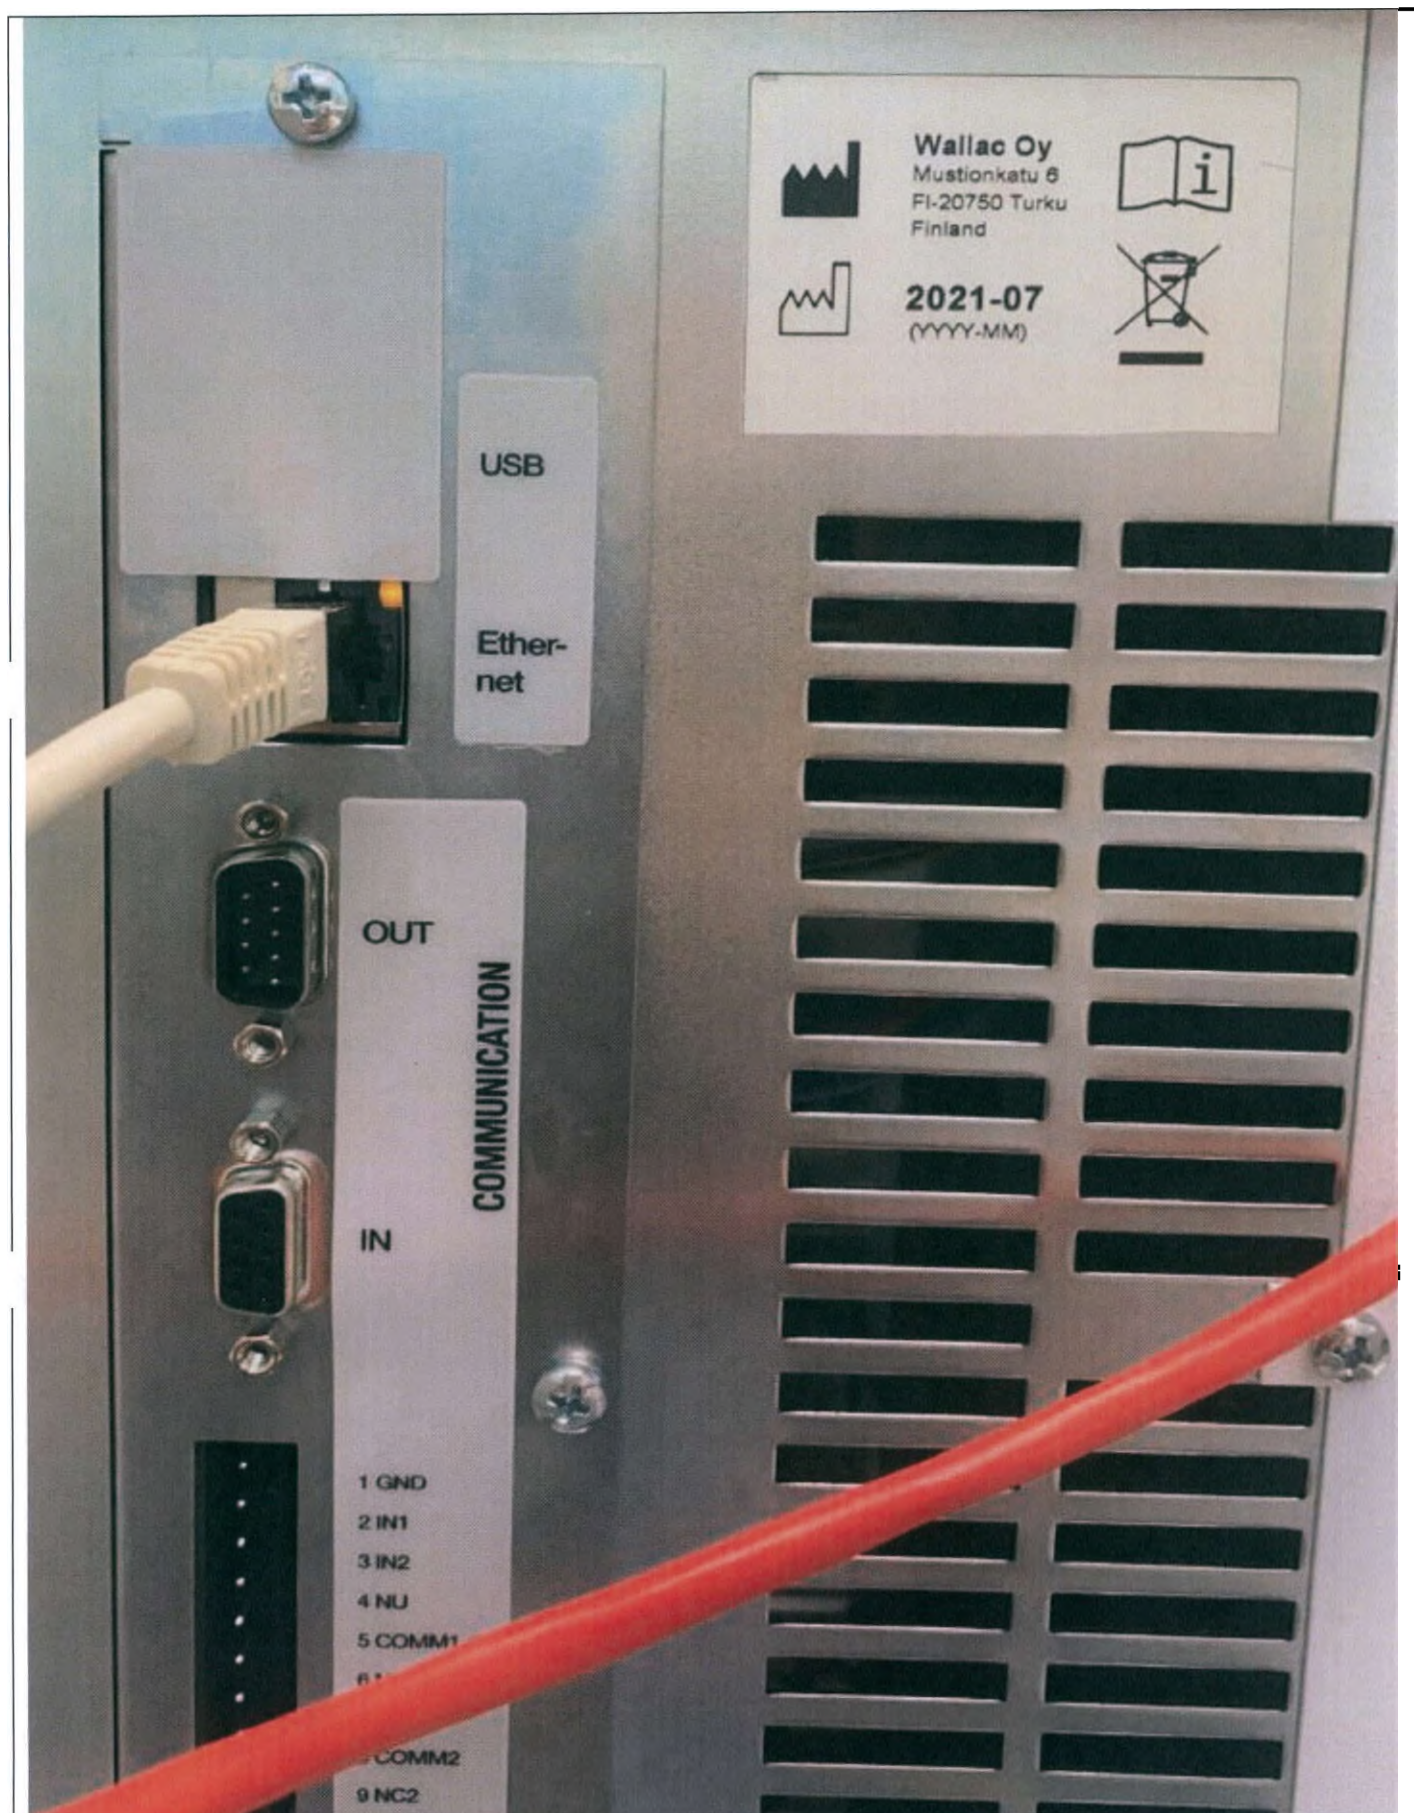

4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD). Маркировка

Home Method Development LC Method Batch List Creator Batch Acquisition Queue Quantitation Method Editor Sample Parameters Settings

ADVANCEDUSER
(Admin)

LOG OUT

Batch List Creator

Generate or import your sample list.

Batch Acquisition Queue

Run samples and manage batch run order.

Quant

System state is **Ready**

MS Q51418 725 MD Mass Spectrometer **Ready**

AS Q51418 MD UHPLC Autosampler **Ready**

Pump Q51418 MD UHPLC Pump **Ready**


Oven Q51418 MD Column Oven **Ready**

MODES Stop Start

SERIAL NUMBER IP ADDRESS PORT

Status: Ready Running from Batch: out of 1 Plate Q

5. Программное обеспечение QSight Simplicity 3Q MD

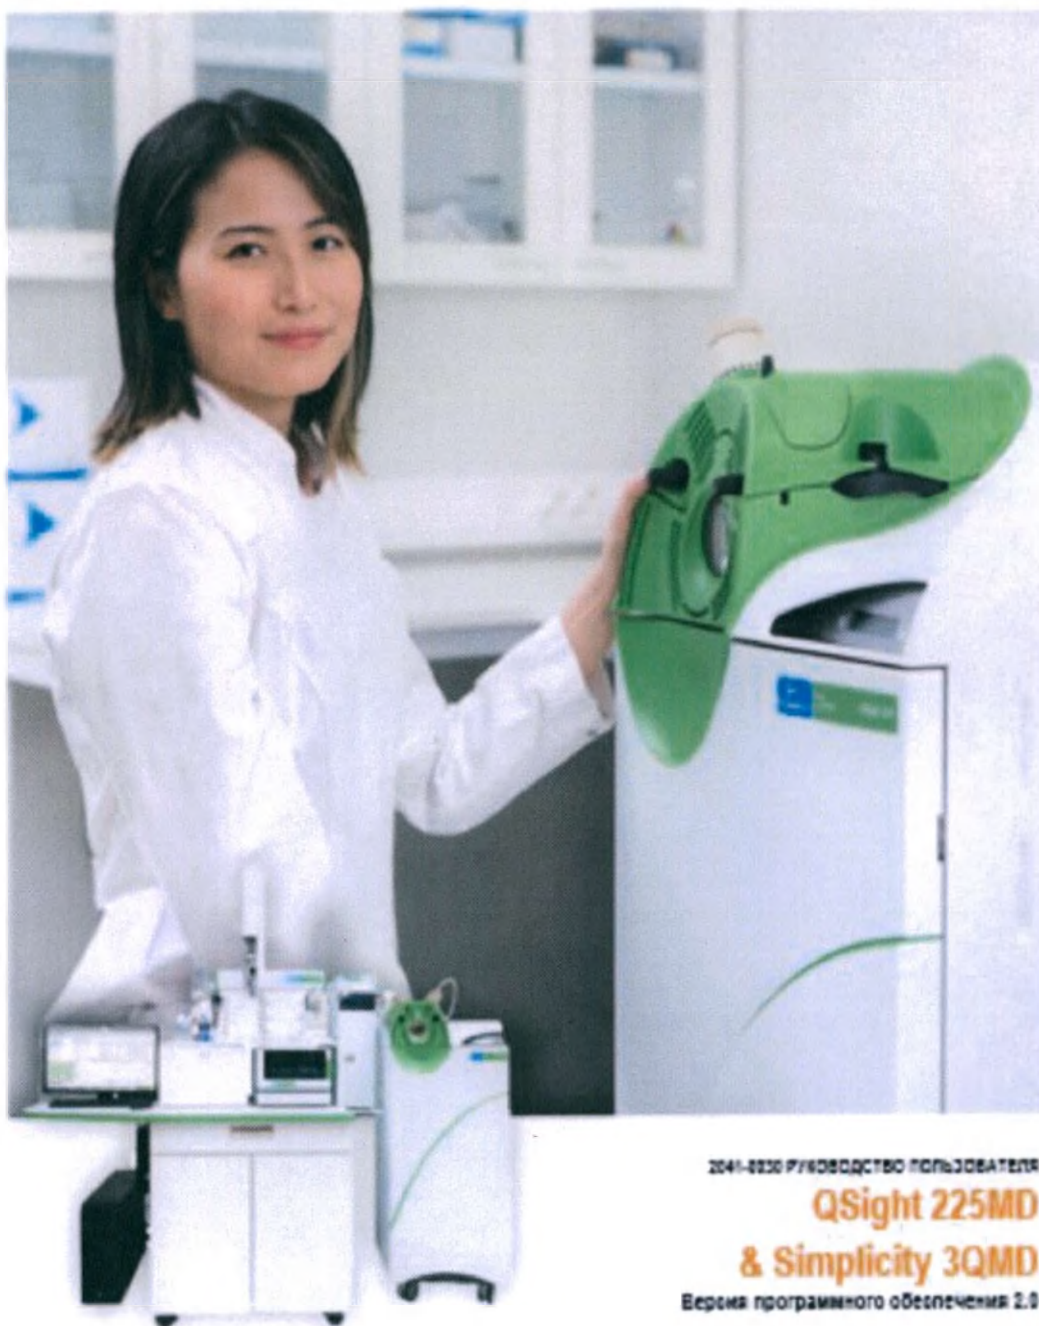

2041-8230 Руководство пользователя
QSight 225MD
& Simplicity 3QMD
 Версия программного обеспечения 2.0

CE IVD

2041-9070-04
 Февраль 2022 г.



6. Руководство пользователя



7.1 Набор желтых виал объемом 1,5 мл, скрепленных с крышкой, септированных (KIT-1.5 mL VIAL AMBER W/BONDED CAP/SEPTA)




7.2 Хроматографическая обращеннофазная C18 колонка Brownlee, размер частиц 2,7 мкм, размер колонки 2,1х50 мм. (COL Brownlee SPP 2.7 UM C18 2.1 X 50MM)




7.3 Предколонка обращеннофазная C18, размер частиц 2,7 мкм, размер колонки 2,1x5 мм (GUARD-SPP 2.7UM C18 2.1 X 5MM(PK3))




7.4 Держатель для предколонки Brownlee (HOLDER-SSP BROWNLEE GUARD)

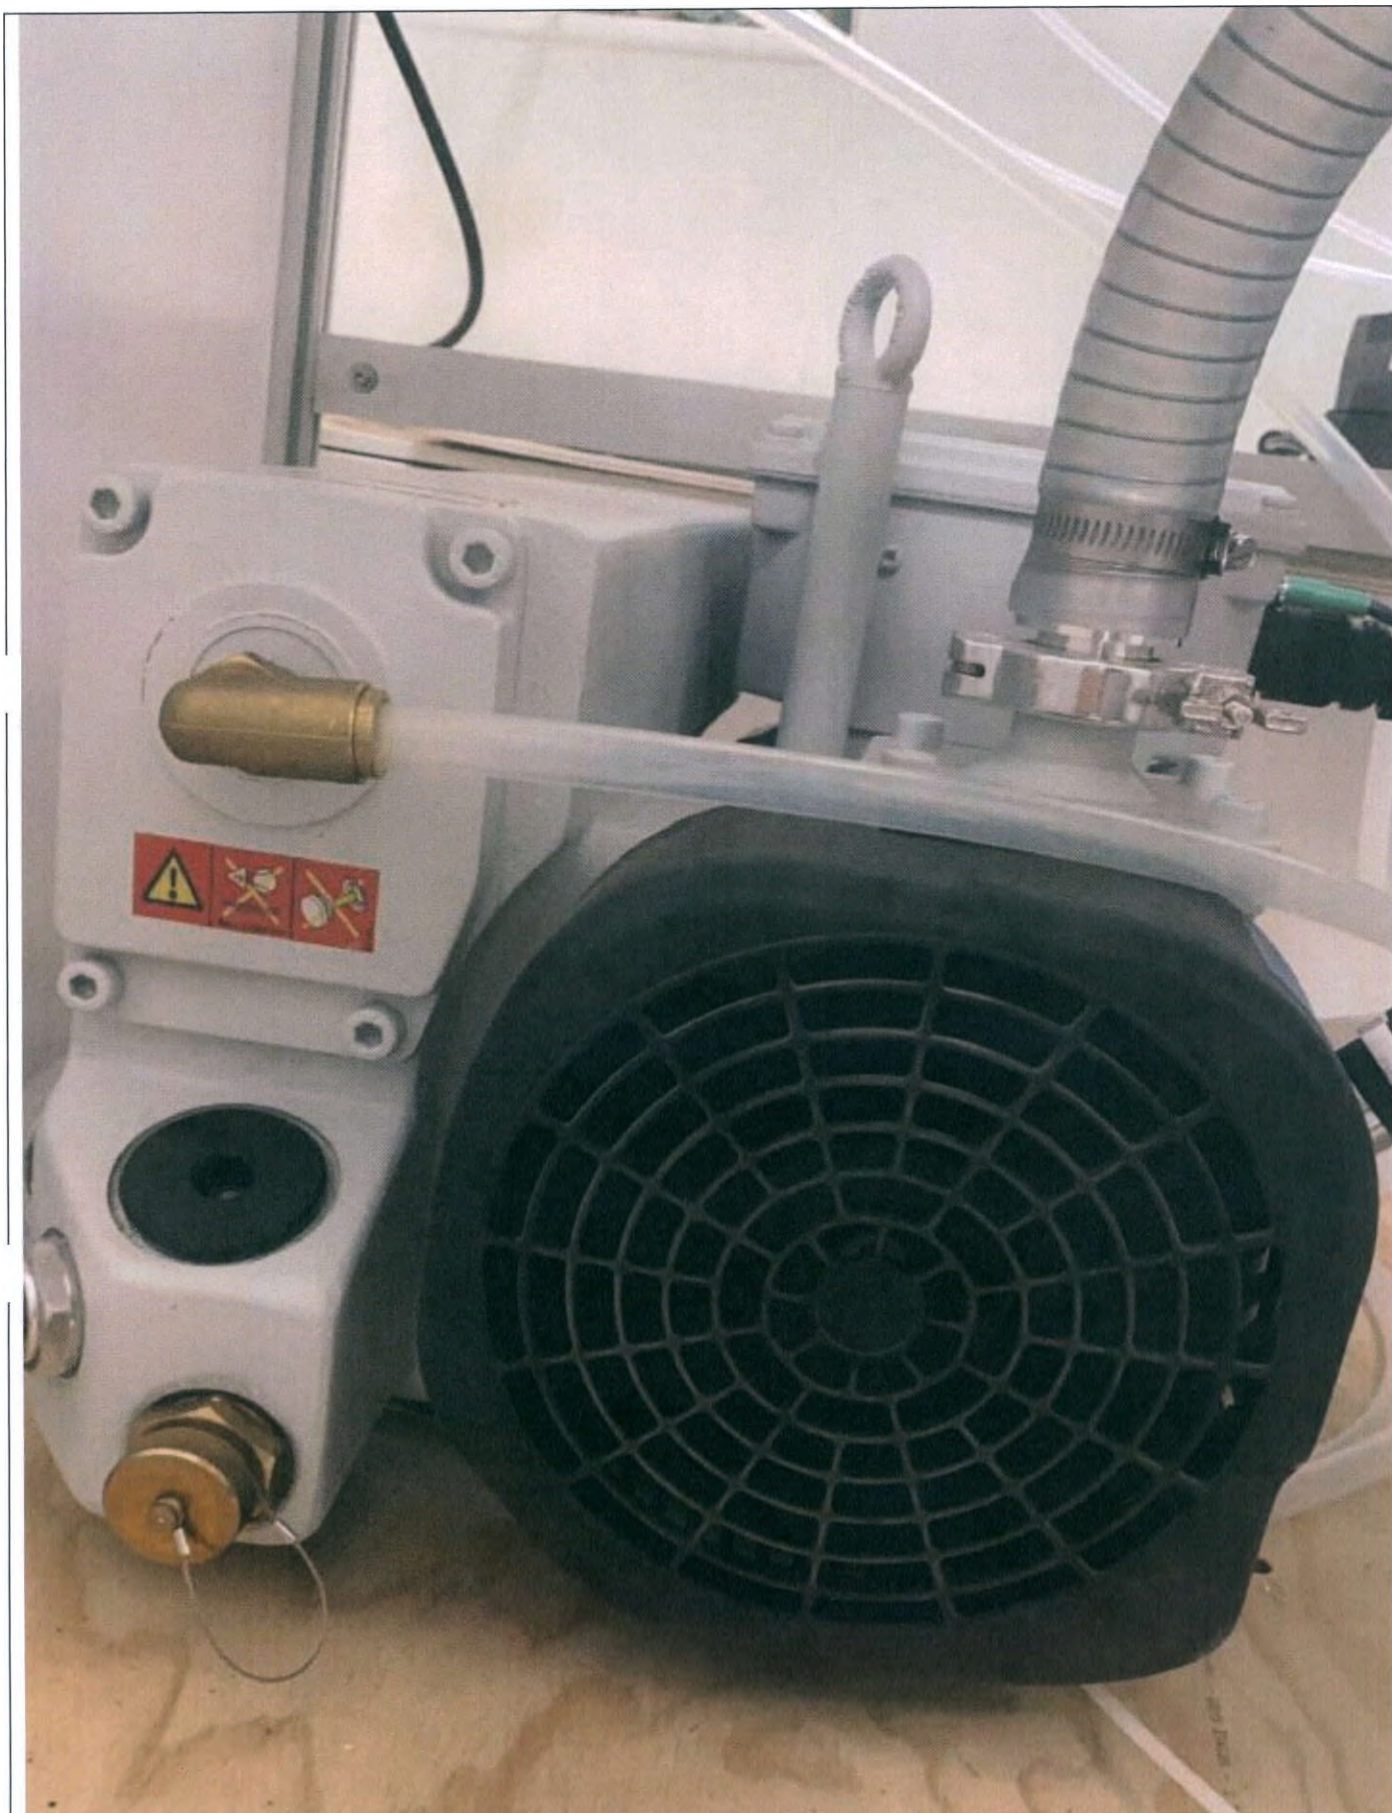

8. Би-роторный лопастной насос SV 40 (SV40 BI Rotary Vane Pump)

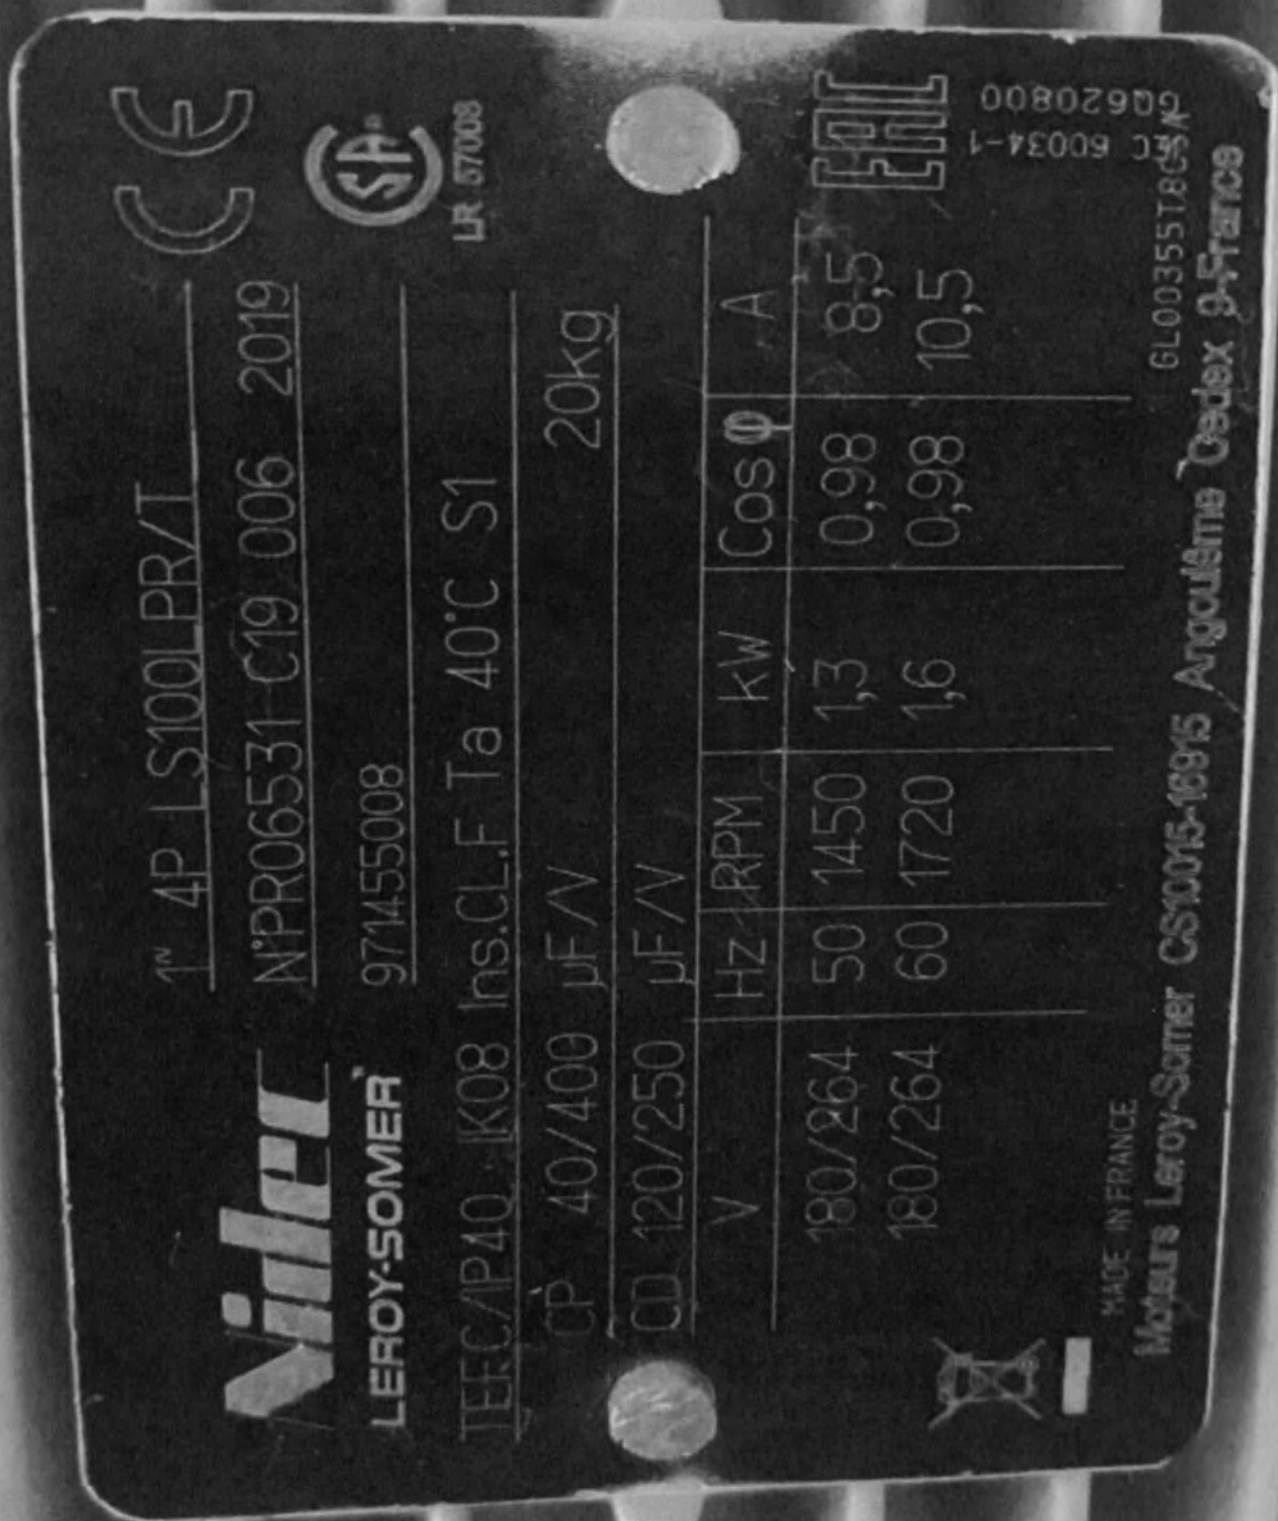

8. Би-роторный лопастной насос SV 40 (SV40 BI Rotary Vane Pump)

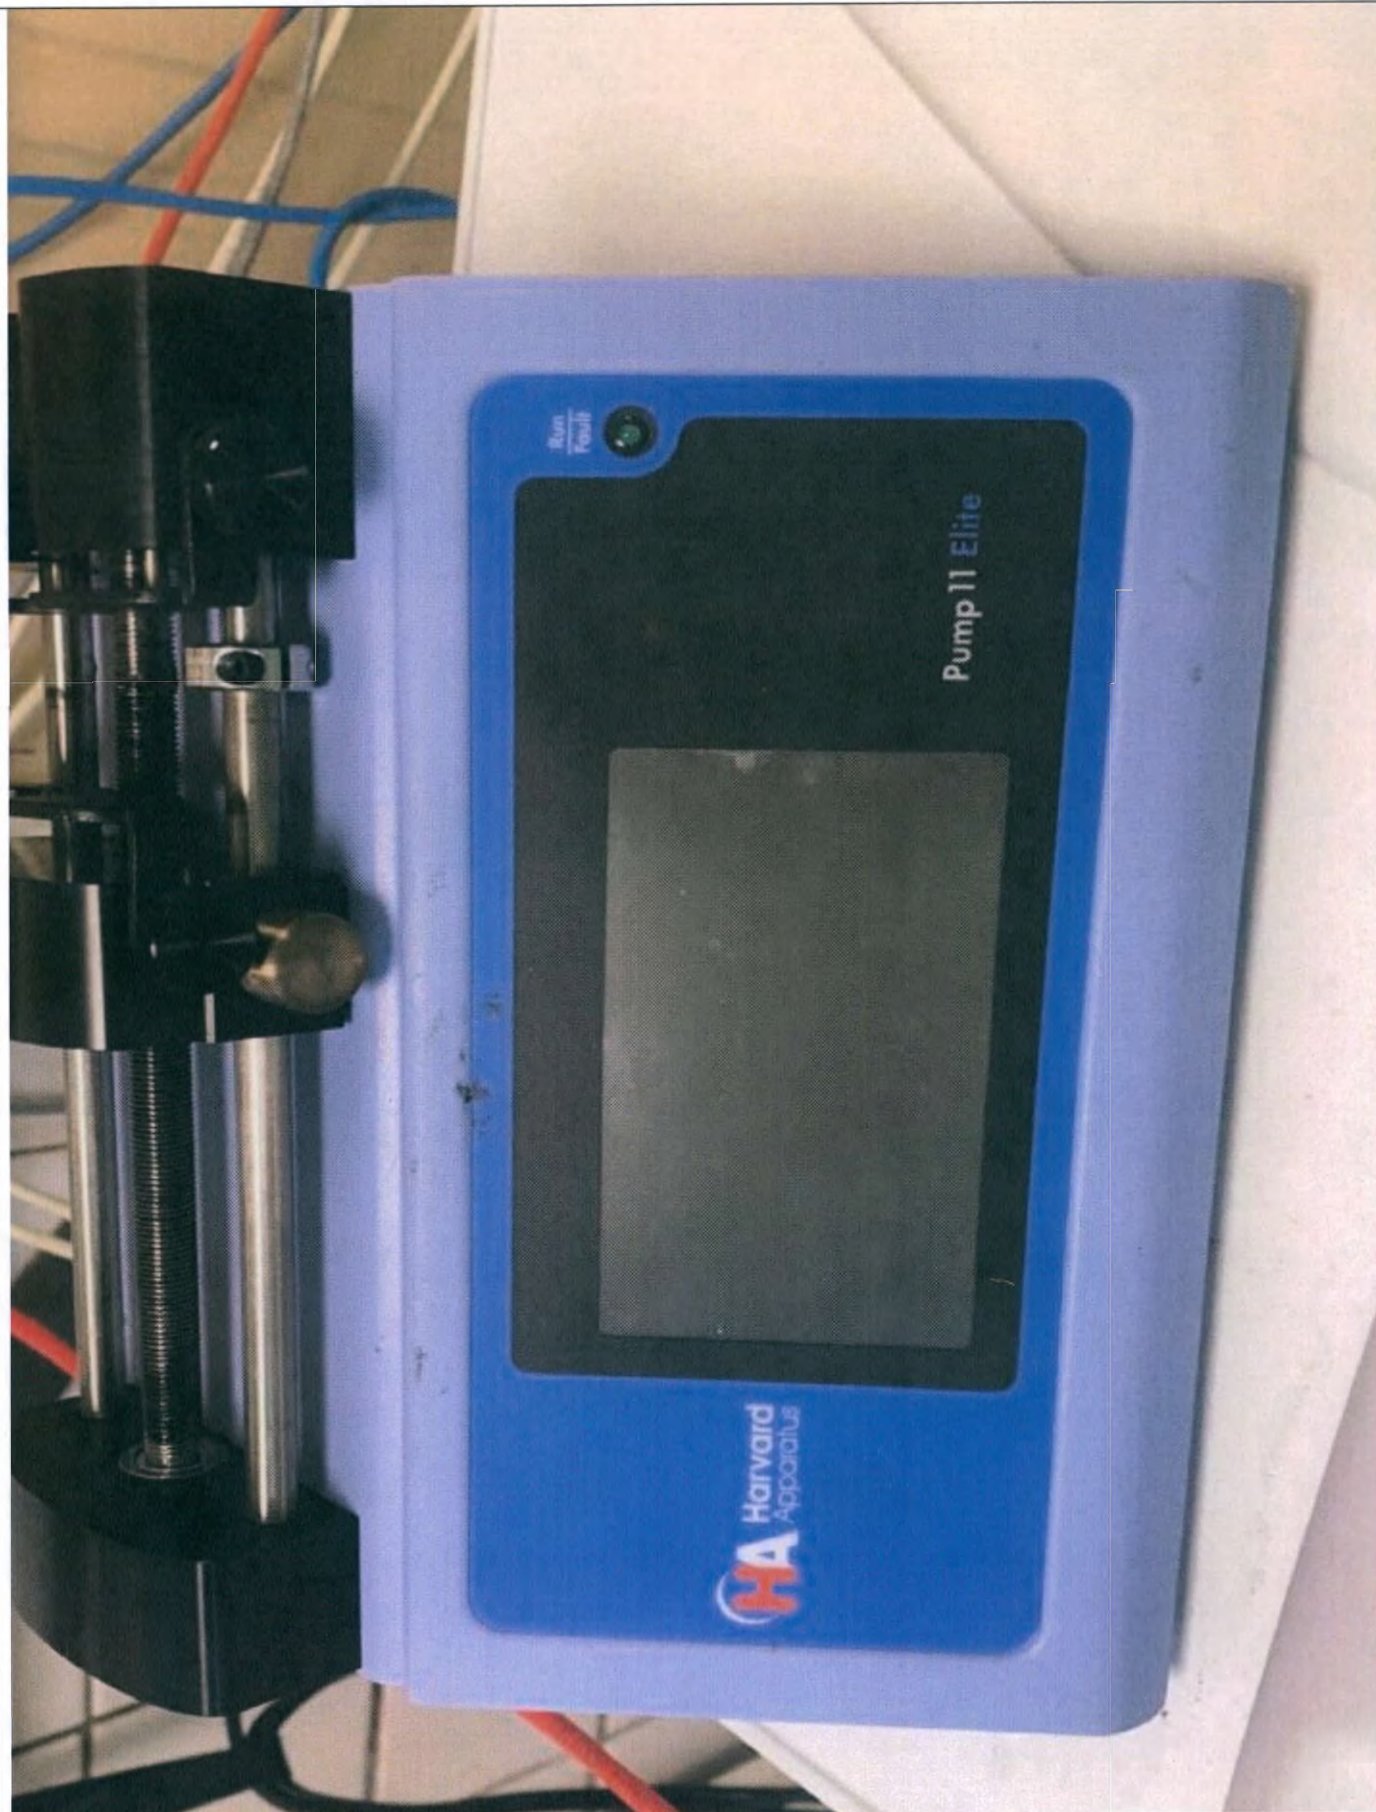

9. Стандартный инфузионный шприцевой насос 11 ELITE (STD- INFUSION PUMP 11 ELITE SYRINGE)




9. Стандартный инфузионный шприцевой насос 11 ELITE (STD- INFUSION PUMP 11 ELITE SYRINGE)


10. Комплект для жидкостной хроматографии/инфузии (LC/Infusion Accessories Kit)



10.1 Шприц, объемом 1 мл с фиксированным наконечником, Hamilton (Syringe, 1 mL Fixed Tip, Hamilton)

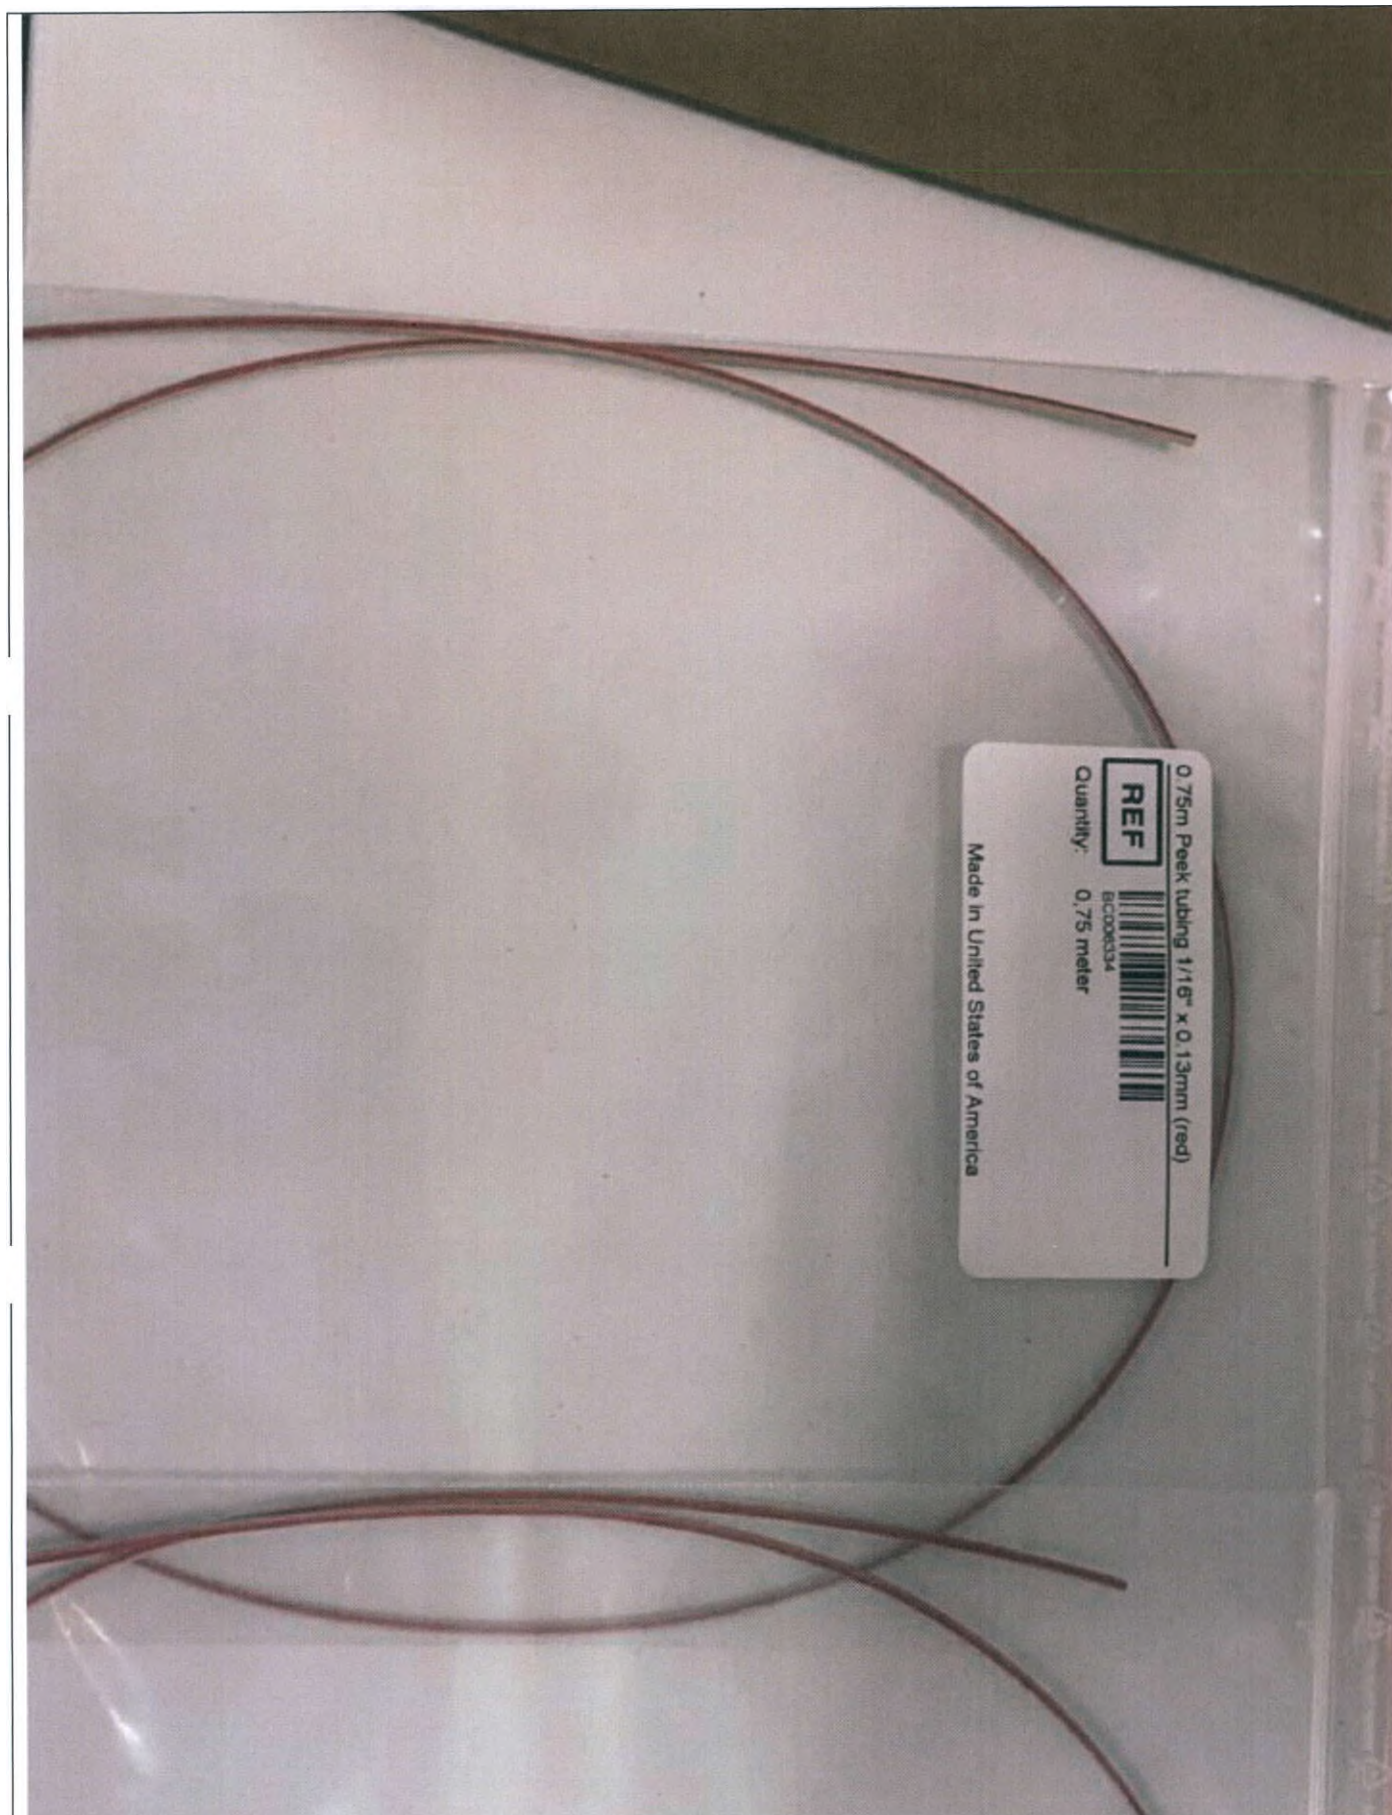

10.2. Капилляр, наружный диаметр 1/16 дюйма, внутренний диаметр 0,005 дюйма, ПЭЭК, красный (Tubing, 1/16 OD x 0.005 ID, PEEK Red), 300 см

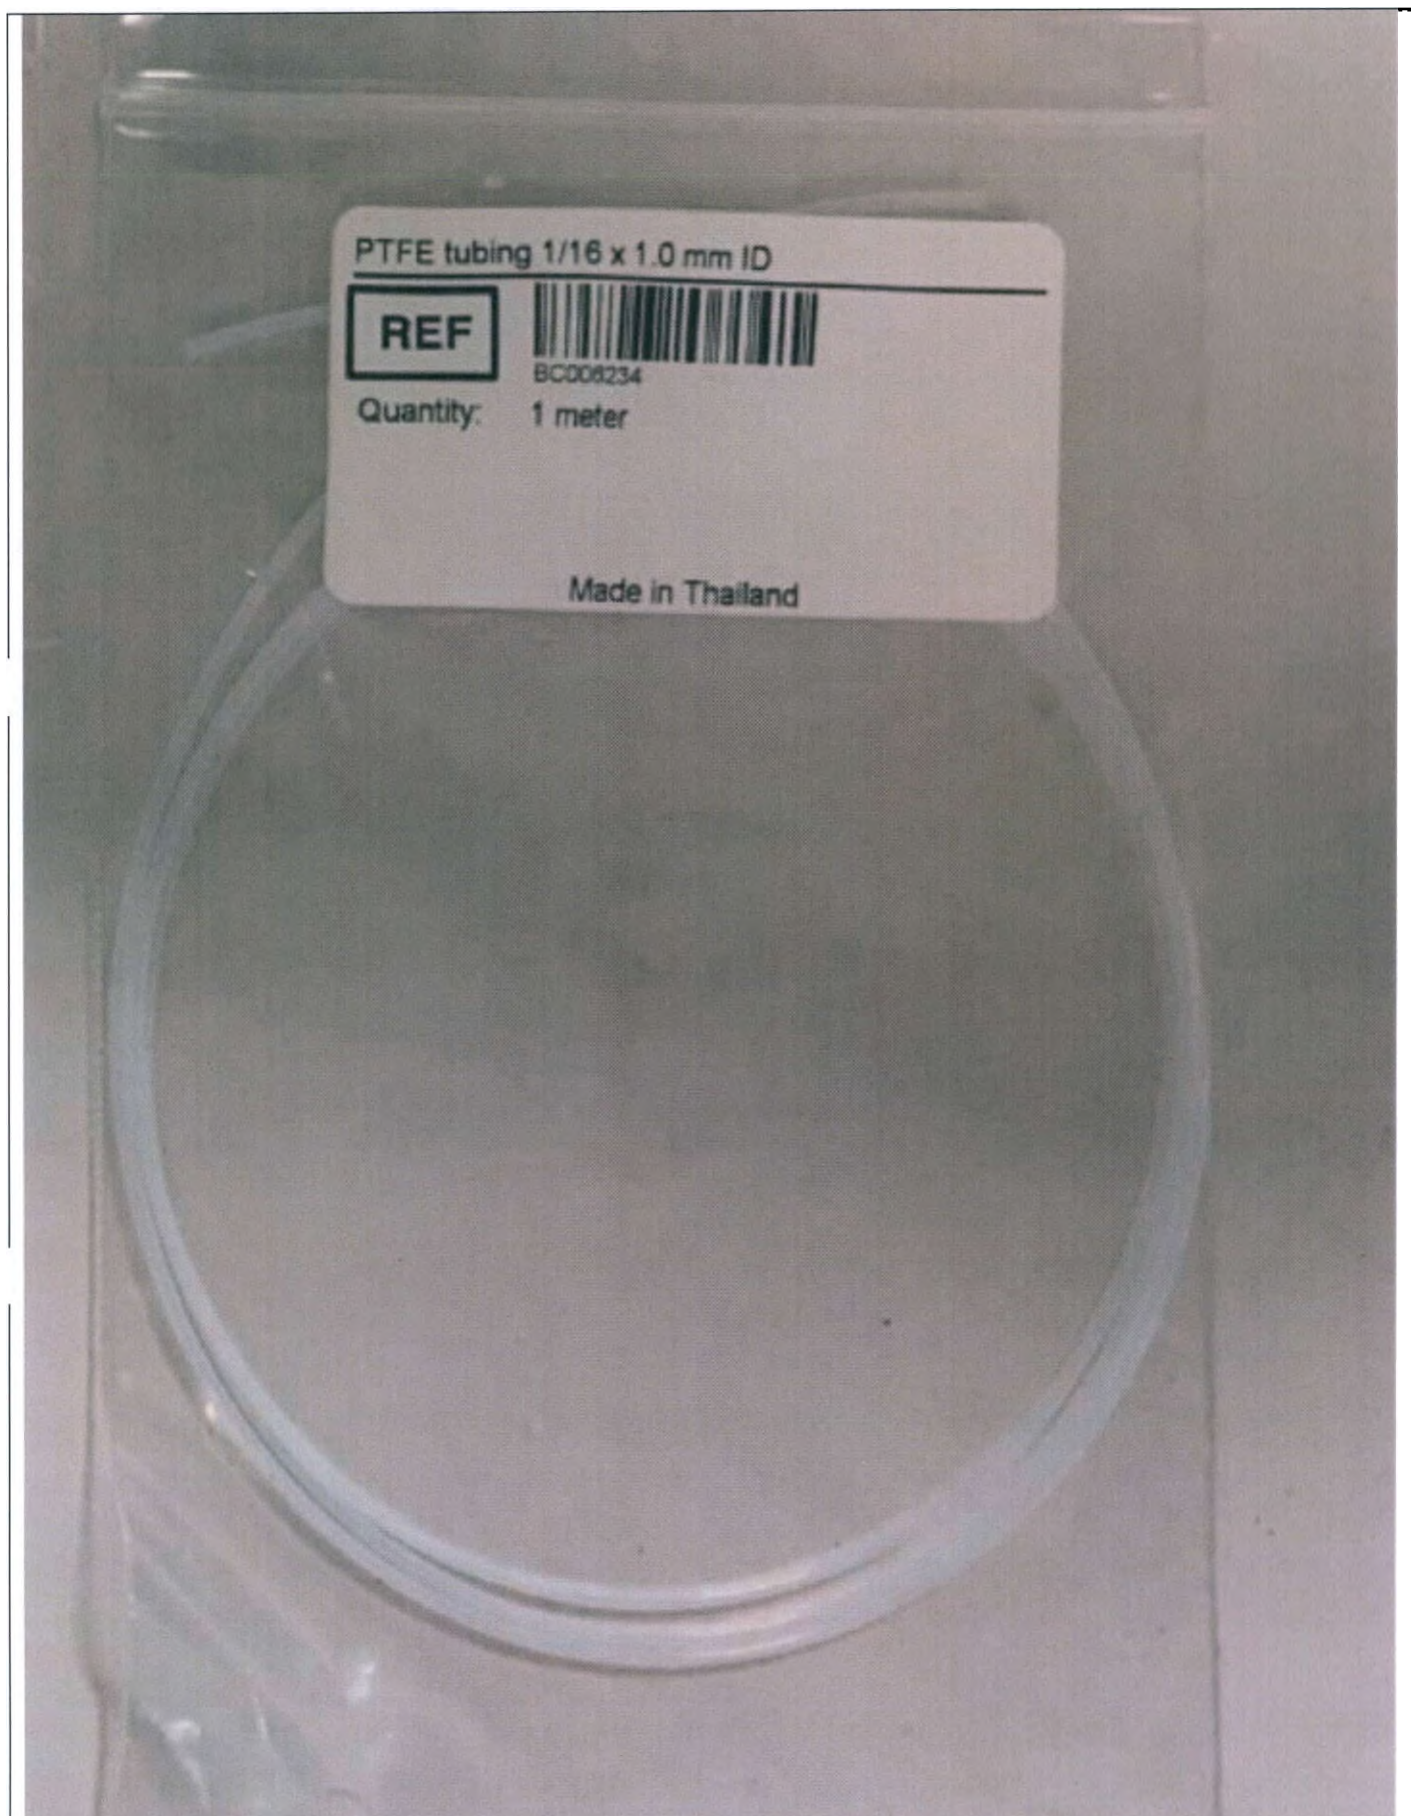


10.3. Капилляр, наружный диаметр 1/16 дюйма, внутренний диаметр 0,03 дюйма, ПТФЭ (Tubing, 1/16 IN OD x 0.030IN ID, PTFE), 10 см



10.4. Соединение нулевого «остаточного» объема с двумя штуцерами F300, ПЭЭК, 0,02 дюйма (PEEK ZDV Union .020IN with 2 F300 fitting)




10.5. Затягиваемое вручную фитинговое соединение (фитинги), для жидкостной хроматографии ПЭЭК (Fitting, PEEK Fingertight, LC)

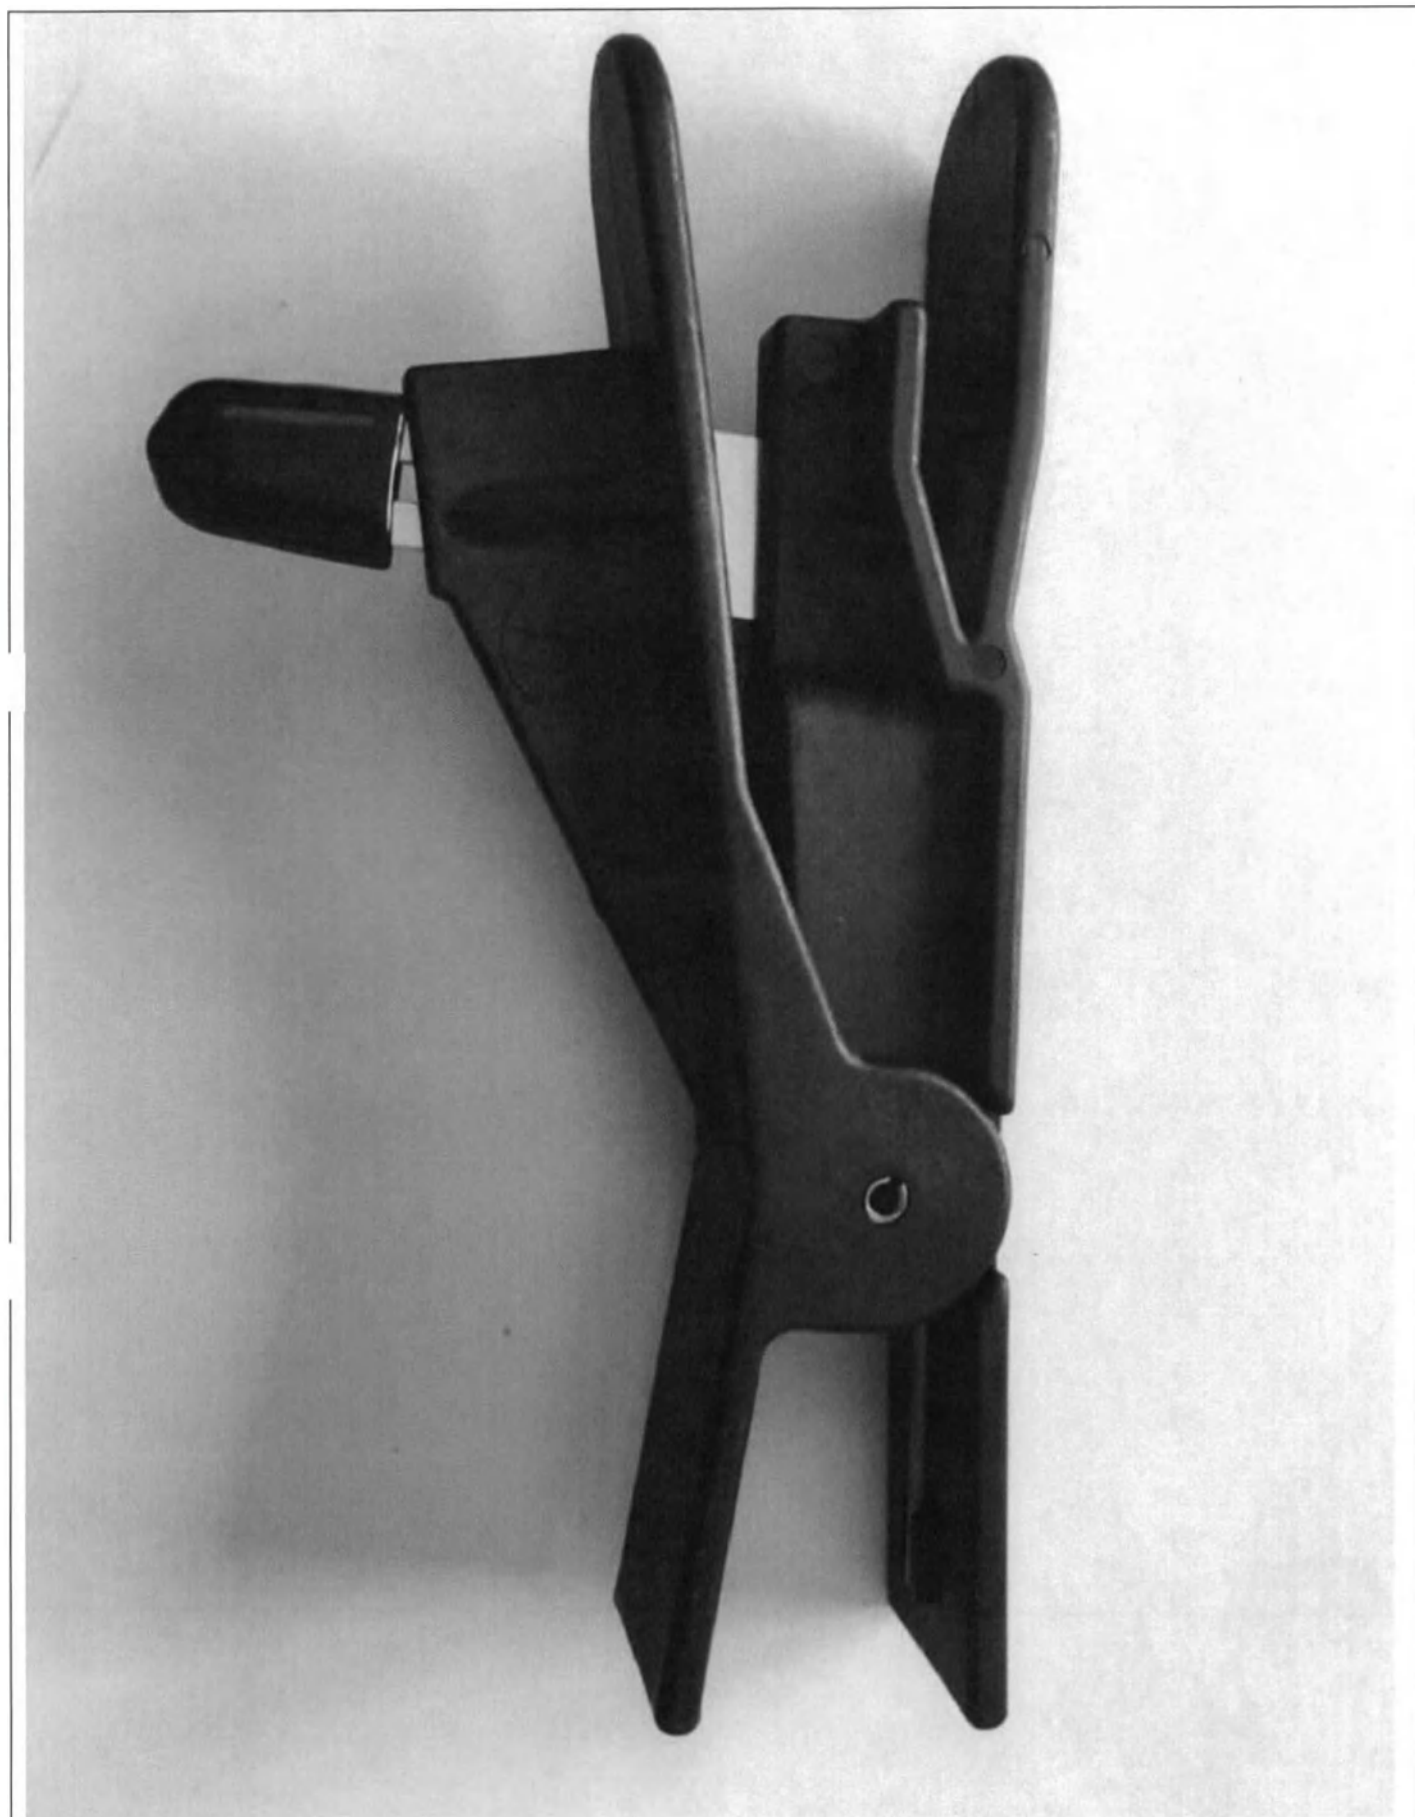


10.6. Инструмент, резак для капилляров с 5 лезвиями (Tool, Tubing Cutter with 5 blades)



10.7. Сквозные тройниковые коннекторы для жидкостной хроматографии, ПЭЭК, 0,02 дюйма (LC Tee, PEEK 0.020 Thru-hole)

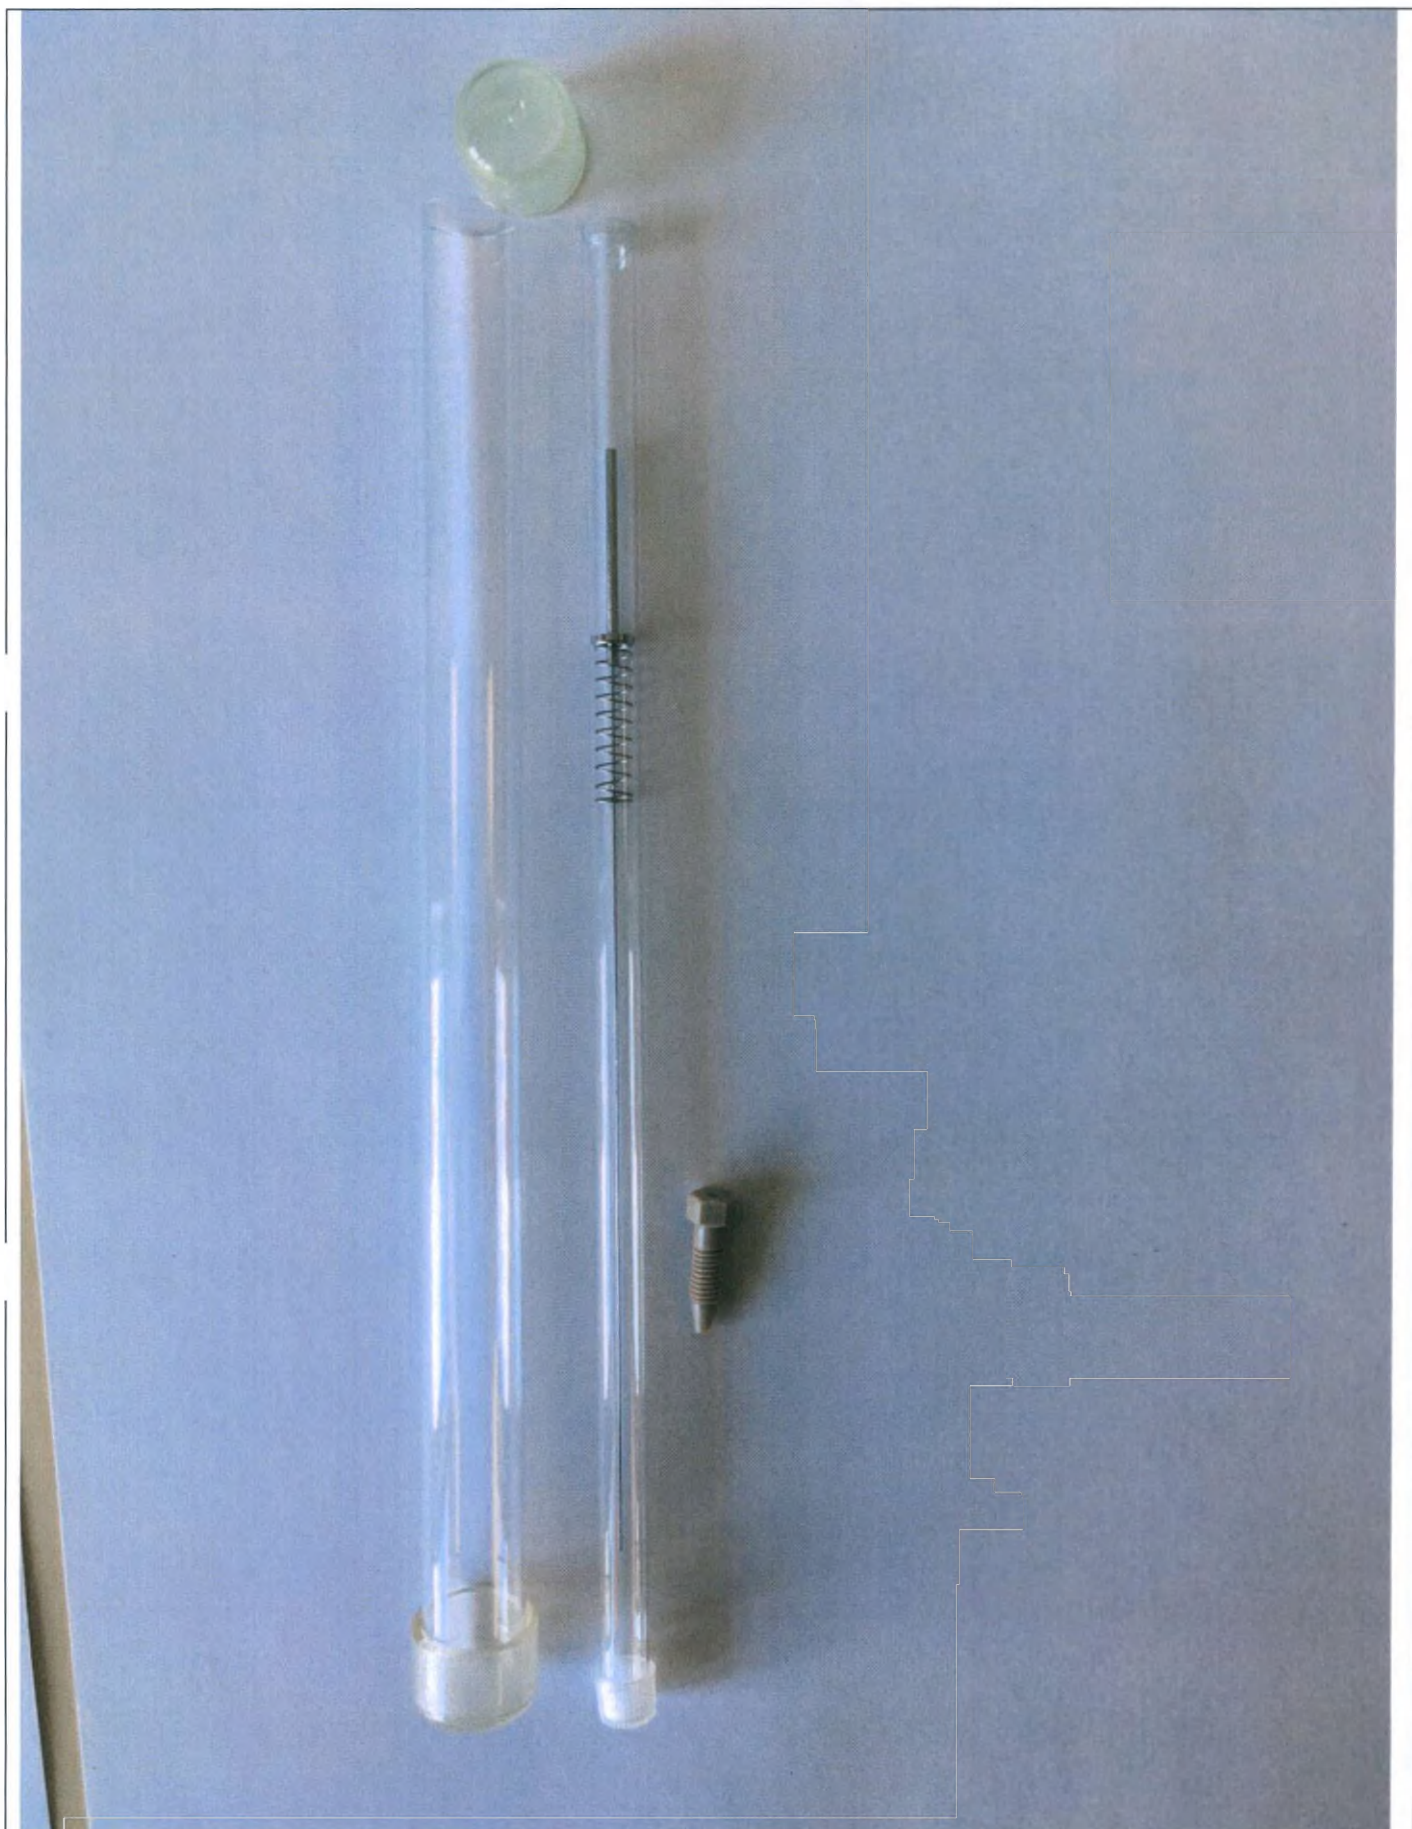


10.8. Металлические иглы (капилляры) для ионизации распылением в электрическом поле, в упаковке (Assy, ESI Needle- Metal Ferrule Set)

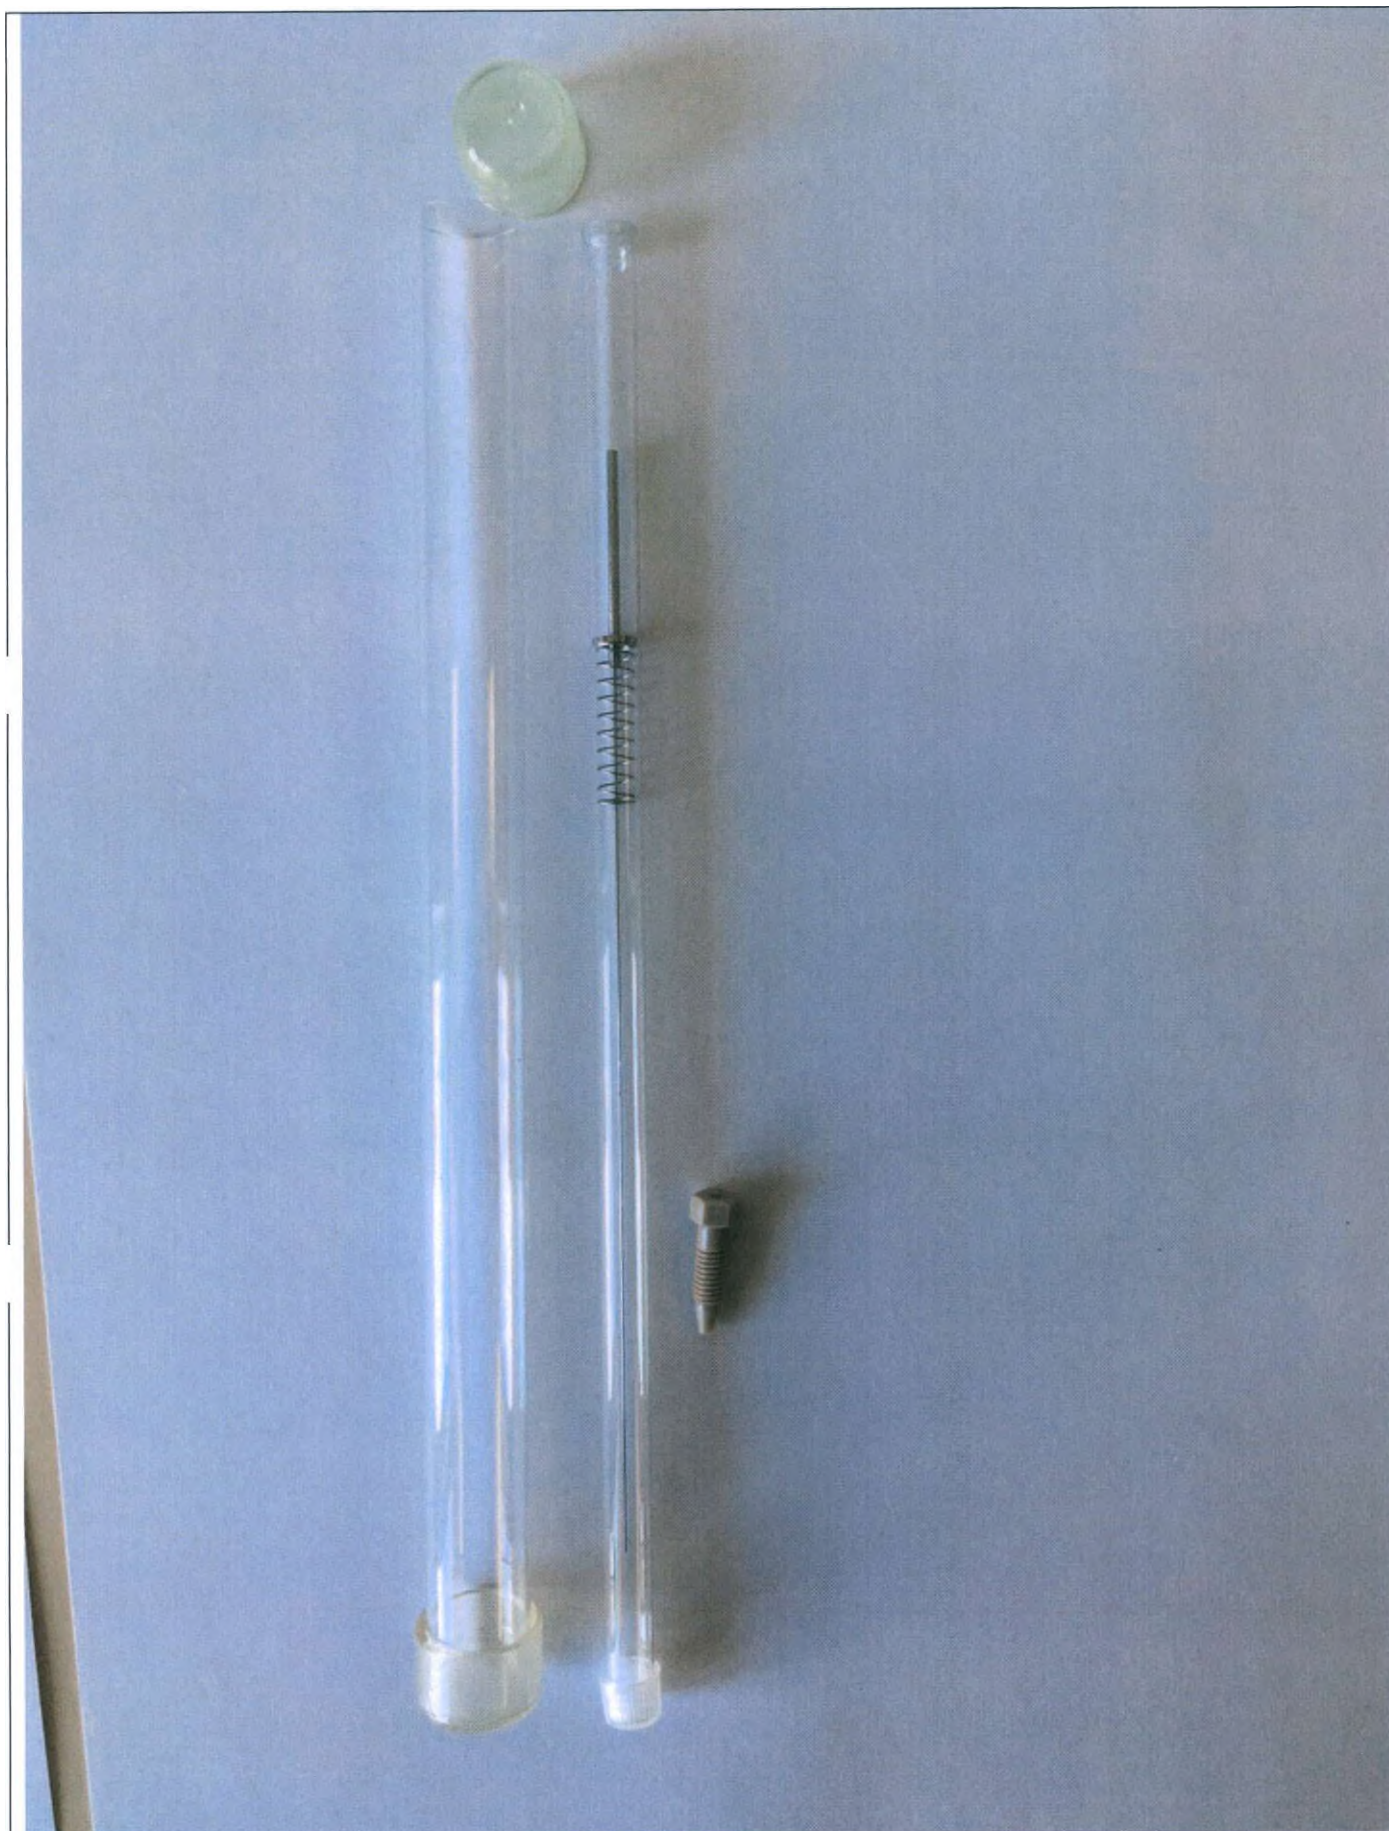

10.9. Игла источника электроспрей ионизации (ESI Source Needle)




11. PAL3-устройство для разрезания фольги (PAL3-Foil Cutter)

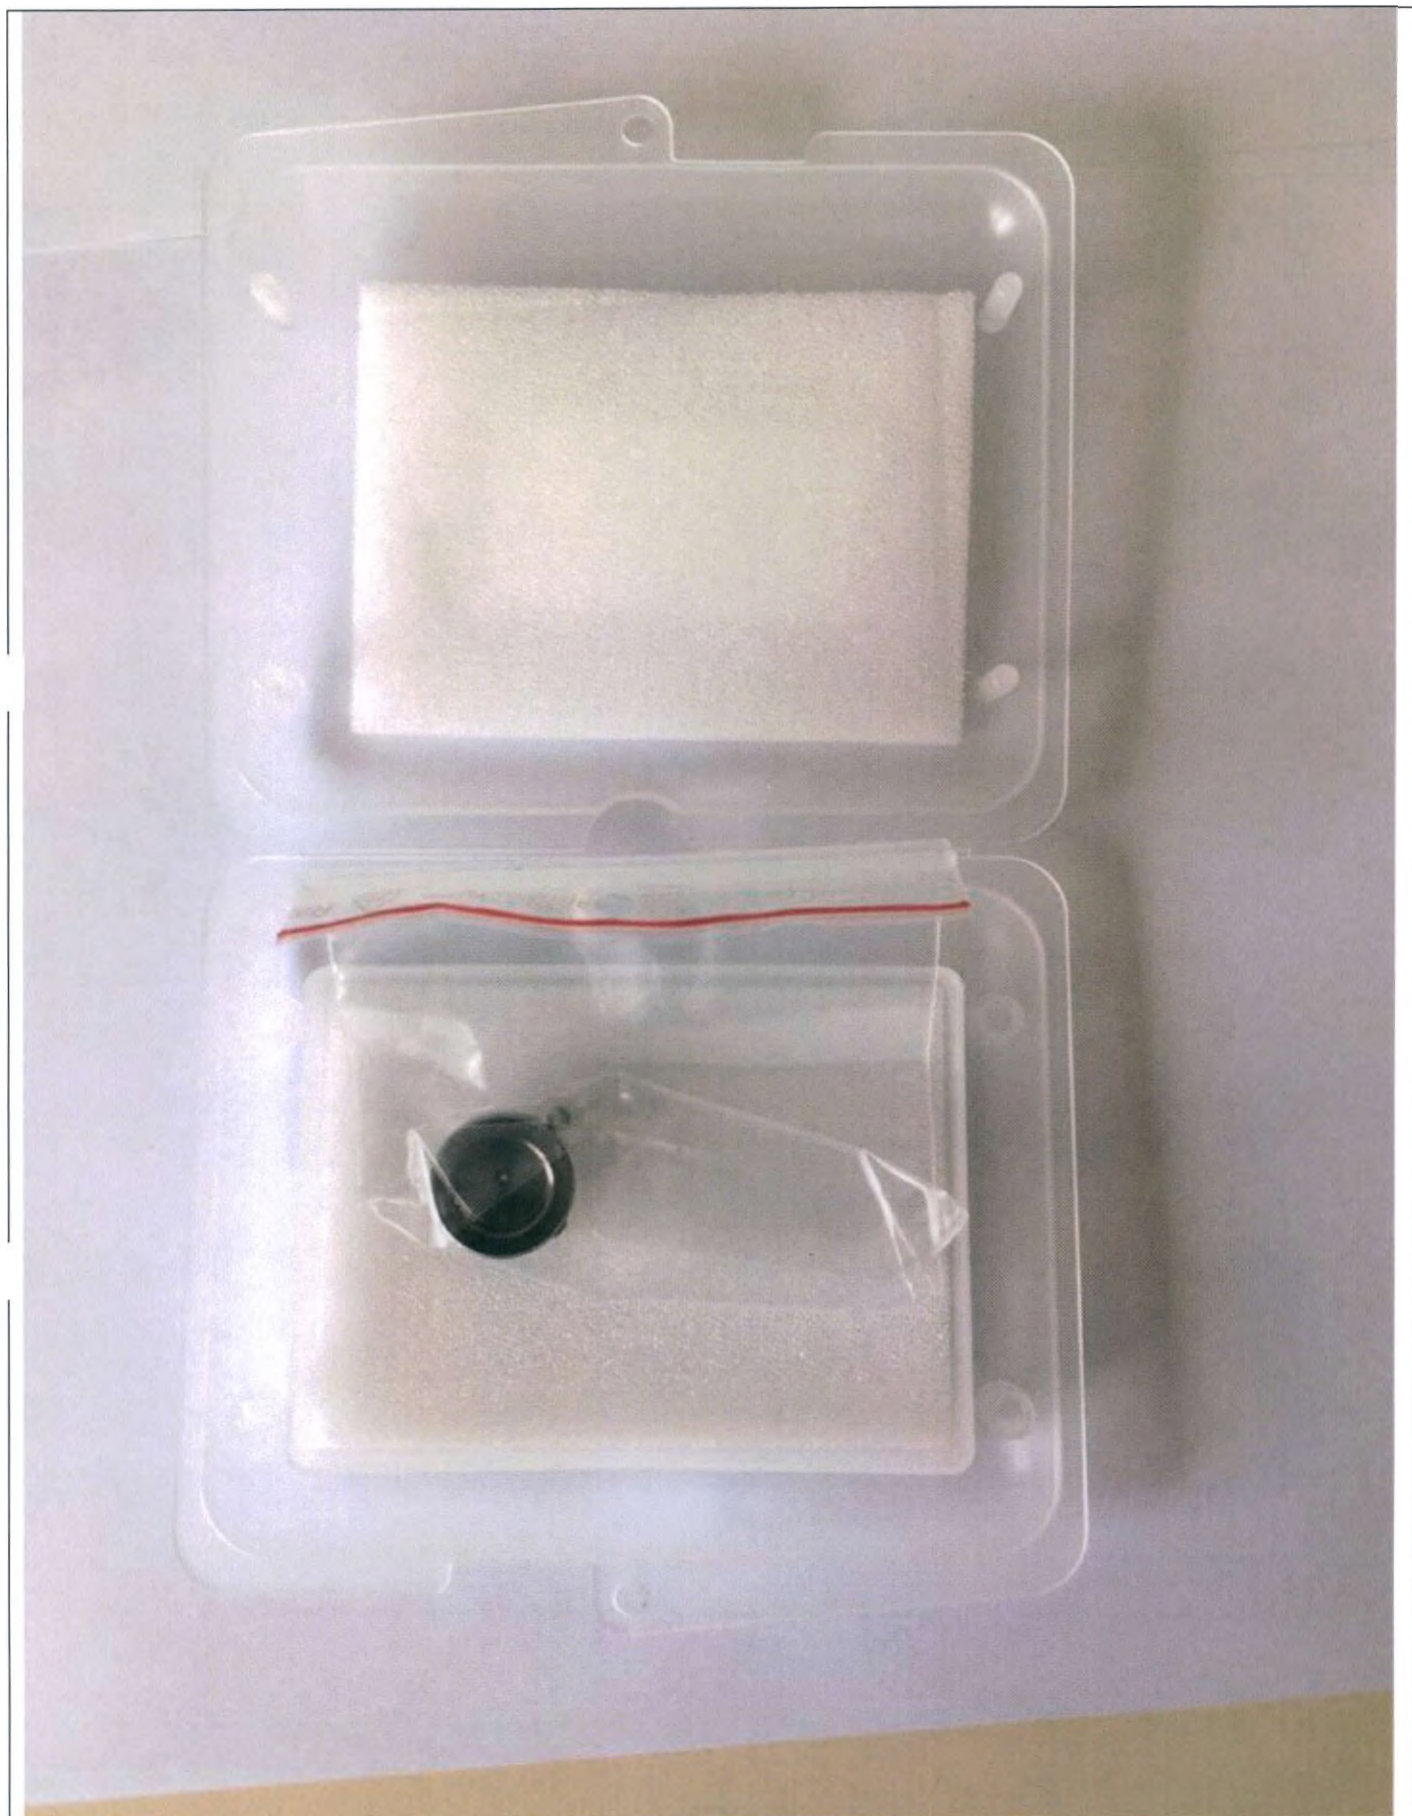


11. PAL3-устройство для разрезания фольги (PAL3-Foil Cutter)



12. Крепежная подставка для УВЭЖХ QSight автосемплера (Tray Table for QSight UHPLC Autosampler)

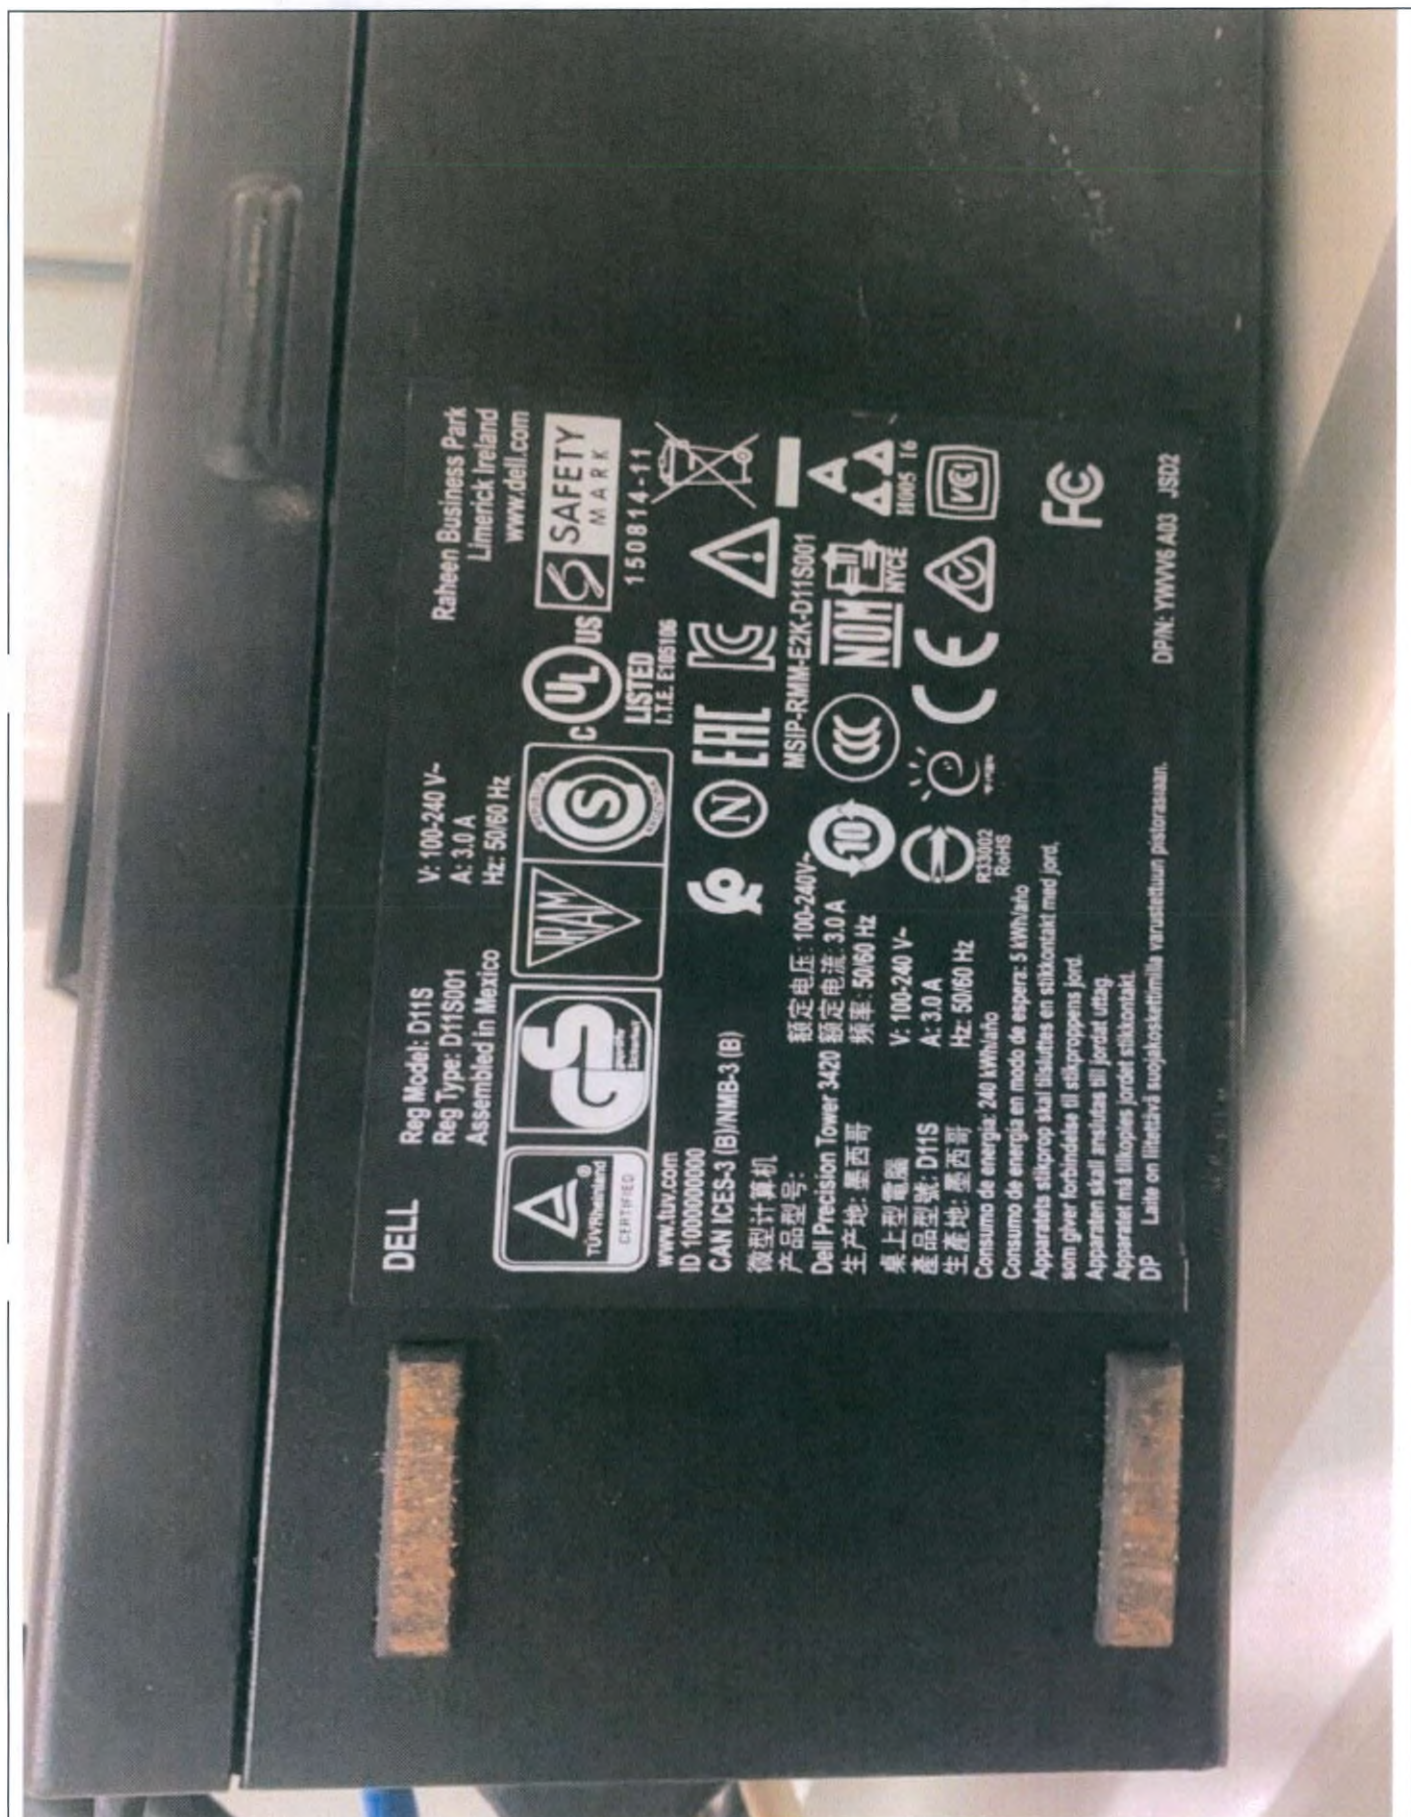


13. Персональный компьютер Dell, модель D11S001

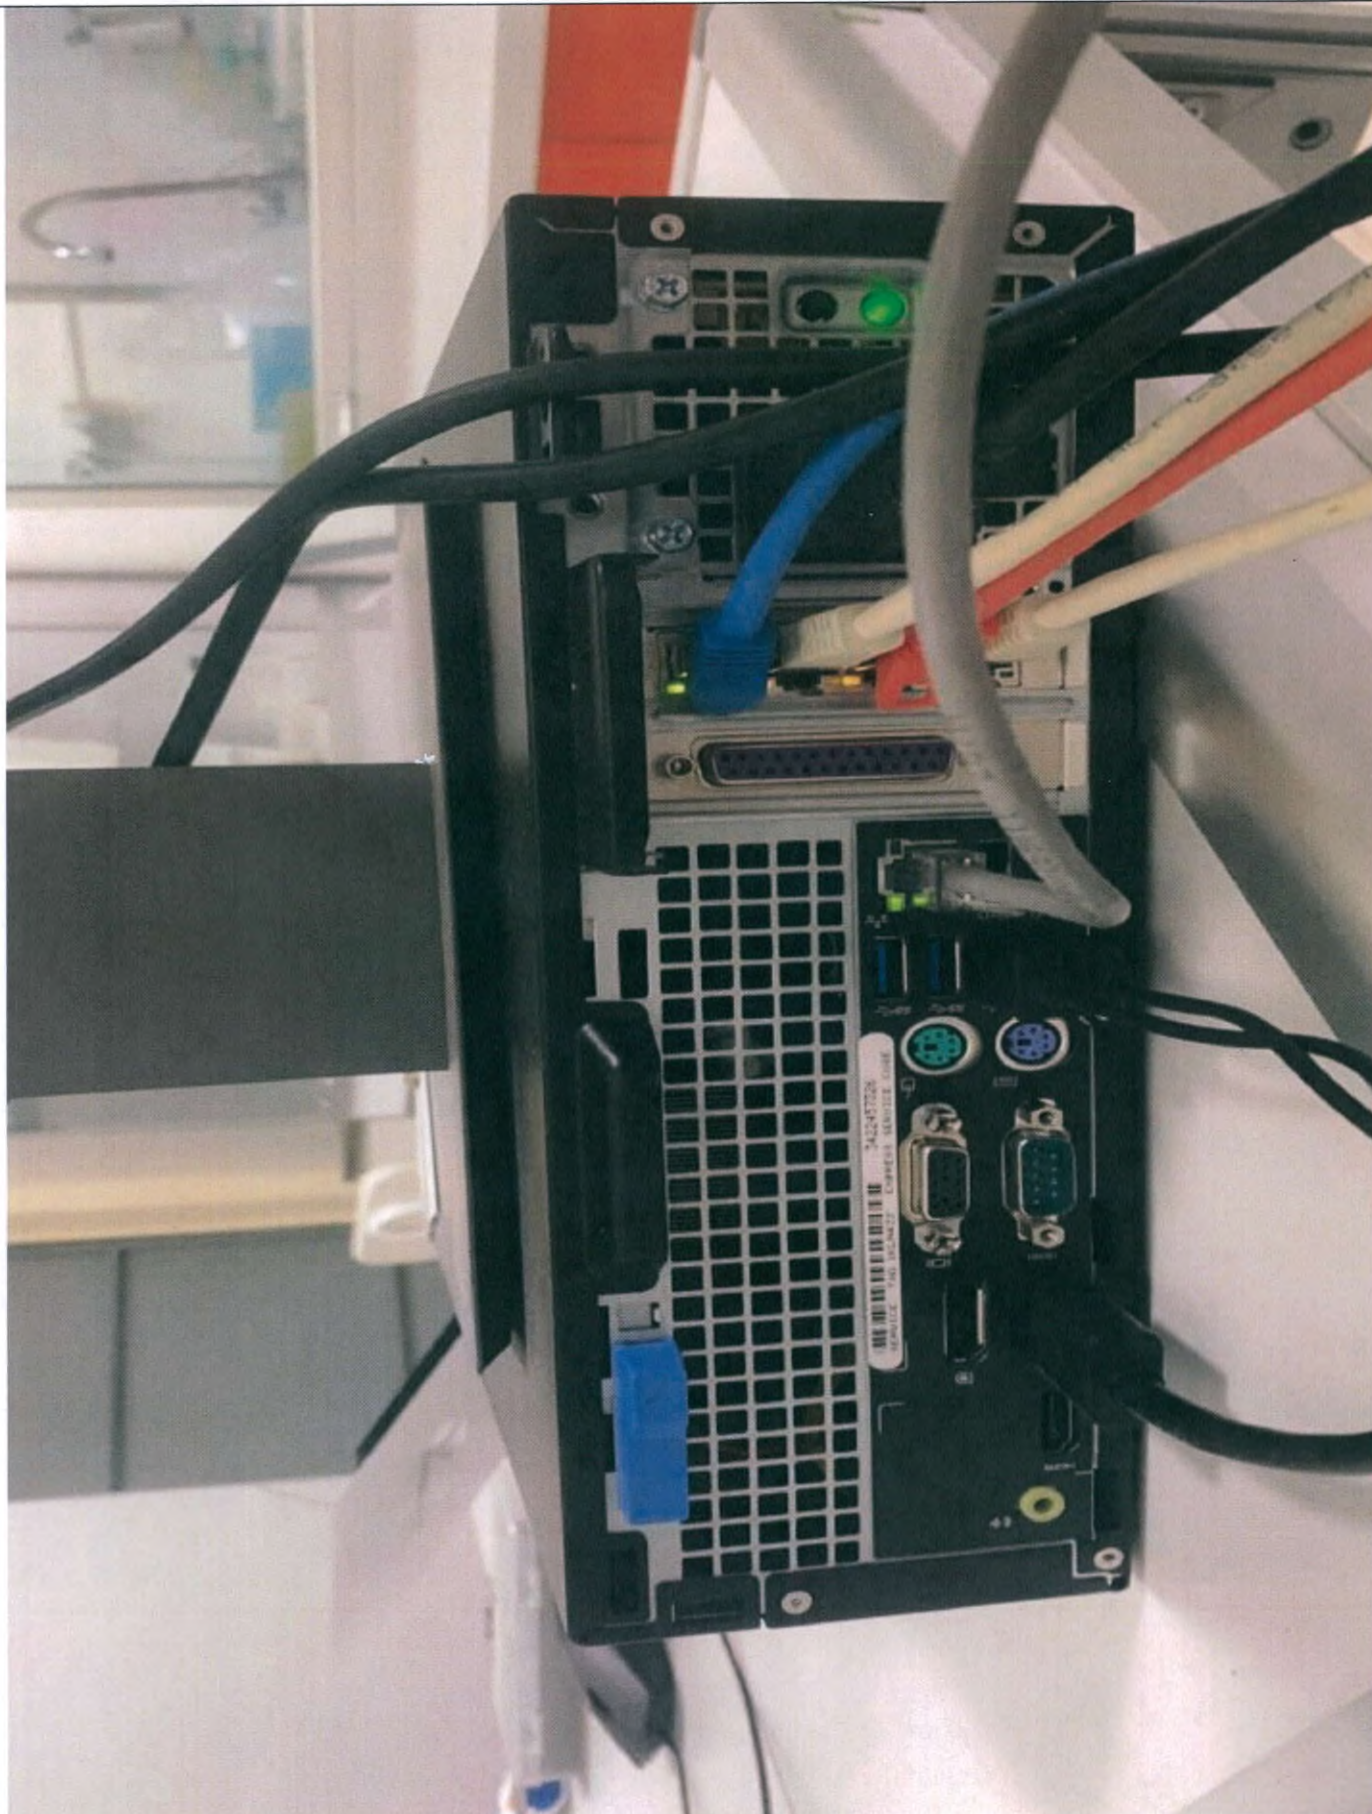


13. Персональный компьютер Dell, модель D11S001



13. Персональный компьютер Dell, модель D11S001

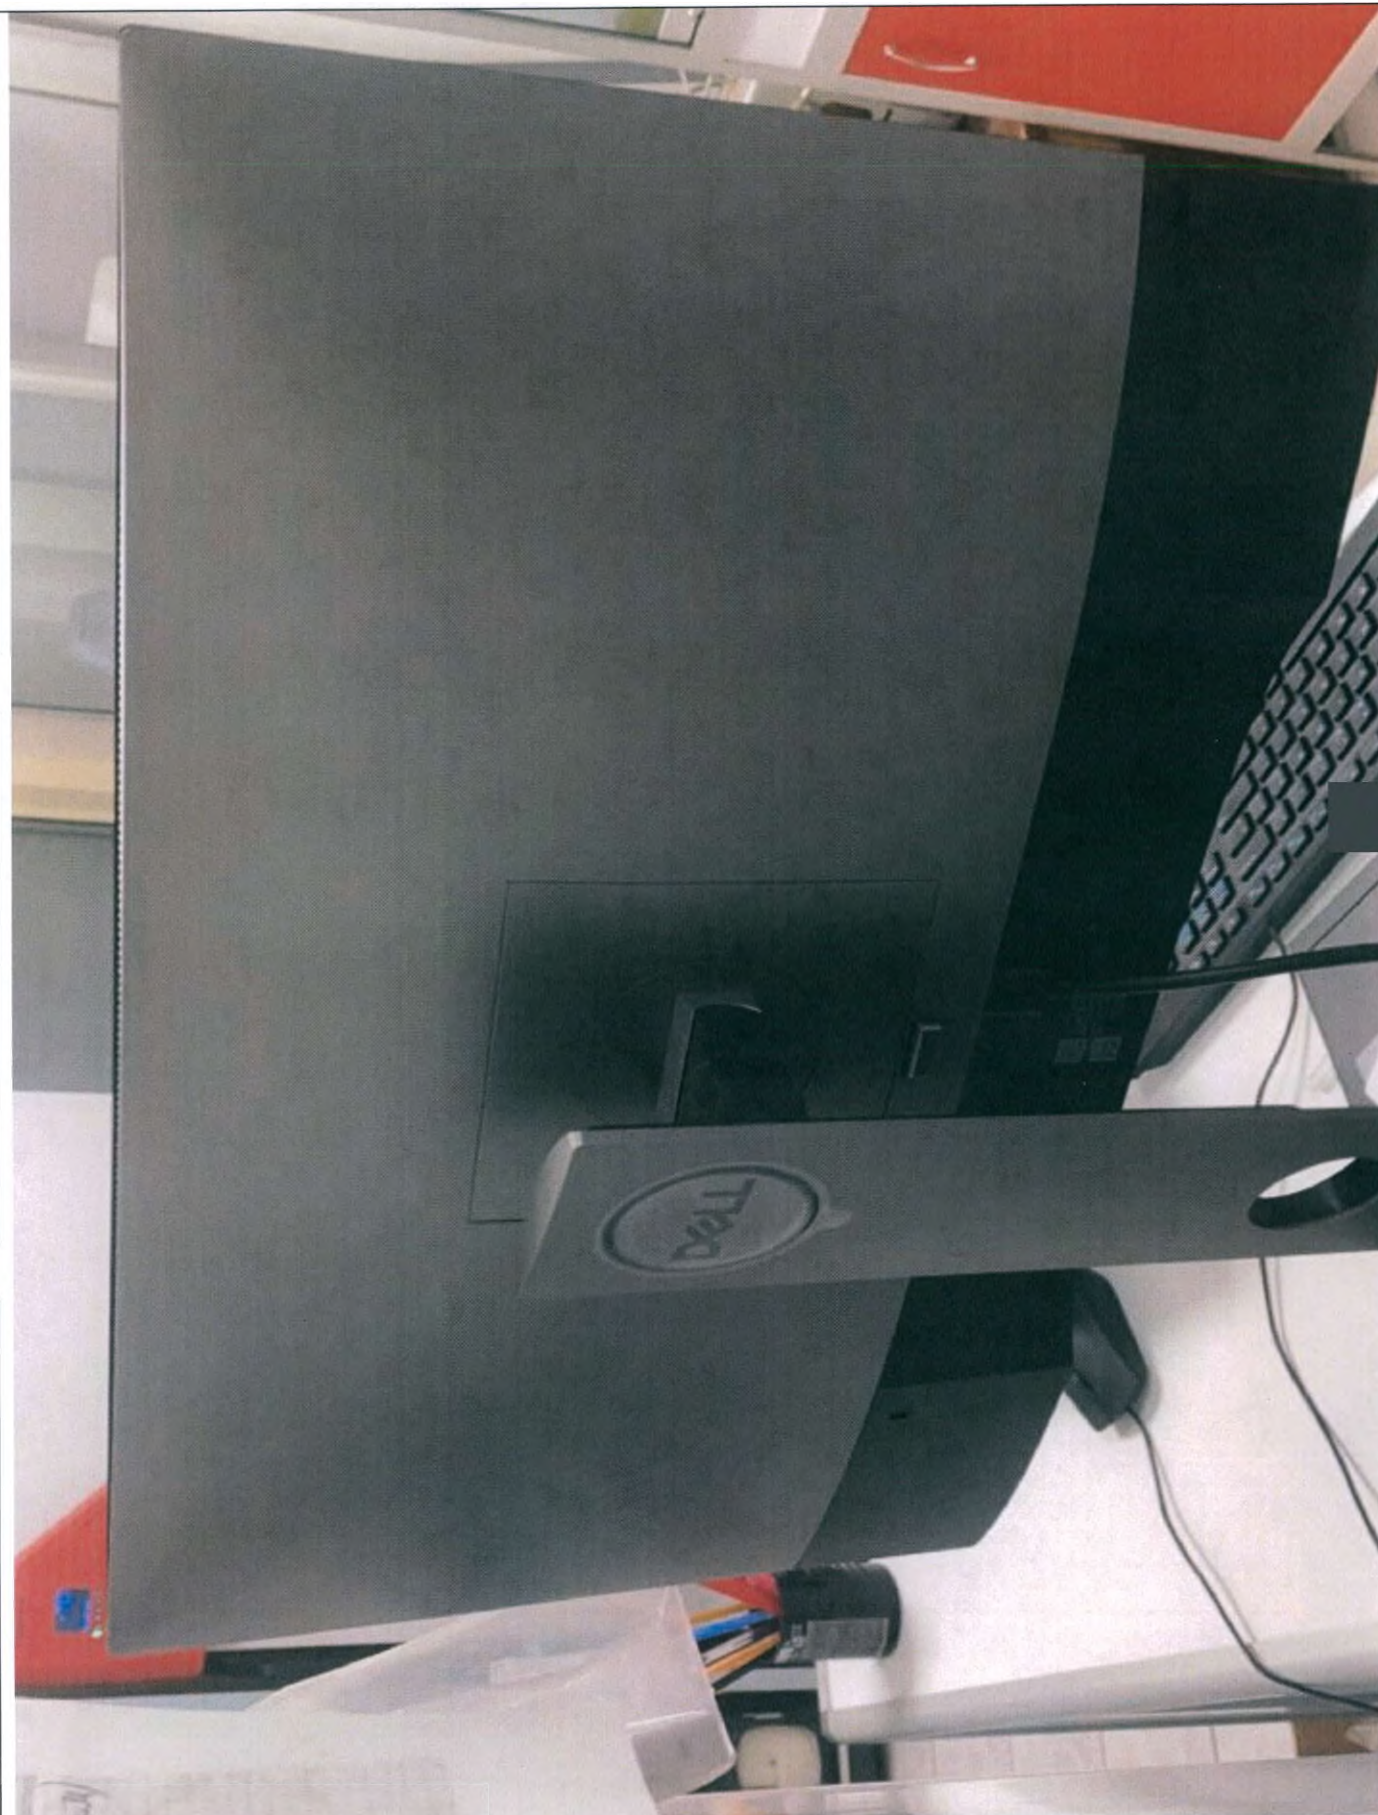


14. Монитор Dell, модель U2419H

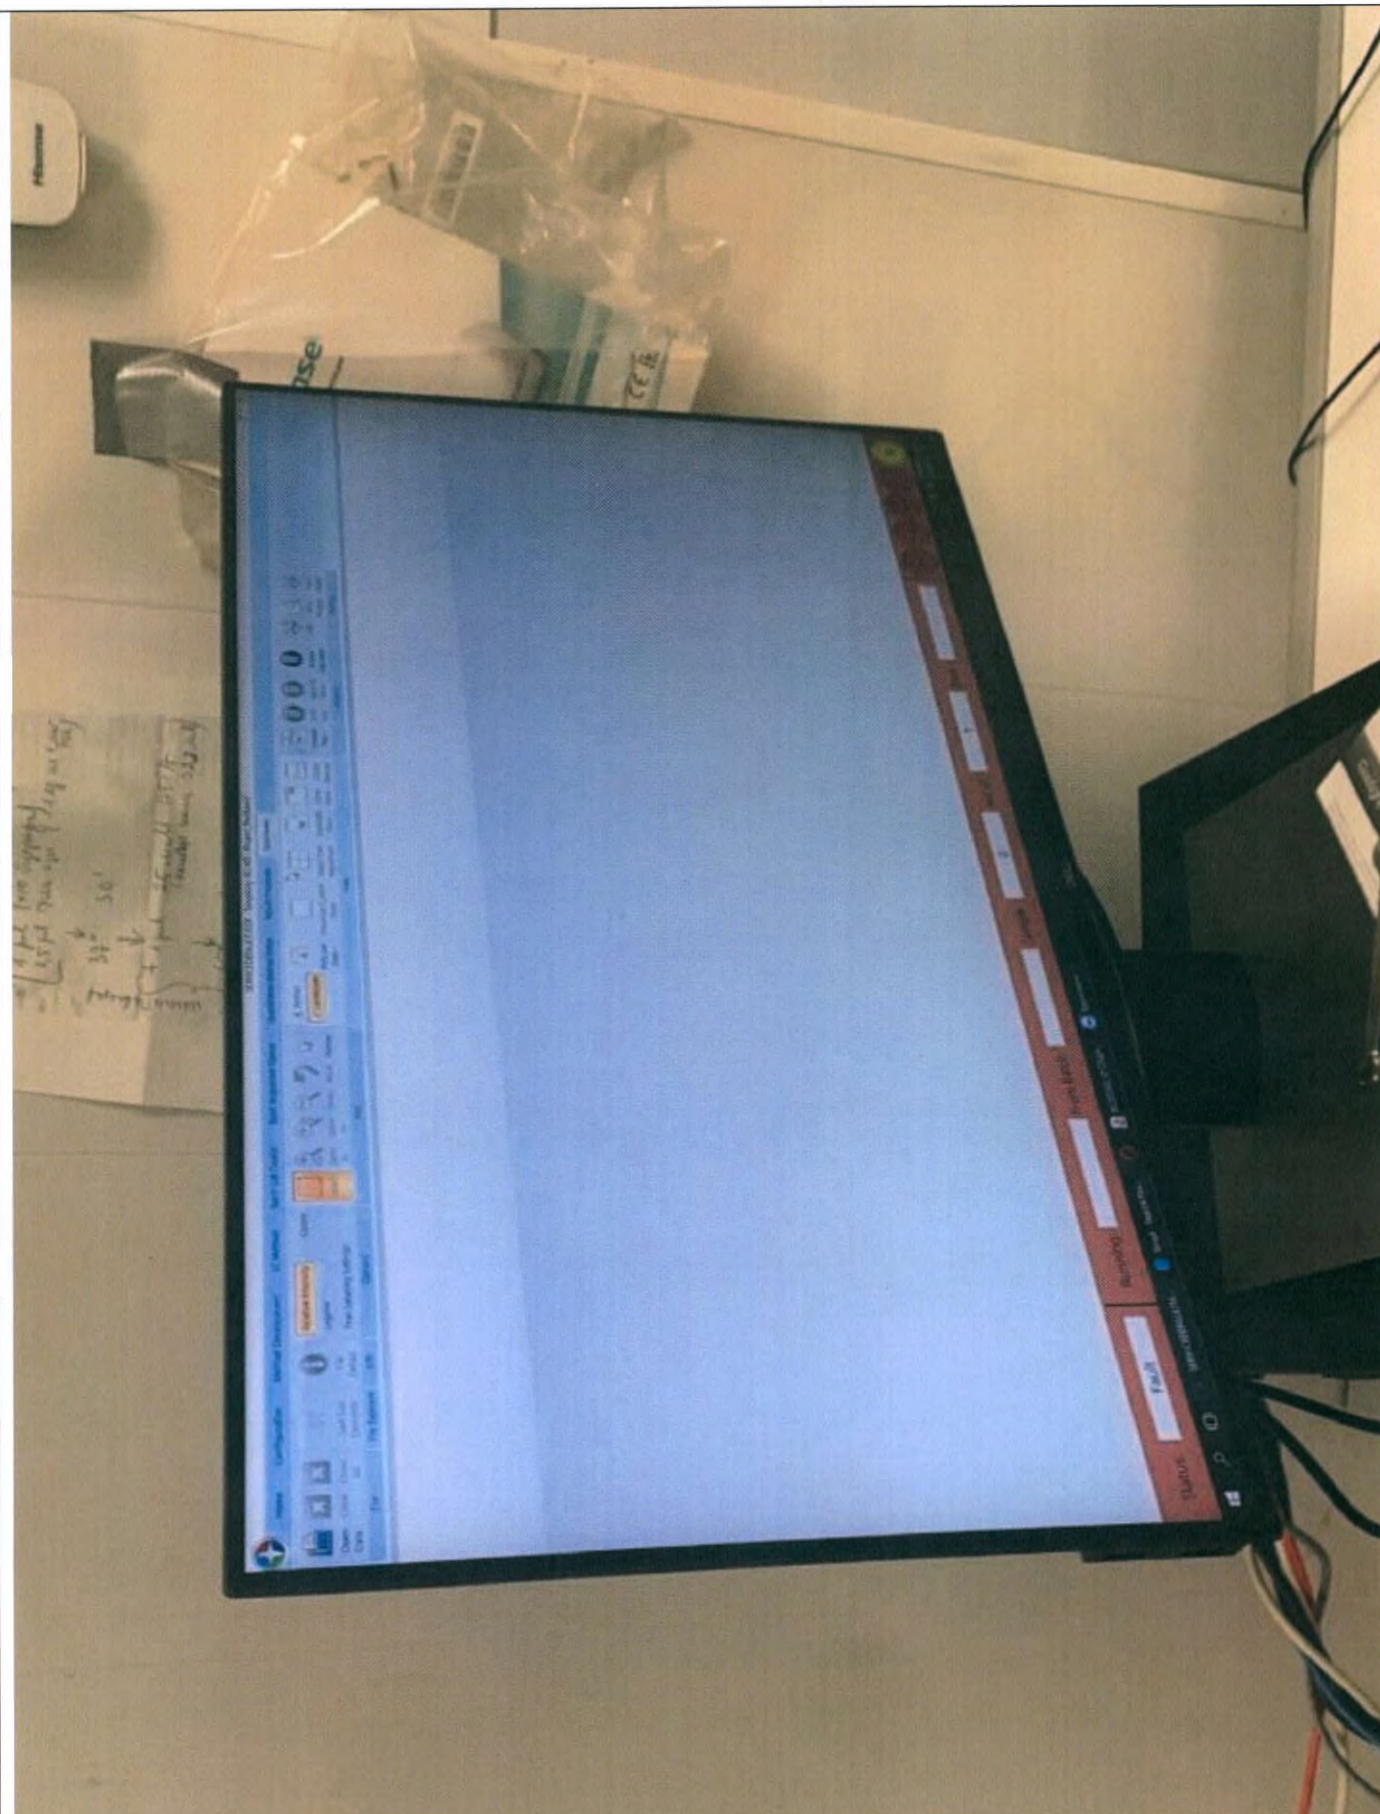

14. Монитор Dell, модель U2419H

15. Набор в зависимости от региона - Европа (Region Dependent Kit-EU)

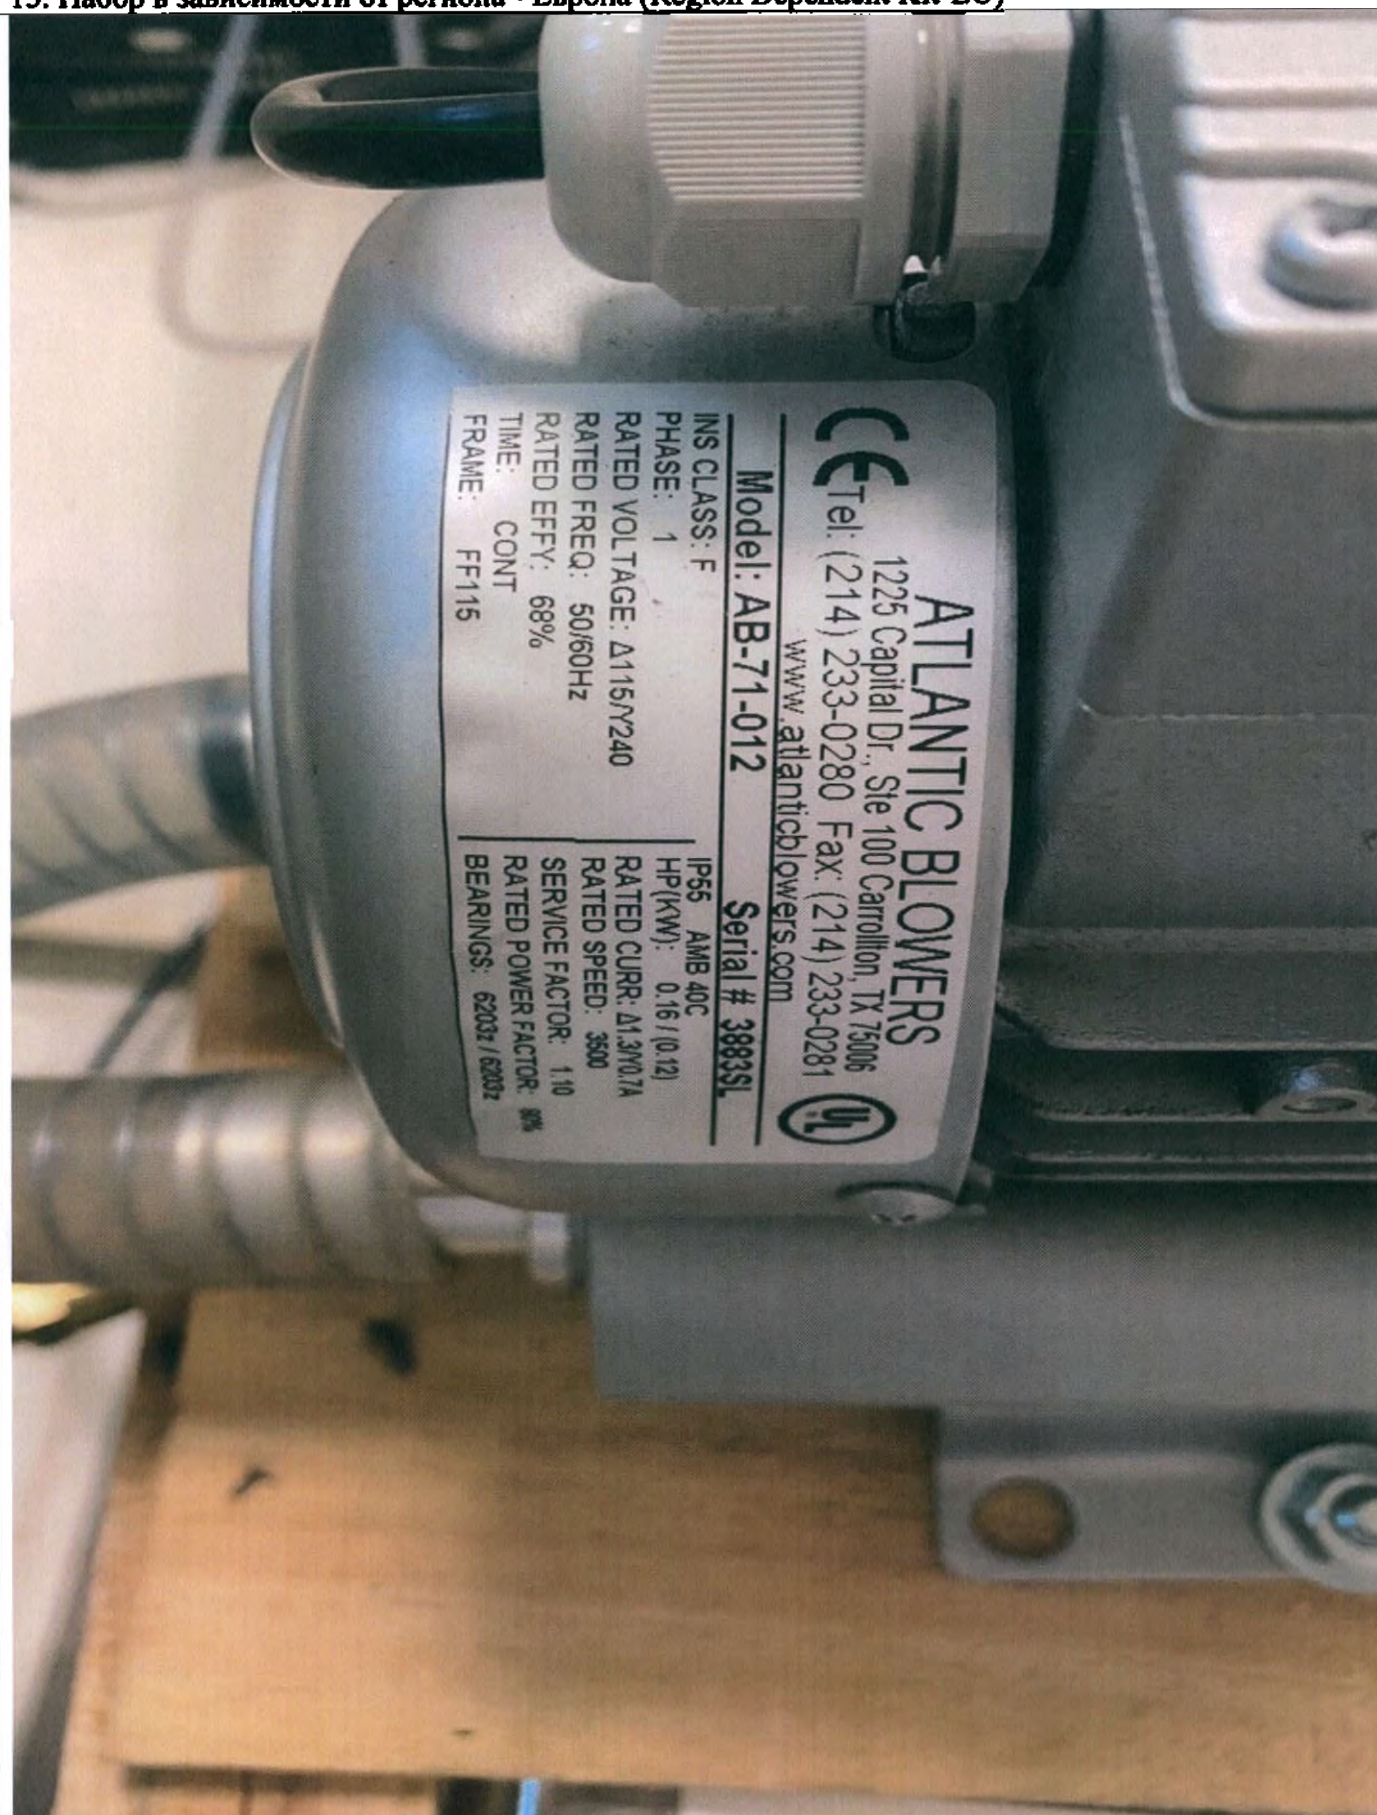

15.1 SX Блоуер, 220 Вольт переменного напряжения (выхлопной насос) (SX Blower, 220VAC (Exhaust pump))



15.1 SX Блоуер, 220 Вольт переменного напряжения (выхлопной насос) (SX Blower, 220VAC (Exhaust pump))



15.1 SX Блоуер, 220 Вольт переменного напряжения (выхлопной насос) (SX Blower, 220VAC (Exhaust pump))



15.2 Сетевой кабель-3С 1.0ММ сеч 2,5ММ 250В 10А (Linecord-3С 1.0ММ sQ 2,5М 250V 10А)



15.3 Силовой кабель, инструмент основной (Power cable Instrument main)



16. Лоток для бутылей с растворителем



Прошито и скреплено печатью

54

листов

Генеральный директор АО «Приборы»

Ефимов Л.Н.

