

"УТВЕРЖДАЮ"




Генеральный директор
ООО «Арсиус» - управляющей компании
ООО «МедПойнт24-Лаб»

А.Д. Николаев

Фотографические изображения медицинского изделия:

Автоматизированная система проведения медицинских осмотров
Medpoint24 в вариантах исполнения с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-
31108056-2020

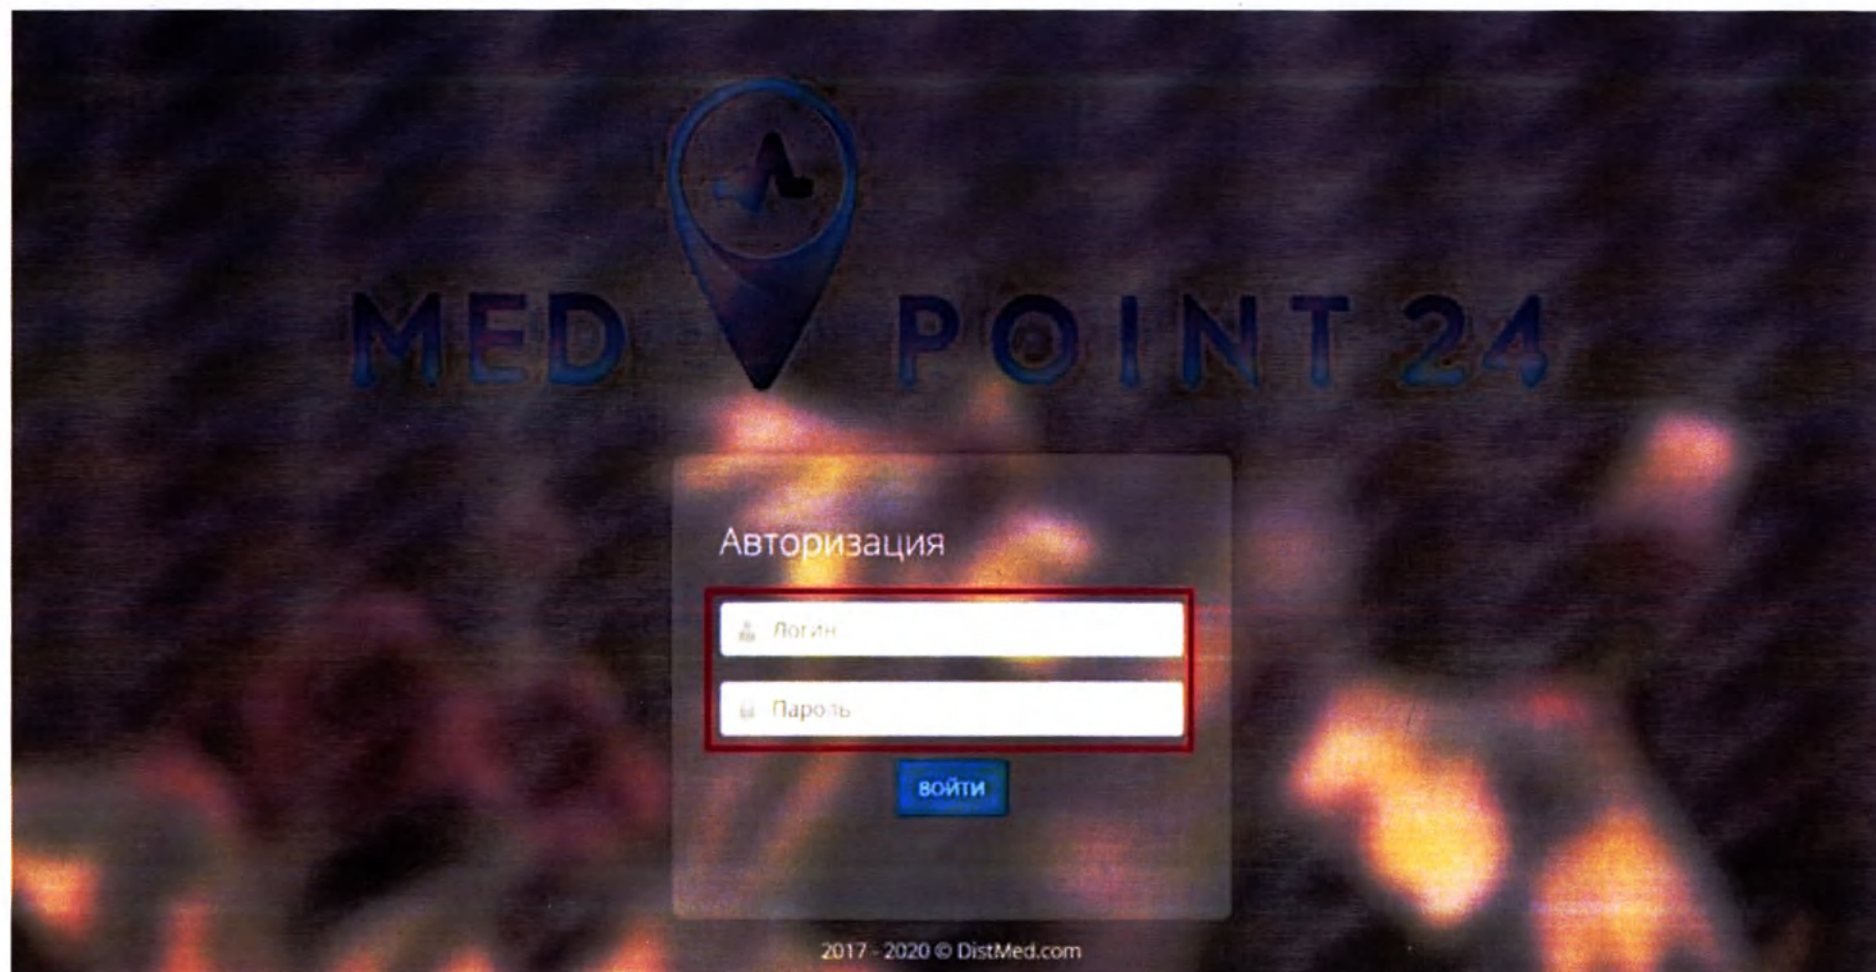

I. Автоматизированная система Medpoint24-01.

1. Программный Комплекс Medpoint24 (Строки авторизации Модулей: Модуля ПО Medpoint24 – Медработник; Модуля ПО Medpoint24 – Диспетчер, Модуля ПО Medpoint24 – Директор, Модуля ПО Medpoint24 – Администратор).

Показатель	min	max
АД верхнее:	100	150
АД нижнее:	60	100
ЧСС:	54	96

ВЫБРАТЬ ДЕНЬ

< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 **6**

техподдержка
8 800 550-76-11
Написать заявку

Вы вошли как: Тестовый Медик DEV




Медосмотры Организации

МЕДОСМОТРЫ

Всего в очереди 1

ПЕЧАТЬ КОПИРОВАТЬ PDF EMAIL CSV КОЛОНКИ

Поиск:

#	Сотрудник	Организация	Результат измерений	Допуск
12148602	 (т.н. 9999 д.р. 03-09-1982)	организация: Тестовая организация Проектный Офис точка осмотра: testTerminal	Дата осмотра: 05-10-2020 18:42:46 Давление: 120 / 80 Пульс: 80 Алкоголь: 0.0 Жалобы: Нет Сон: более 8 часов Температура: - Авто:	ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР СПРАВКА ЭКСПРЕСС КАРТОЧКА ОСМОТРА

Записи с 1 до 1 из 1 записей



1.1 Модуль ПО Medpoint24 – Медработник

Табельный номер

Сотрудник

Дата рождения

Организации

Действия

100000

Угулдар Мугулдар Иванович (B.Y.)

16-07-1978

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

100000000

test test test (B.Y.: null)

10-10-1100

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

100000000000

Медведев Евгений Александрович (B.Y.)

05-08-1989

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Морозовский Виссентий Одноклассович (B.Y.)

03-02-1900

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Cookie Monster (B.Y.: null)

01-01-1970

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Kermit the Frog (B.Y.: null)

09-05-1955

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Шараликов Алимбай Абдулпашаевич (B.Y.: 12as12343)

30-10-1900

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Шараликов1 Алимбай1 Абдулпашаевич1 (B.Y.: 12as12343)

30-10-1901

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Гончарова Наталья Николаевна (B.Y.)

26-05-1999

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Test Test Тестович (B.Y.: null)

03-08-2017

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Test Test Тестович (B.Y.: 1234567890YFX)

23-10-1999

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1000000

Test Test Тестович (B.Y.: 1234567890YFX)

23-10-1999

Тестовая организация DistMed

МЕДКАРТОНКА

ПРАВКА

АРХИВИРОВАТЬ

1.1. Модуль ПО Medpoint24 – Диспетчер



Рабочий стол

СТРУКТУРА

Организации

Пользователи

Водители

МЕДОСМОТРЫ

Вся статистика

За текущий месяц

ВЫБРАТЬ ДЕНЬ

Июль 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Статистика медосмотров

Медосмотры

Организации

Пользователи

Водители

МЕДОСМОТРЫ

ОБНОВИТЬ СПИСОК МЕДОСМОТРОВ

ПЕЧАТЬ

КОПИРОВАТЬ

PDF

EXCEL

CSV

КОЛОНКИ

Показать 50 записей

Поиск:

Сотрудник

Организация

Результат измерений

Допуск

В таблице отсутствуют данные

Записи с 0 до 0 из 0 записей

1.3 Модуль ПО Medpoint24 – Директор

ВЫПОЛНИТЬ

техподдержка
8 800 550-76-11
Написать заявку

Выход: [Выход](#) [Тест](#) [Тест](#) [Тест](#)



Medpoint24 - Администратор

[Medpoint24 - Администратор](#)

[Статистика](#) [Медосмотры](#) [Организации](#) [Пользователи](#) [Сотрудники](#) [Лог](#)

МЕДОСМОТРЫ

ПЕЧАТЬ КОПИРОВАТЬ PDF EXCEL CSV КОЛОНКИ

Показать 50 записей

Поиск:

#	Сотрудник	Организация	Результат измерений	Допуск
9269097	Test test test (т.н. 123 д.р. 13-04-2018)	организация: Тестовая организация DistMed точка осмотра: openpoint 0045 (К. ОТ Тк Город Лефортово ш. Энтузиастов, ш. Энтузиастов 12х2)	Дата осмотра: 17-03-2020 21:52:30 Давление: 122 / 86 Пuls: 73 Алкоголь: 0.0 Жалобы: ☒ Есть Сон: ☒ менее 8 часов t: -	НЕ ДОПУЩЕН ПОВТОРНАЯ ПЕЧАТЬ ОТМЕТКА QR

1.4 Модуль ПО Medpoint24 – Администратор



МЕДОСМОТР

1.5. Модуль ПО Medpoint24 – Терминал




1.6. Модуль ПО Medpoint24 – Сервер



Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24 на примере варианта исполнения II. Автоматизированная система Medpoint24-02

(Корпус в виде стола закрытого)

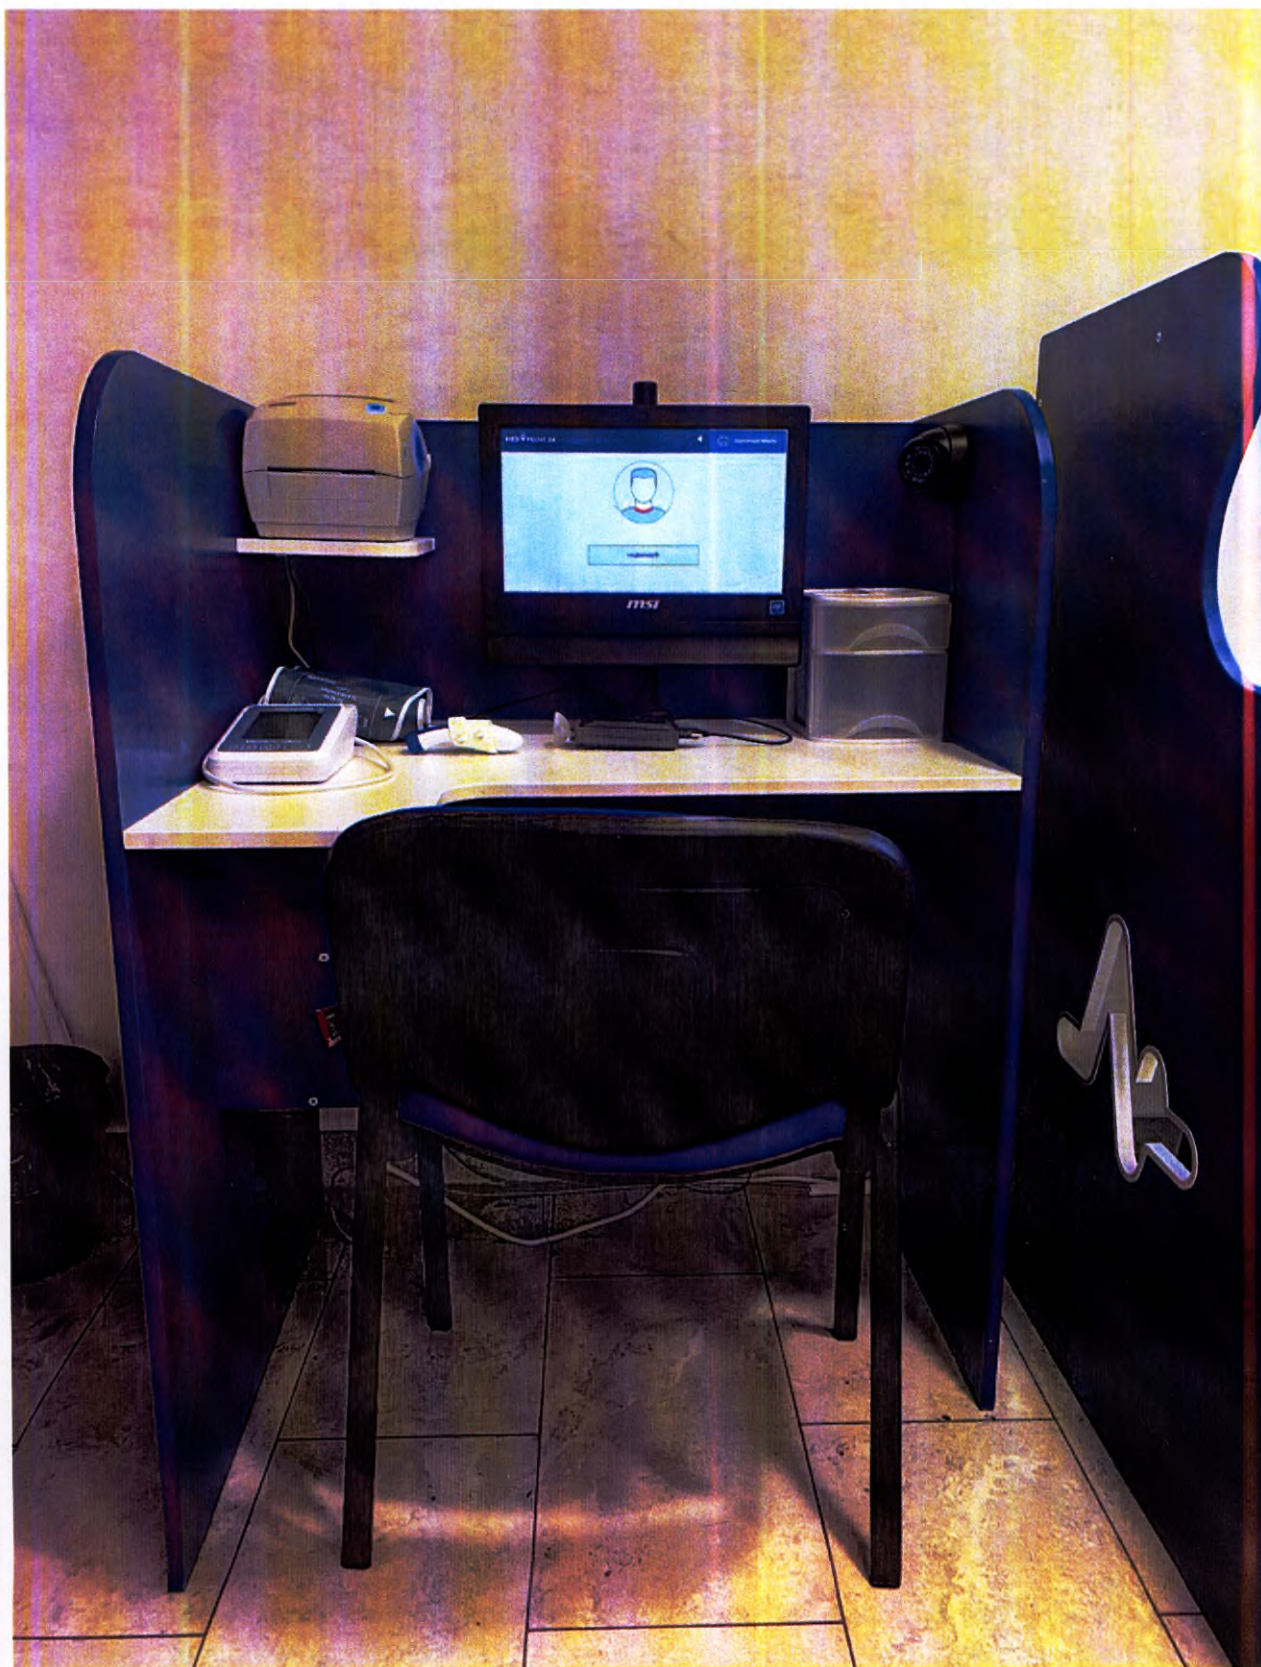

**Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24 на
примере варианта исполнения III. Автоматизированная система Medpoint24-03**

(Корпус в виде стола)



Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24 на примере варианта исполнения IV. Автоматизированная система Medpoint24-04

(Корпус в виде кабины)




Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24 на примере варианта исполнения V. Автоматизированная система Medpoint24-05

(Корпус в виде кейса)



**Автоматизированная система проведения медицинских осмотров Medpoint24 на примере варианта исполнения VI.
Автоматизированная система Medpoint24-06**

(Корпус настольный)

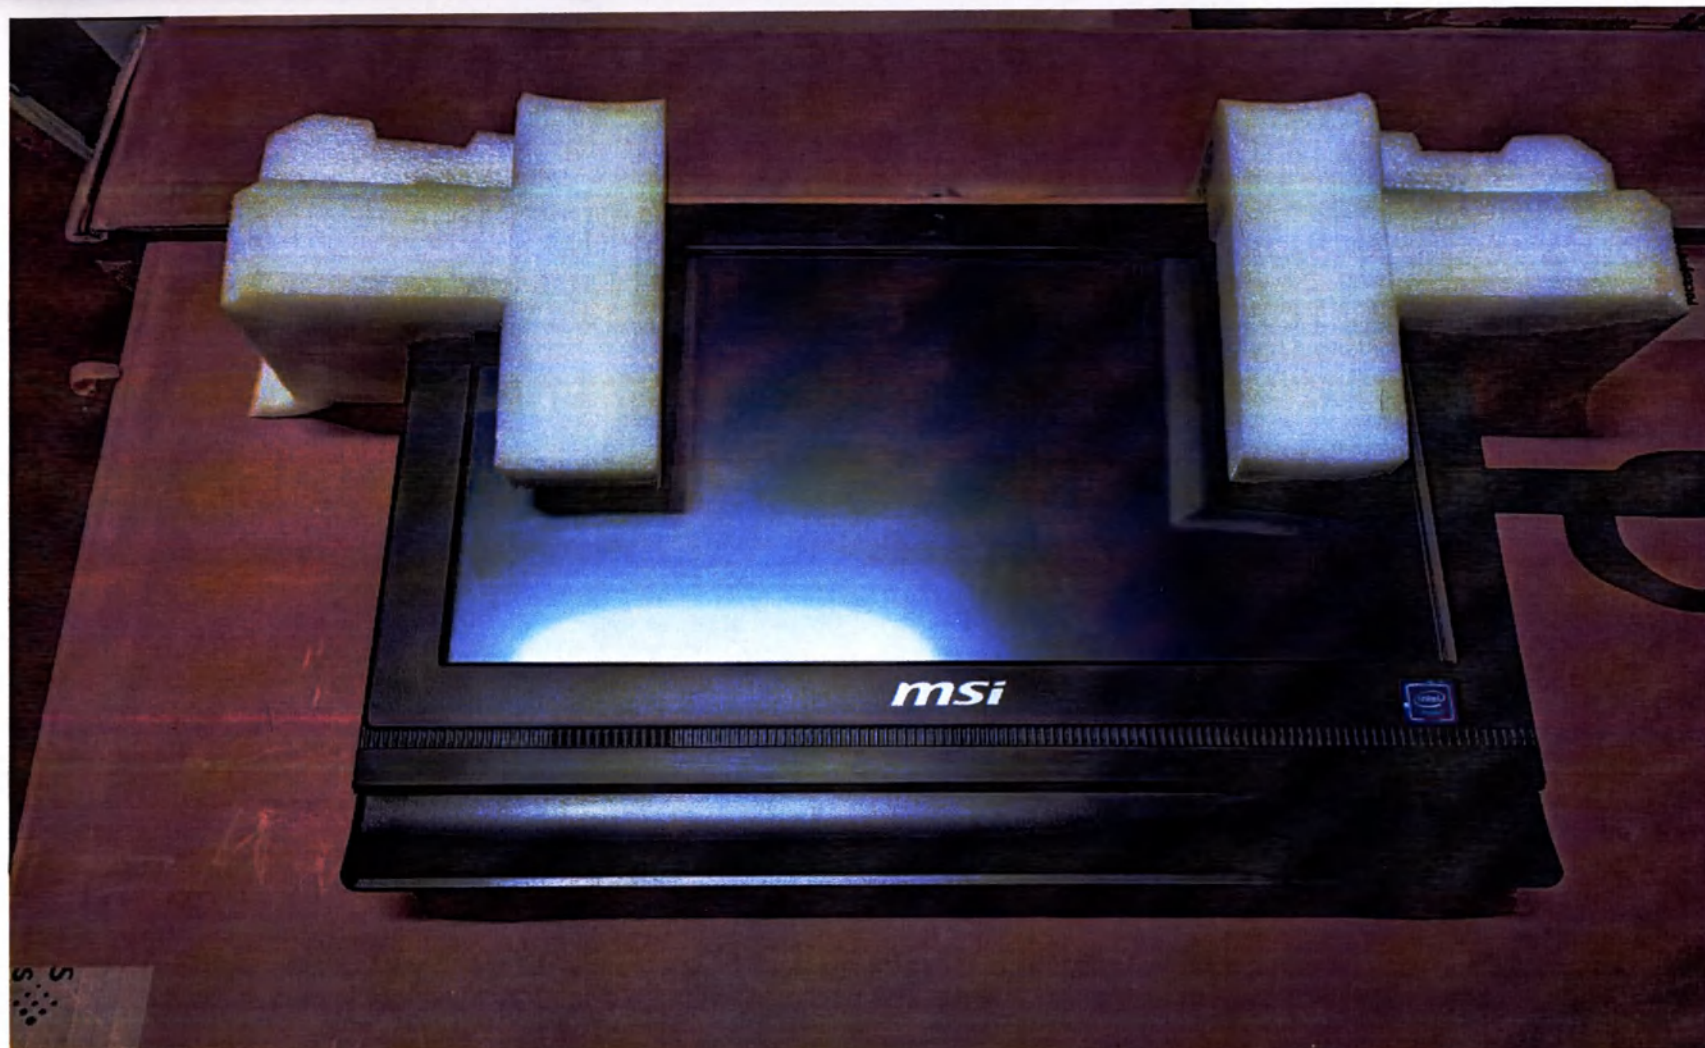


Управляющее устройство, входящее в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06

(Вариант исполнения Моноблок)



Управляющее устройство, входящее в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06

(Вариант исполнения Неттоп)

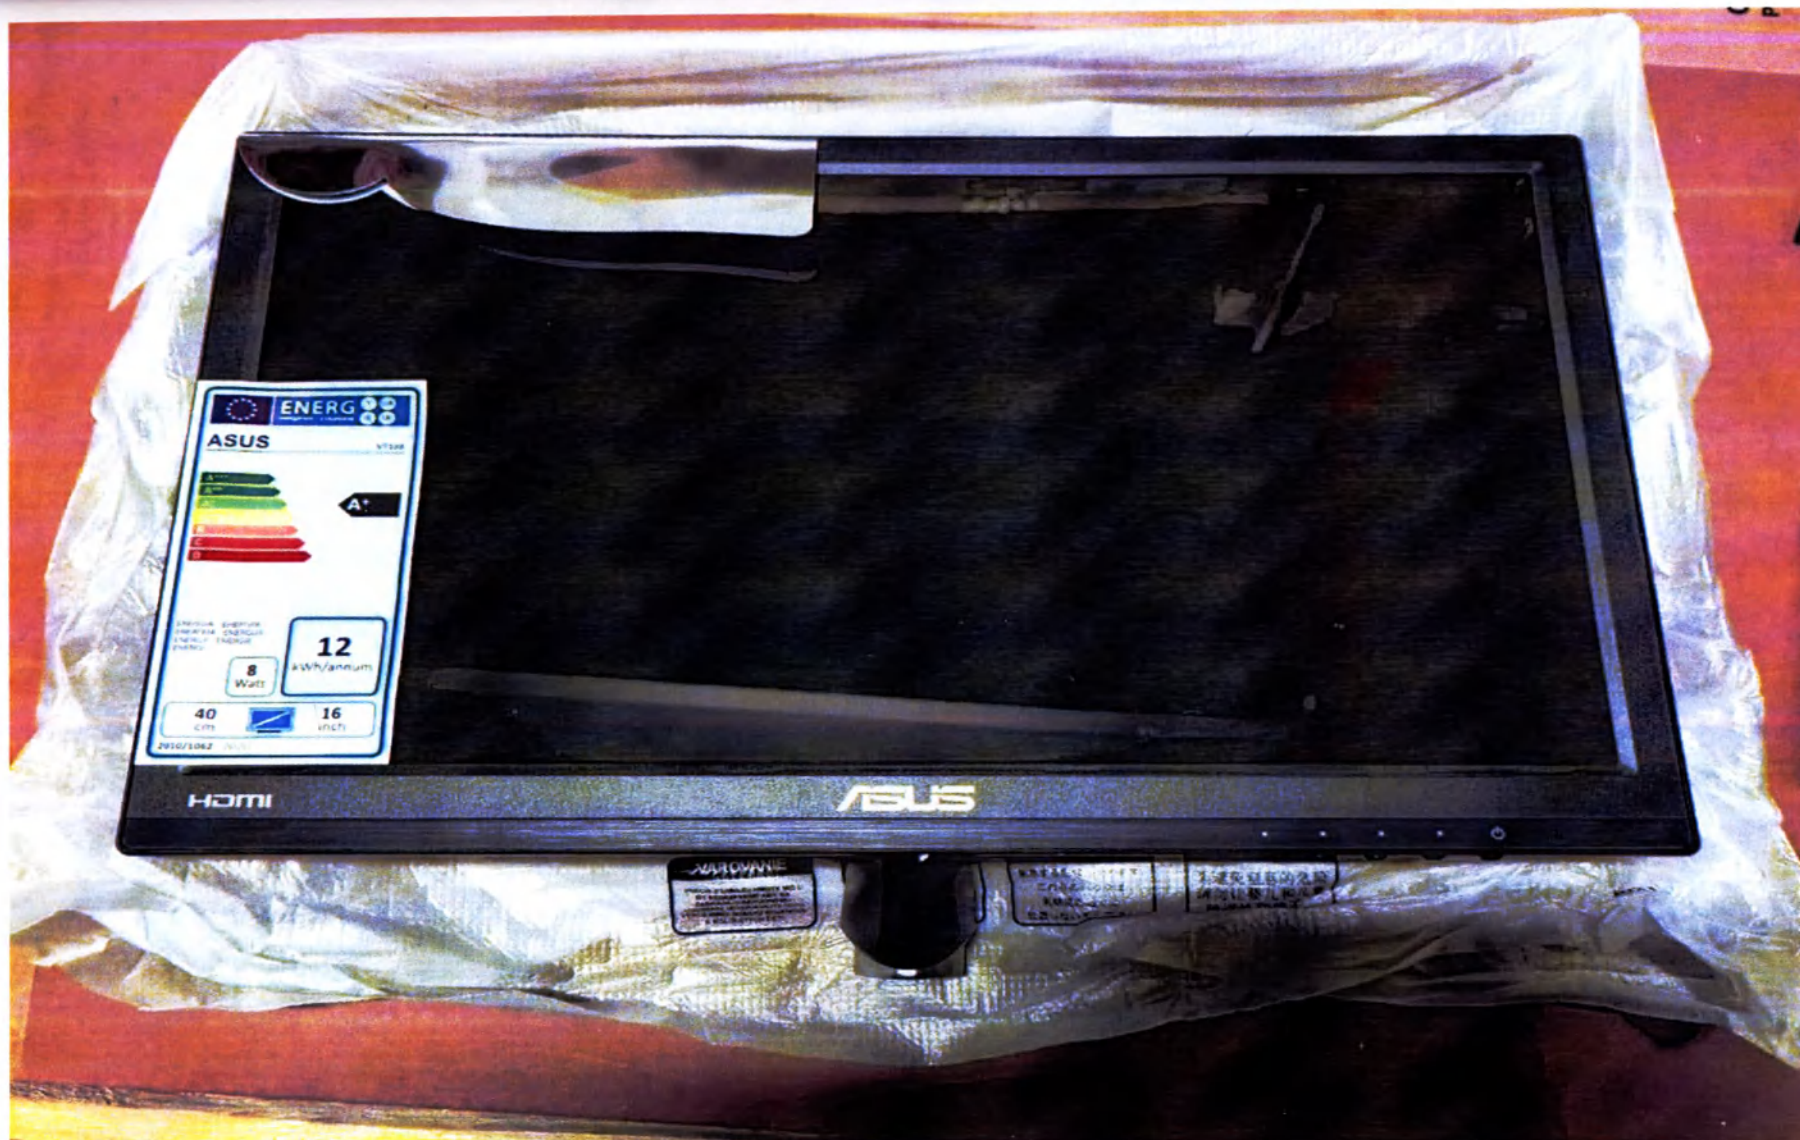


Монитор, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модель TM-2655P, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06




Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса серии BP модели Watch BP Office, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06

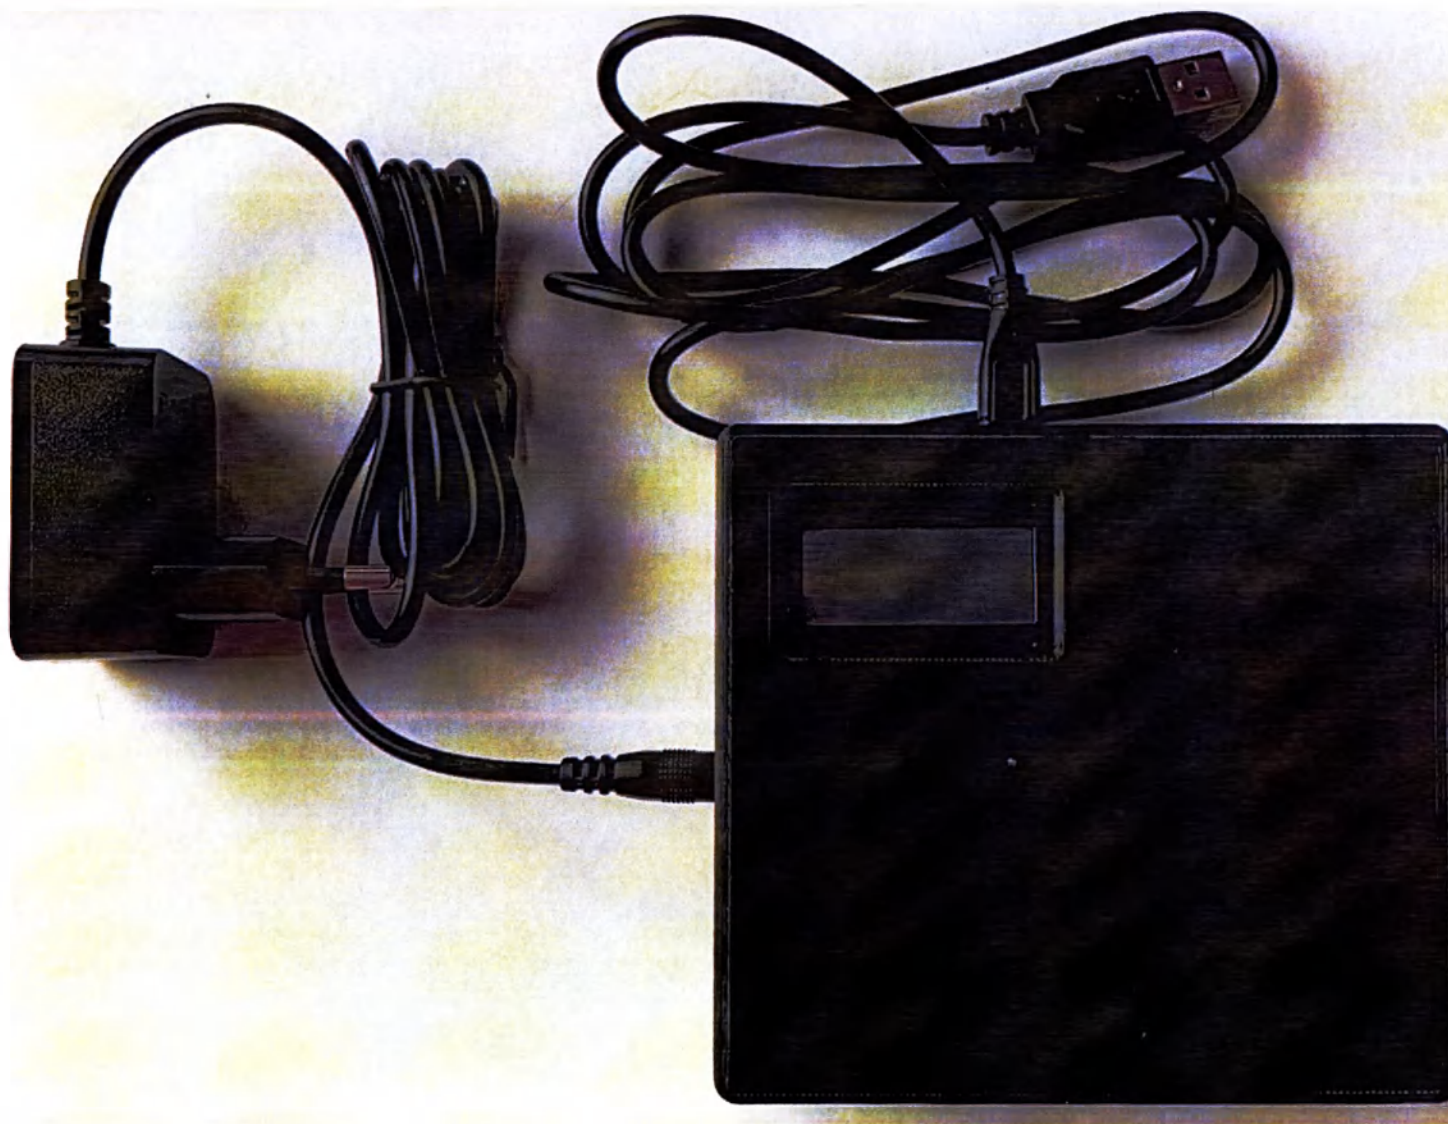

?

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Medpoint24 BPM-M1, входящий в состав вариантов исполнения:
Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04,
Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06

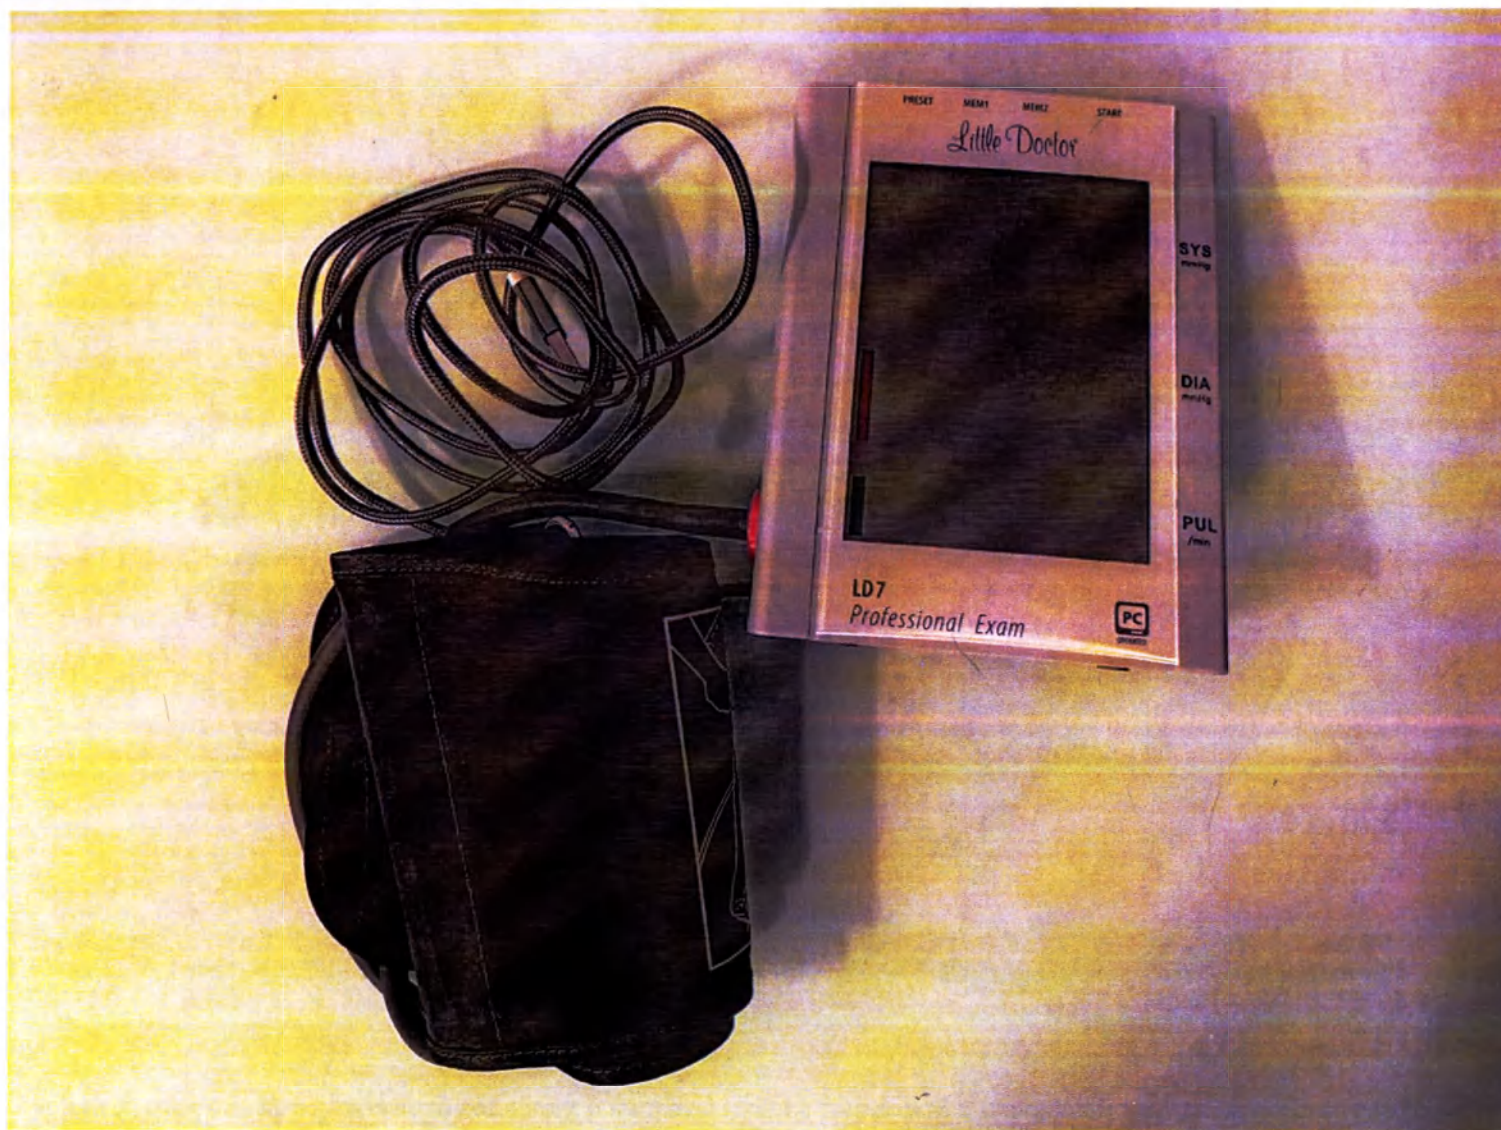

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD с принадлежностями, вариант исполнения LD7, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



?

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по «Блютус» (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



?


Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой серии UA с принадлежностями, модель UA-767, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения Динго E-200, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения Динго E-200 (В), входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06

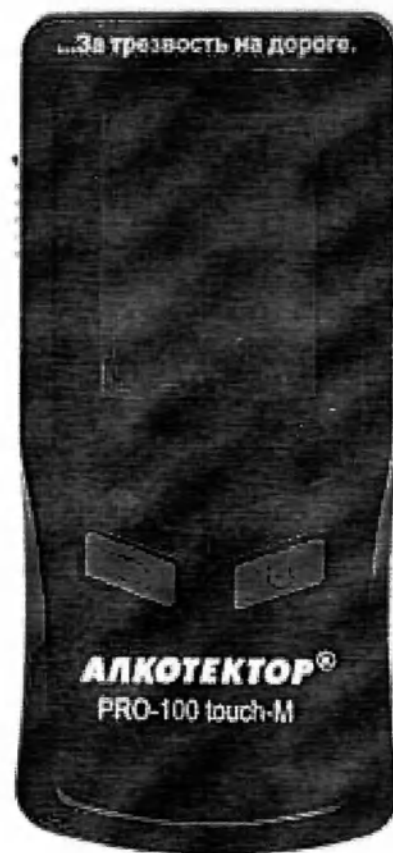

?

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M" с принадлежностями, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



Бесконтактный инфракрасный Термометр Bercom JXB-183, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06




Термометр инфракрасный бесконтактный Medpoint24 IRT-M1, входящий в состав вариантов исполнения: Автоматизированная система Medpoint24-02, Автоматизированная система Medpoint24-03, Автоматизированная система Medpoint24-04, Автоматизированная система Medpoint24-05, Автоматизированная система Medpoint24-06



Принадлежности:

Термопринтер

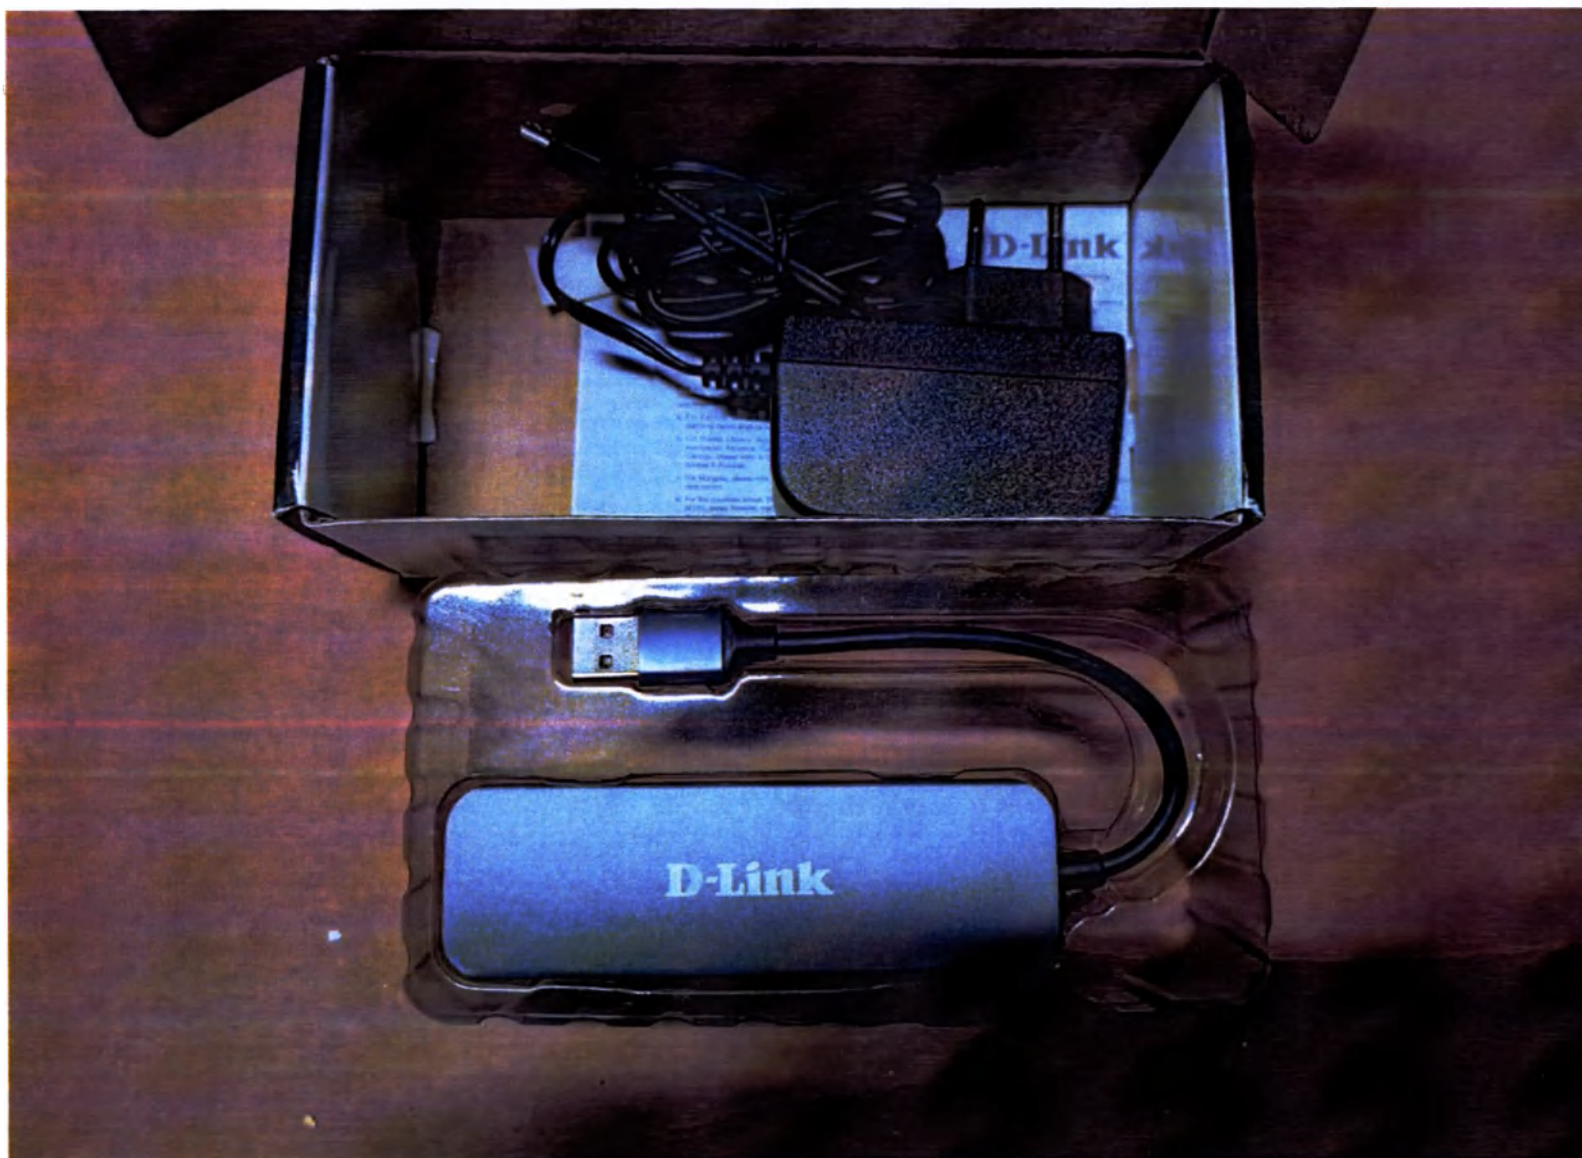


USB концентратор для подключения дополнительных устройств




Камера




Считыватель смарт карт для идентификации

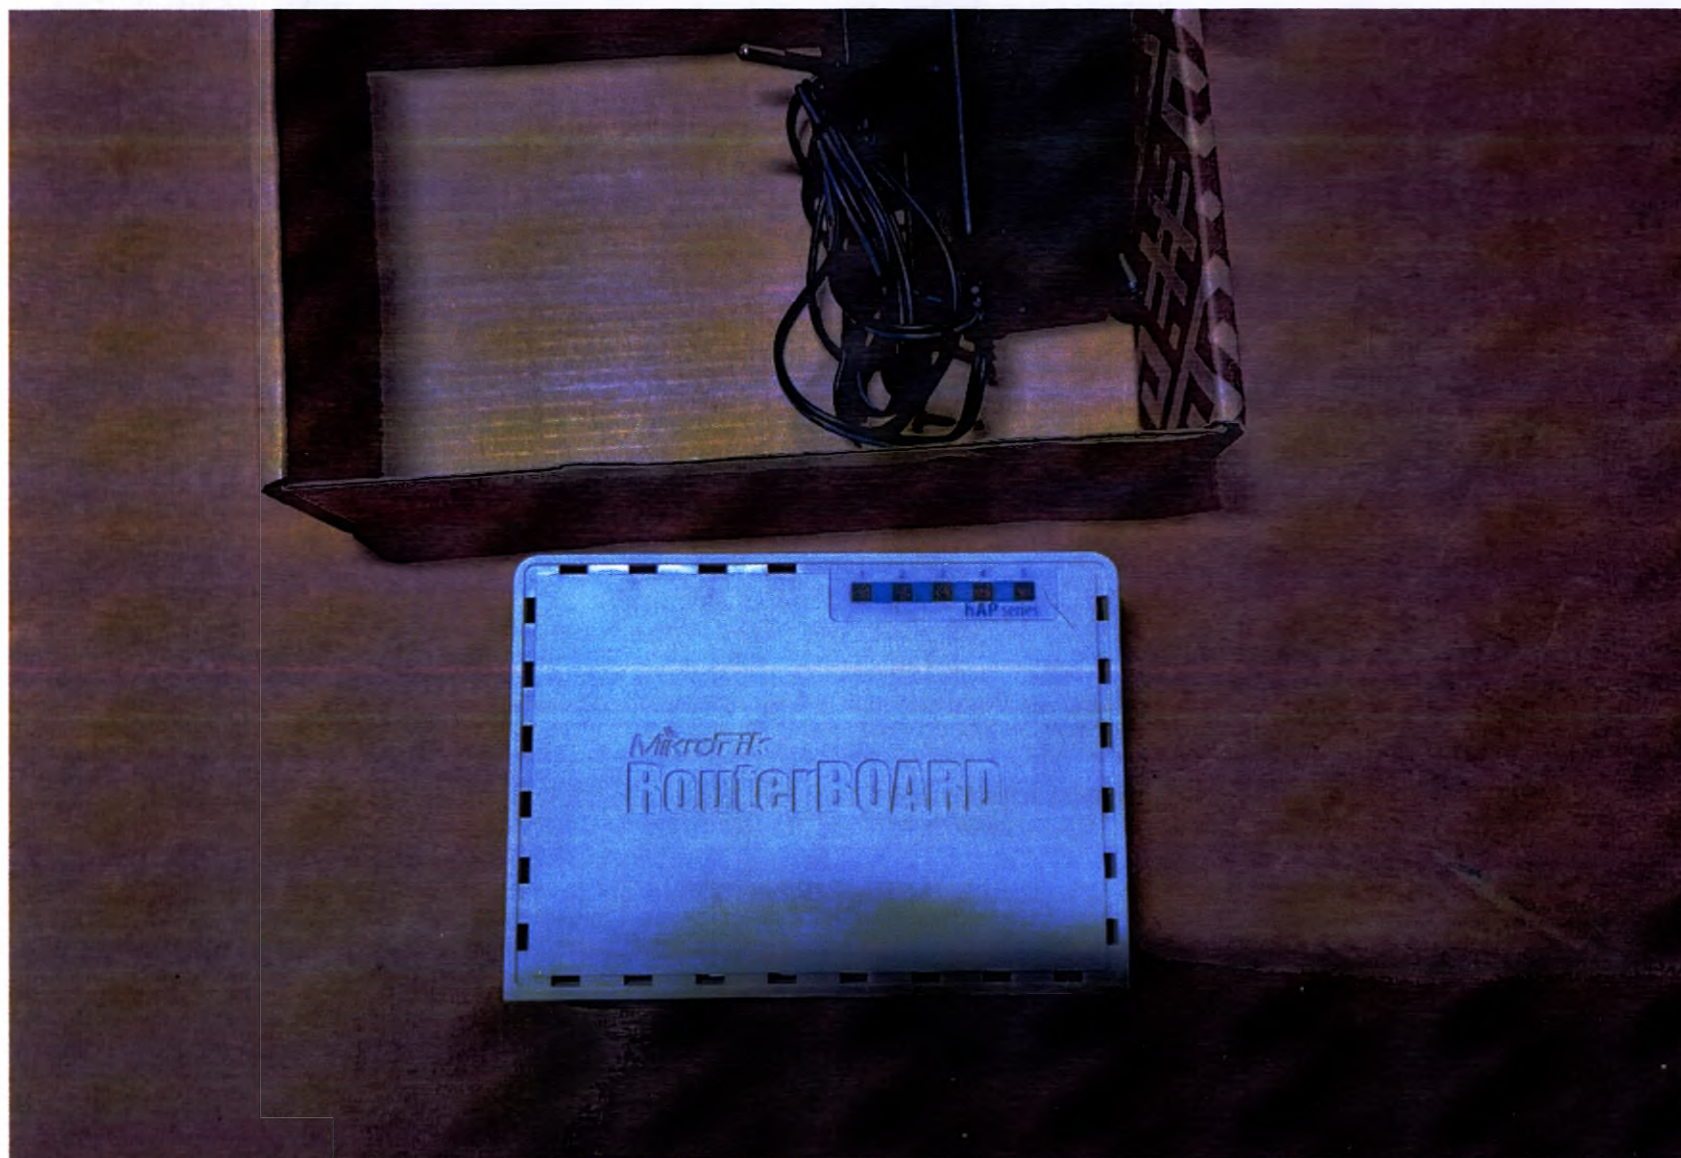


Маршрутизатор для подключения к сети Internet

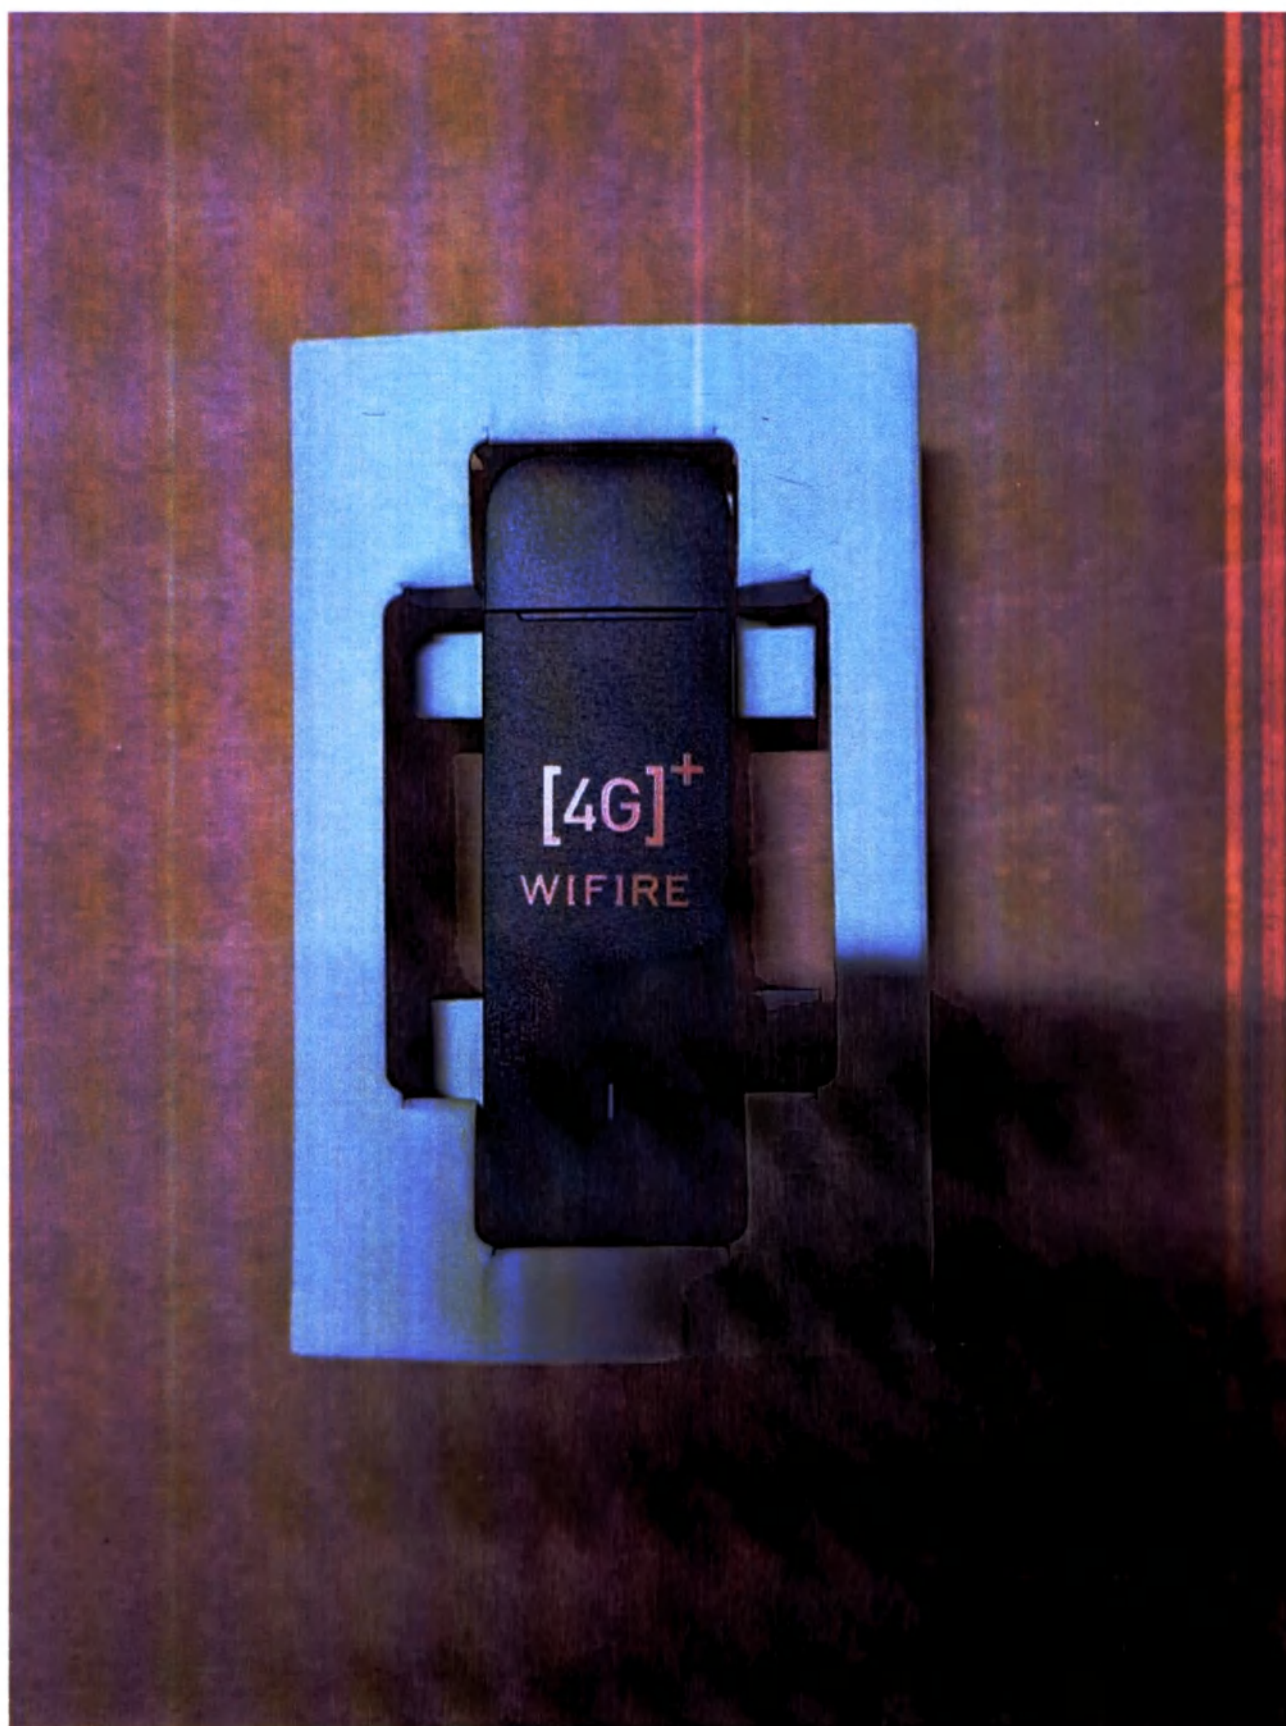

USB-модем

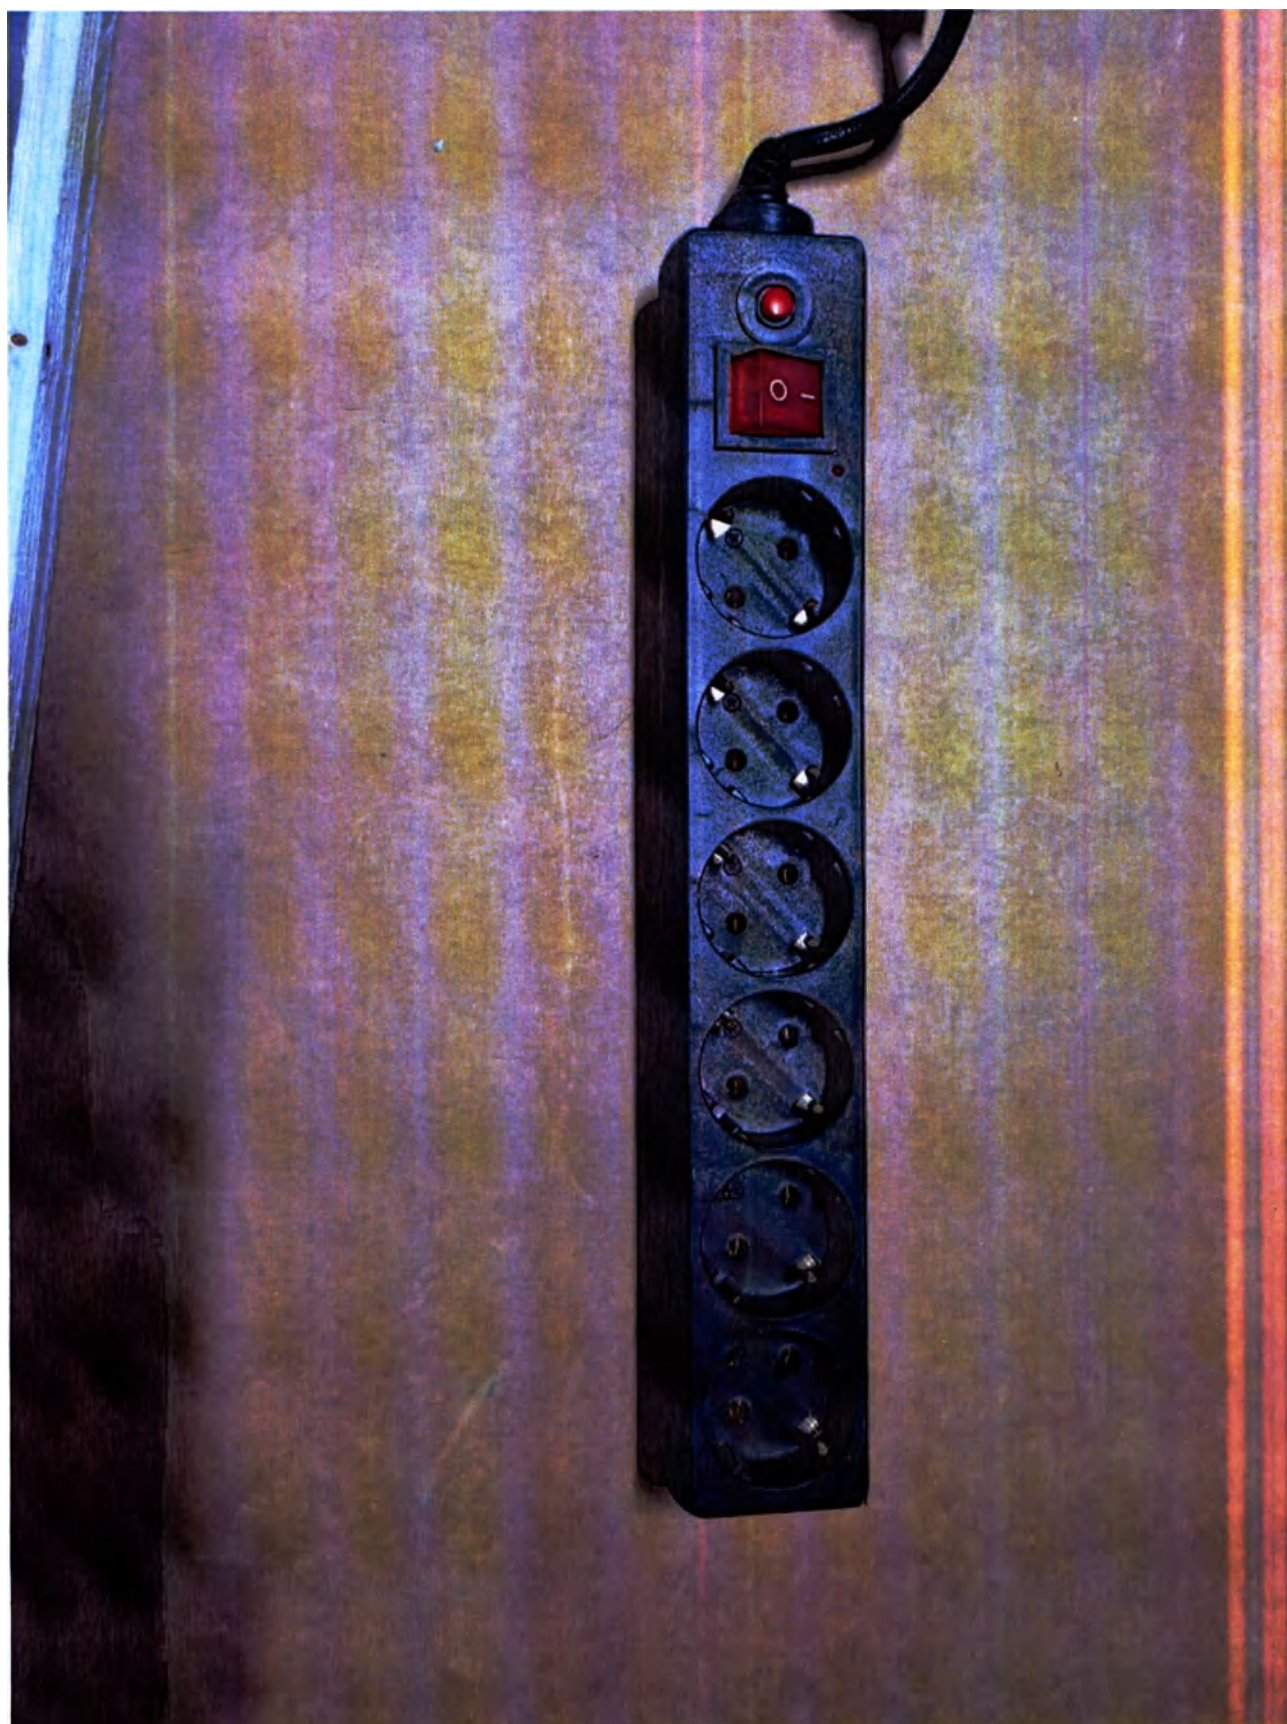


Сетевой фильтр-удлинитель

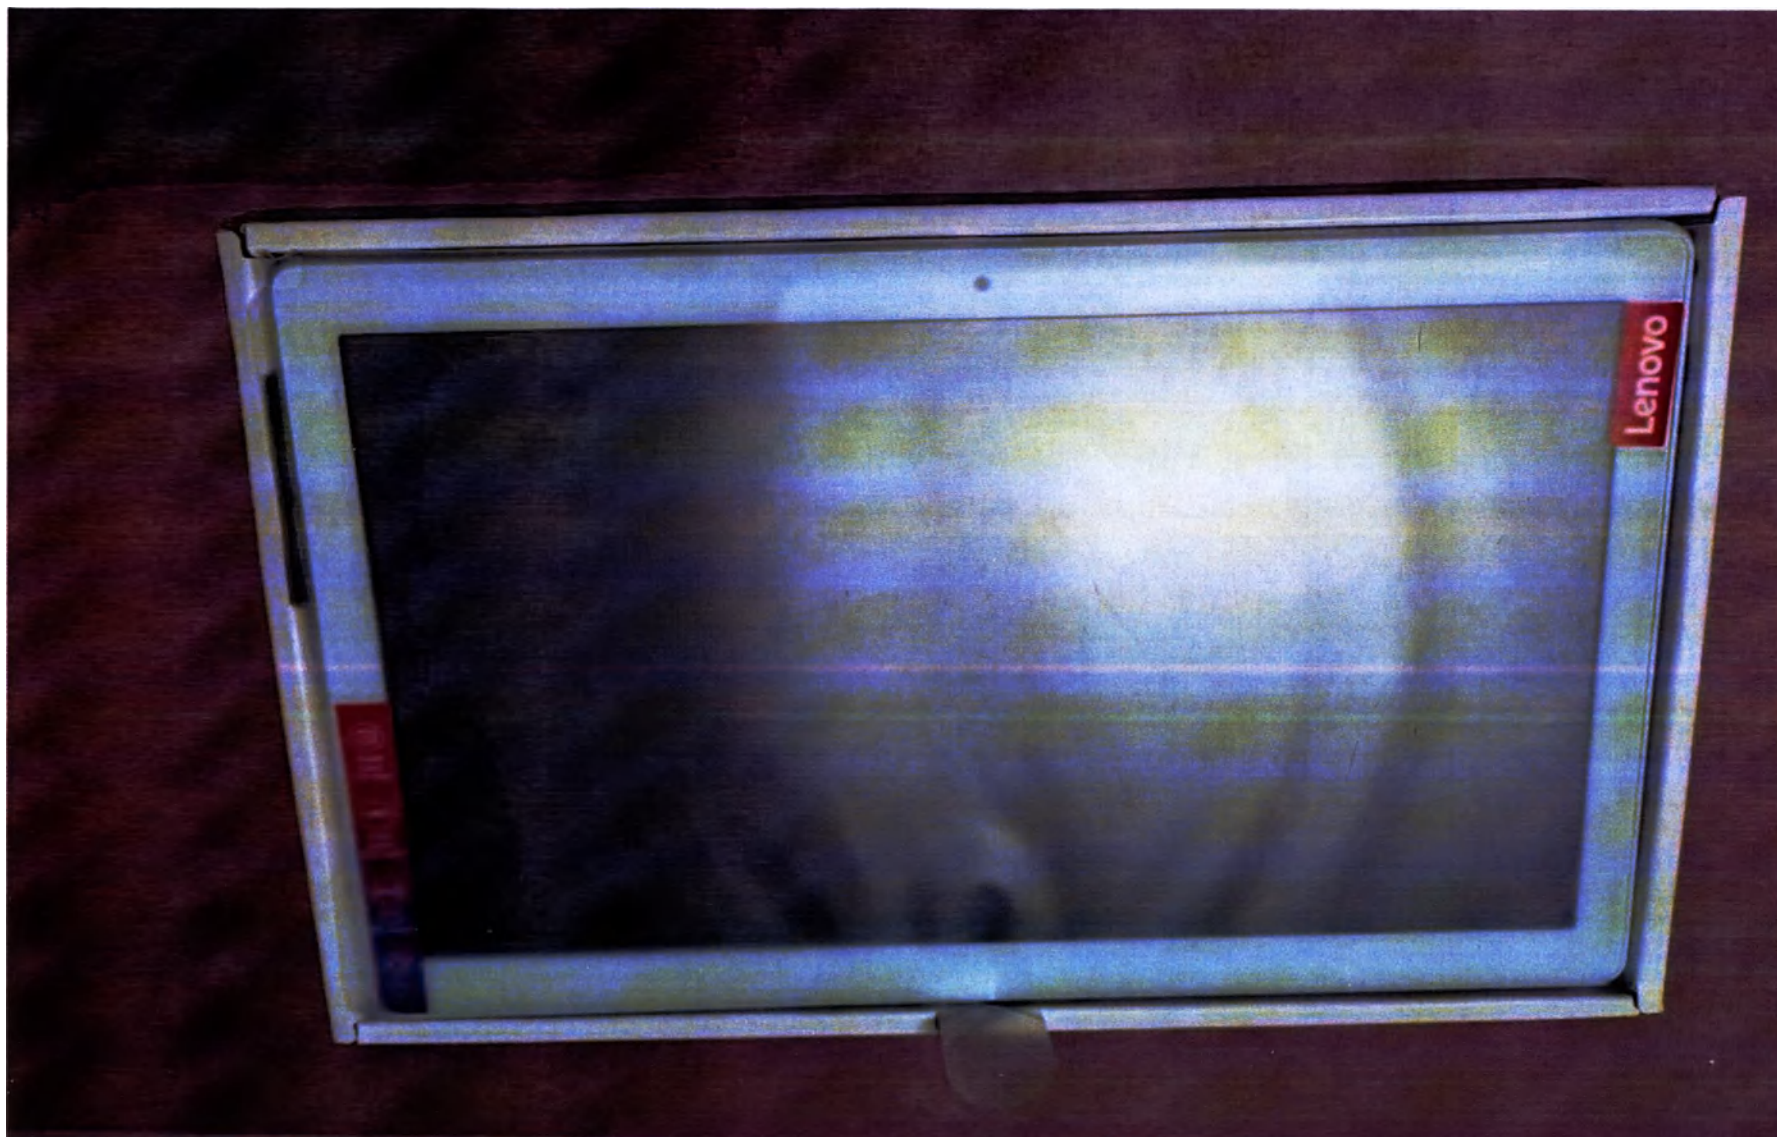

Планшет




Источник бесперебойного питания

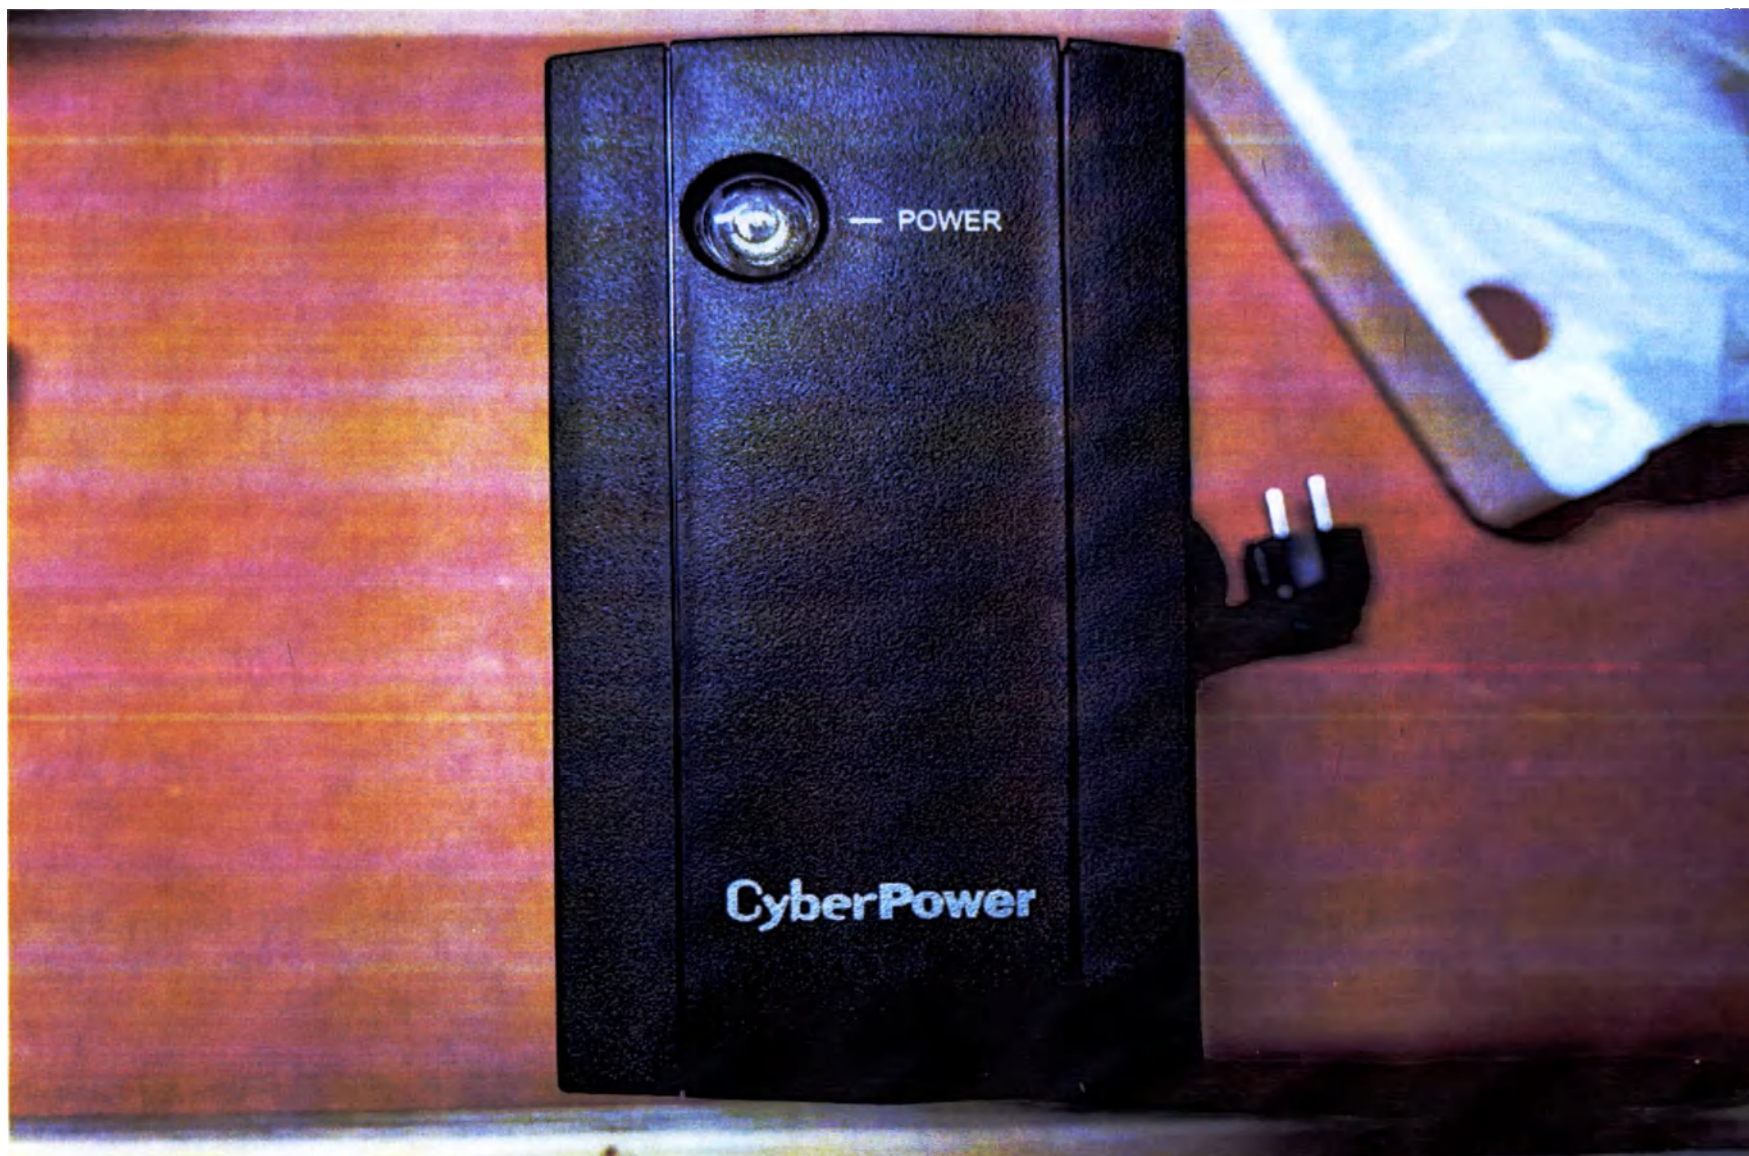

Стабилизатор напряжения

Служба

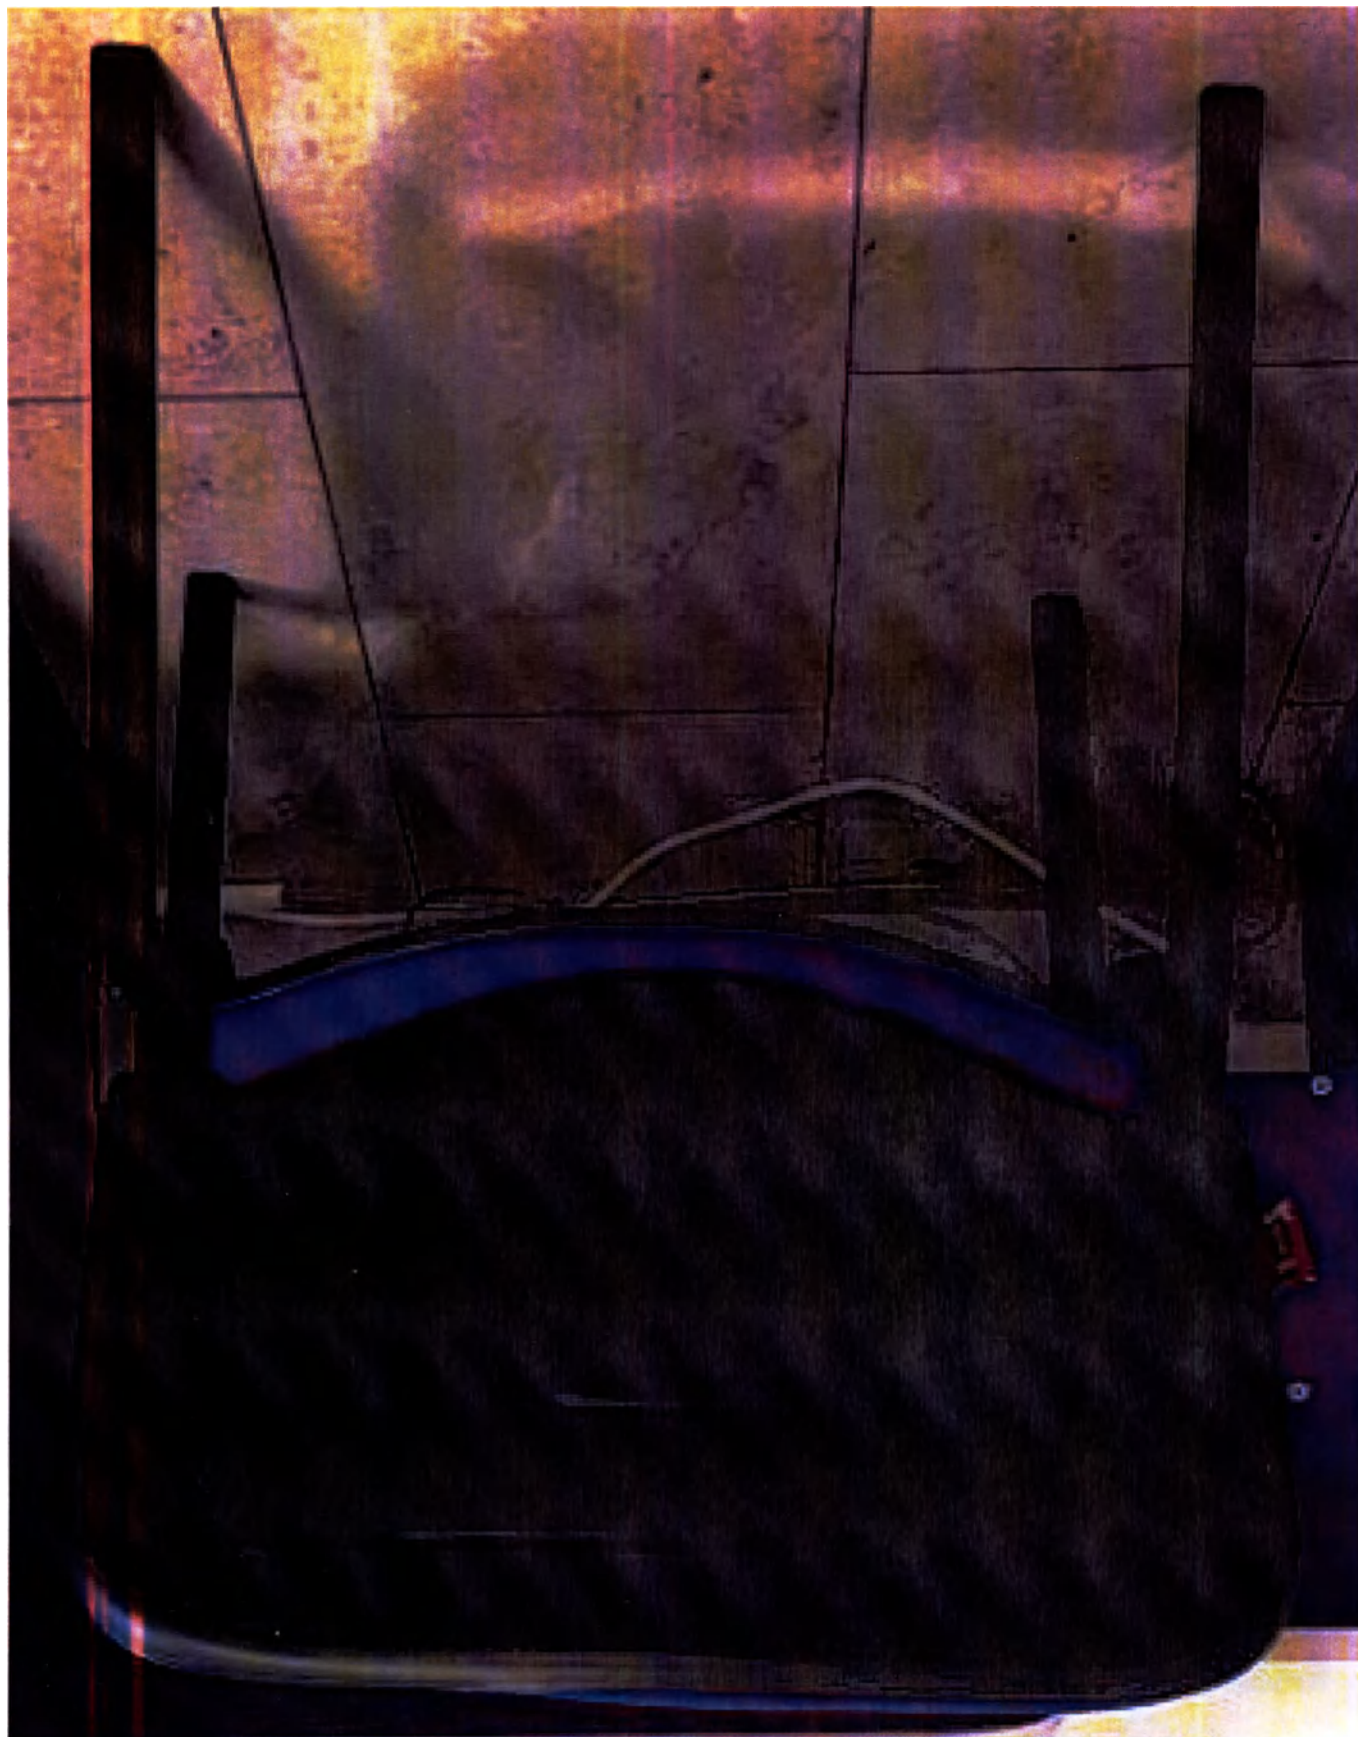



Антенна для усиления сигнала сети



Сервер

Генеральный директор
ООО "Арциус" -
- управляющей компании
ООО "МедПоинт24-Лаб"
Николаев А.Д.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
40 листа (ов)

27. 07. 2022