



Генеральный директор
ООО НТО «ИРЭ – Поллюс»



«А» декабрь 2022 г.

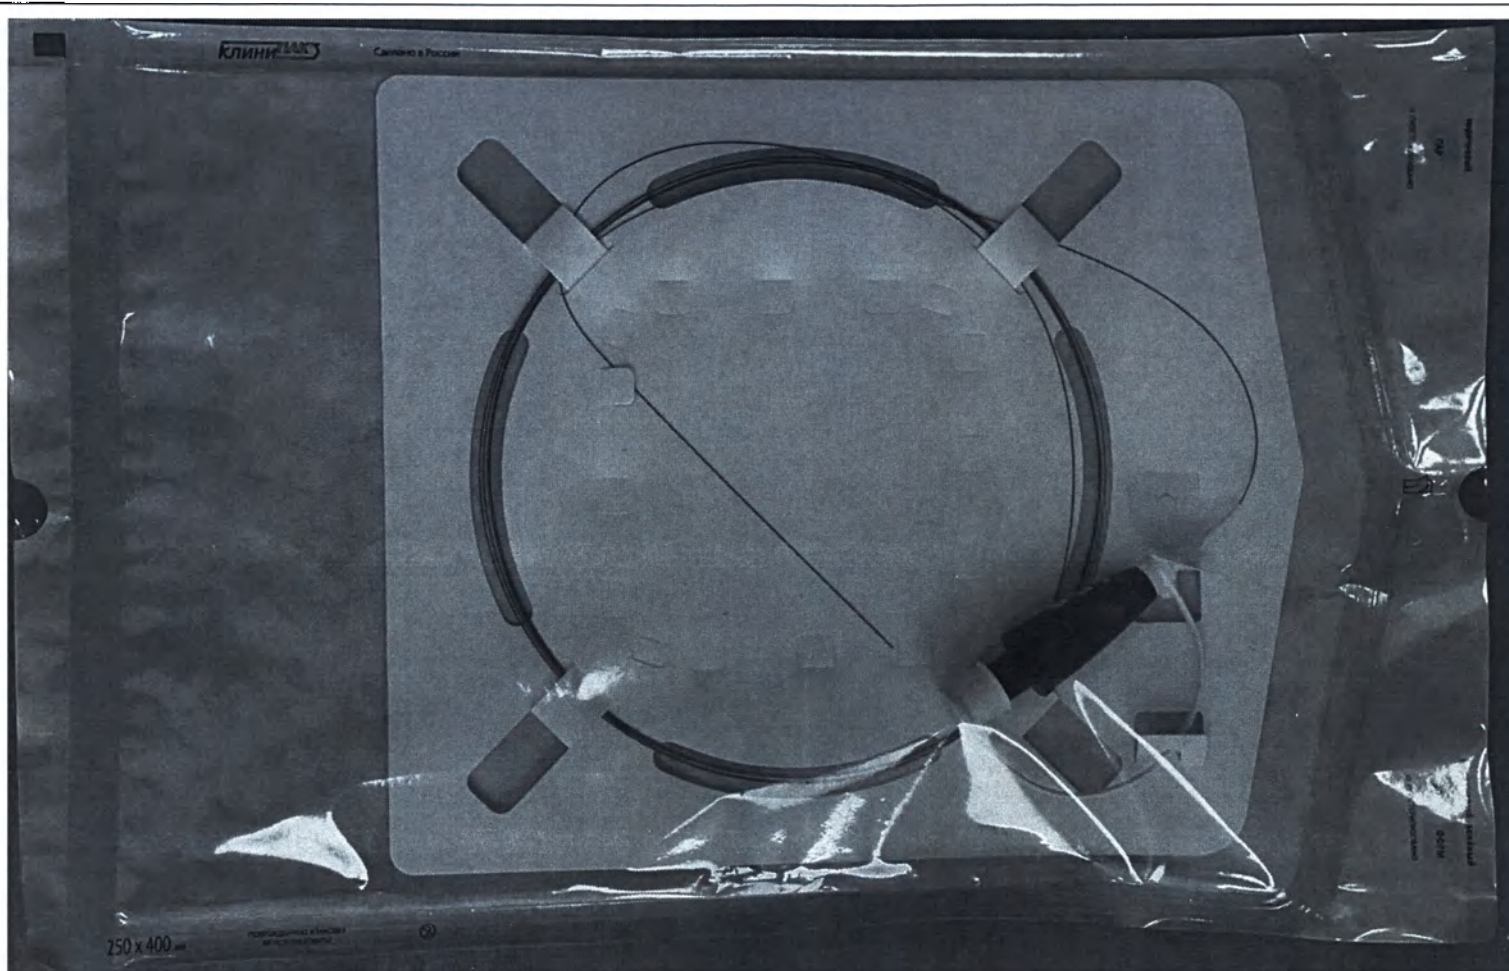

Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018


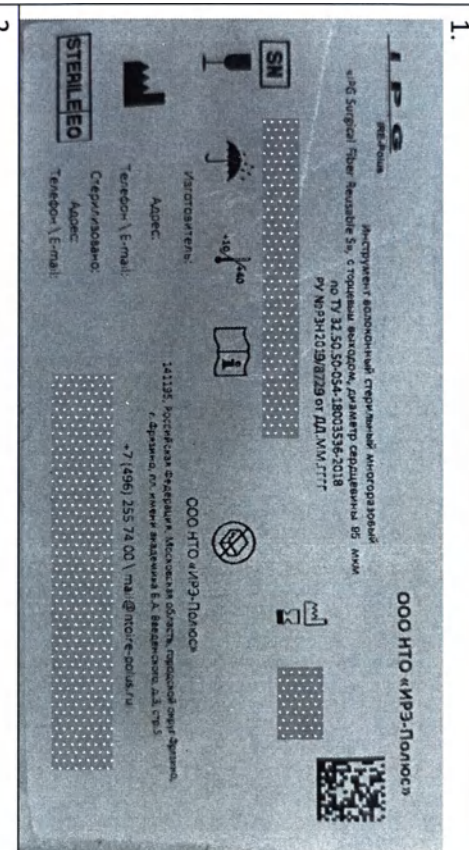


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 95 мкм

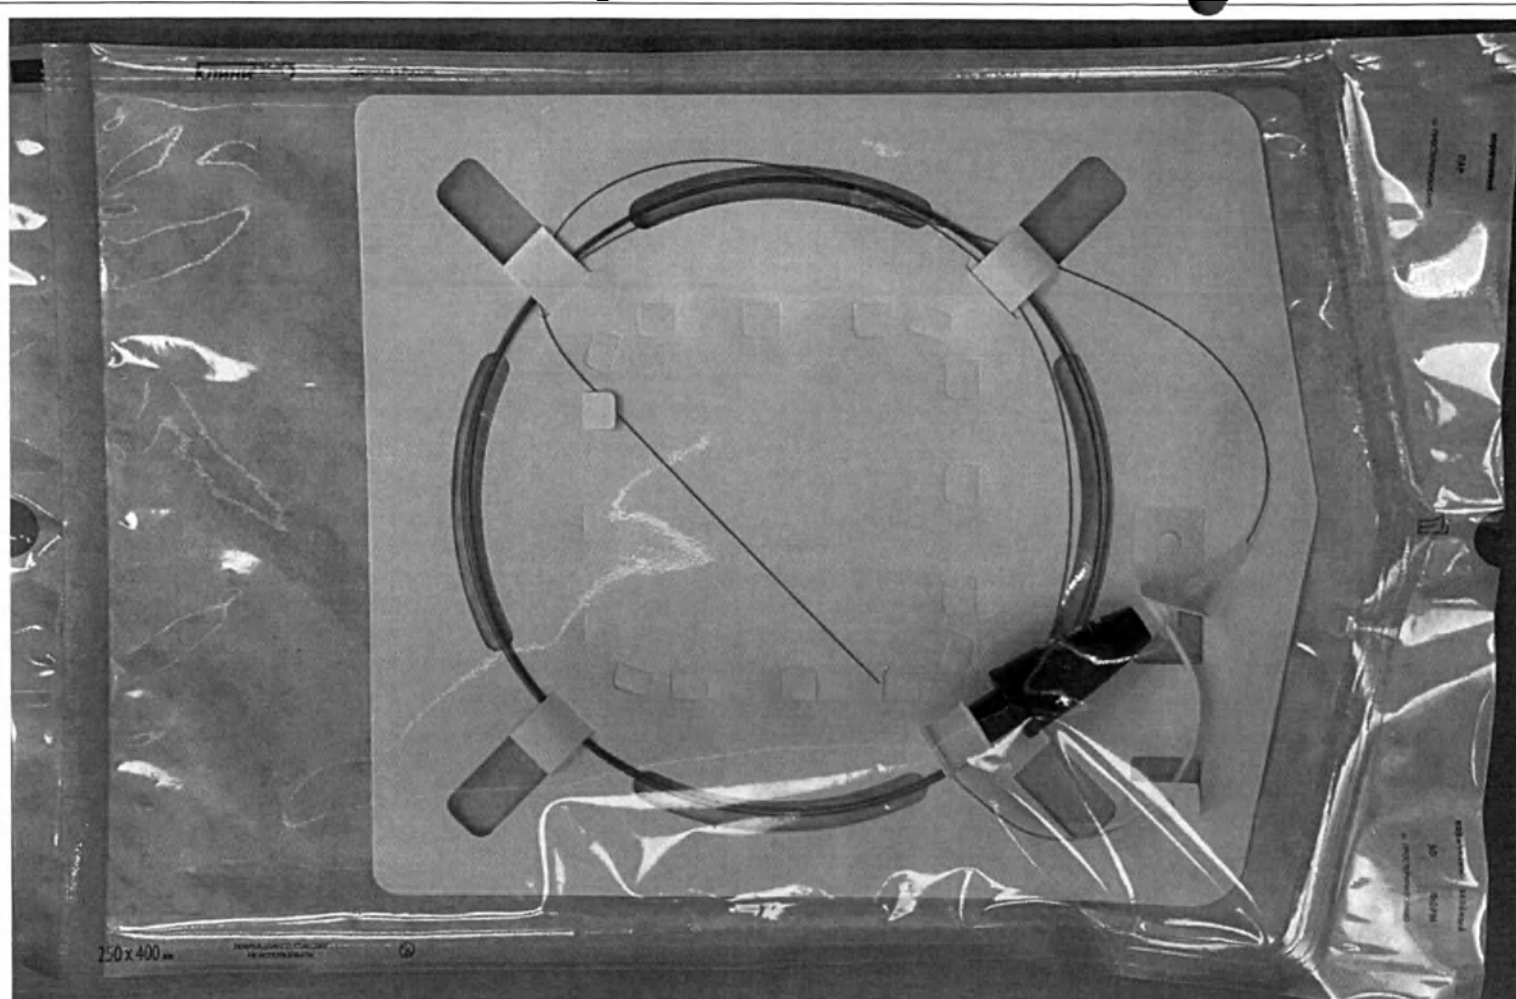
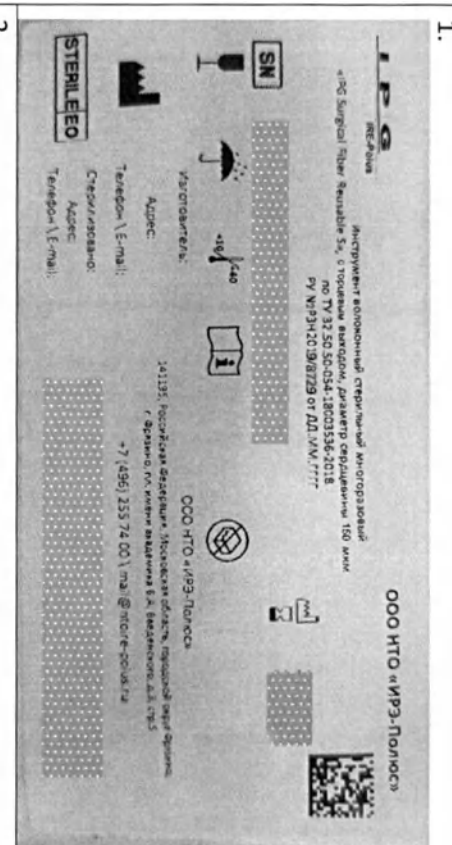


3. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки



4. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевинны 150 мкм

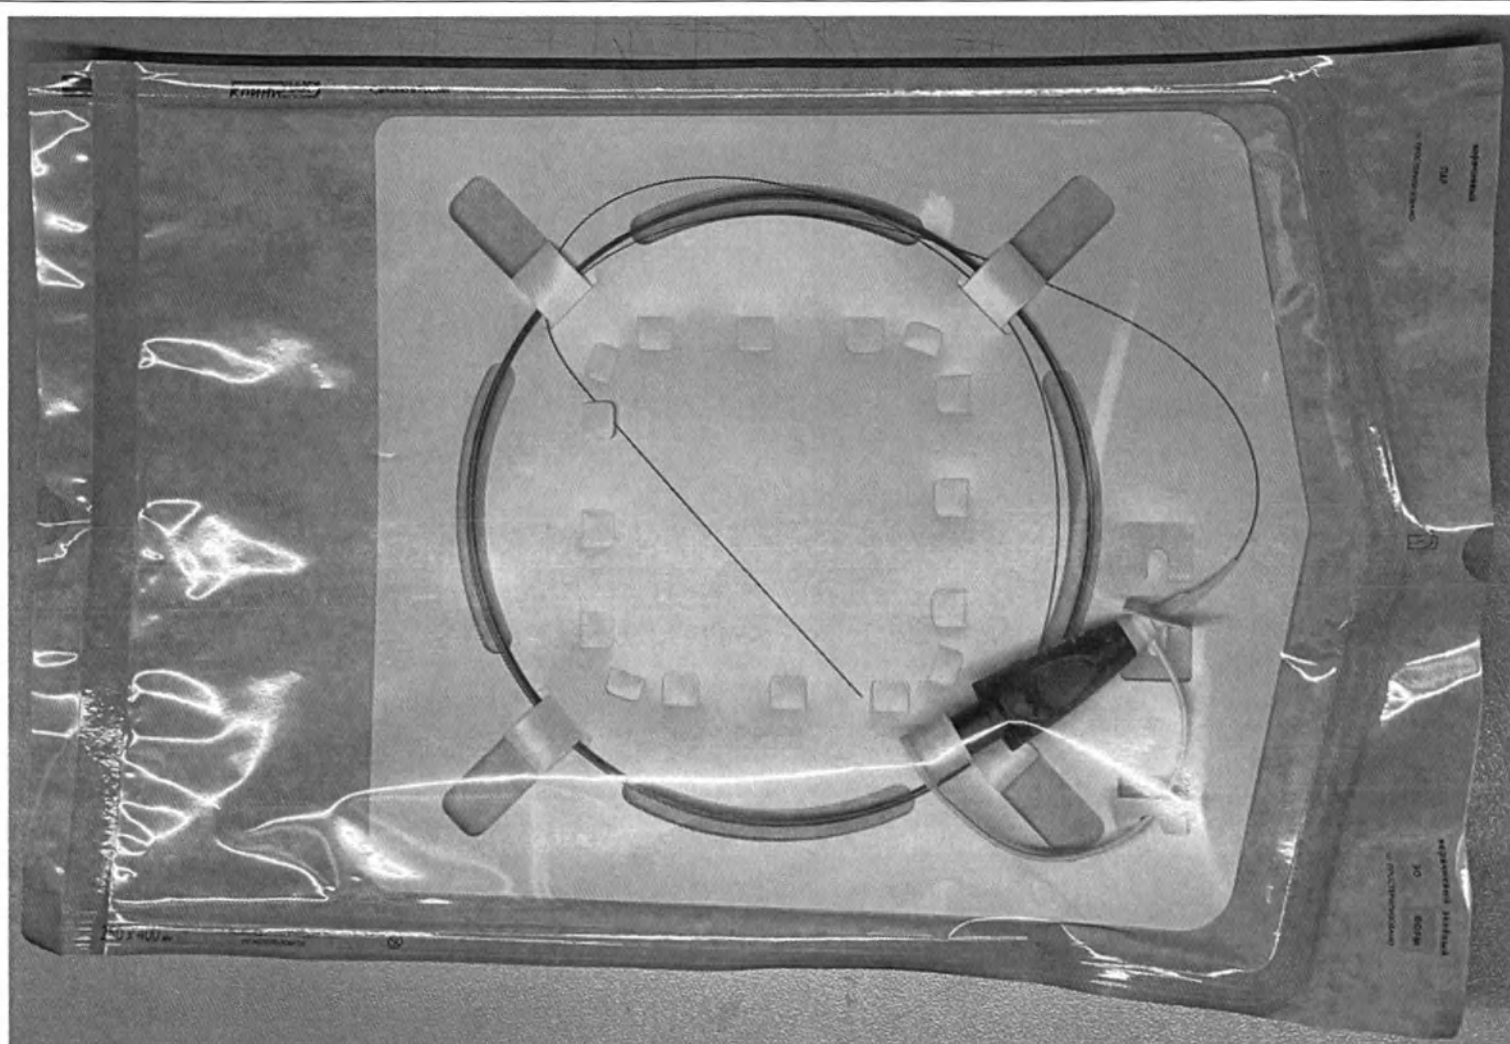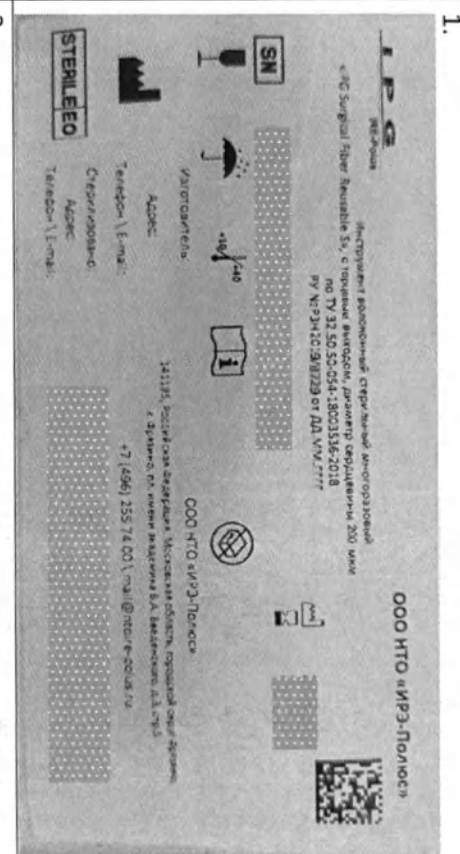



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм

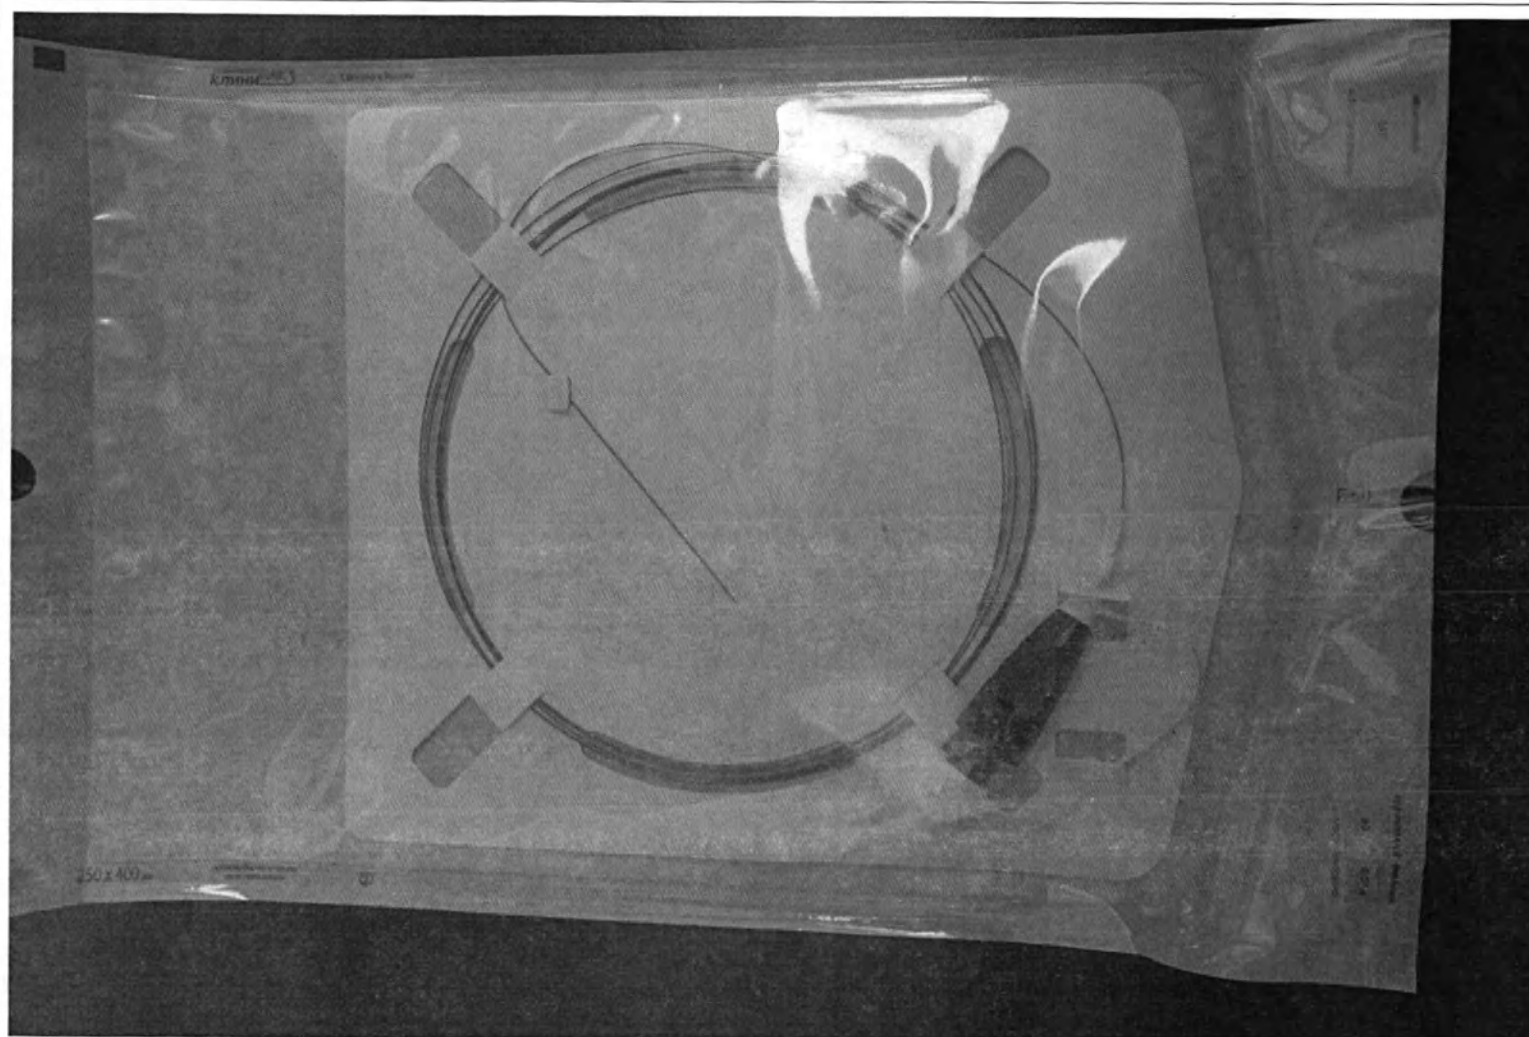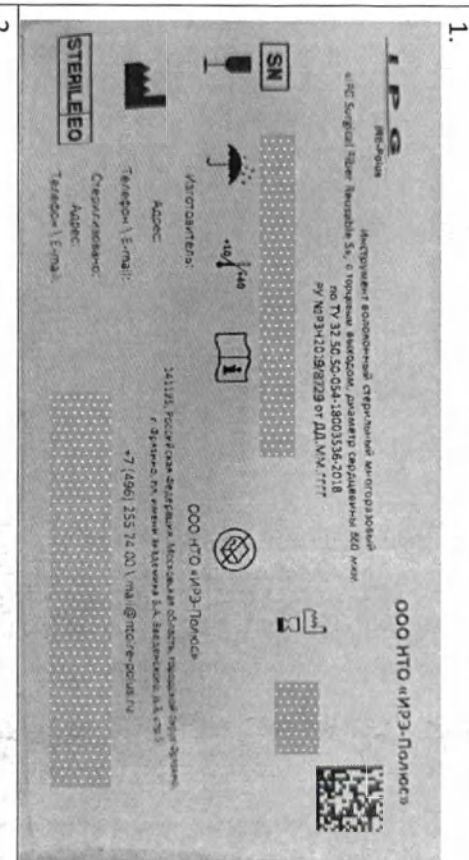



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм

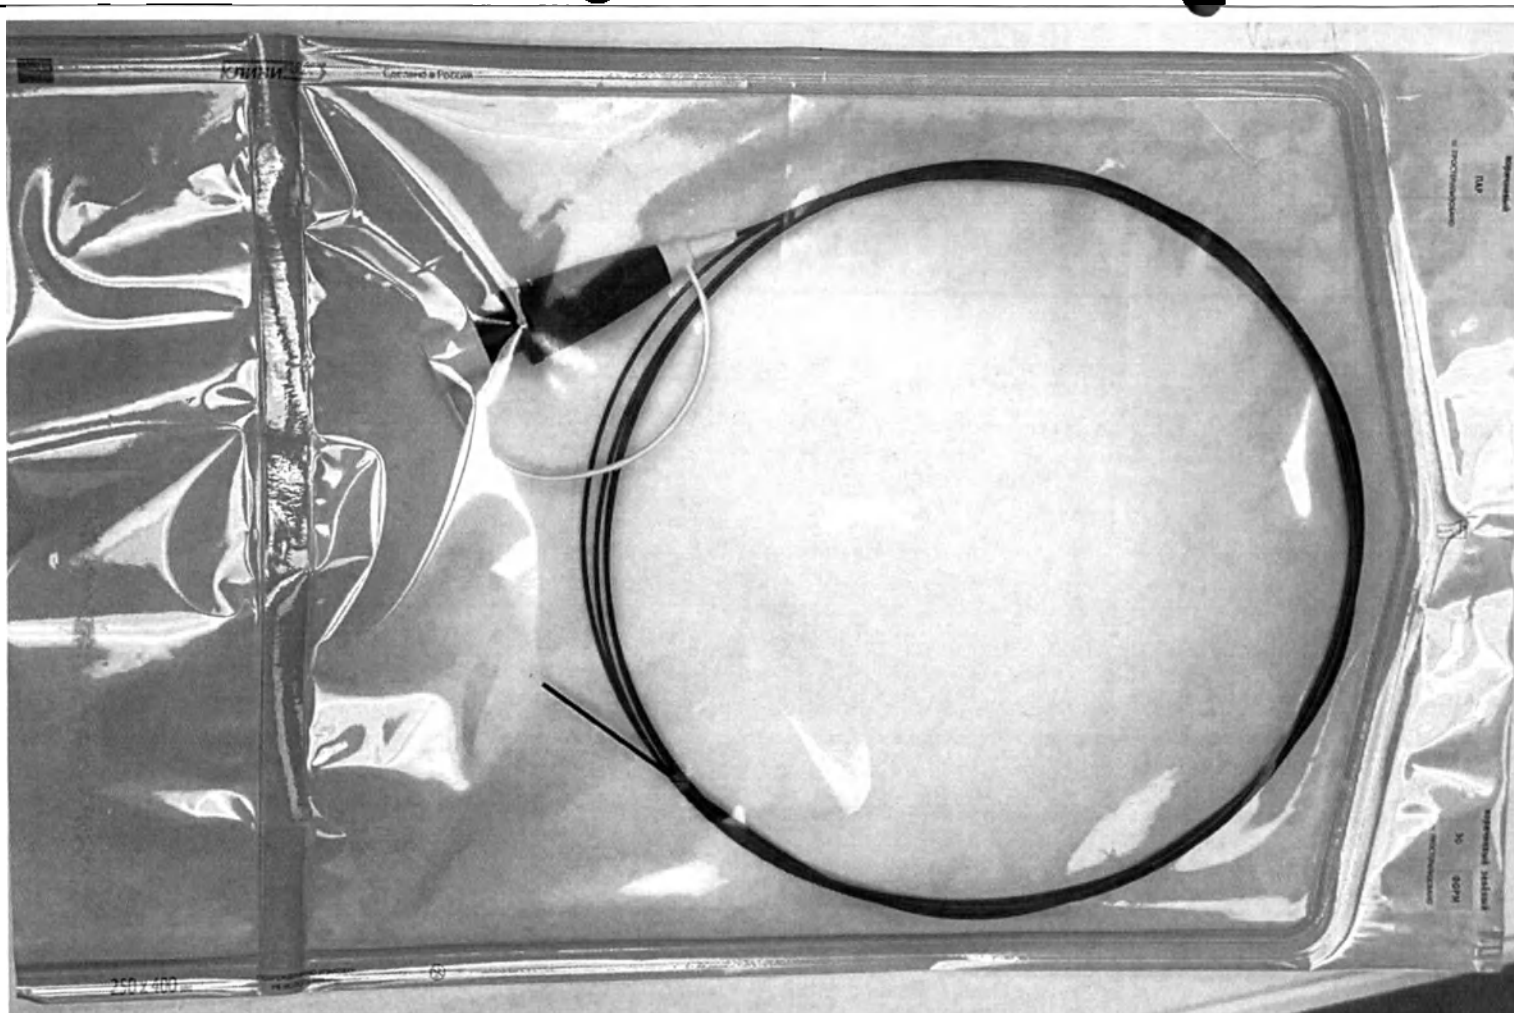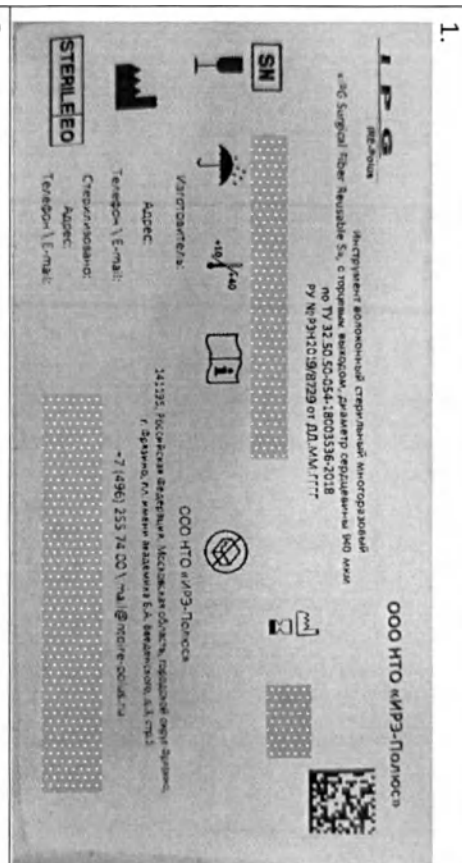


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм

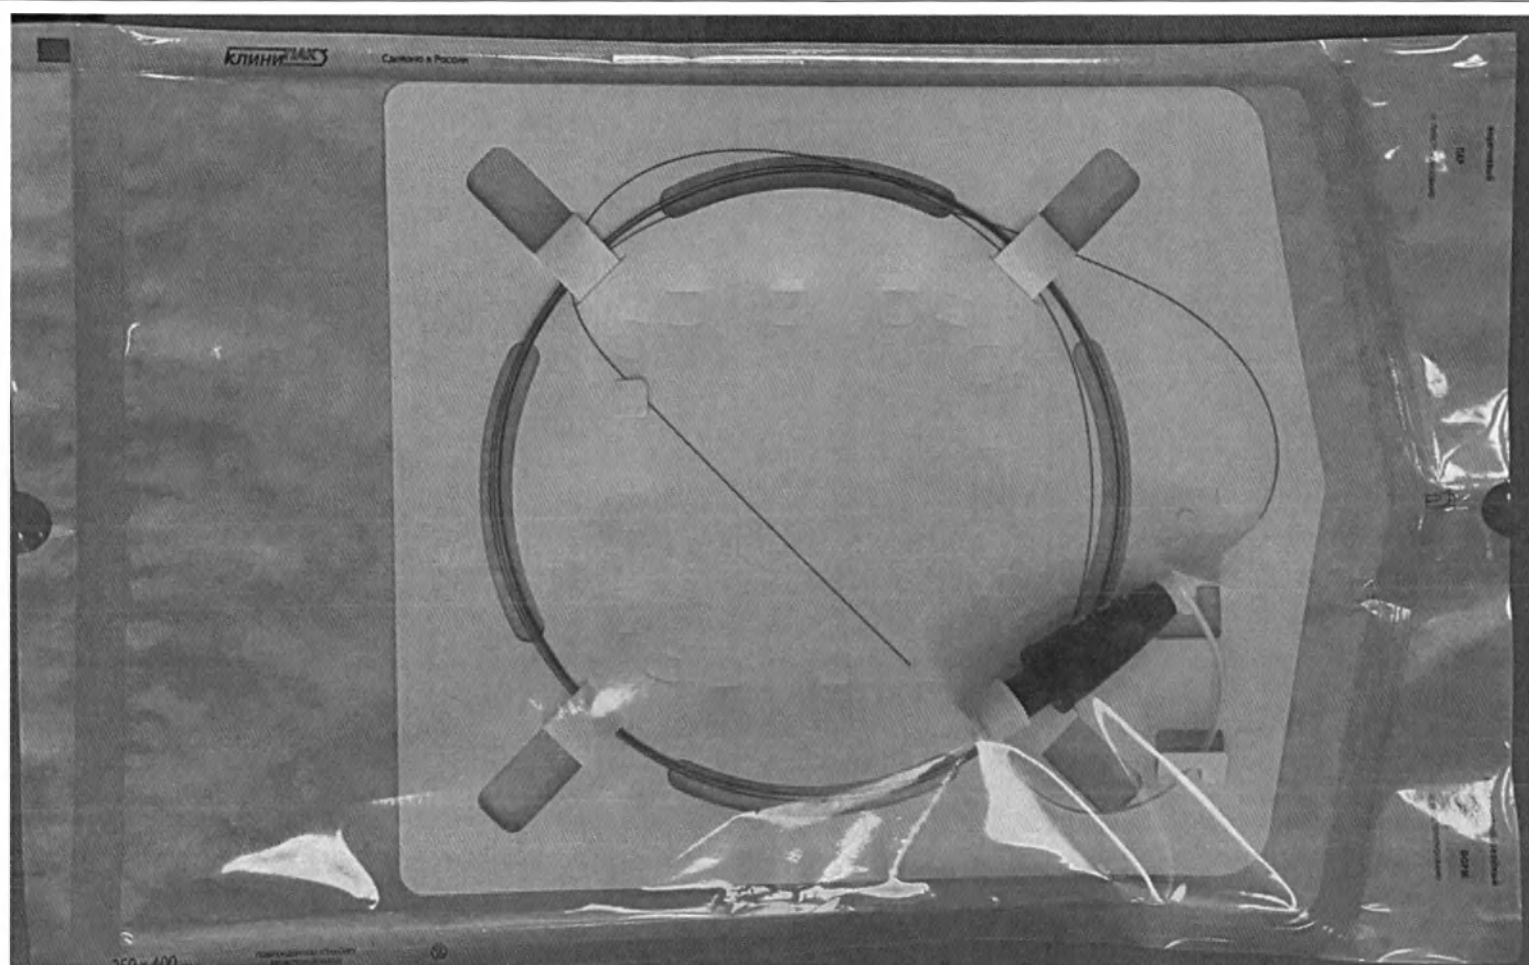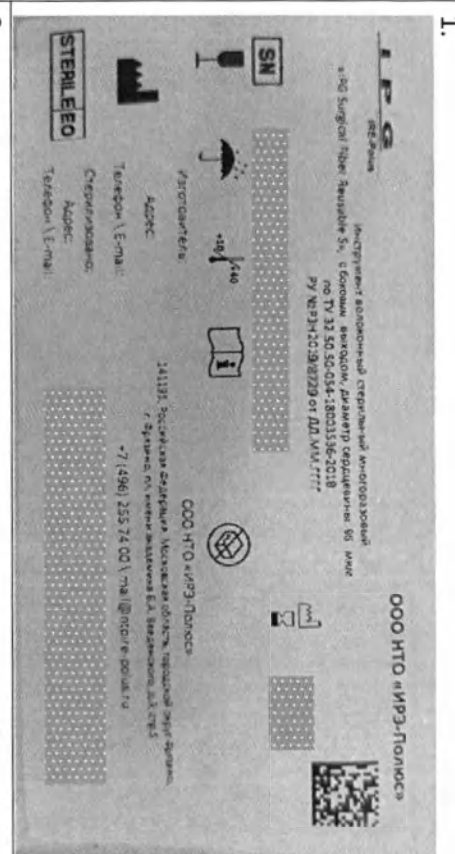



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многобазовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многобазовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 95 мкм.

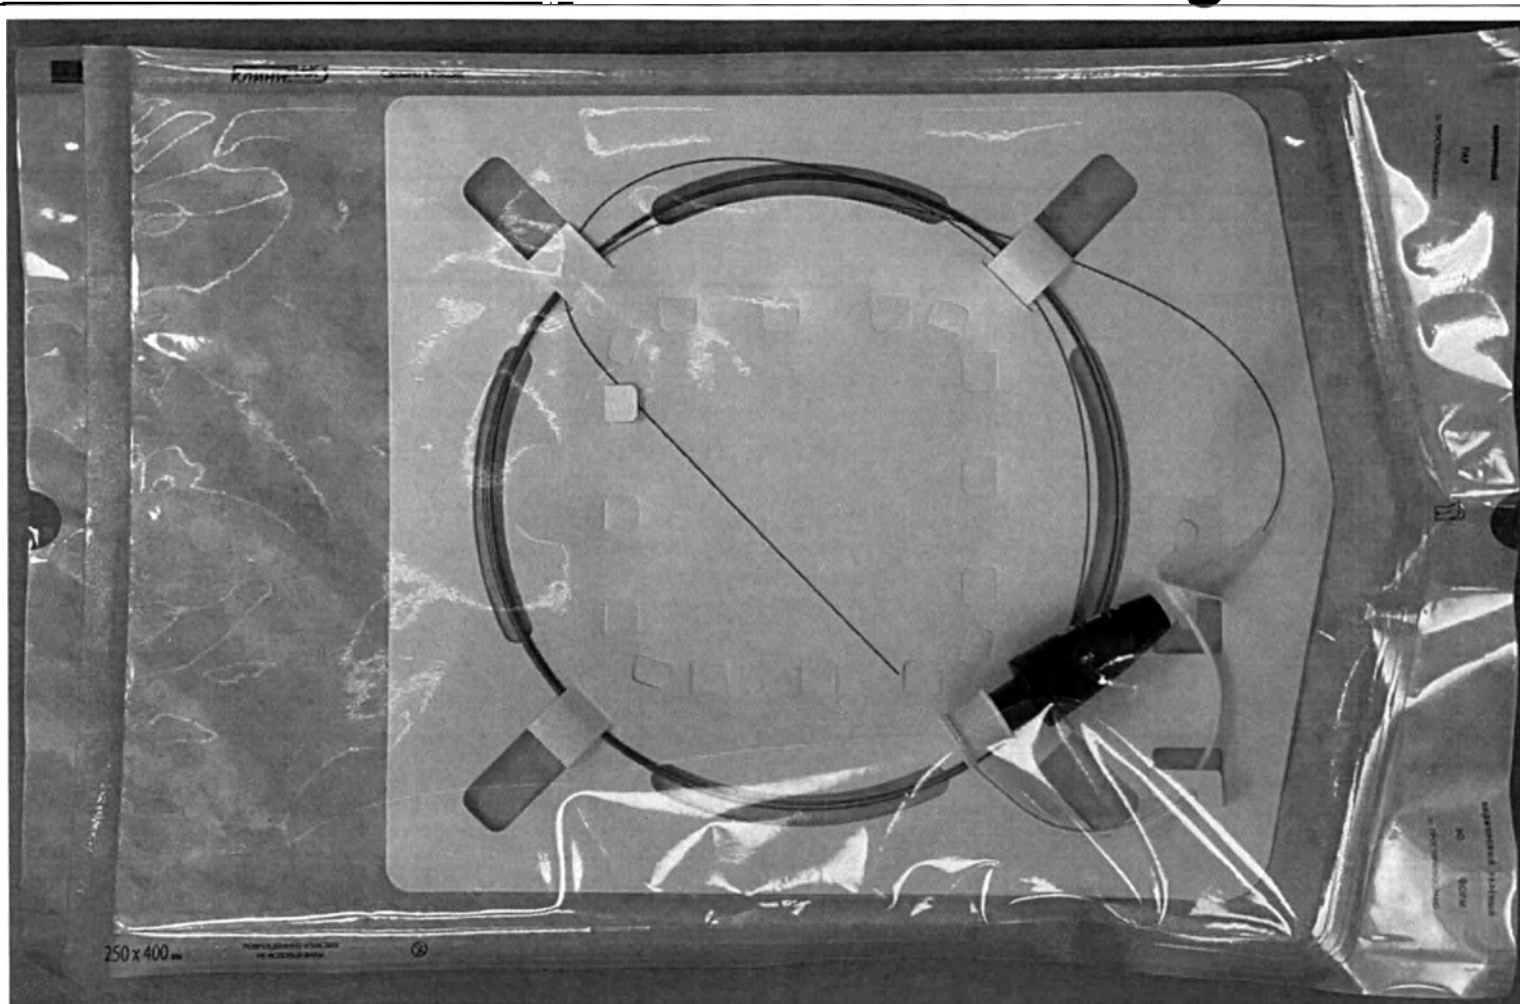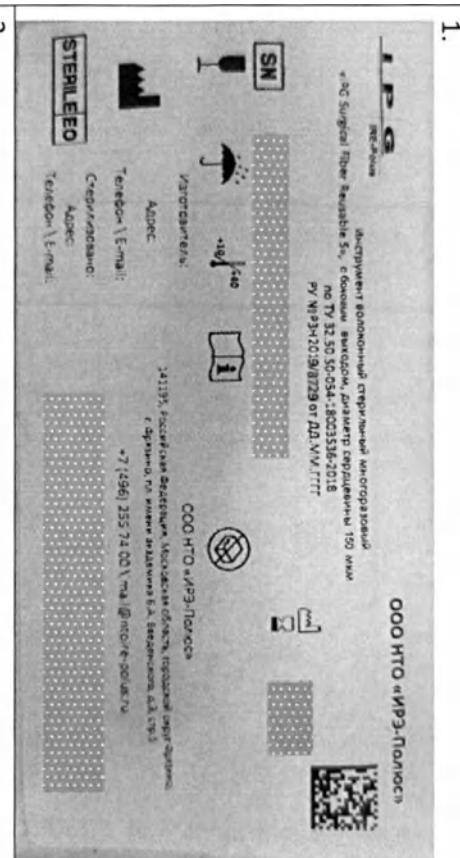



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многооборотный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многооборотный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм.

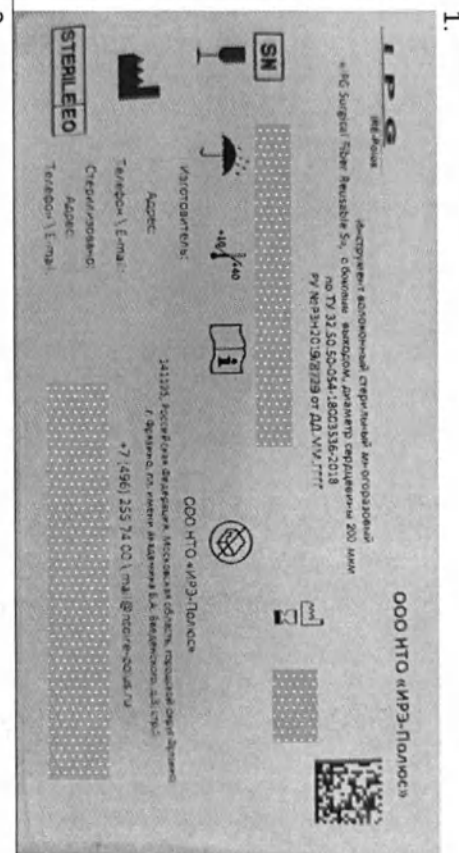


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм.

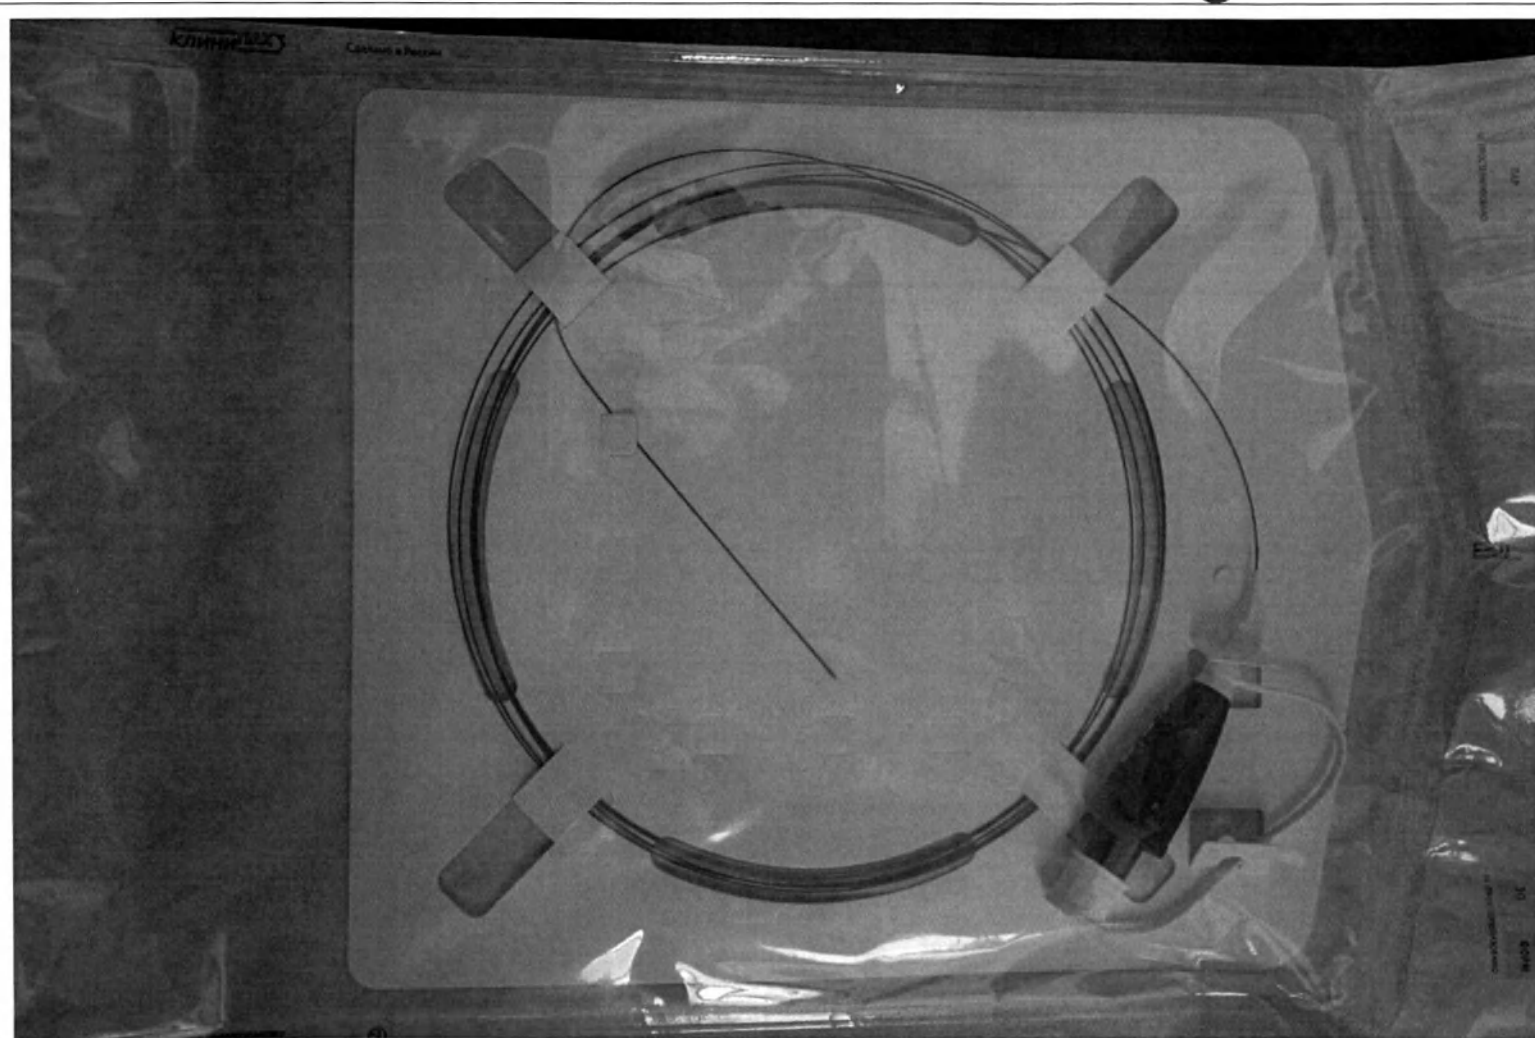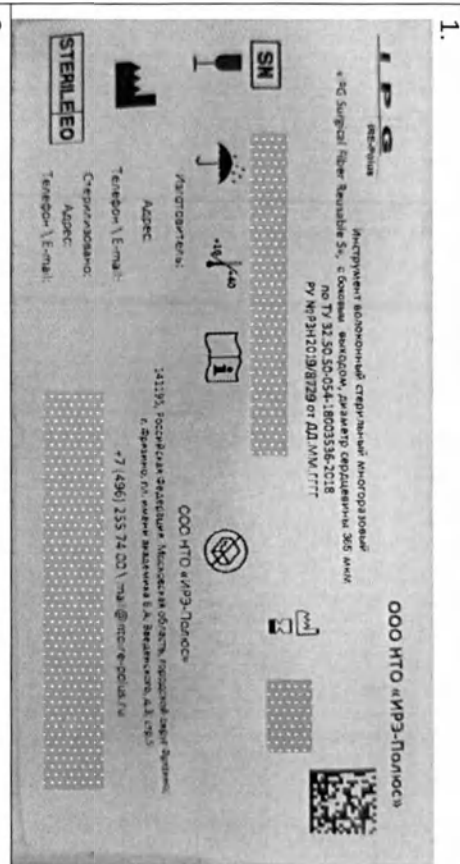



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения: Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм

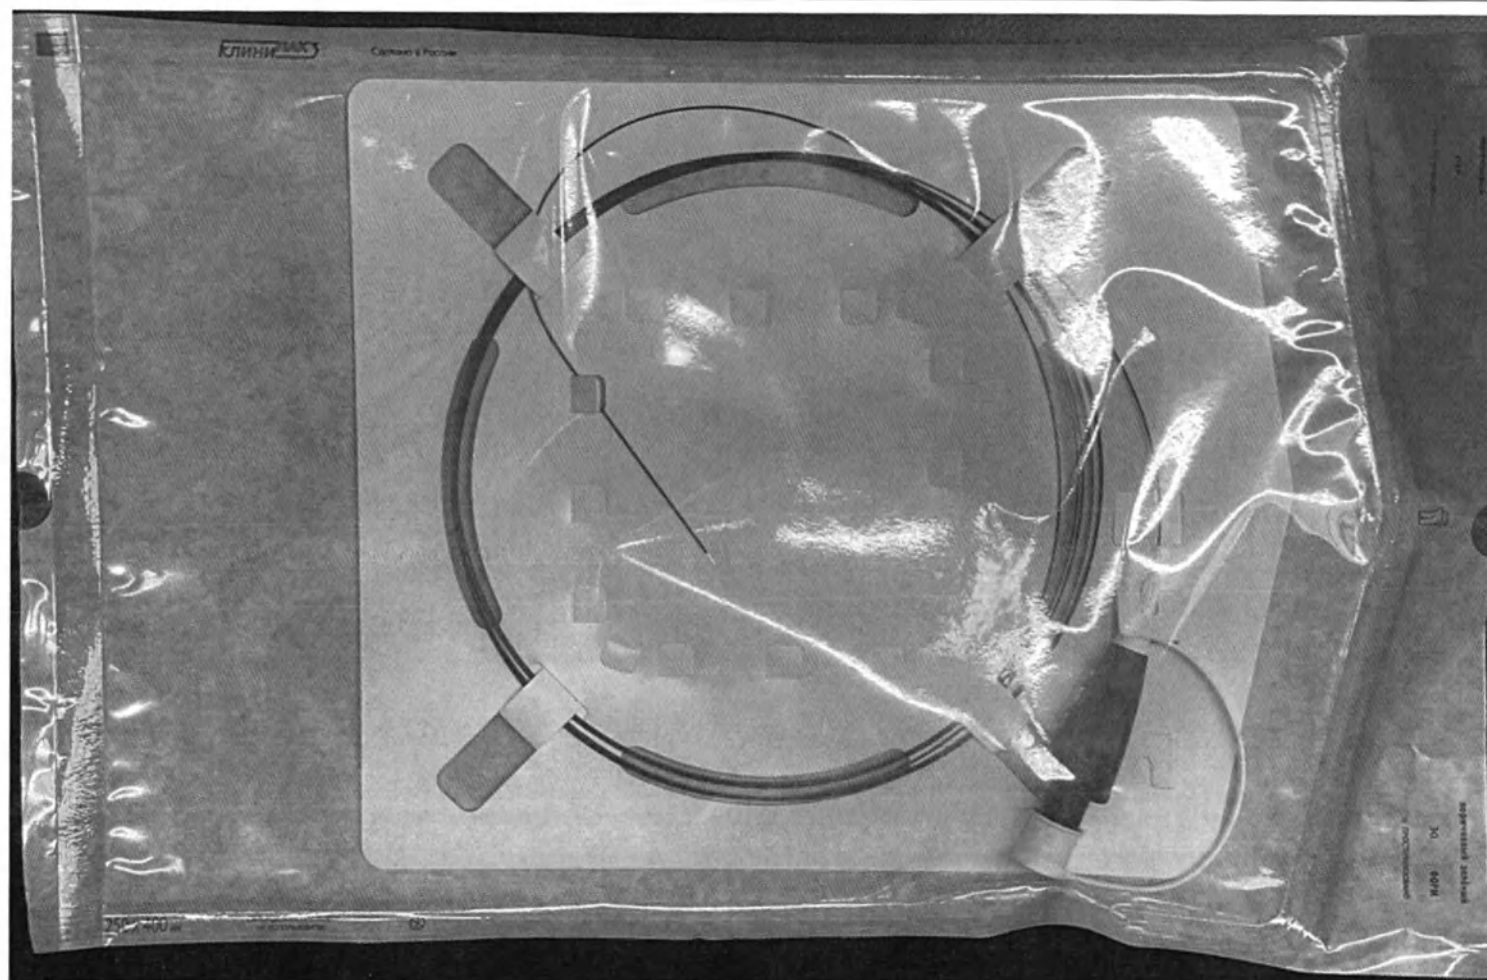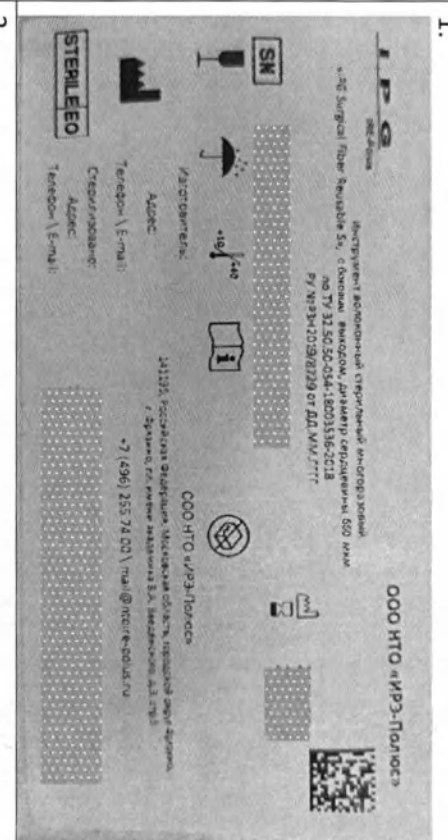



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм

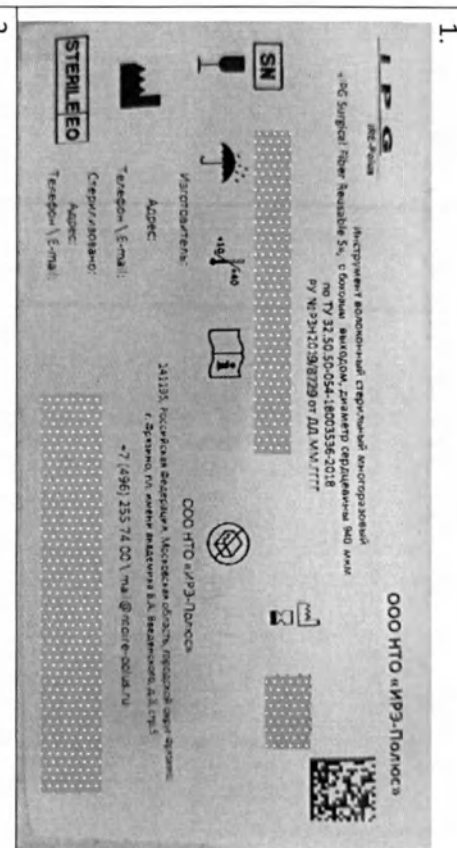



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм

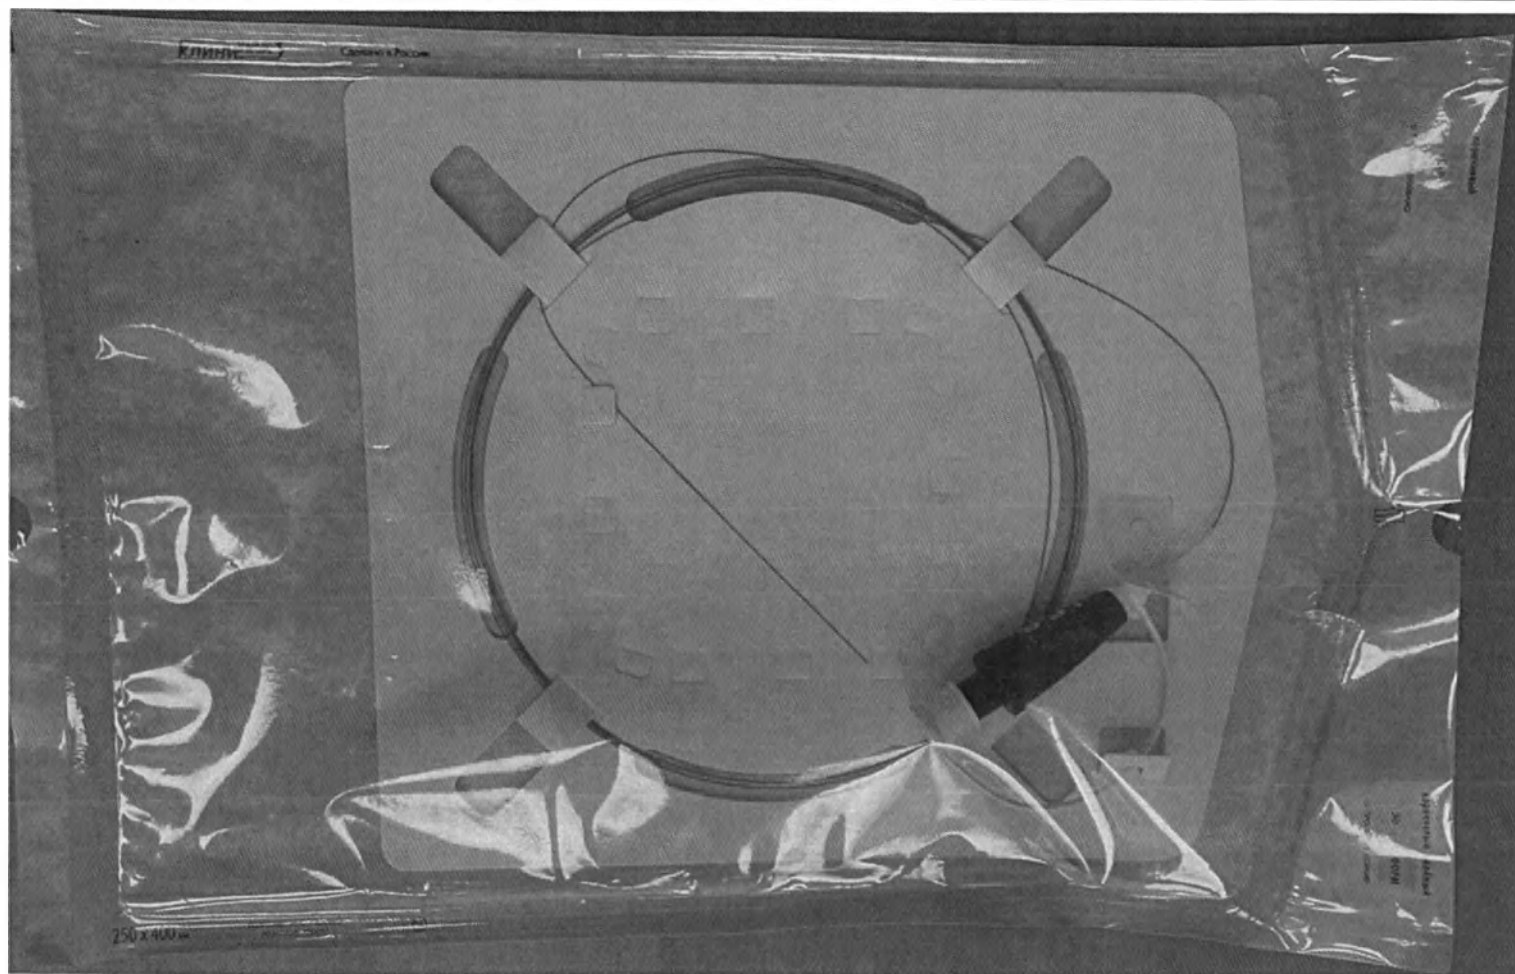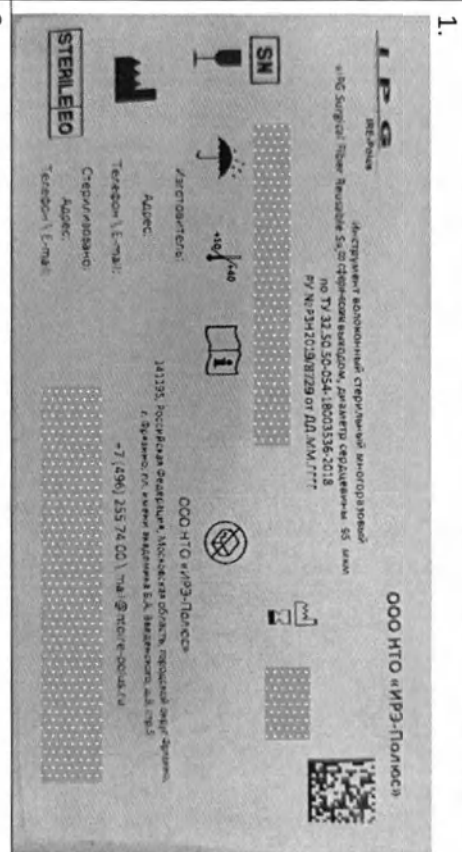


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 95 мкм

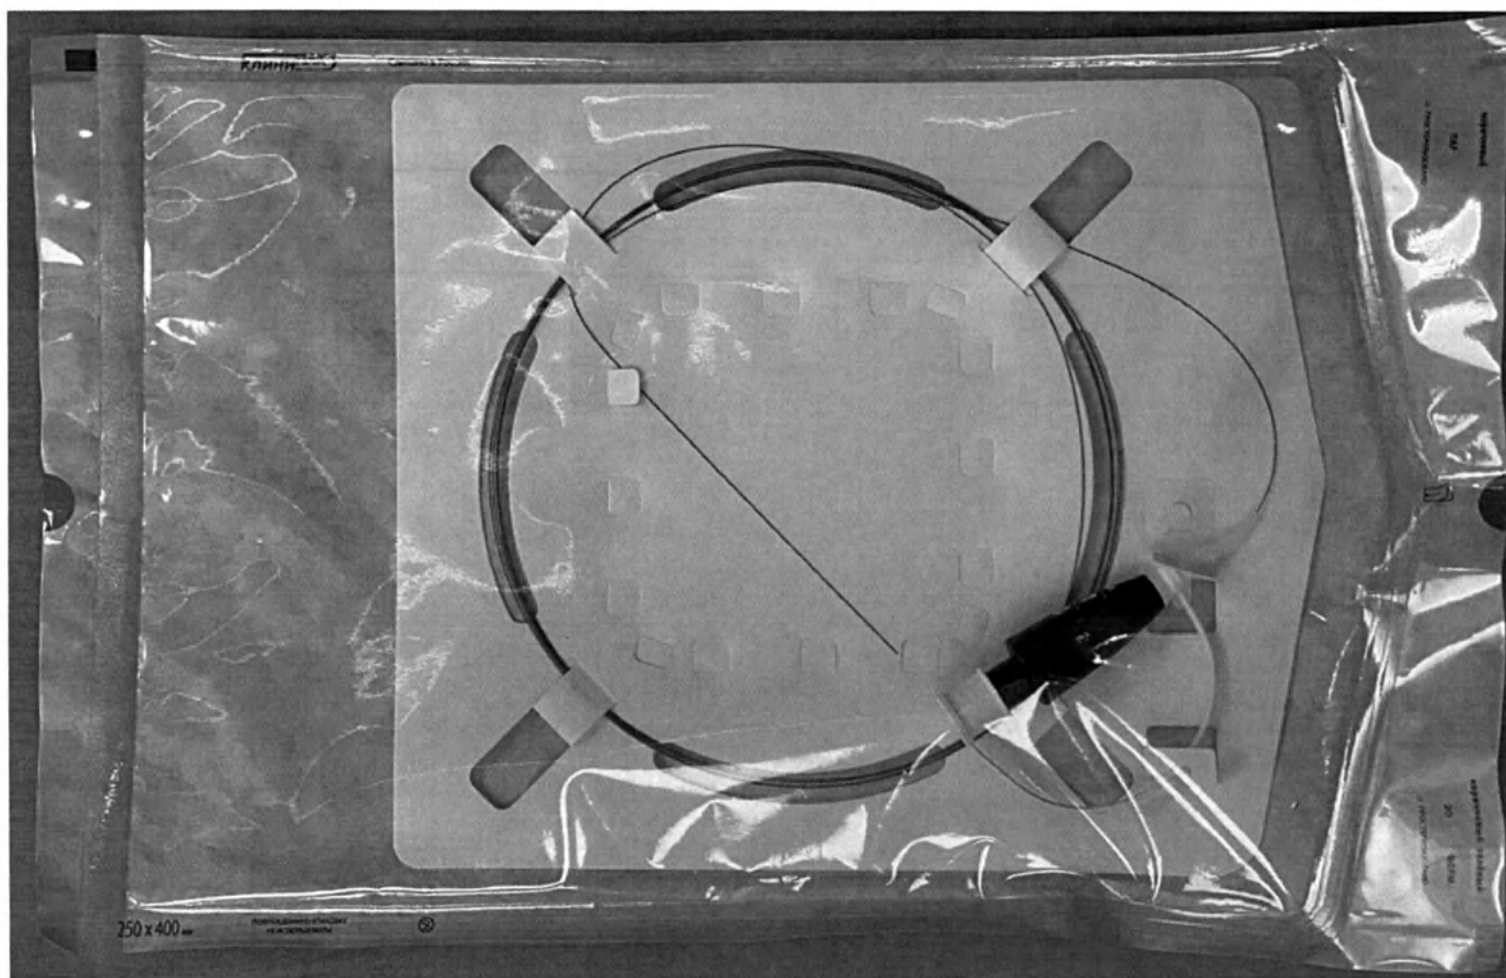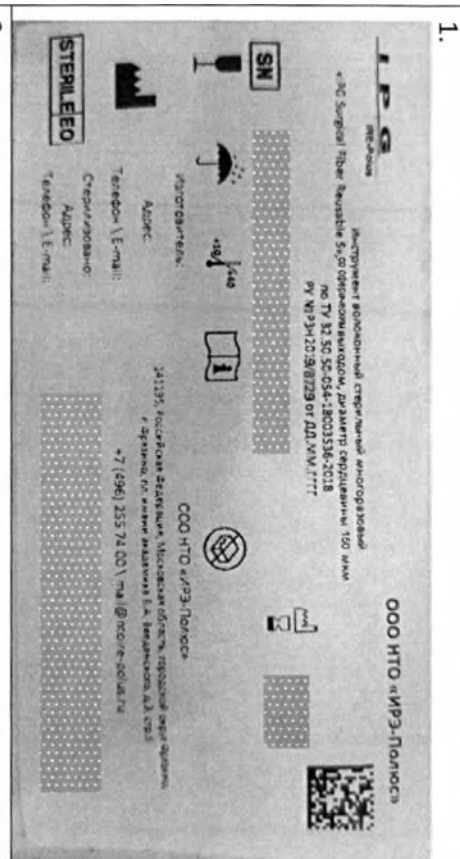



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 150 мкм

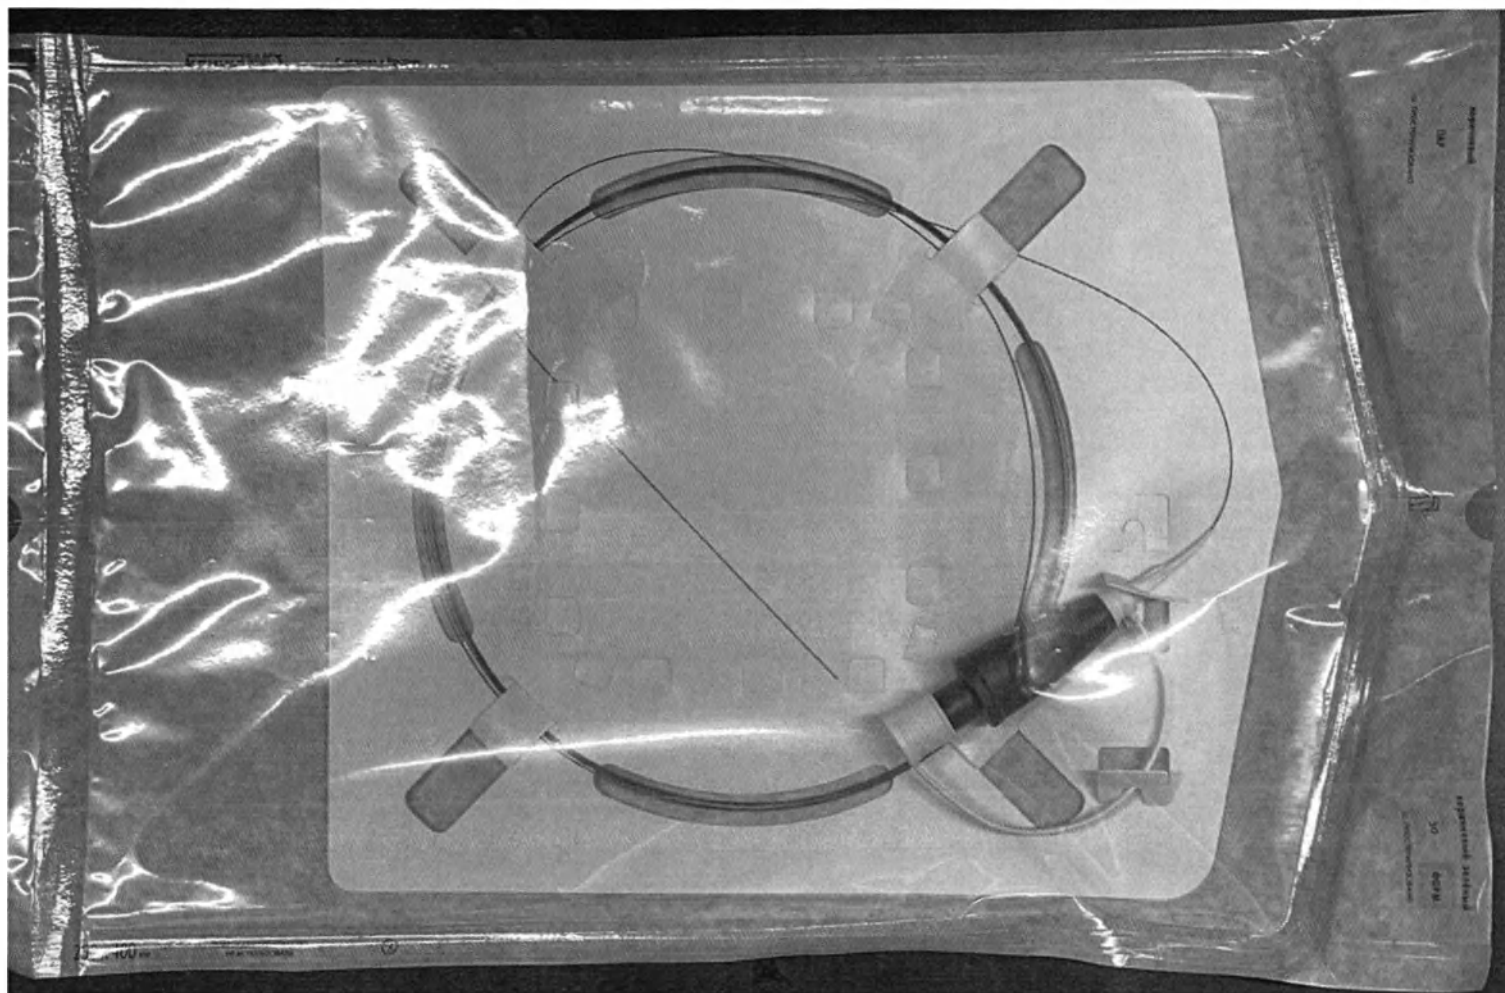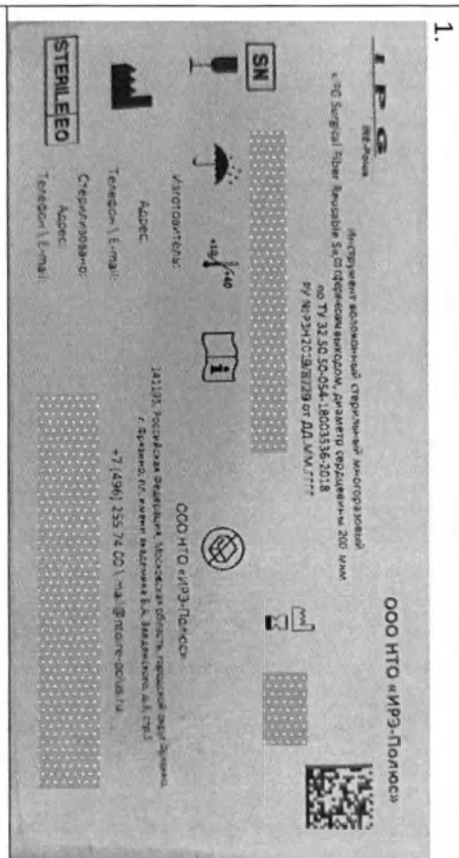



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 200 мкм

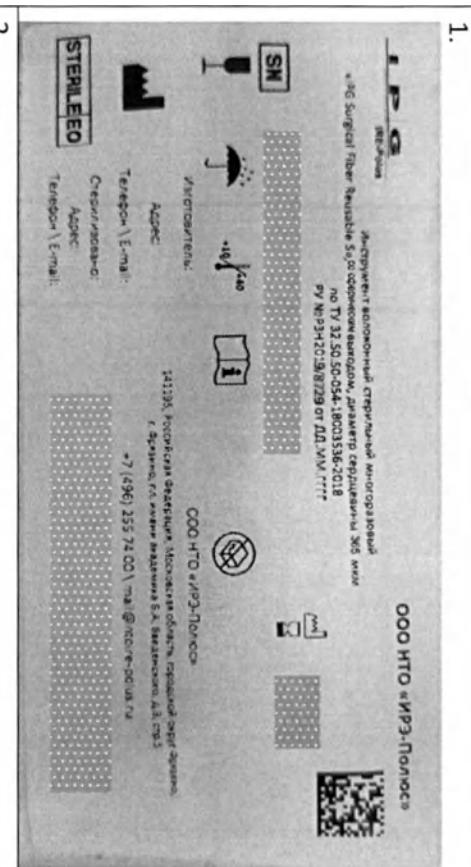



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 365 мкм

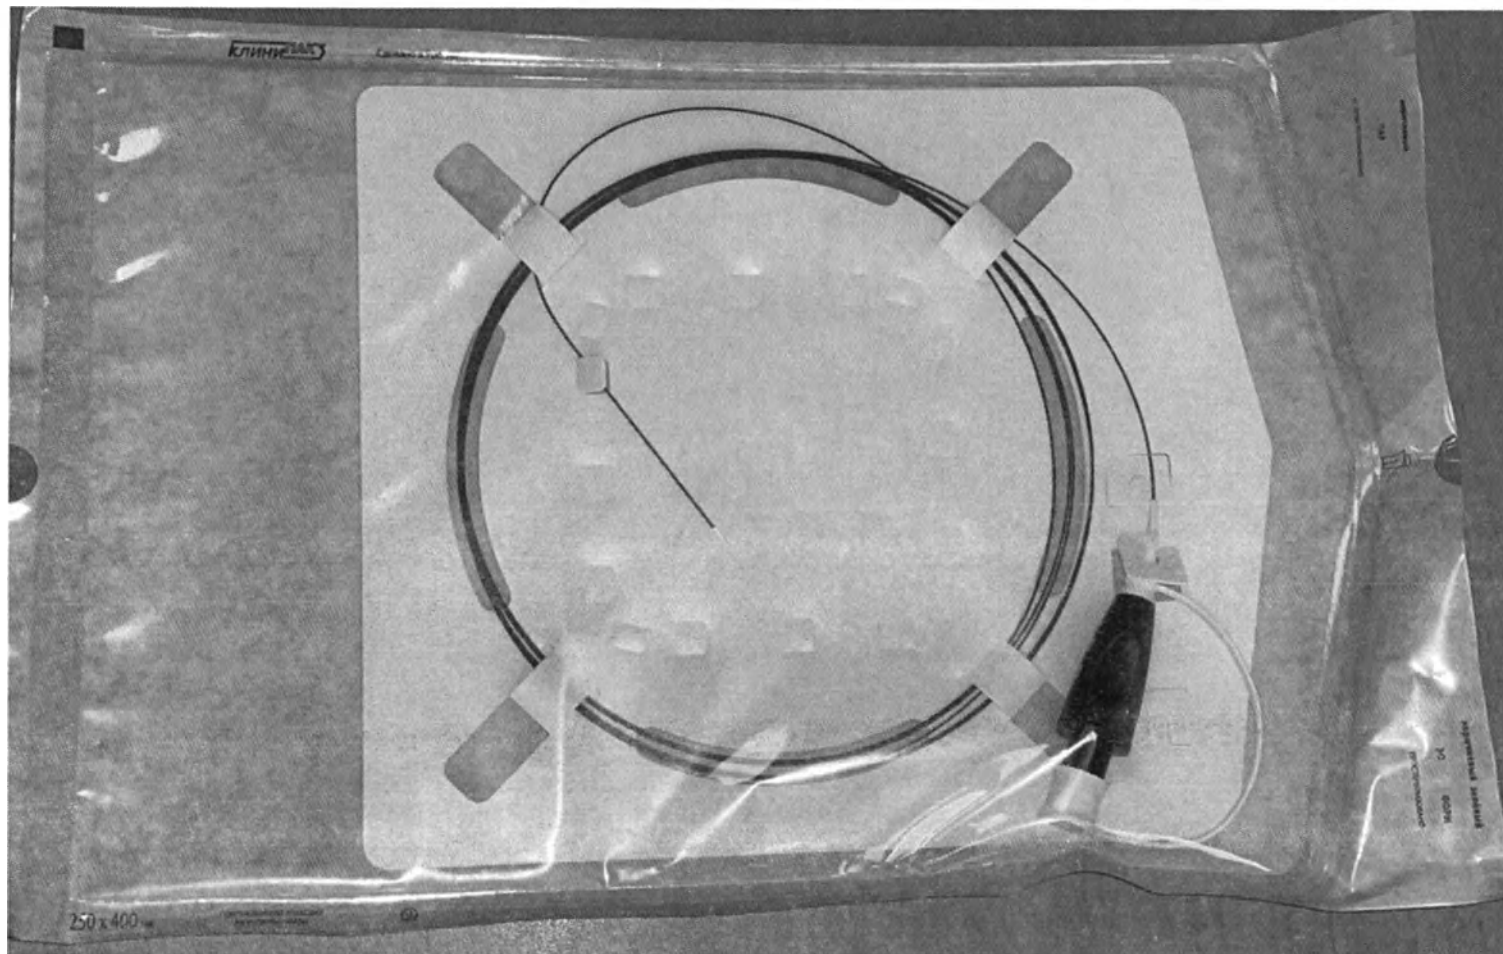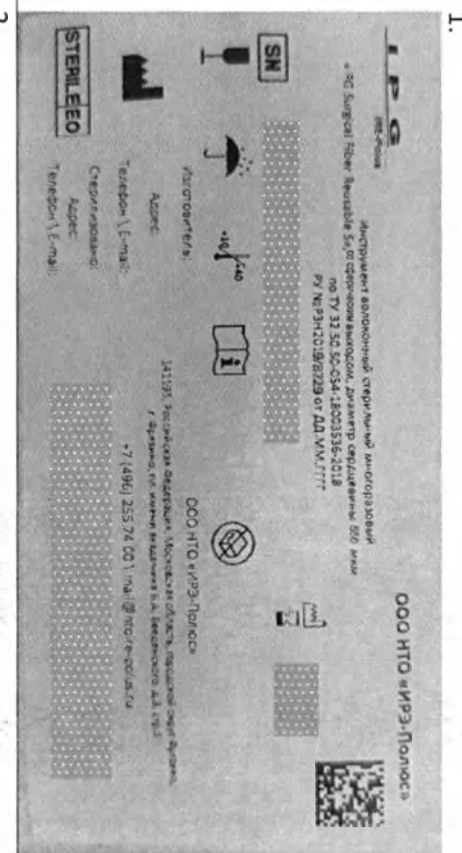



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 550 мкм

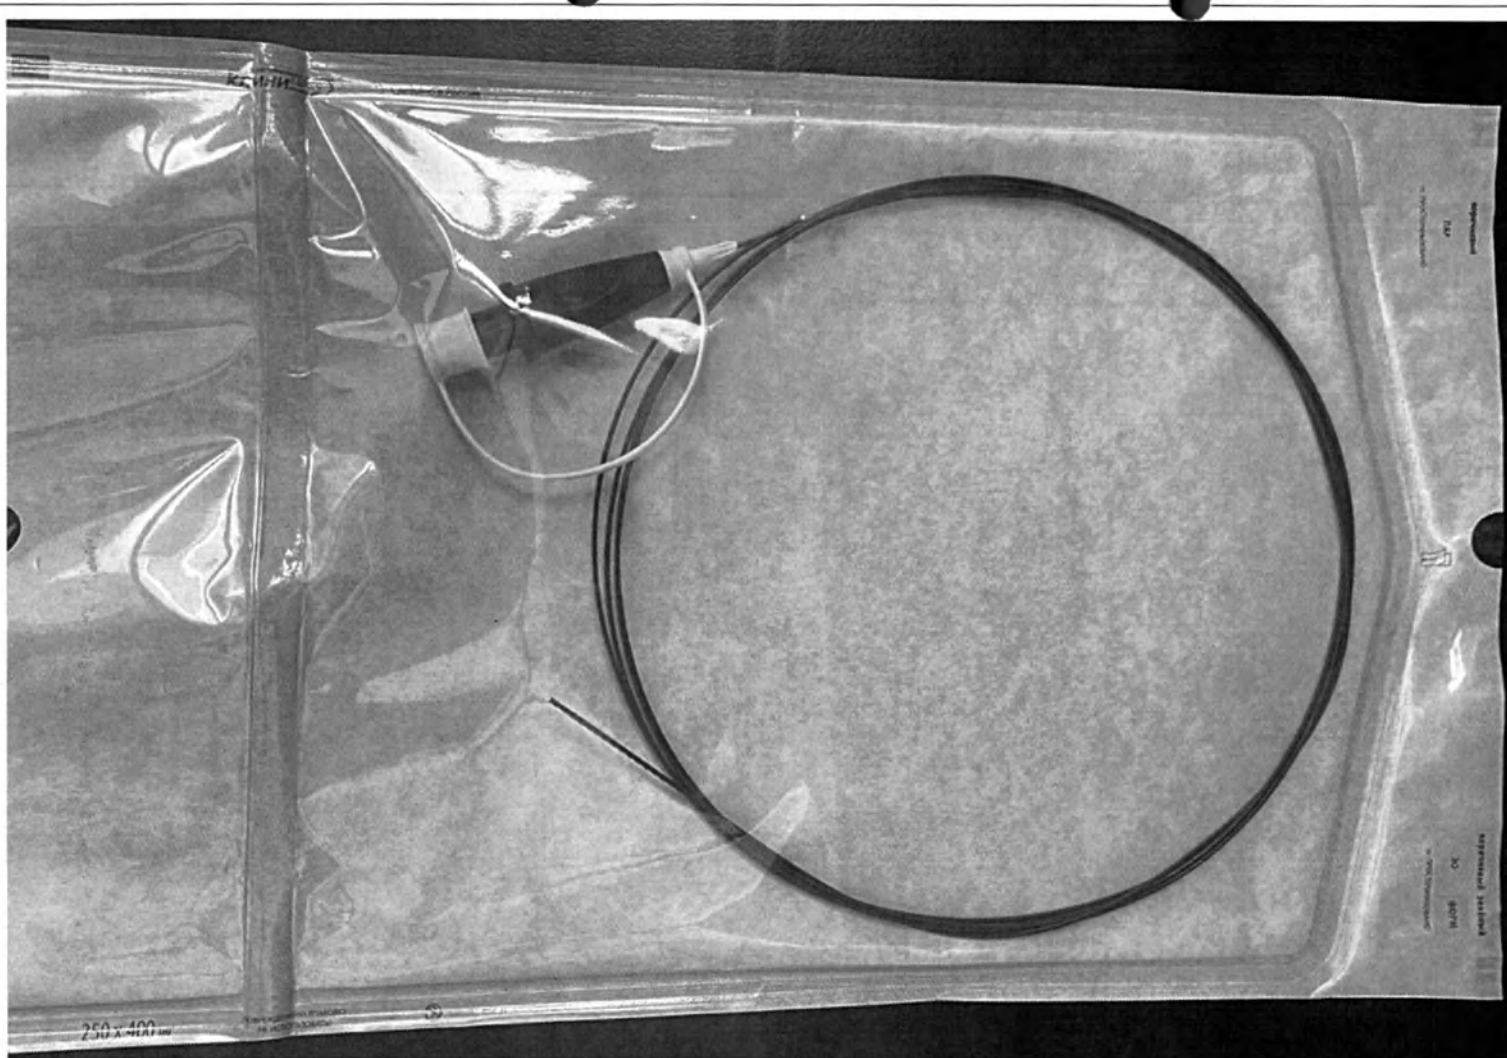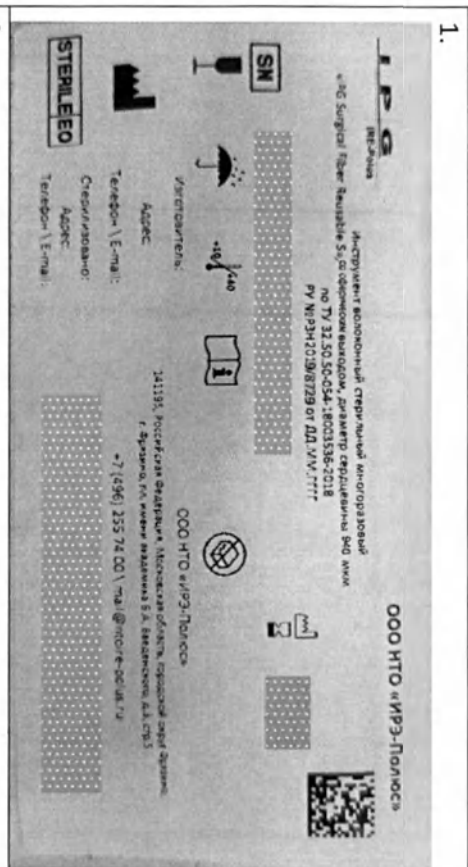



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 940 мкм

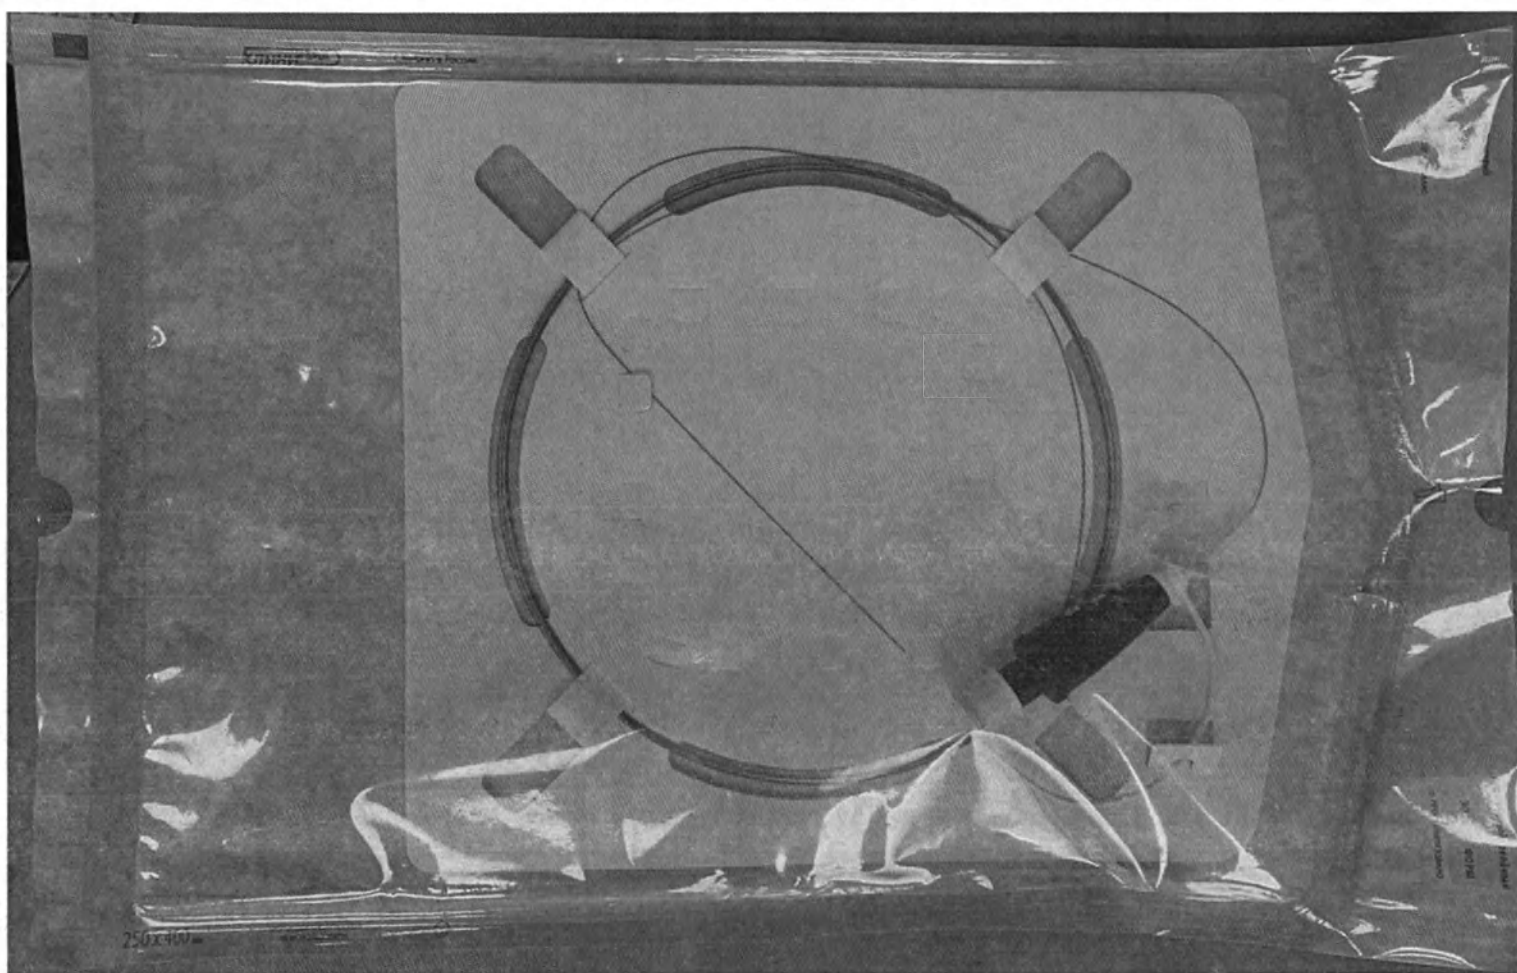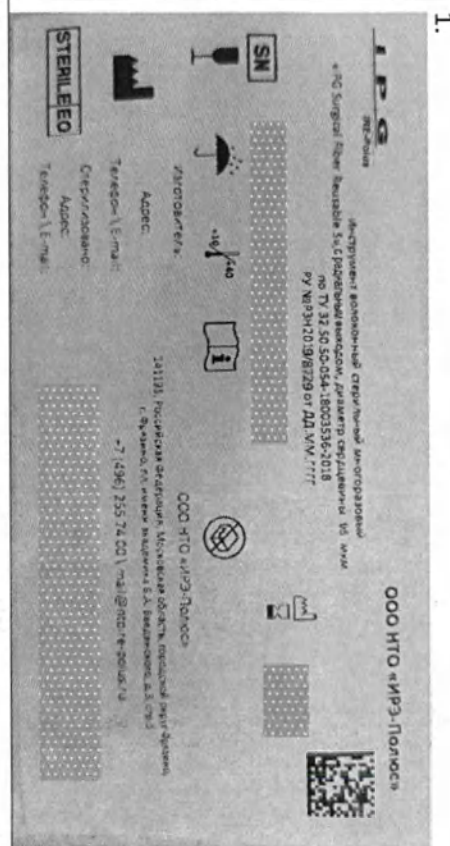


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 95 мкм

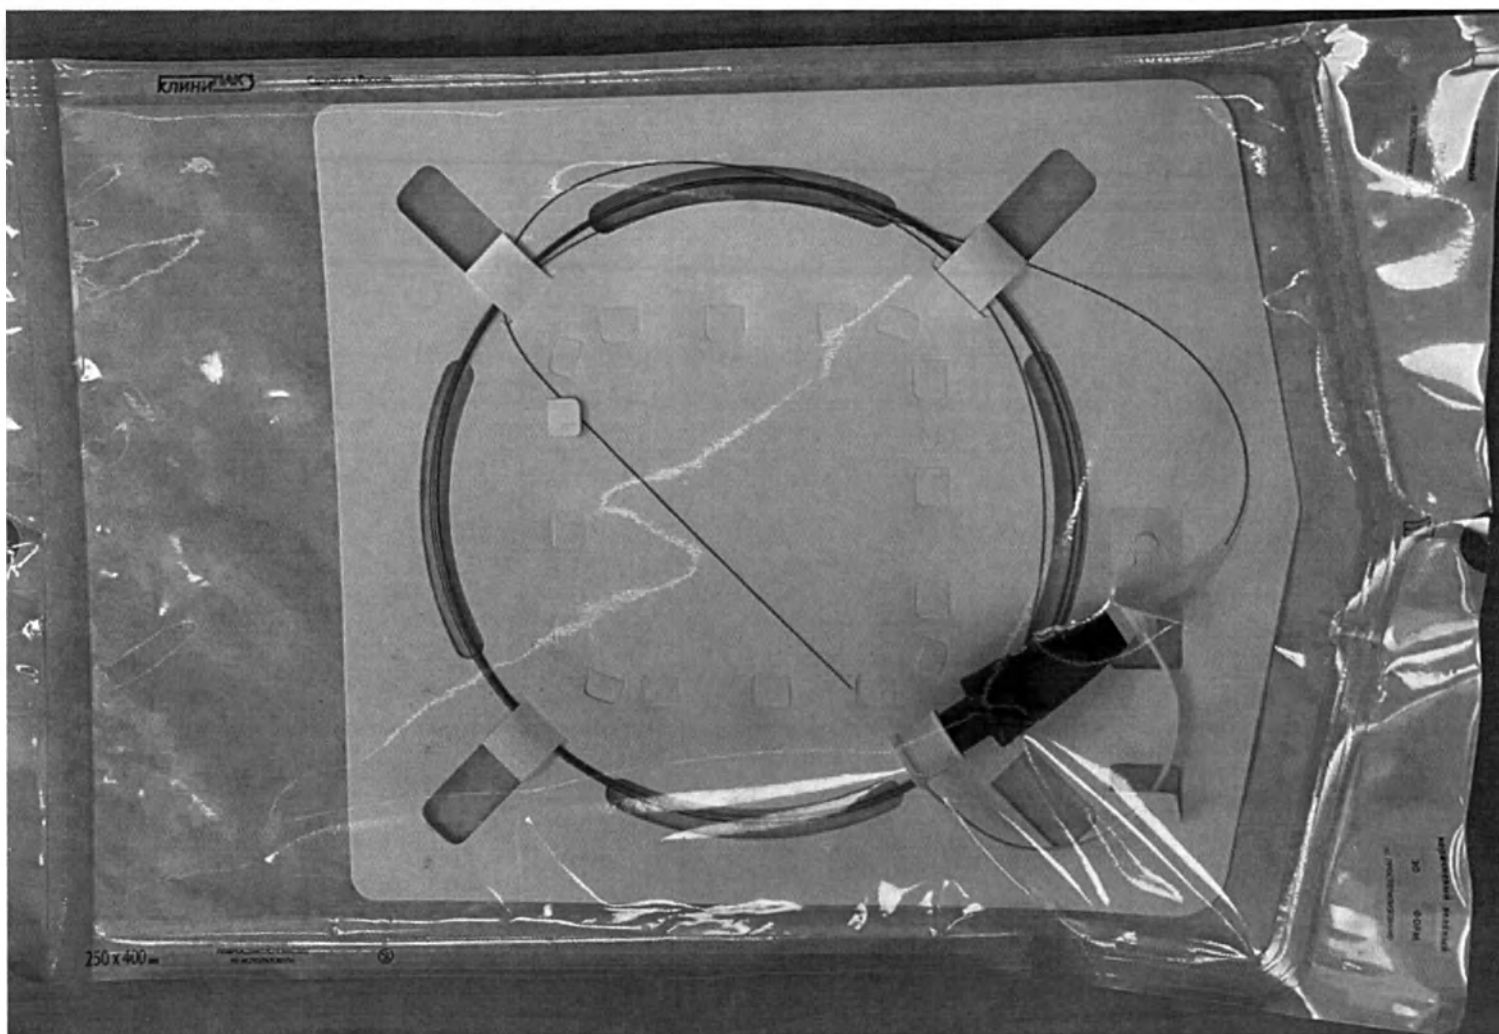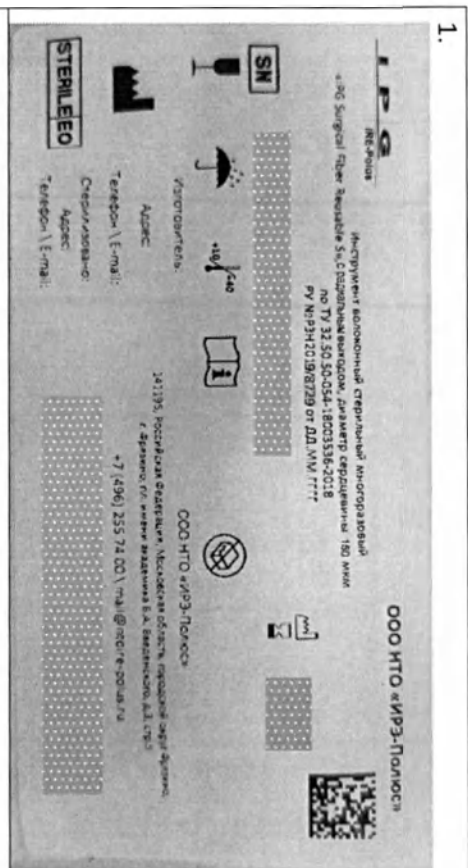



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 150 мкм

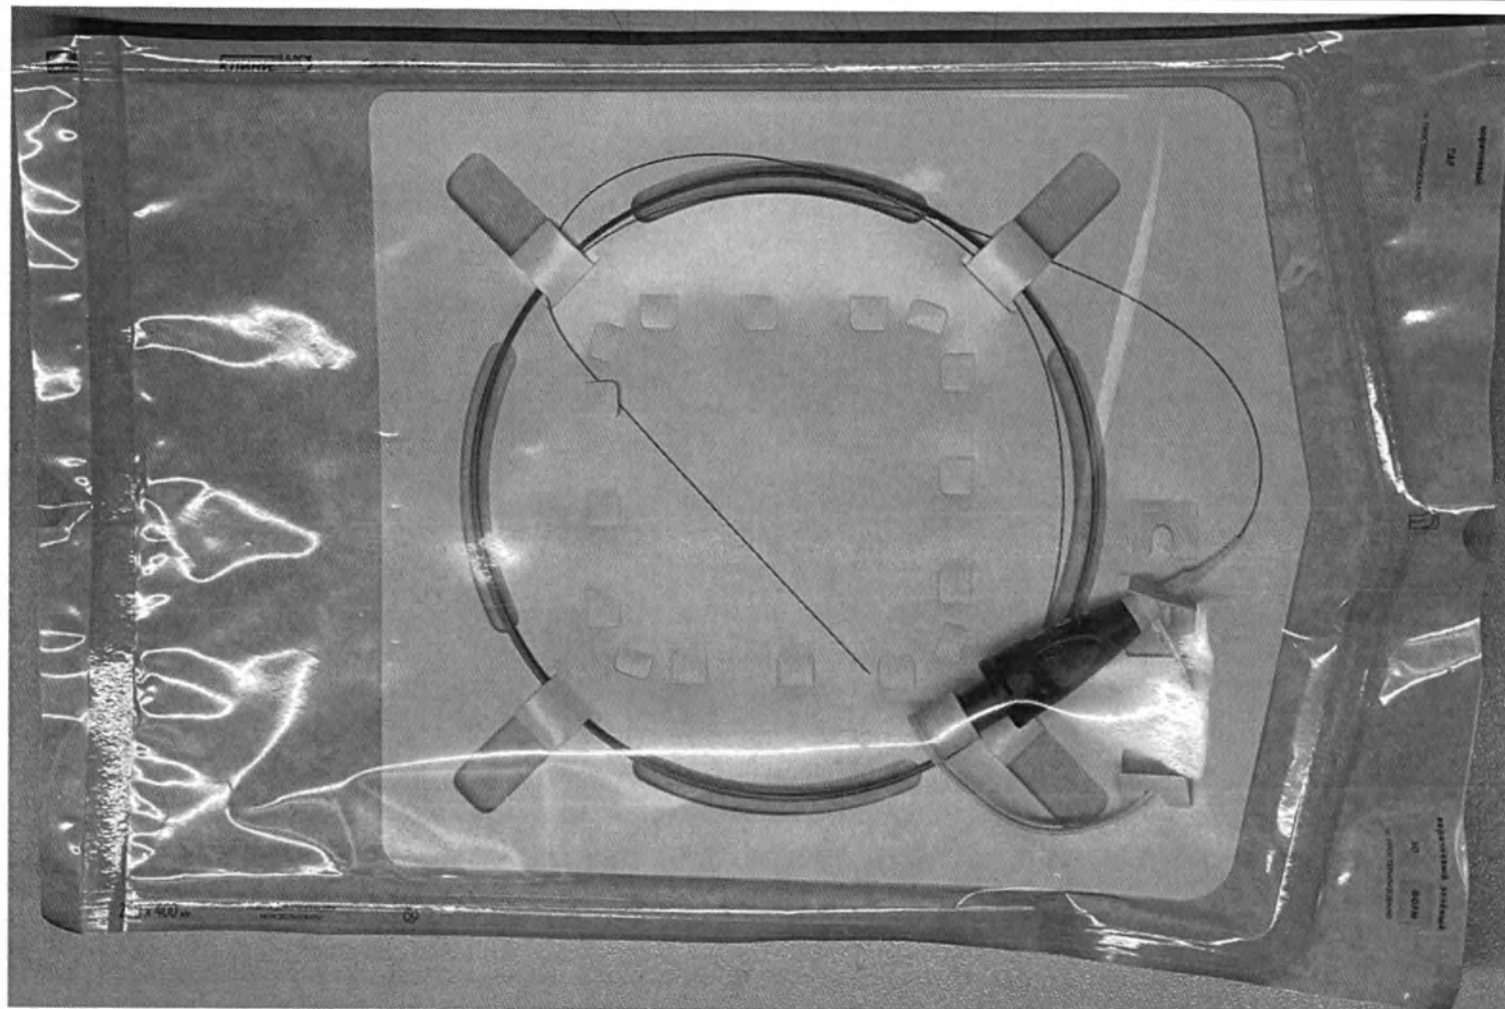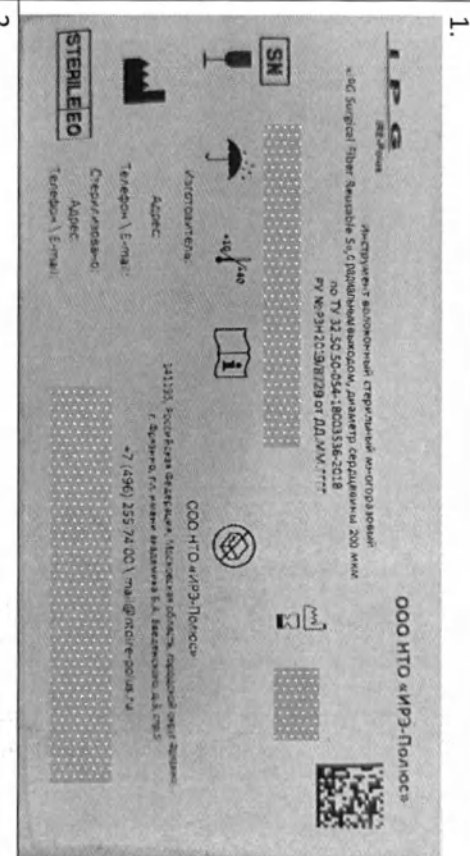


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 200 мкм

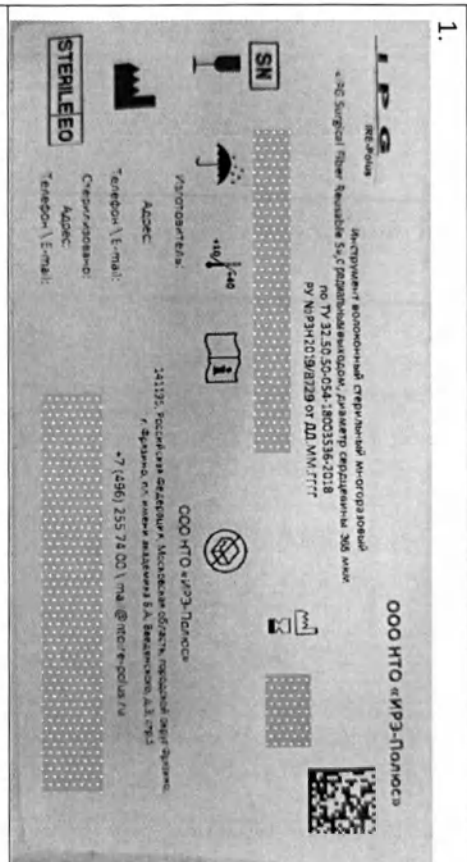



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 365 мкм

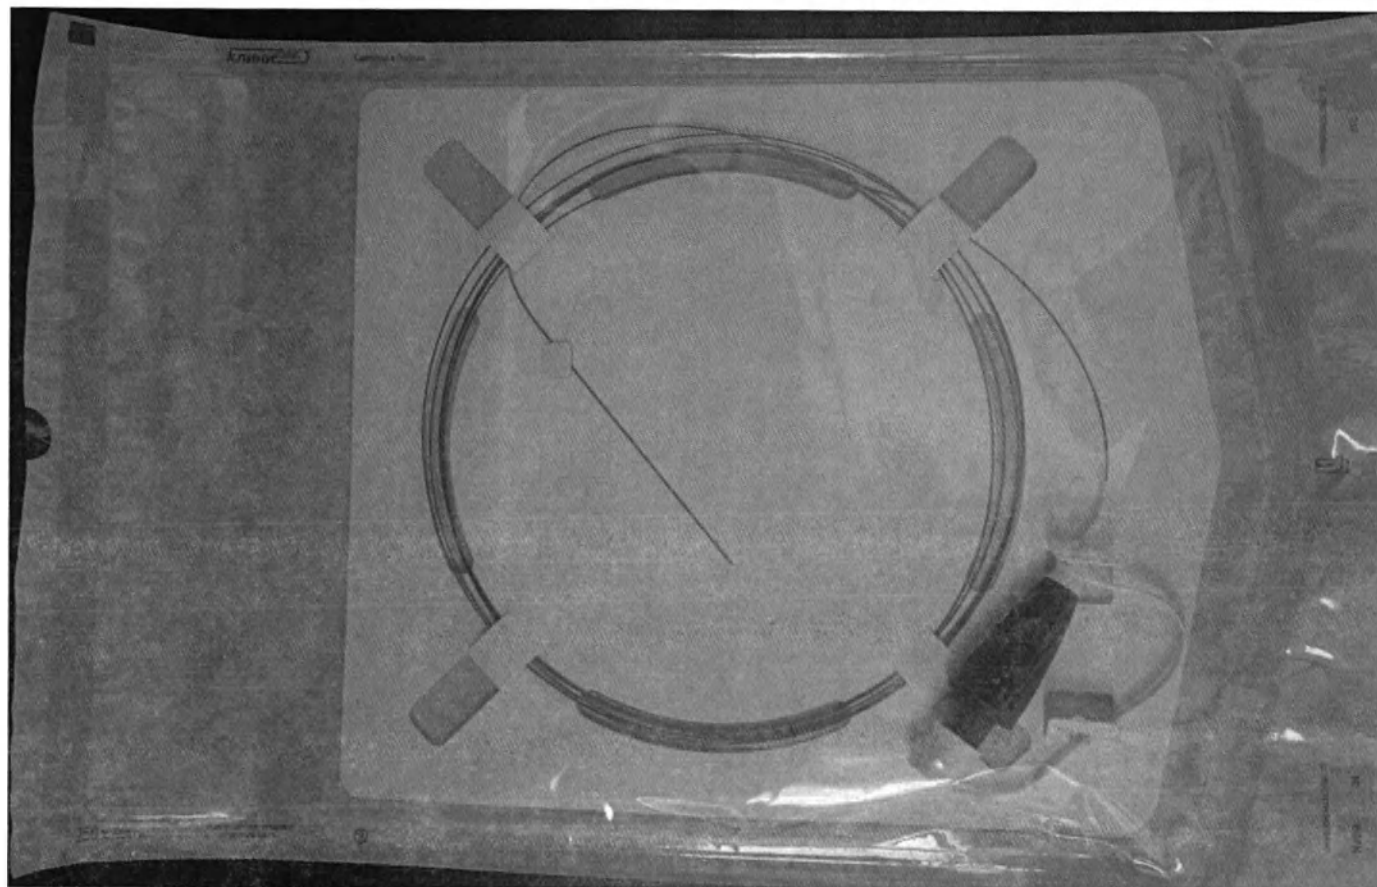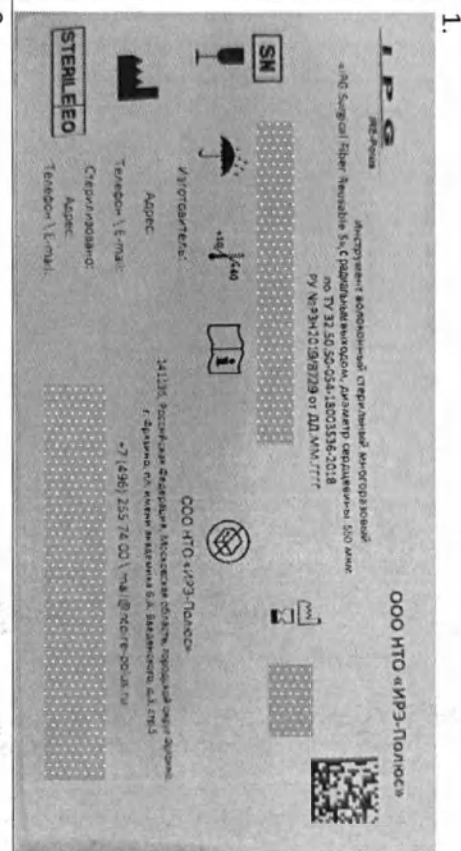



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм

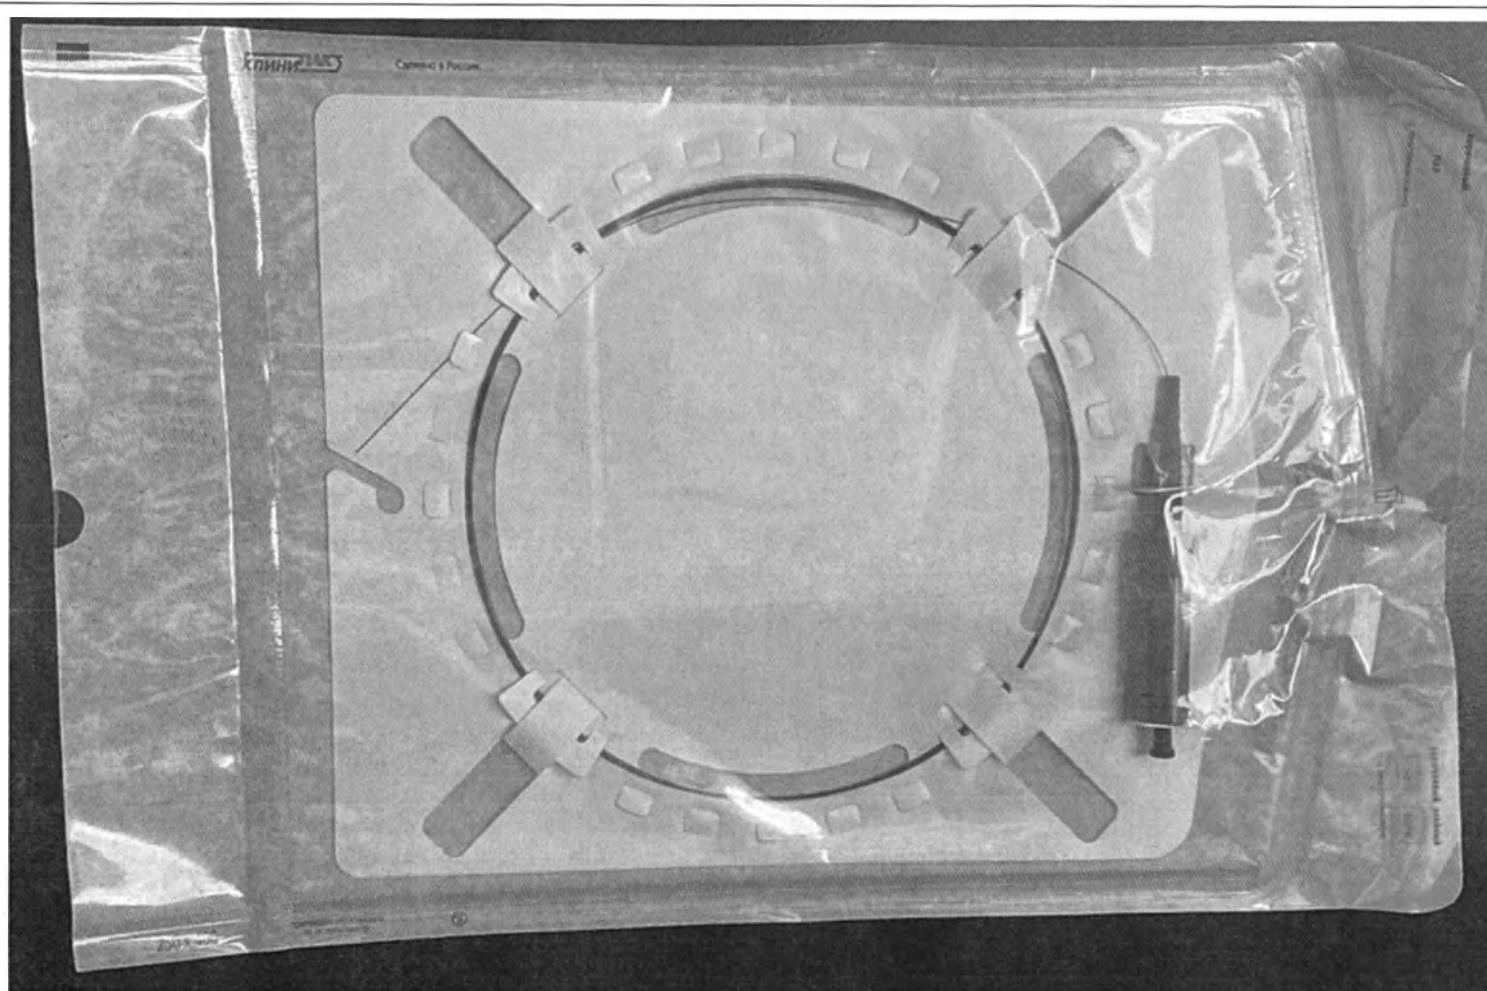



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многооборотный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многооборотный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 95 мкм, разъем SMA-905, HP

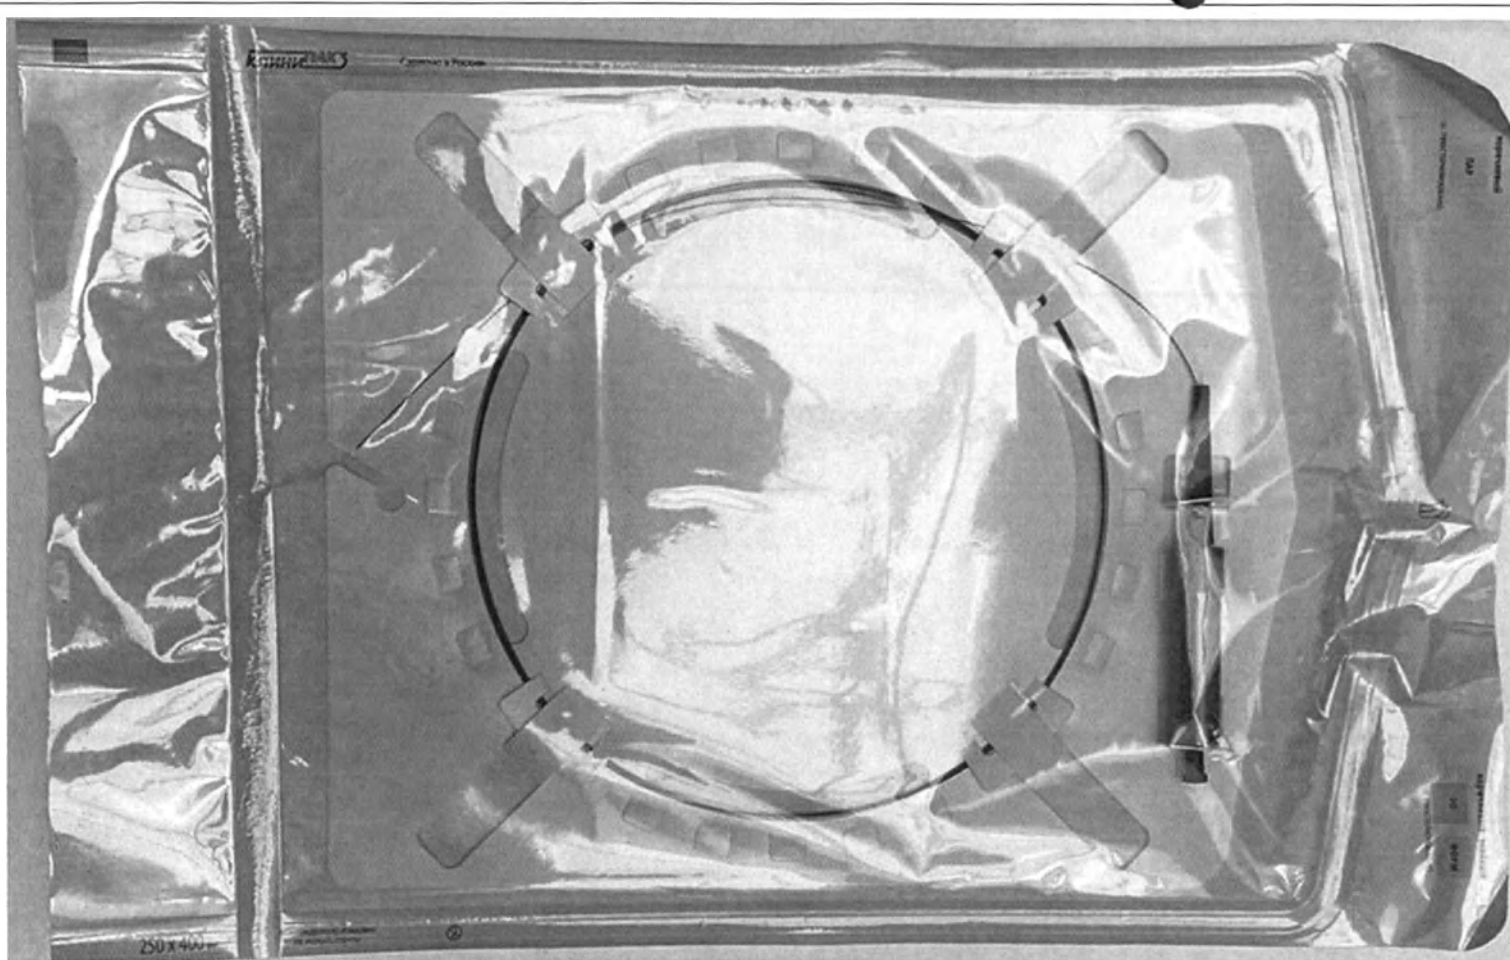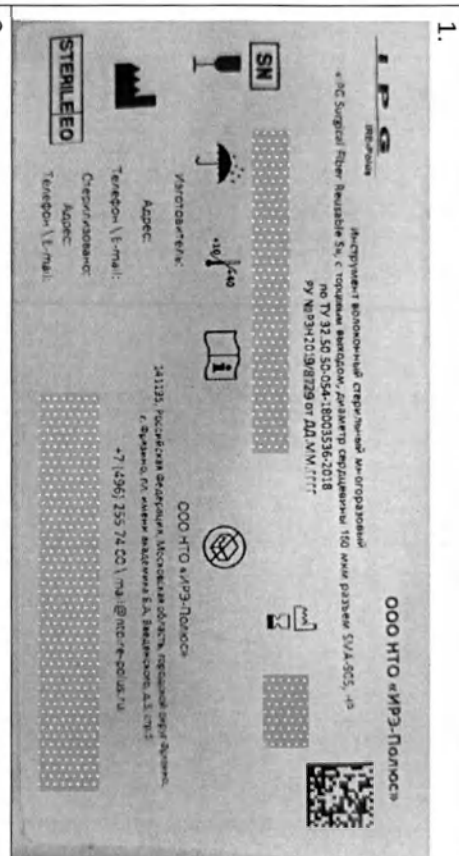


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм, разъем SMA-905, HP

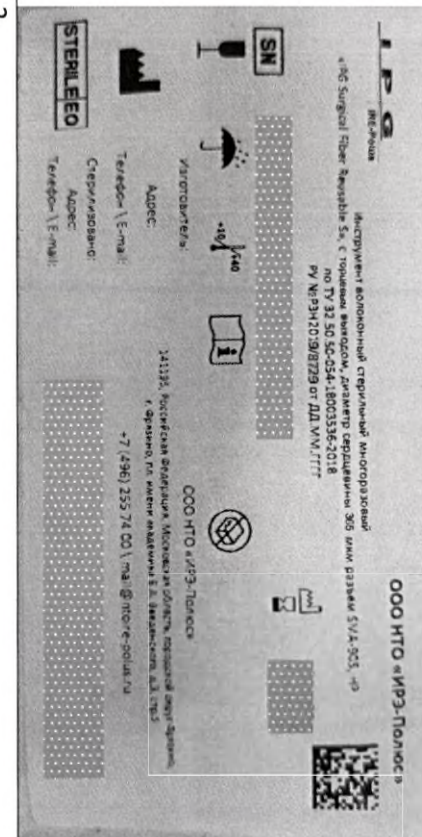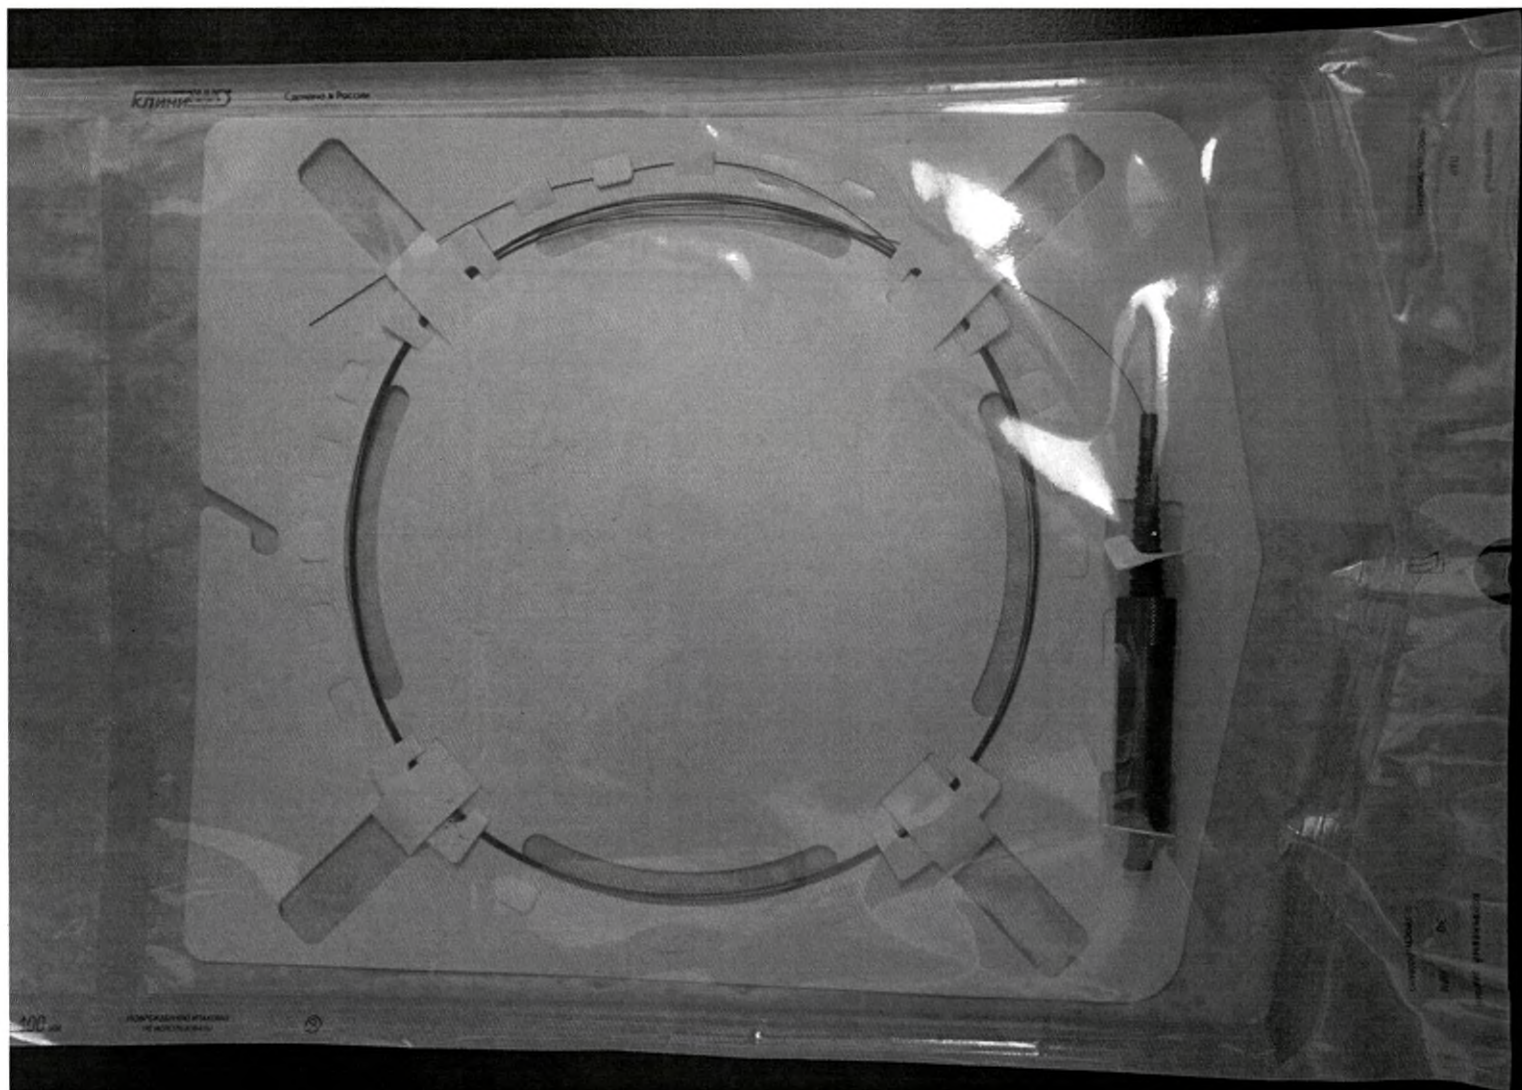



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, HP

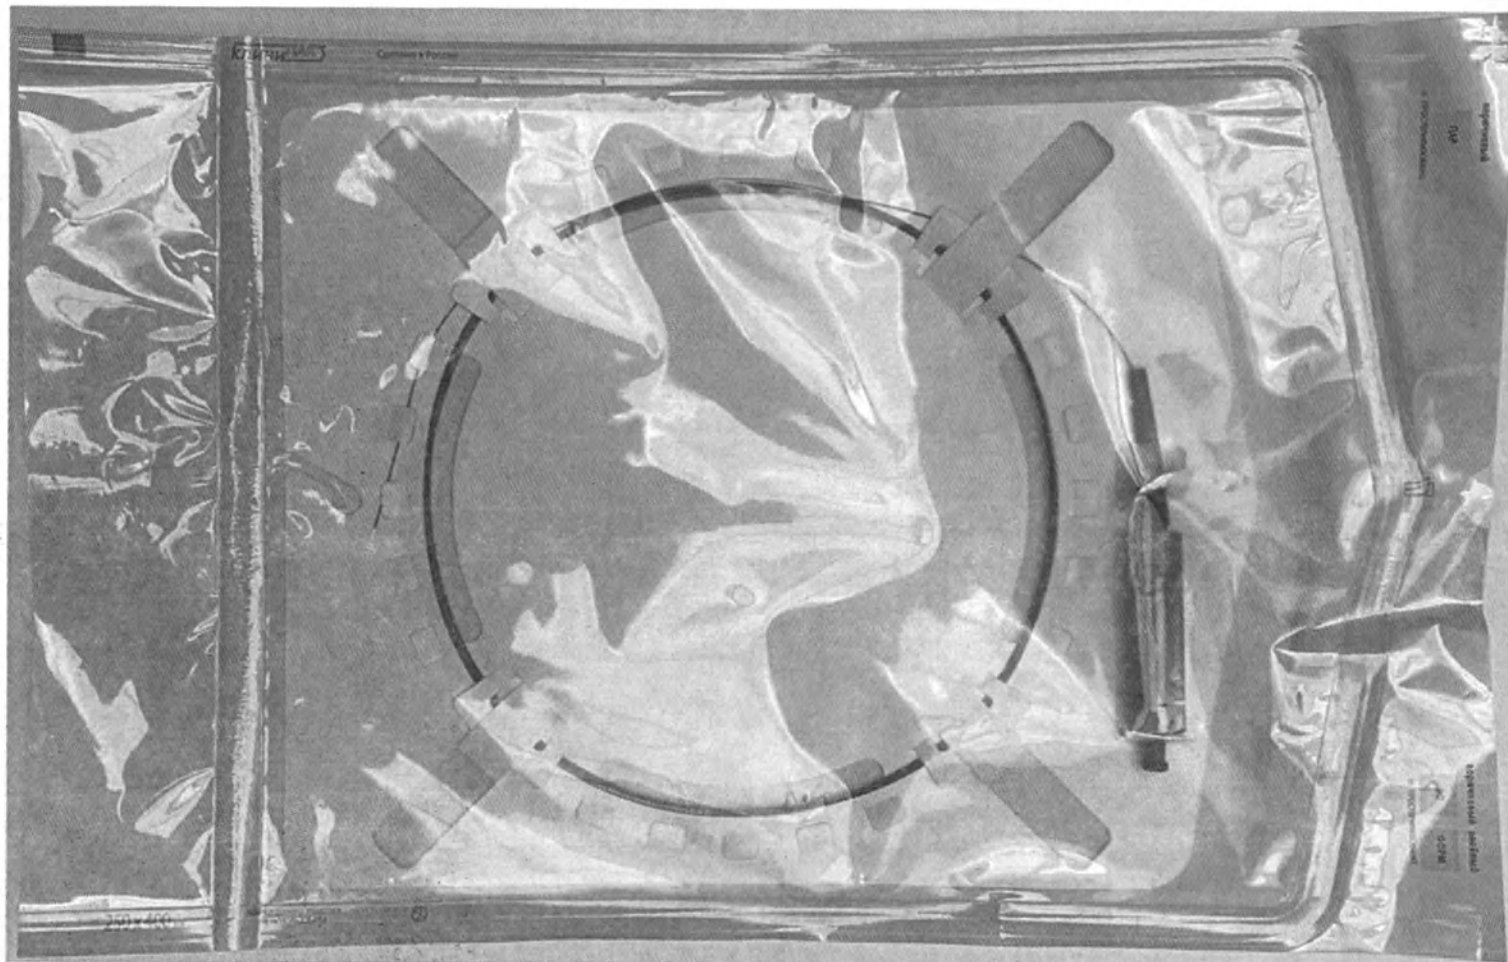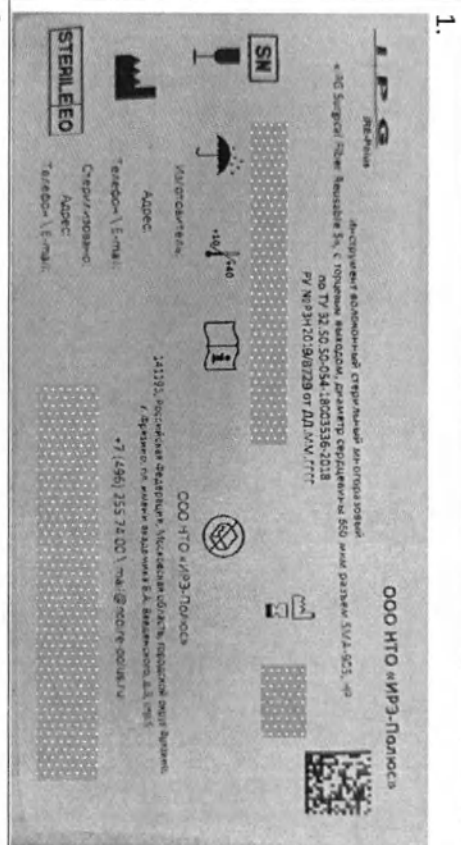


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм, разъем SMA-905, HP

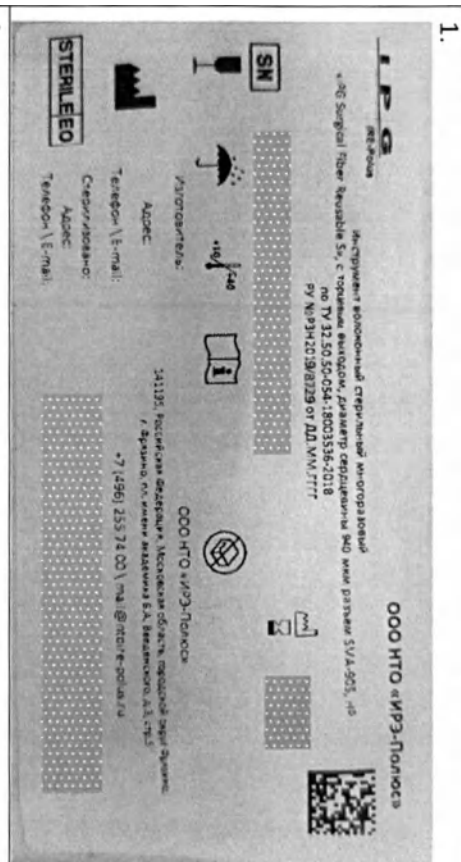



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, HP

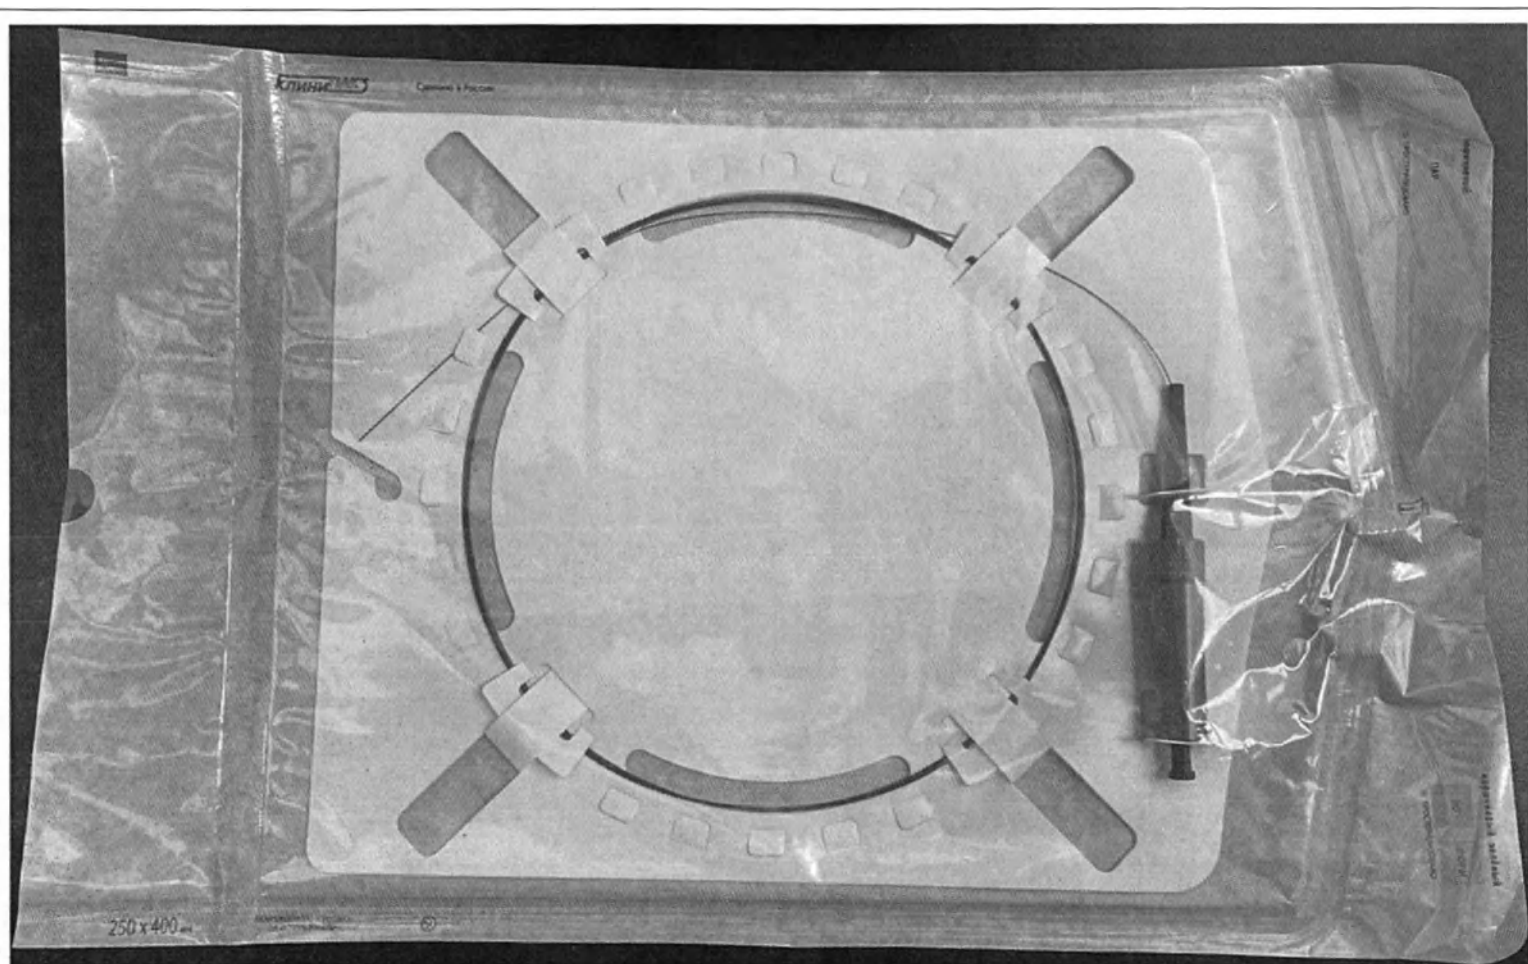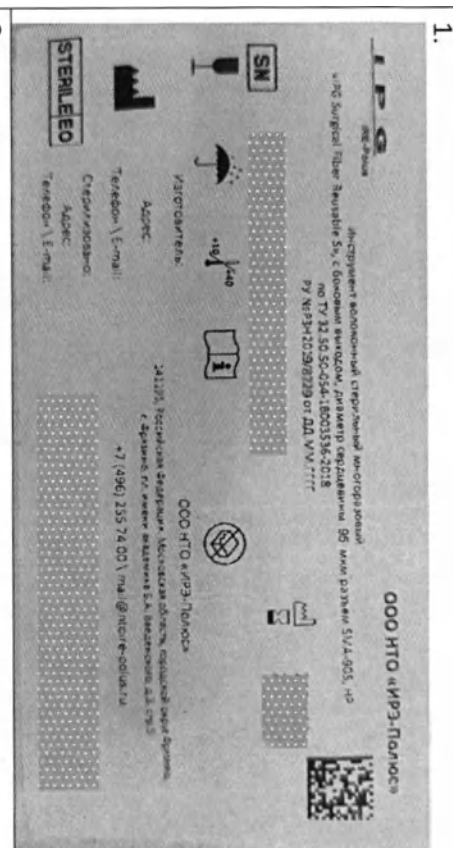



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевинны 95 мкм, разъем SMA-905, HP

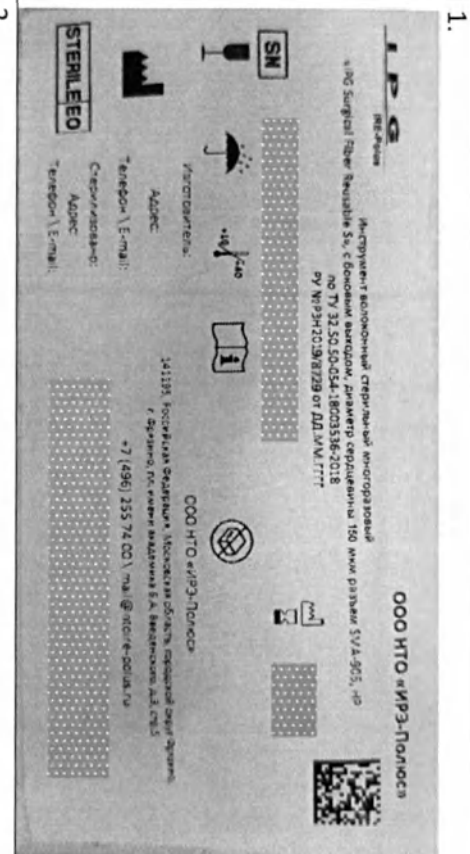


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм, разъем SMA-905, НР

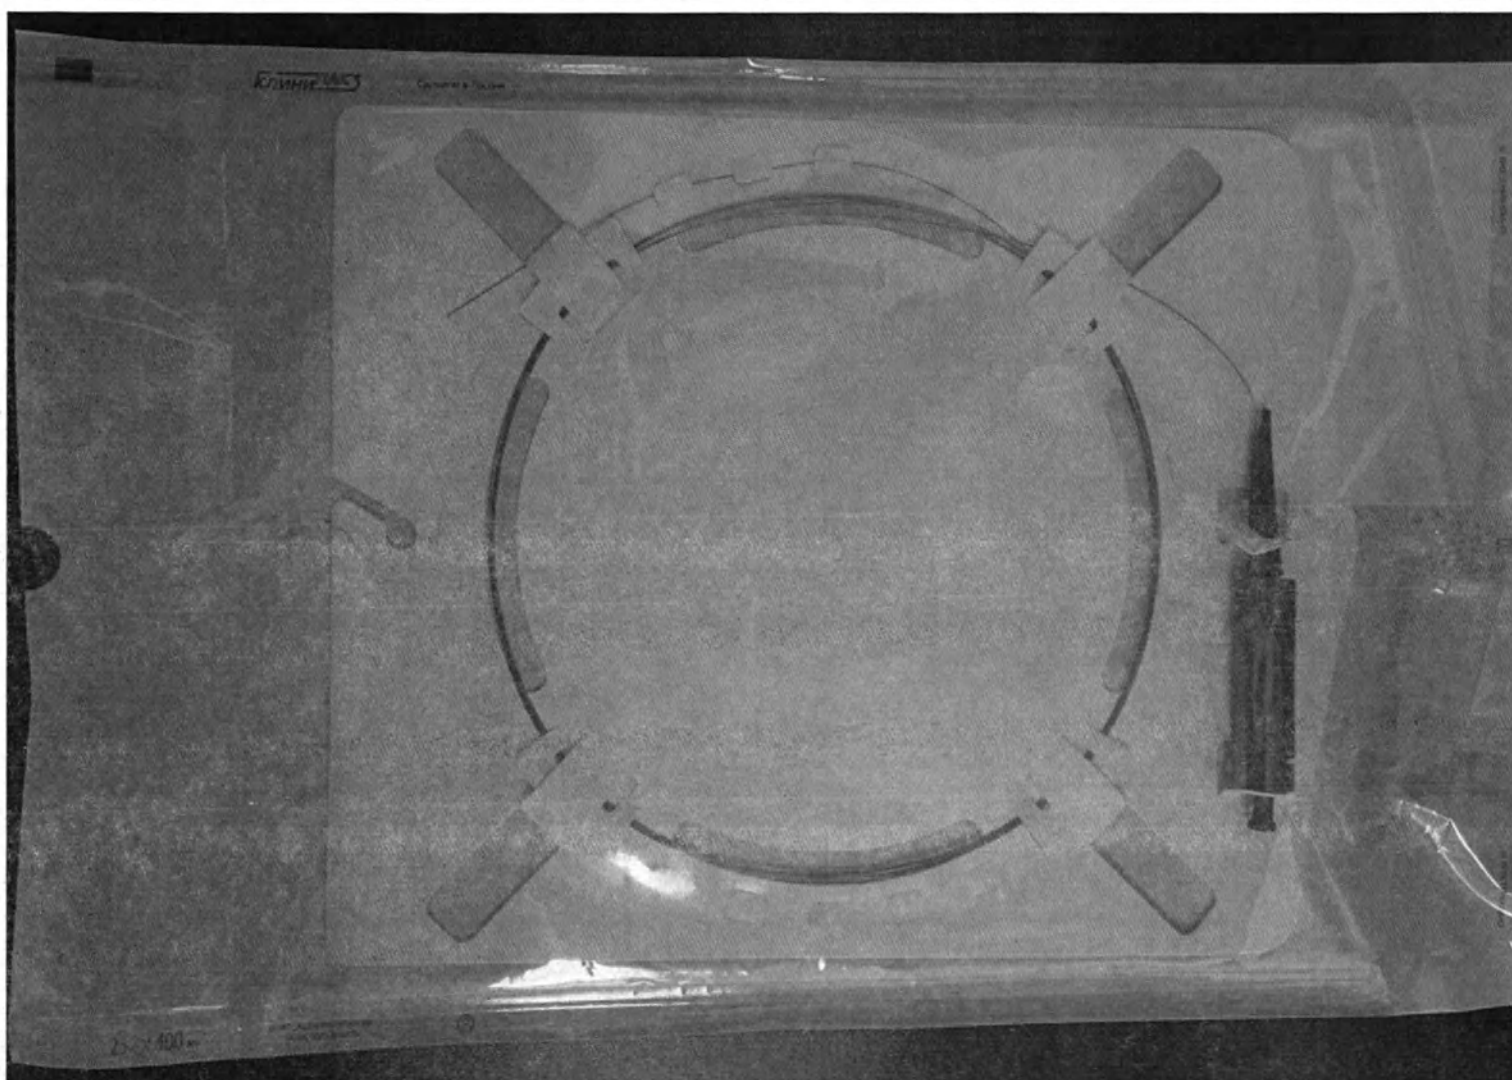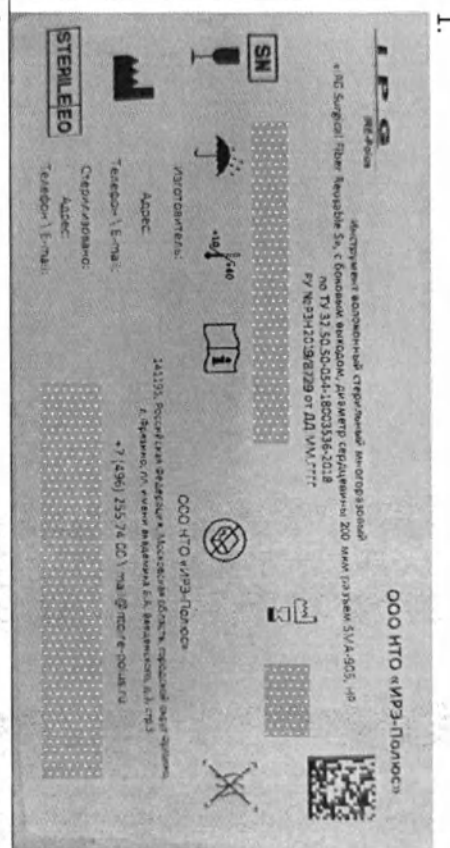



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм, разъем SMA-905, HP

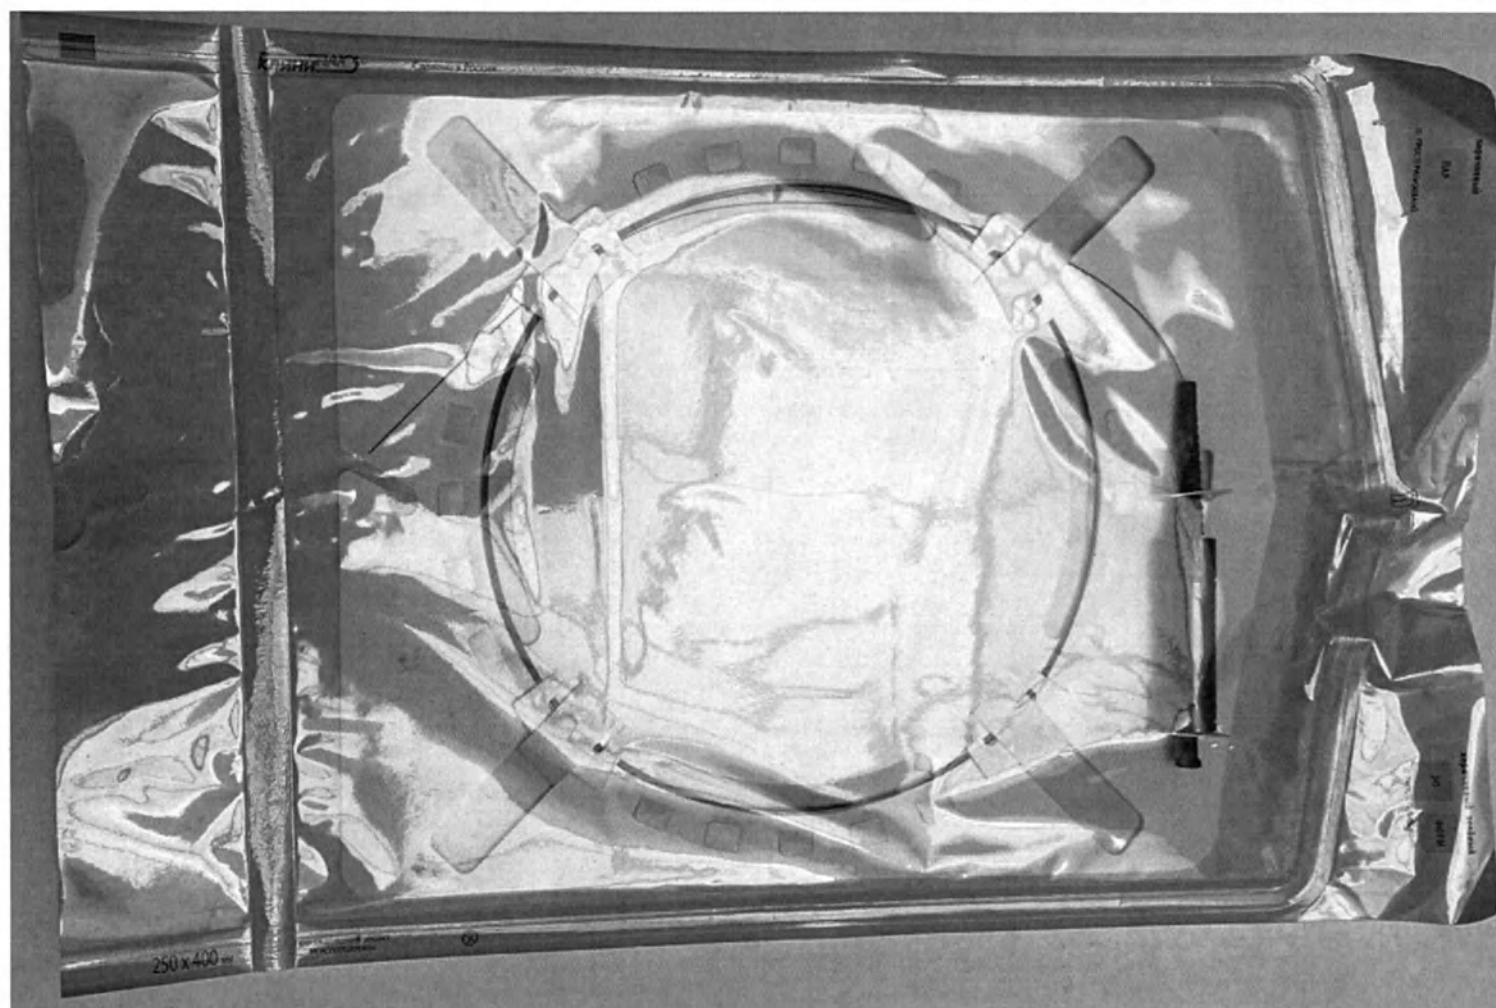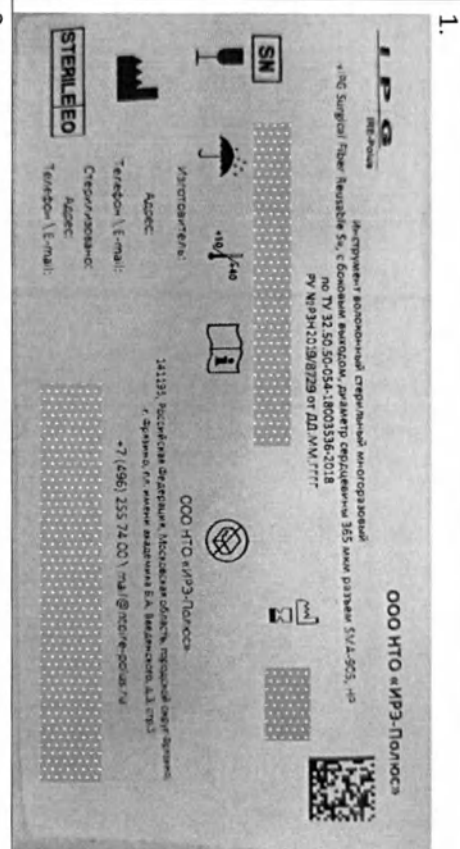



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, HP

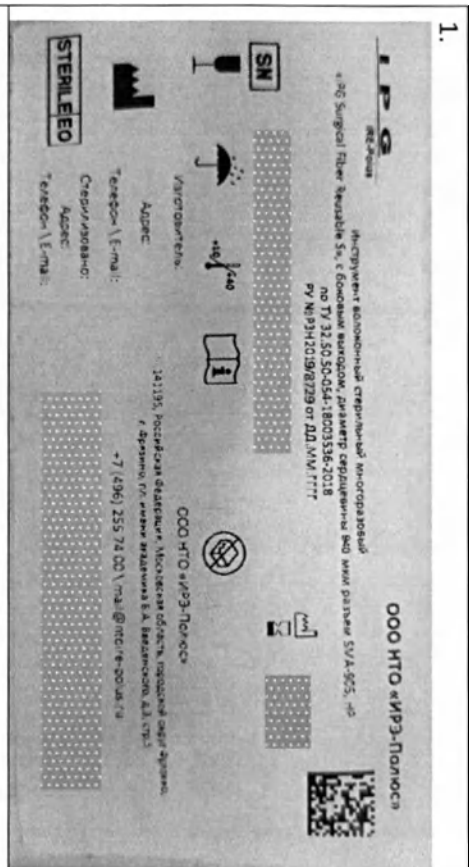



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с боковым выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, HP

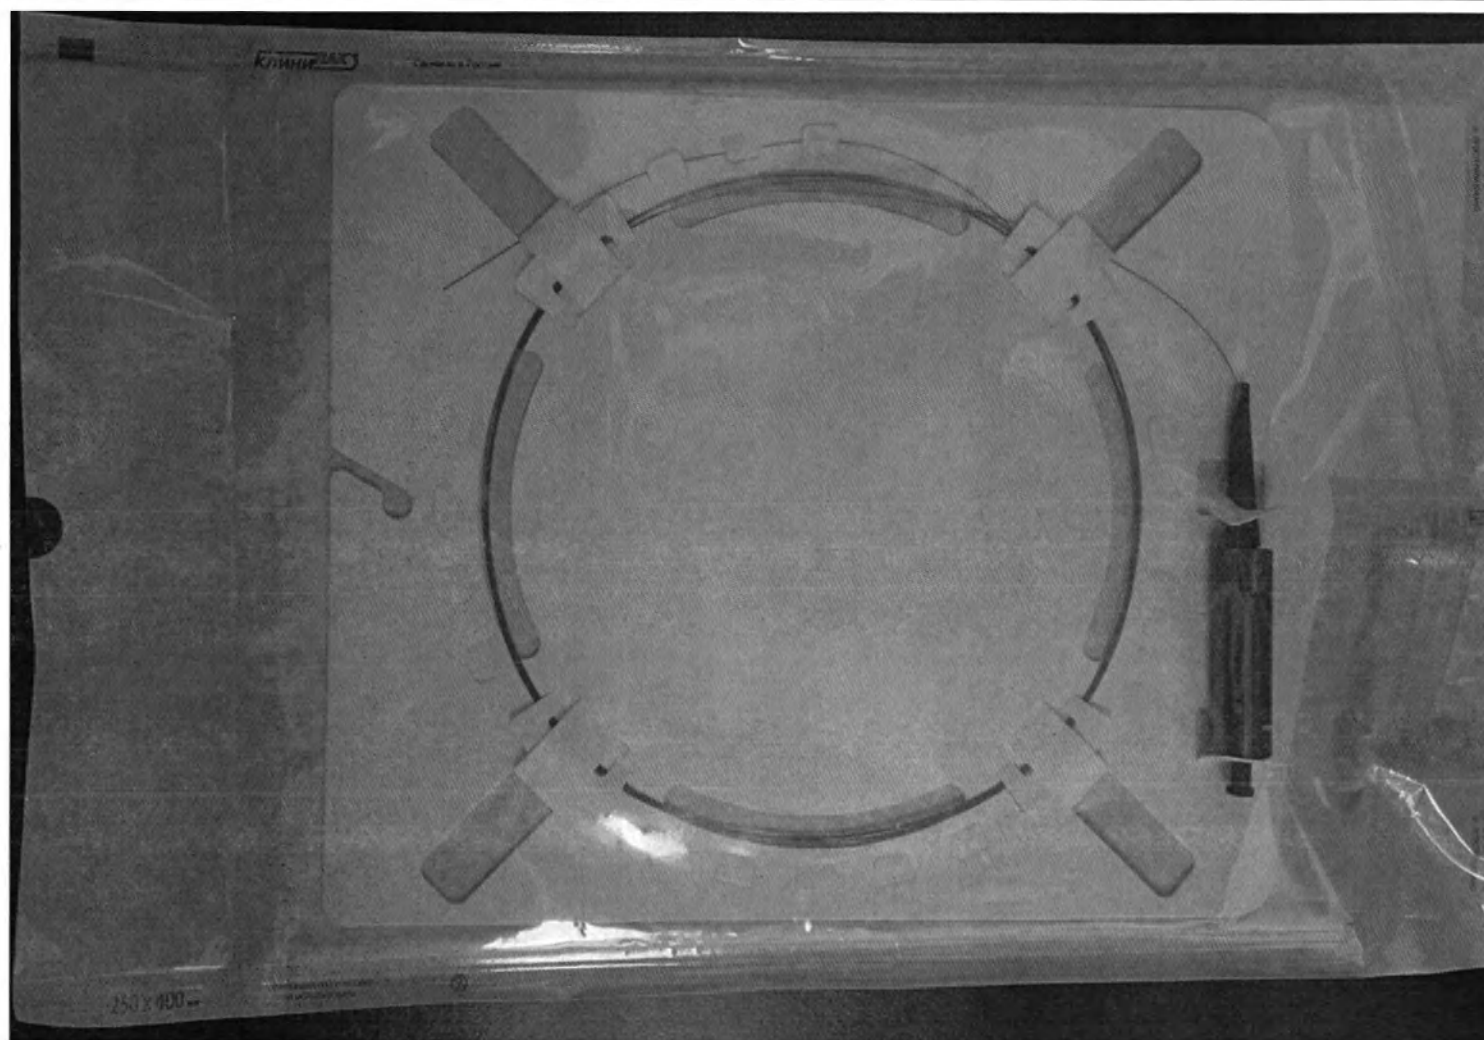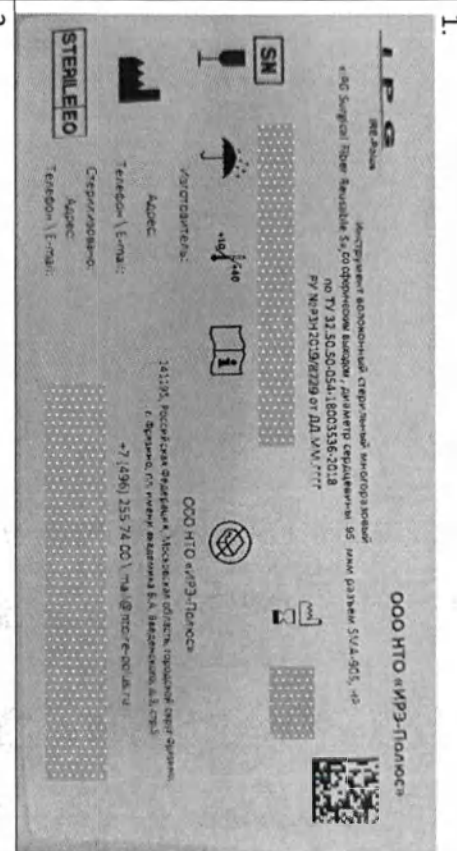



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 95 мкм, разъем SMA-905, HP

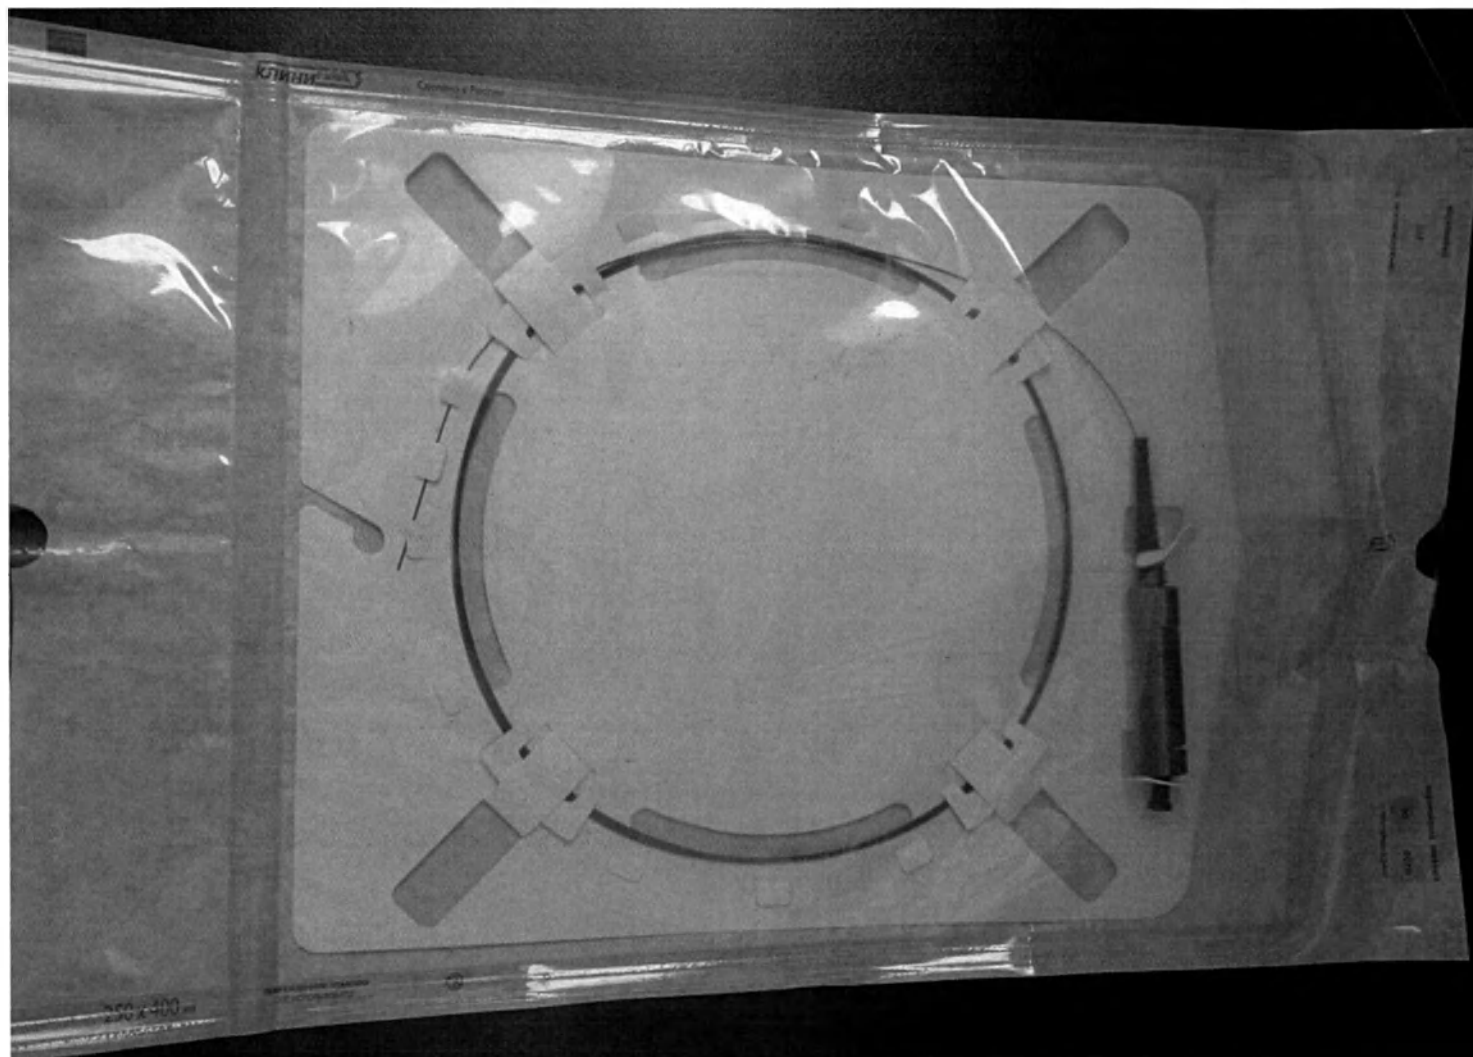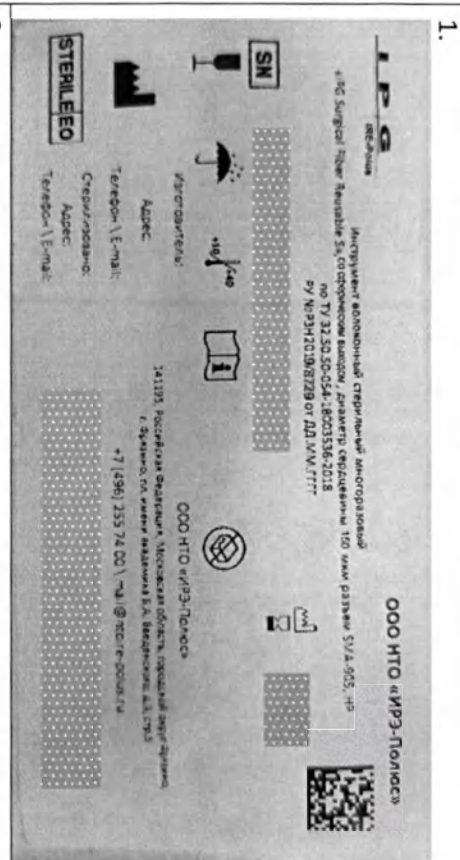



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 150 мкм, разъем SMA-905, HP

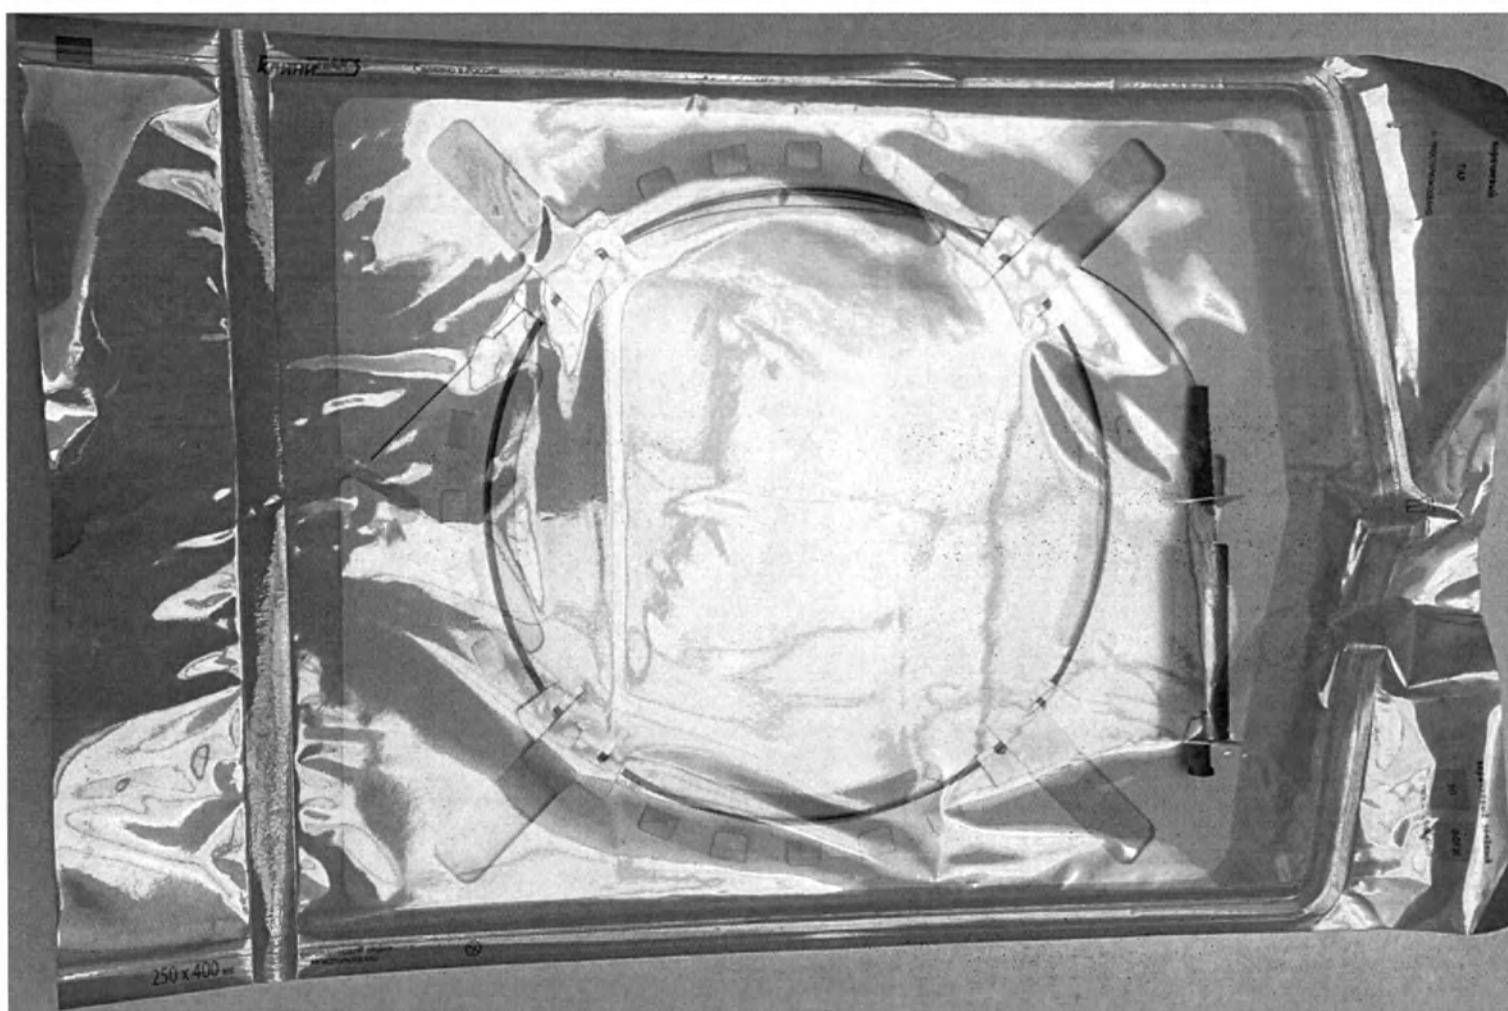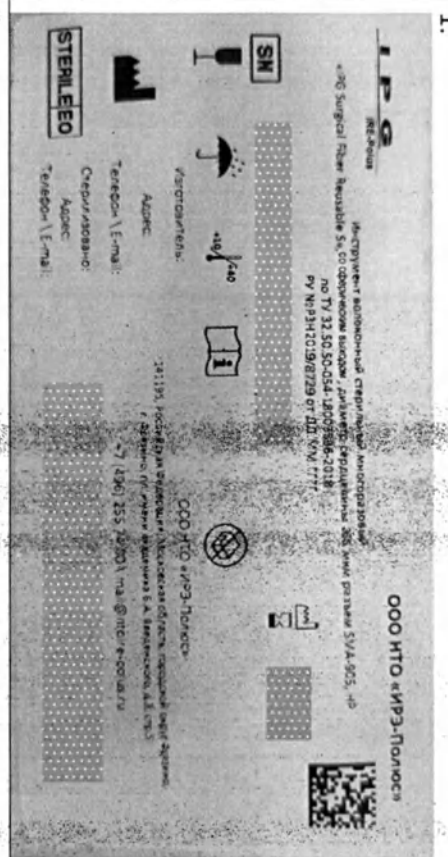



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 365 мкм, разъем SMA-905, HP

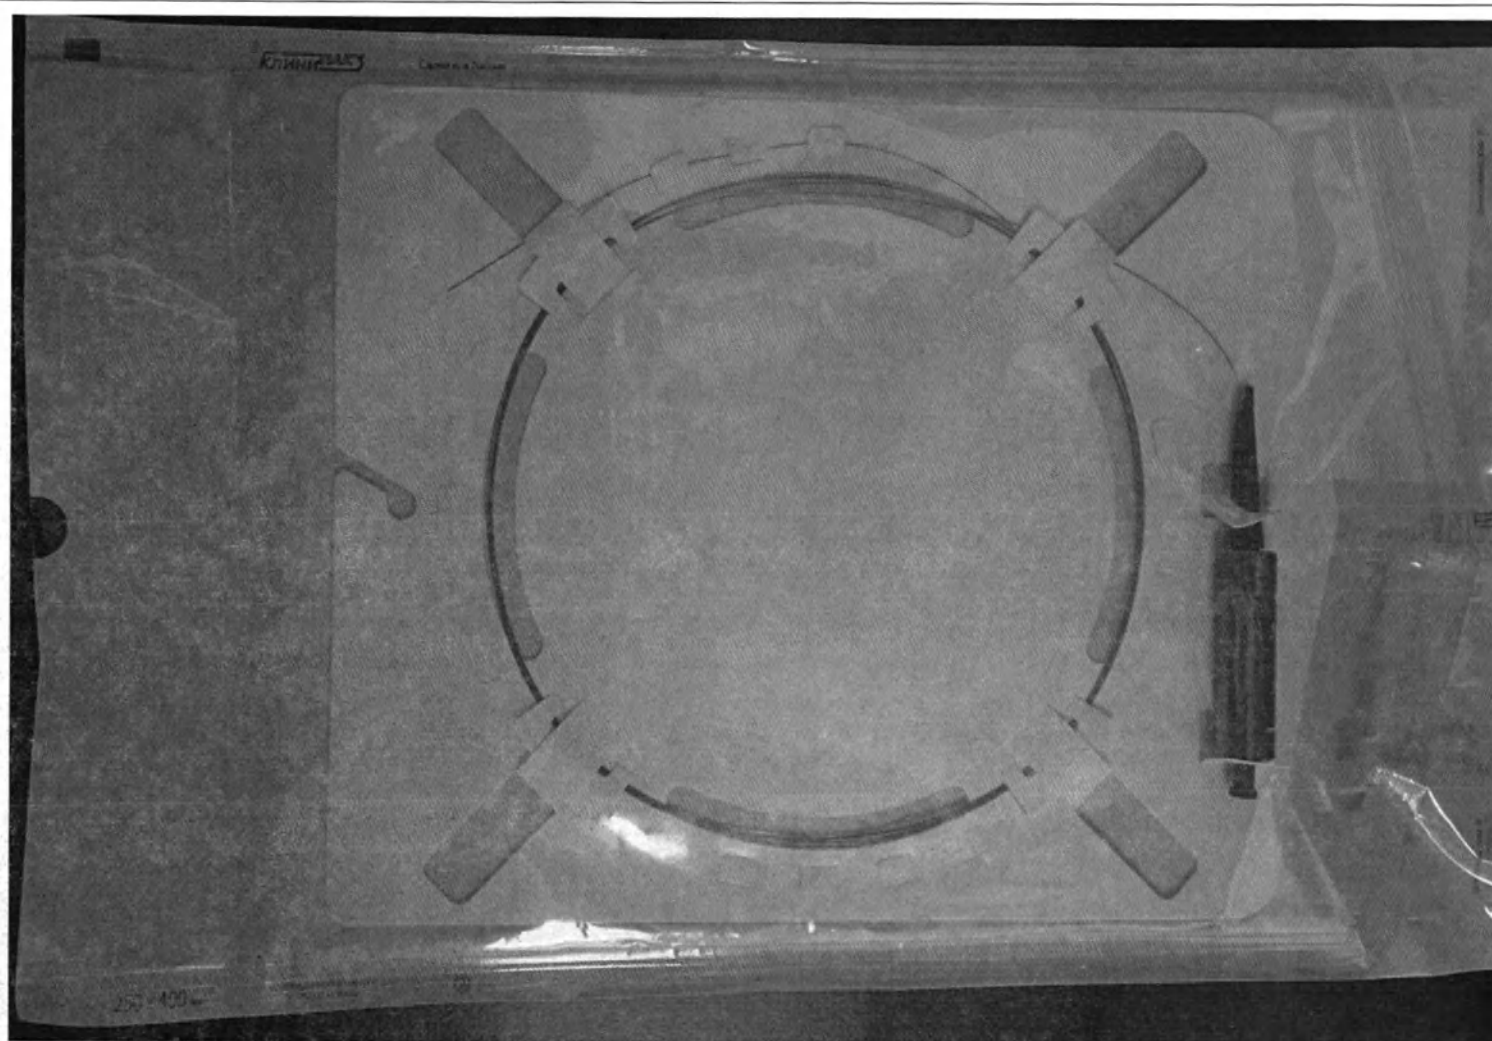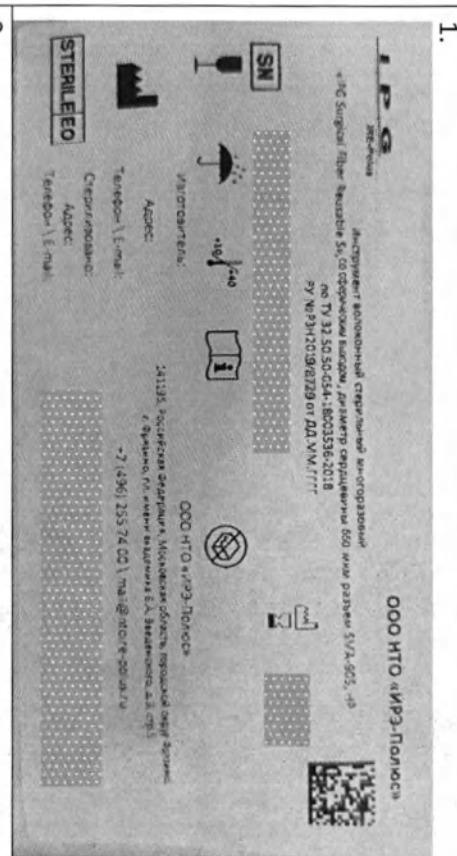



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 550 мкм, разъем SMA-905, HP

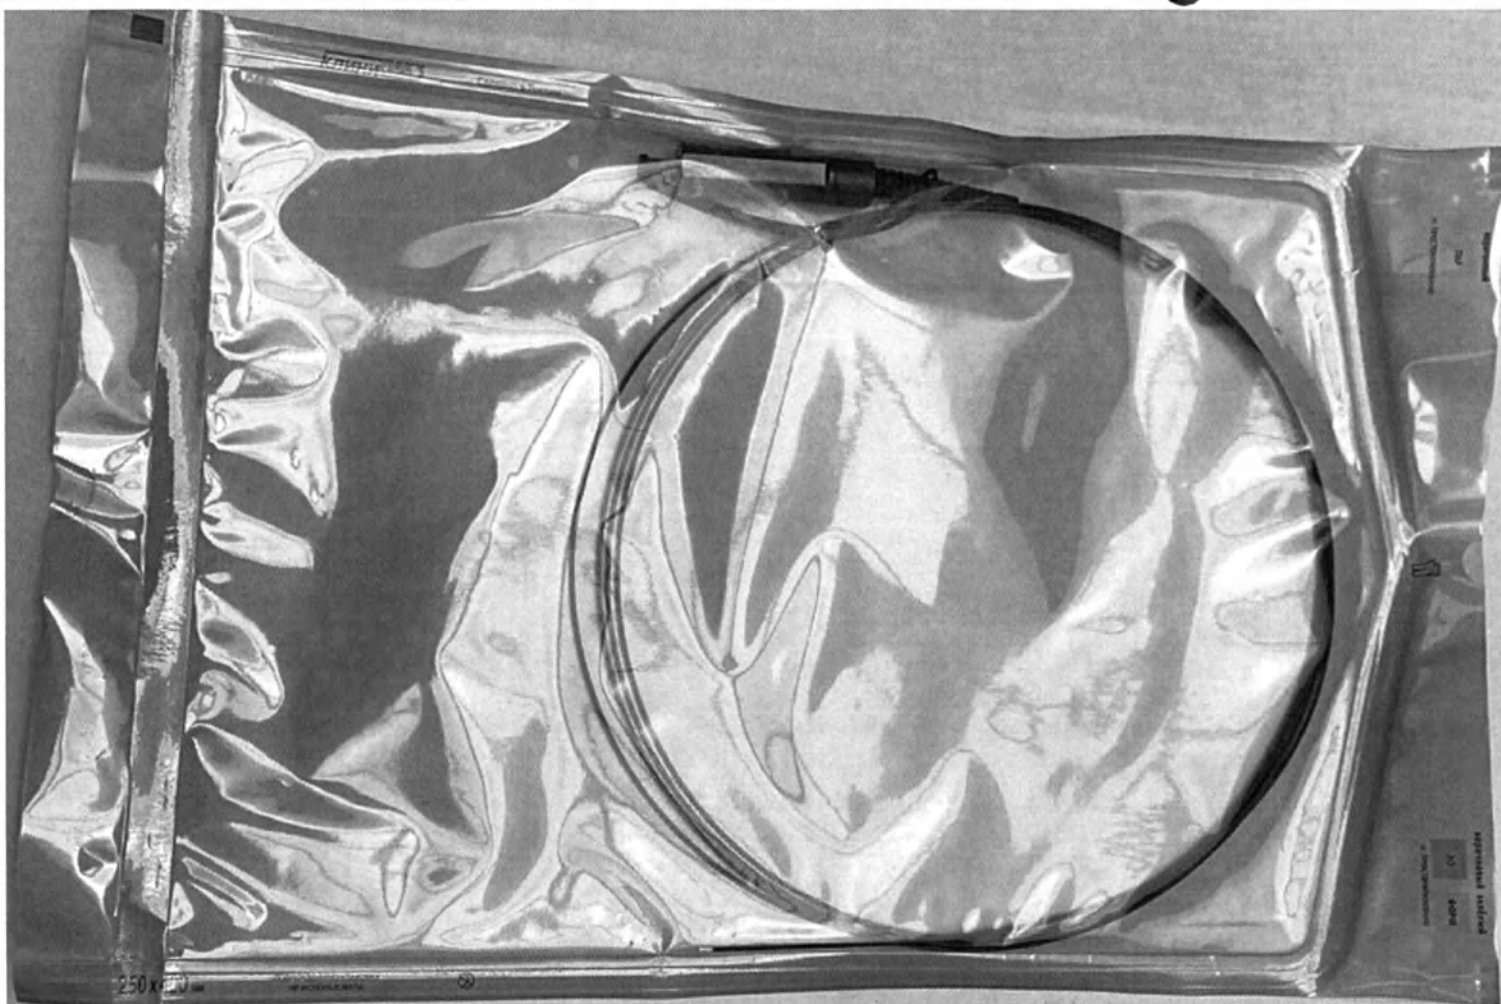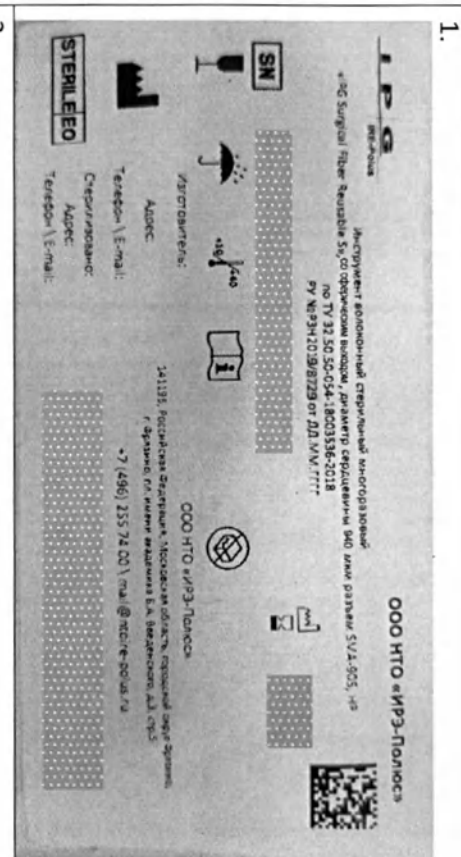


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения: Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» со сферическим выходом, диаметр сердцевины 940 мкм, разъем SMA-905, HP

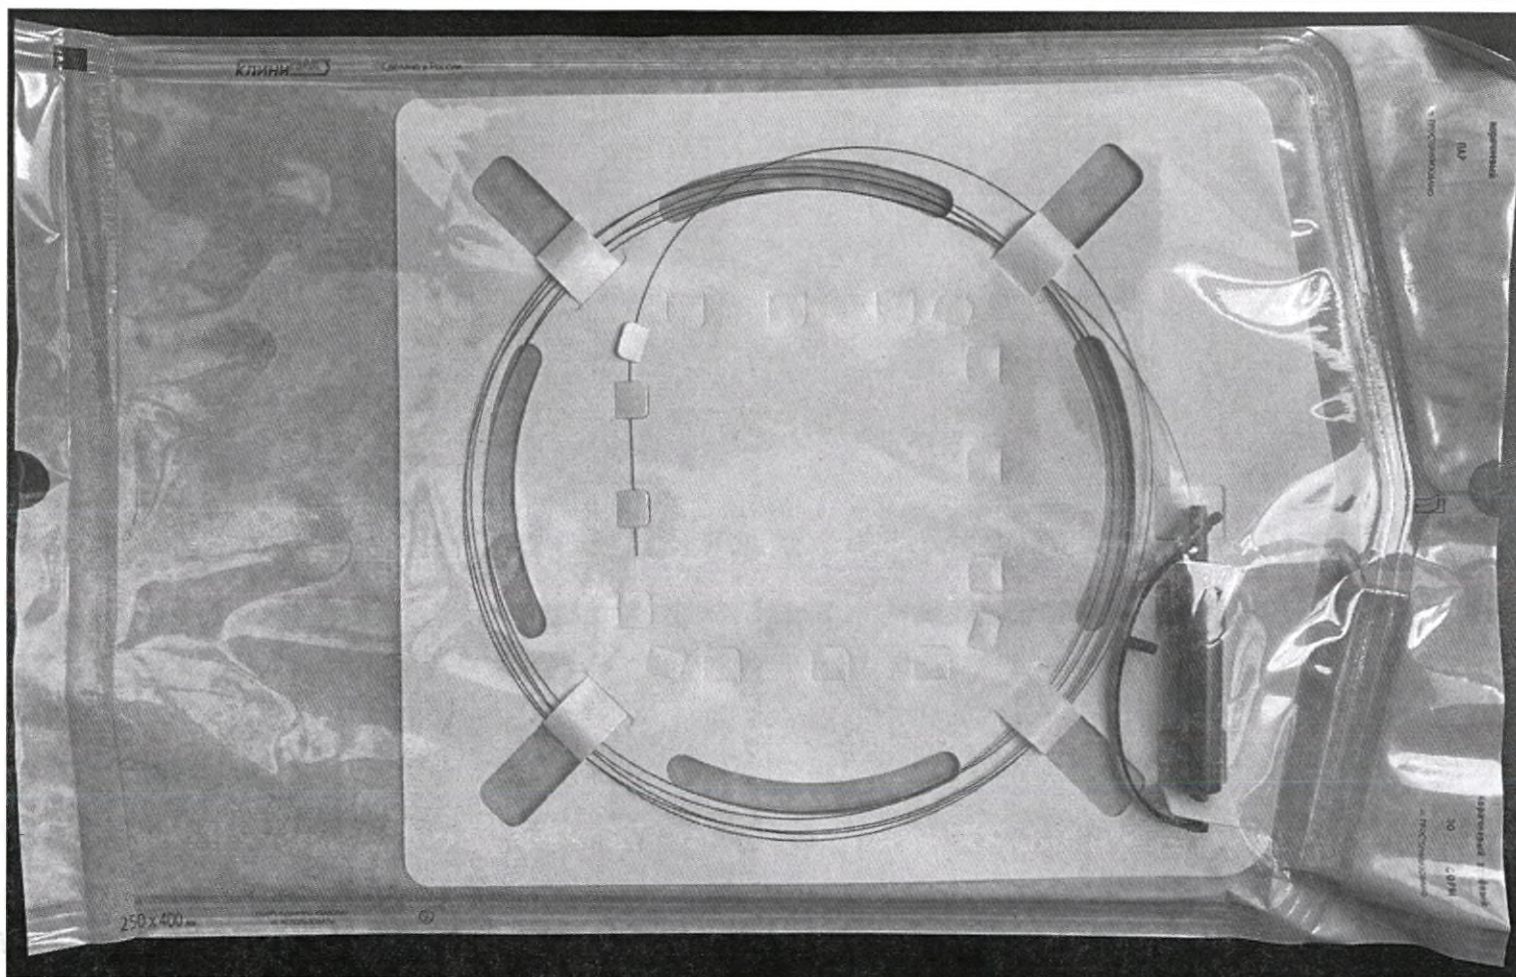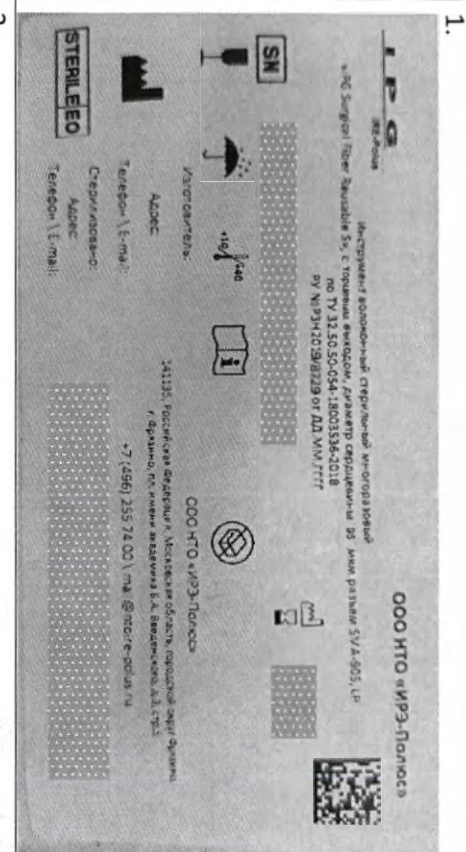



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения: Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 95 мкм разъем SMA-905, LP

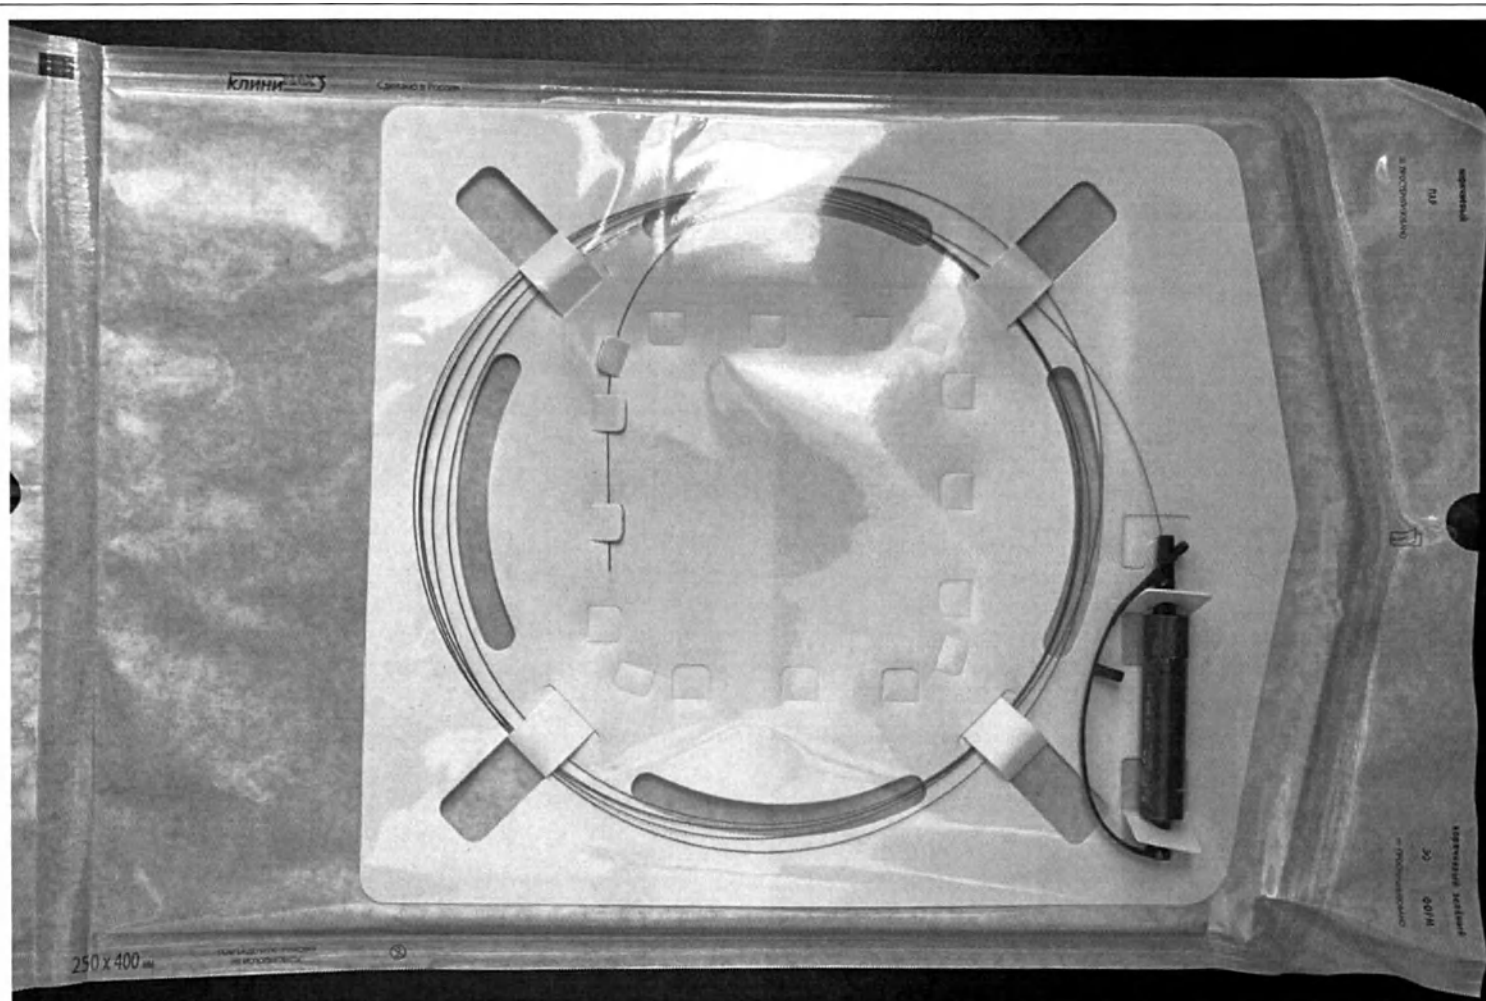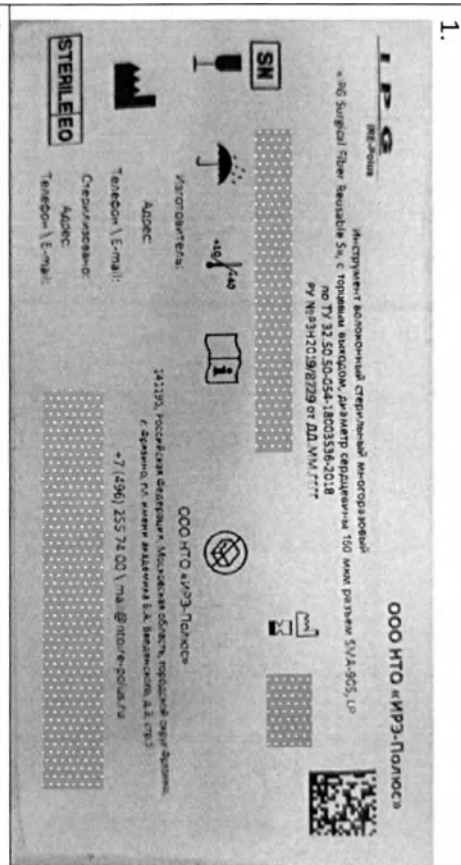



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многократный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 150 мкм разъем SMA-905, LP

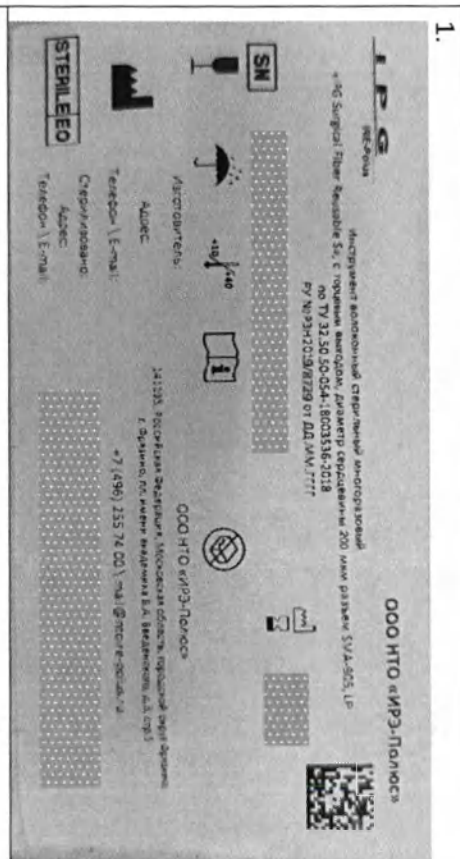


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 200 мкм разъем SMA-905, LP

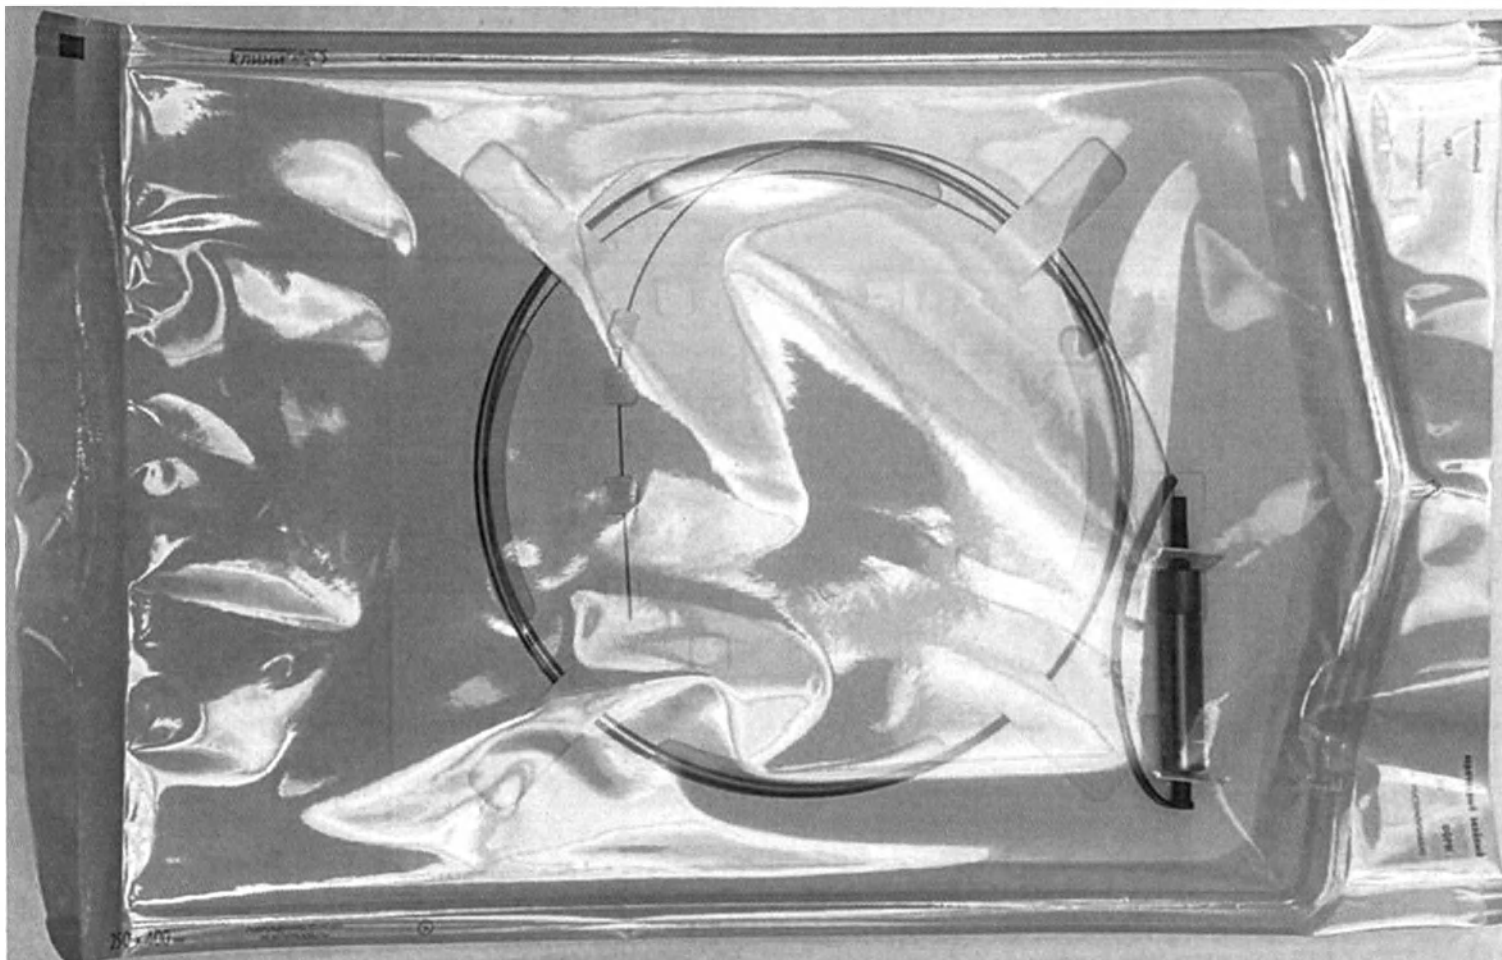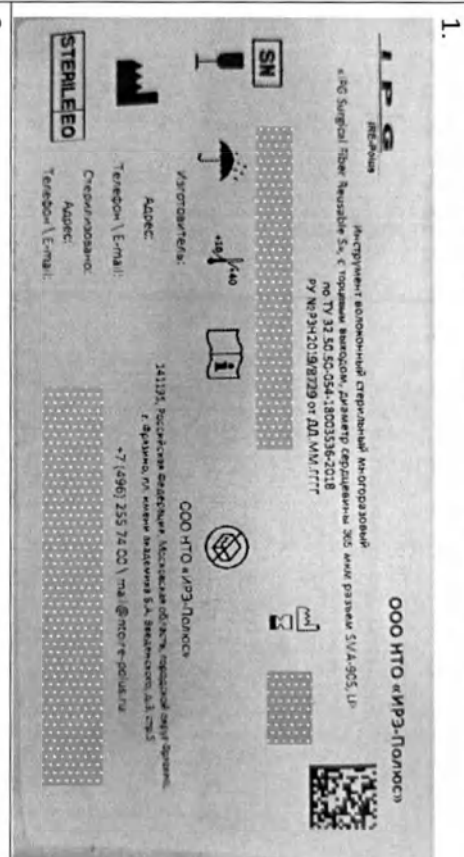



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 365 мкм разъем SMA-905, LP

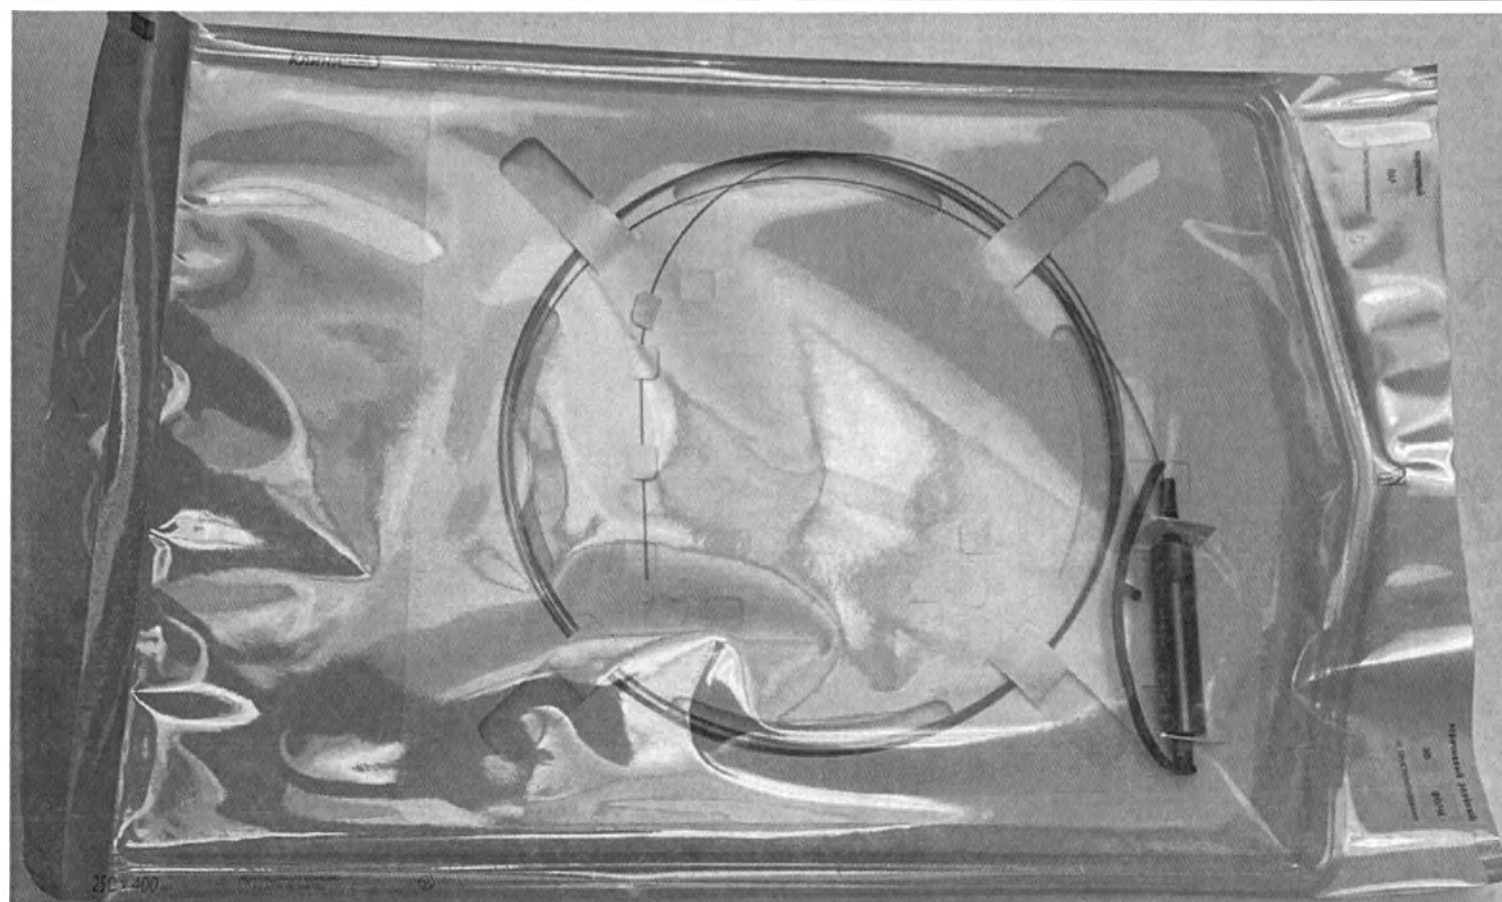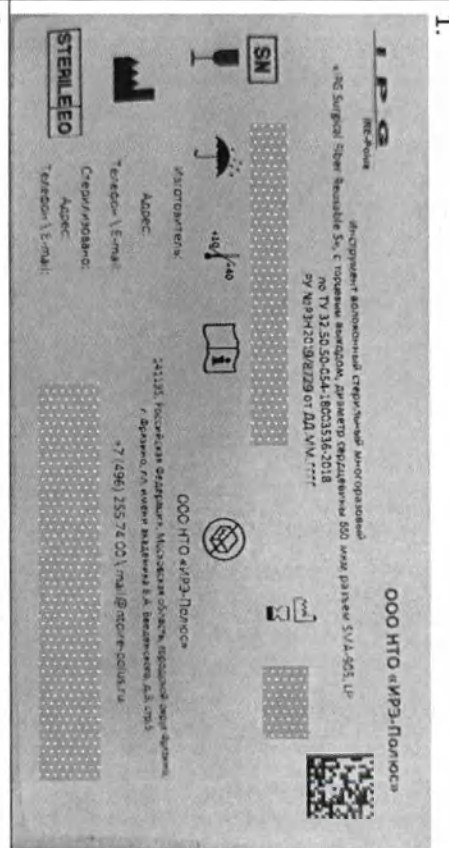



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с торцевым выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP

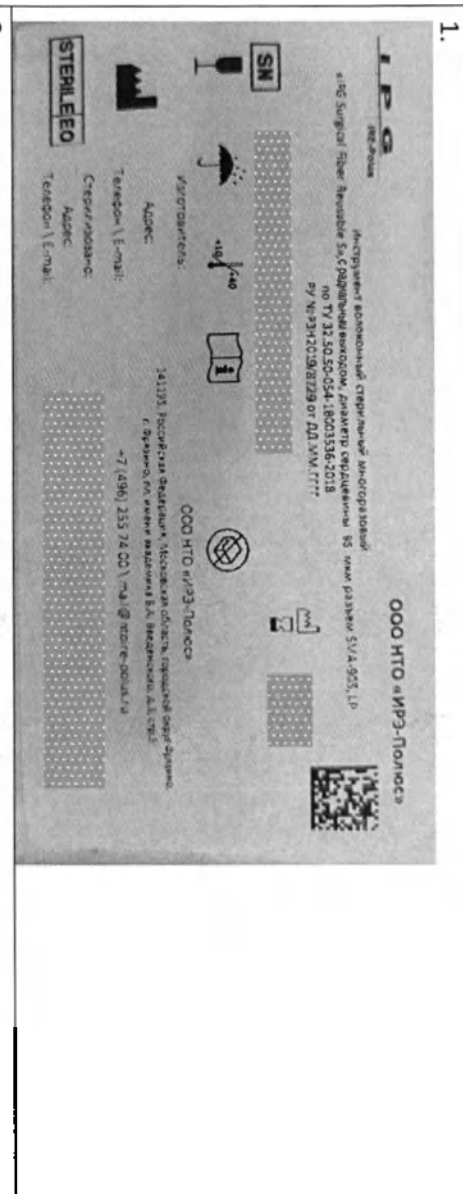



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 95 мкм разъем SMA-905, LP

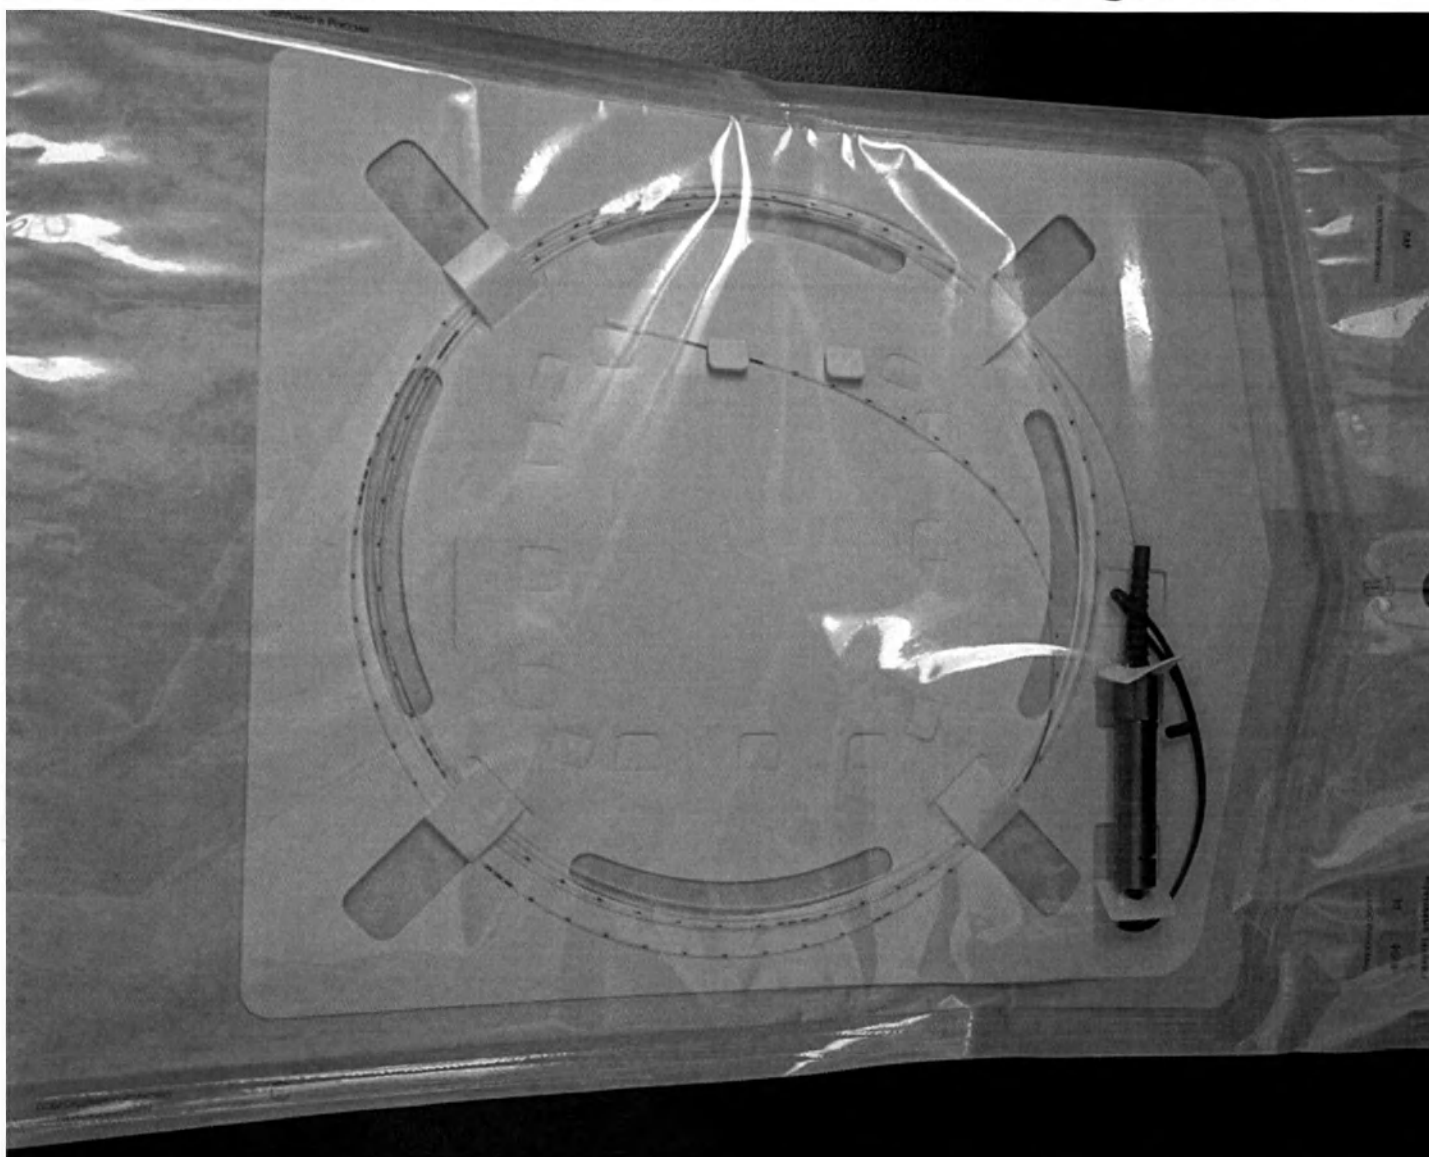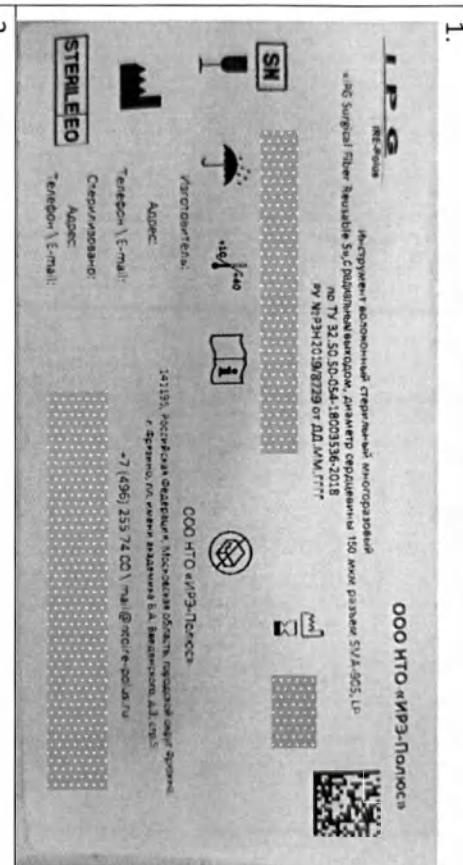



1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоцветный «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 150 мкм разъем SMA-905, LP

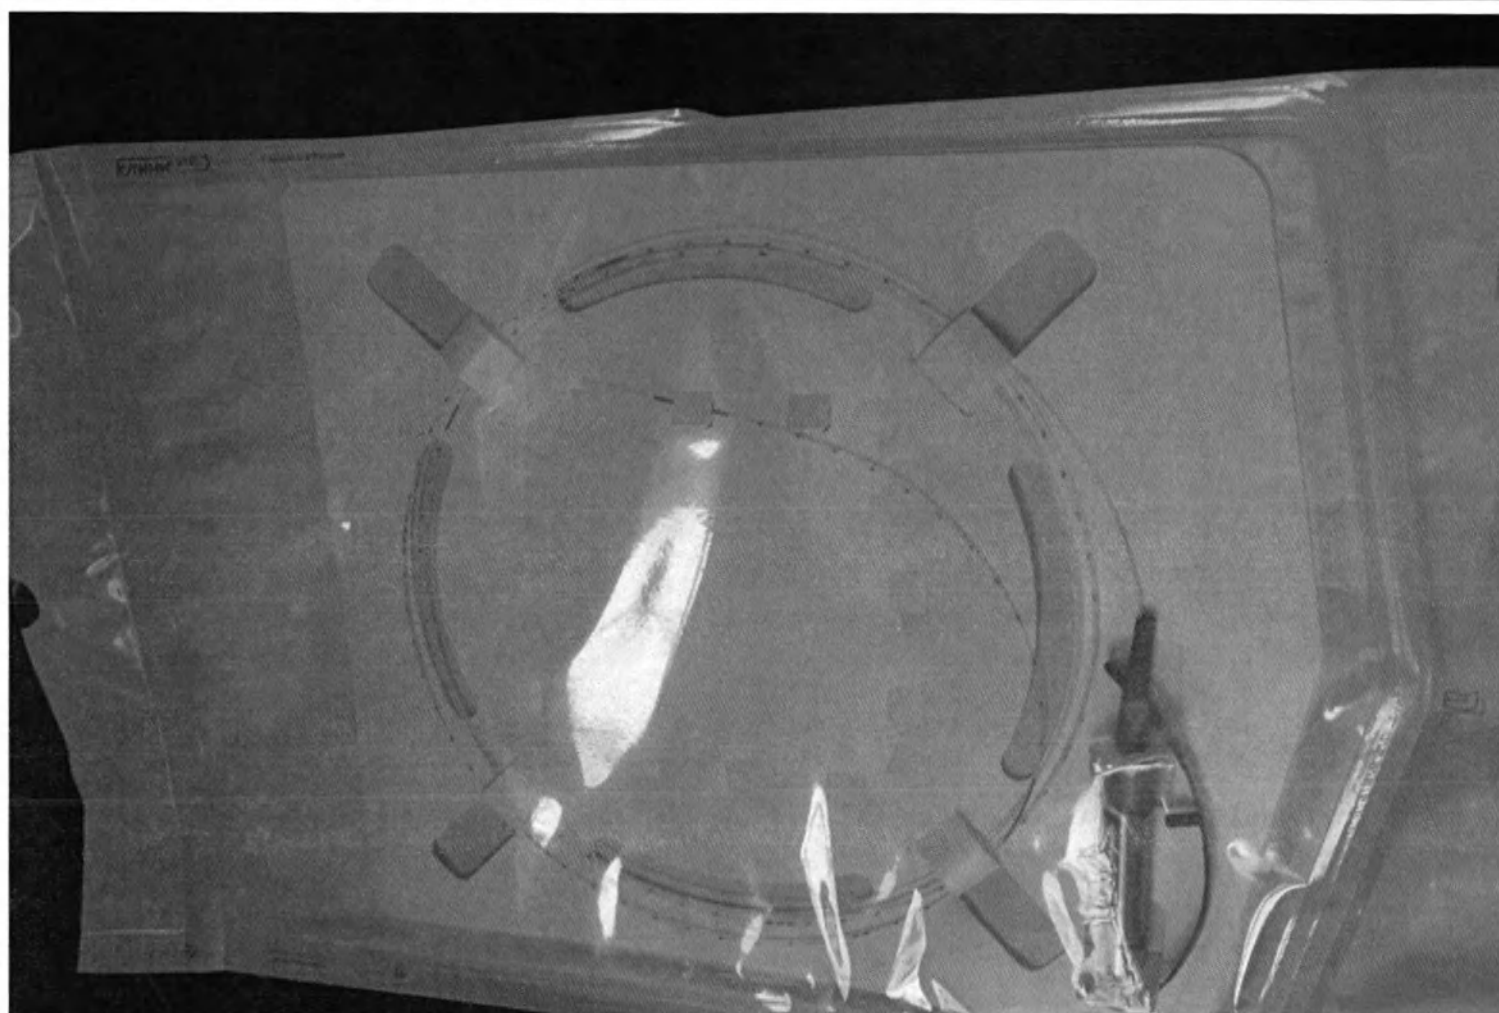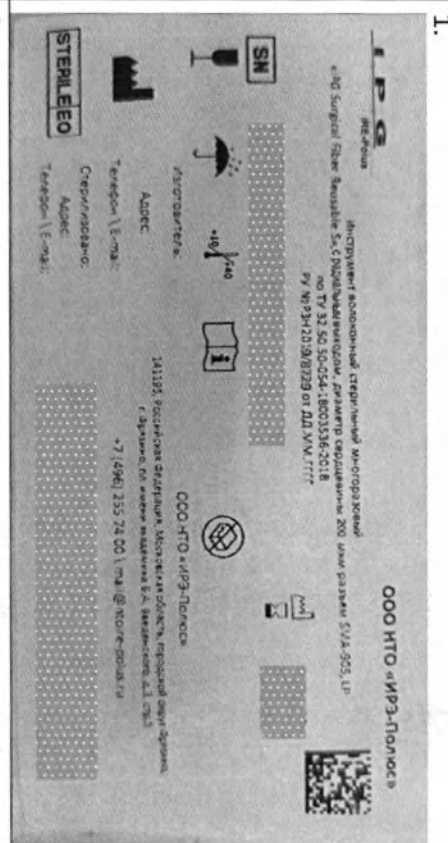


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 200 мкм разъем SMA-905, LP

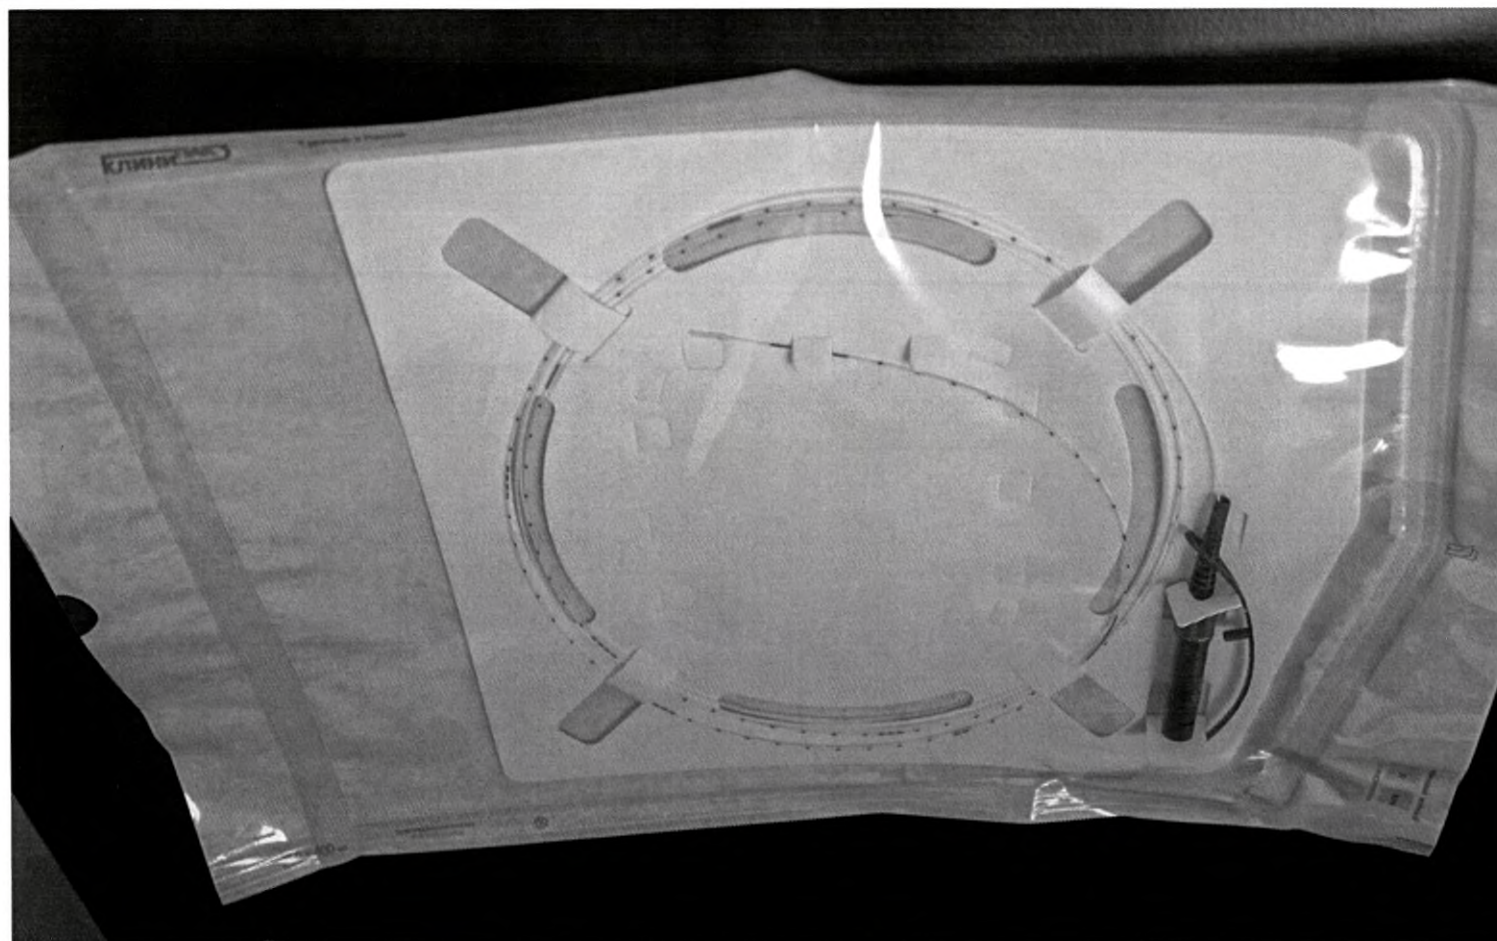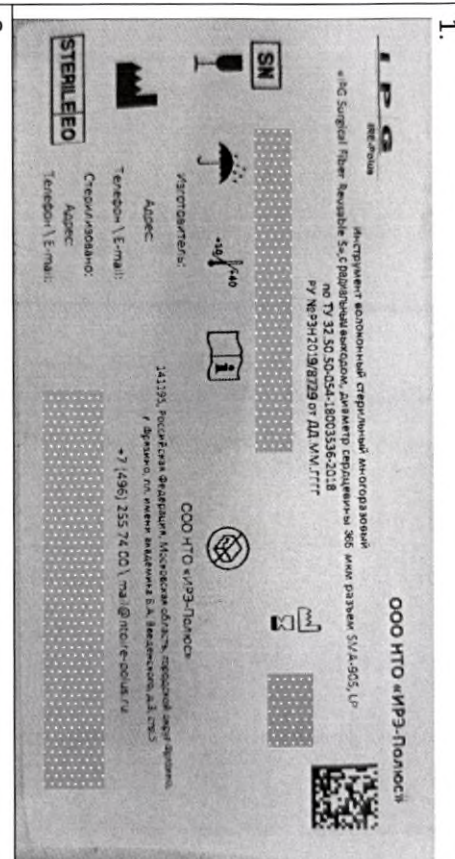


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 365 мкм разъем SMA-905, LP

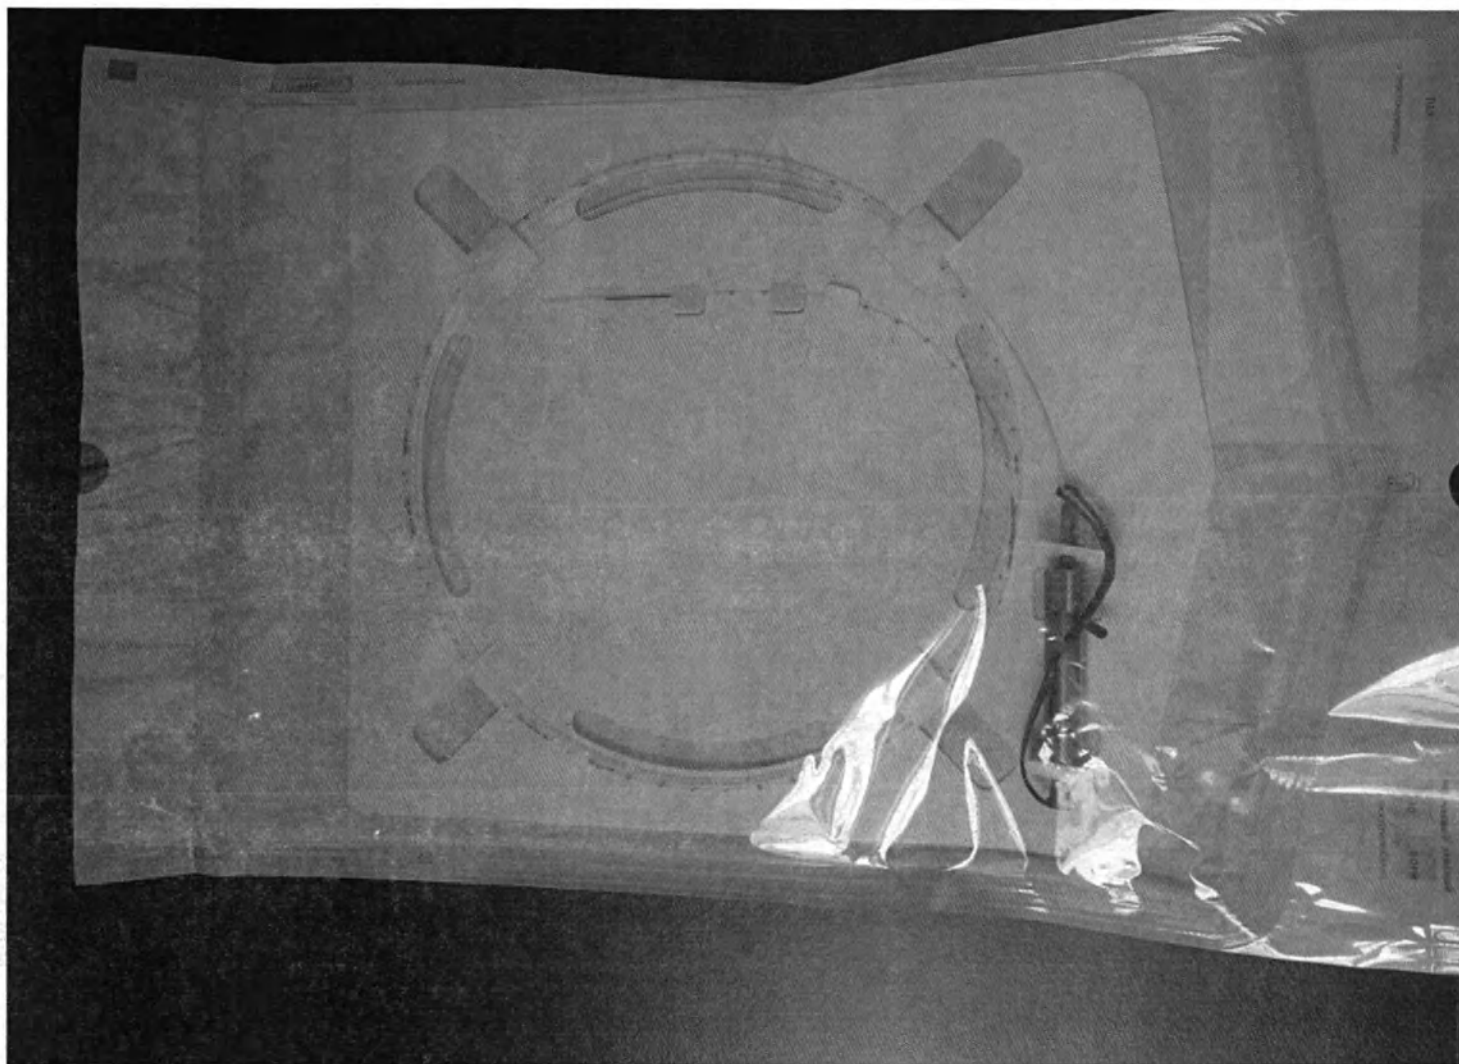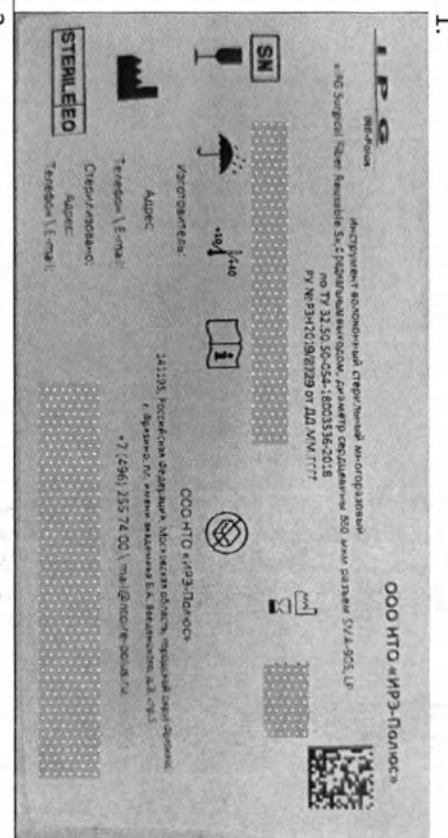

1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 550 мкм разъем SMA-905, LP

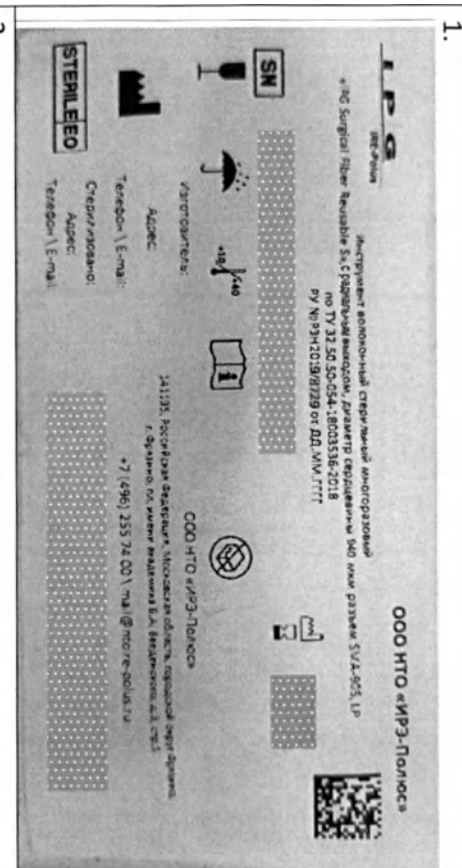


1. Внешний вид маркировки индивидуальной упаковки
2. Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018 в варианте исполнения:
Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины 940 мкм разъем SMA-905, LP

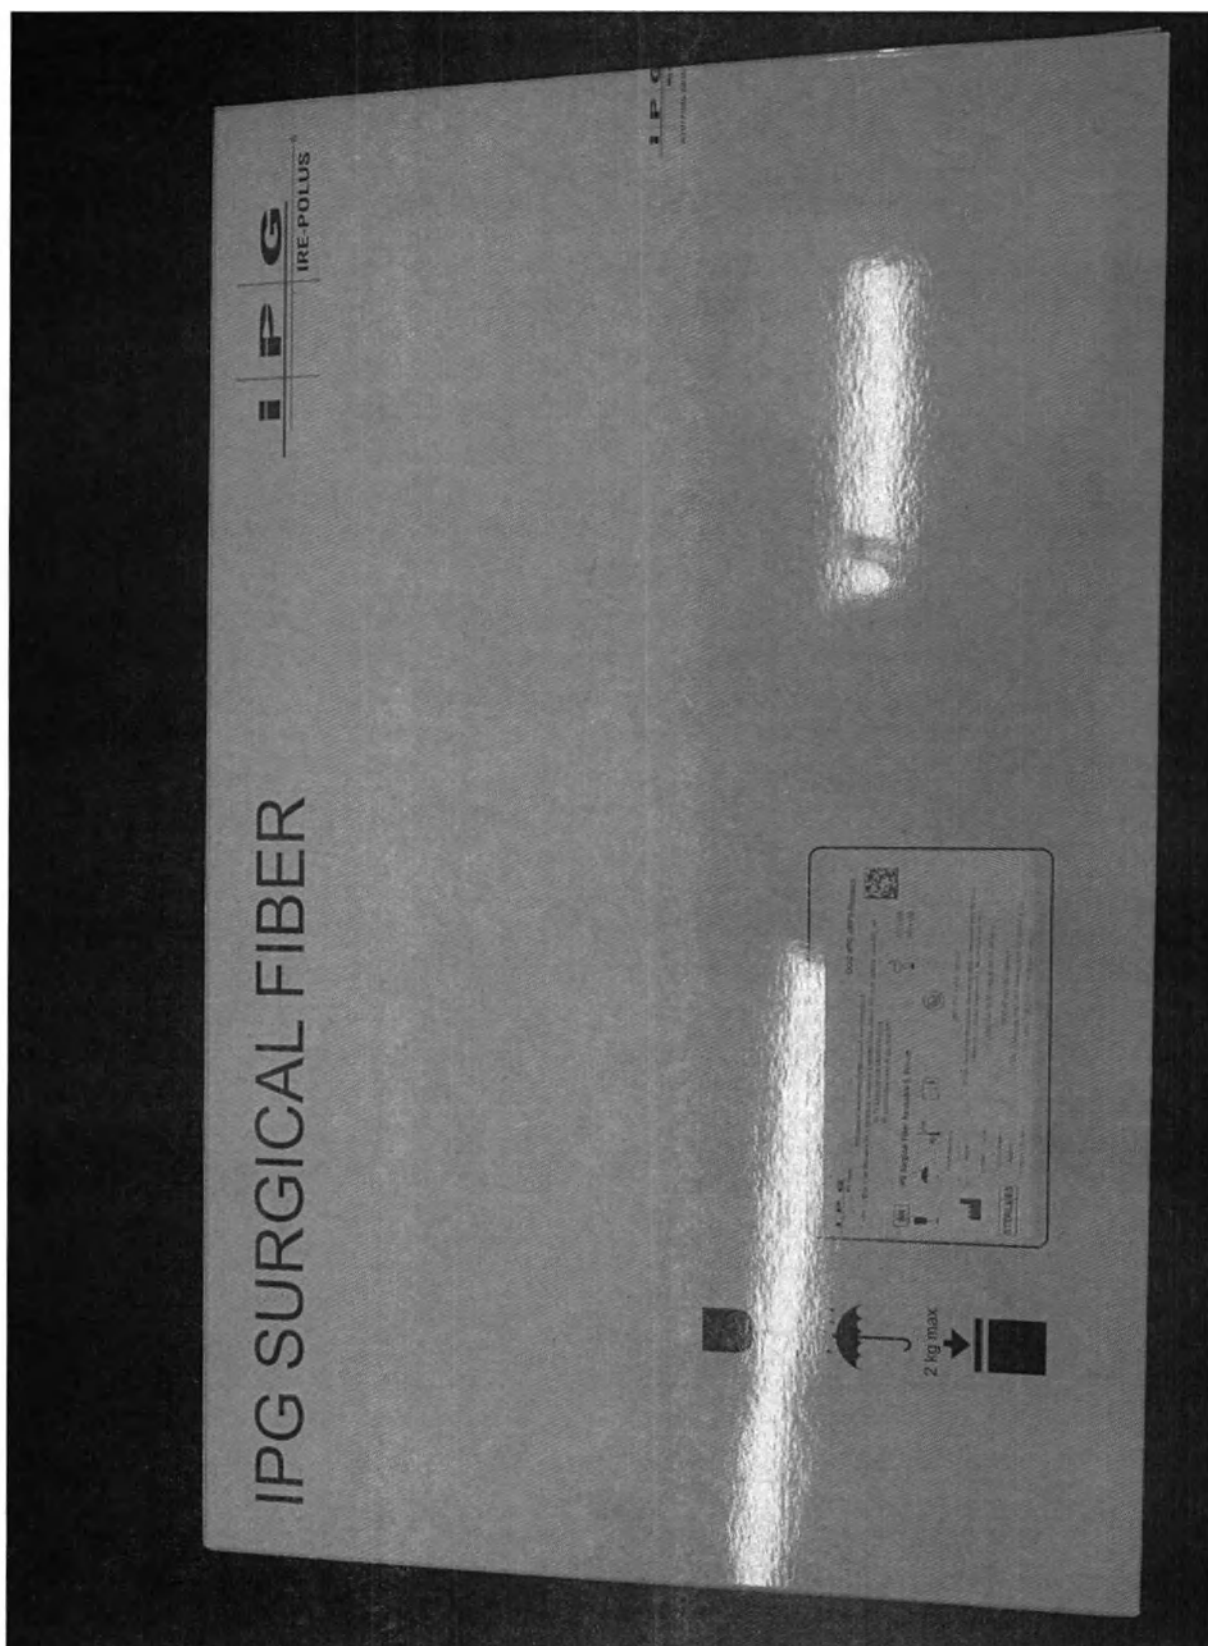

Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018, внешний вид потребительской (транспортной) упаковки (варианты исполнения:

Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм


Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP.)

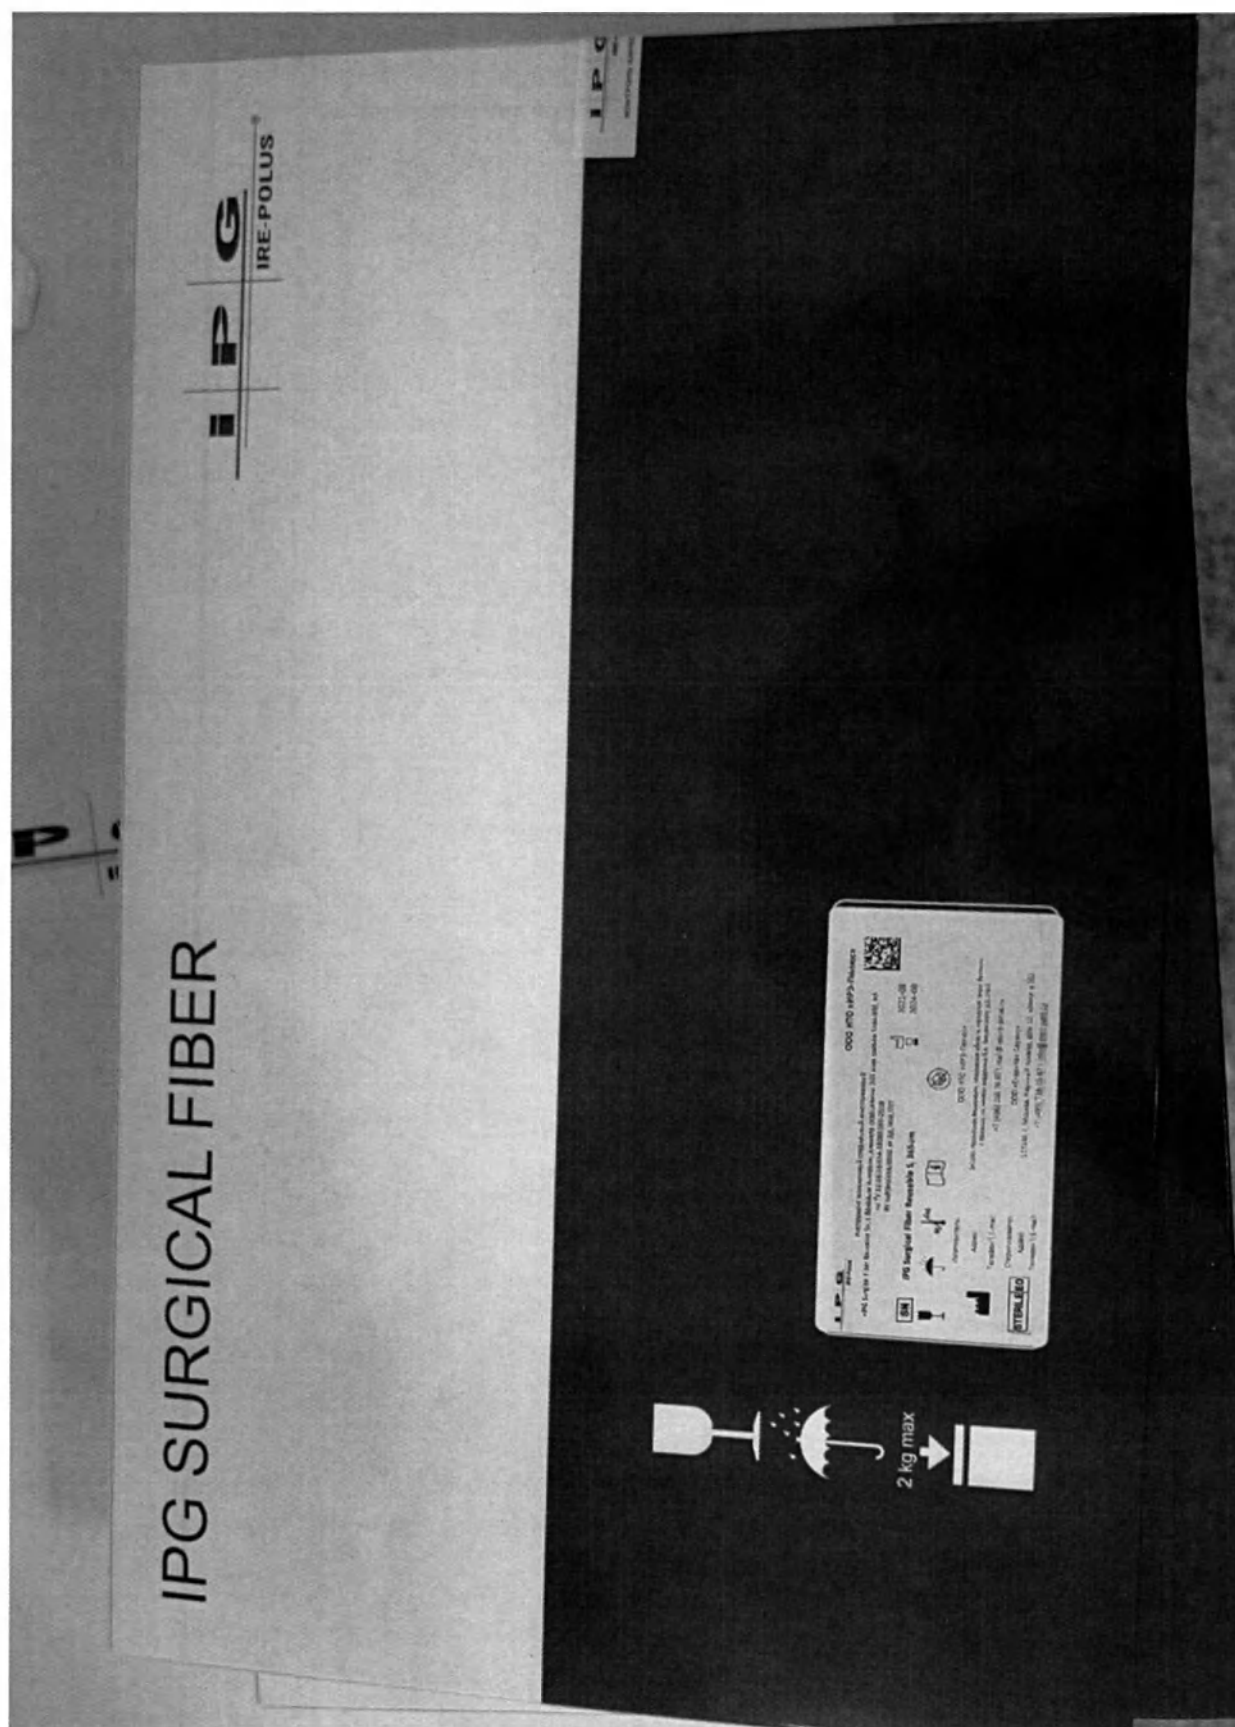


Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054-18003536-2018, внешний вид потребительской (транспортной) упаковки (все варианты исполнения, кроме:

- Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм
- Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» с радиальным выходом, диаметр сердцевины XX мкм, разъем SMA-905, LP.)

1

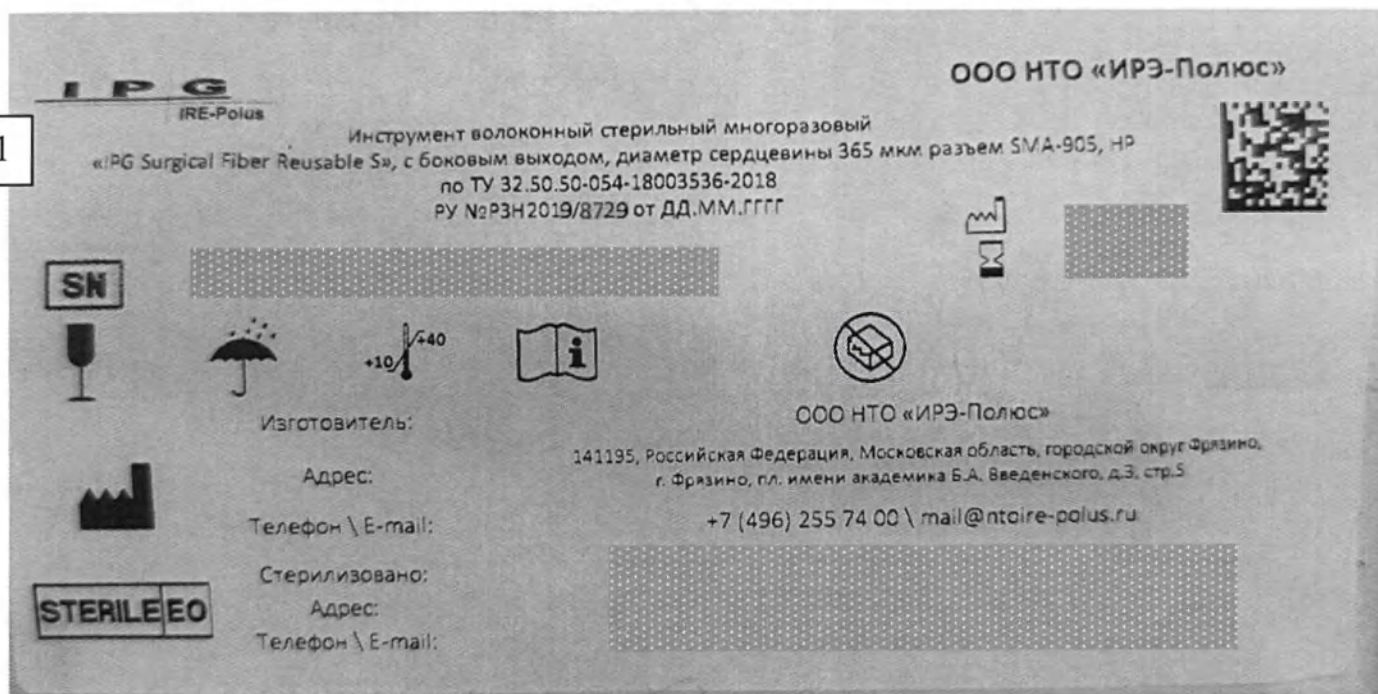

2.1

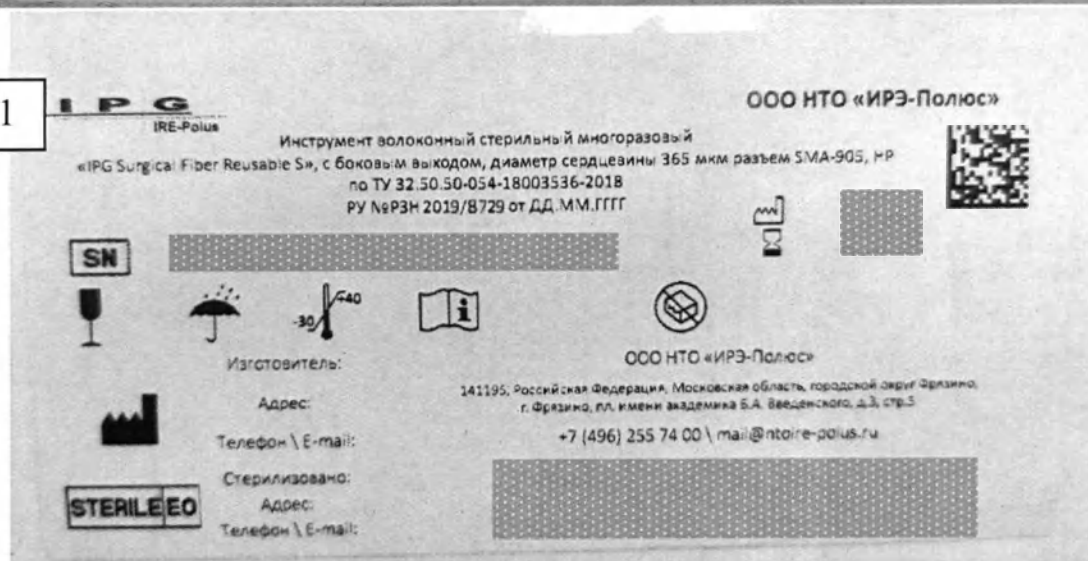

2.2



3.1




3.2



Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S» по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018, пример маркировки:

1. Пример маркировки индивидуальной упаковки
2. Пример маркировки потребительской упаковки
3. Пример маркировки разъема

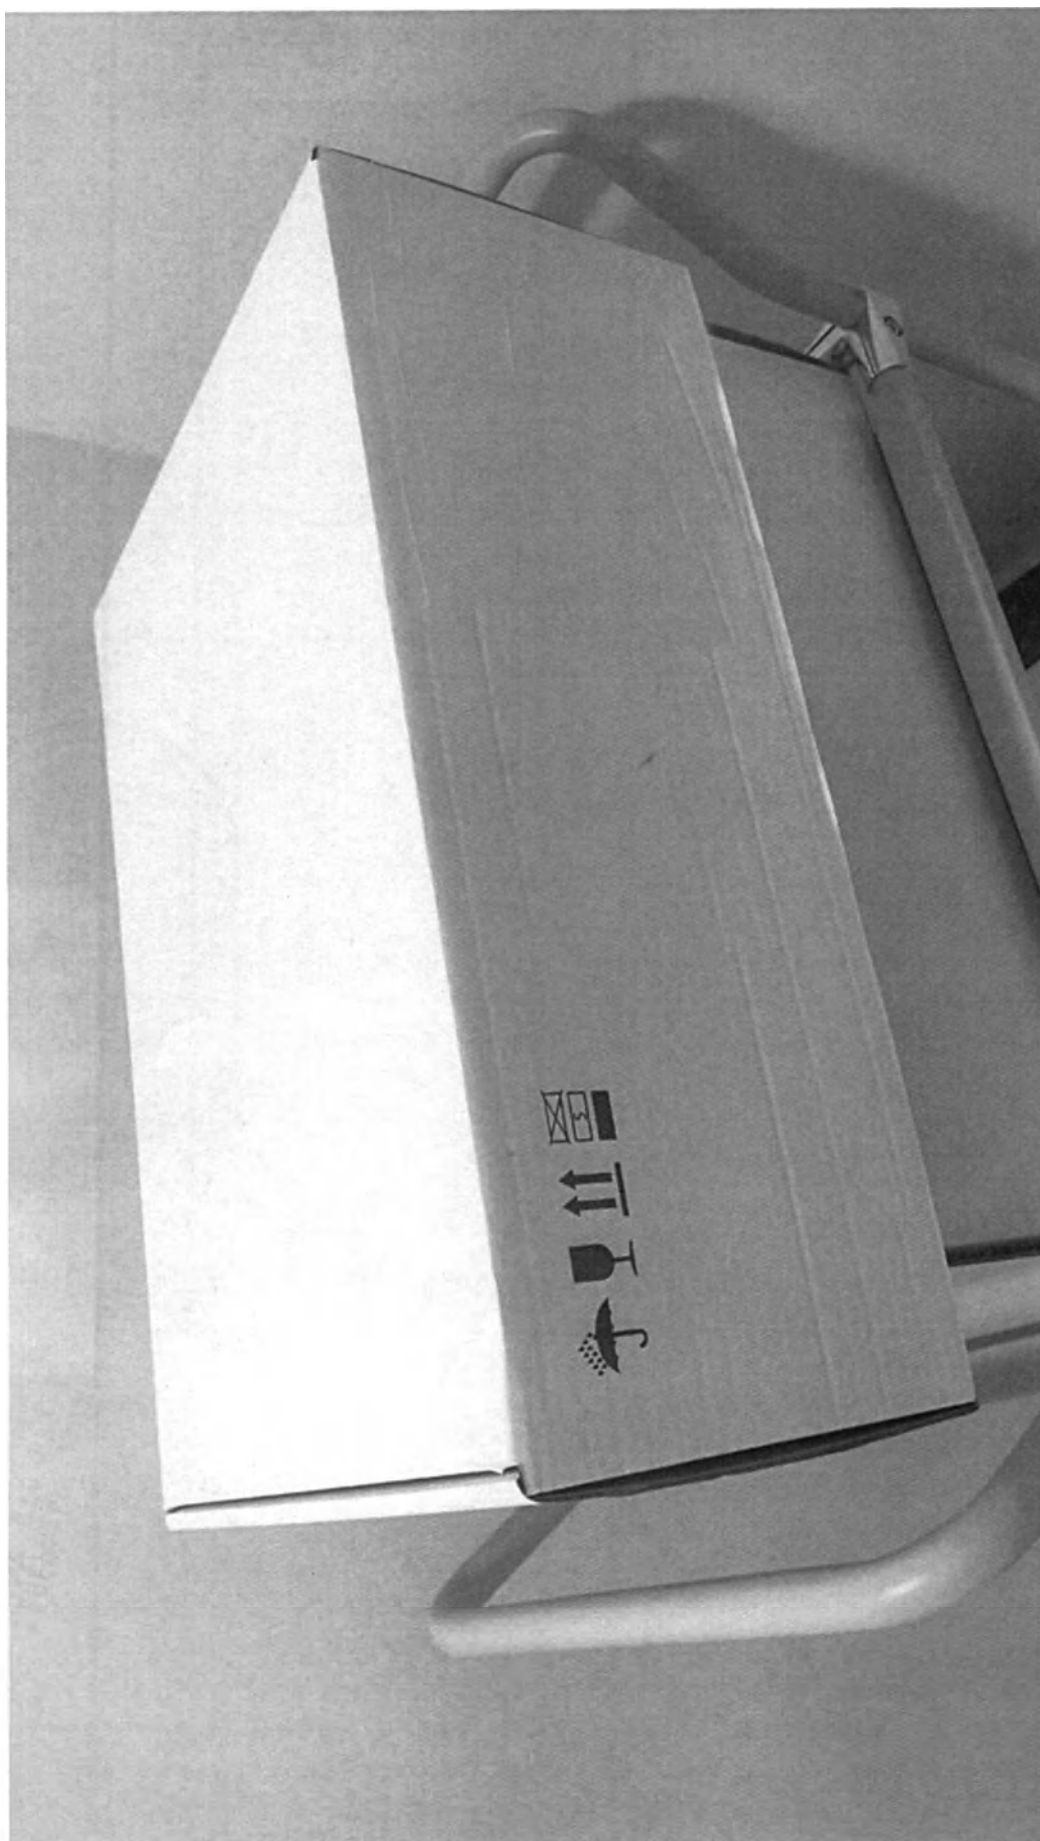

Инструмент волоконный стерильный многоразовый «IPG Surgical Fiber Reusable S»
по ТУ 32.50.50-054- 18003536-2018, внешний вид и маркировка групповой упаковки

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
ООО НТО «ИРЭ-Полус»

30 лист

Печать, подпись



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО НТО «ИРЭ-ПОЛУС»
ЕВТИХИЕВ Н.Н.