

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедРегистратор»

Жвакина Е.Е.

2021г.




Фотографические изображения
На медицинское изделие:
«Аппарат ультразвуковой
диагностический: Clover 60 в составе»

Производитель: Shenzhen Wisonic Medical Technology Co., Ltd.
(Шэньчжэнь Висоник Медикал Технолоджи Ко.,Лтд.)


1. Аппарат ультразвуковой диагностический: Clover 60



2. Датчик ультразвуковой С5-1

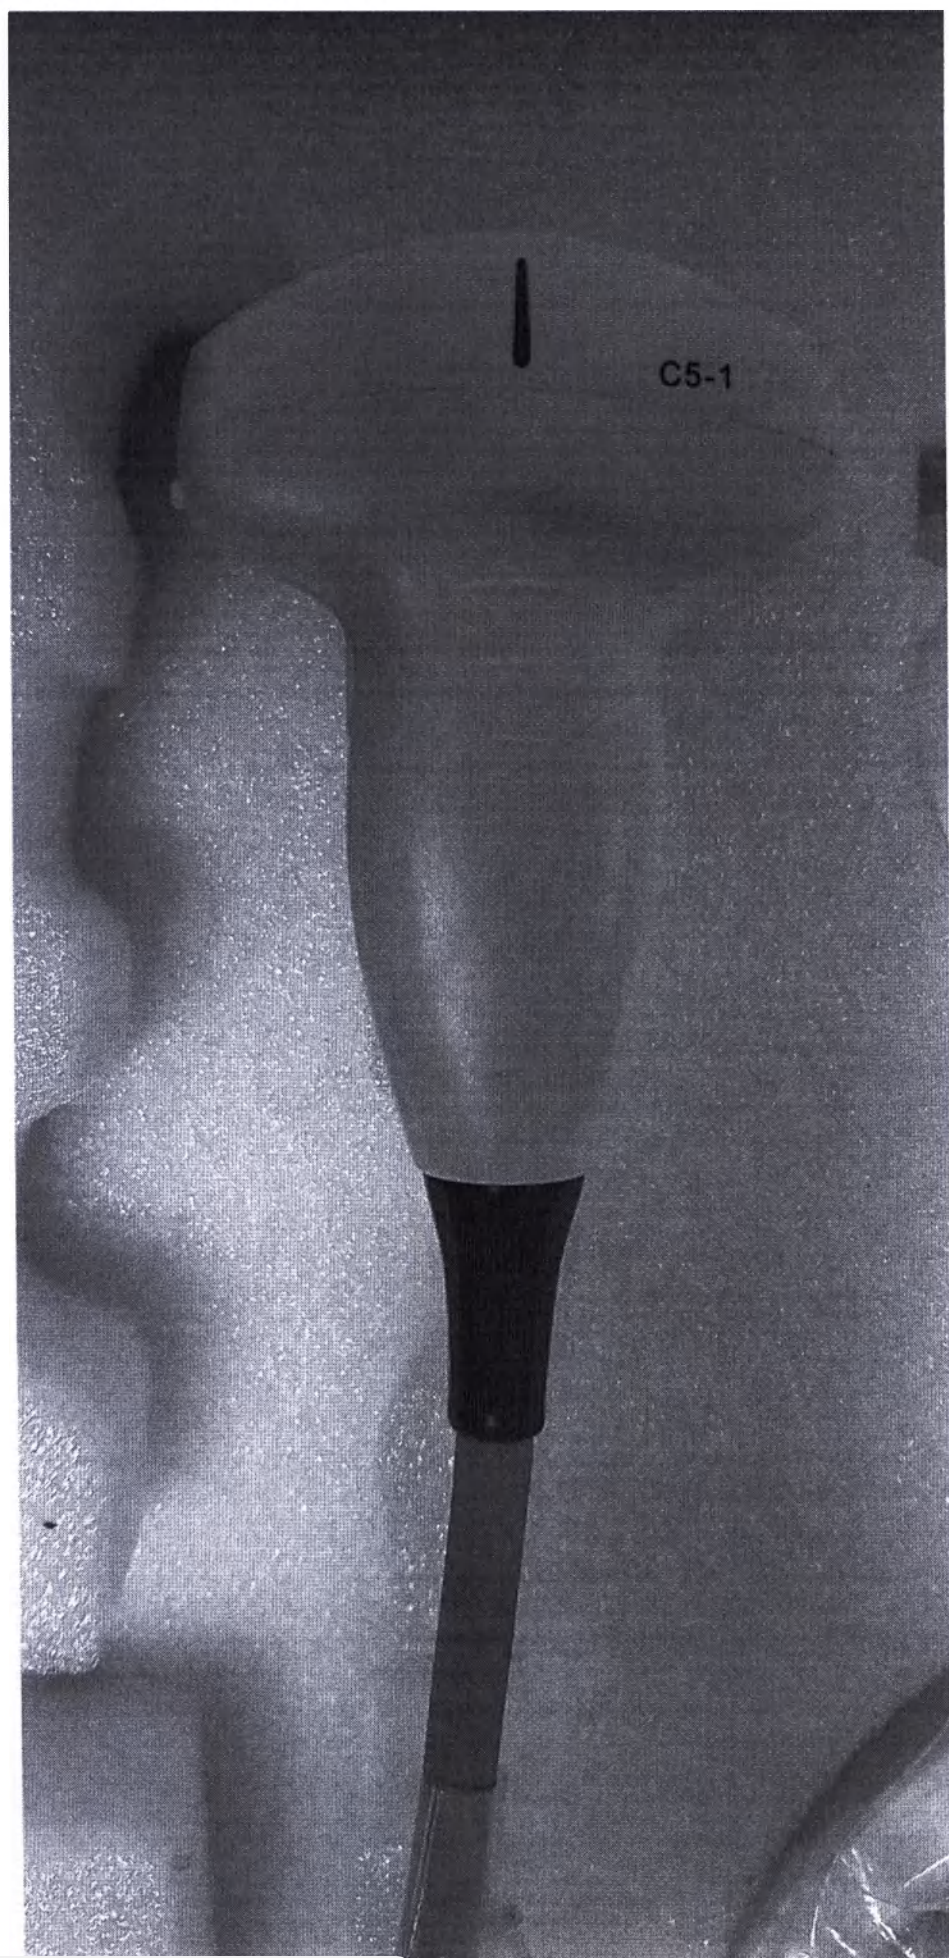

3. Датчик ультразвуковой L15-4.

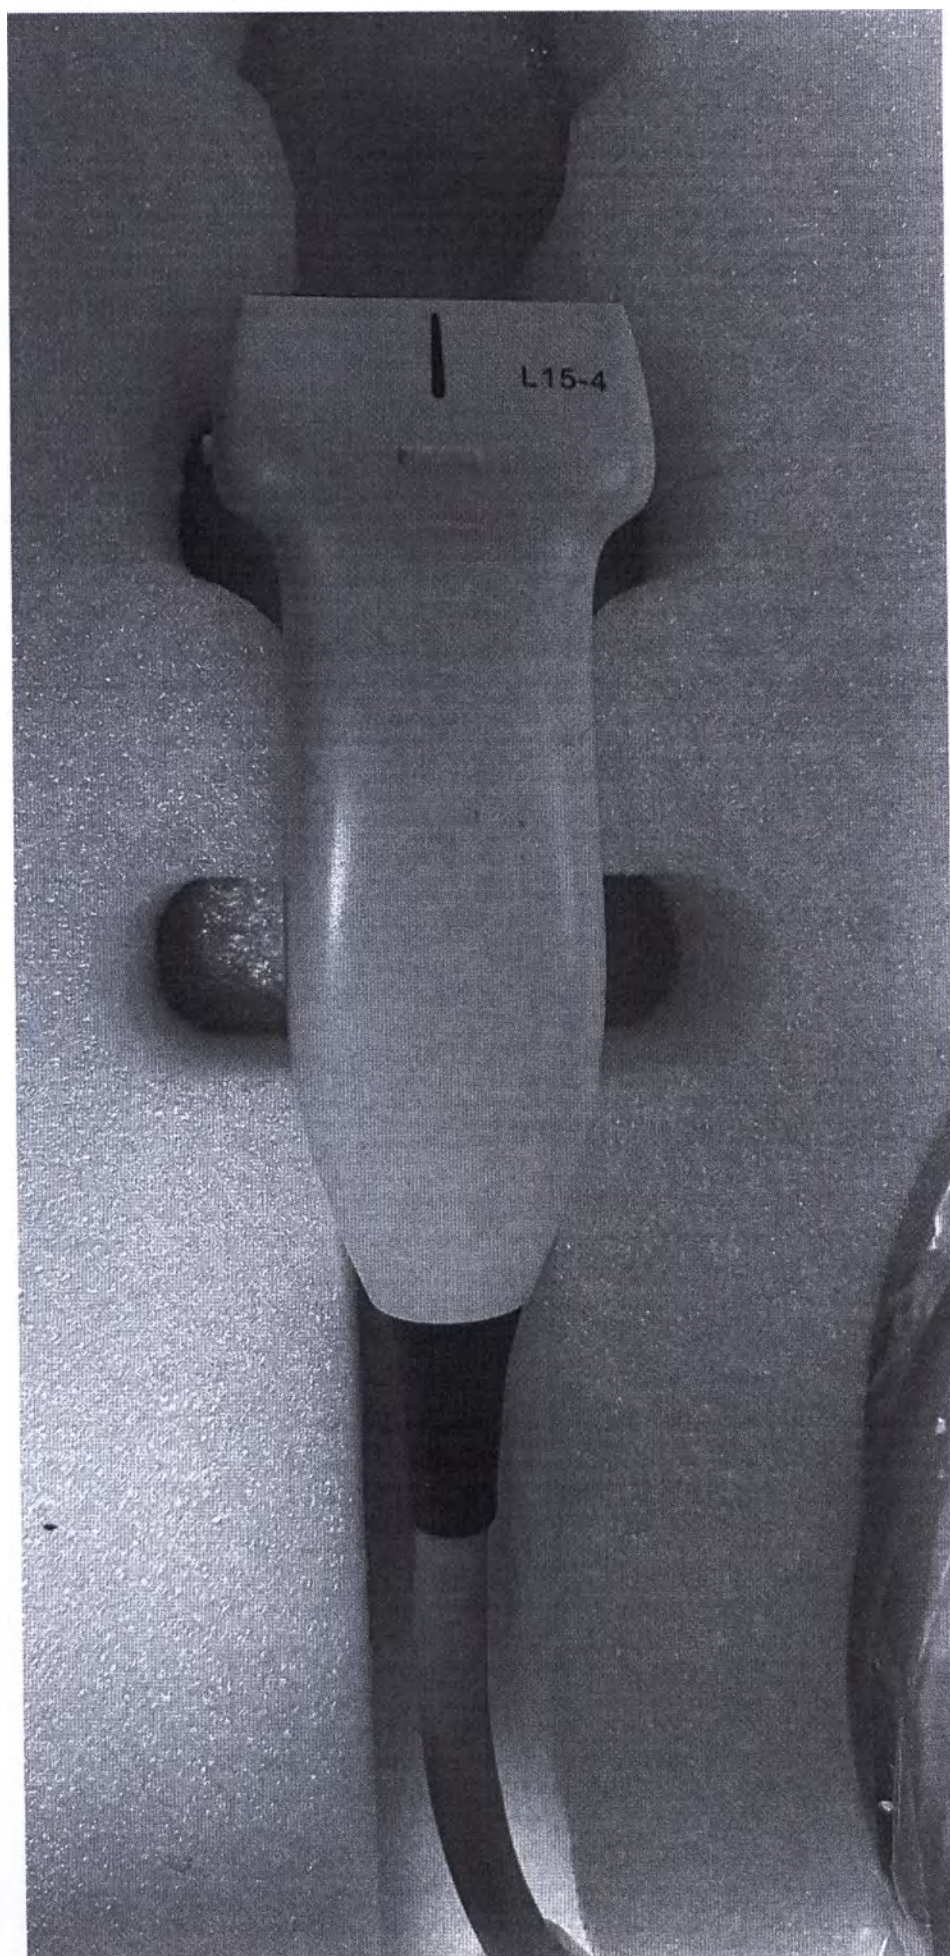

4. Датчик ультразвуковой L12-5.



5. Датчик ультразвуковой LH15-6




6. Датчик ультразвуковой L20-10




7. Датчик ультразвуковой L10-5



8. Датчик ультразвуковой С8-3

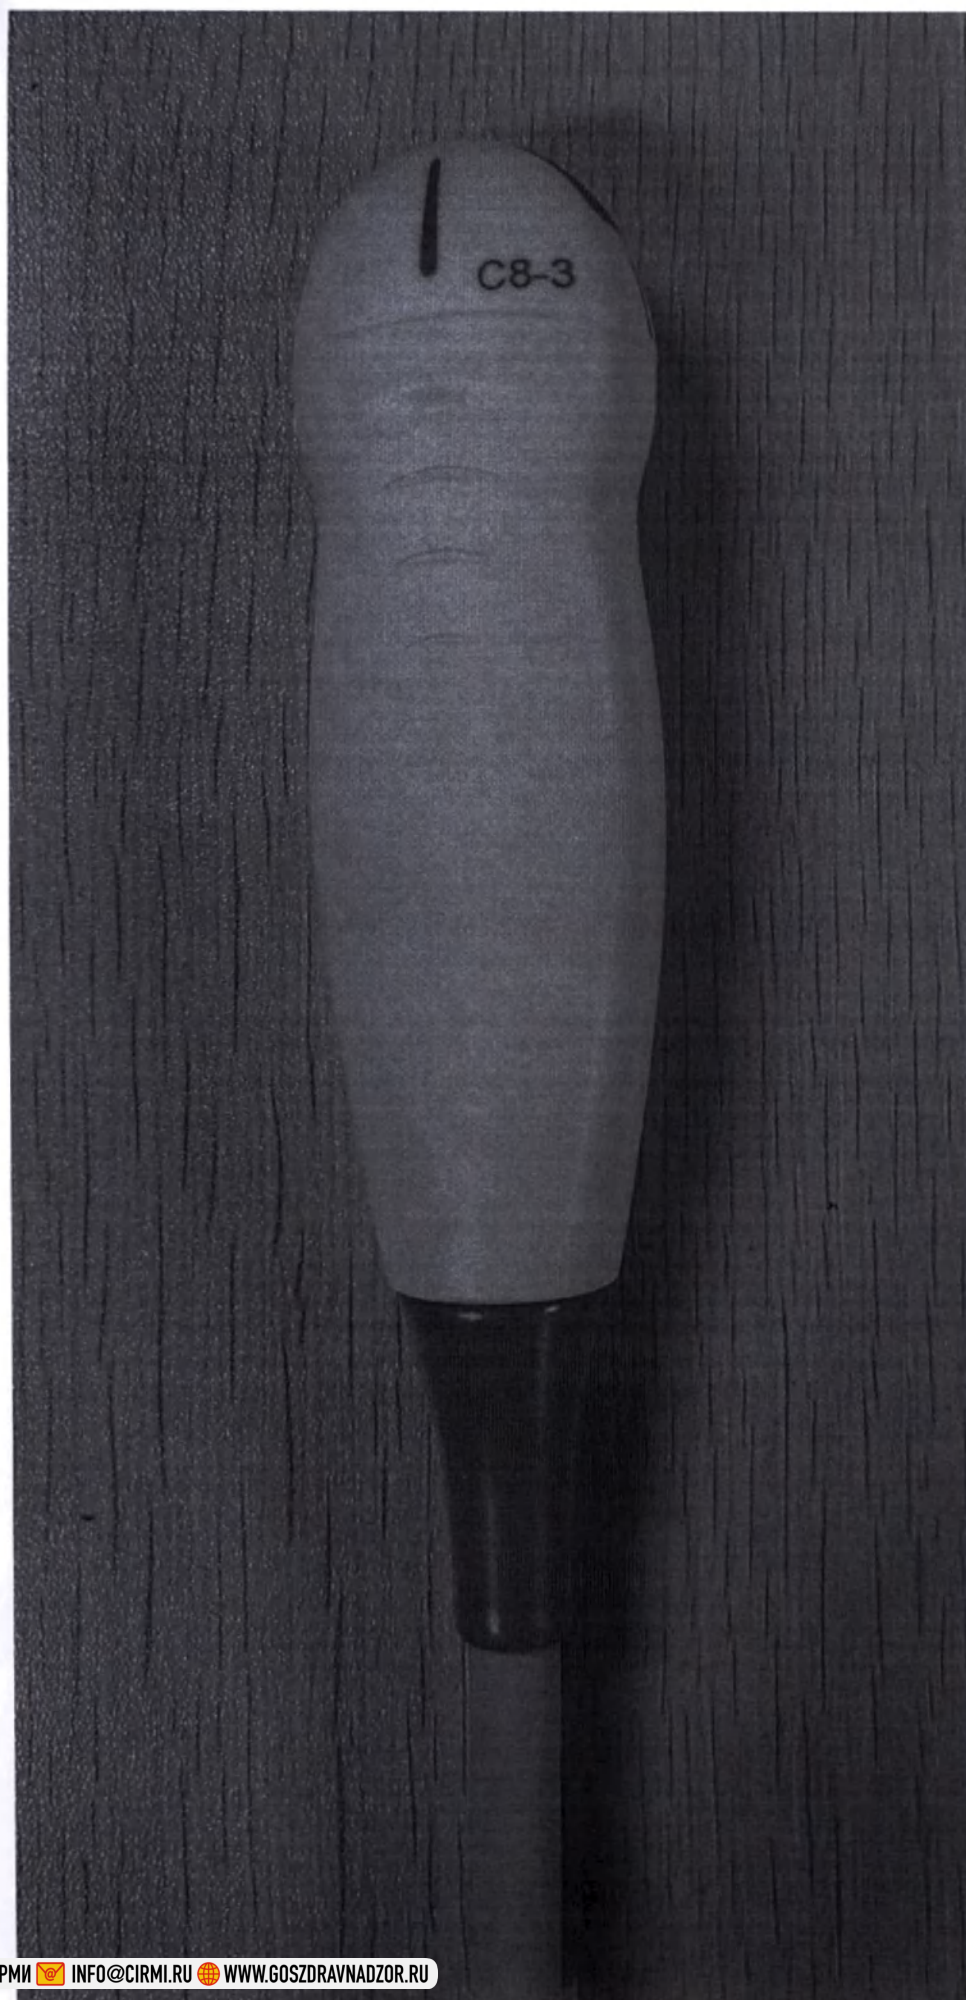


9. Датчик ультразвуковой С7-2

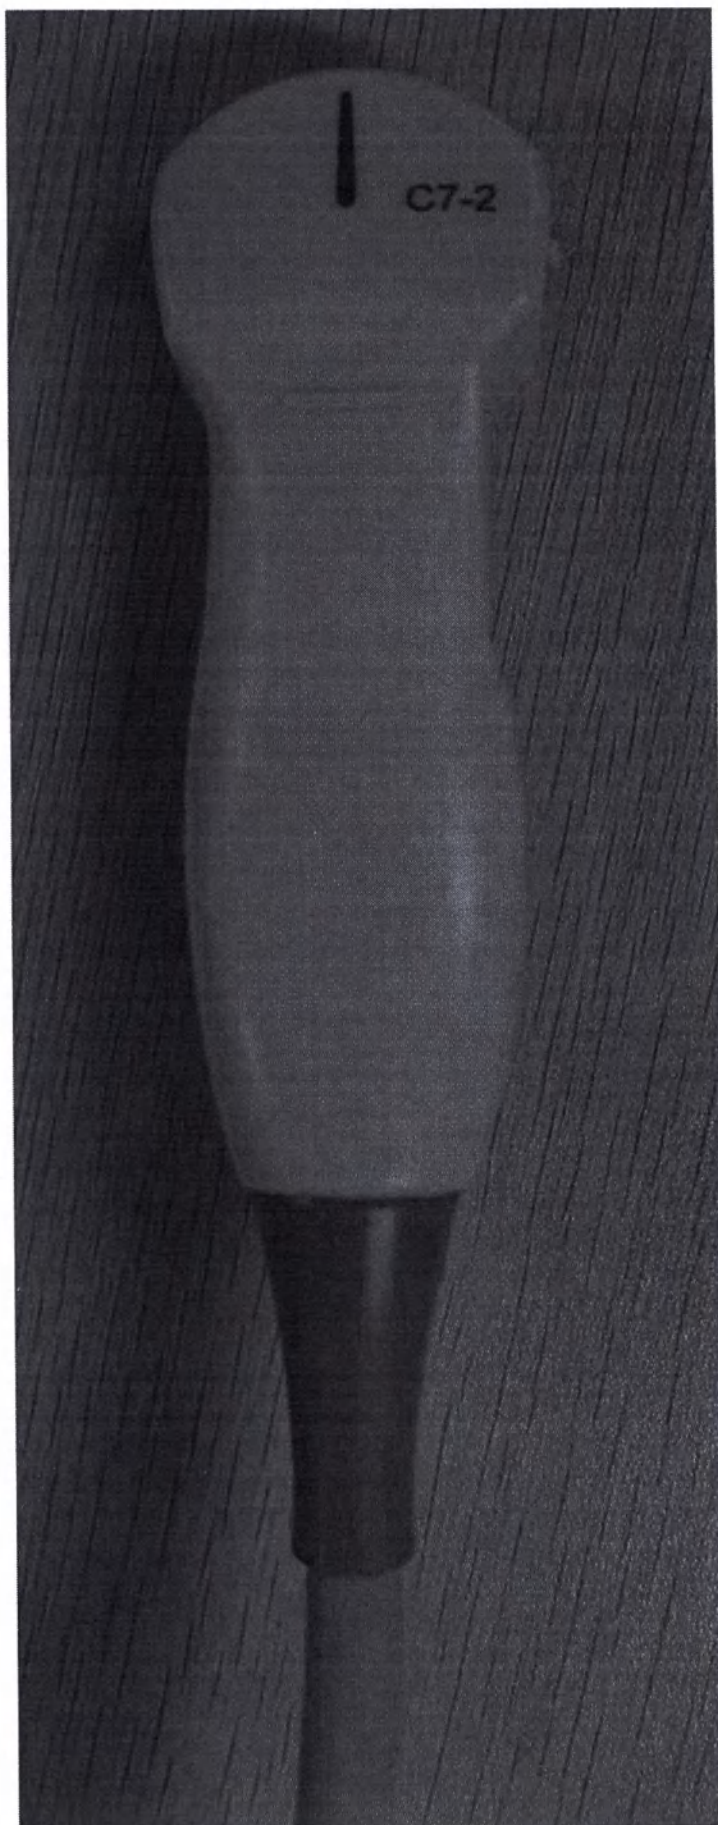

10. Датчик ультразвуковой Р4-1



11. Датчик ультразвуковой Р7-3

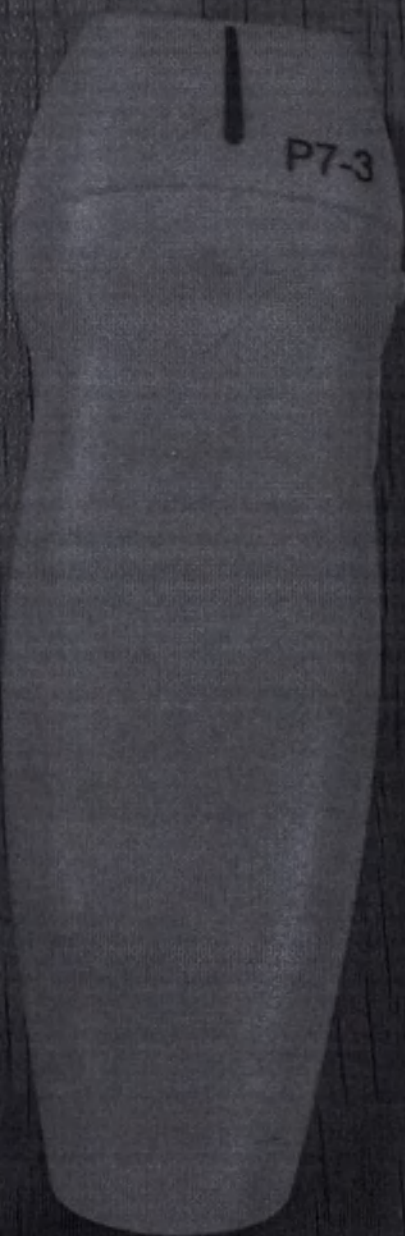

12. Датчик ультразвуковой SP4-1



13. Датчик ультразвуковой EV10-4




14. Датчик ультразвуковой D7-2



15. Тележка




16. Модуль ЭКГ

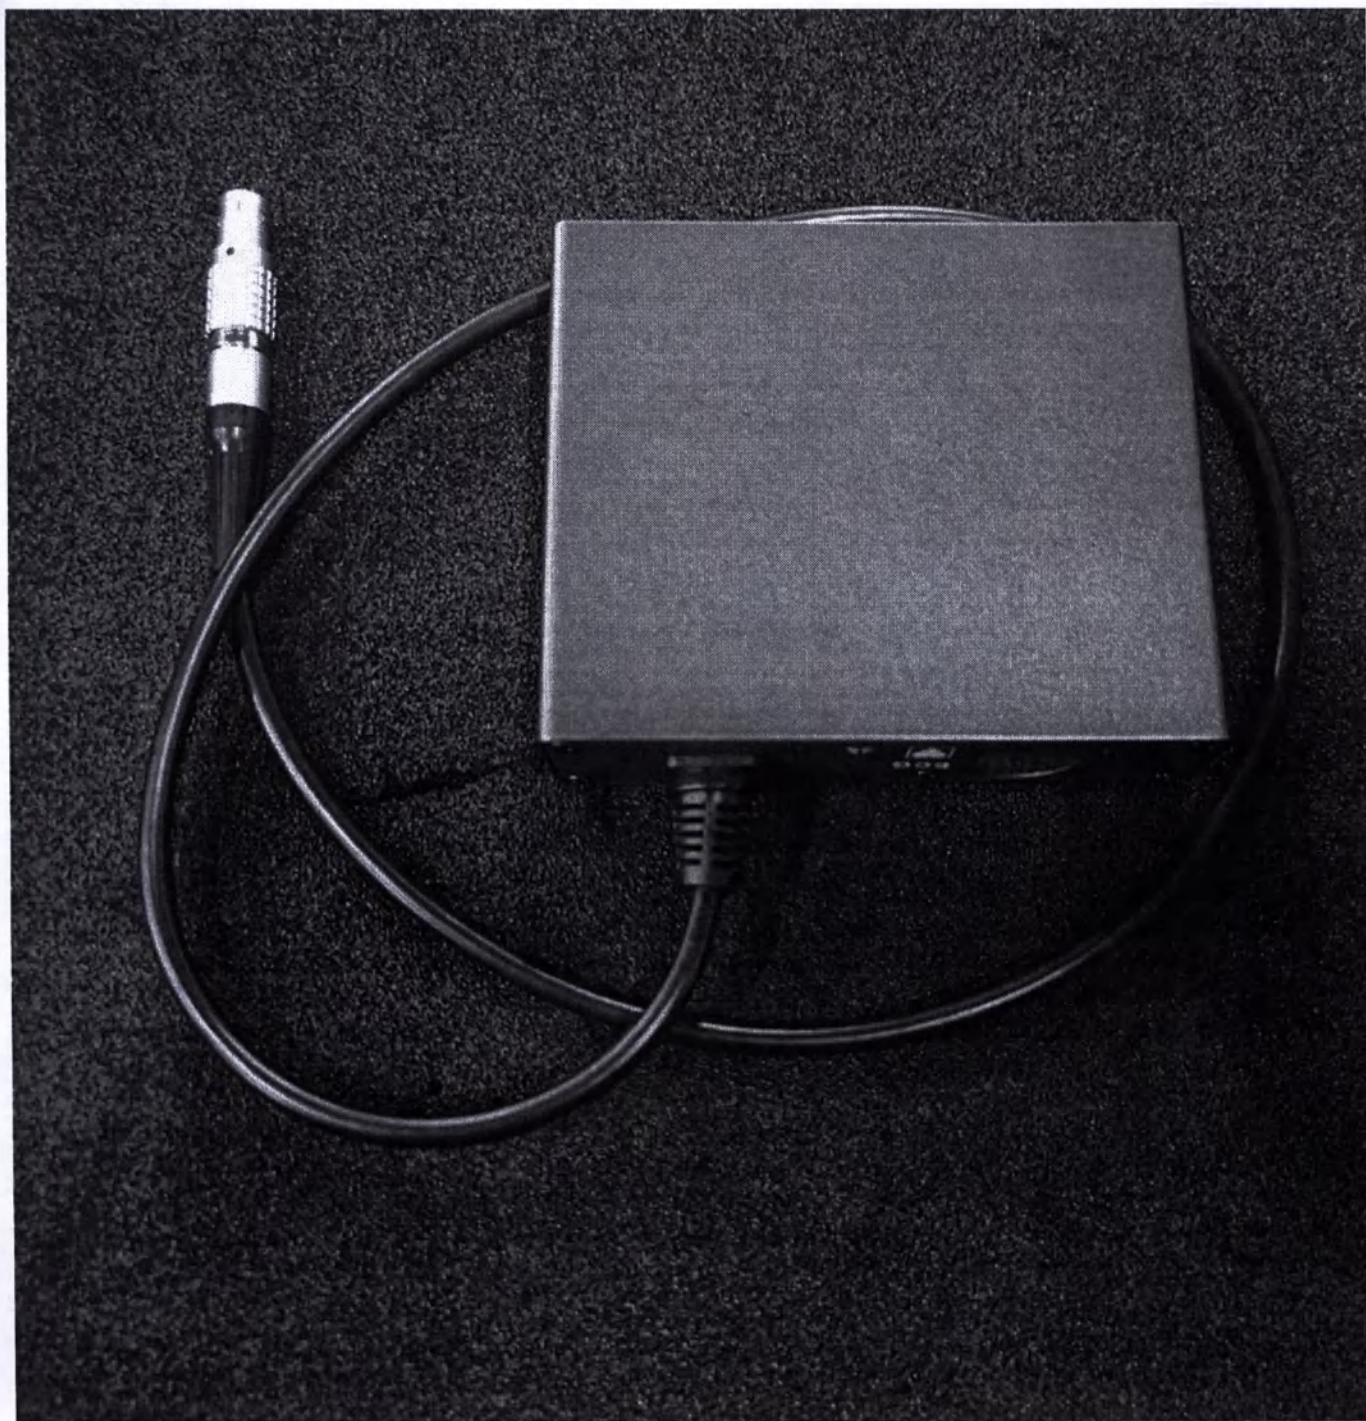

17. Кабель ЭКГ




18. Переключатель ножной

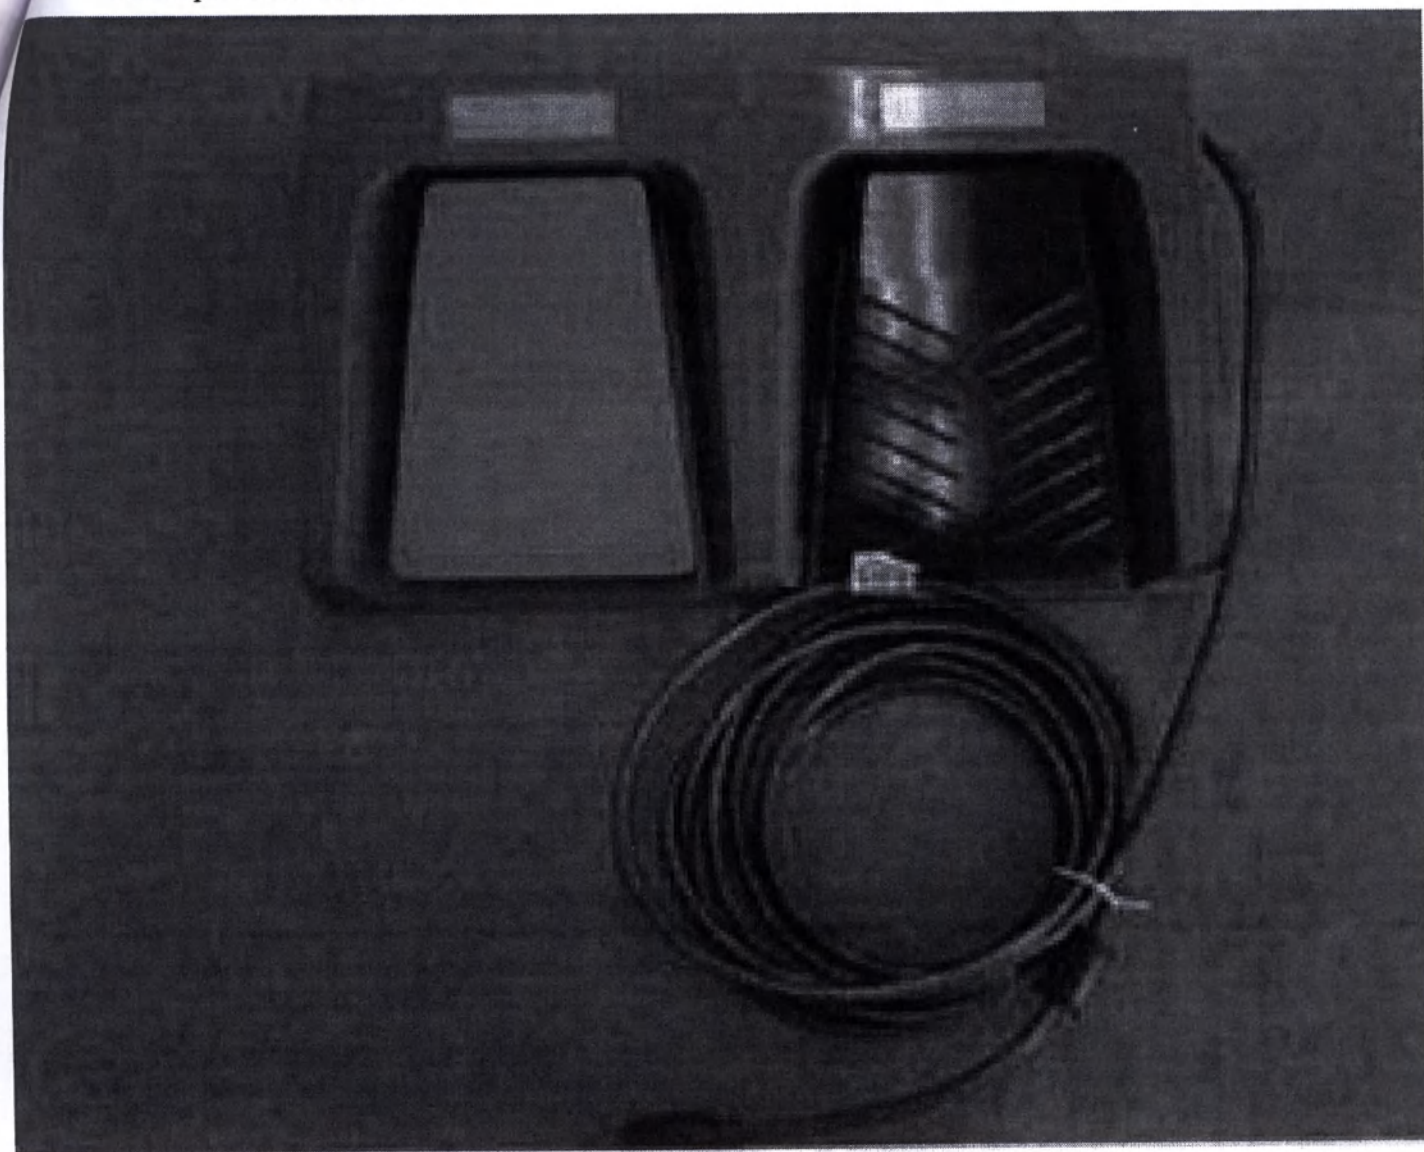


19. Батарея



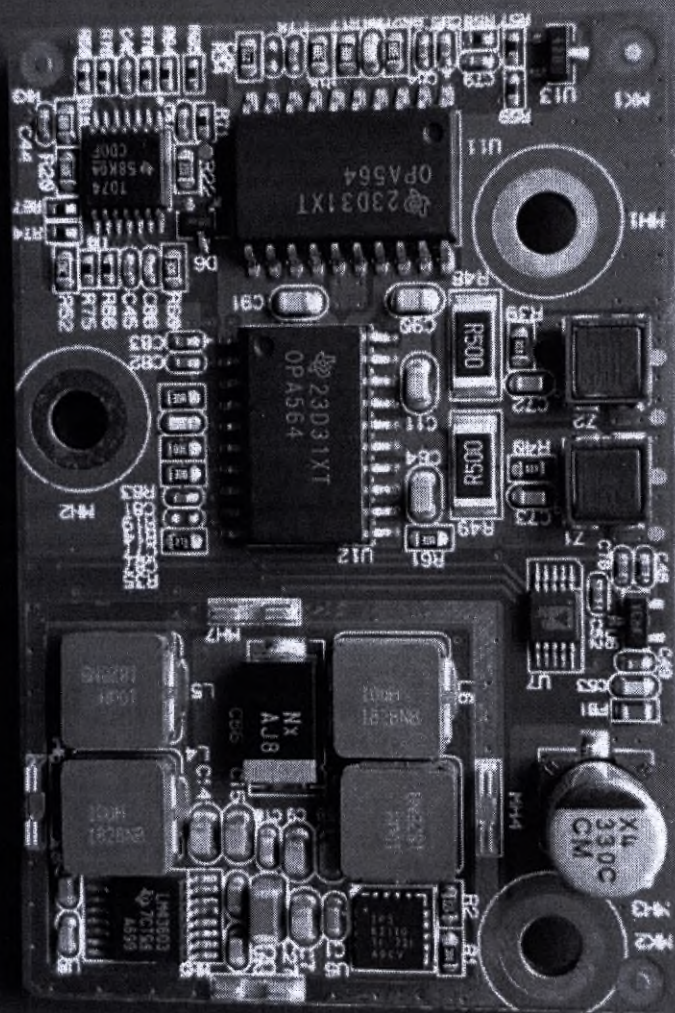

21. Адаптер

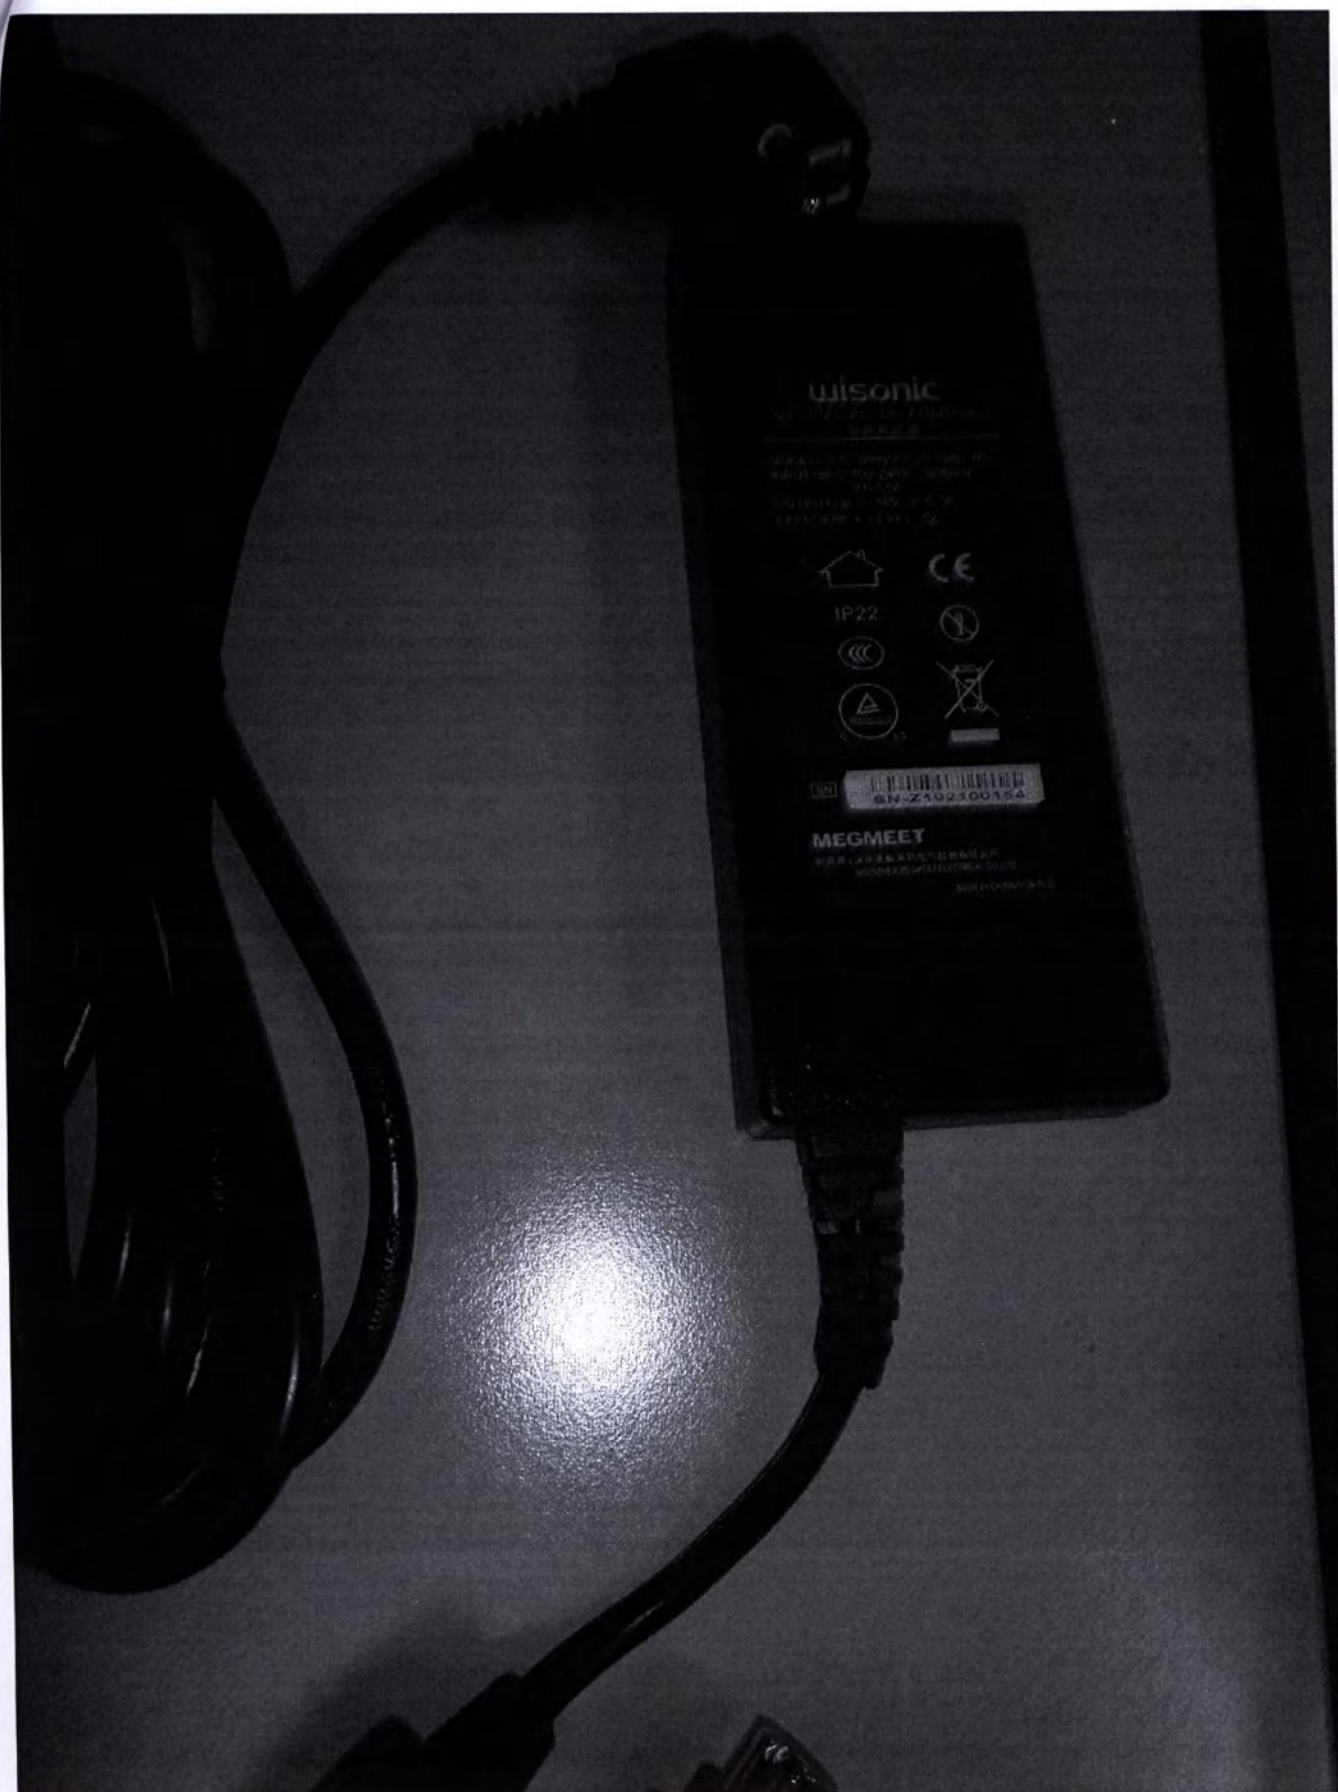

22. Насадка биопсийная для L10-5




23. Насадка биопсийная для L15-4



24. Насадка биопсийная для Р4-1



25. Насадка биопсийная для С5-1

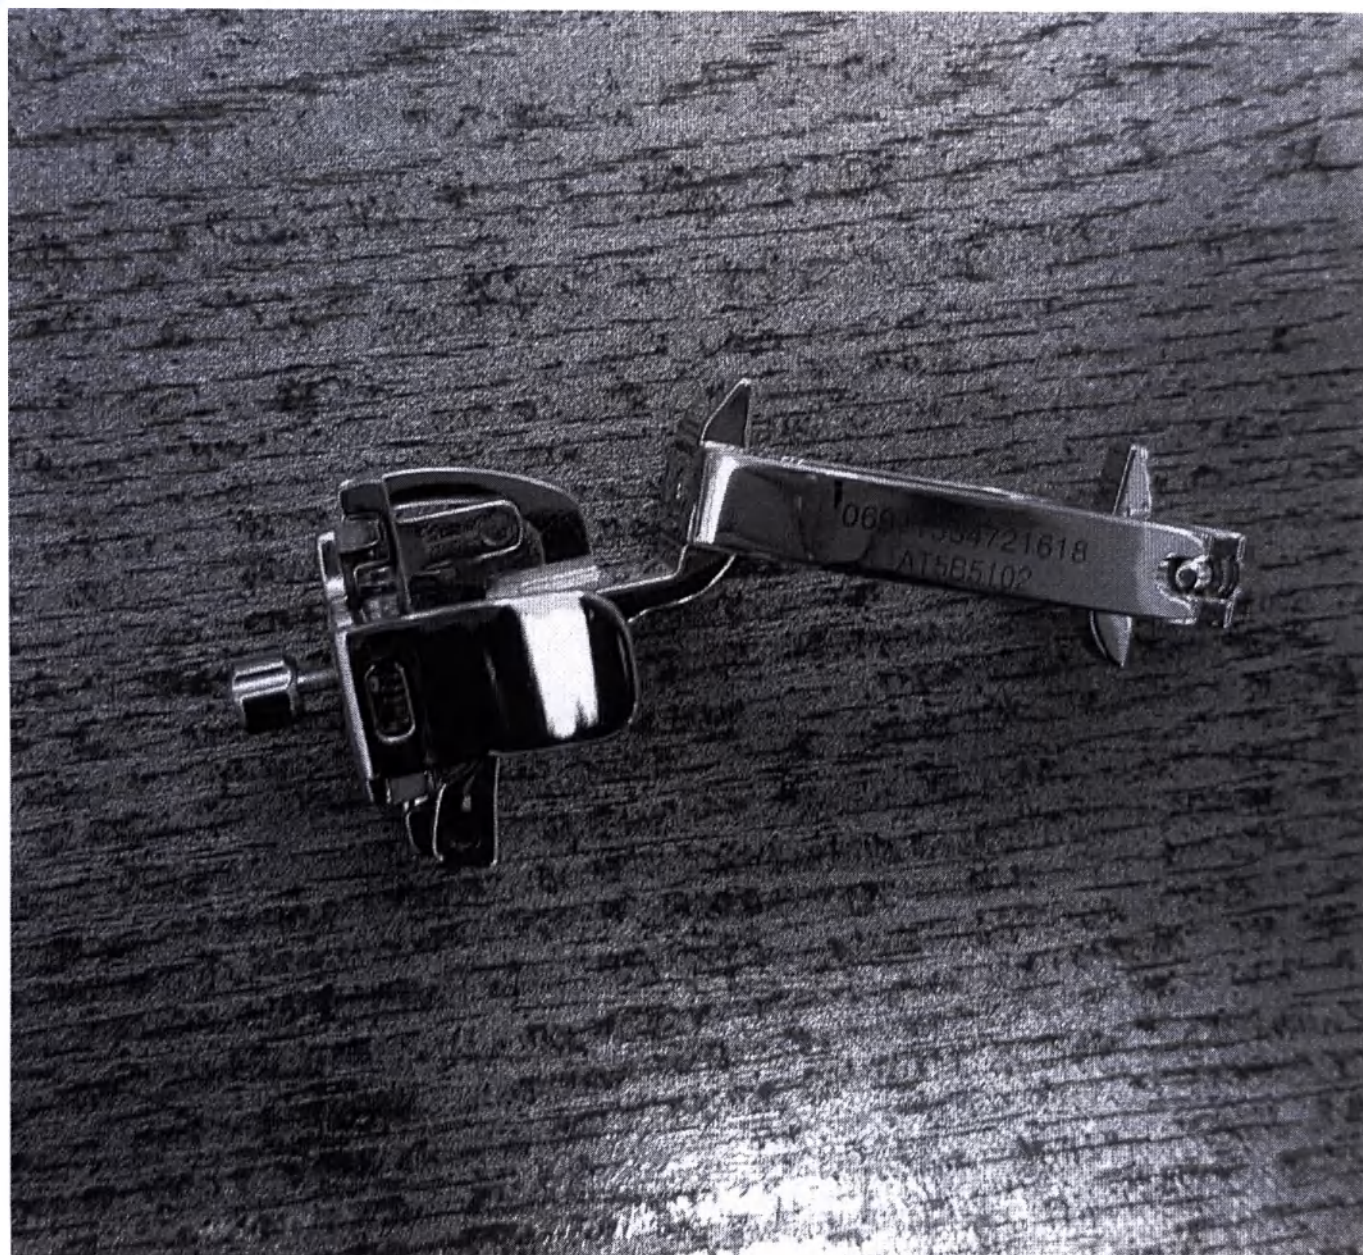

26. Насадка биопсийная для EV10-4



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

