

**Фотографические изображения медицинского изделия:
«Концентратор кислорода медицинский «Armed»,
производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай**

- I. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU360, в составе (см. Приложение).**
- II. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU500, в составе (см. Приложение).**
- III. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU560, в составе (см. Приложение).**
- IV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 9F-3C, в составе (см. Приложение).**
- V. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 9F-3CW, в составе (см. Приложение).**
- VI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 8F-3Z, в составе (см. Приложение).**
- VII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 8F-3ZW, в составе (см. Приложение).**
- VIII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3N, в составе (см. Приложение).**
- IX. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3NW, в составе (см. Приложение).**
- X. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3W (5L), в составе (см. Приложение).**
- XI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5B, в составе (см. Приложение).**
- XII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5BW, в составе (см. Приложение).**
- XIII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5C, в составе (см. Приложение).**
- XIV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5CW, в составе (см. Приложение).**
- XV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5E, в составе (см. Приложение).**
- XVI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5EW, в составе (см. Приложение).**
- XVII. Макеты этикеток (см. Приложение).**
- XVIII. Макет шильда (см. Приложение).**
- XIX. Макет упаковки (см. Приложение).**

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)



(Р.С. Жуков)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОПОРА» (ООО «ОПОРА»)
(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU360, в составе:

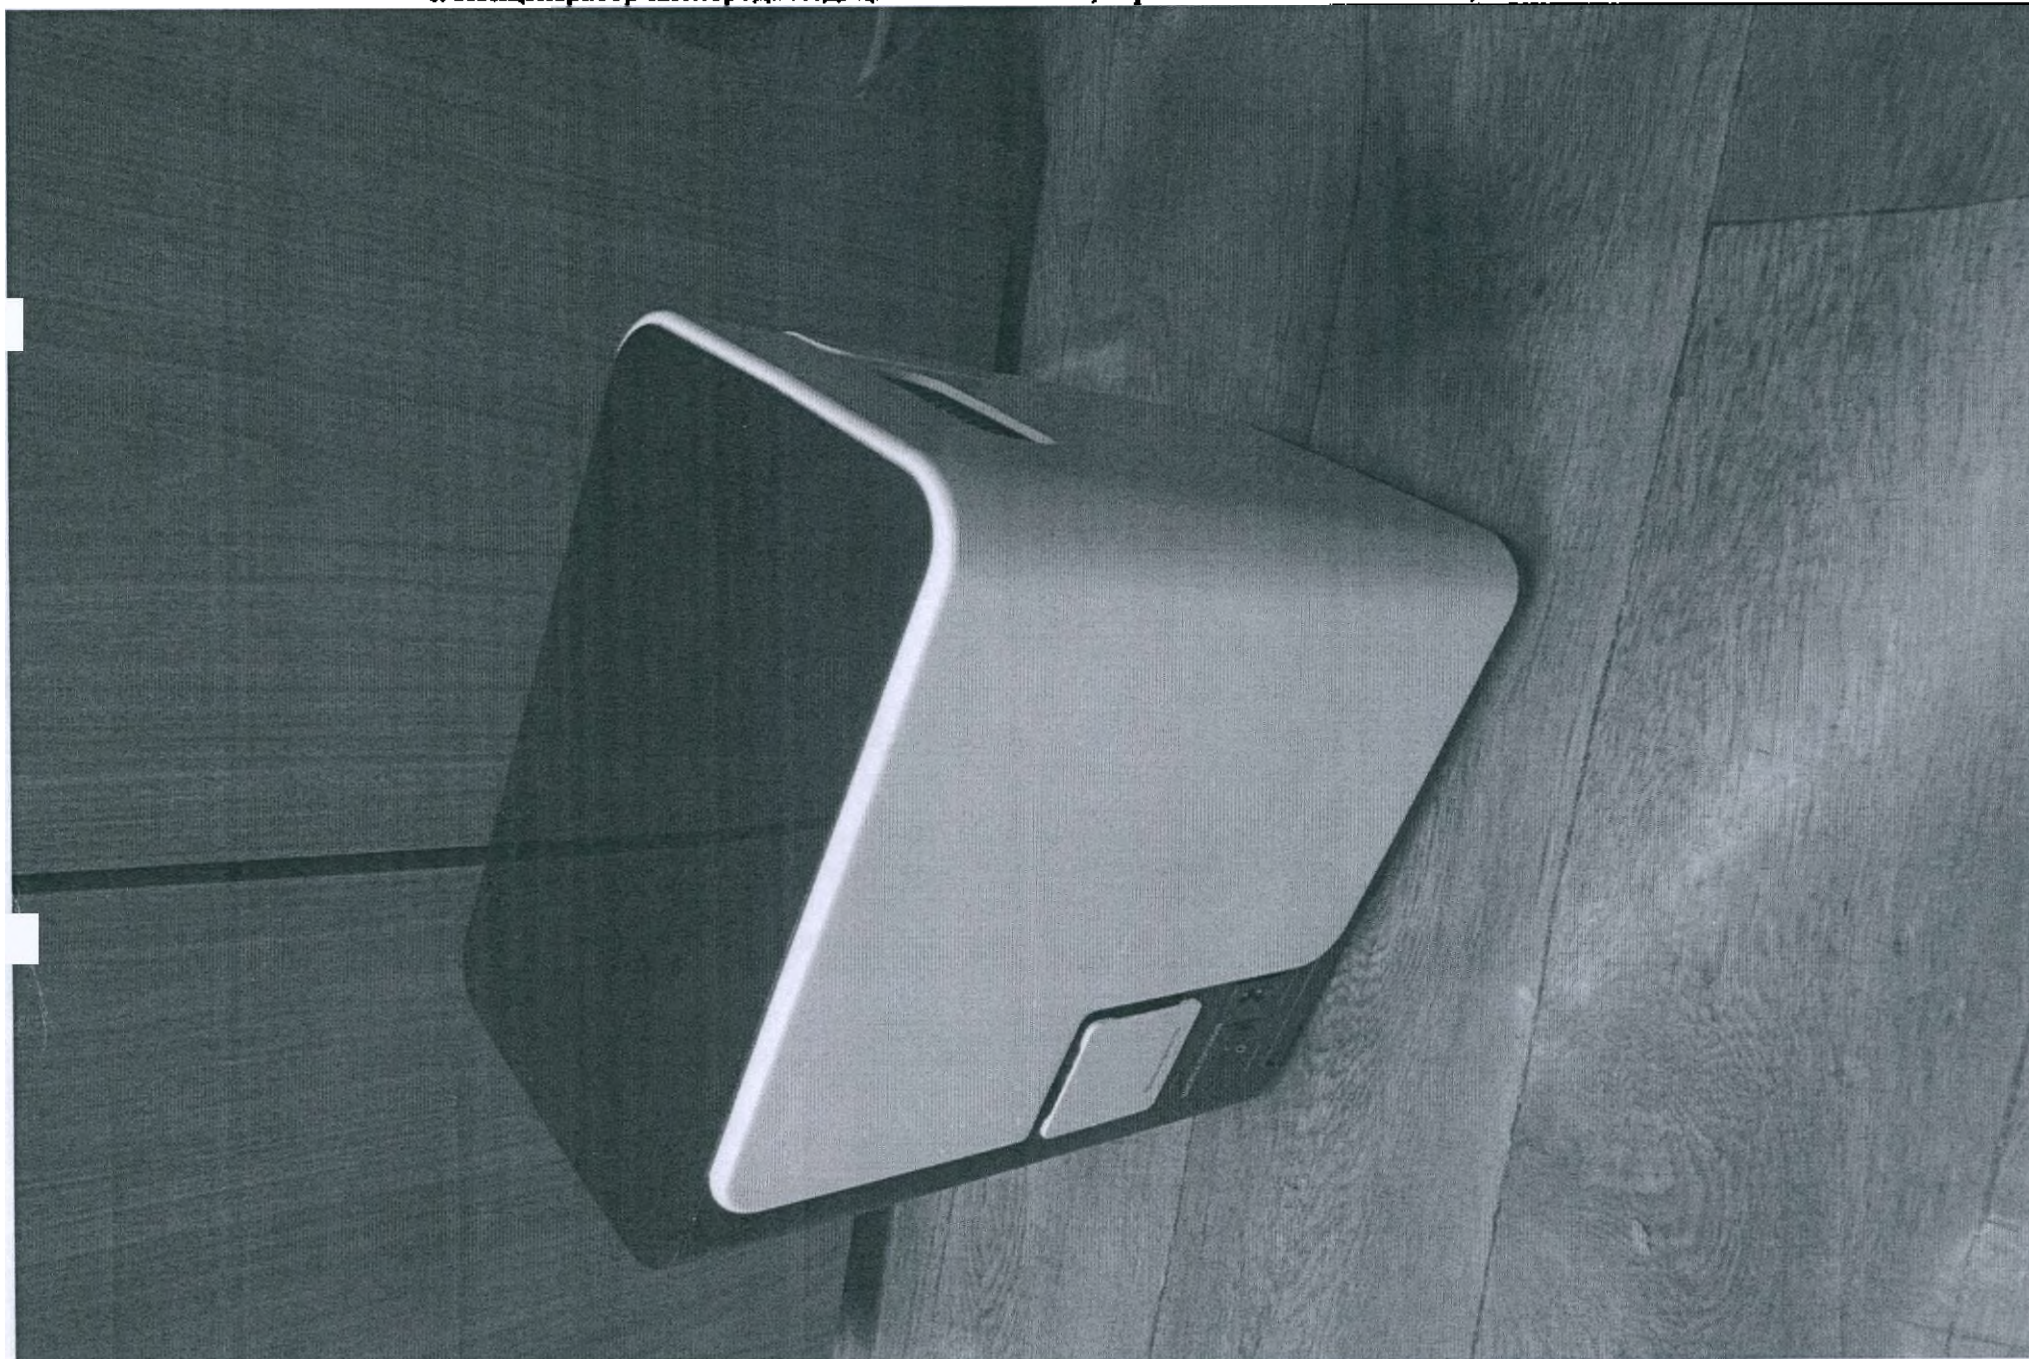


Рис. 1 – Концентратор кислорода

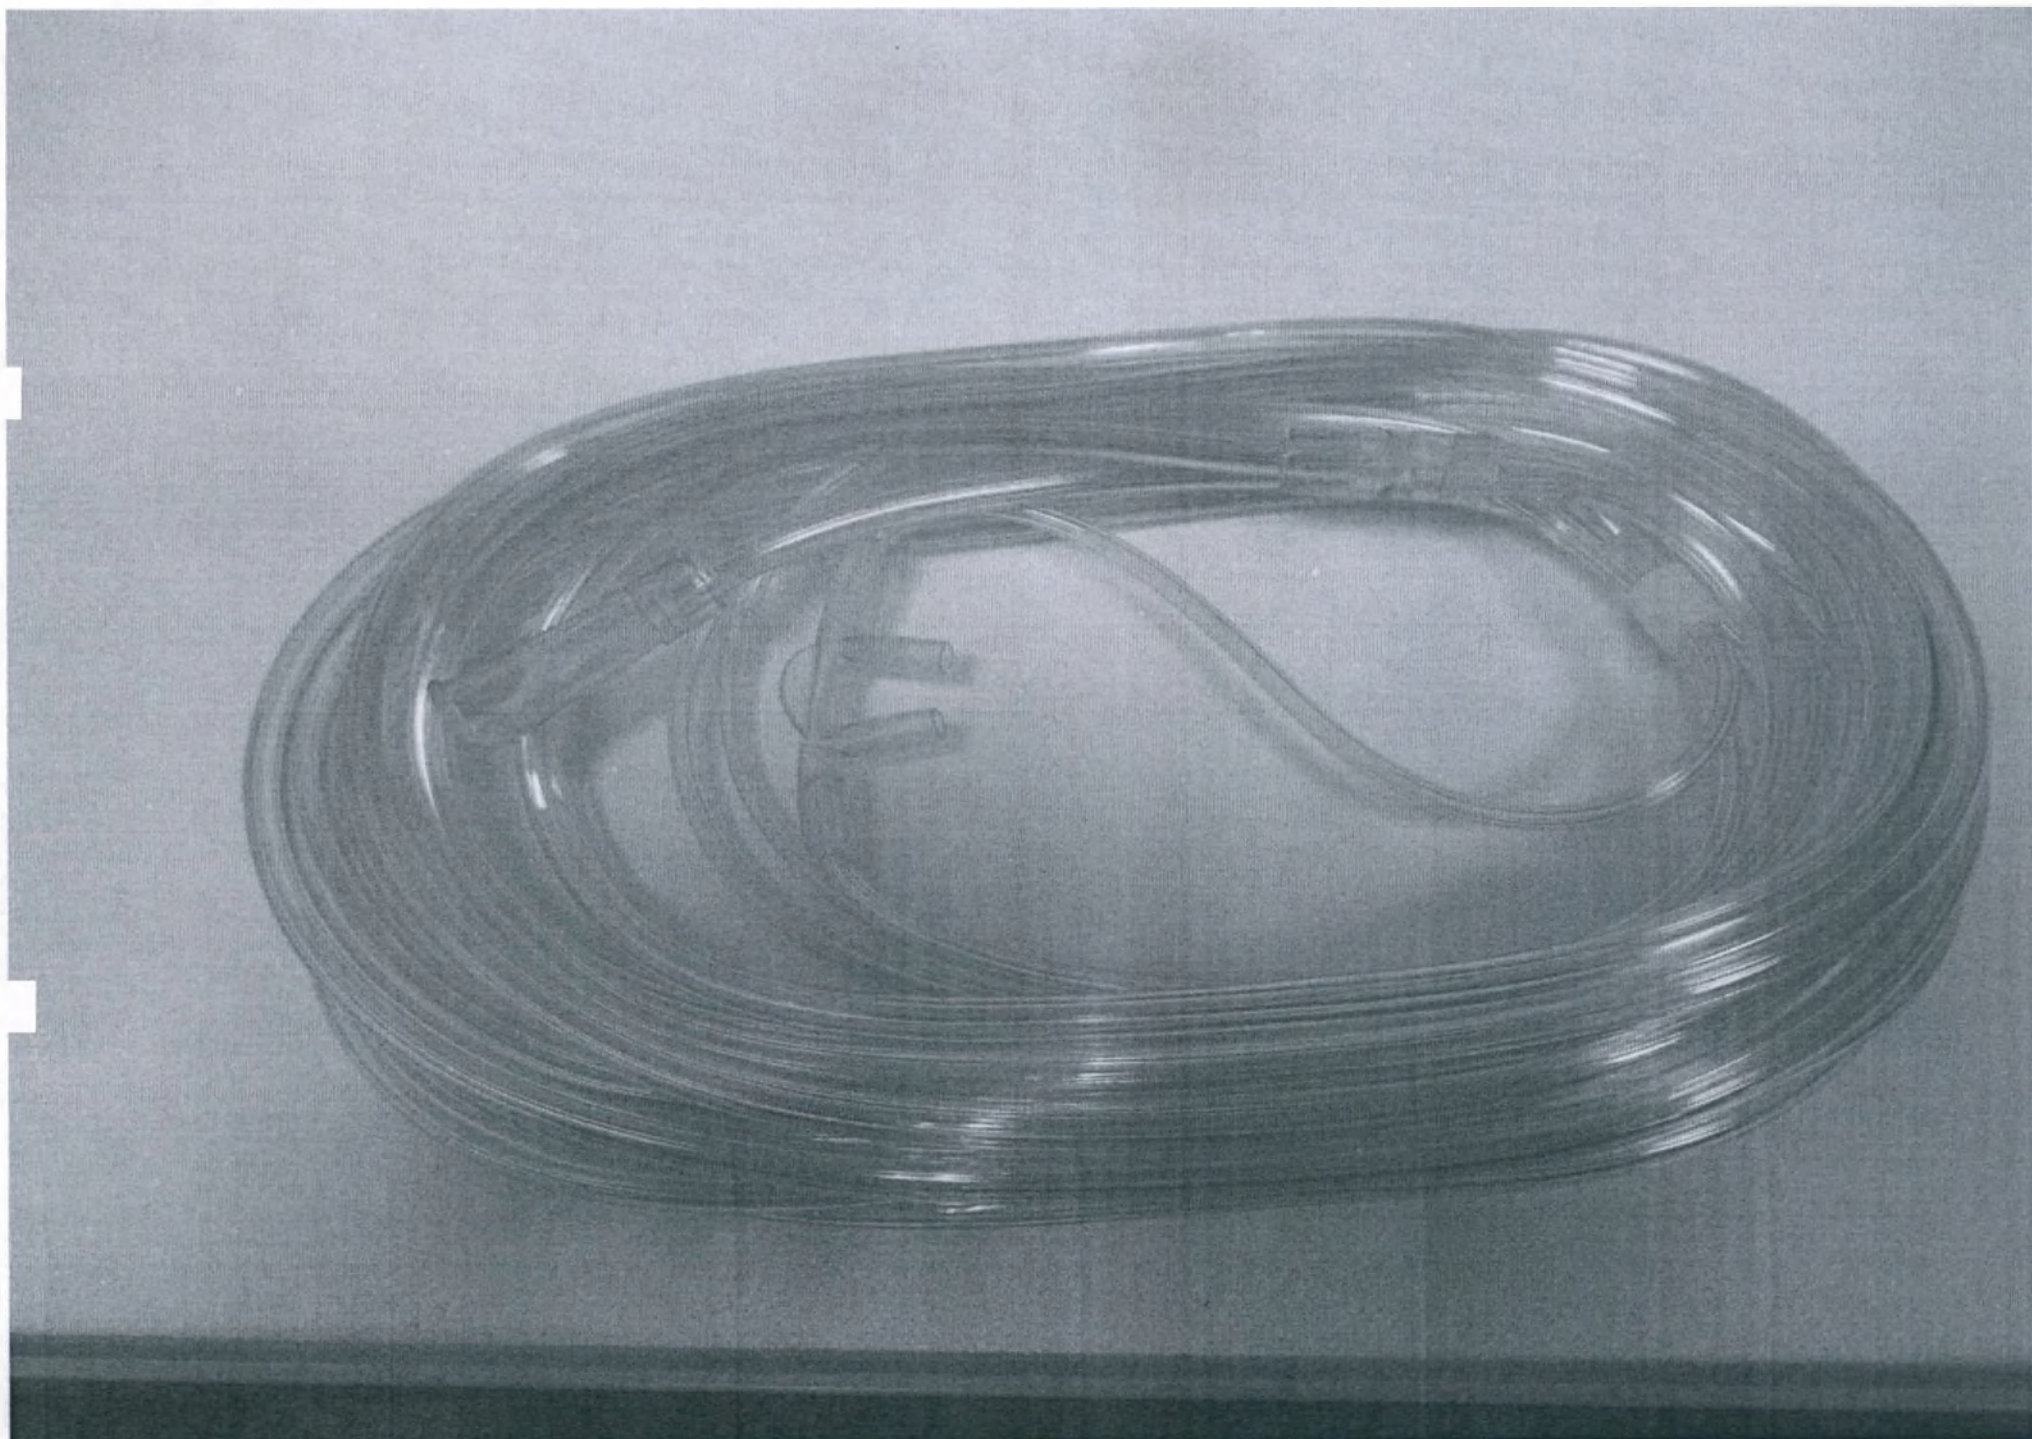


Рис. 2 – Канюля назальная большая

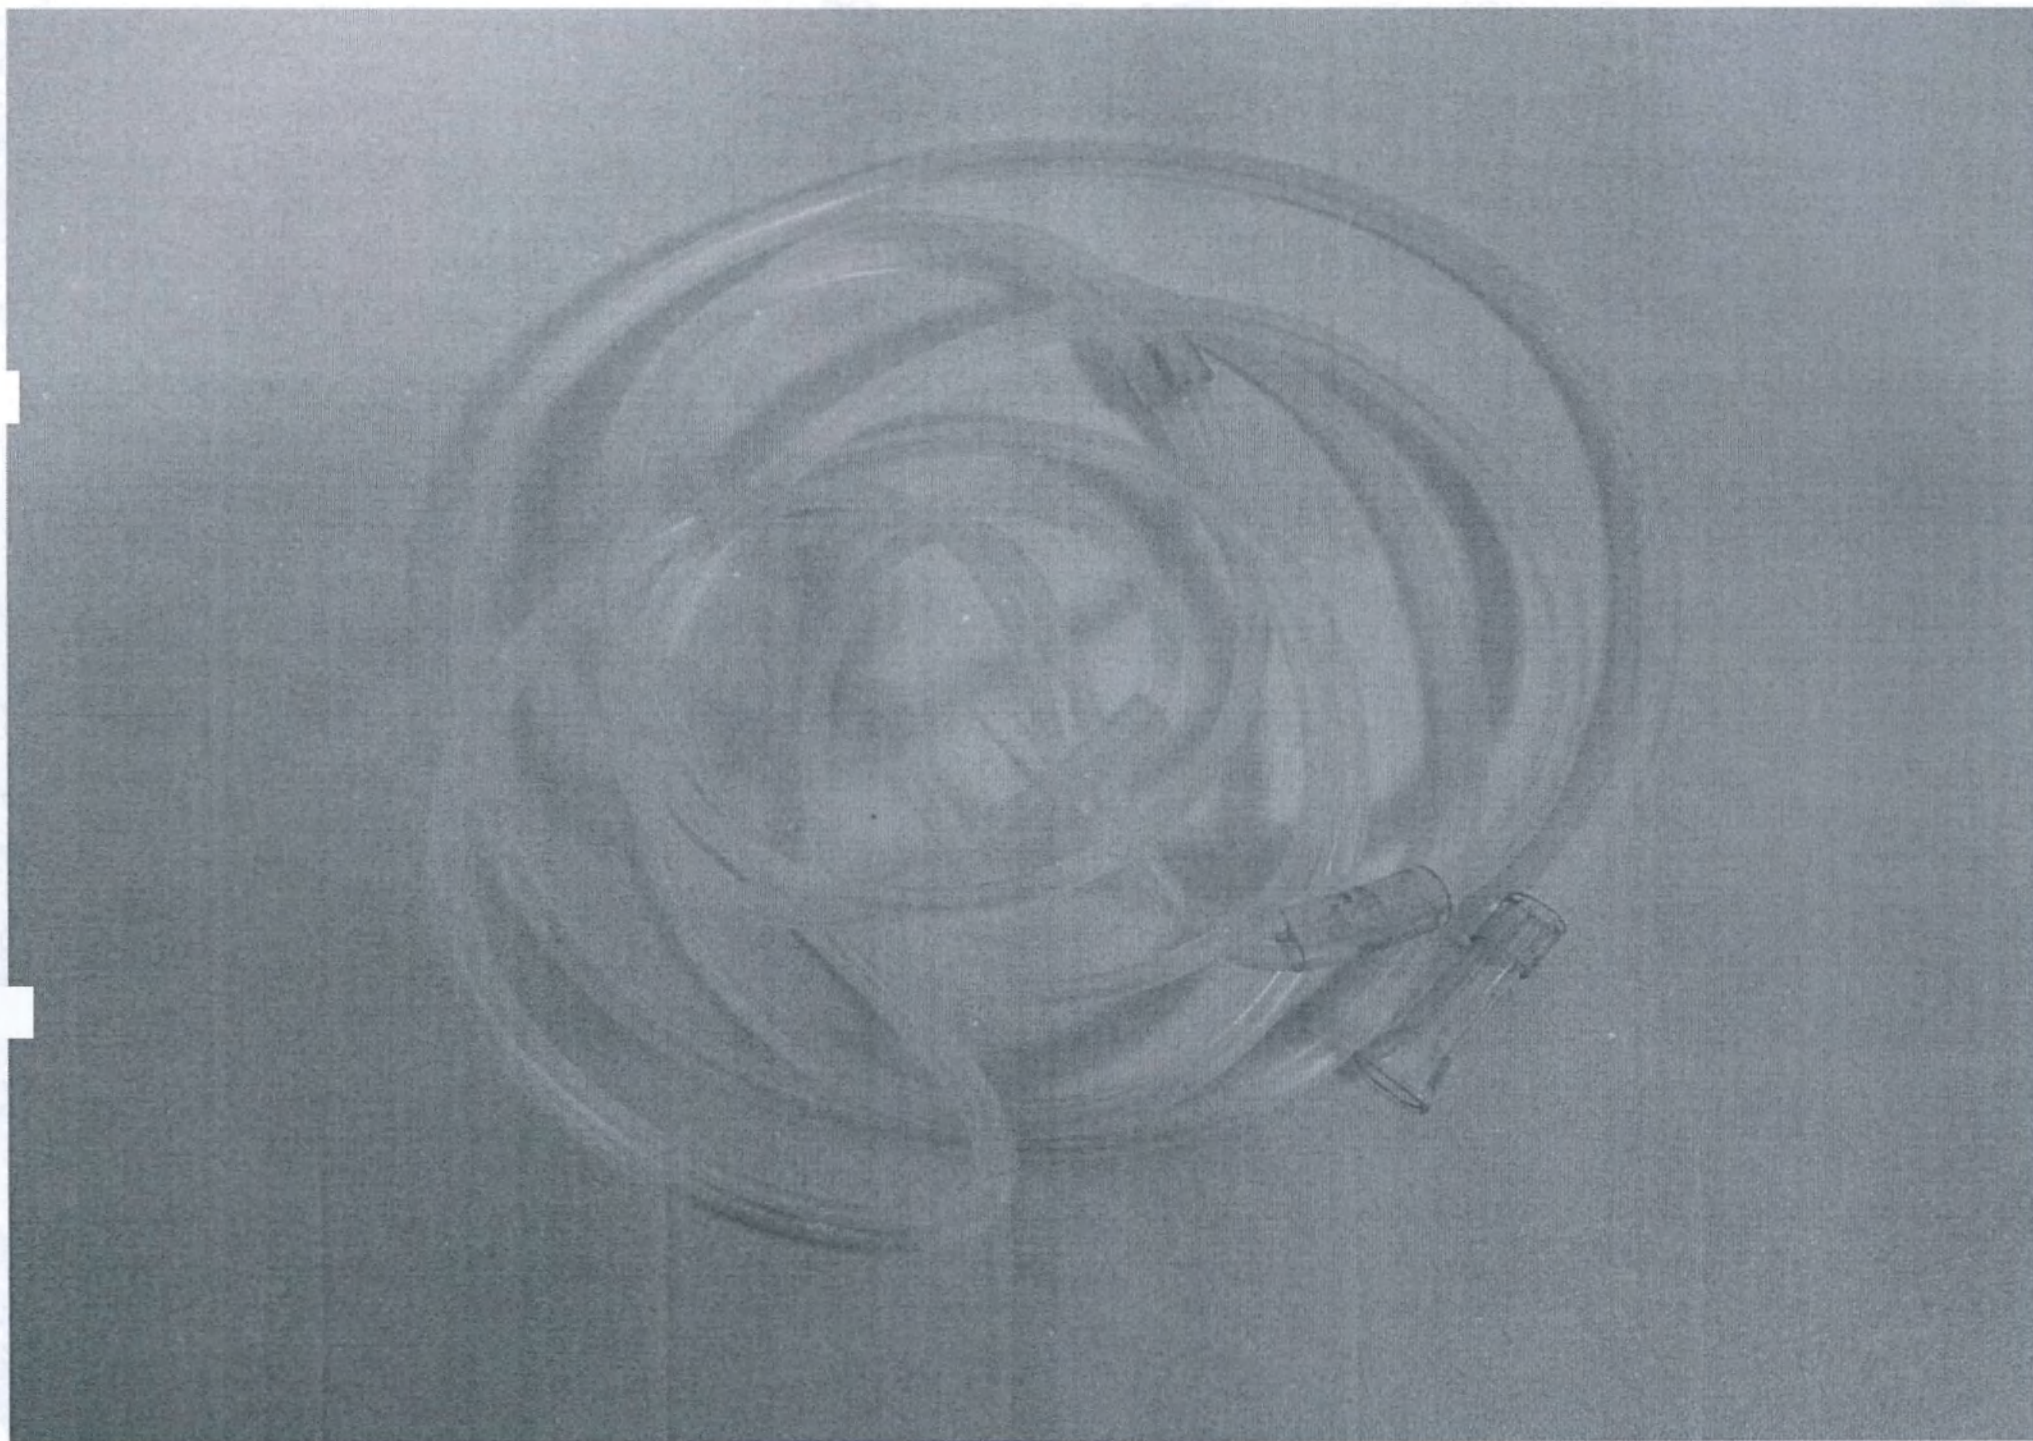


Рис. 3 – Канюля назальная малая



Рис. 4 – Диффузор (2 шт.)

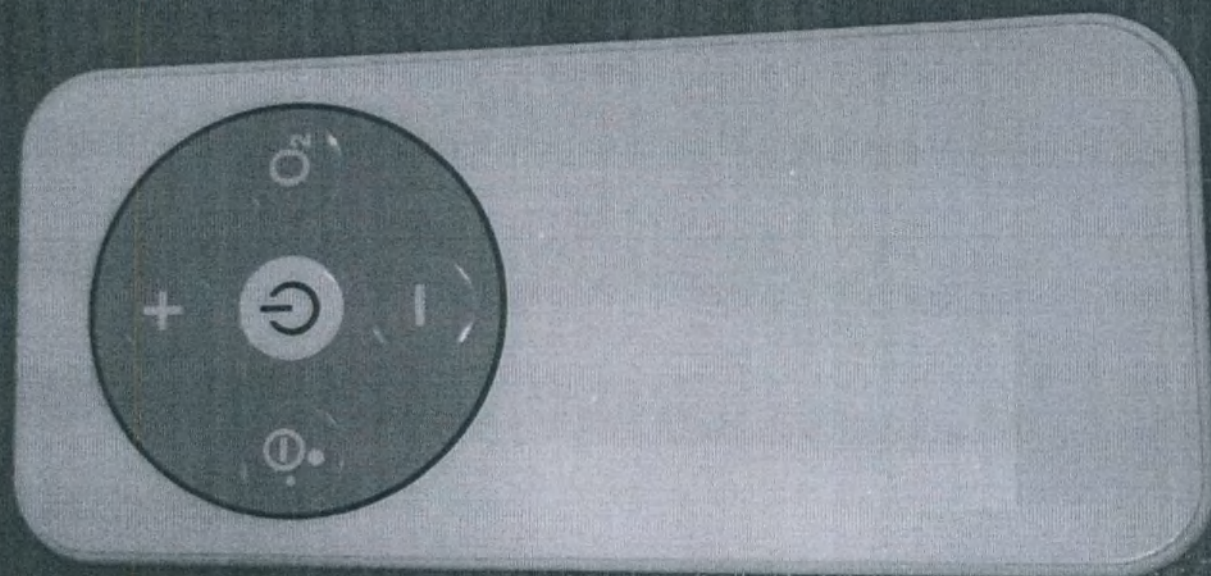


Рис. 5 – Пульт ДУ

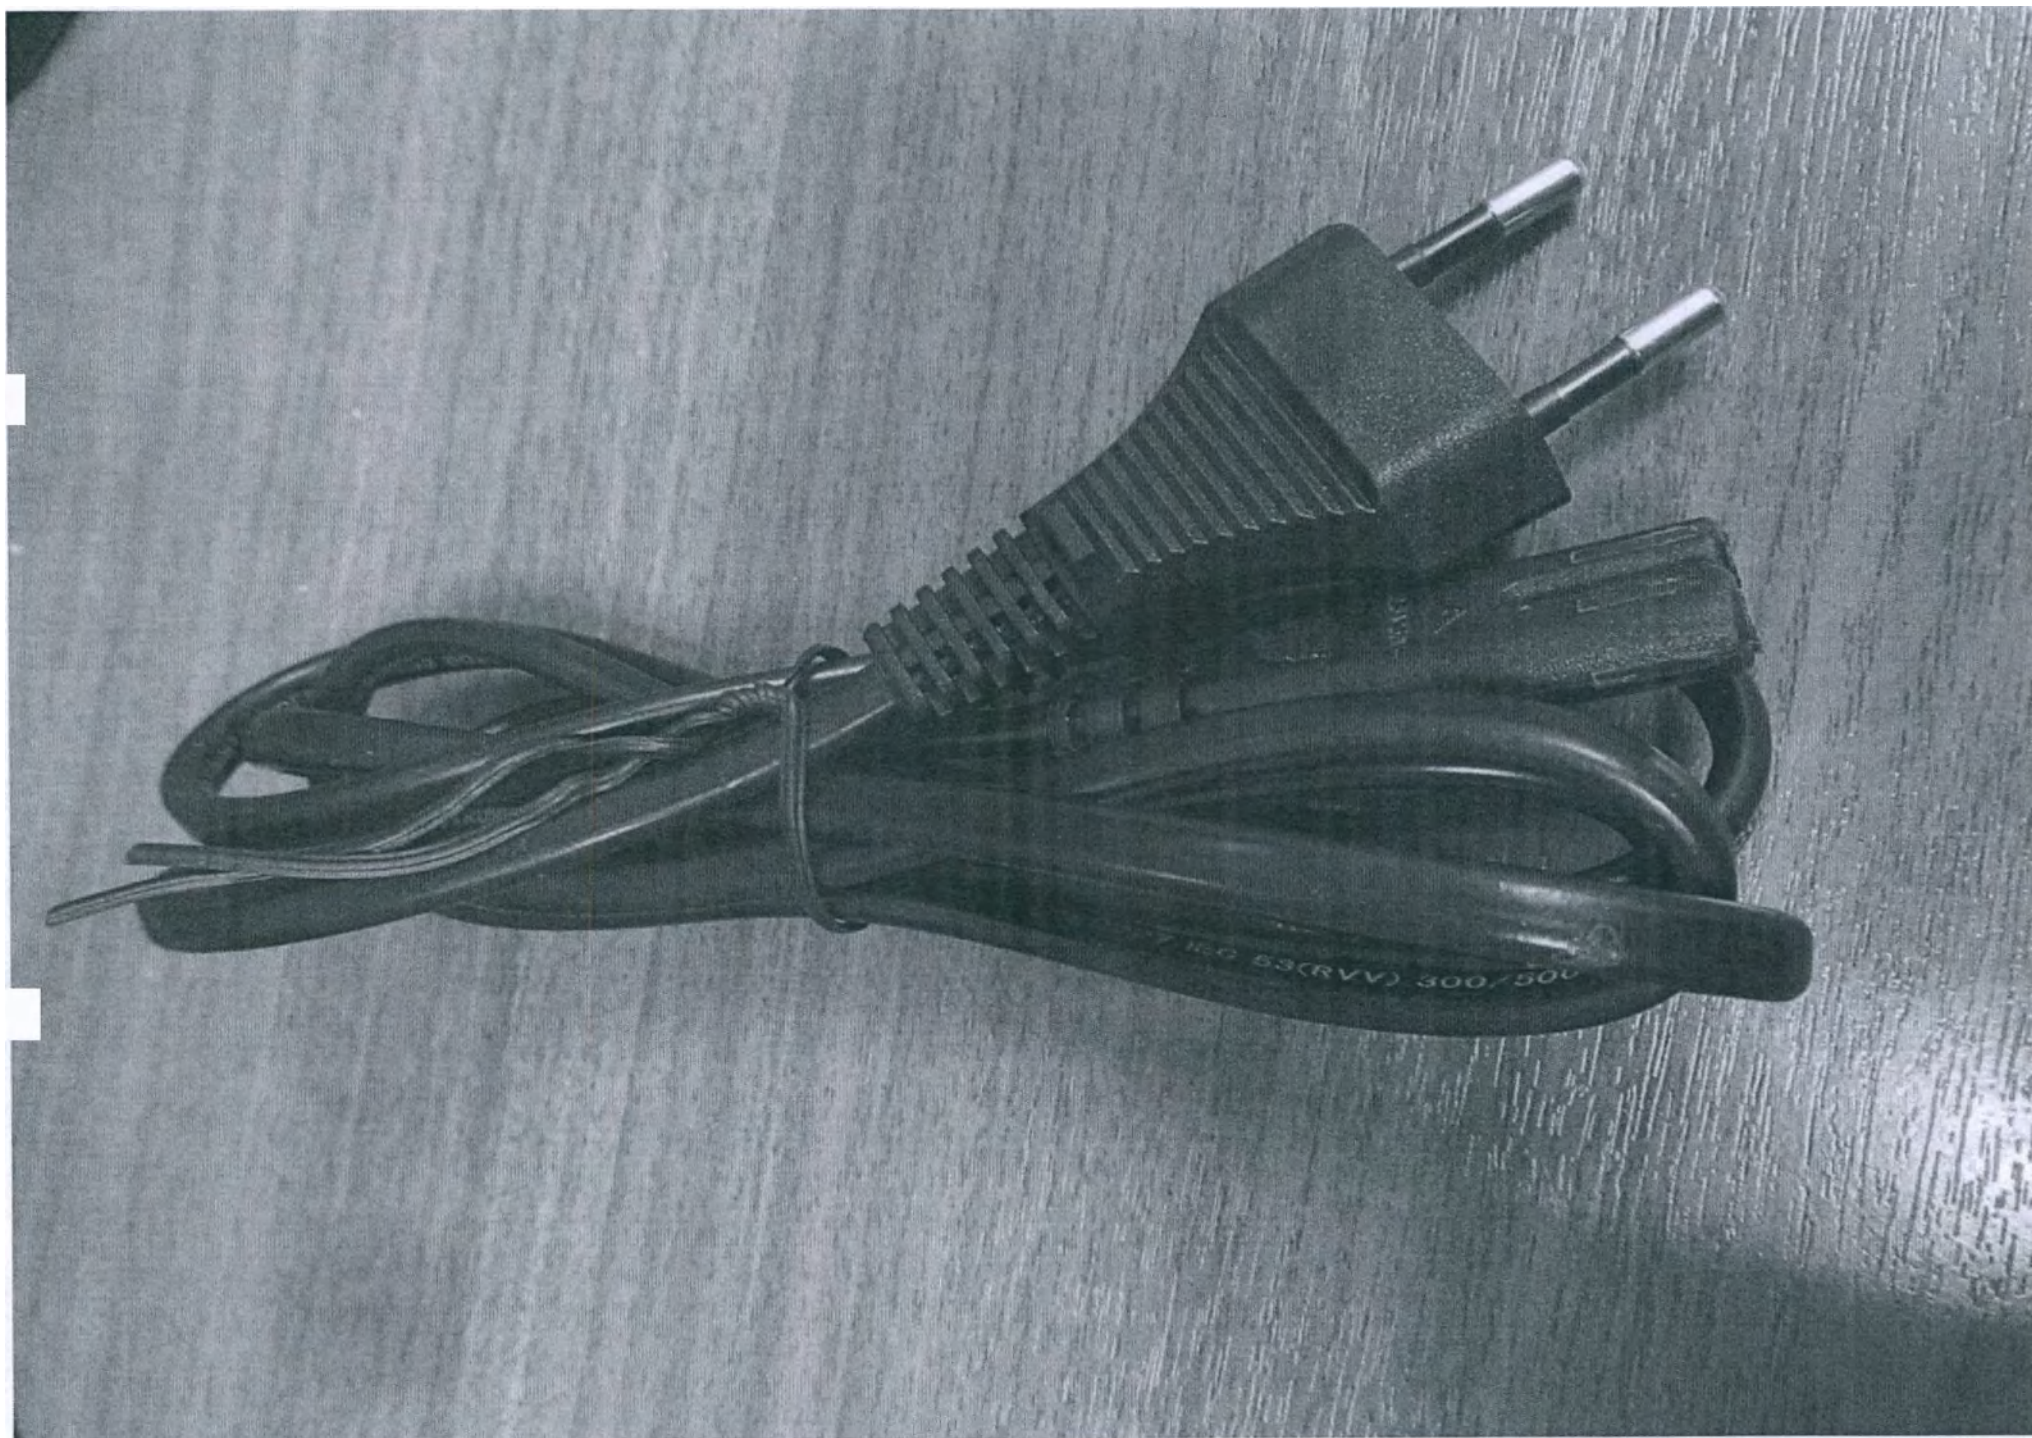


Рис. 6 – Шнур питания

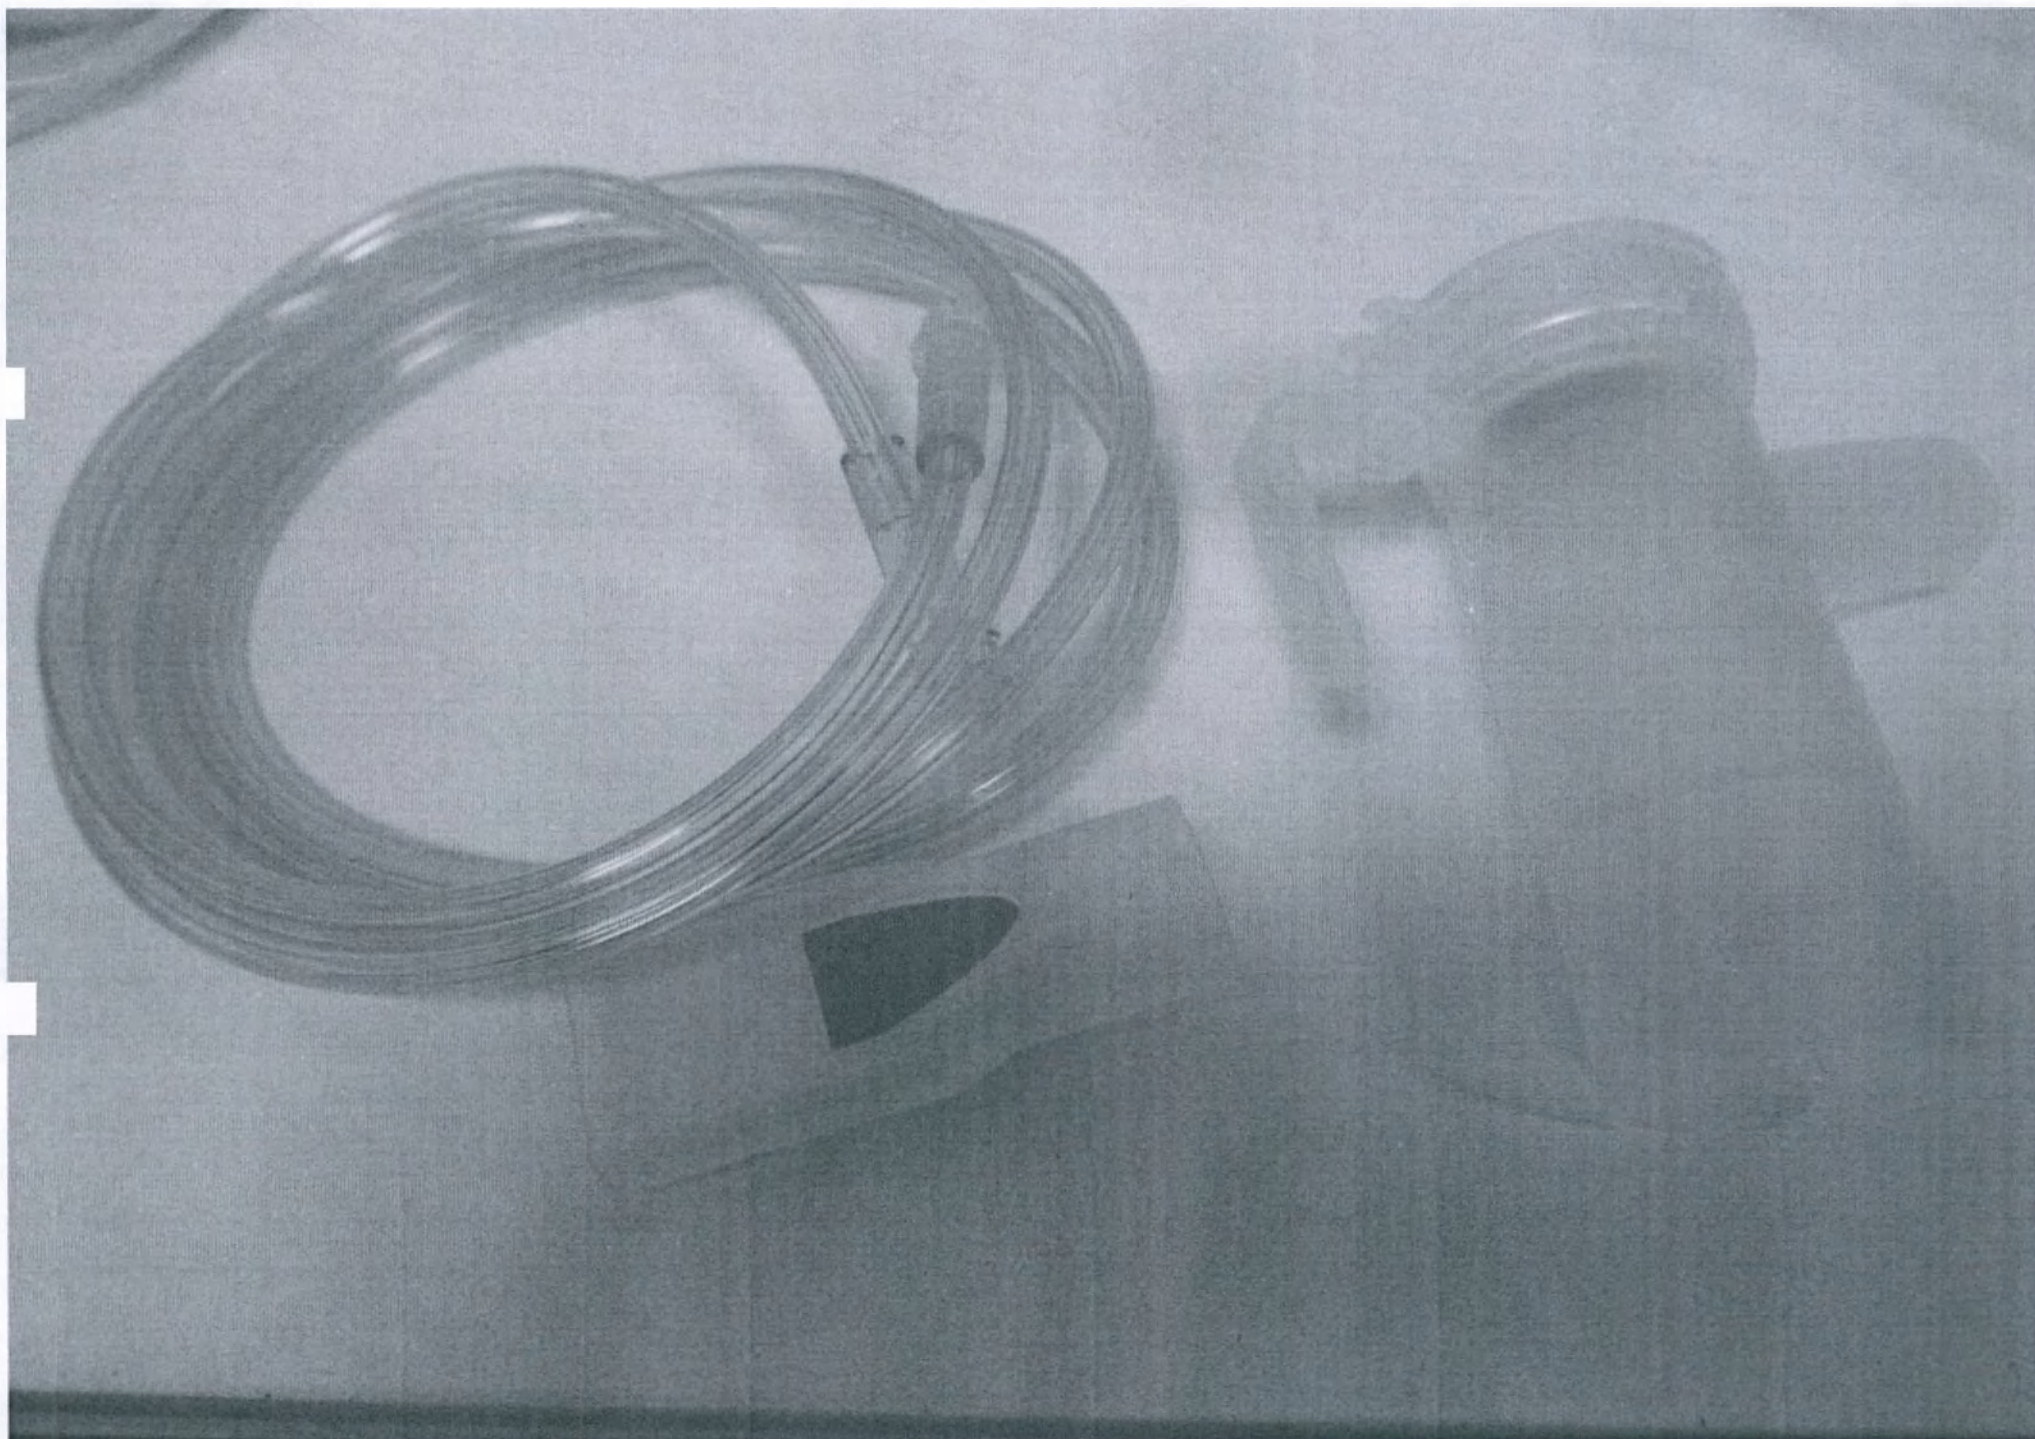


Рис. 7 – Комплект для ингаляции (тип I)

II. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU500, в составе:

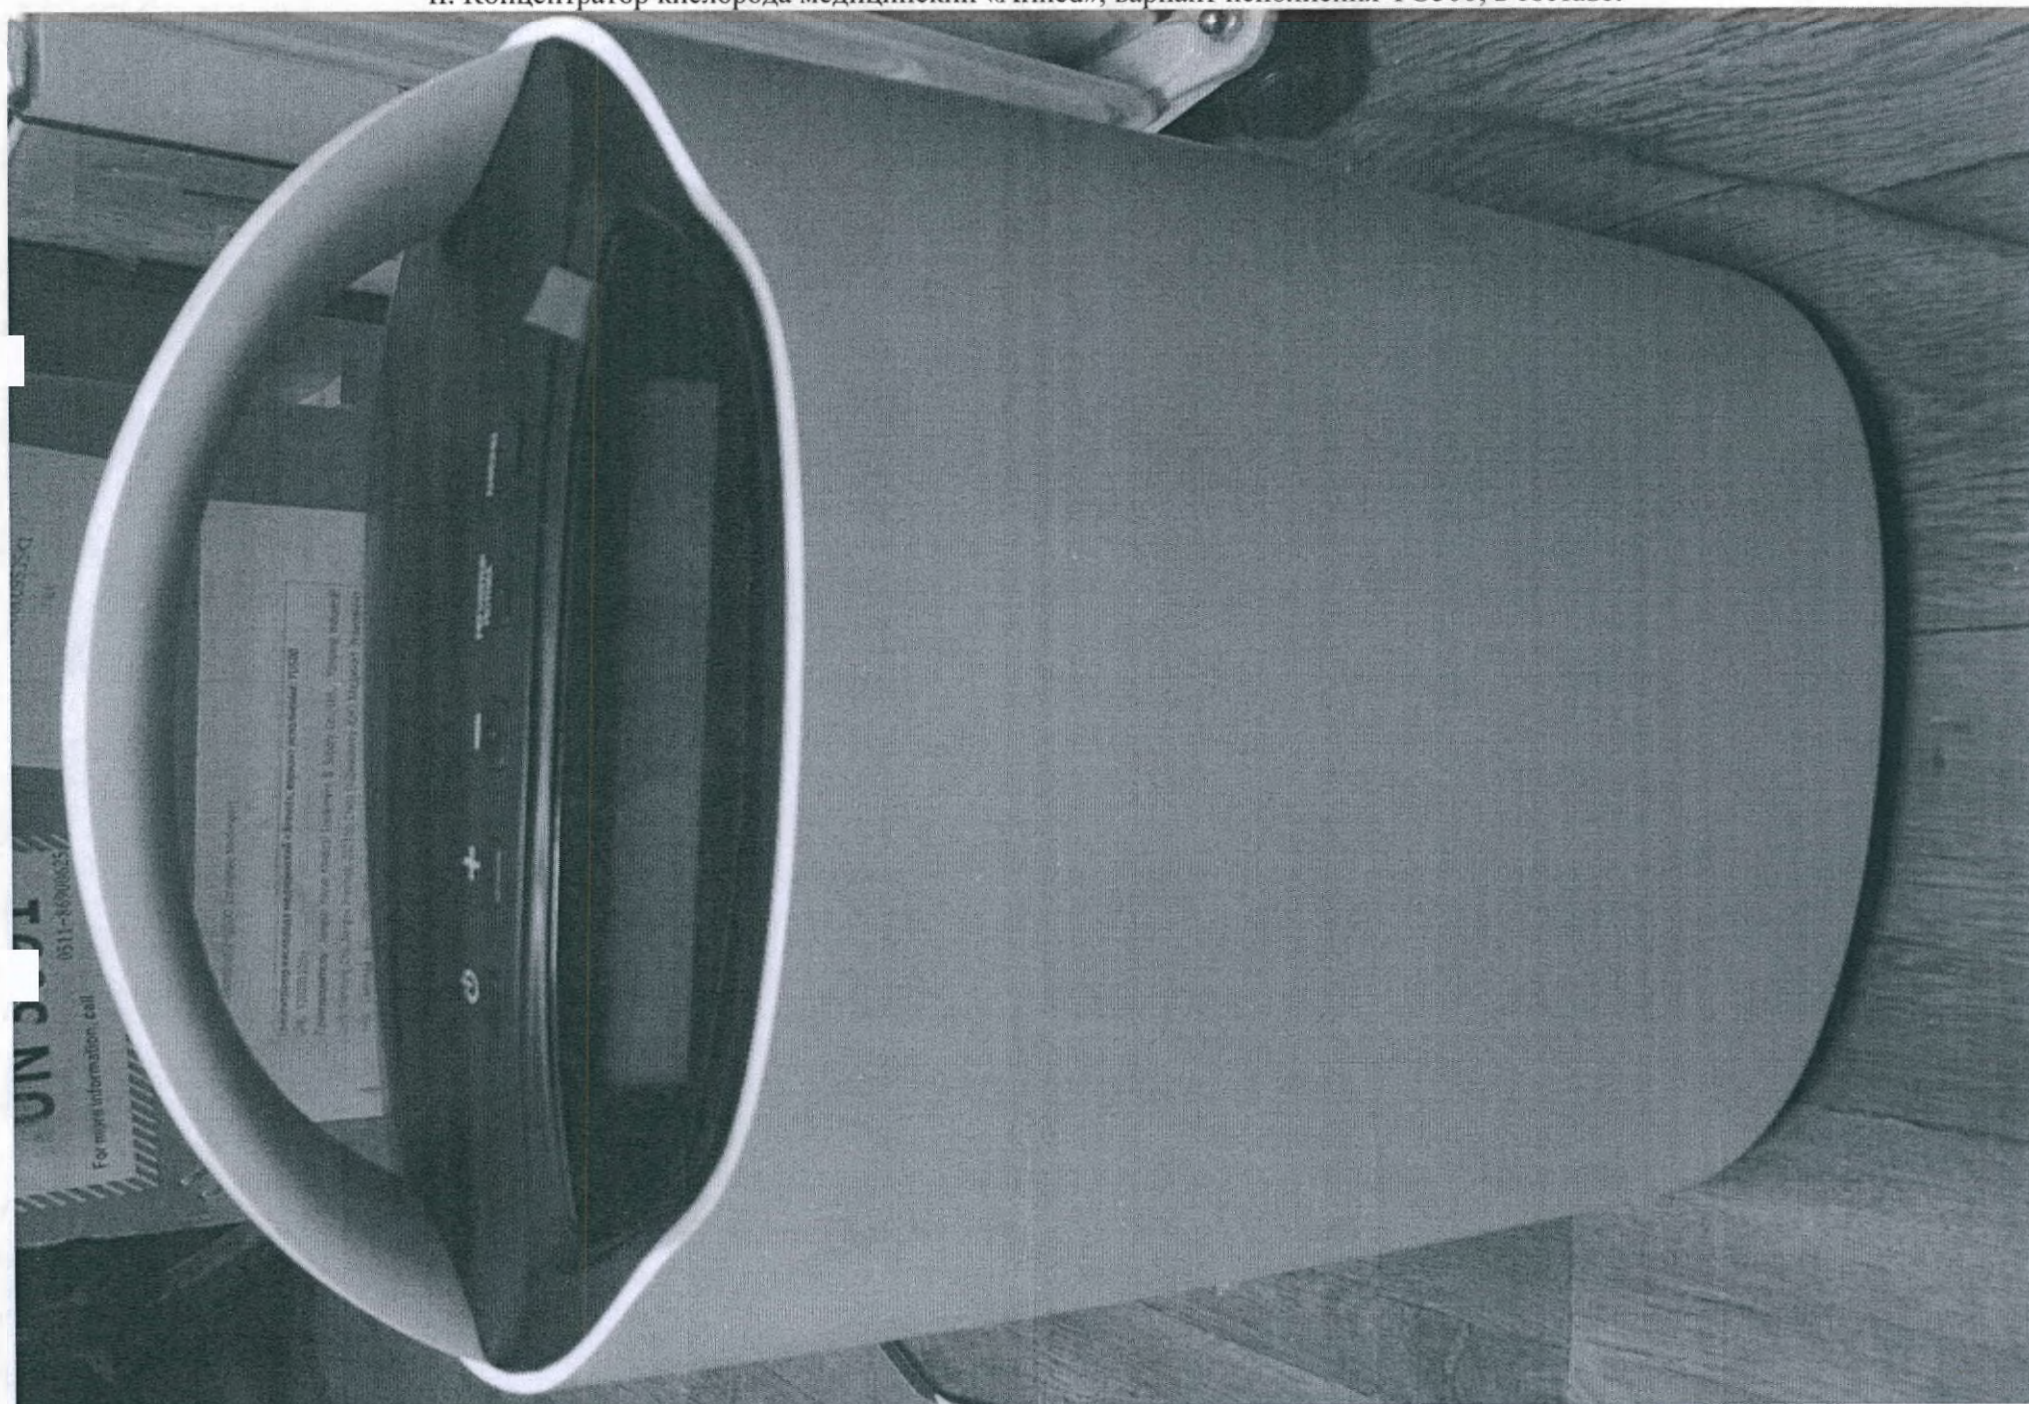


Рис. 8 – Концентратор кислорода

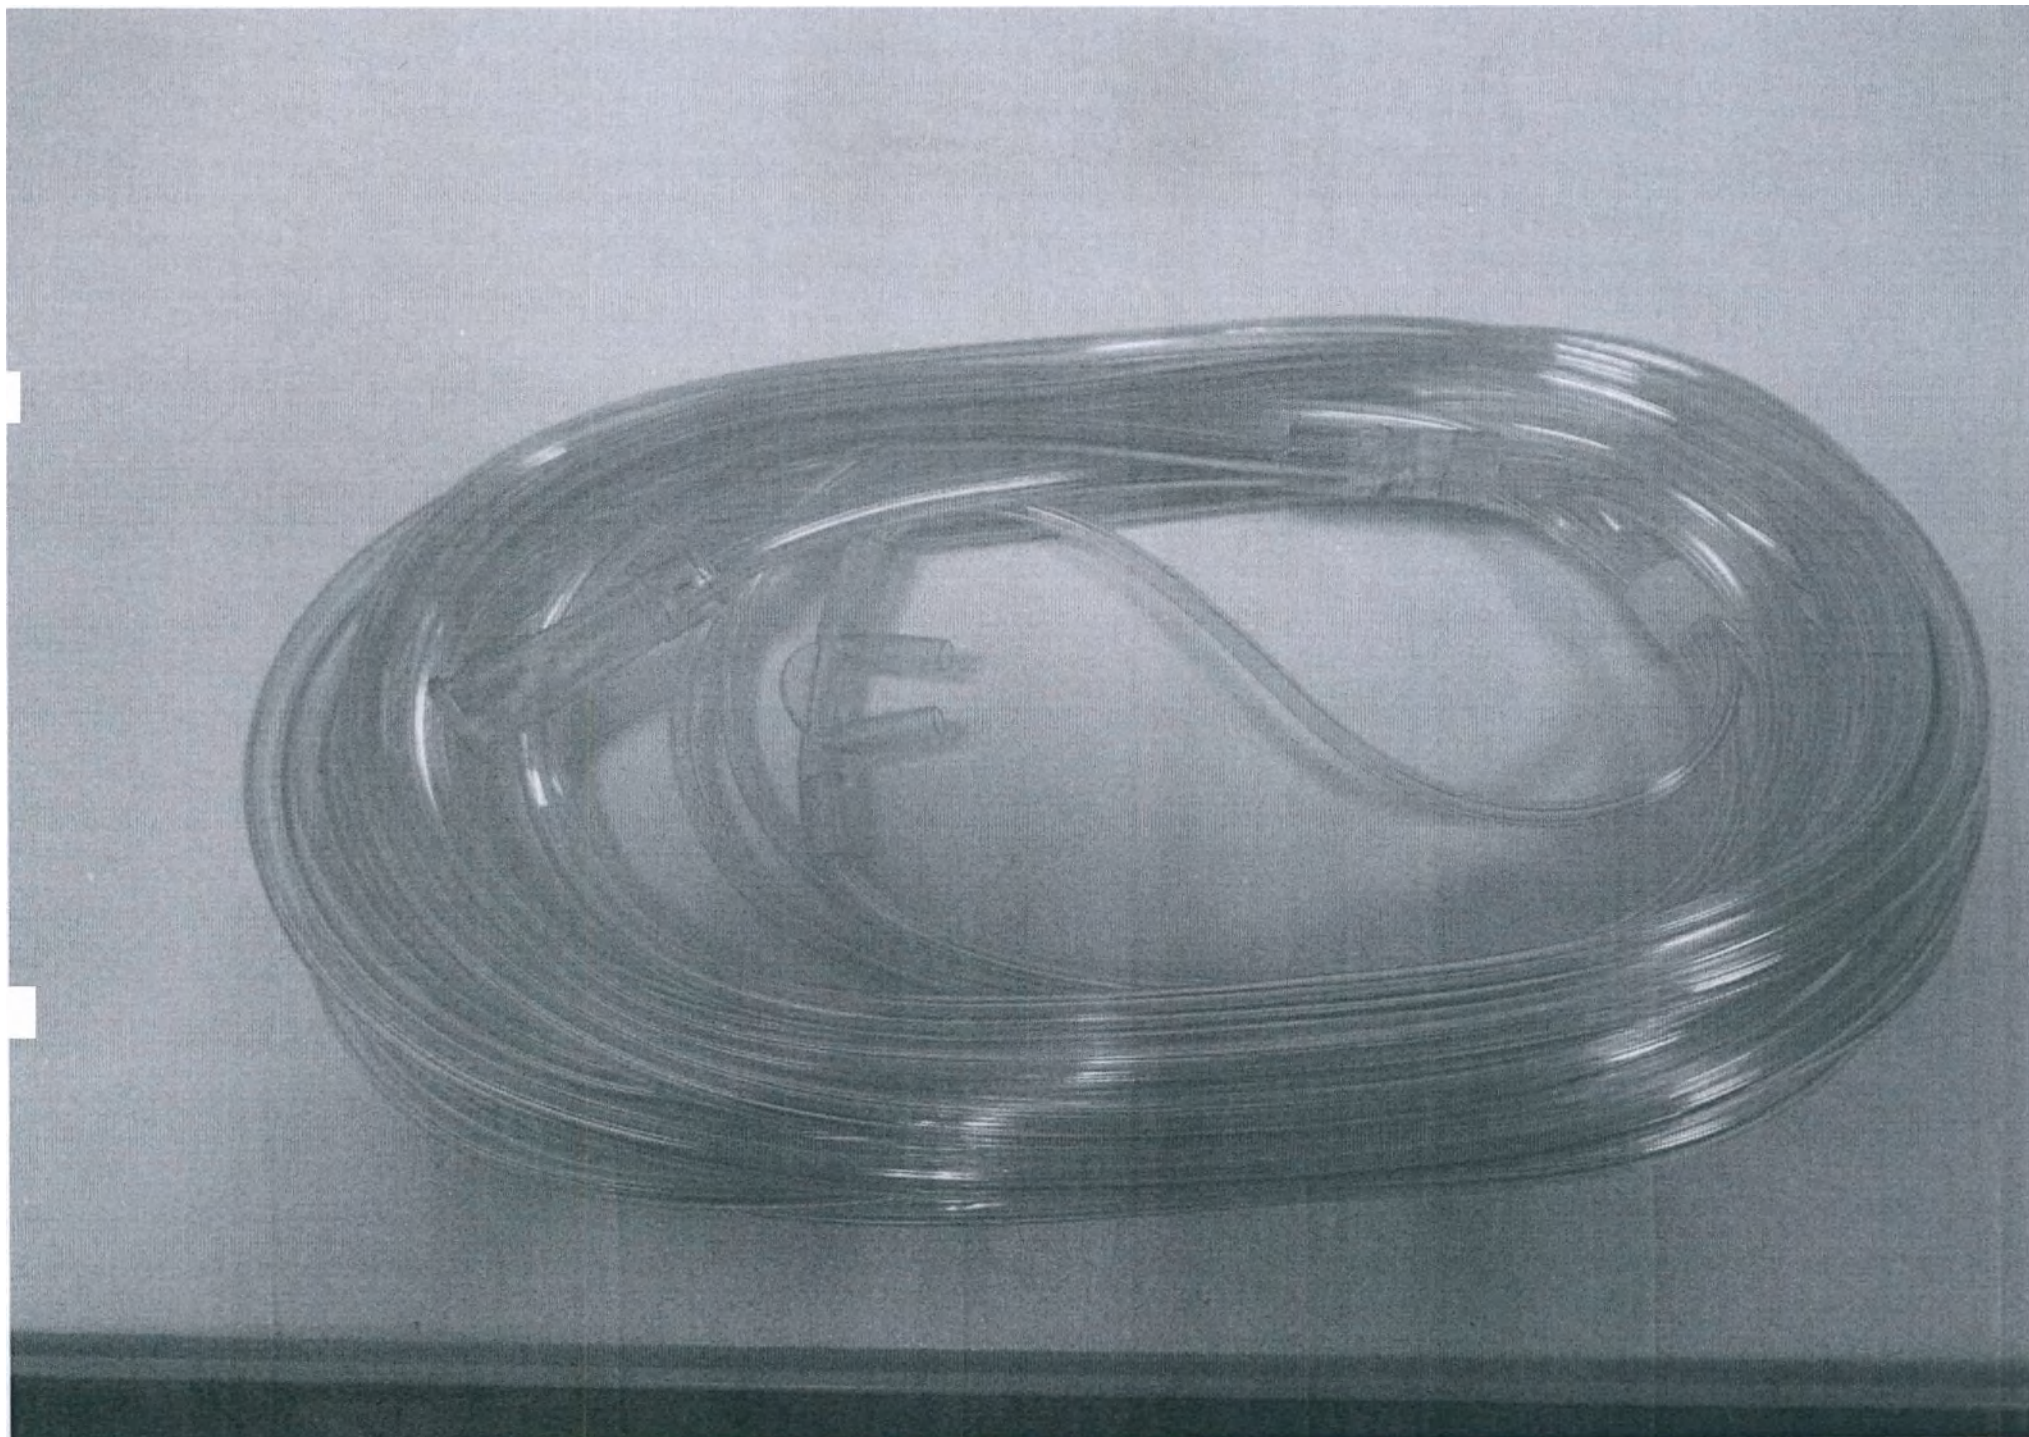


Рис. 9 – Канюля назальная большая

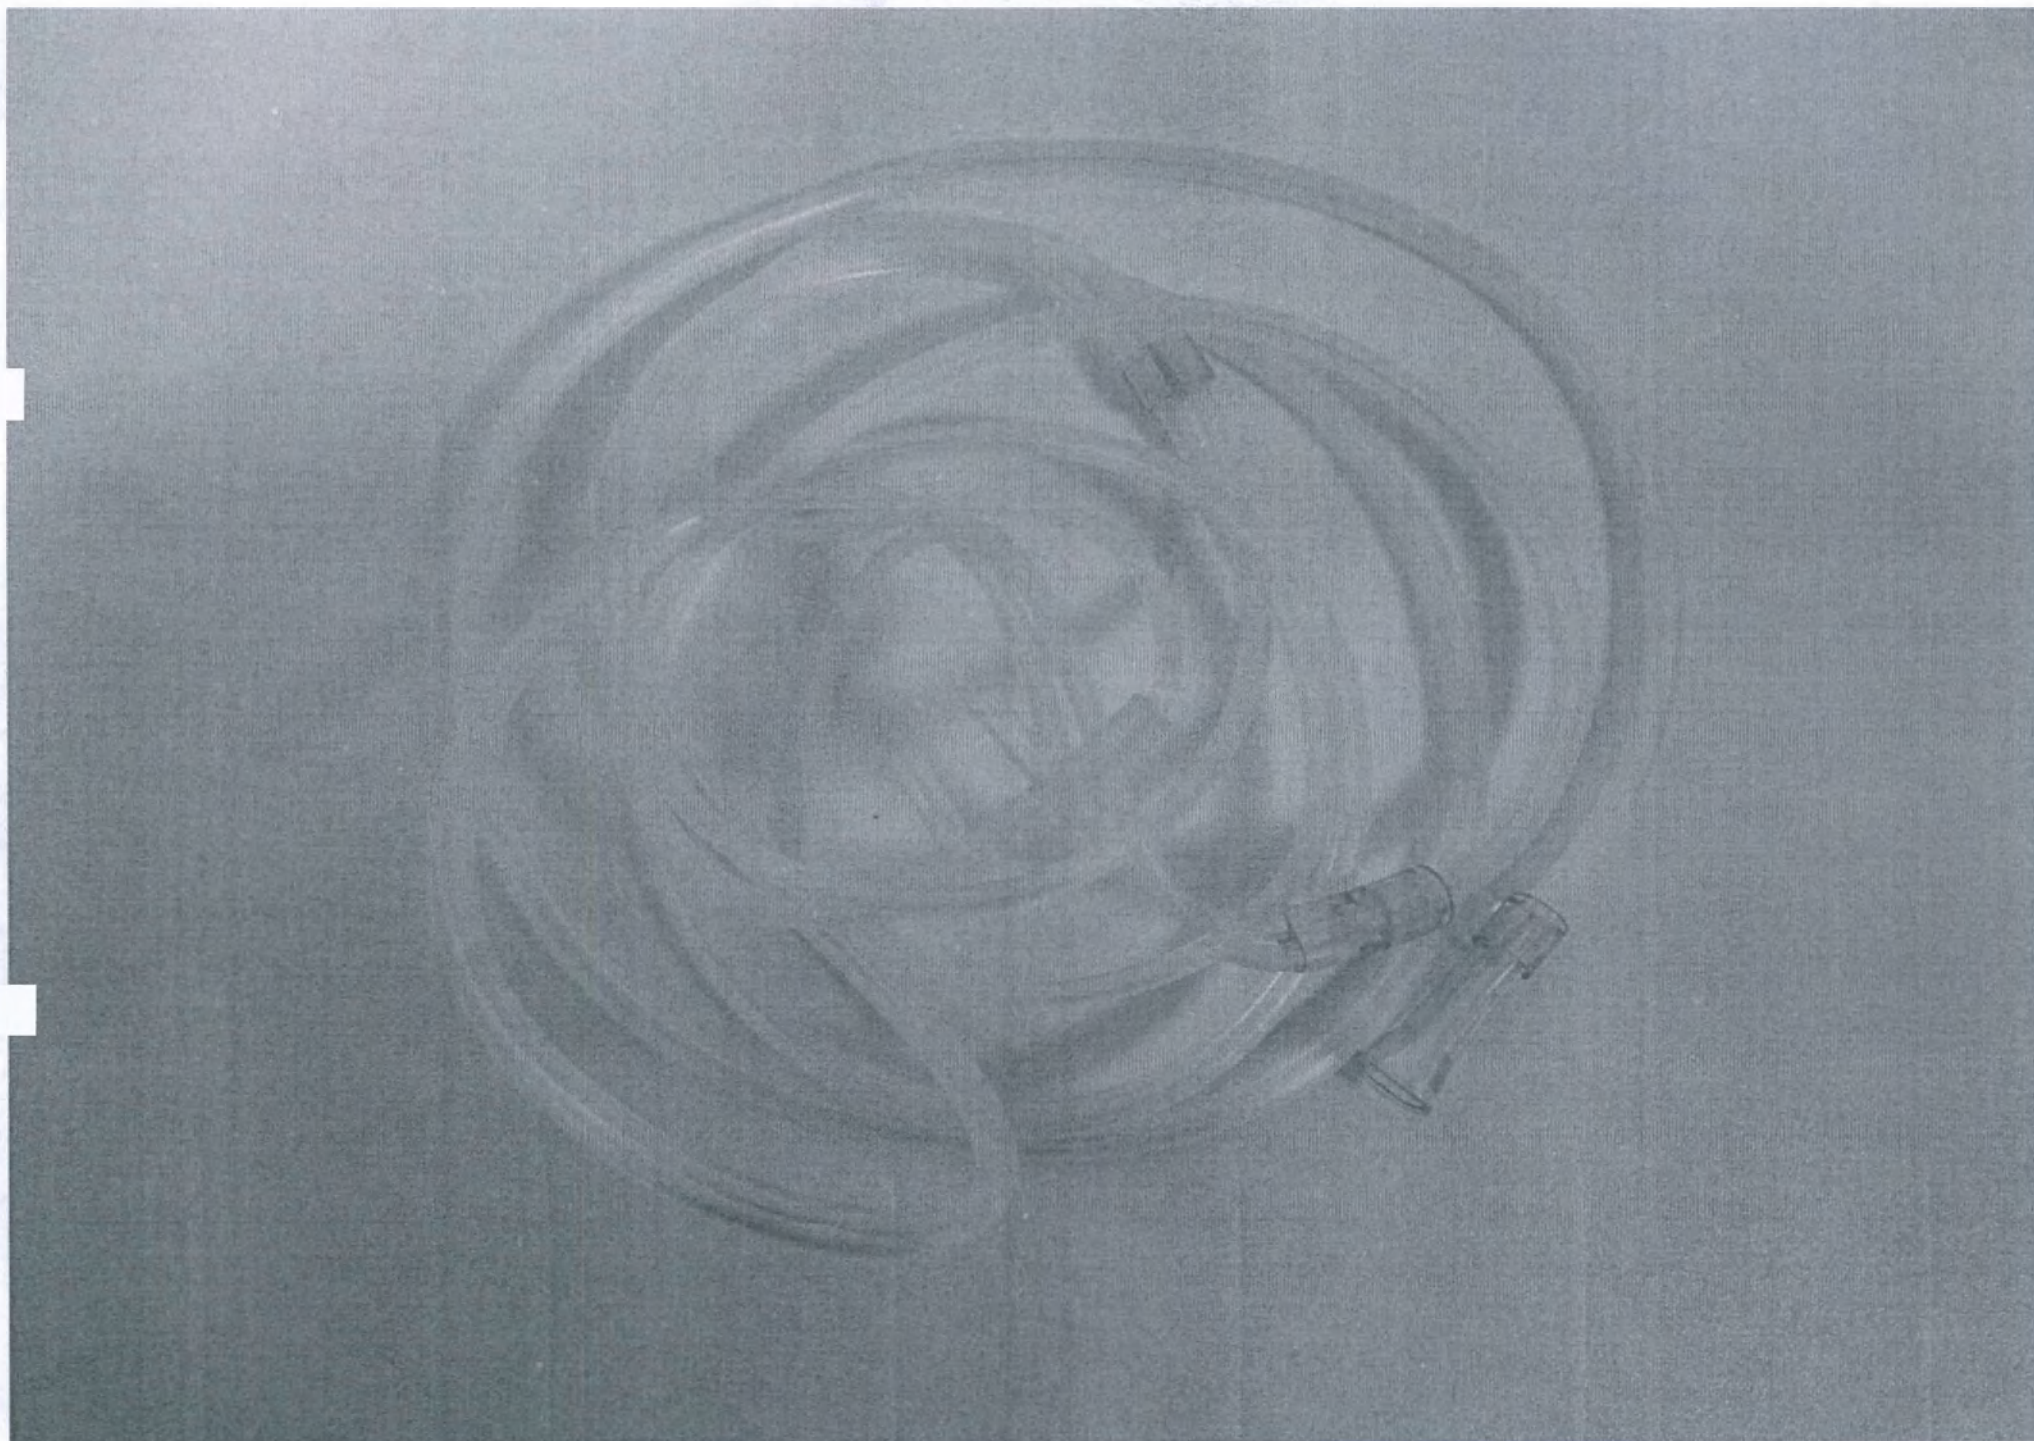


Рис. 10 – Канюля назальная малая



Рис. 11 – Диффузор (2 шт.)



Рис. 12 – Пульт ДУ

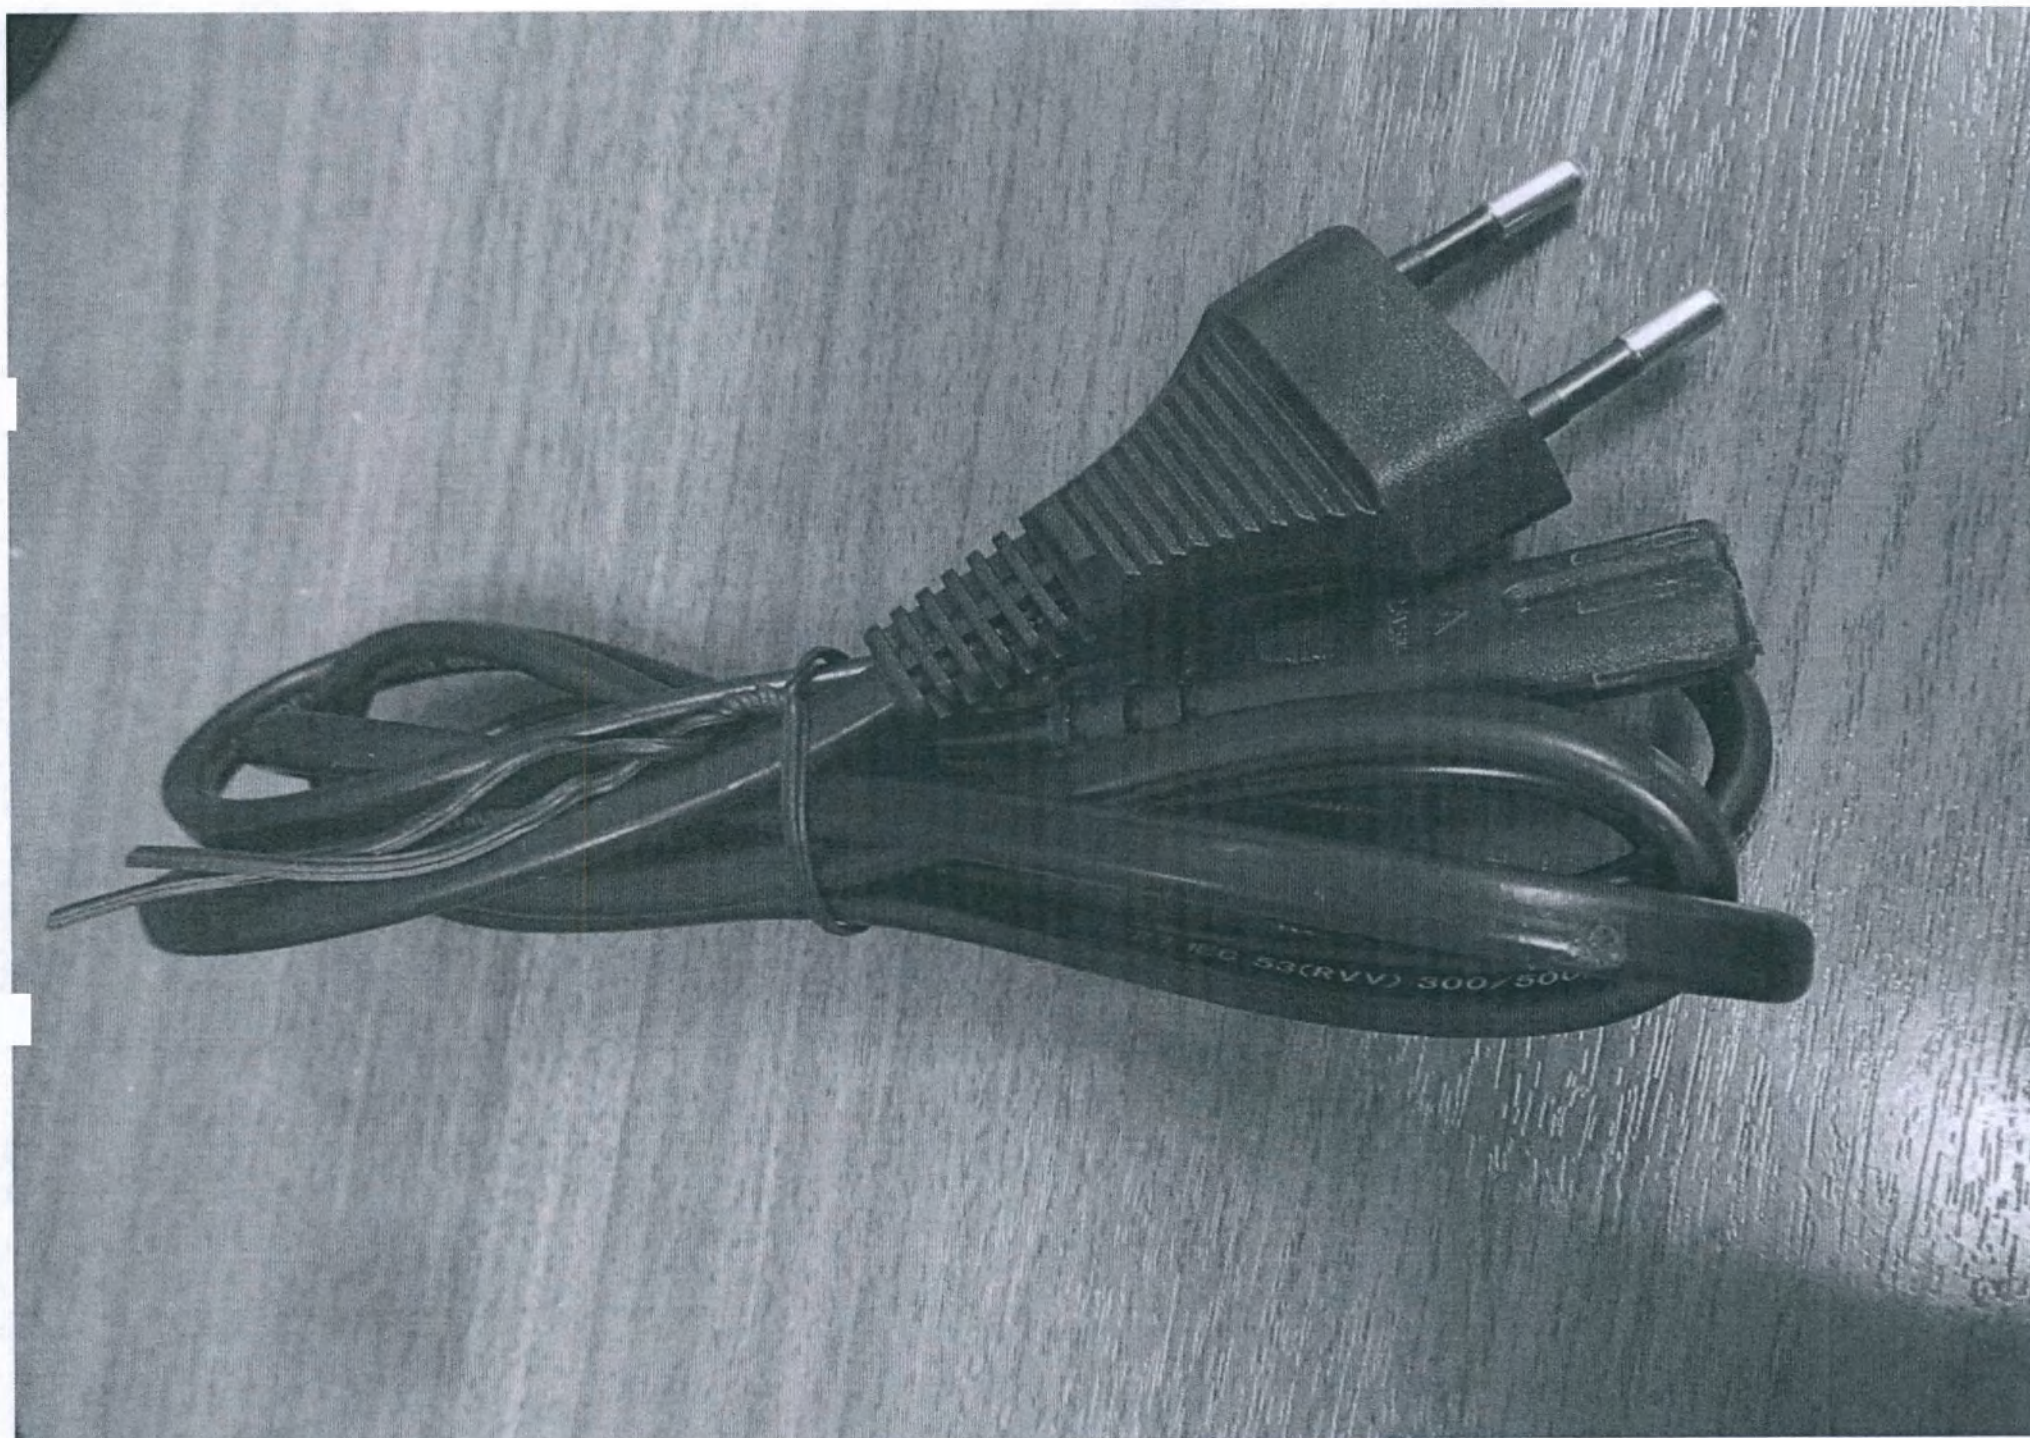


Рис. 13 – Шнур питания

III. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения YU560, в составе:

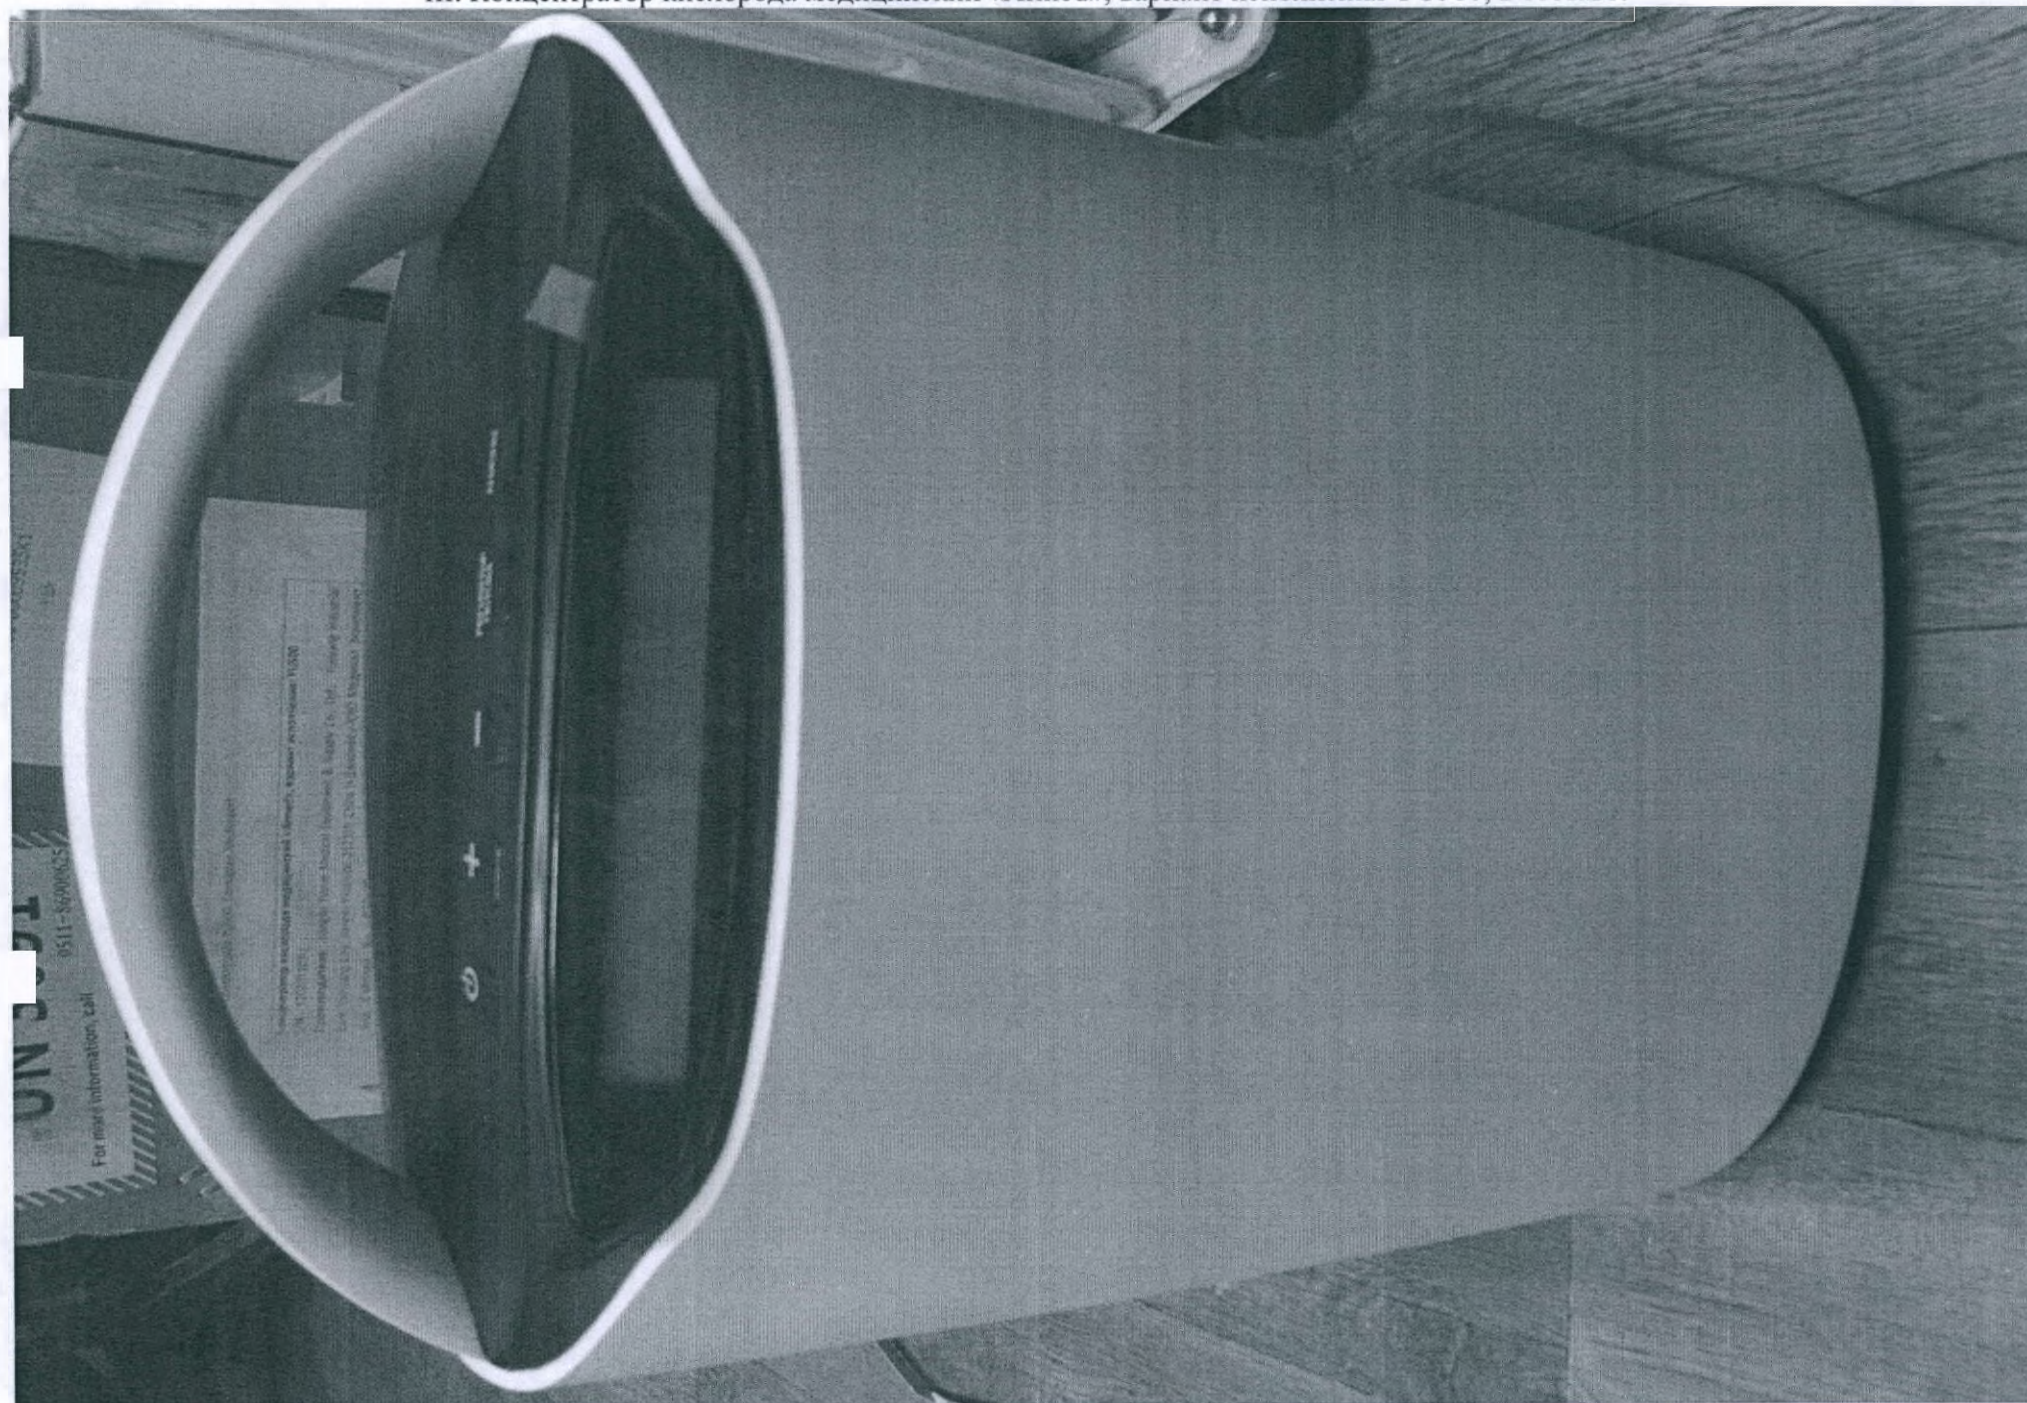


Рис. 14 – Концентратор кислорода

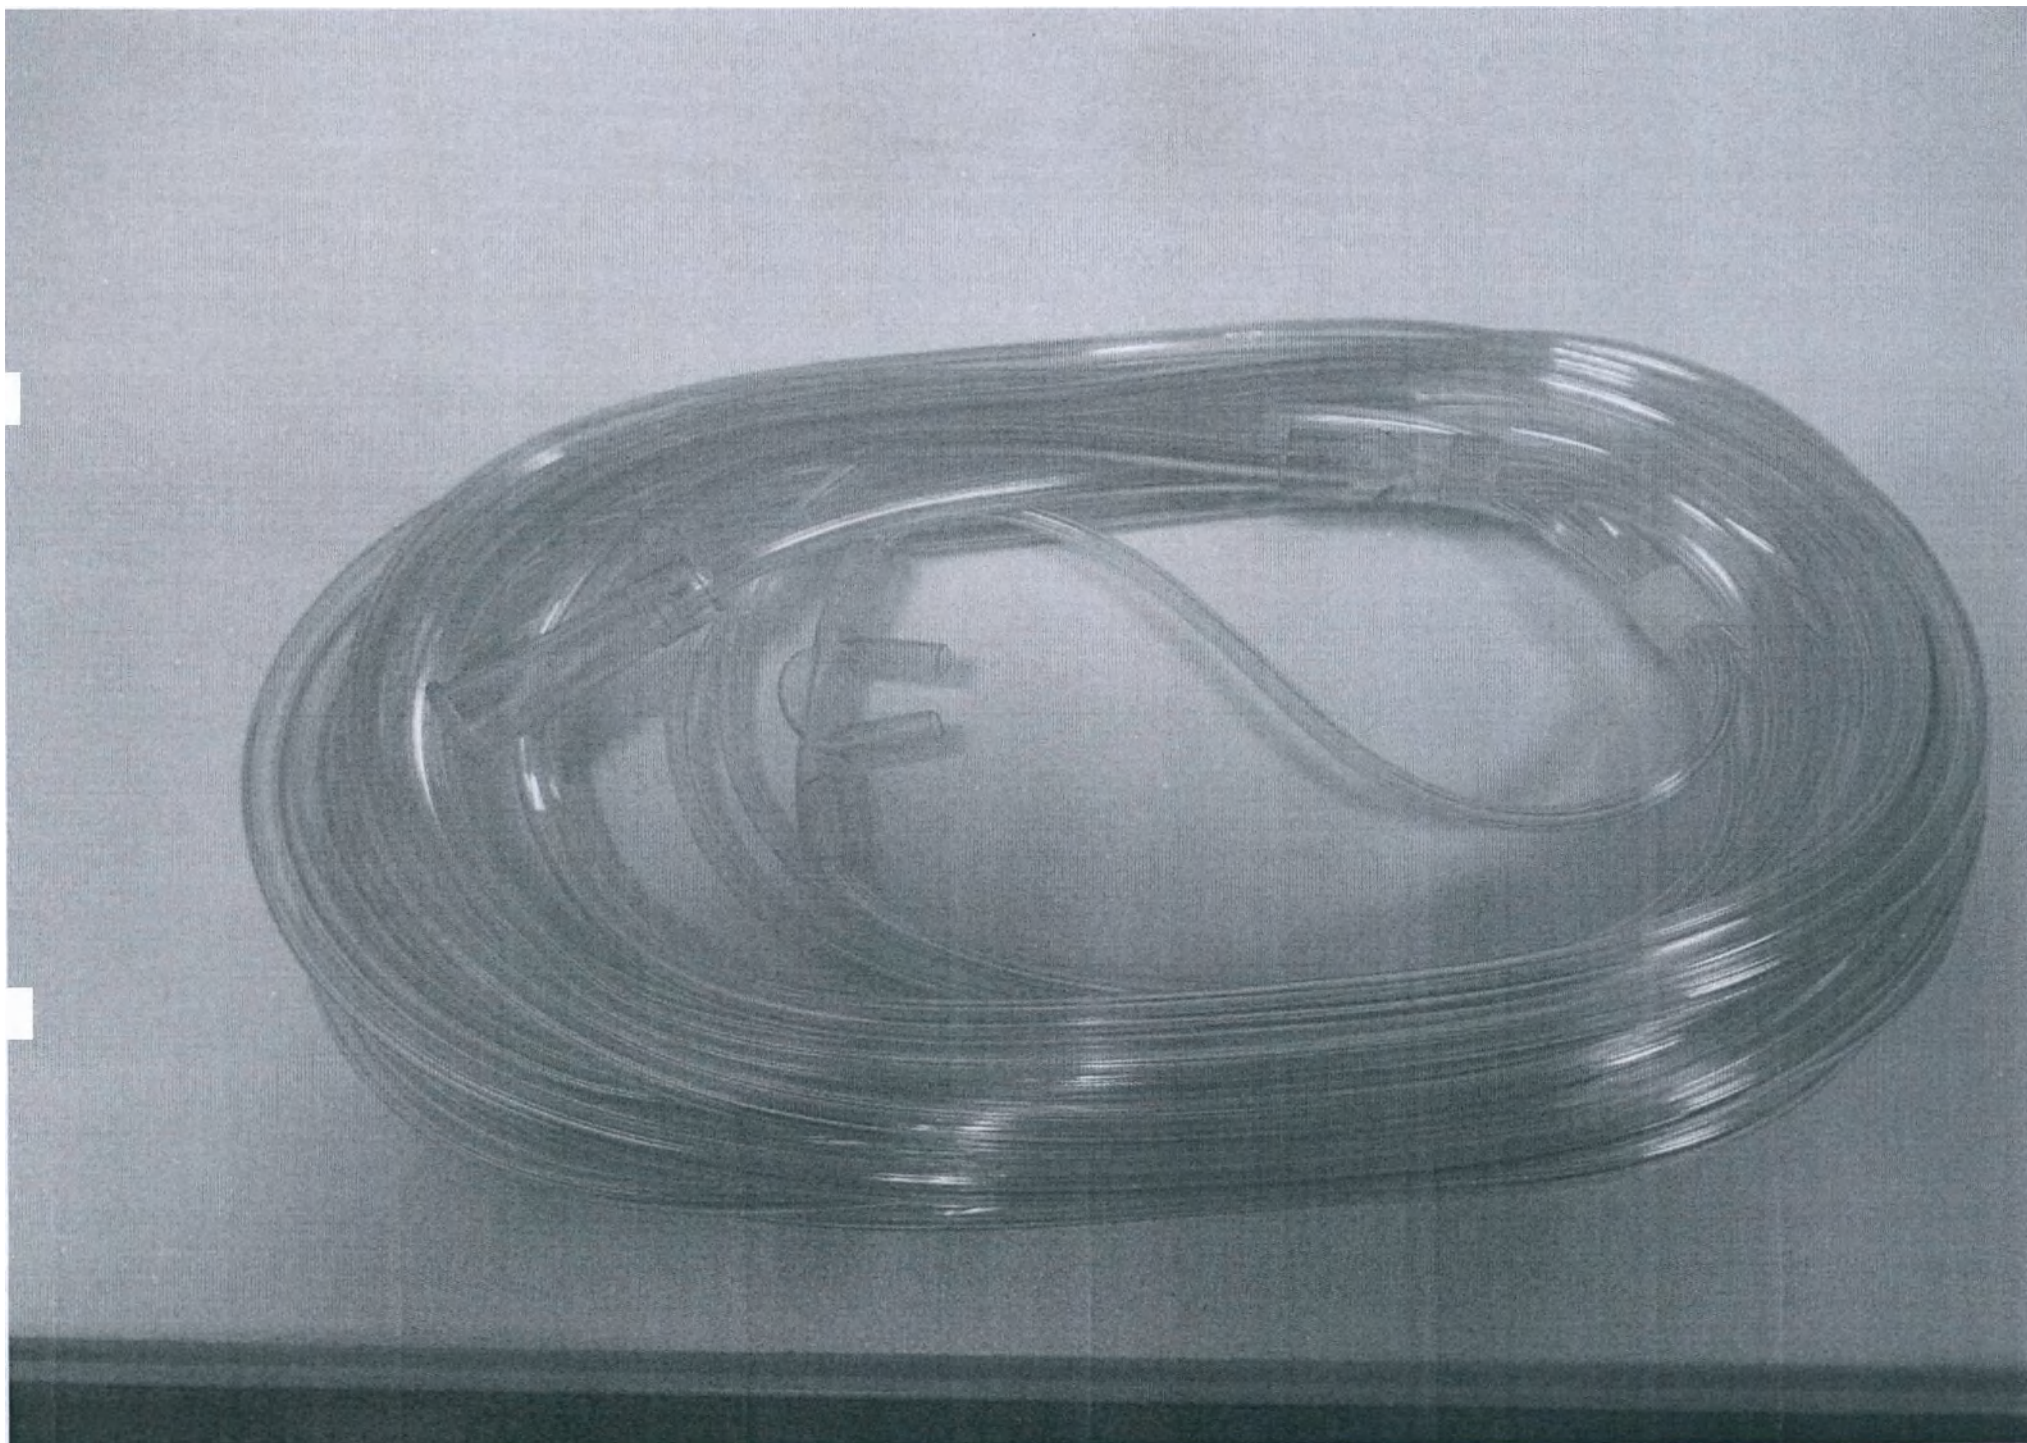


Рис. 15 – Канюля назальная большая



Рис. 16 – Диффузор (2 шт.)



Рис. 17 – Пульт ДУ

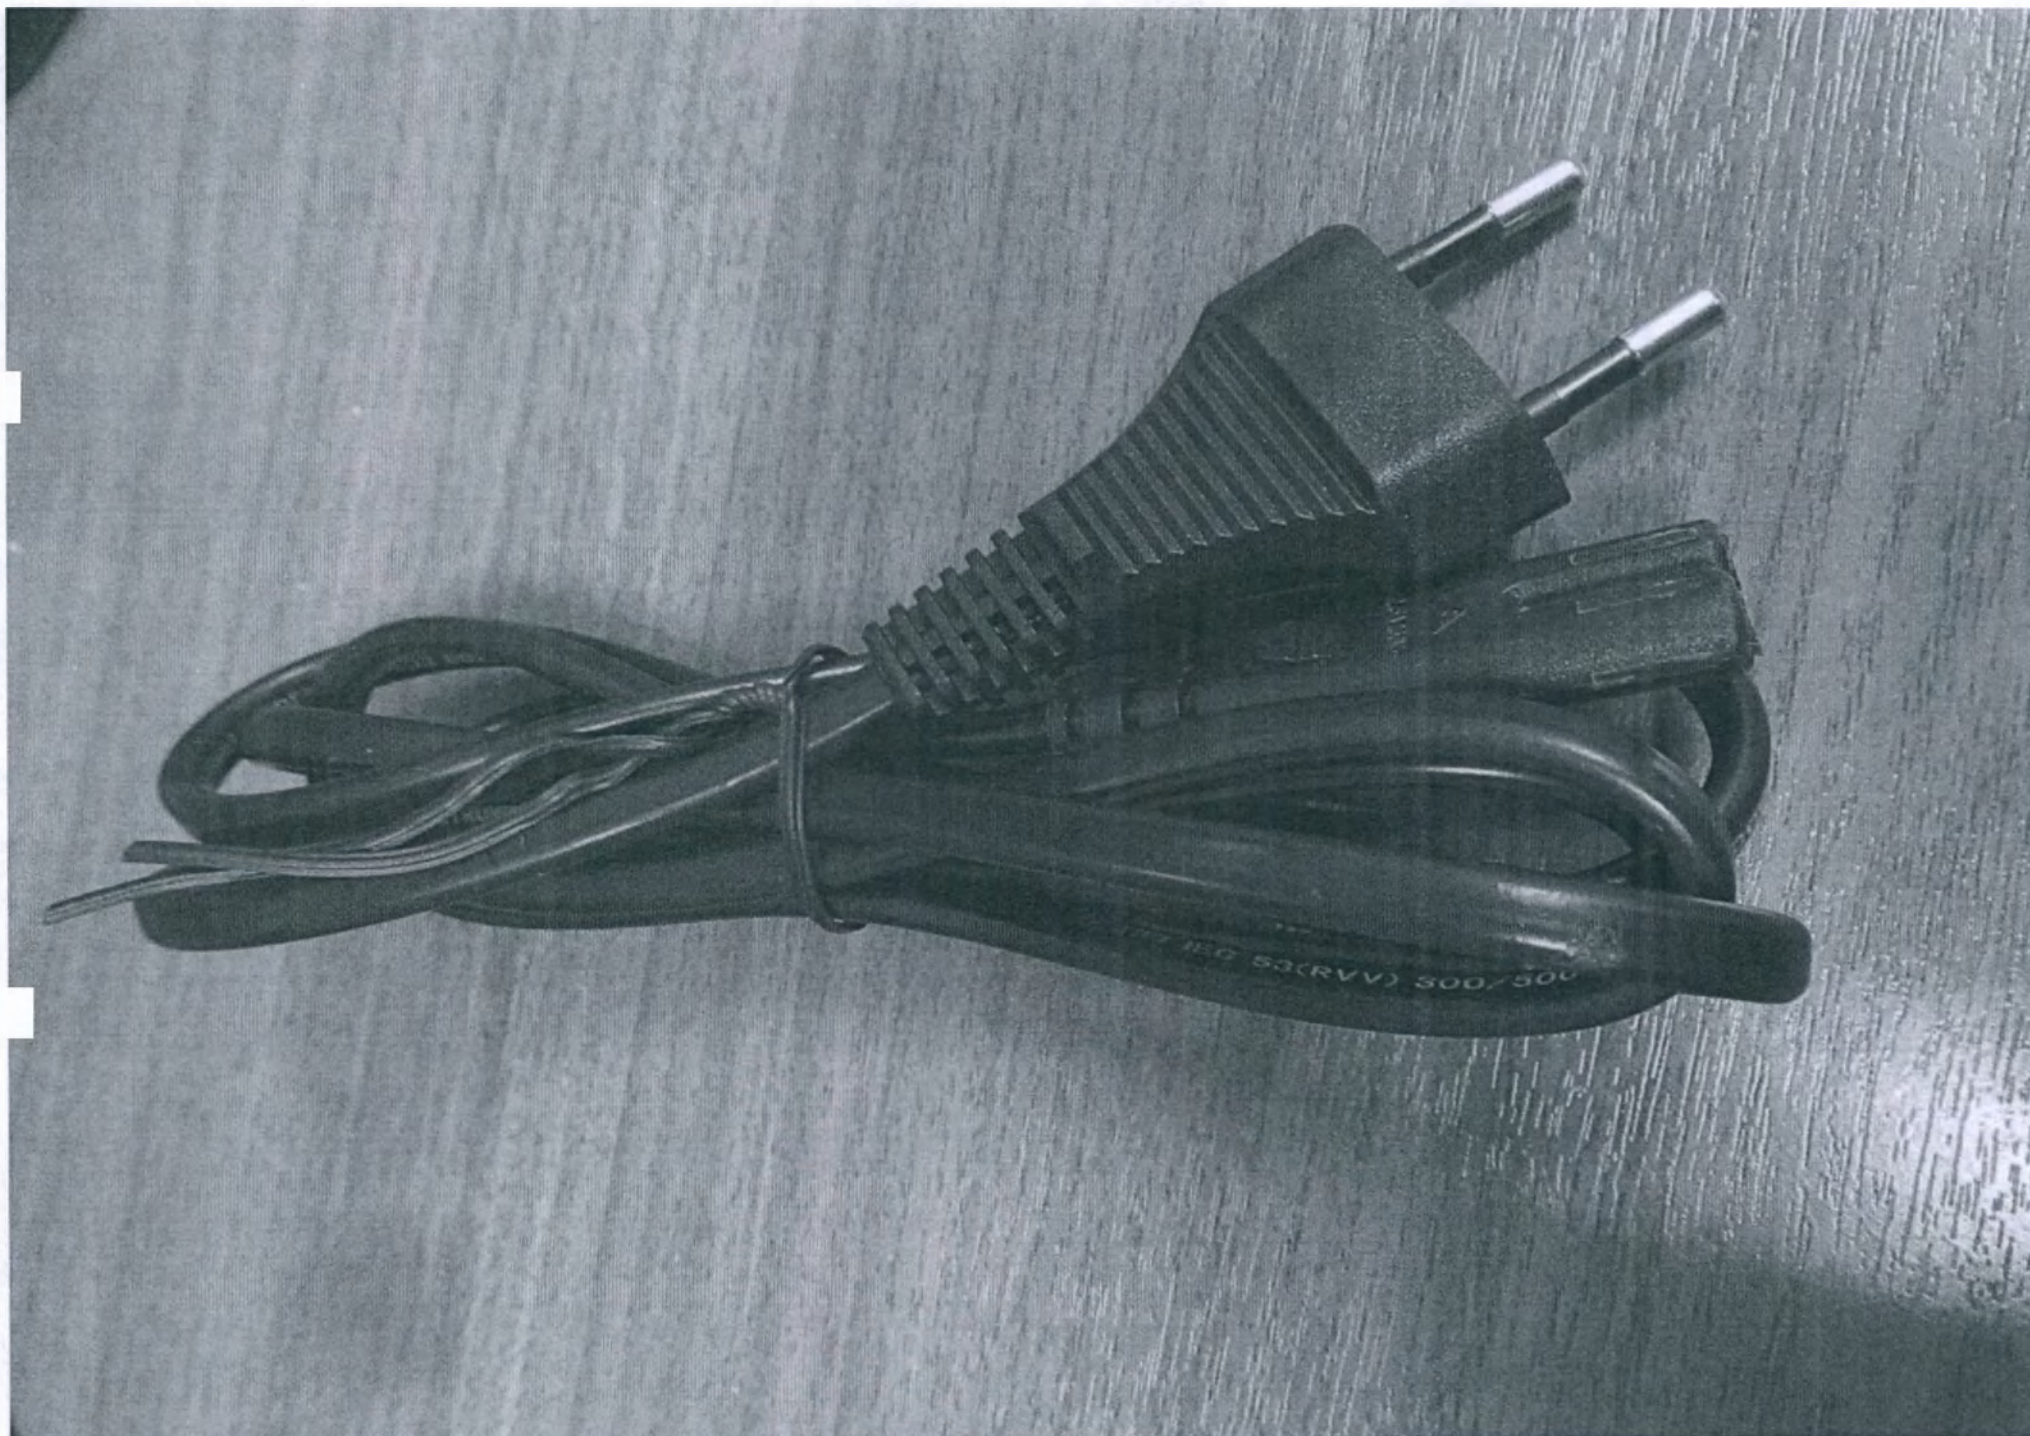


Рис. 18 – Шнур питания

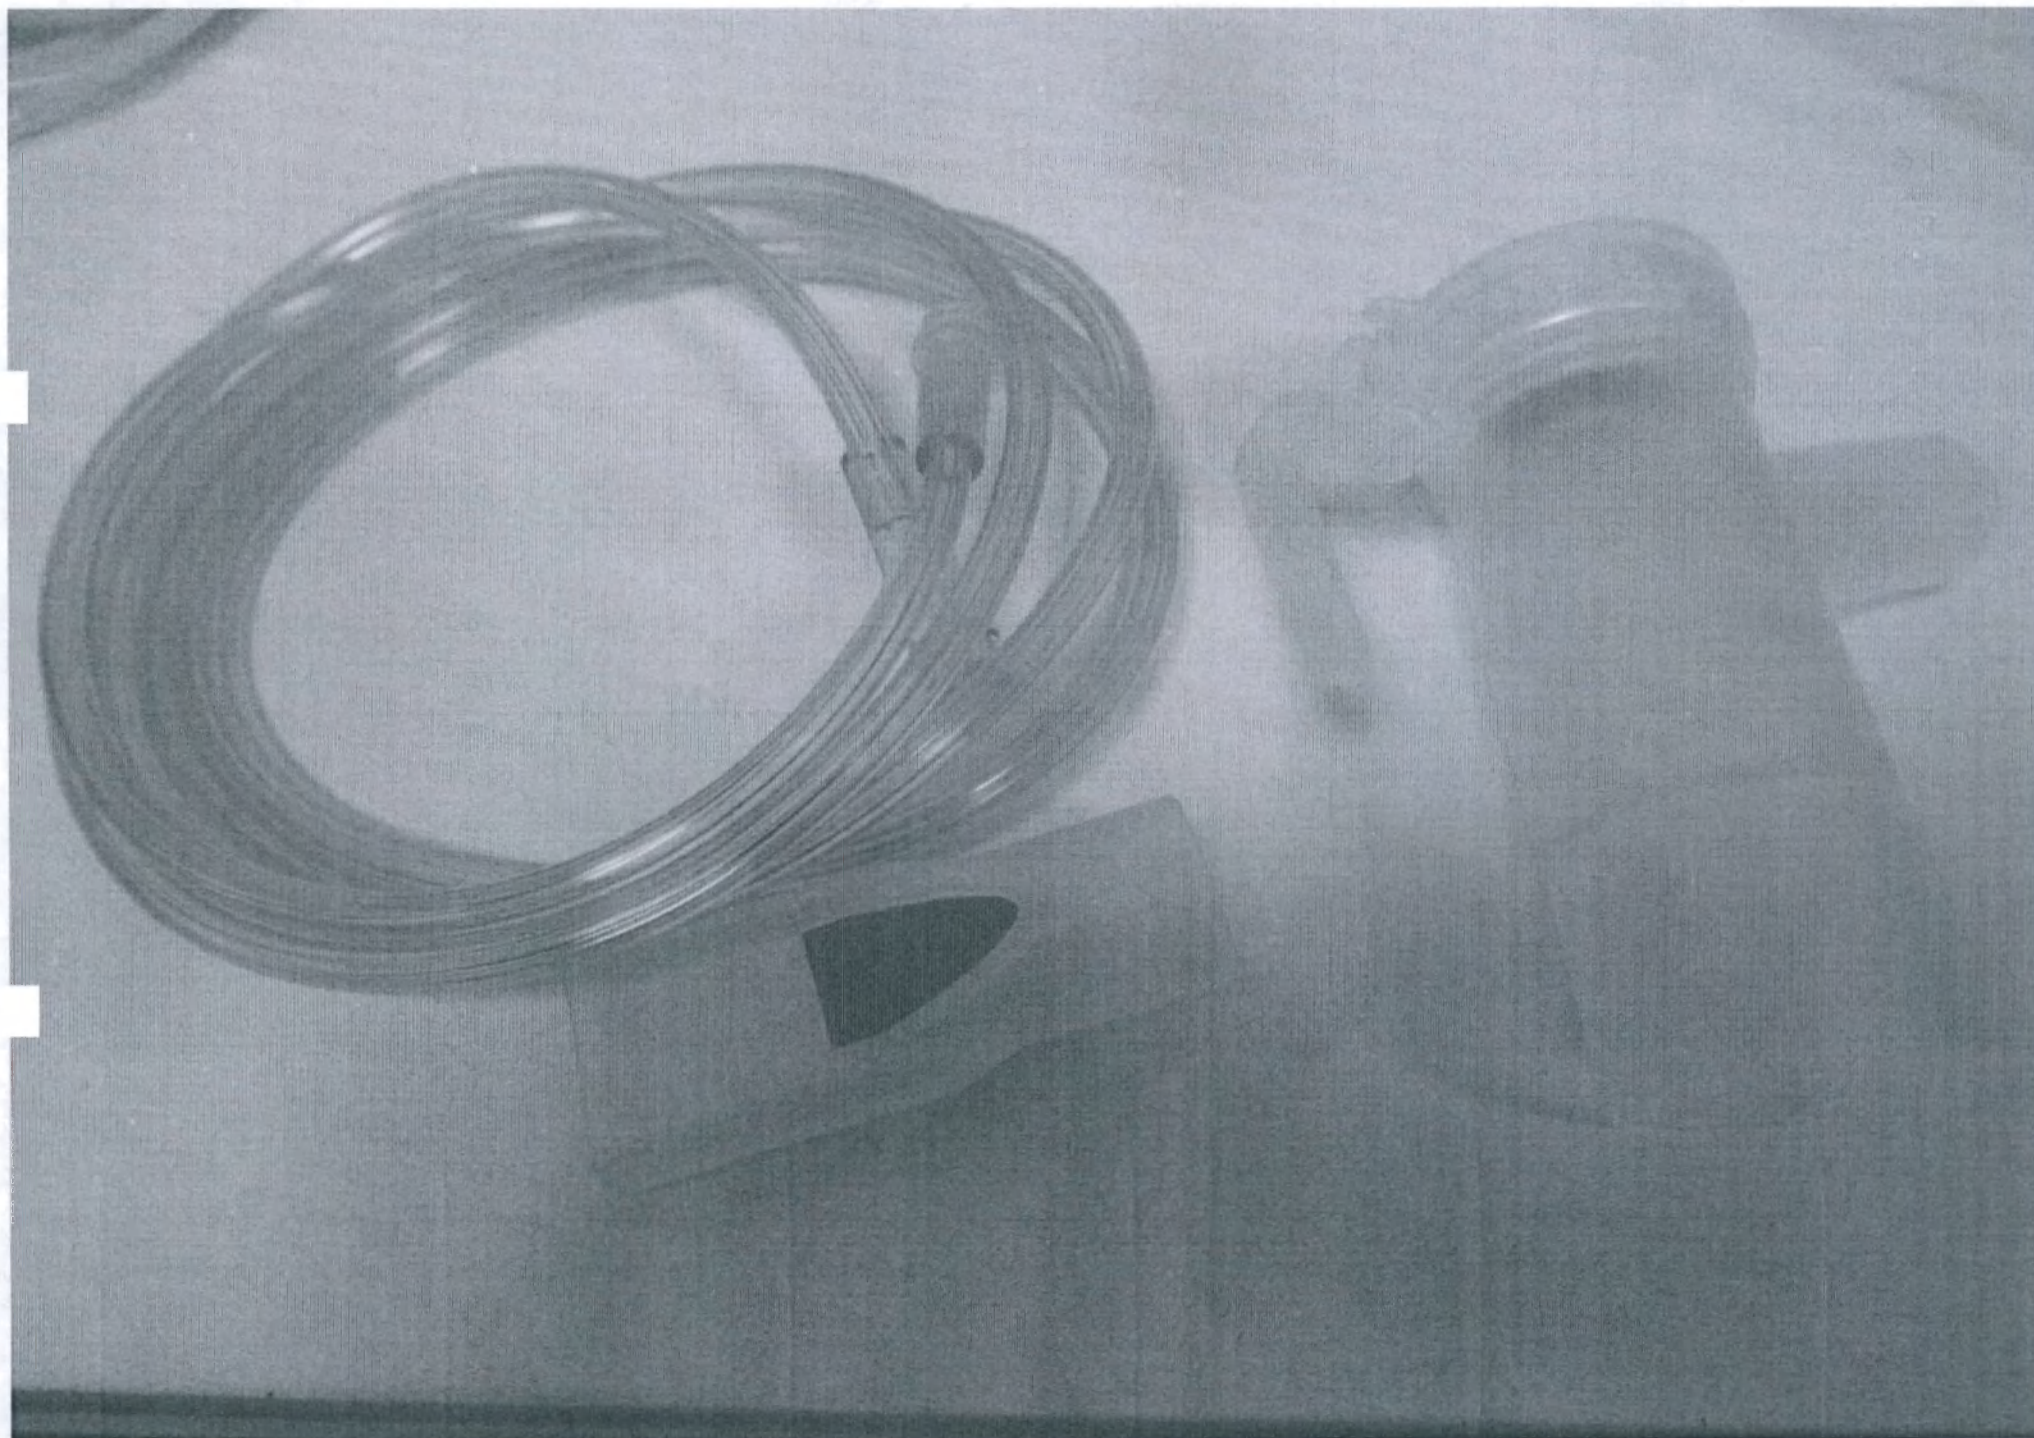


Рис. 19 – Комплект для ингаляции (тип I)

IV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 9F-3C, в составе:

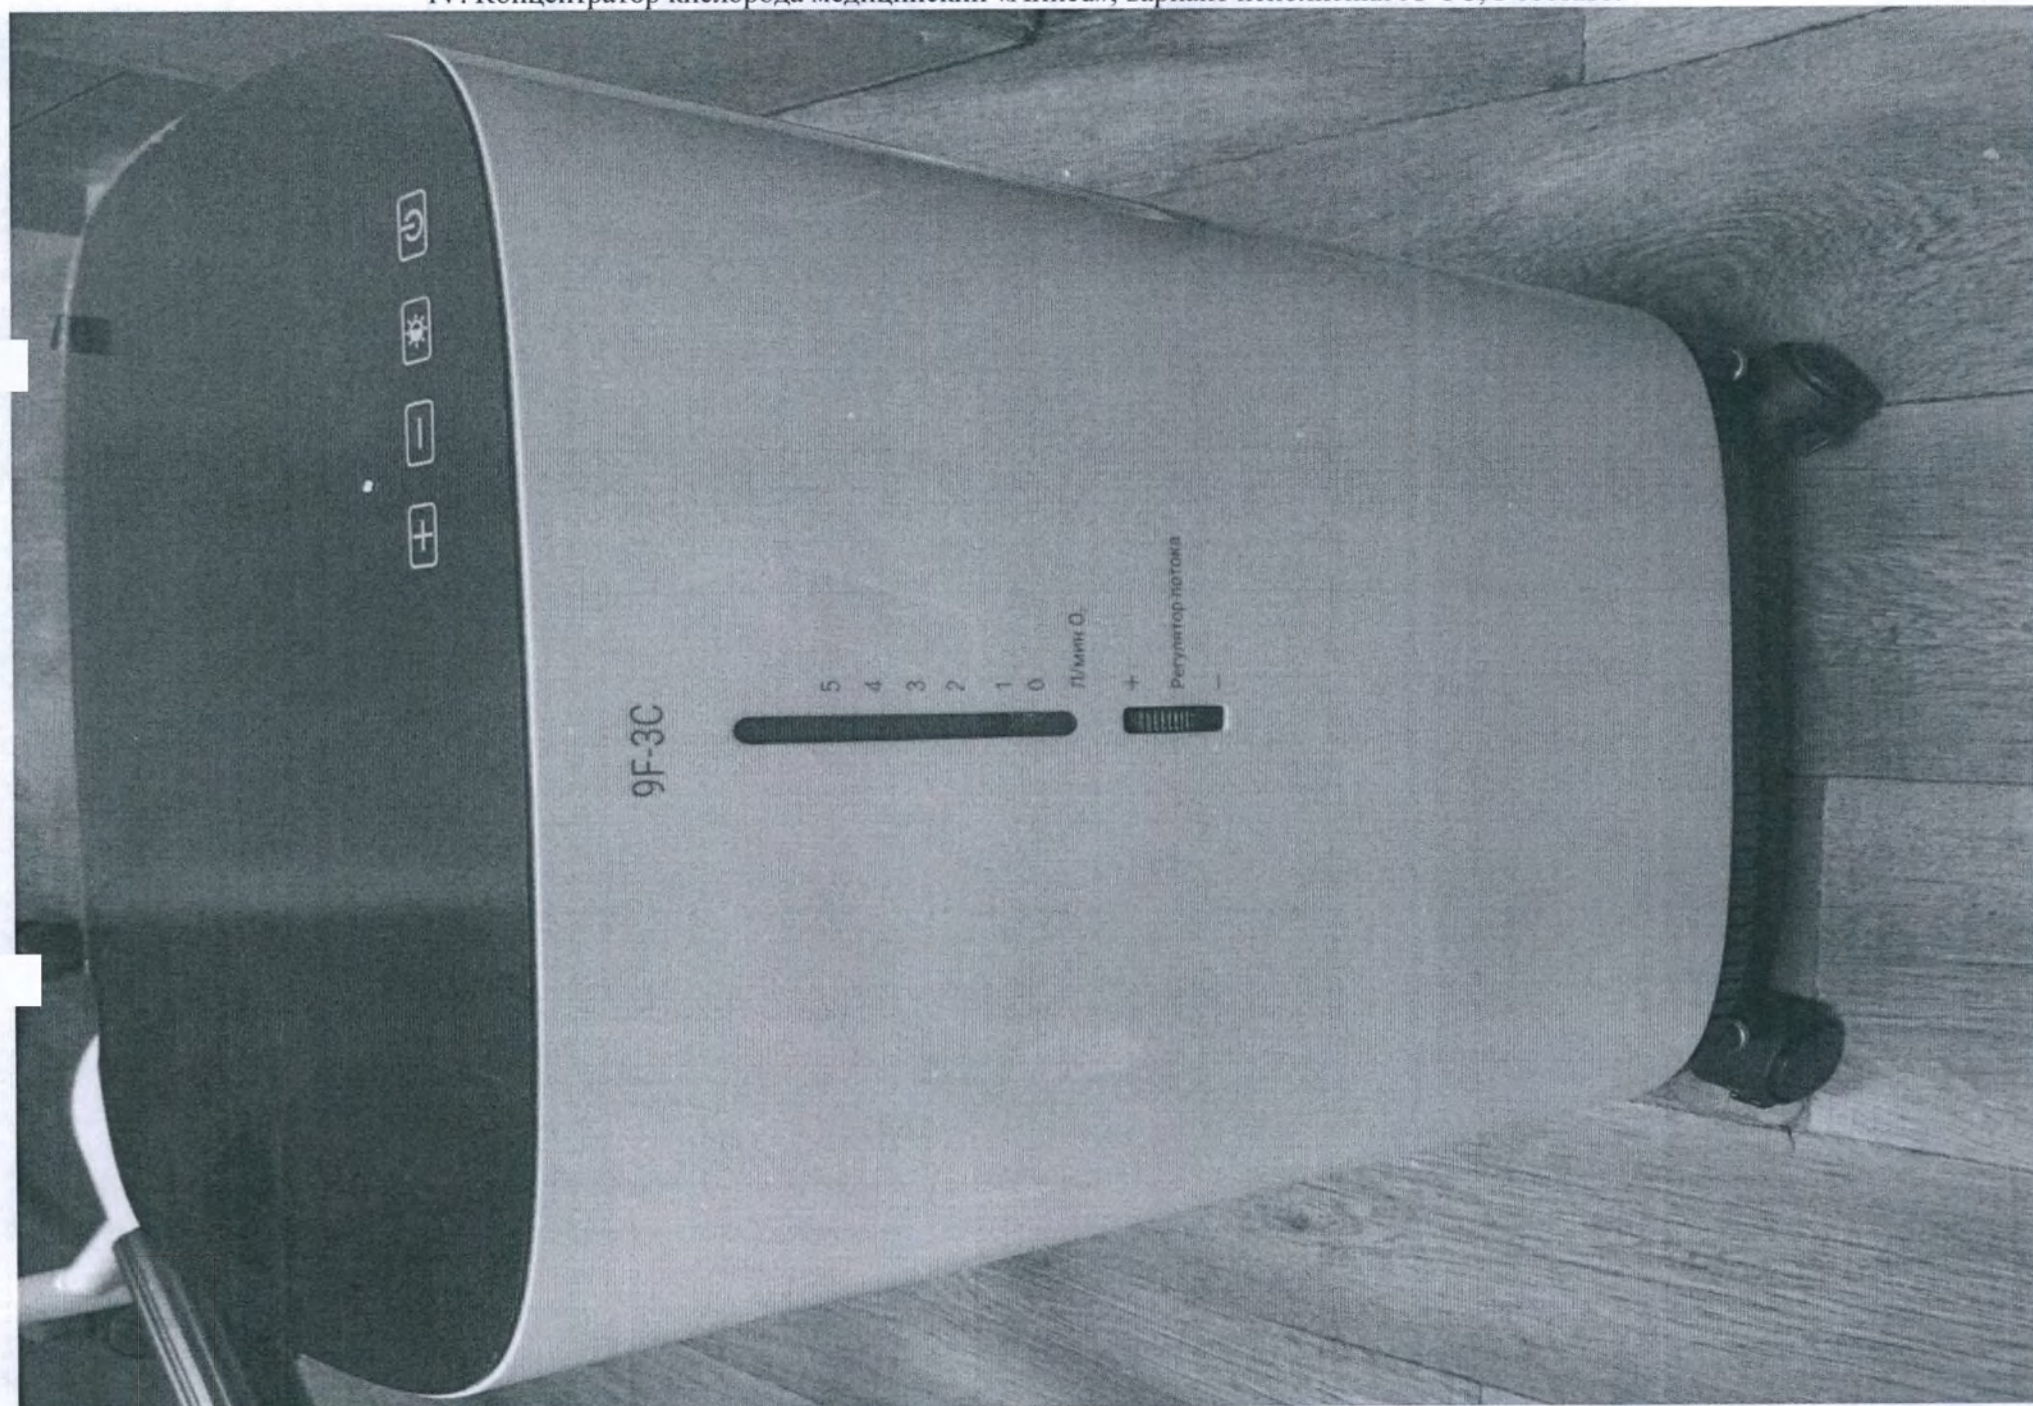


Рис. 20 – Концентратор кислорода

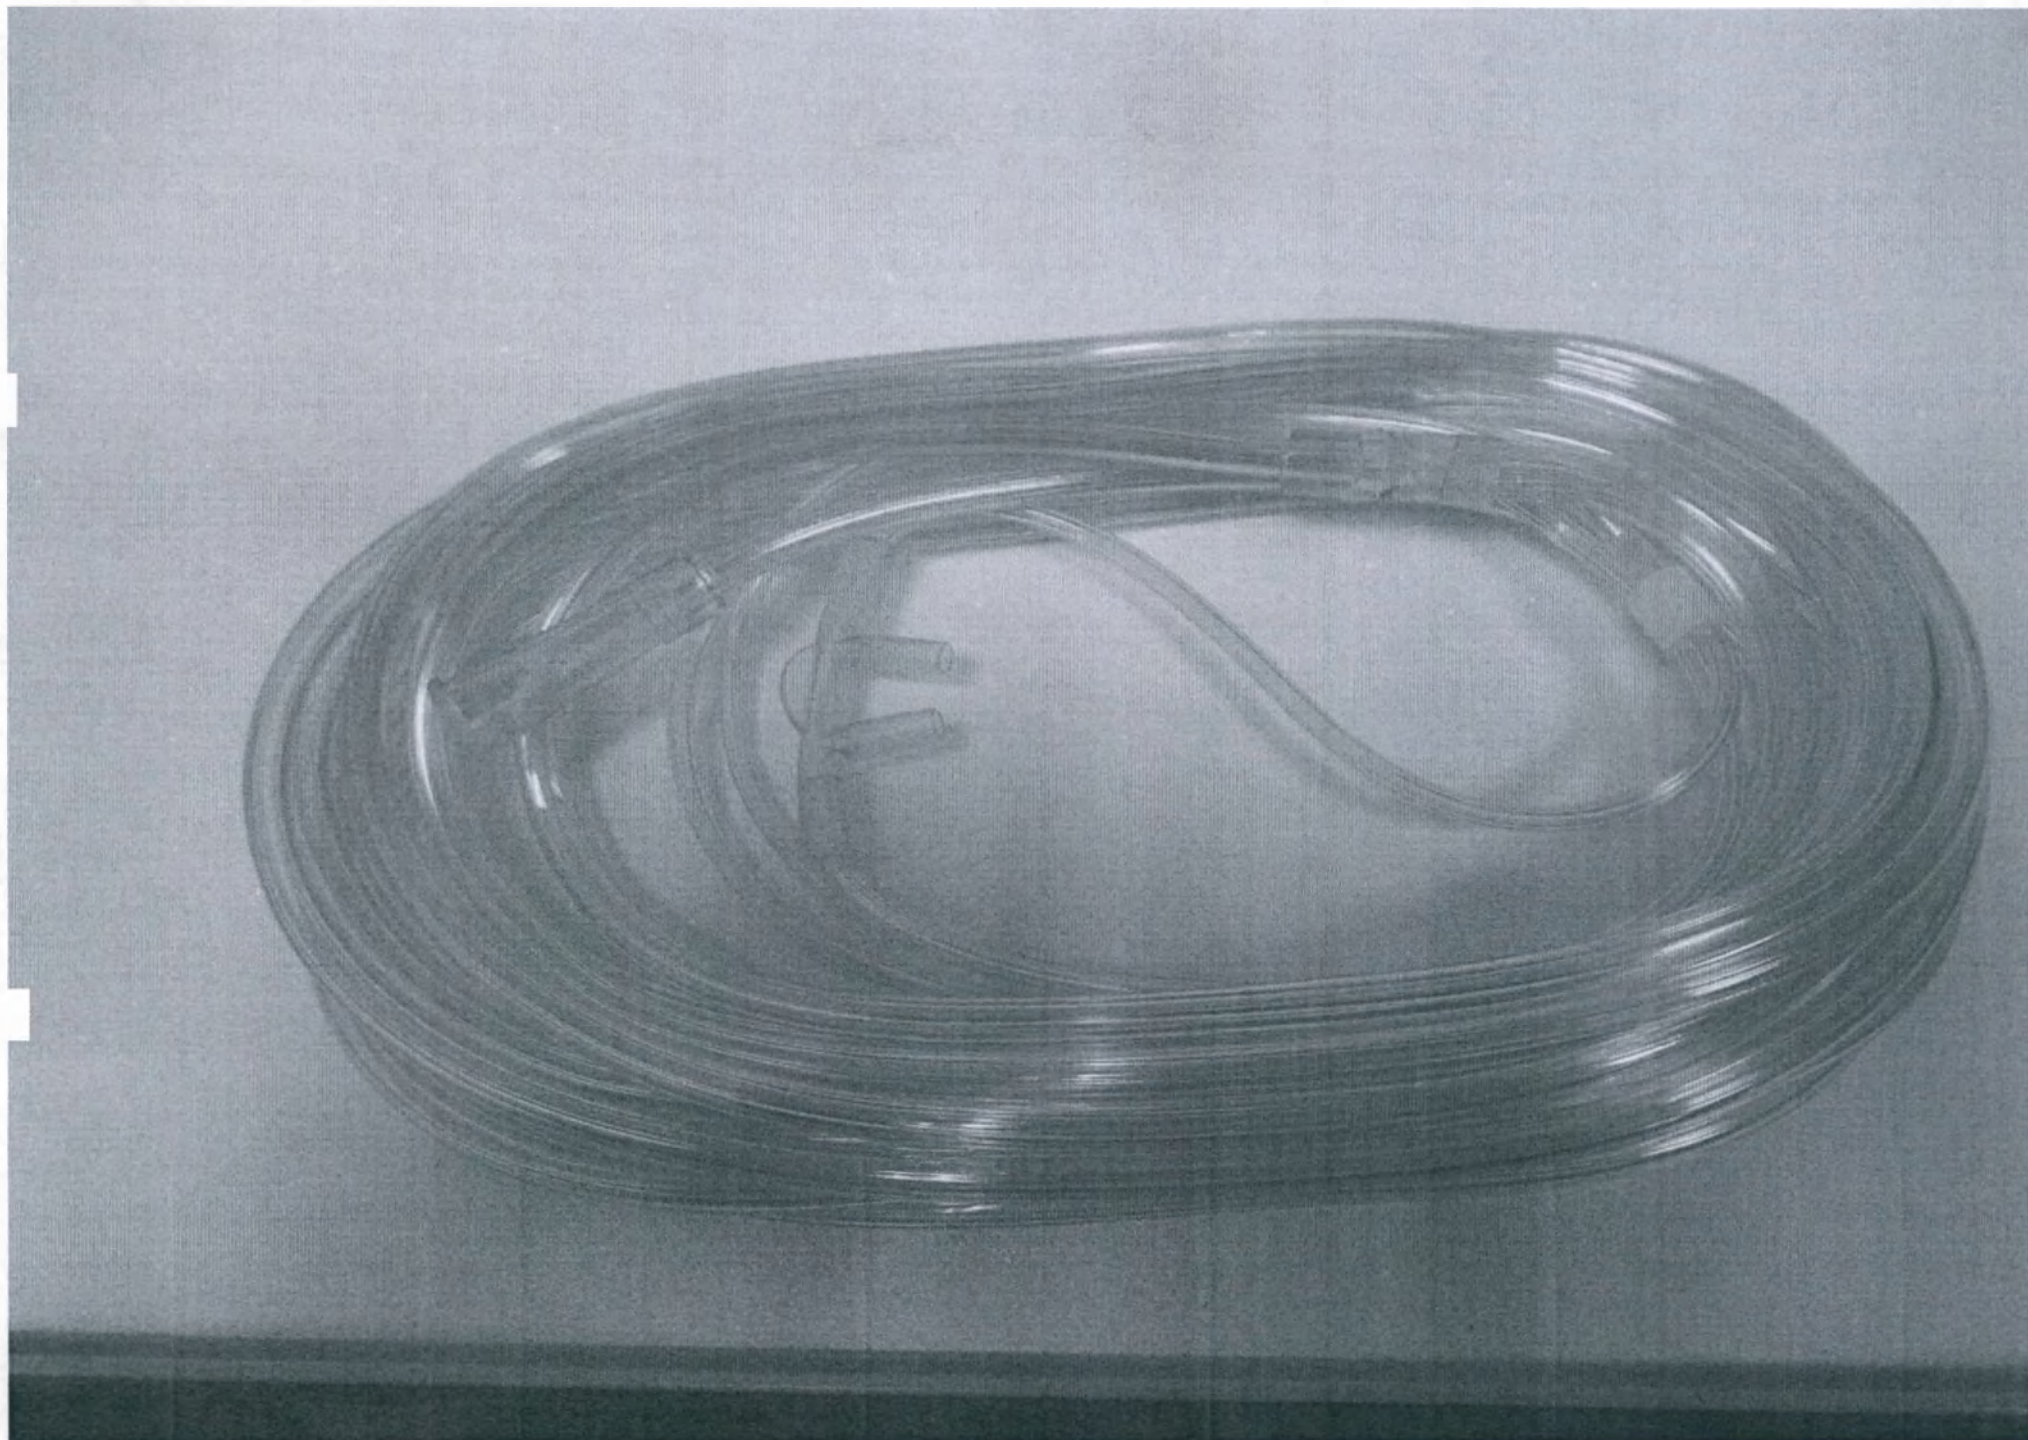


Рис. 21 – Канюля назальная большая

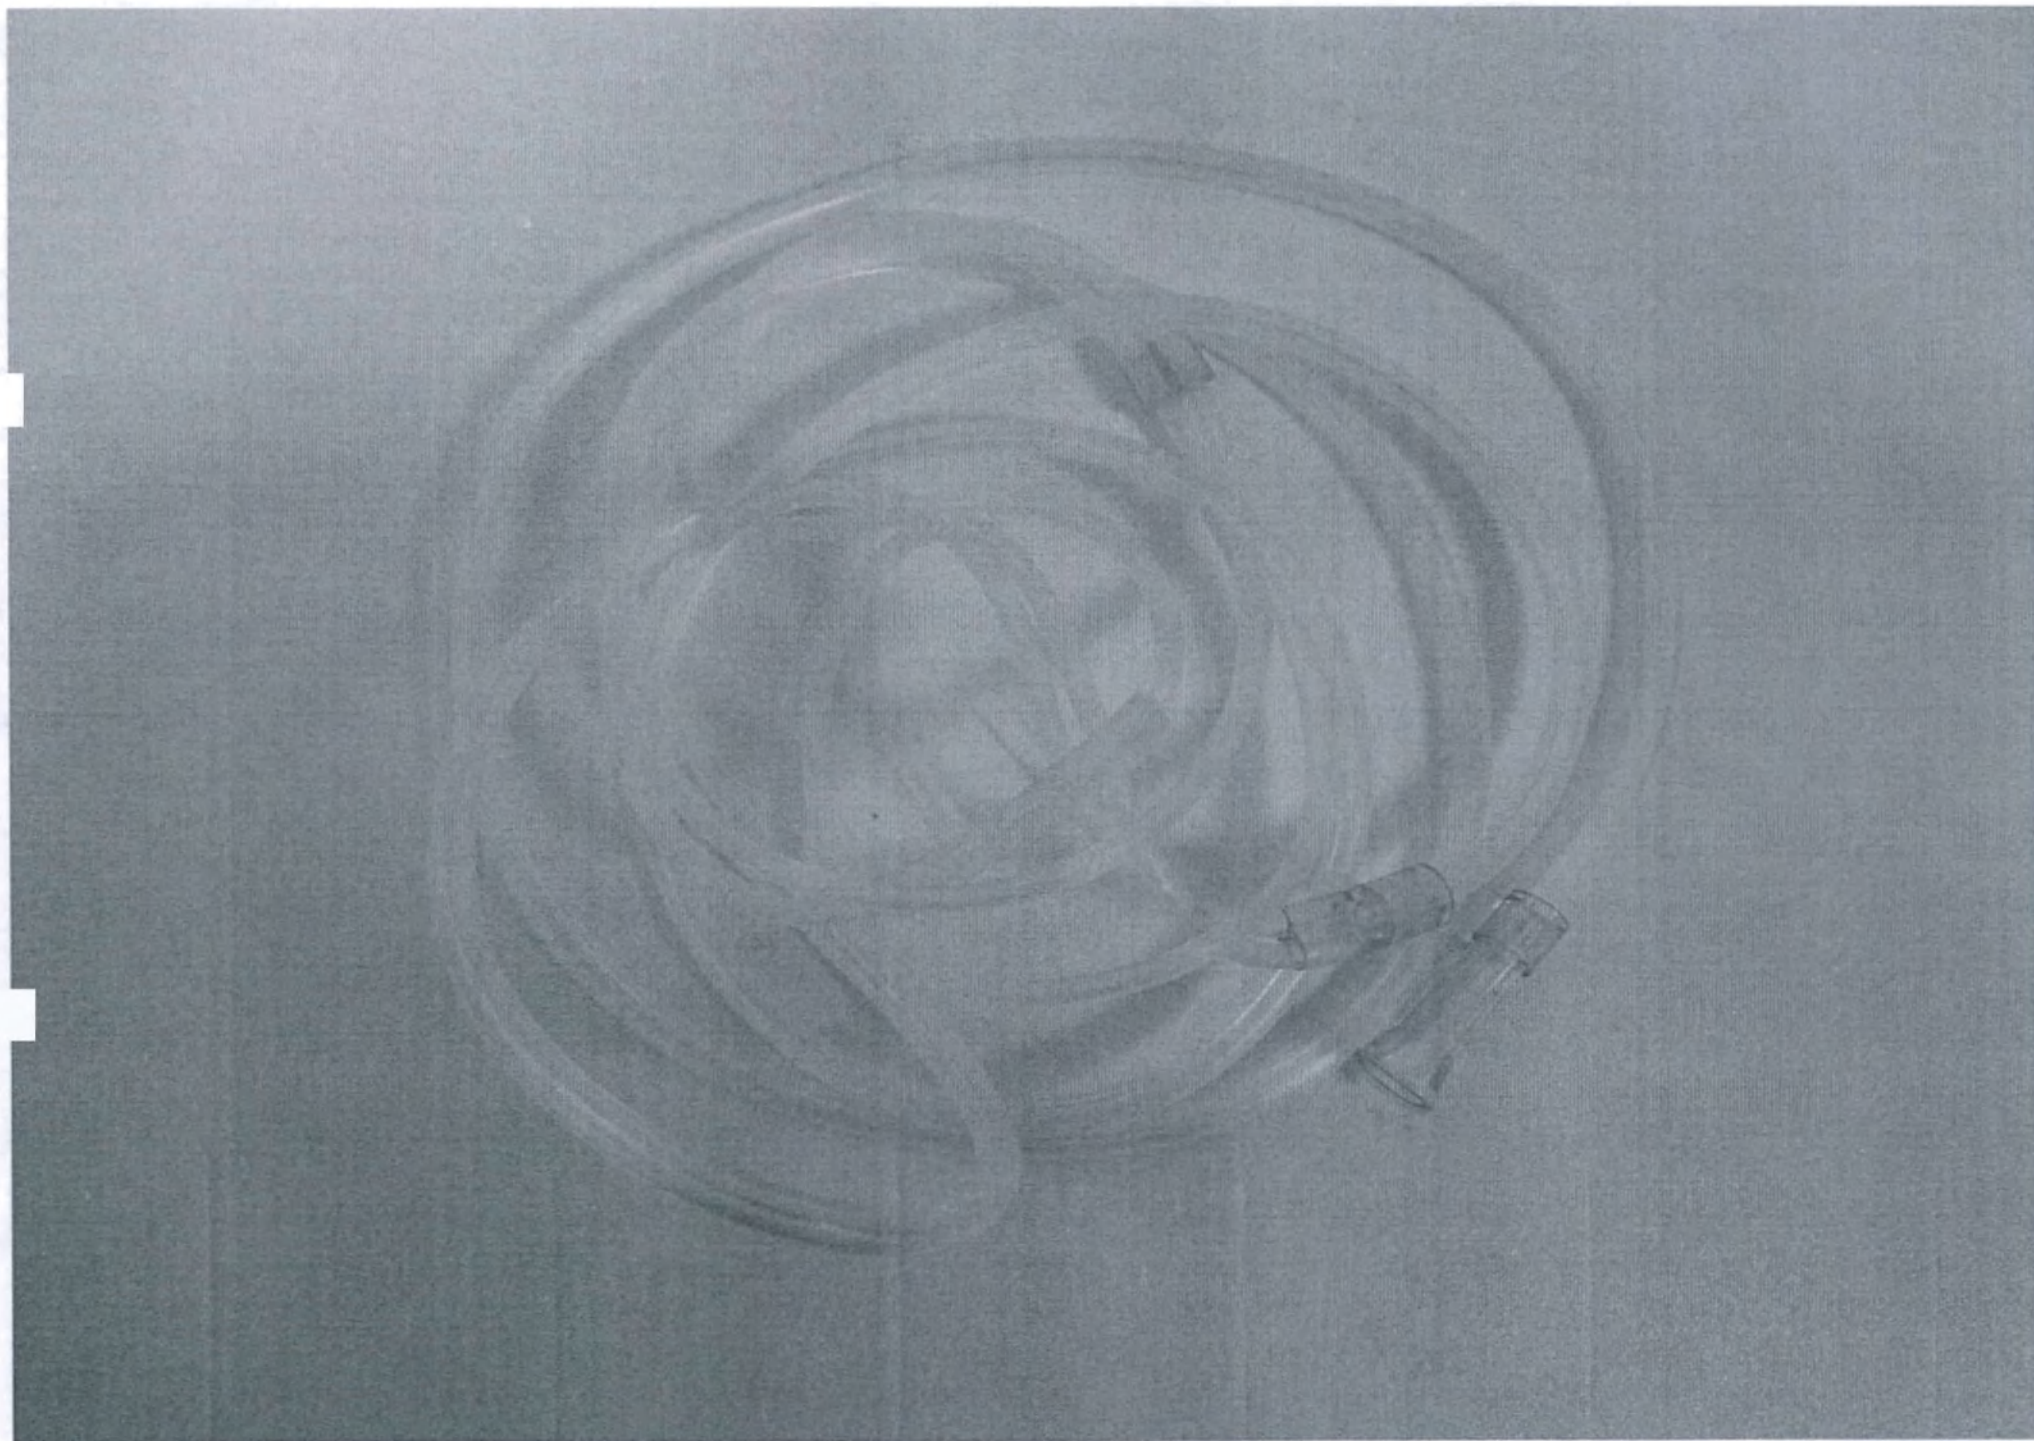


Рис. 22 – Канюля назальная малая



Рис. 23 – Диффузор (2 шт.)

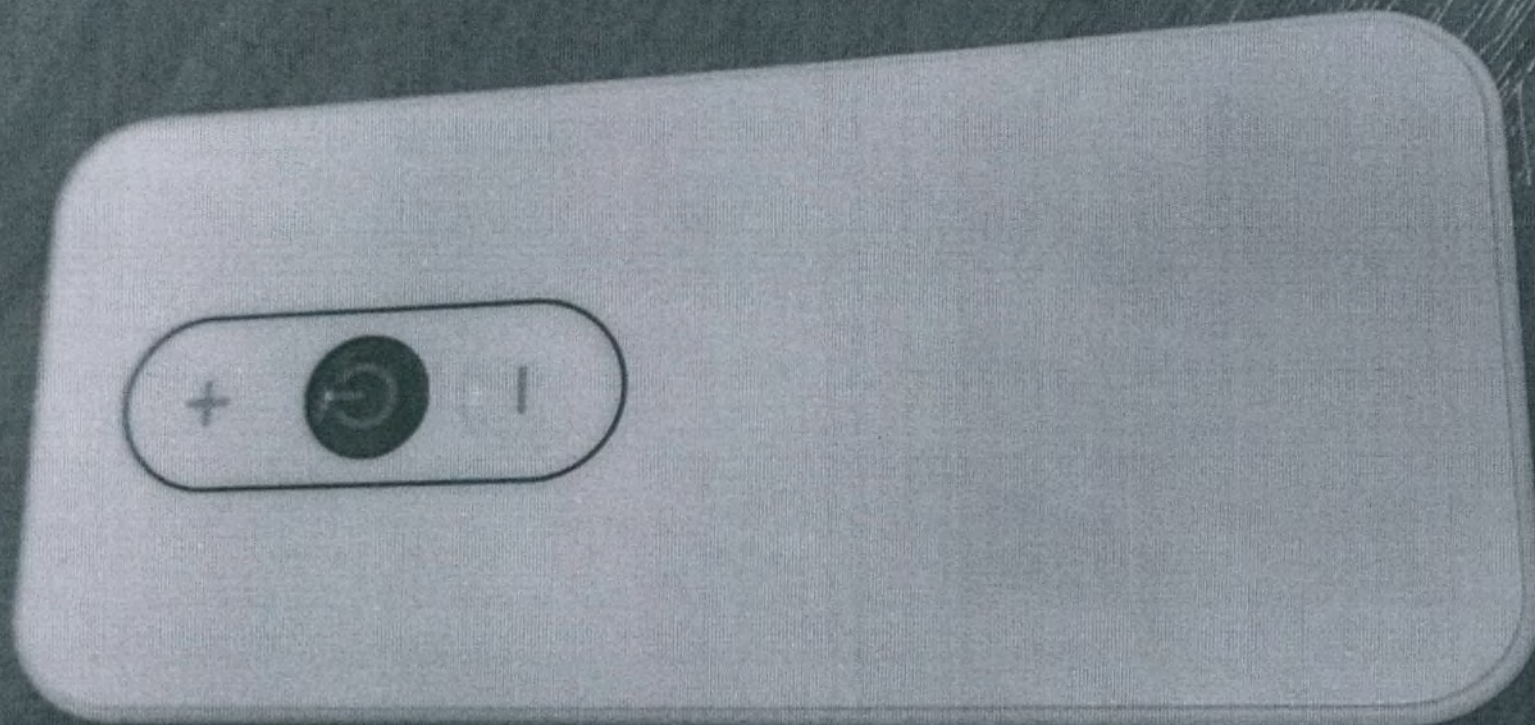


Рис. 24 – Пульт ДУ

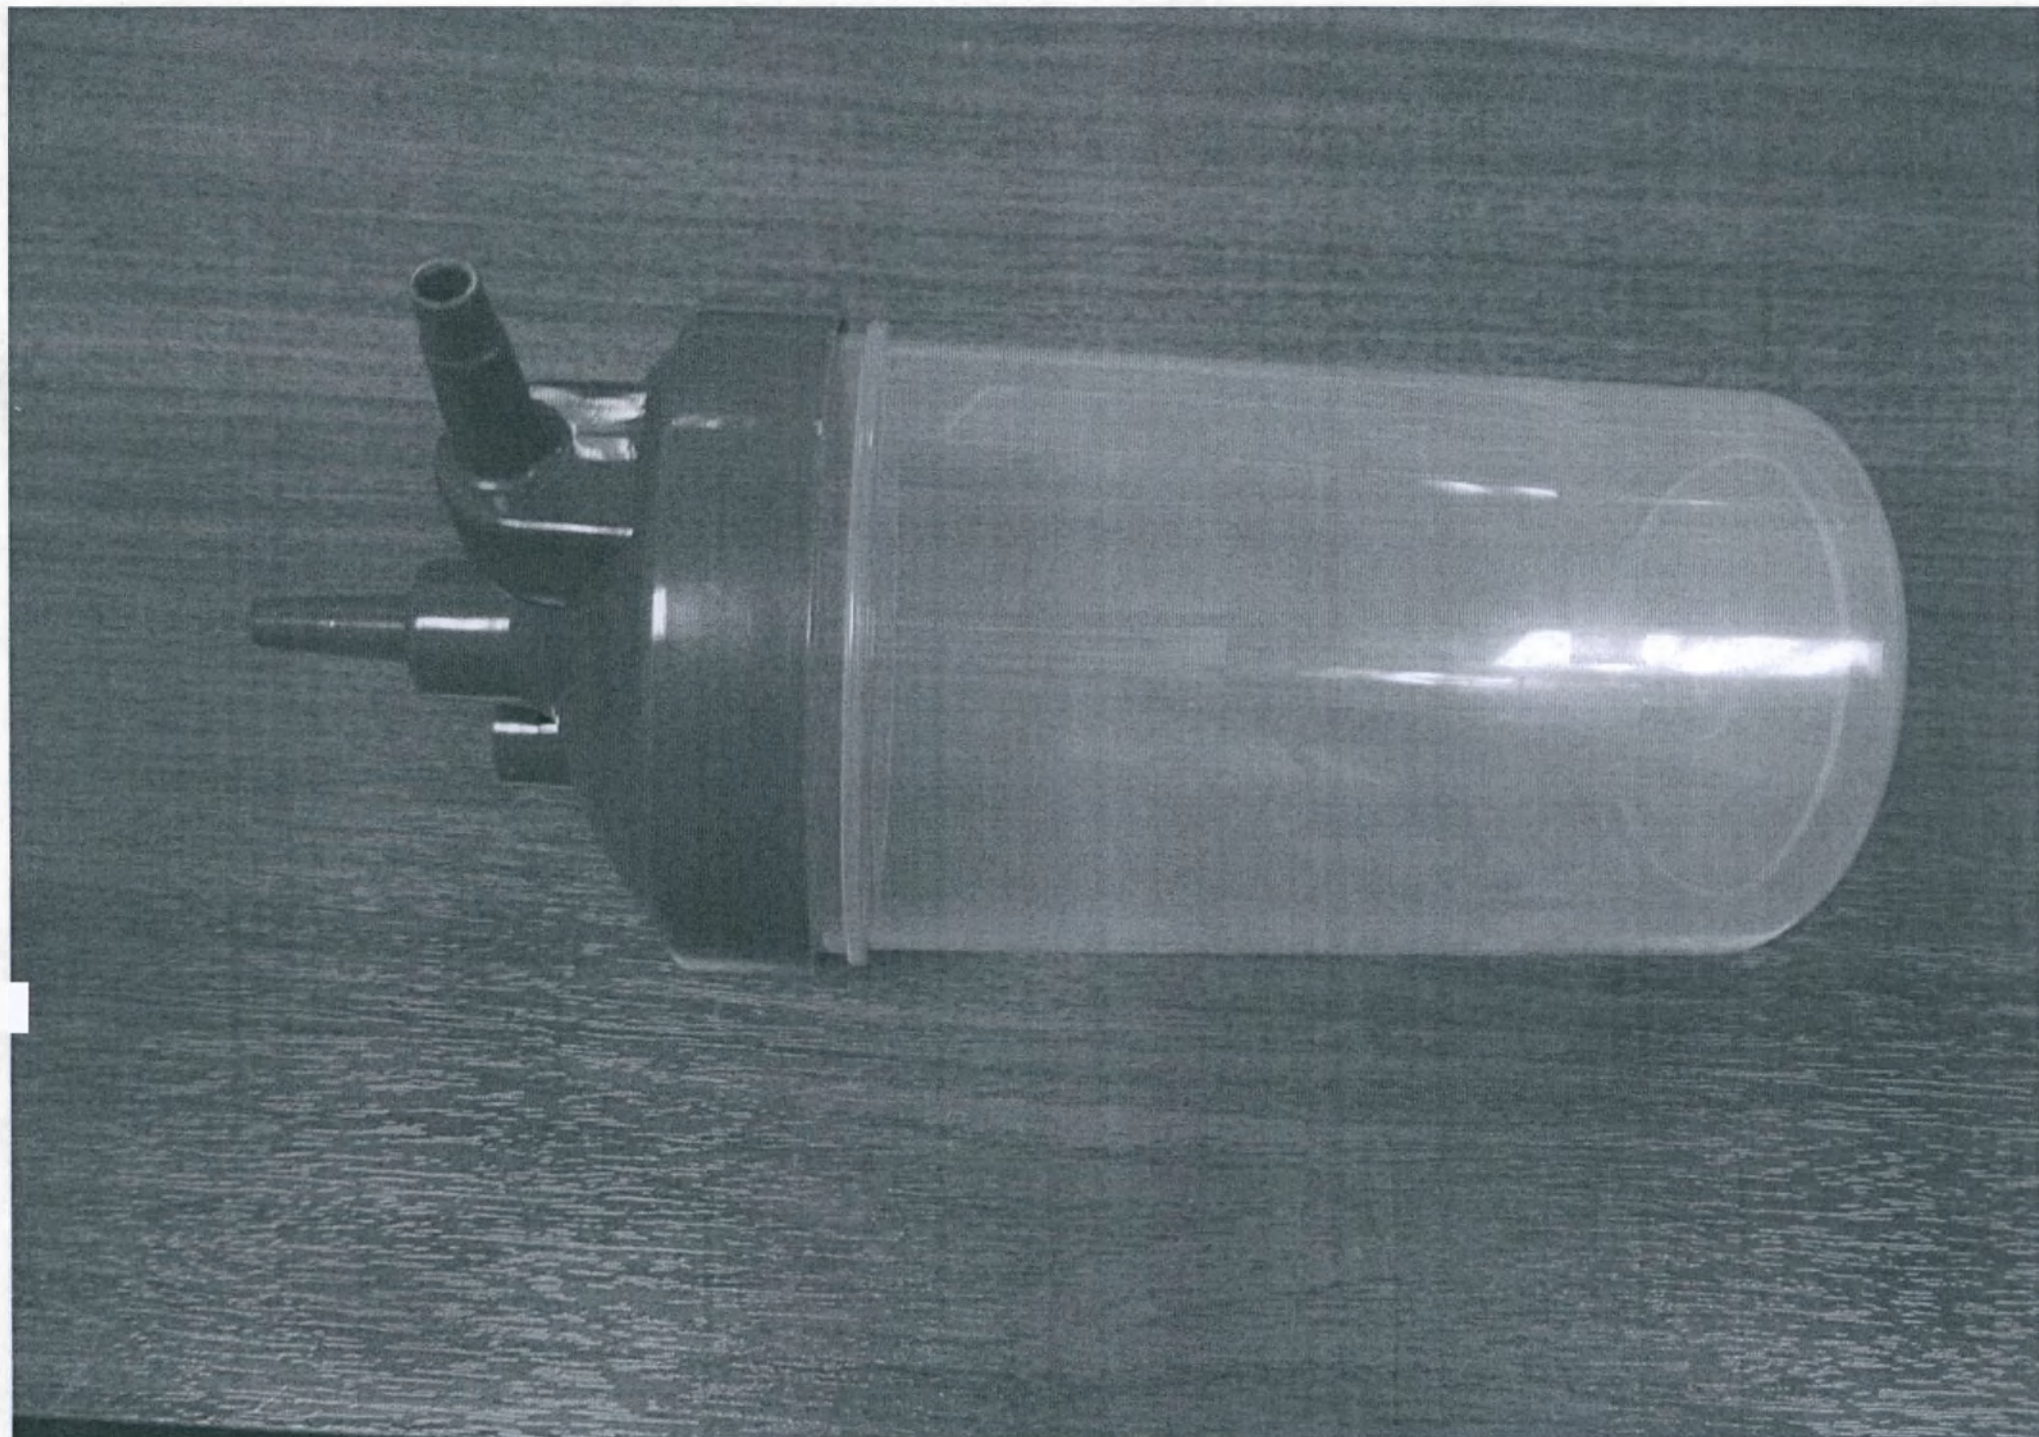


Рис. 25 – Увлажнитель

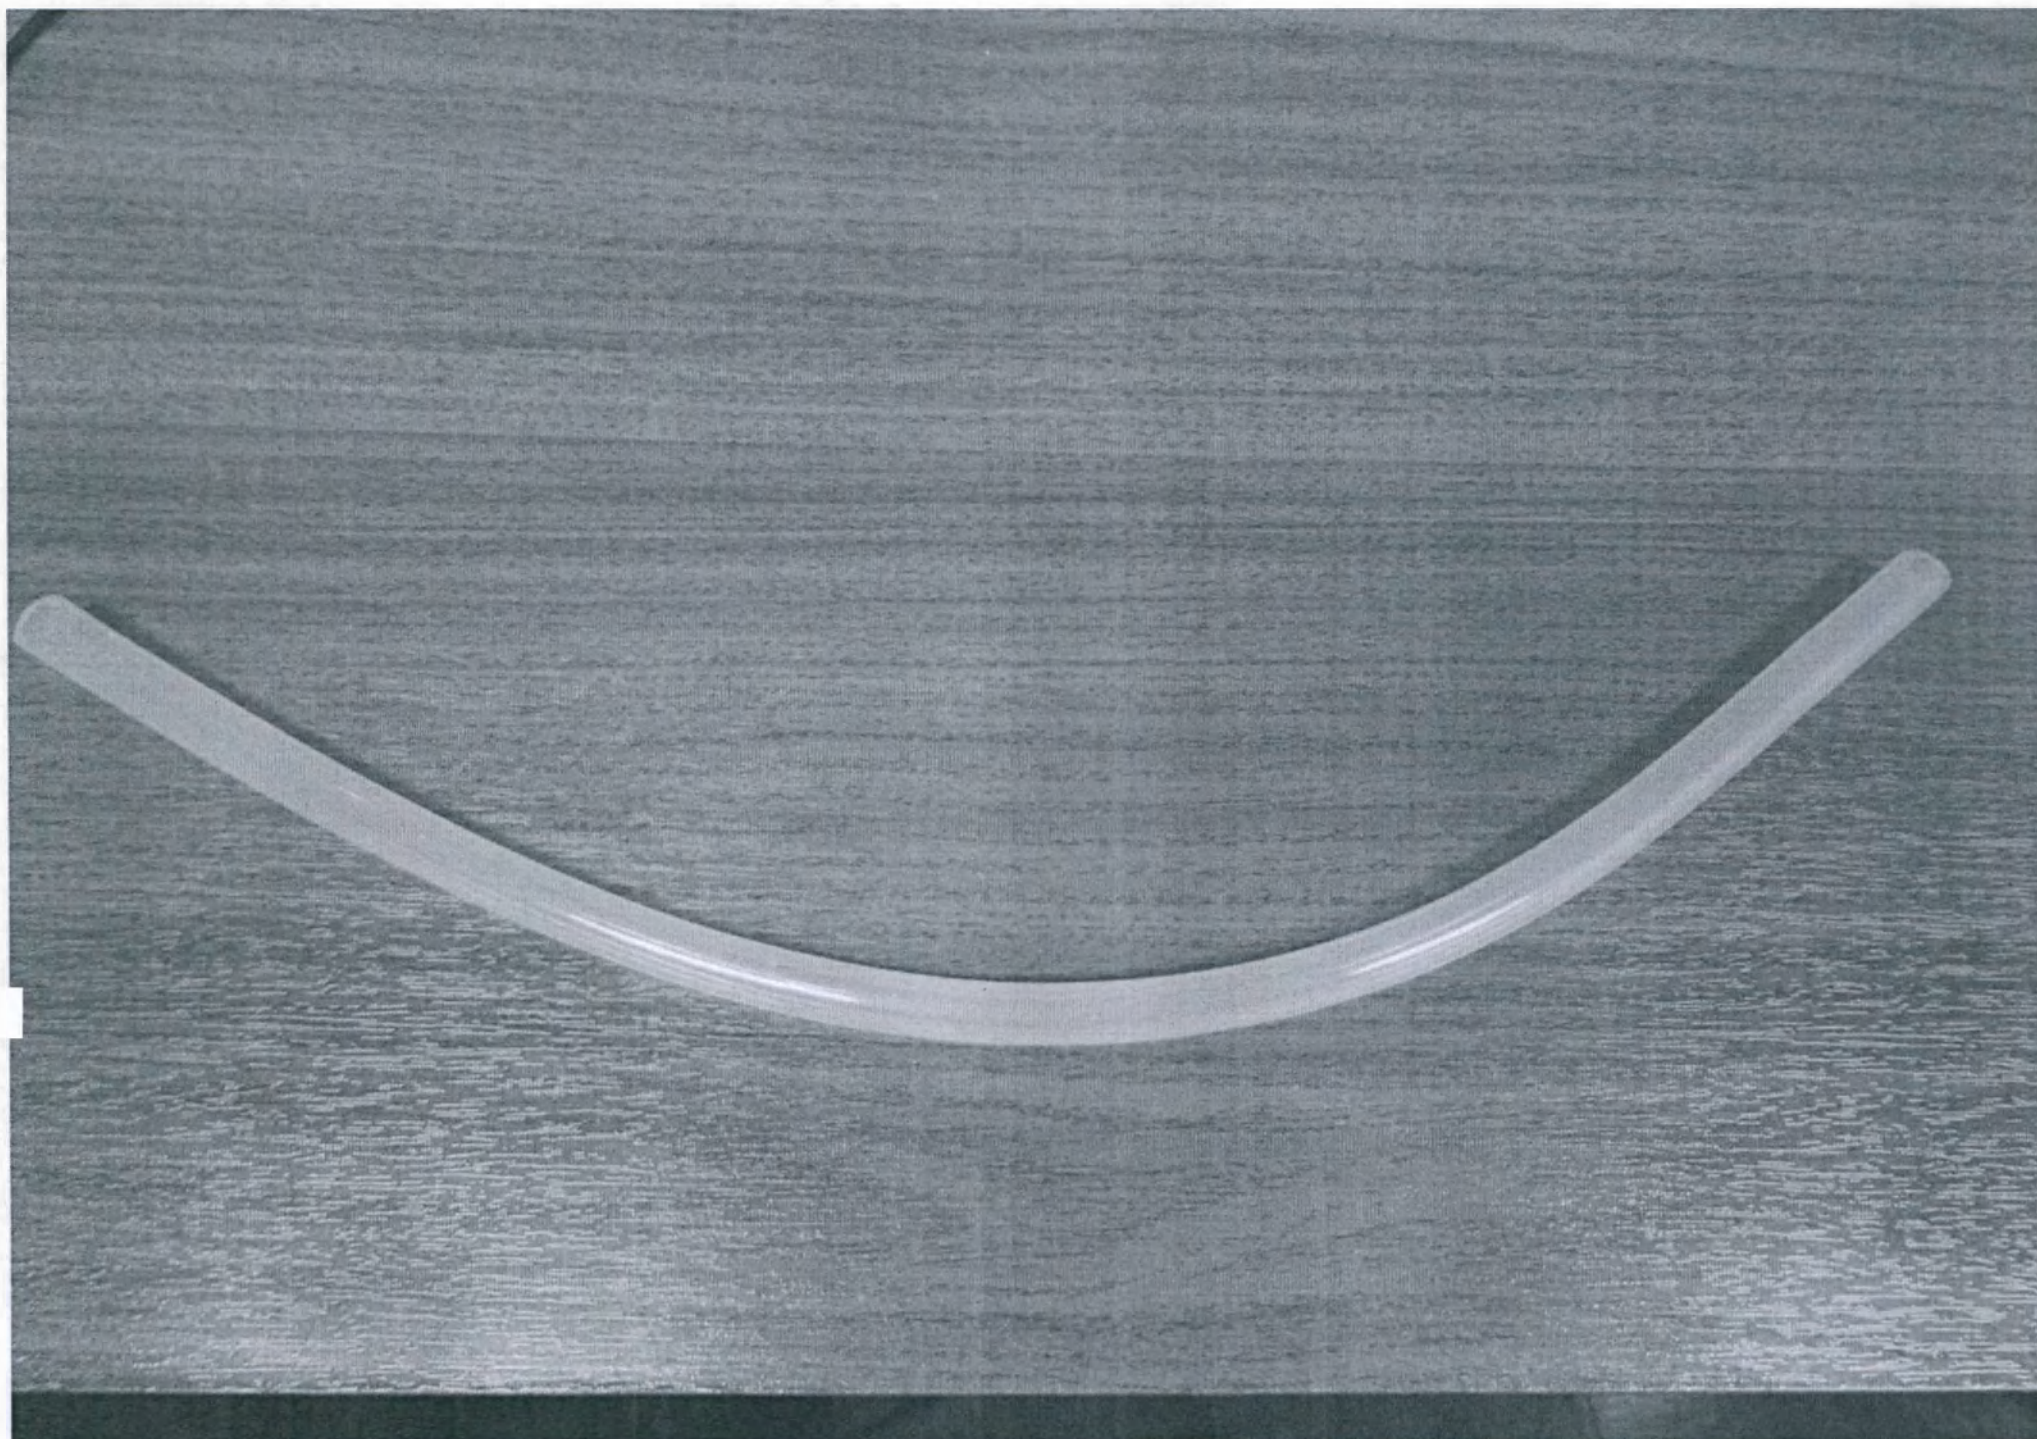


Рис. 26 – Шланг для увлажнителя

V. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 9F-3CW, в составе:

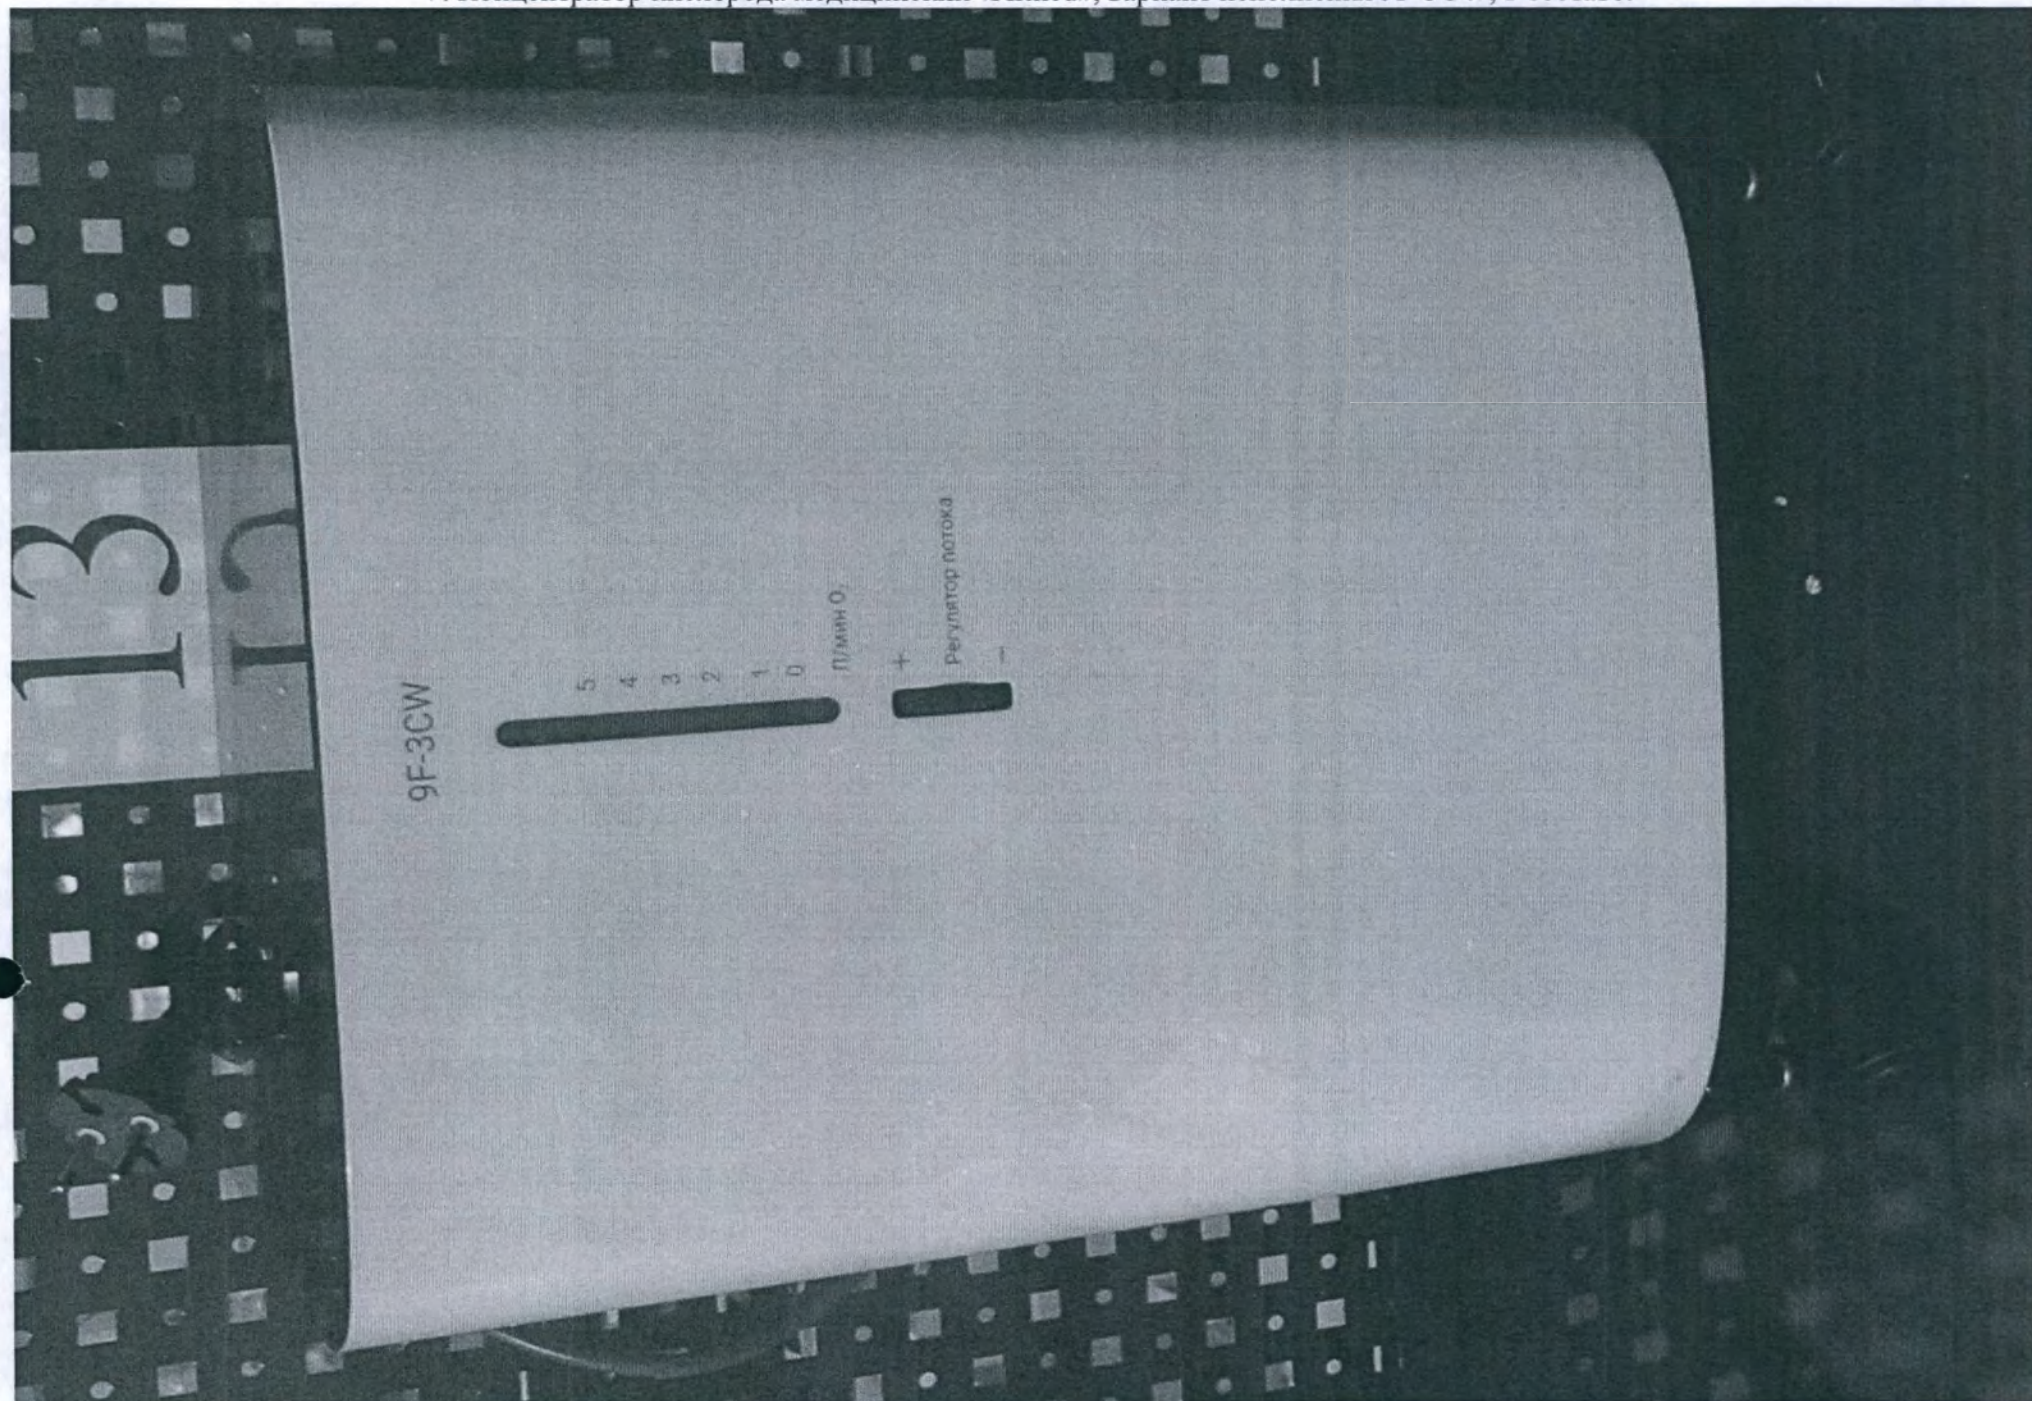


Рис. 27 – Концентратор кислорода

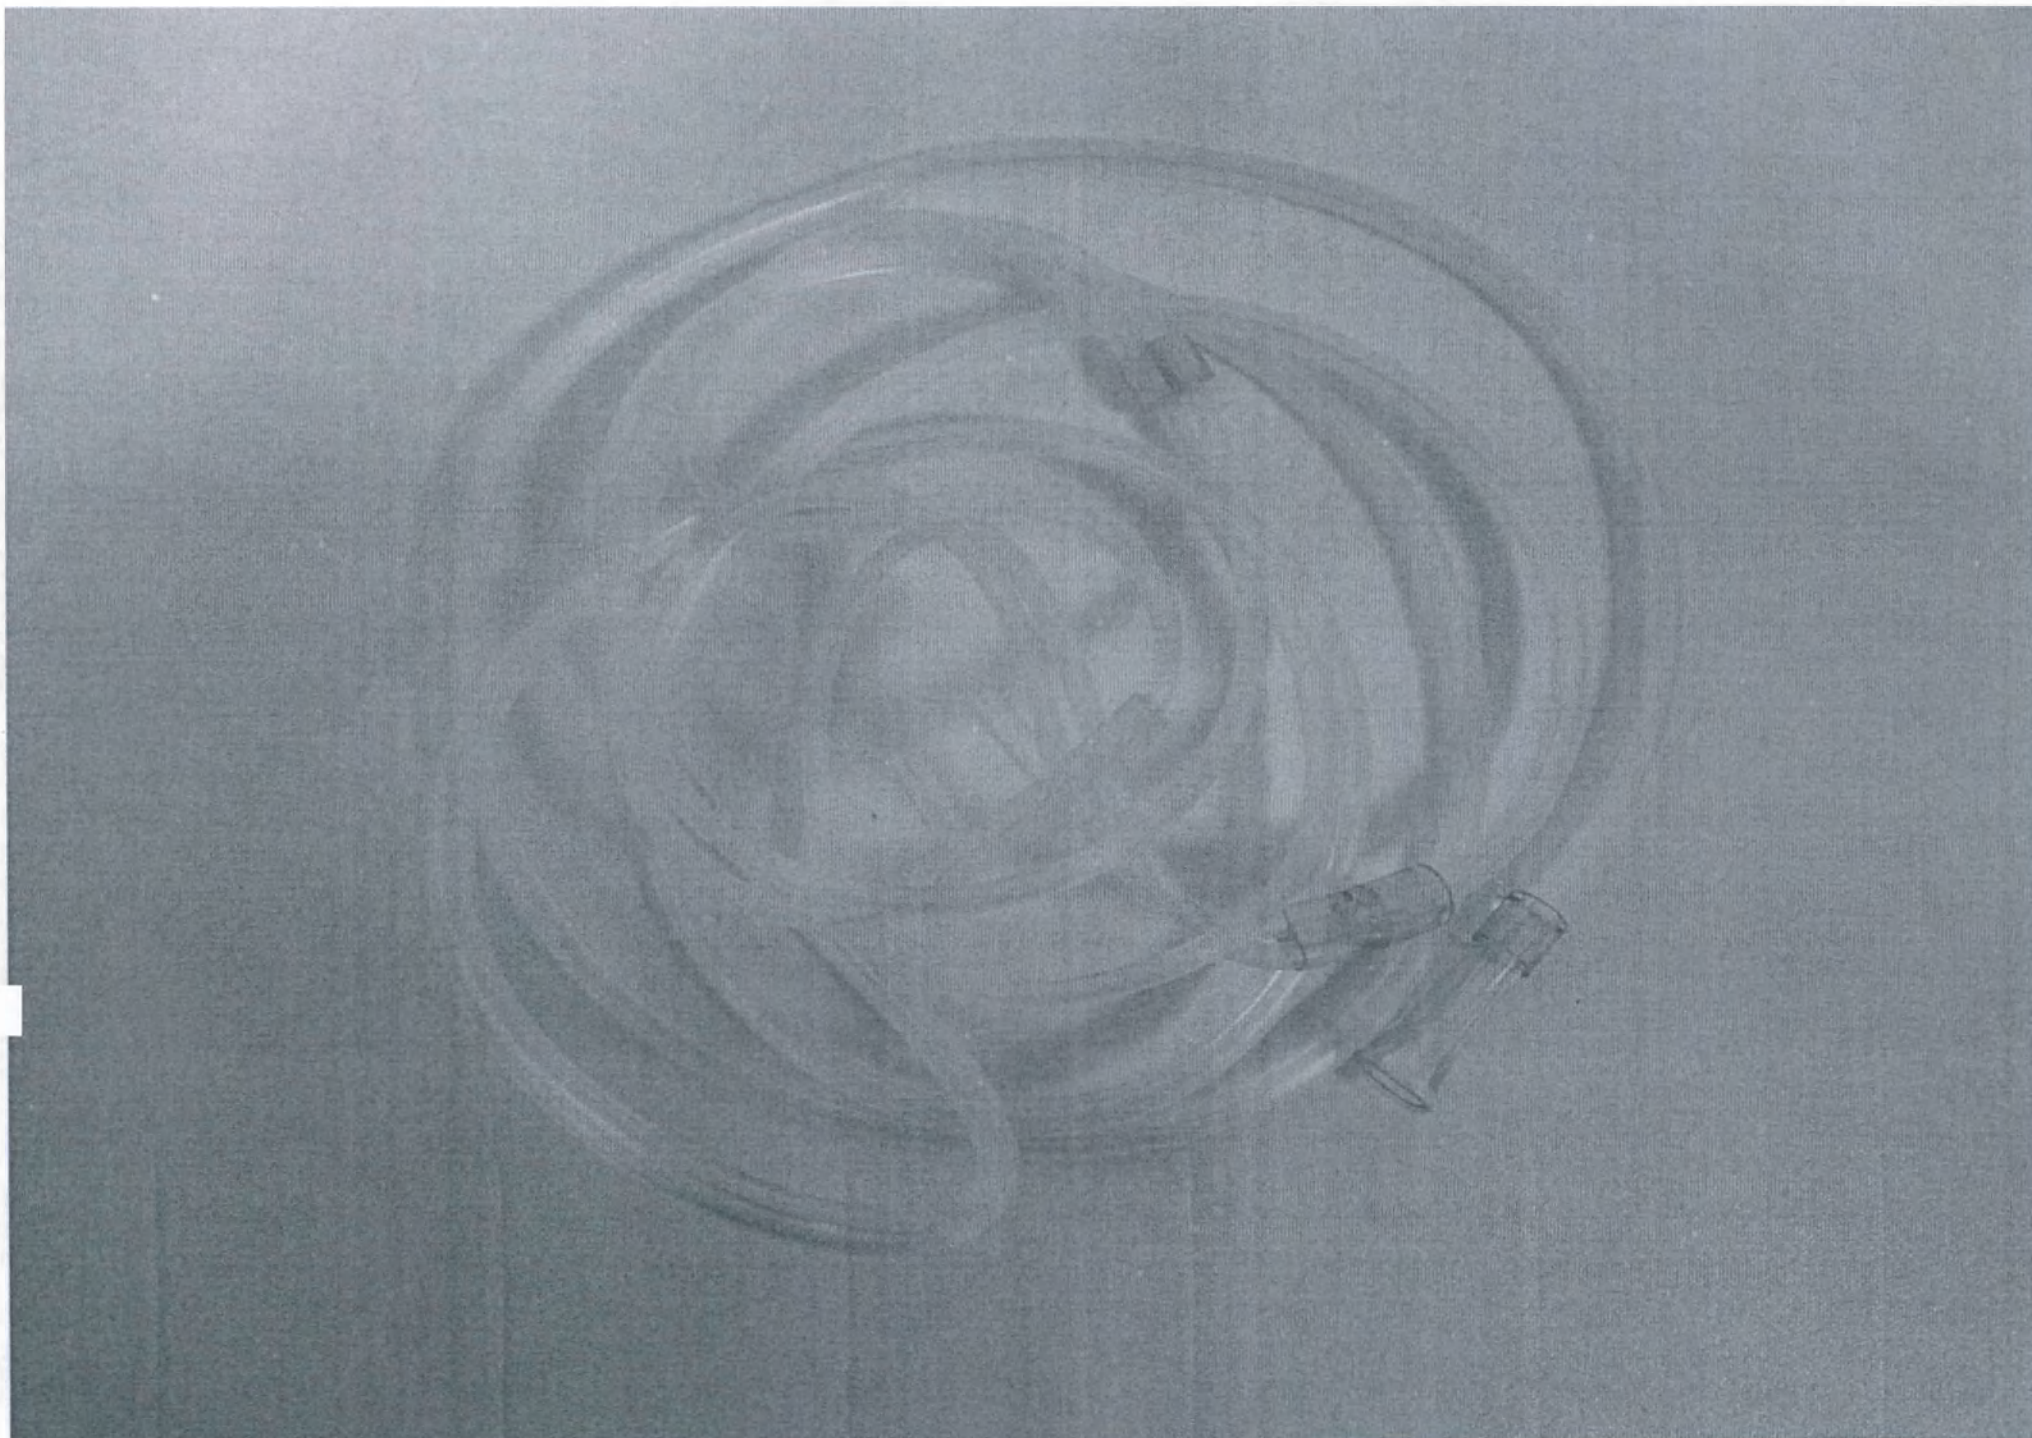


Рис. 28 – Канюля назальная малая



Рис. 29 – Пульт ДУ

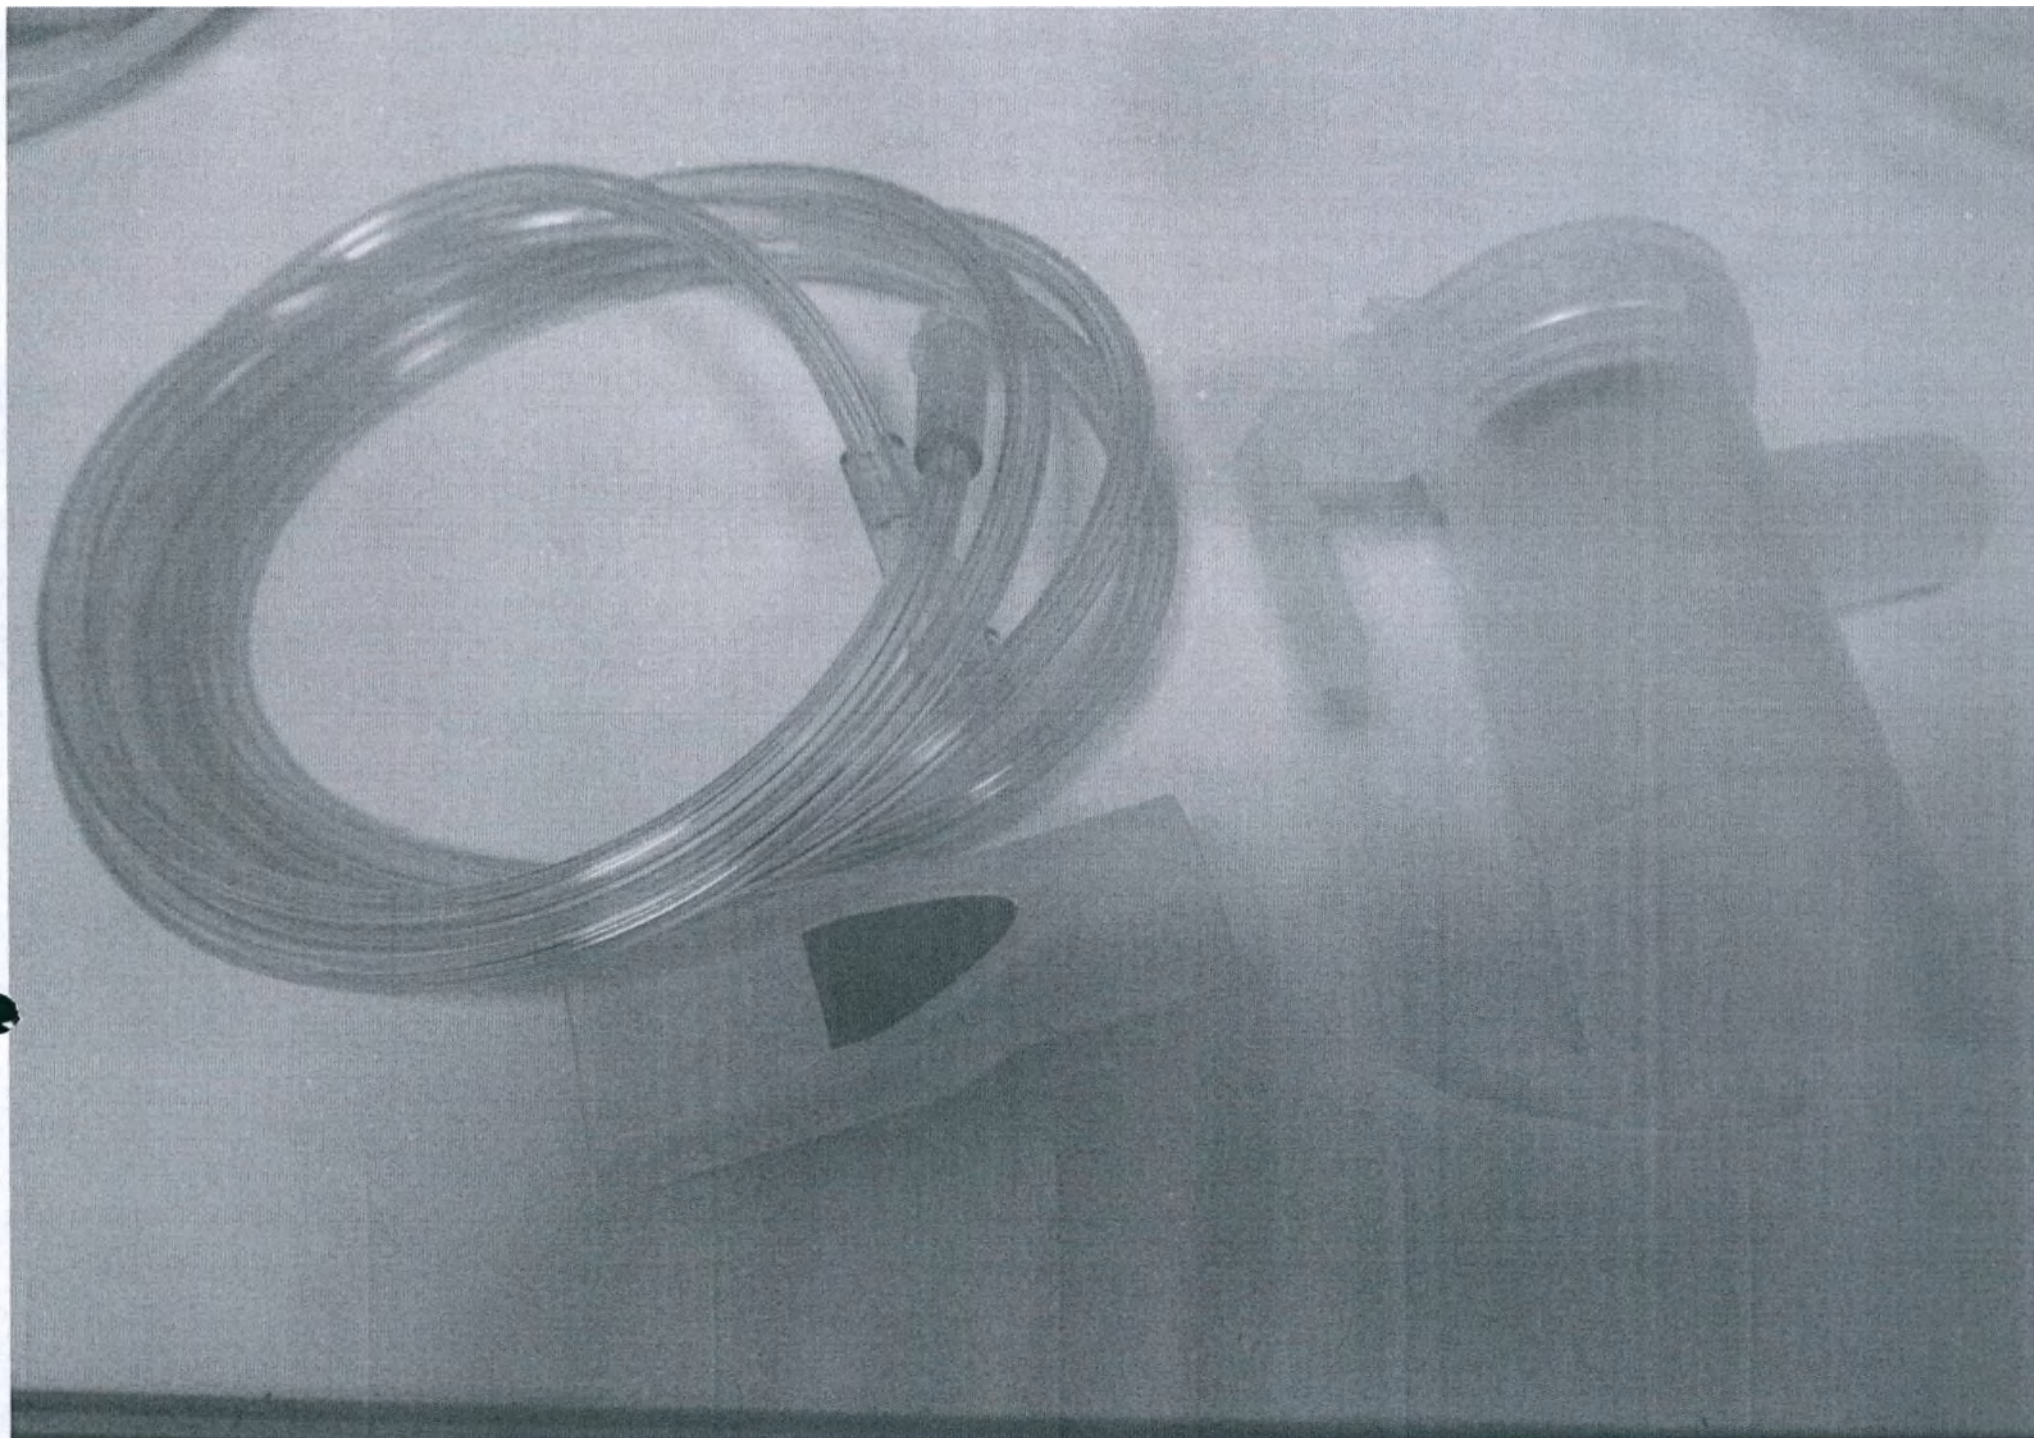


Рис. 30 – Комплект для ингаляции (тип I)



Рис. 31 – Увлажнитель

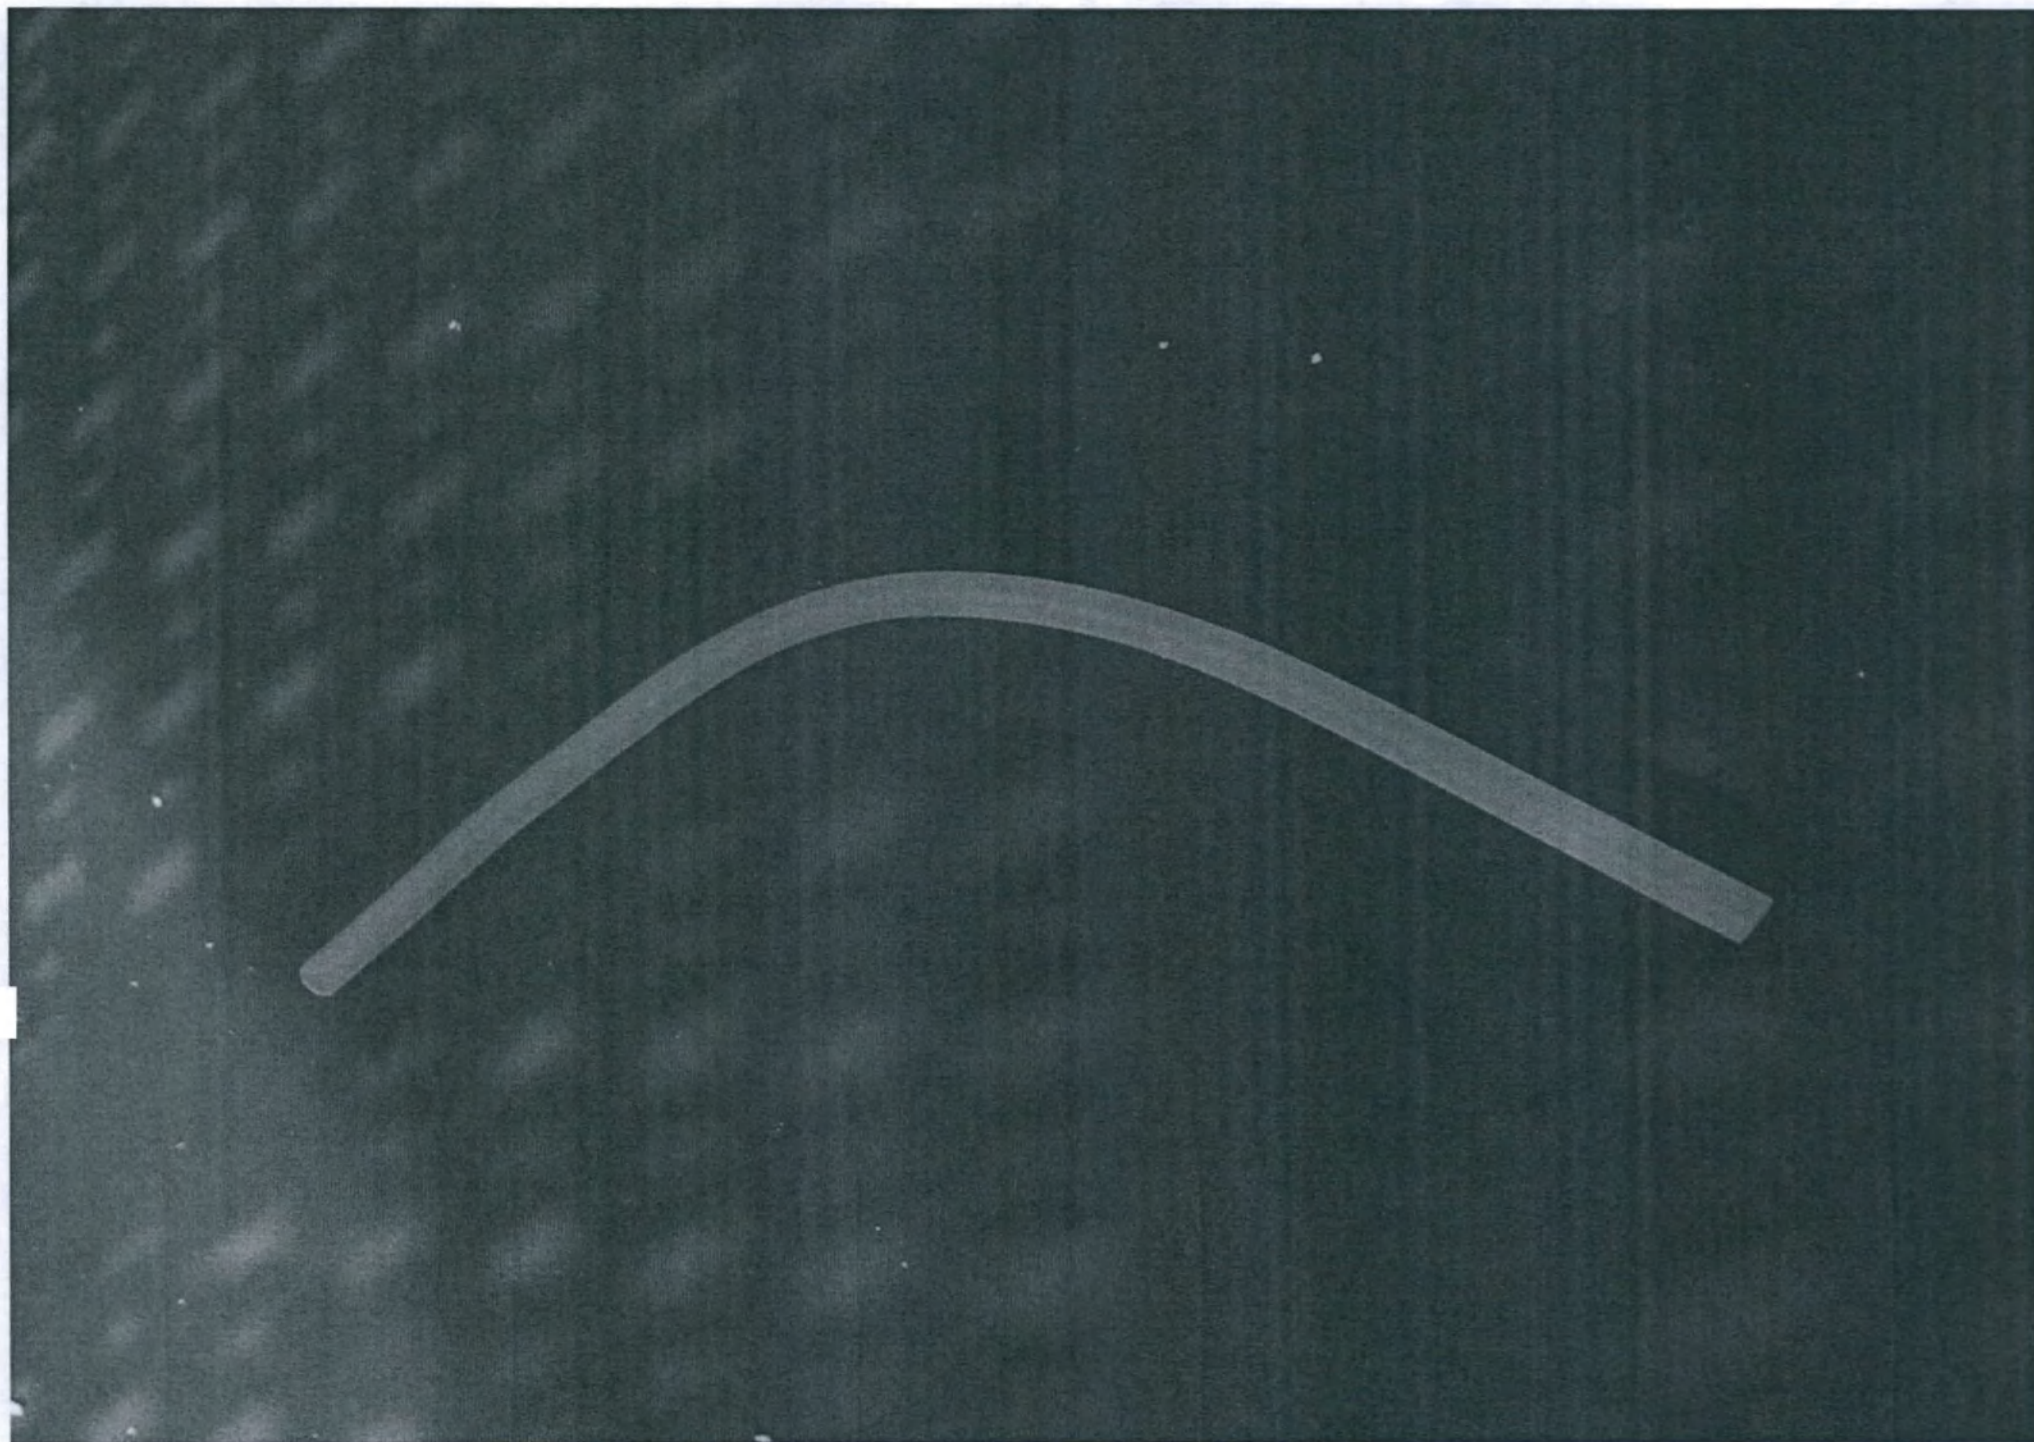


Рис. 32 – Шланг для увлажнителя

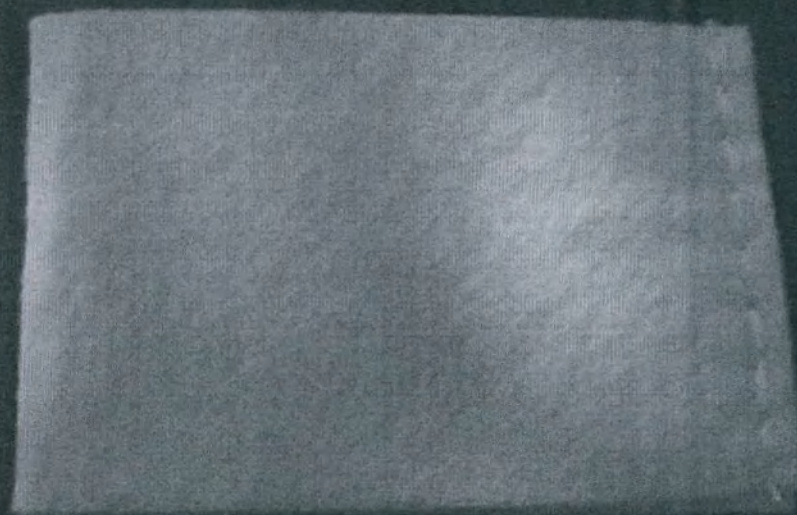


Рис. 33 – Фильтр тонкой очистки



Рис. 34 – Предохранитель плавкий T5AL250V (2 шт.)

VI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 8F-3Z, в составе:

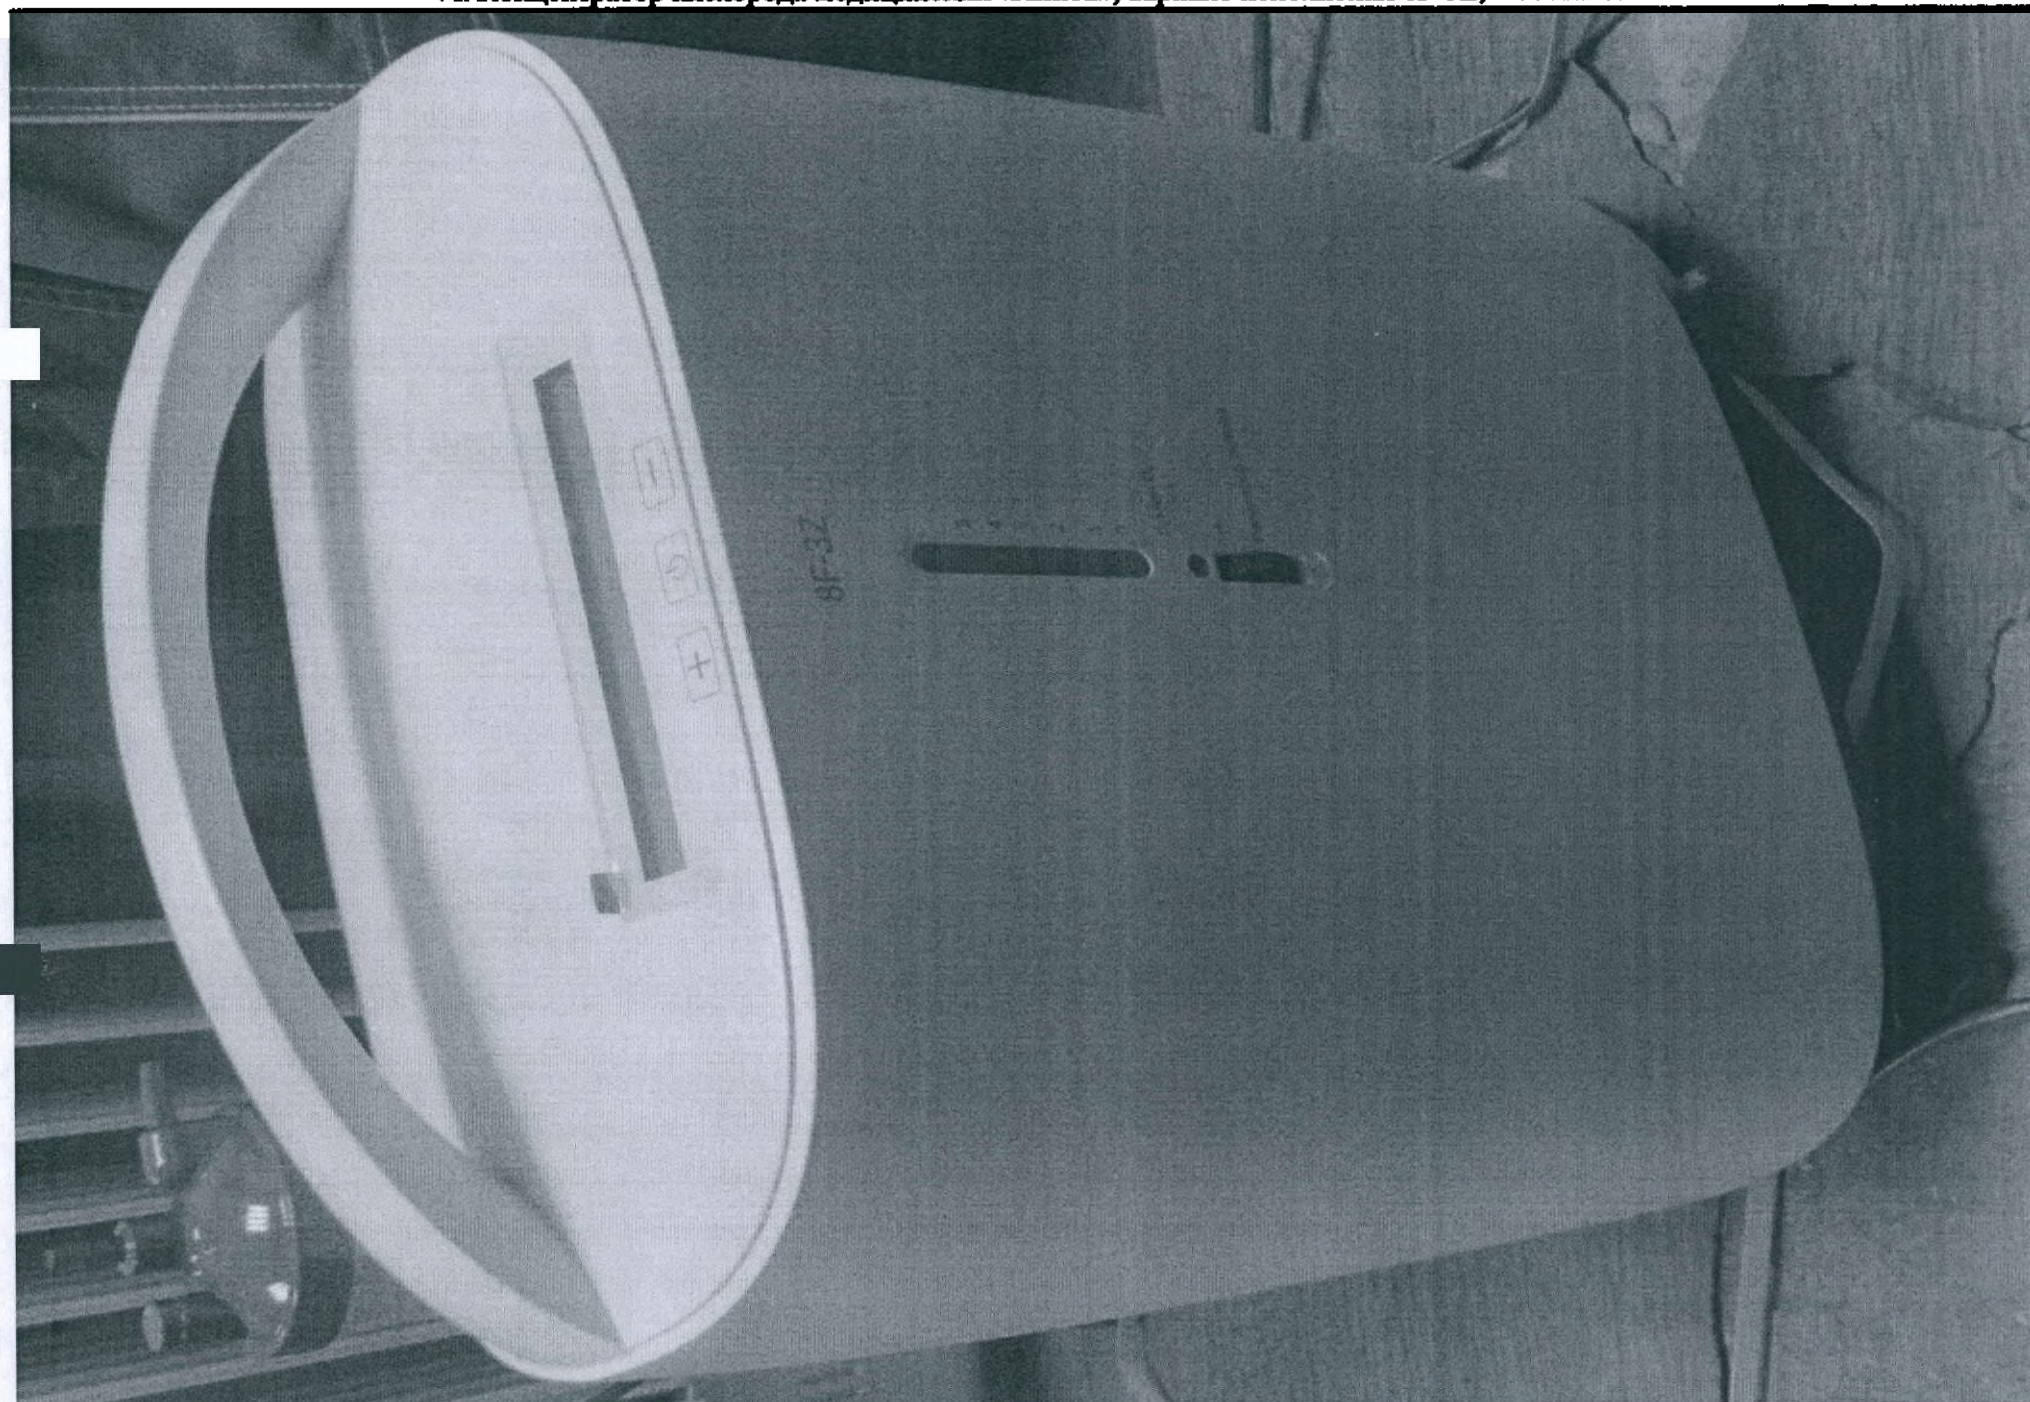


Рис. 35 – Концентратор кислорода

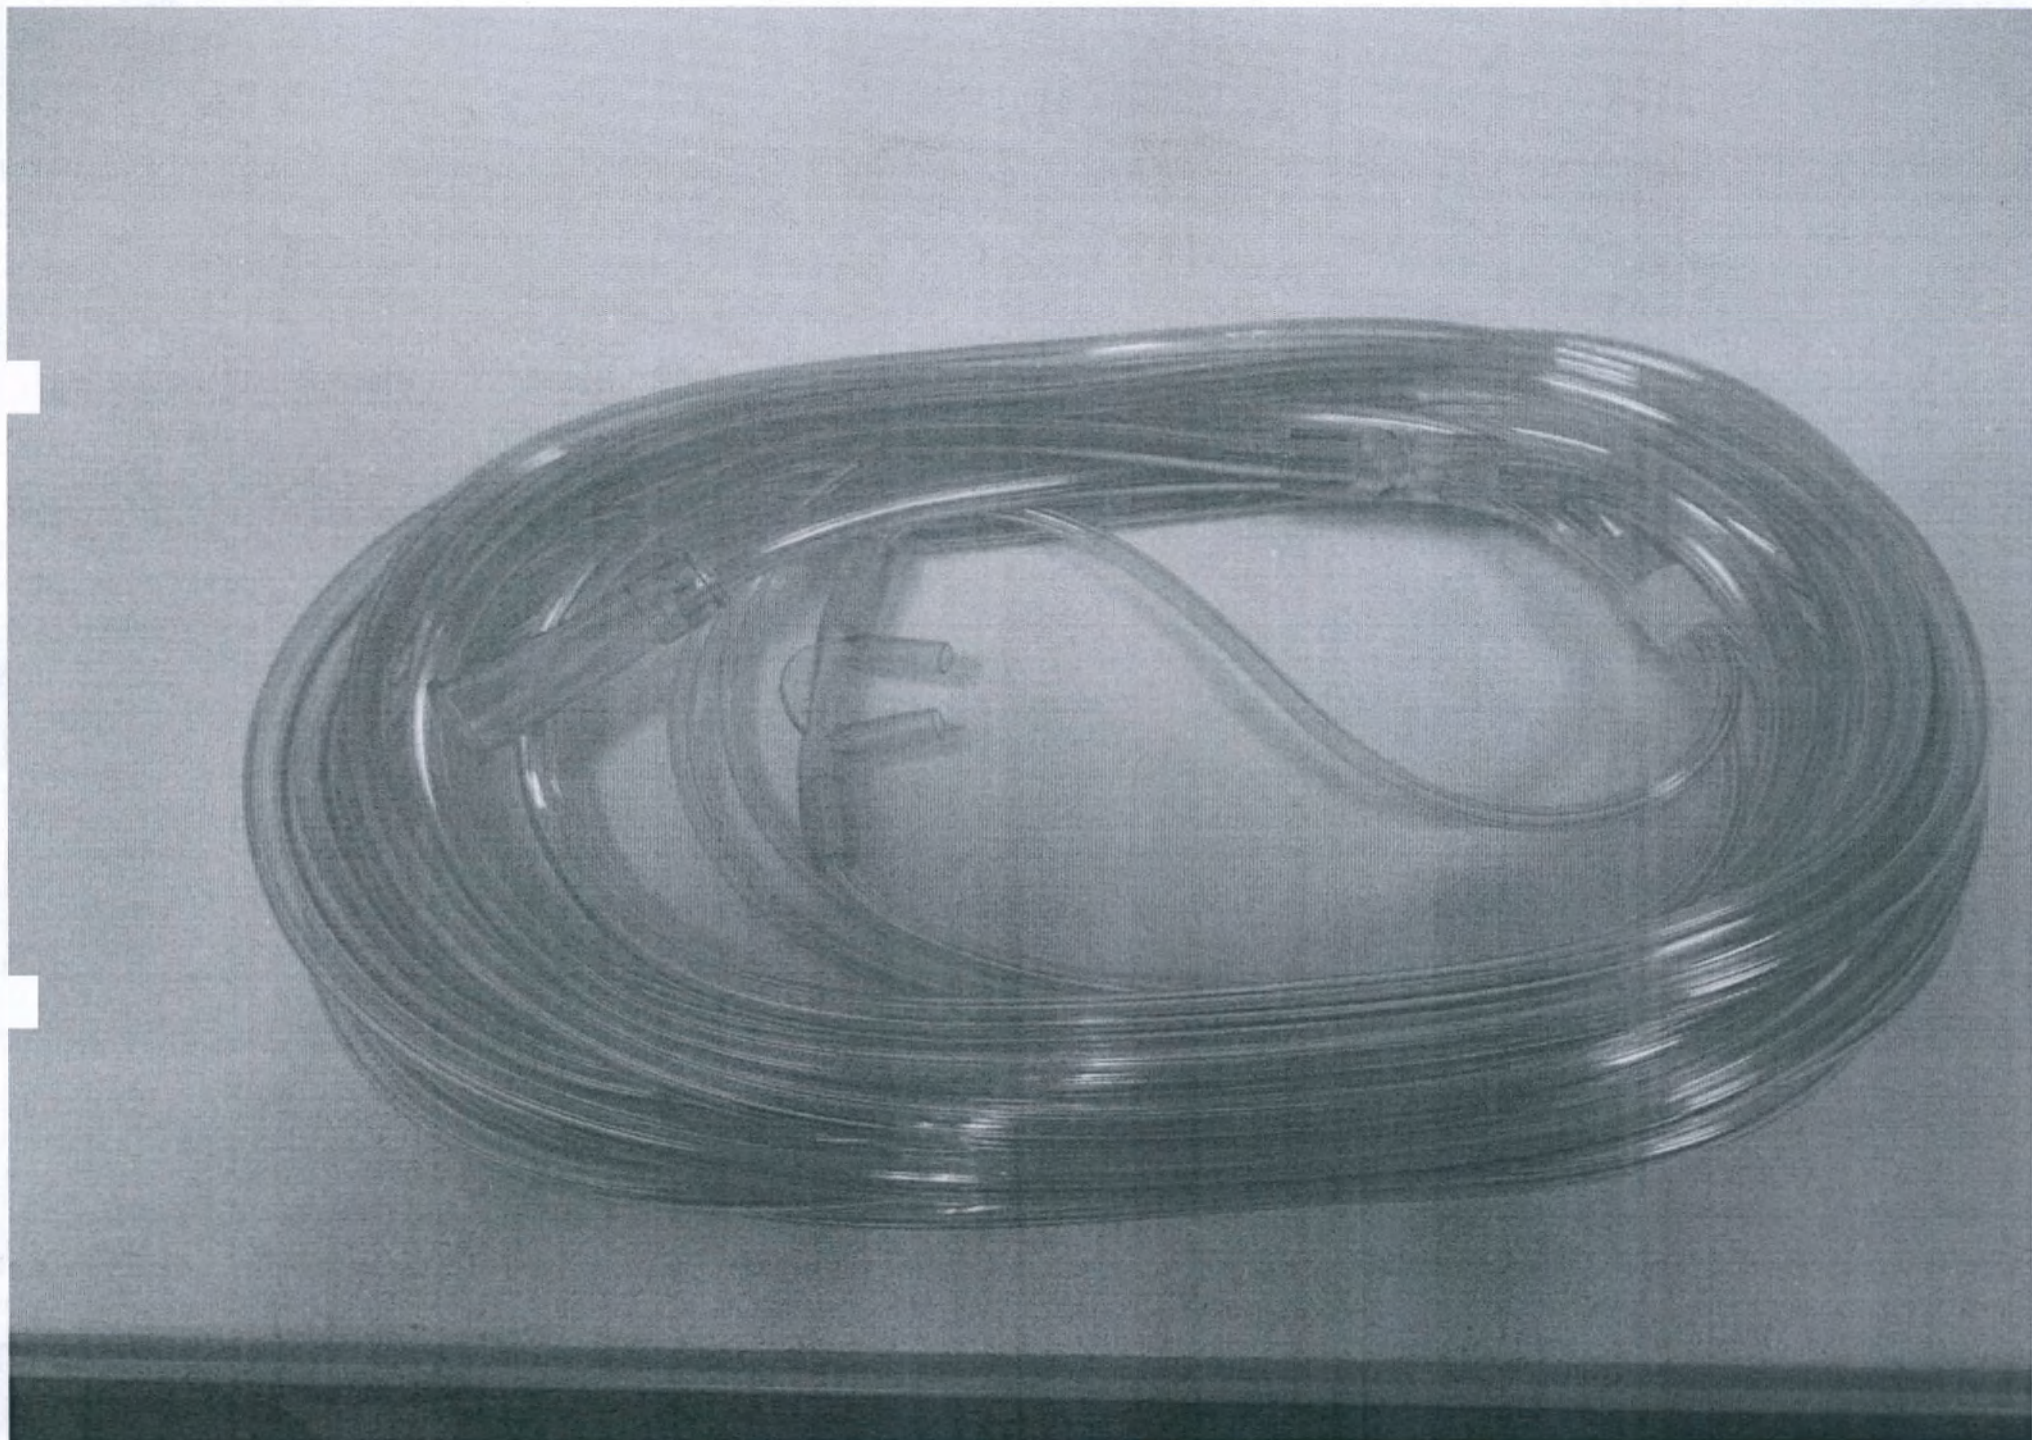


Рис. 36 – Канюля назальная большая

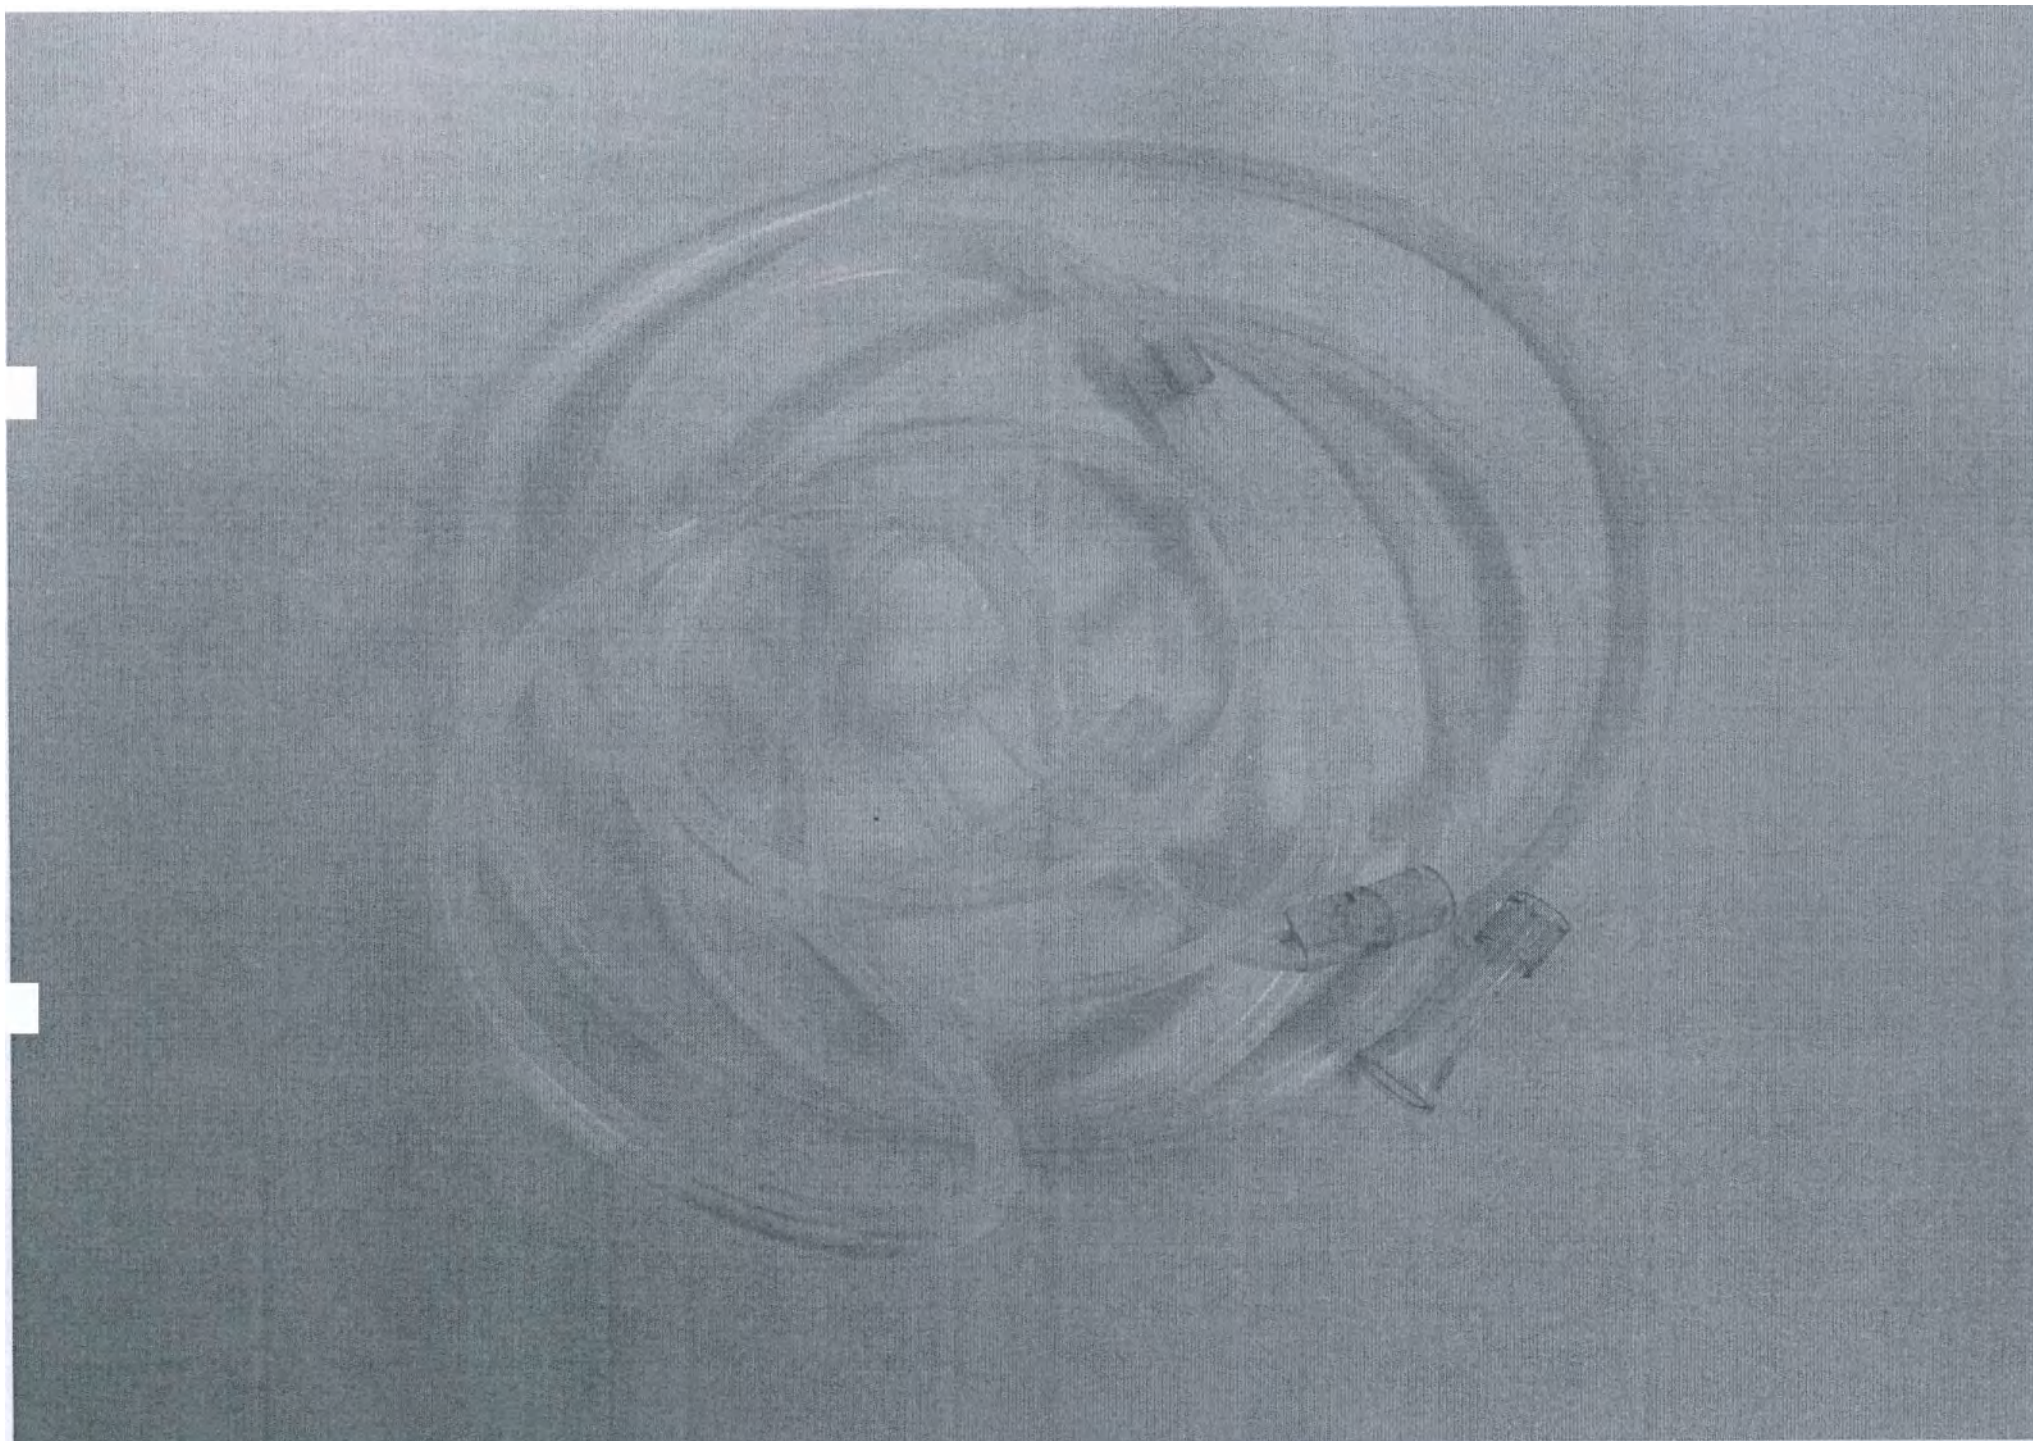


Рис. 37 – Канюля назальная малая

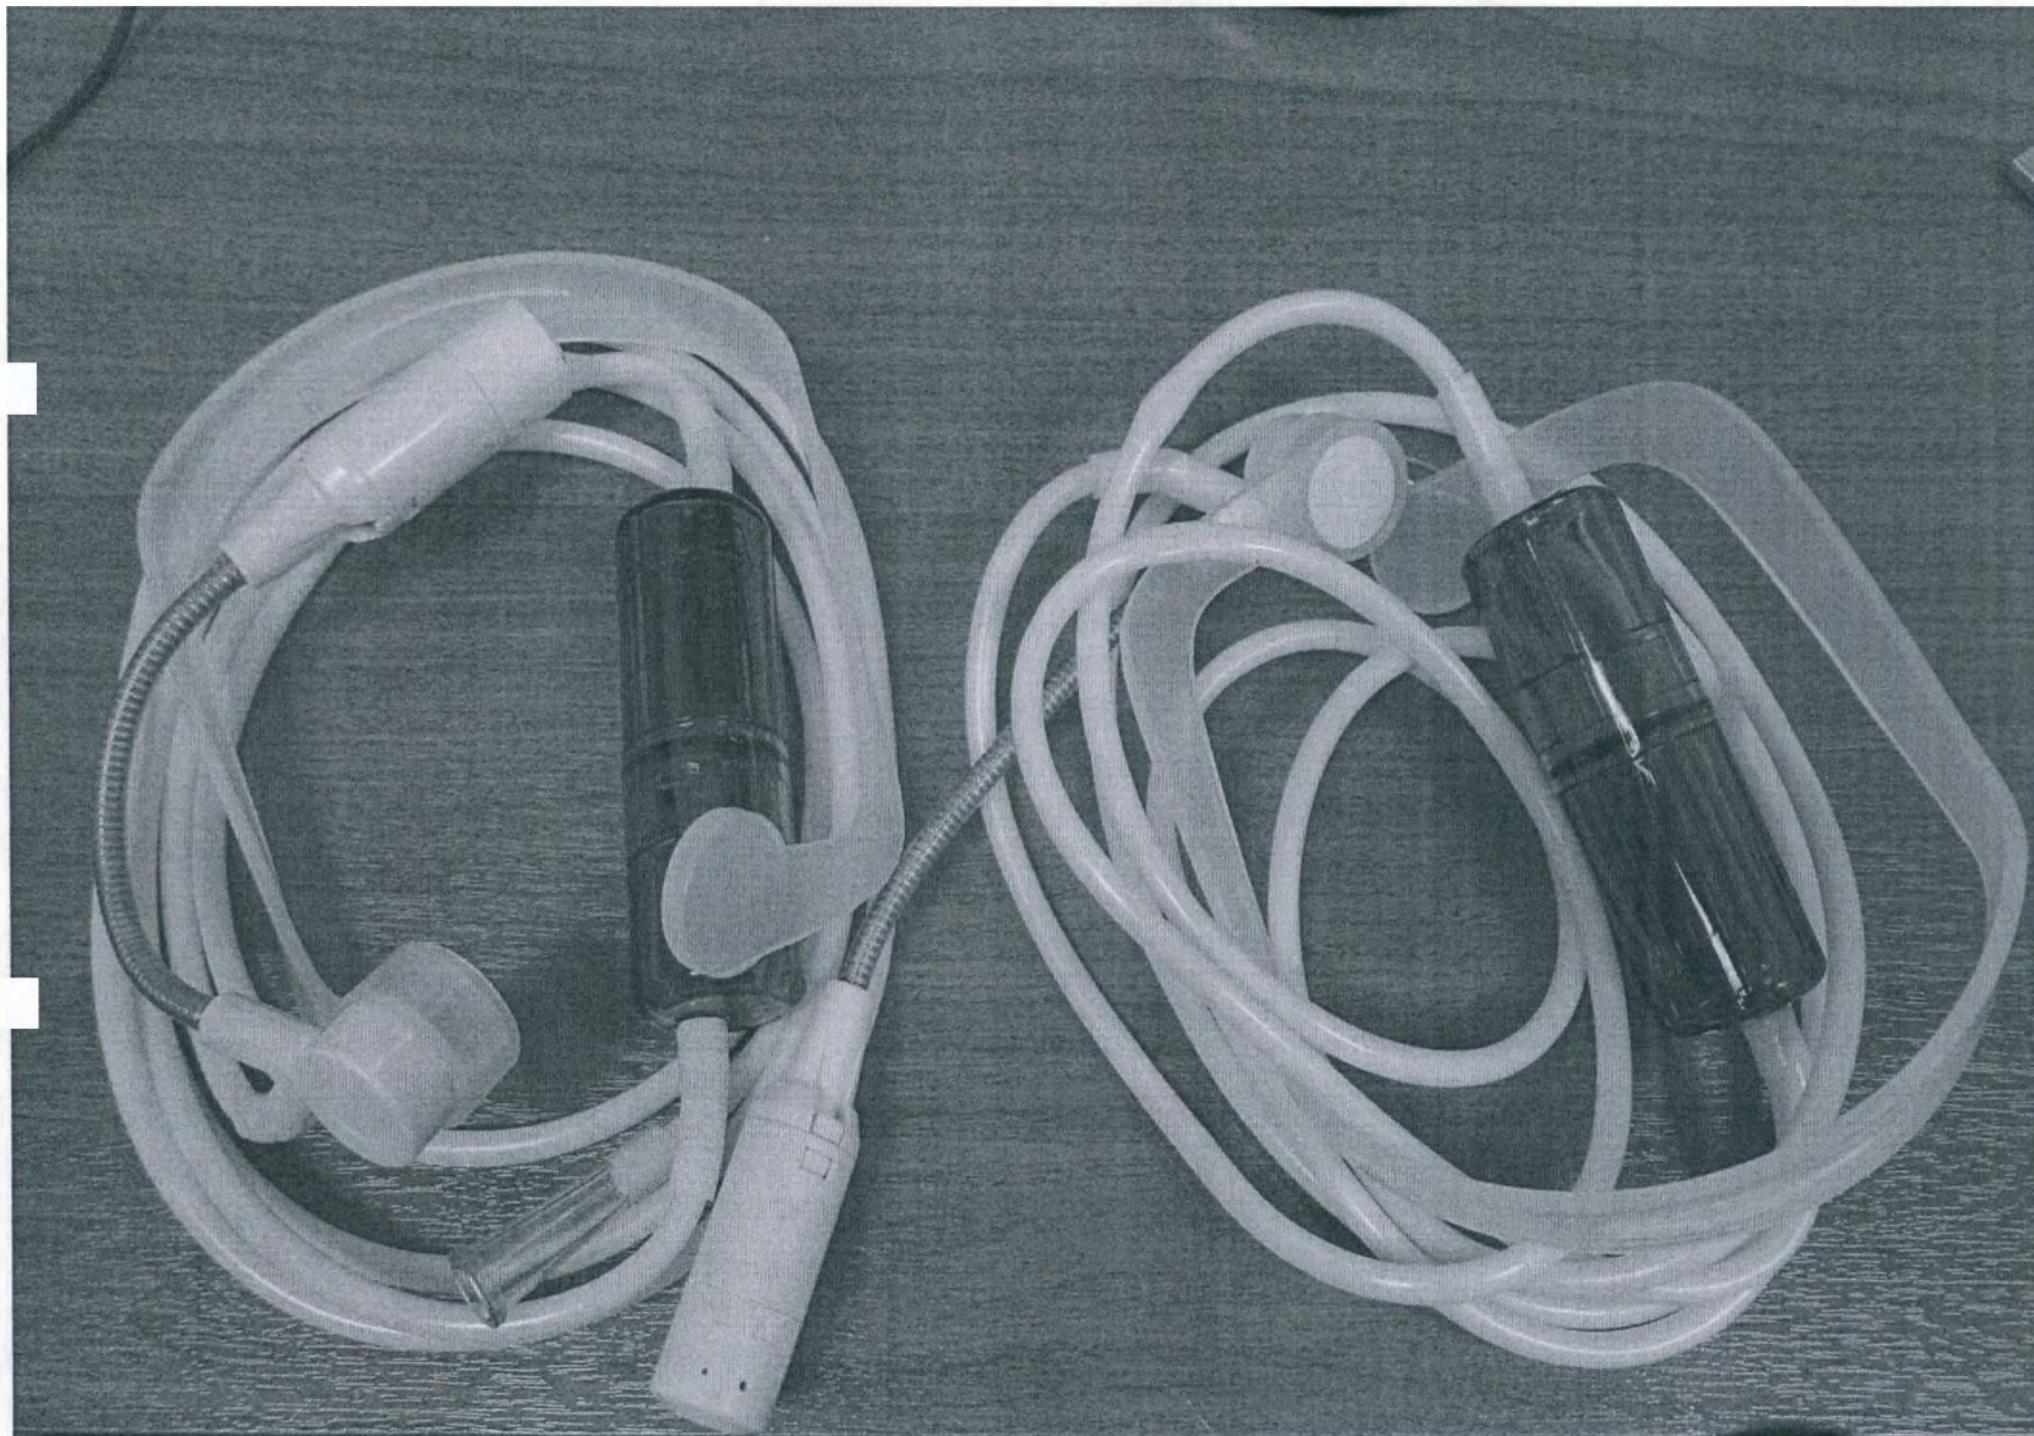


Рис. 38 – Диффузор (2 шт.)

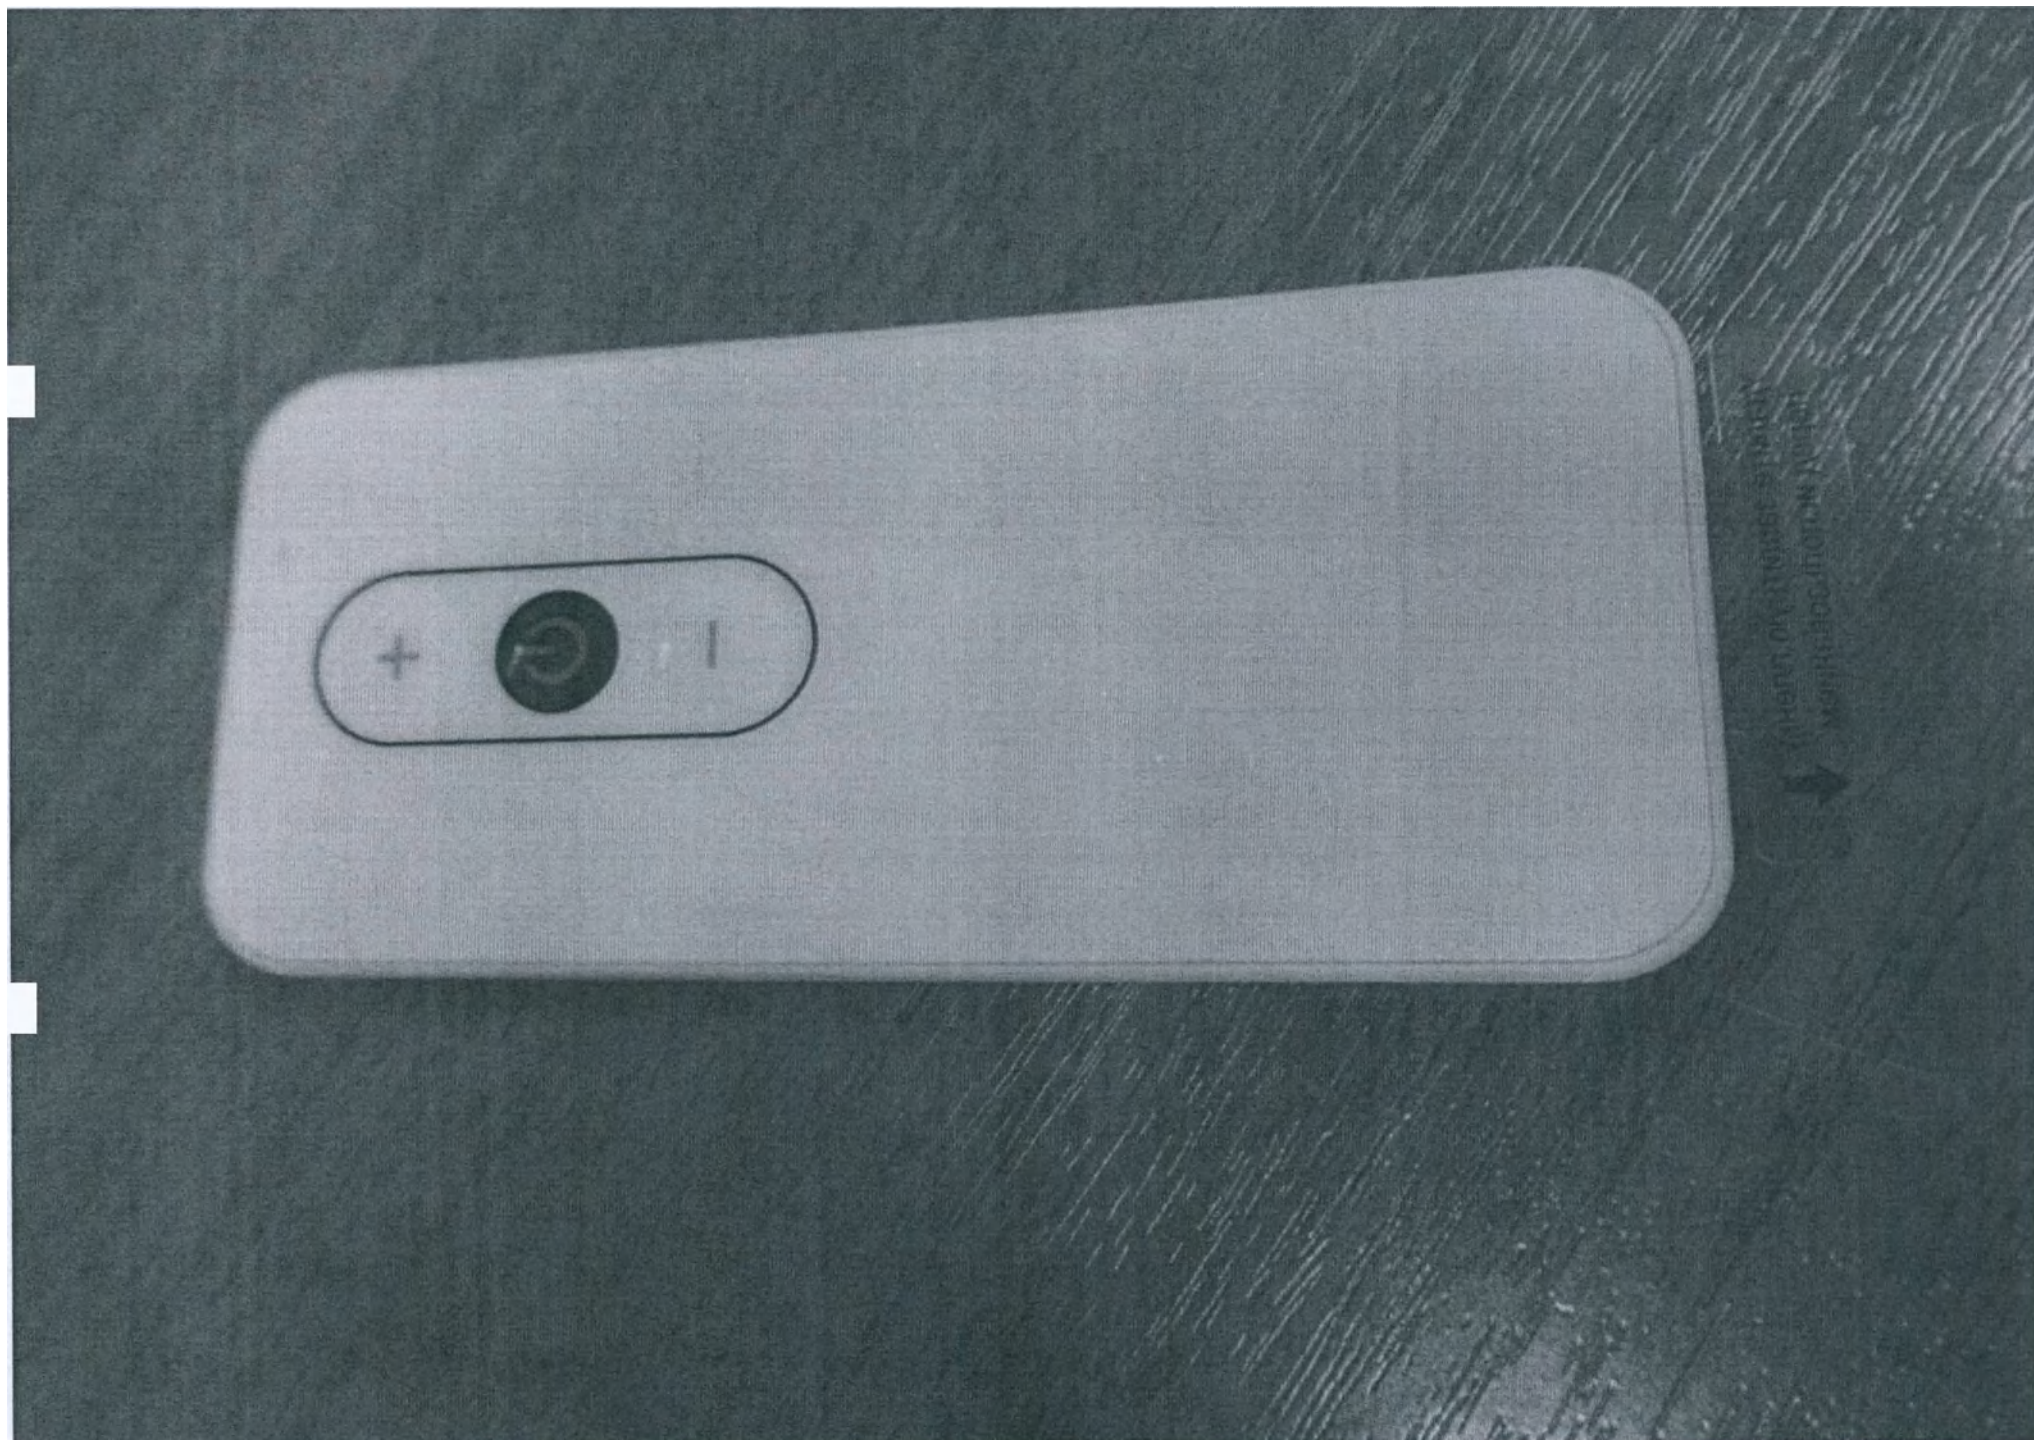




Рис. 40 – Увлажнитель

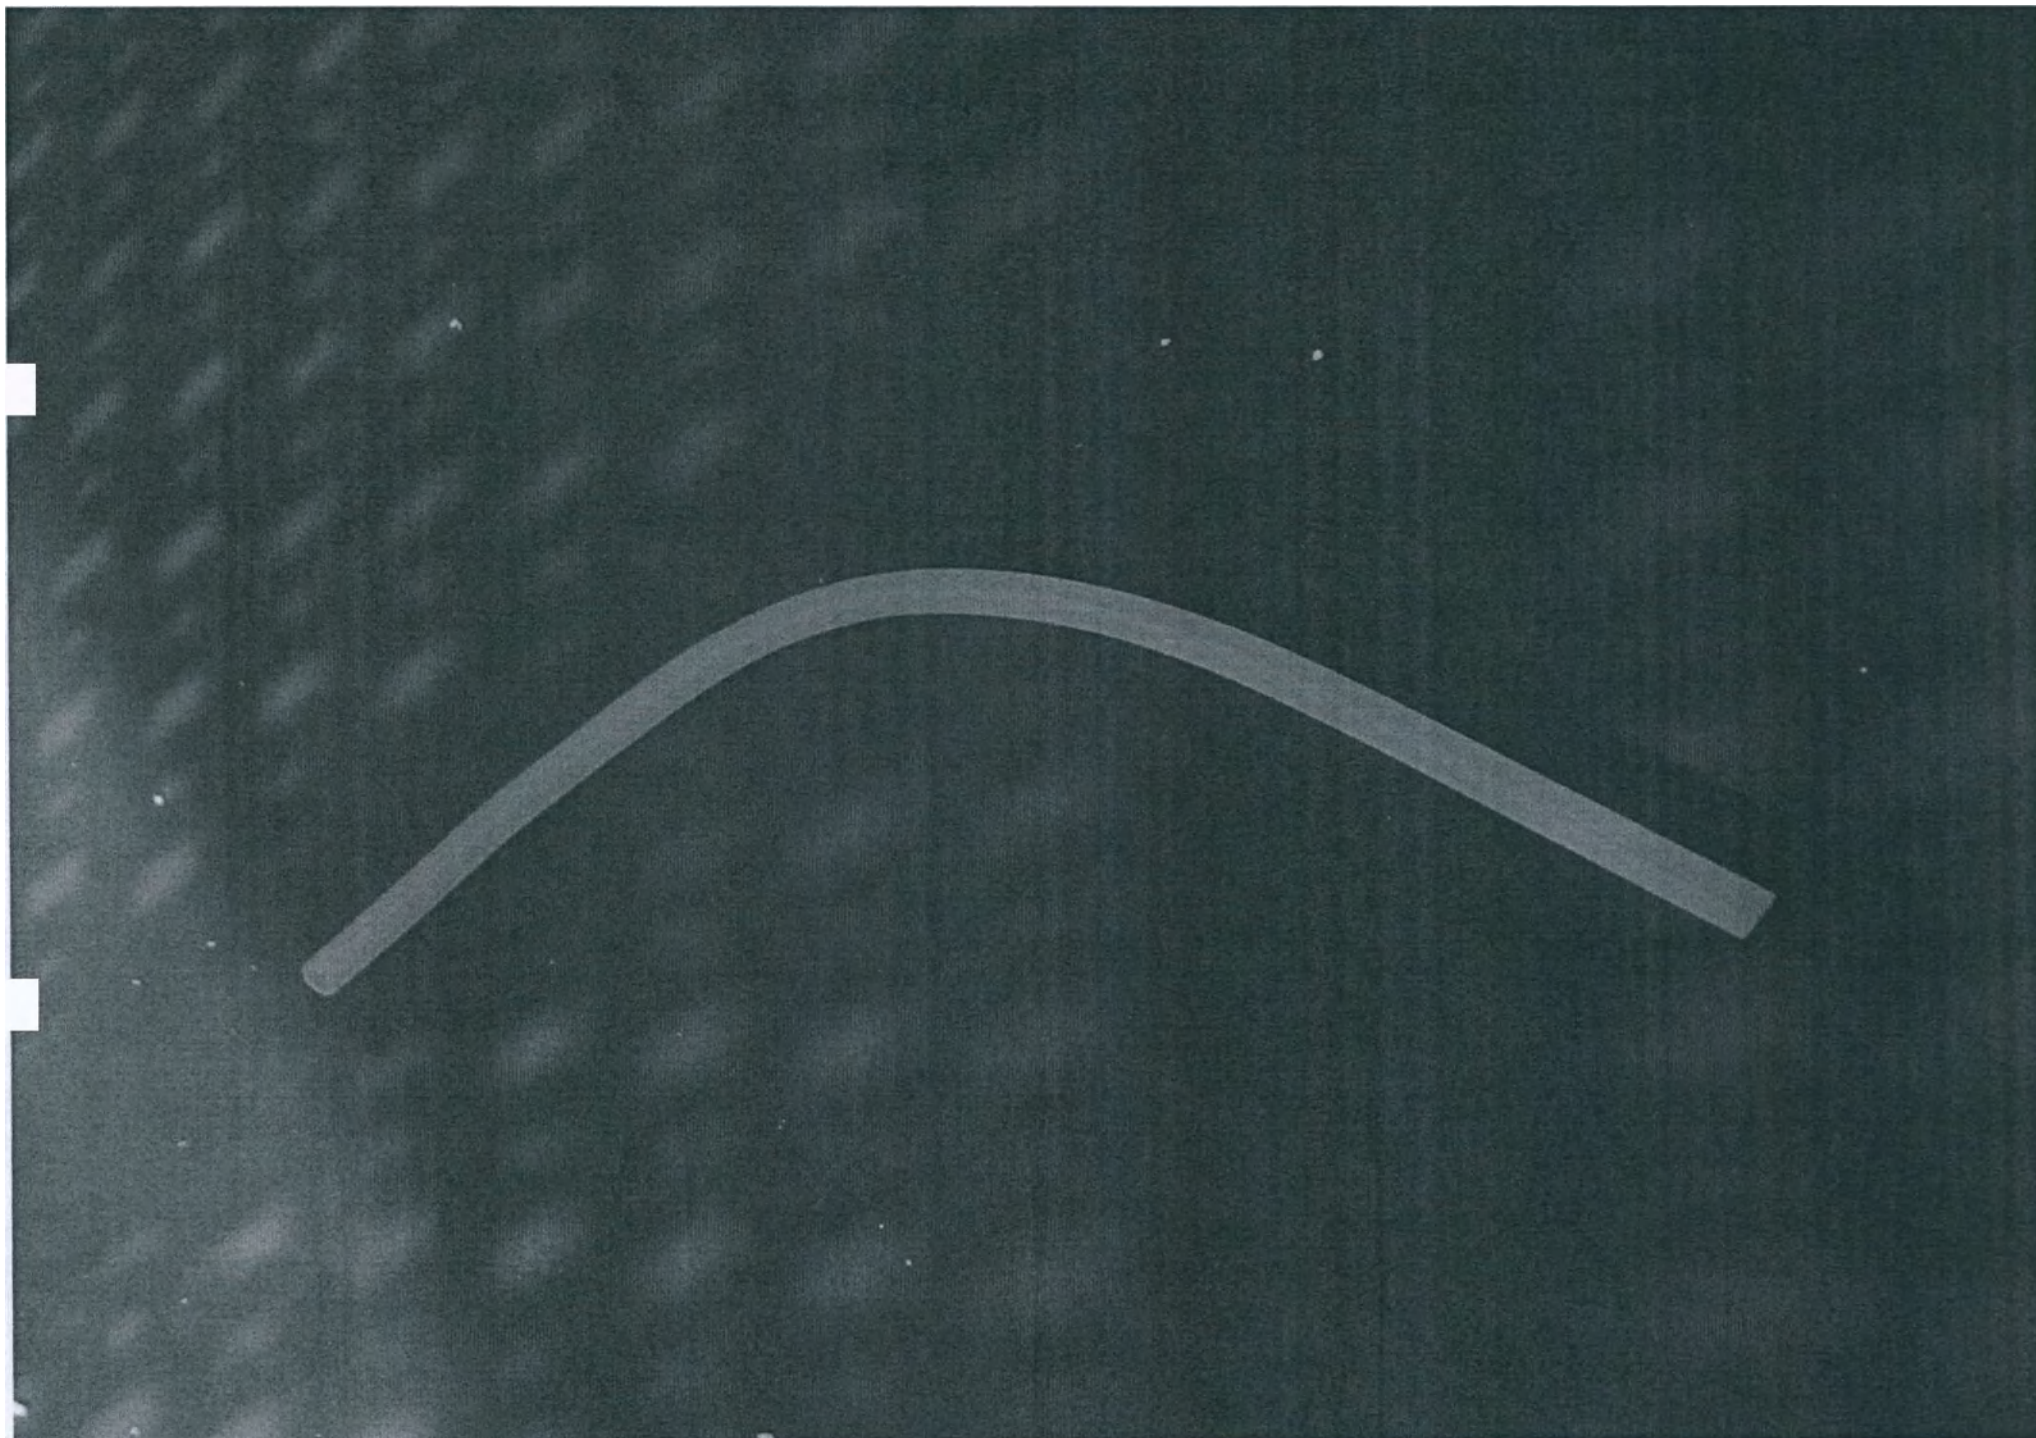


Рис. 41 – Шланг для увлажнителя

VII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 8F-3ZW, в составе:

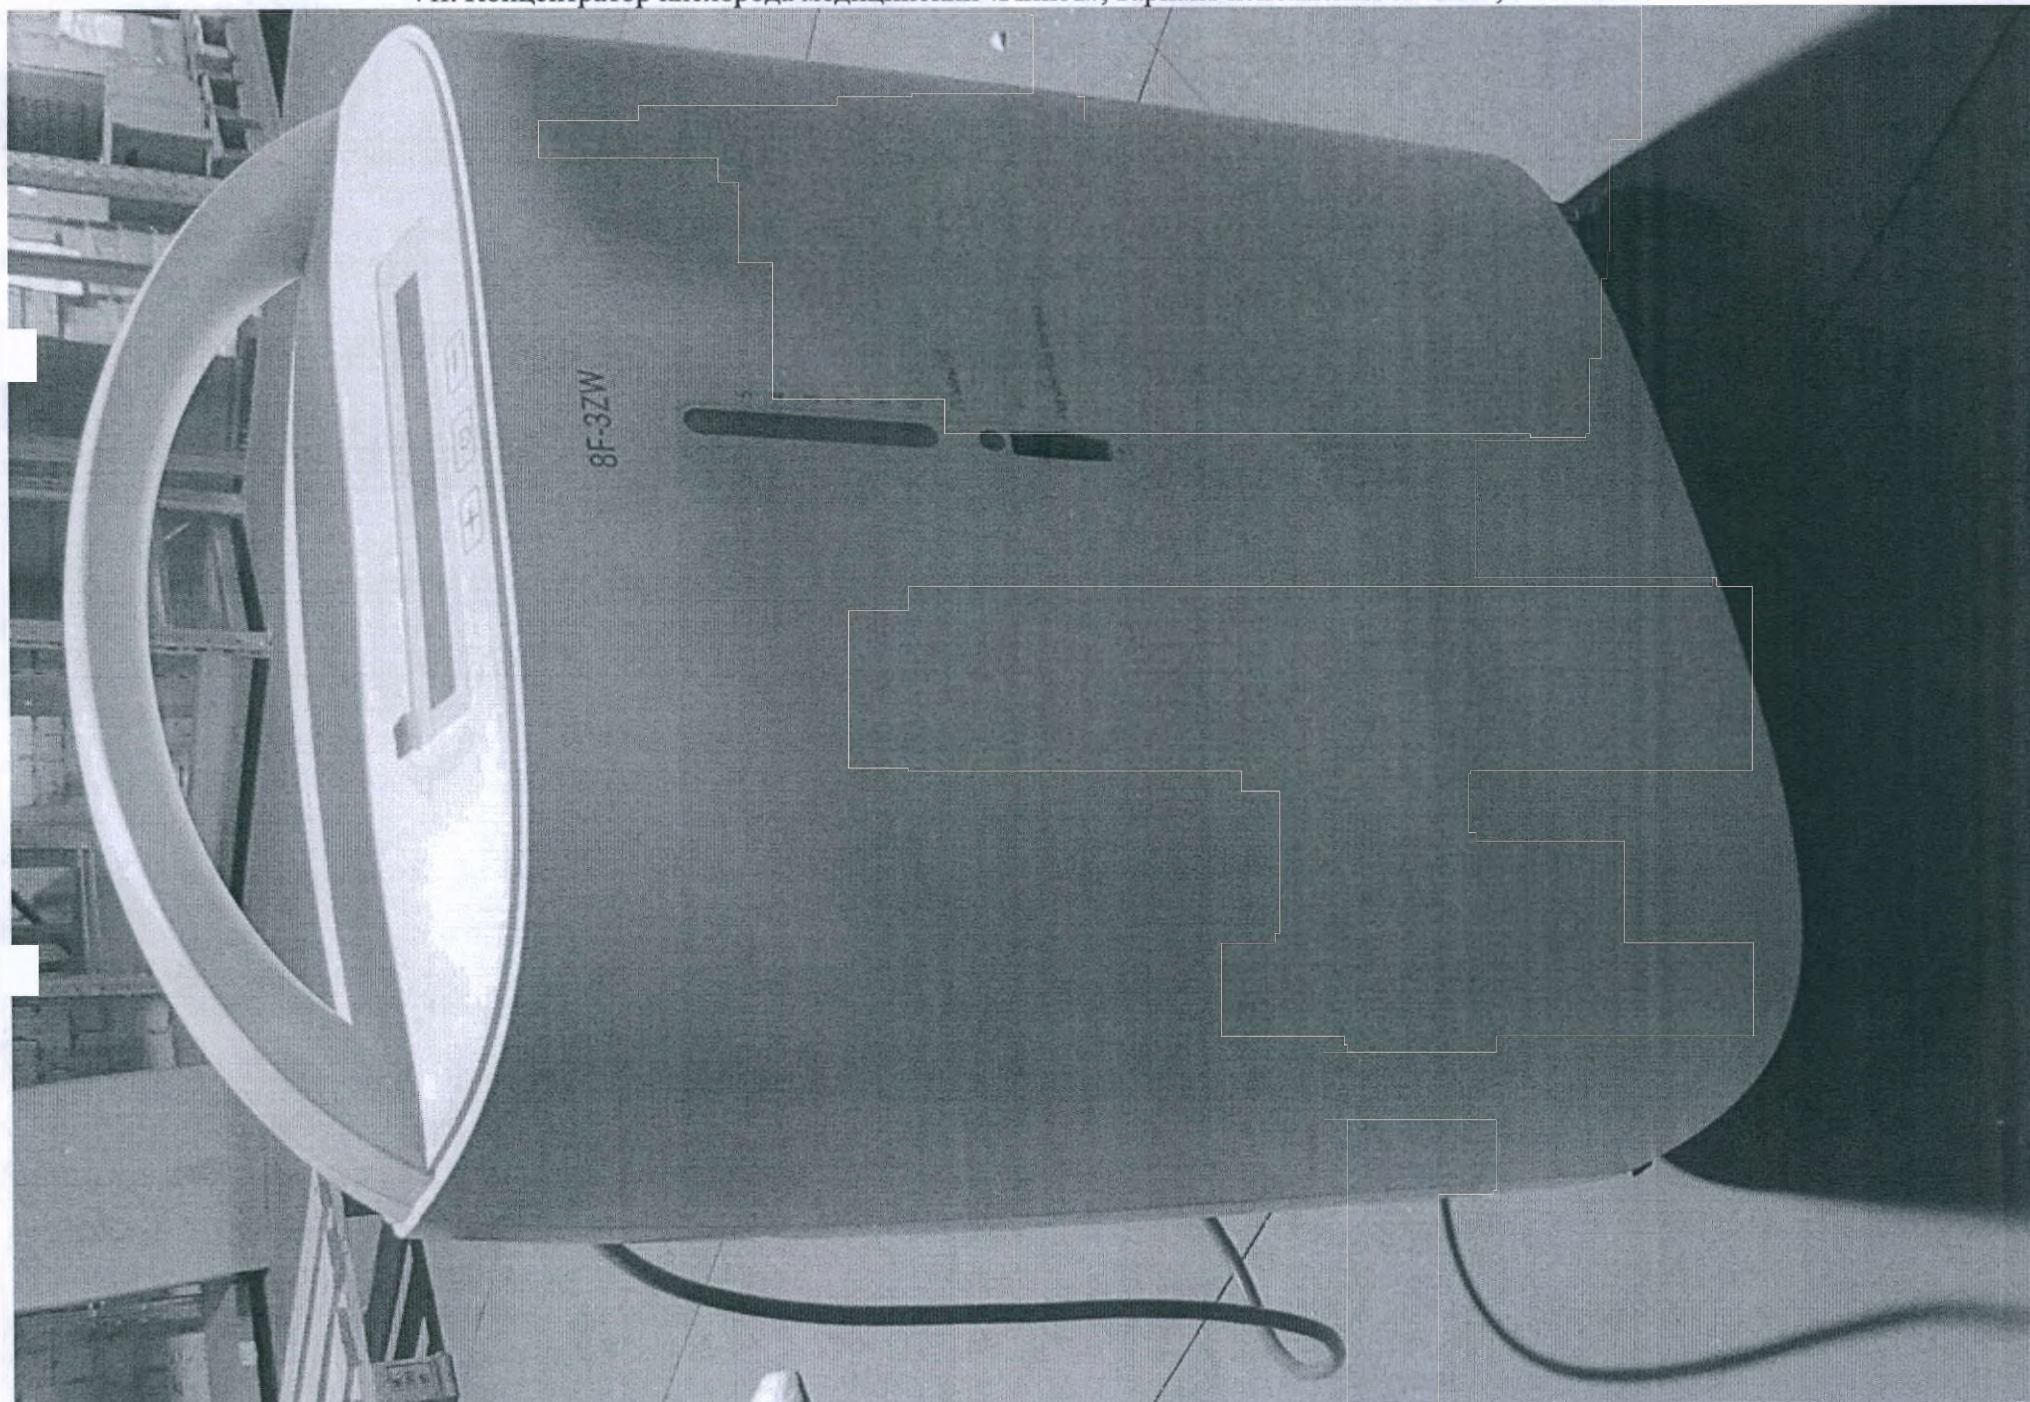


Рис. 42 – Концентратор кислорода

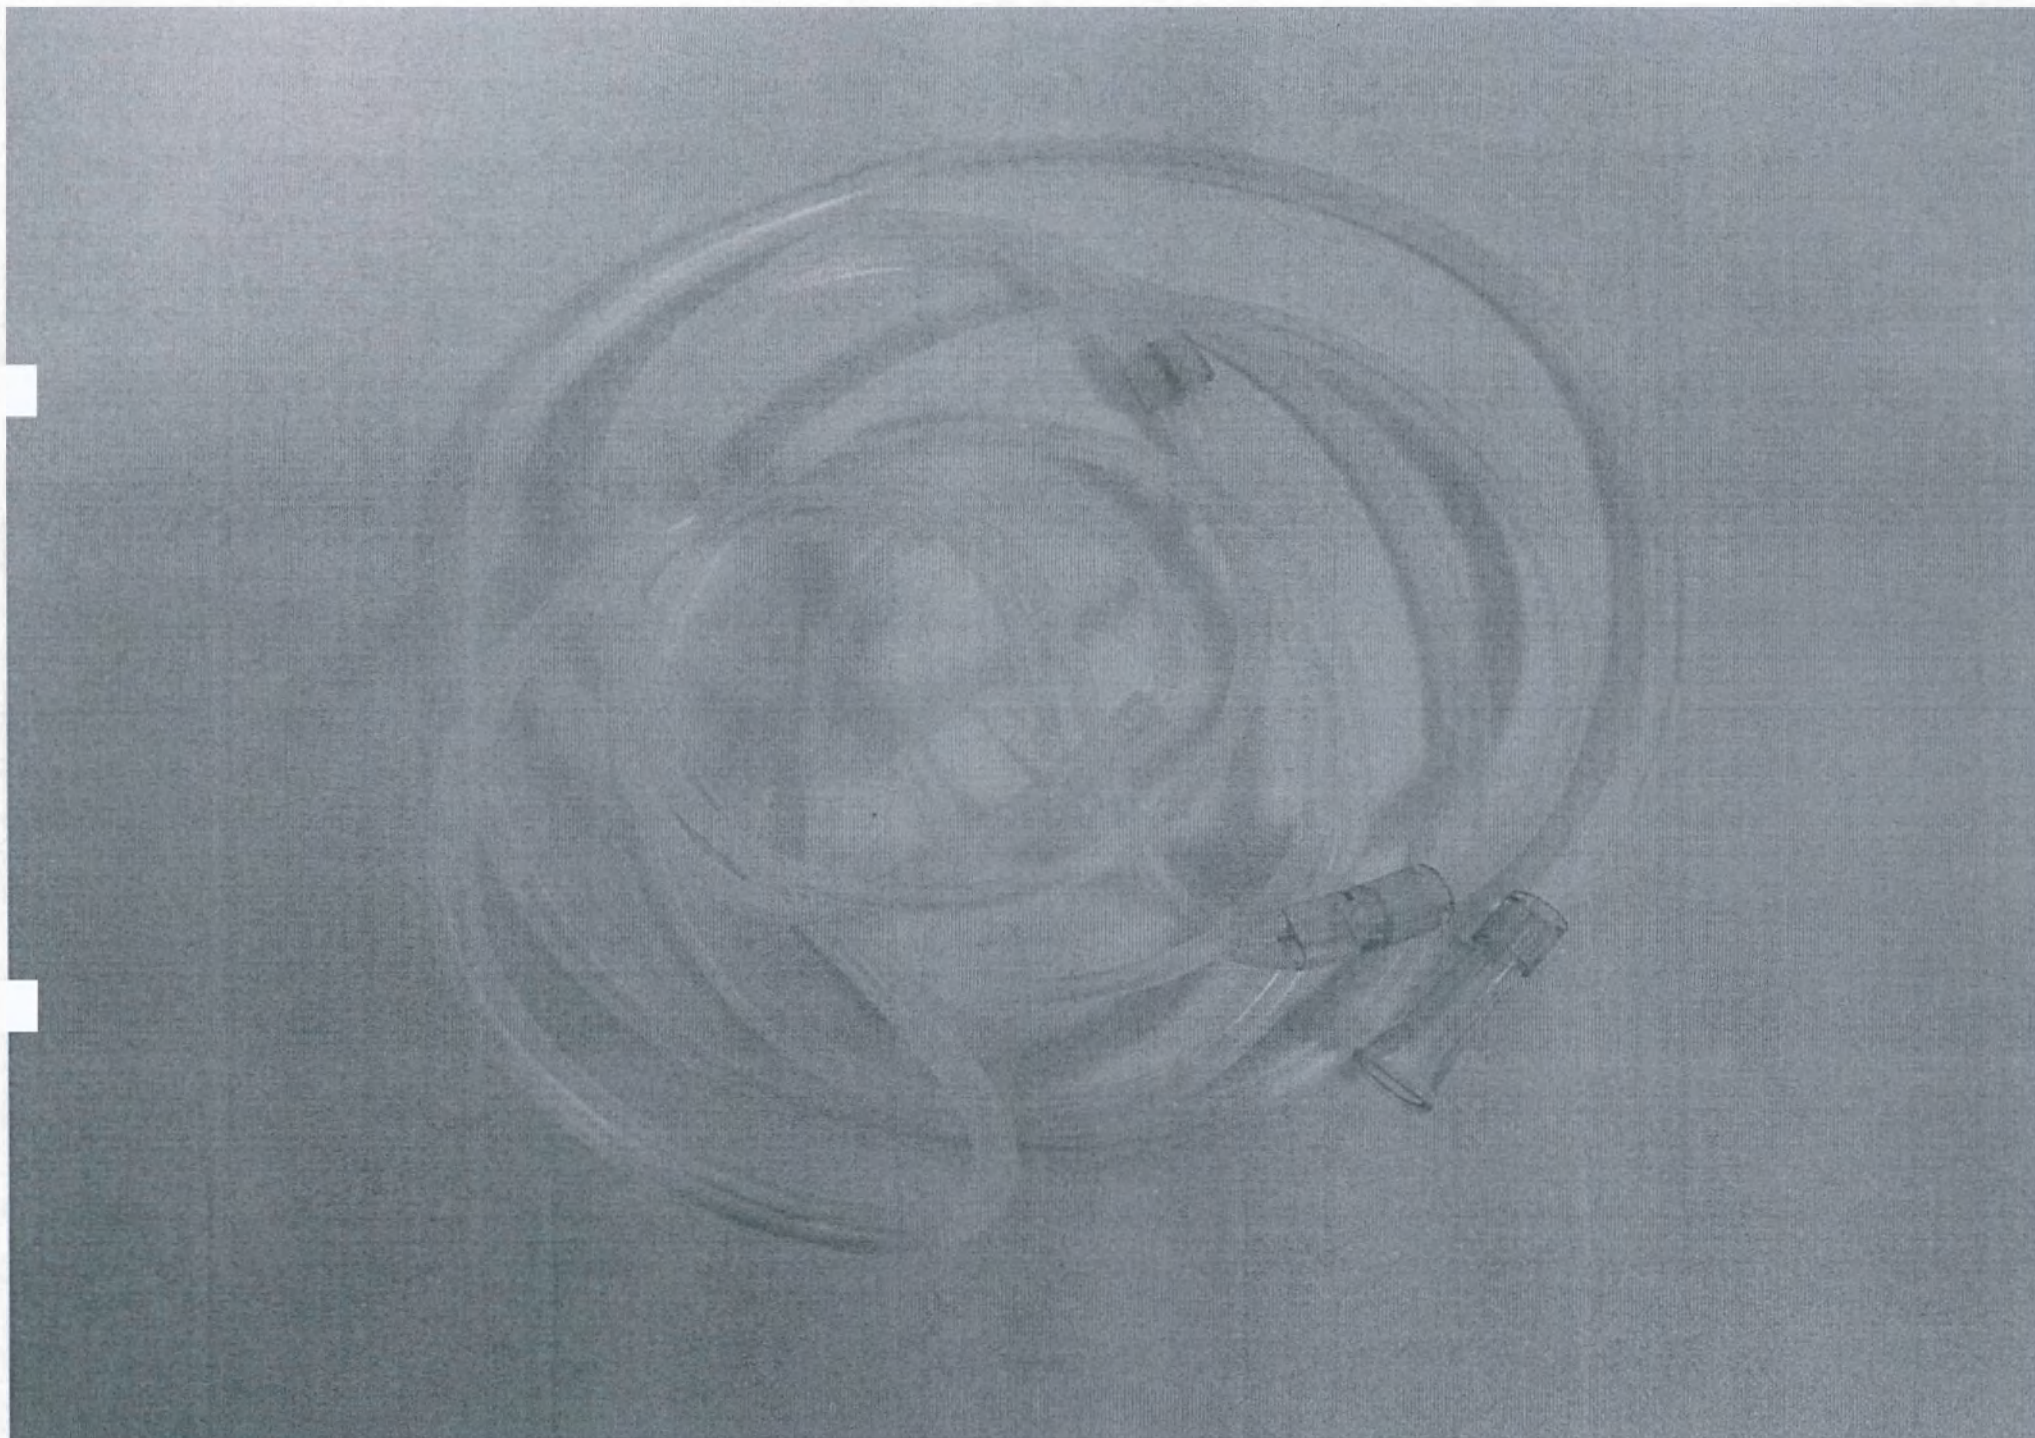
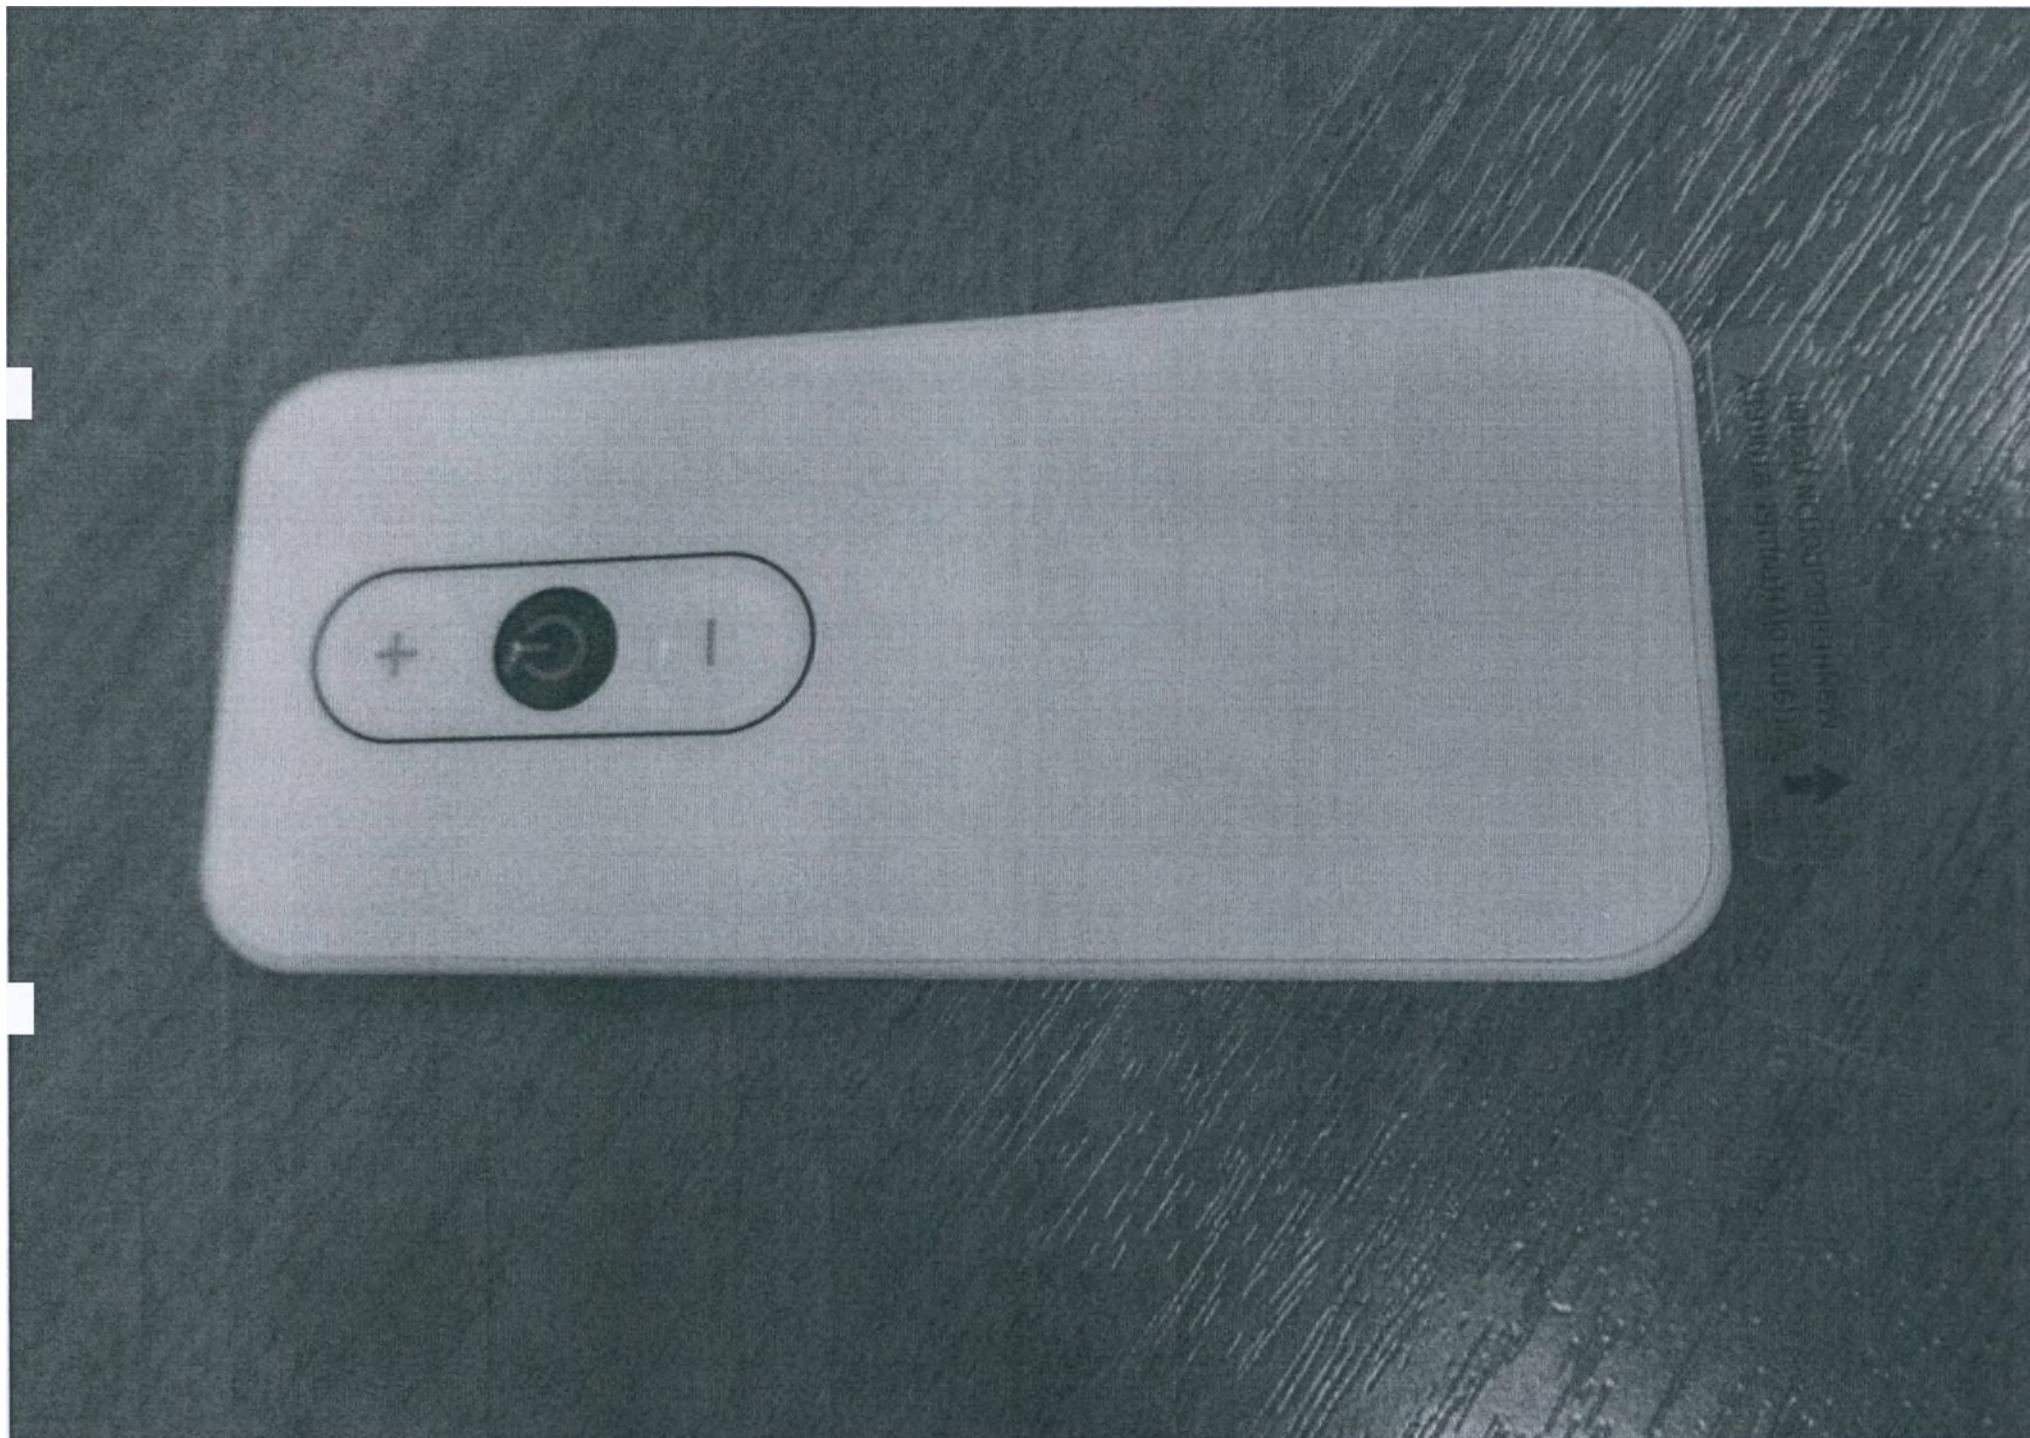


Рис. 43 – Канюля назальная малая



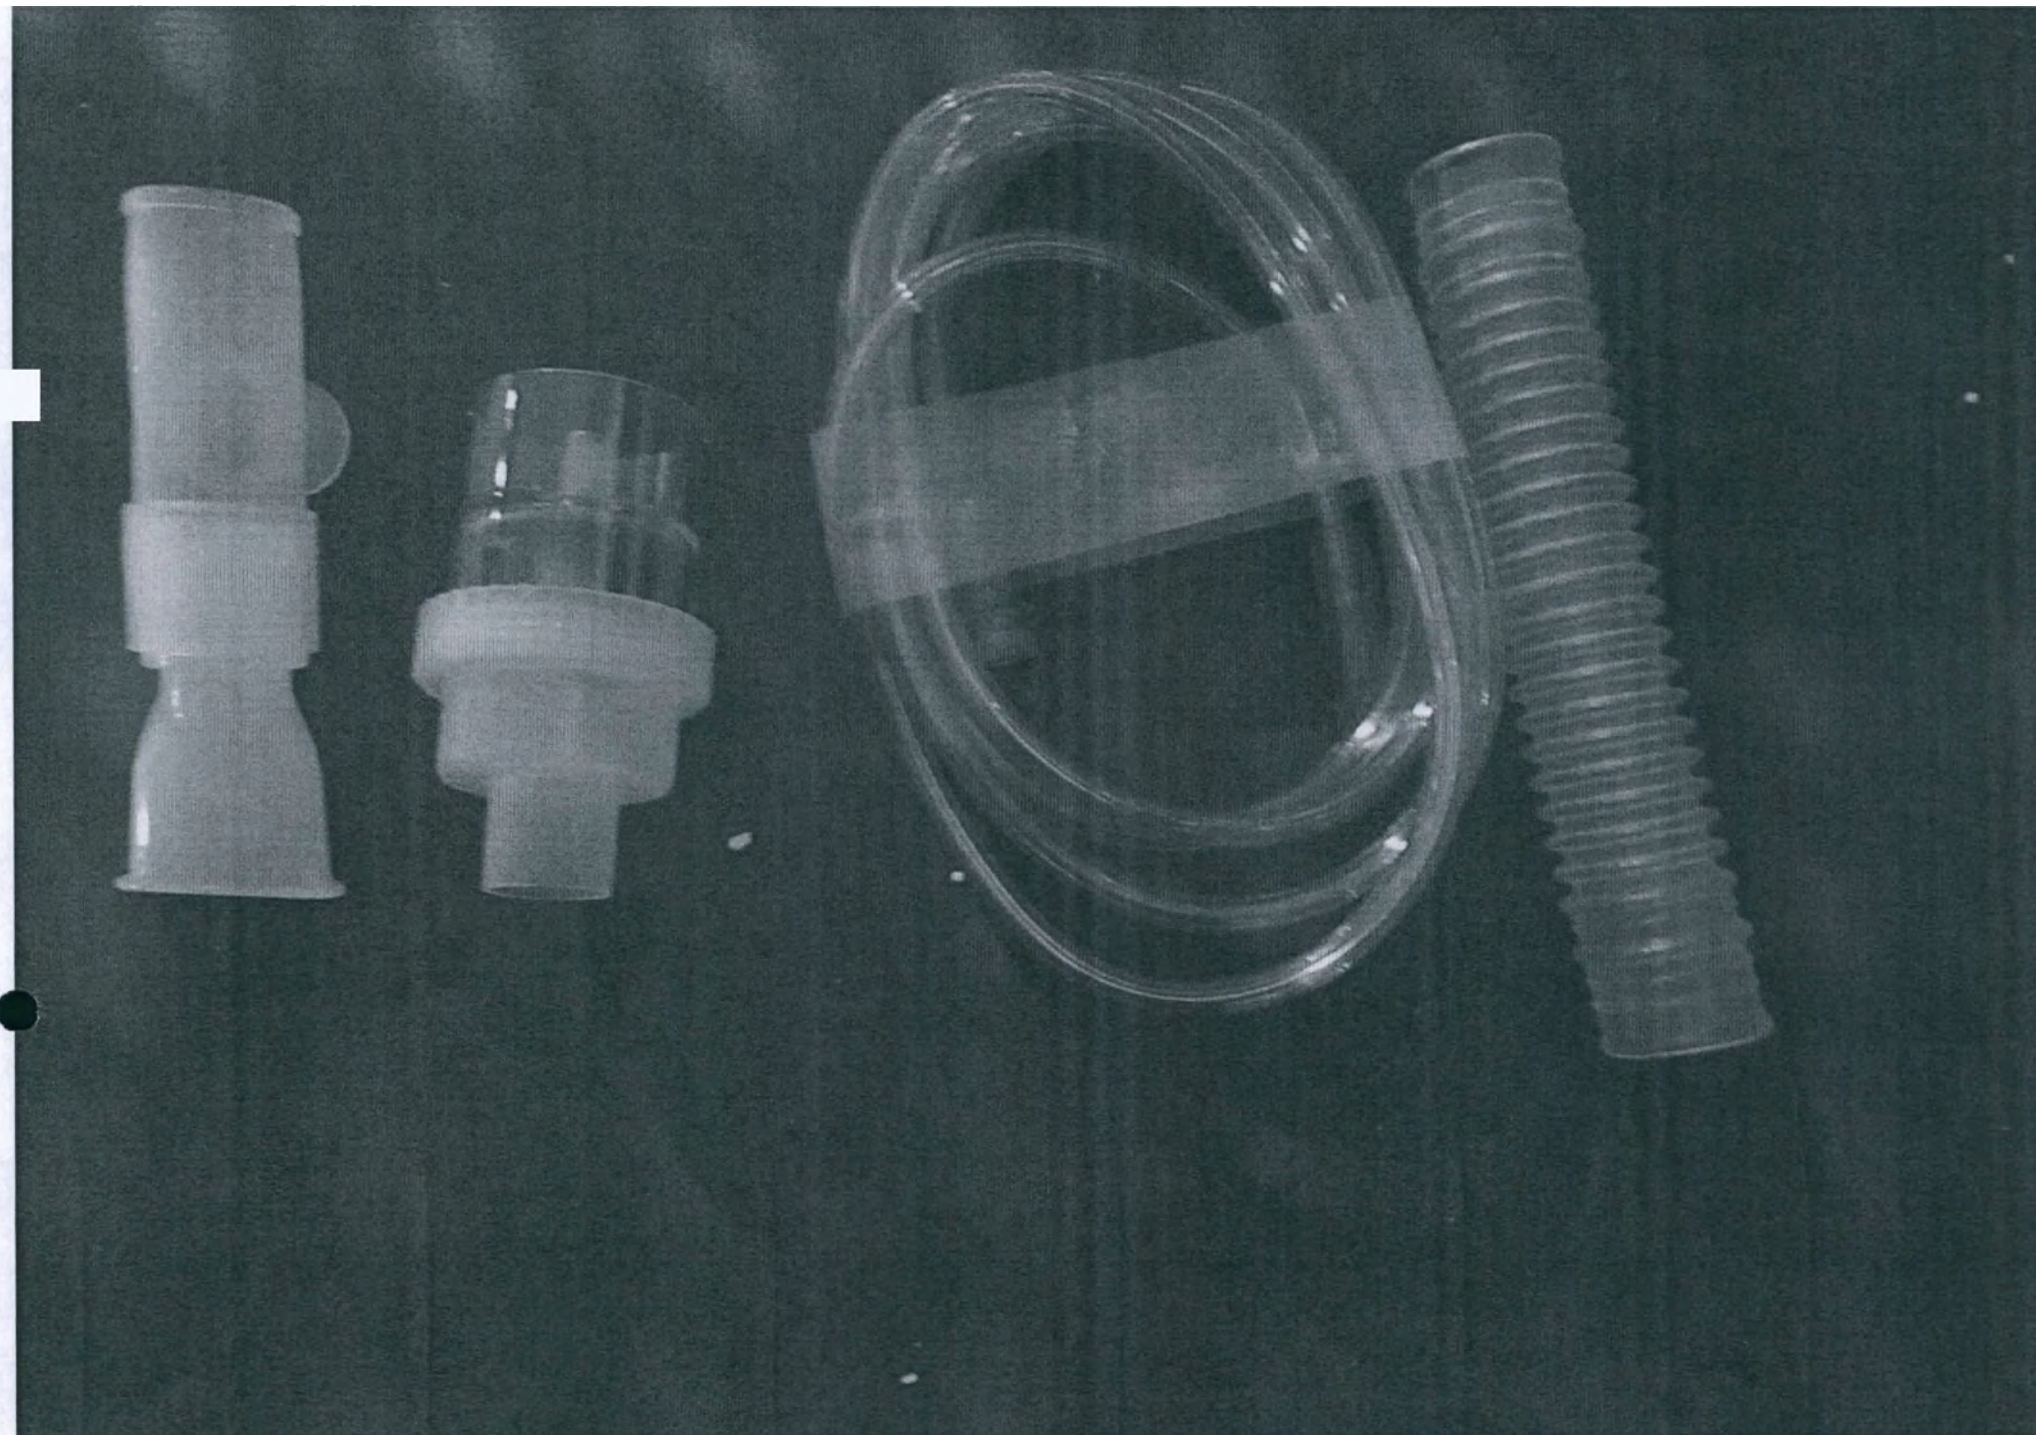


Рис. 45 – Комплект для ингаляции (тип II)

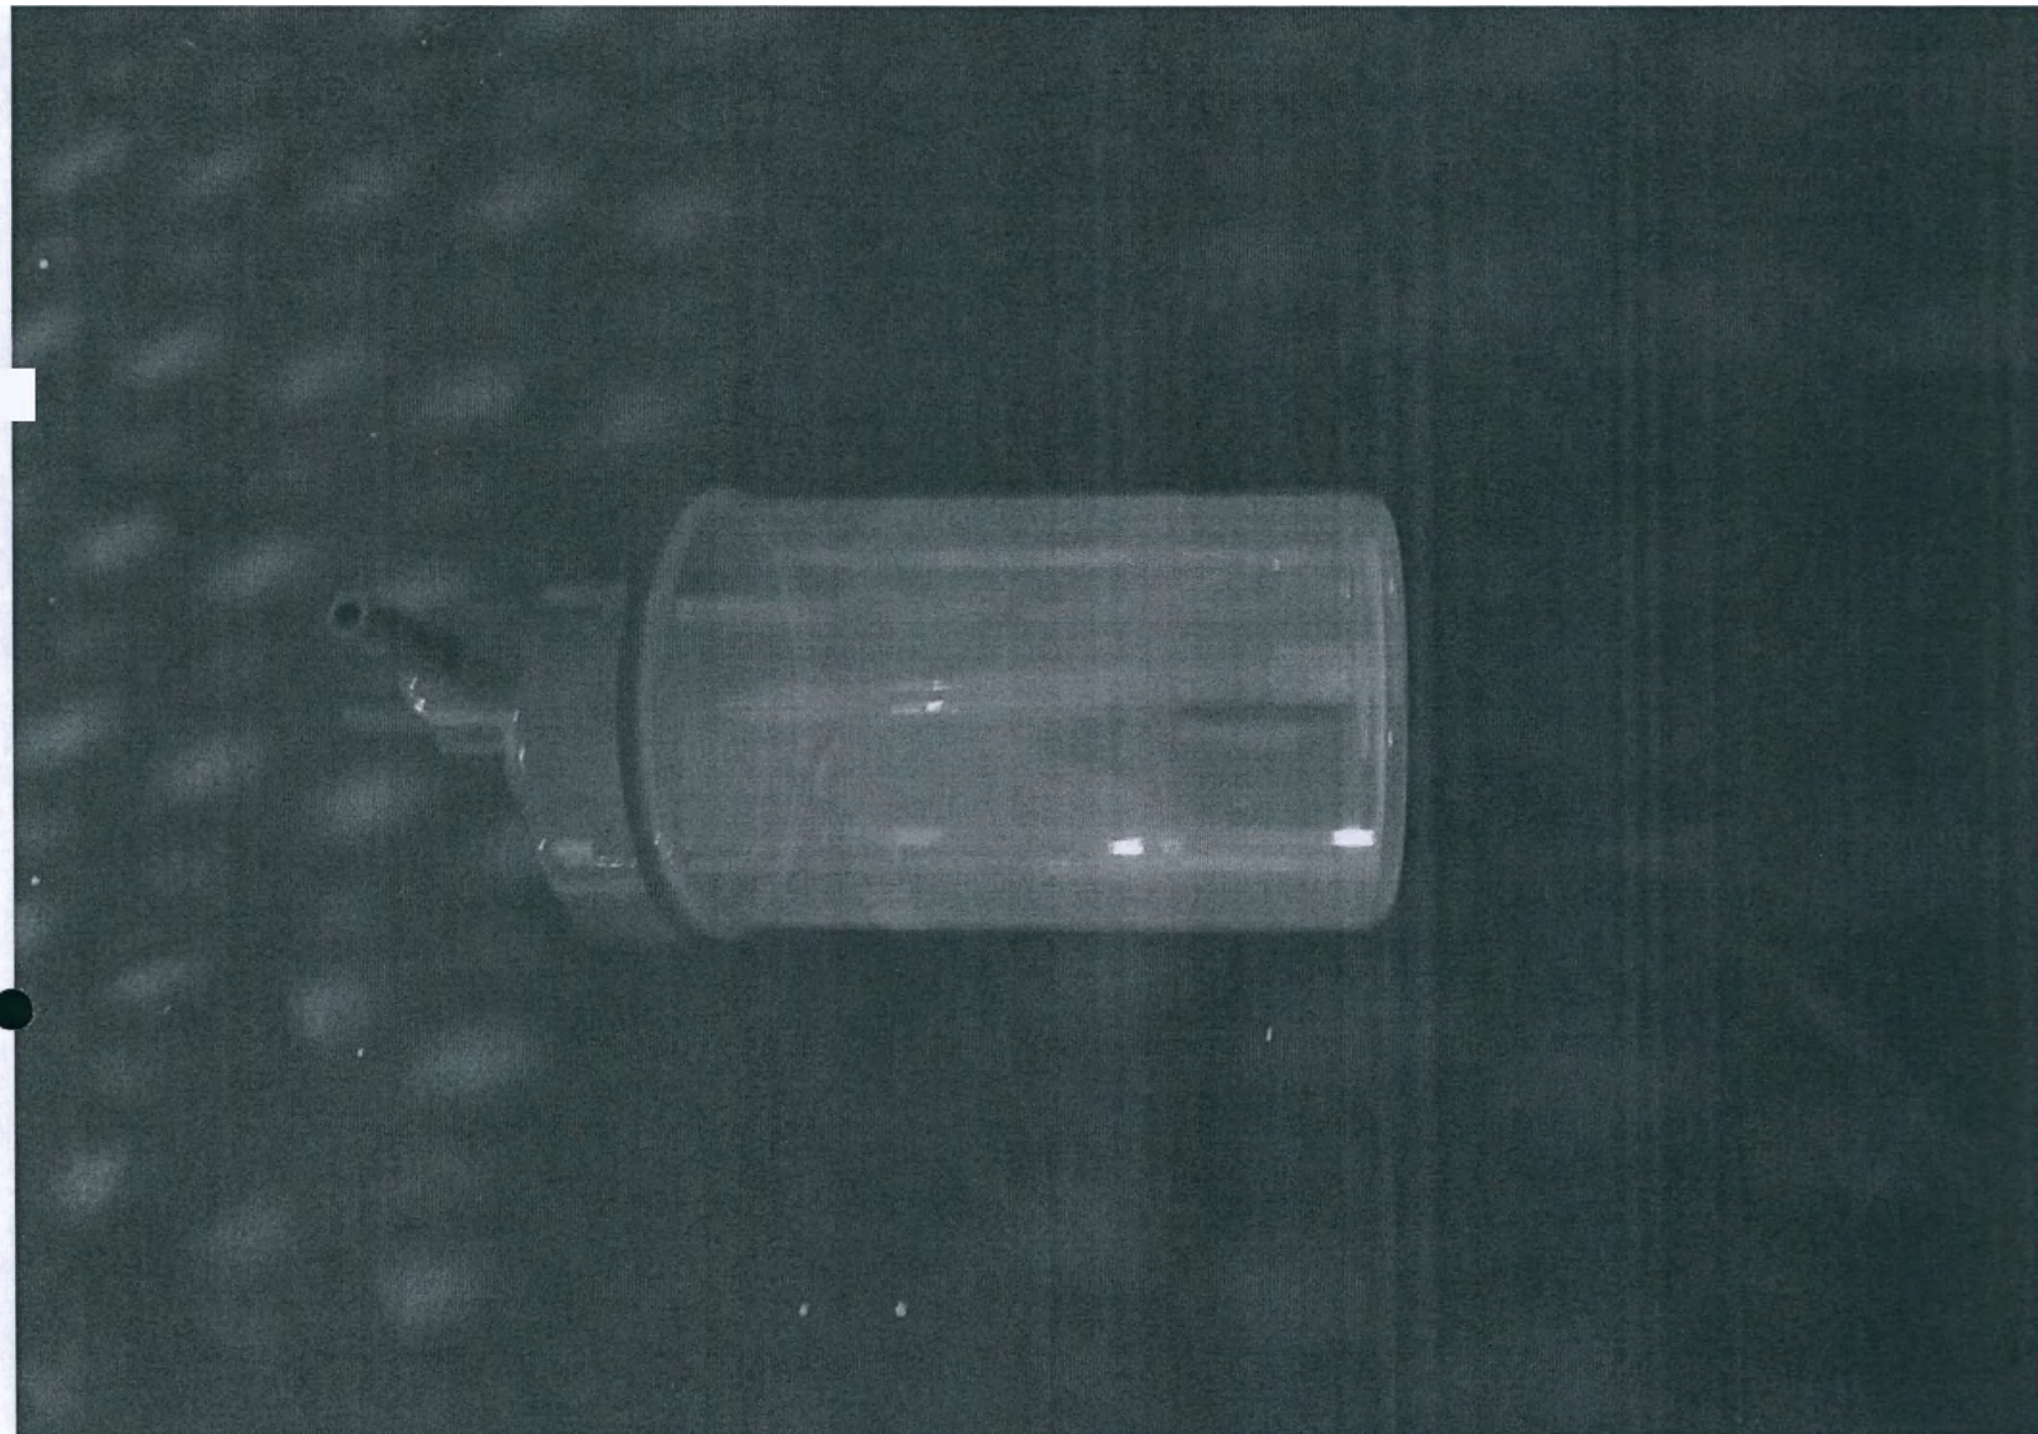


Рис. 46 – Увлажнитель

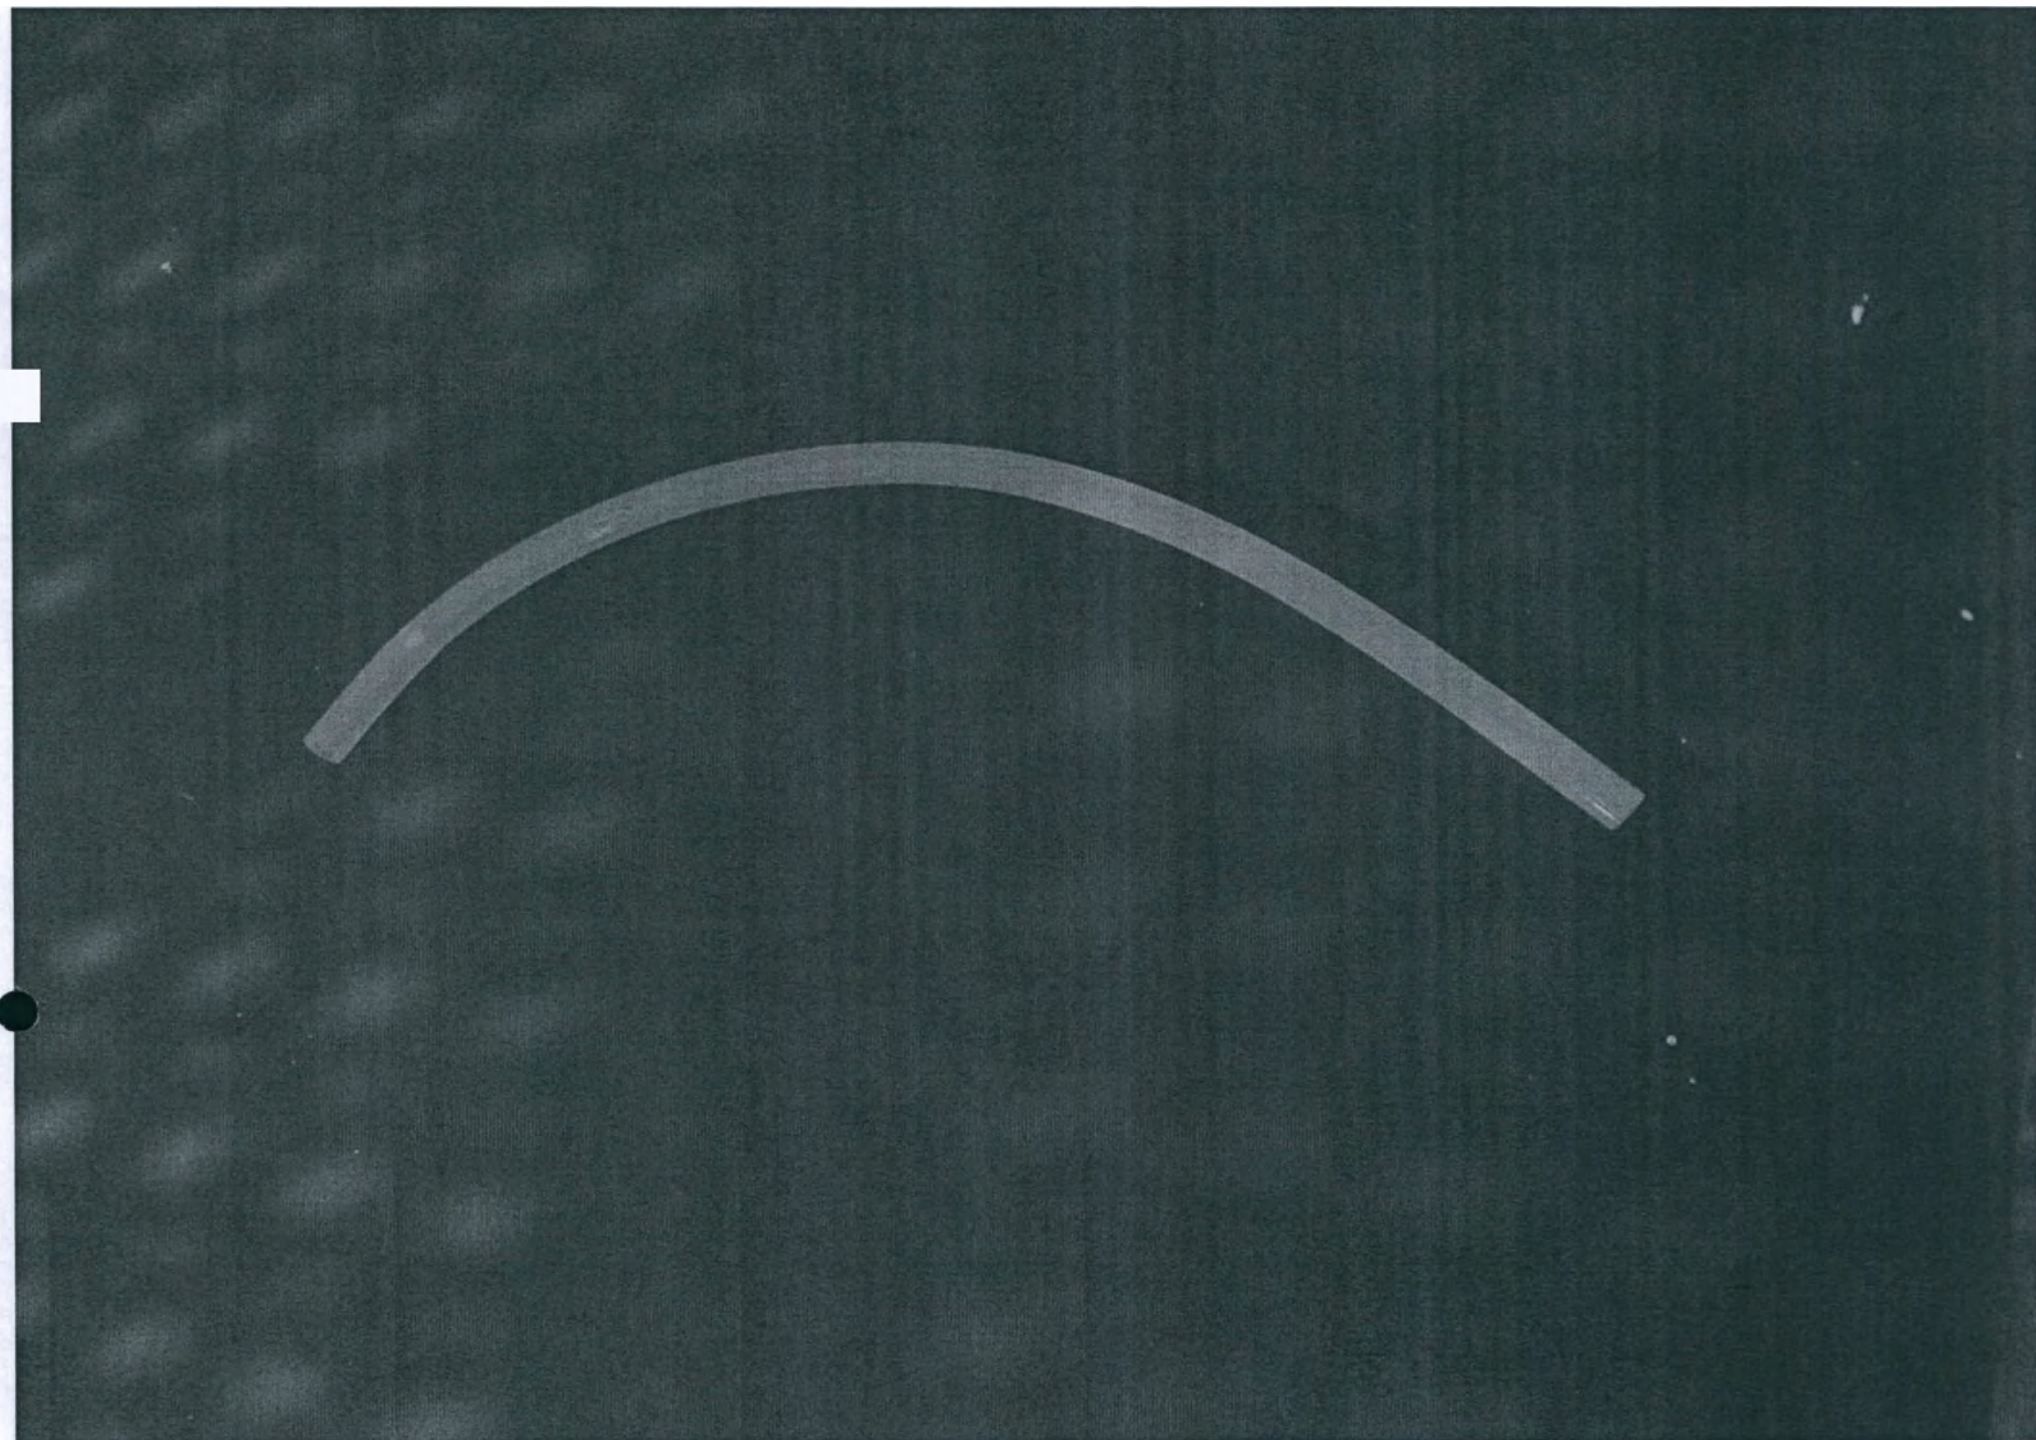


Рис. 47 – Шланг для увлажнителя

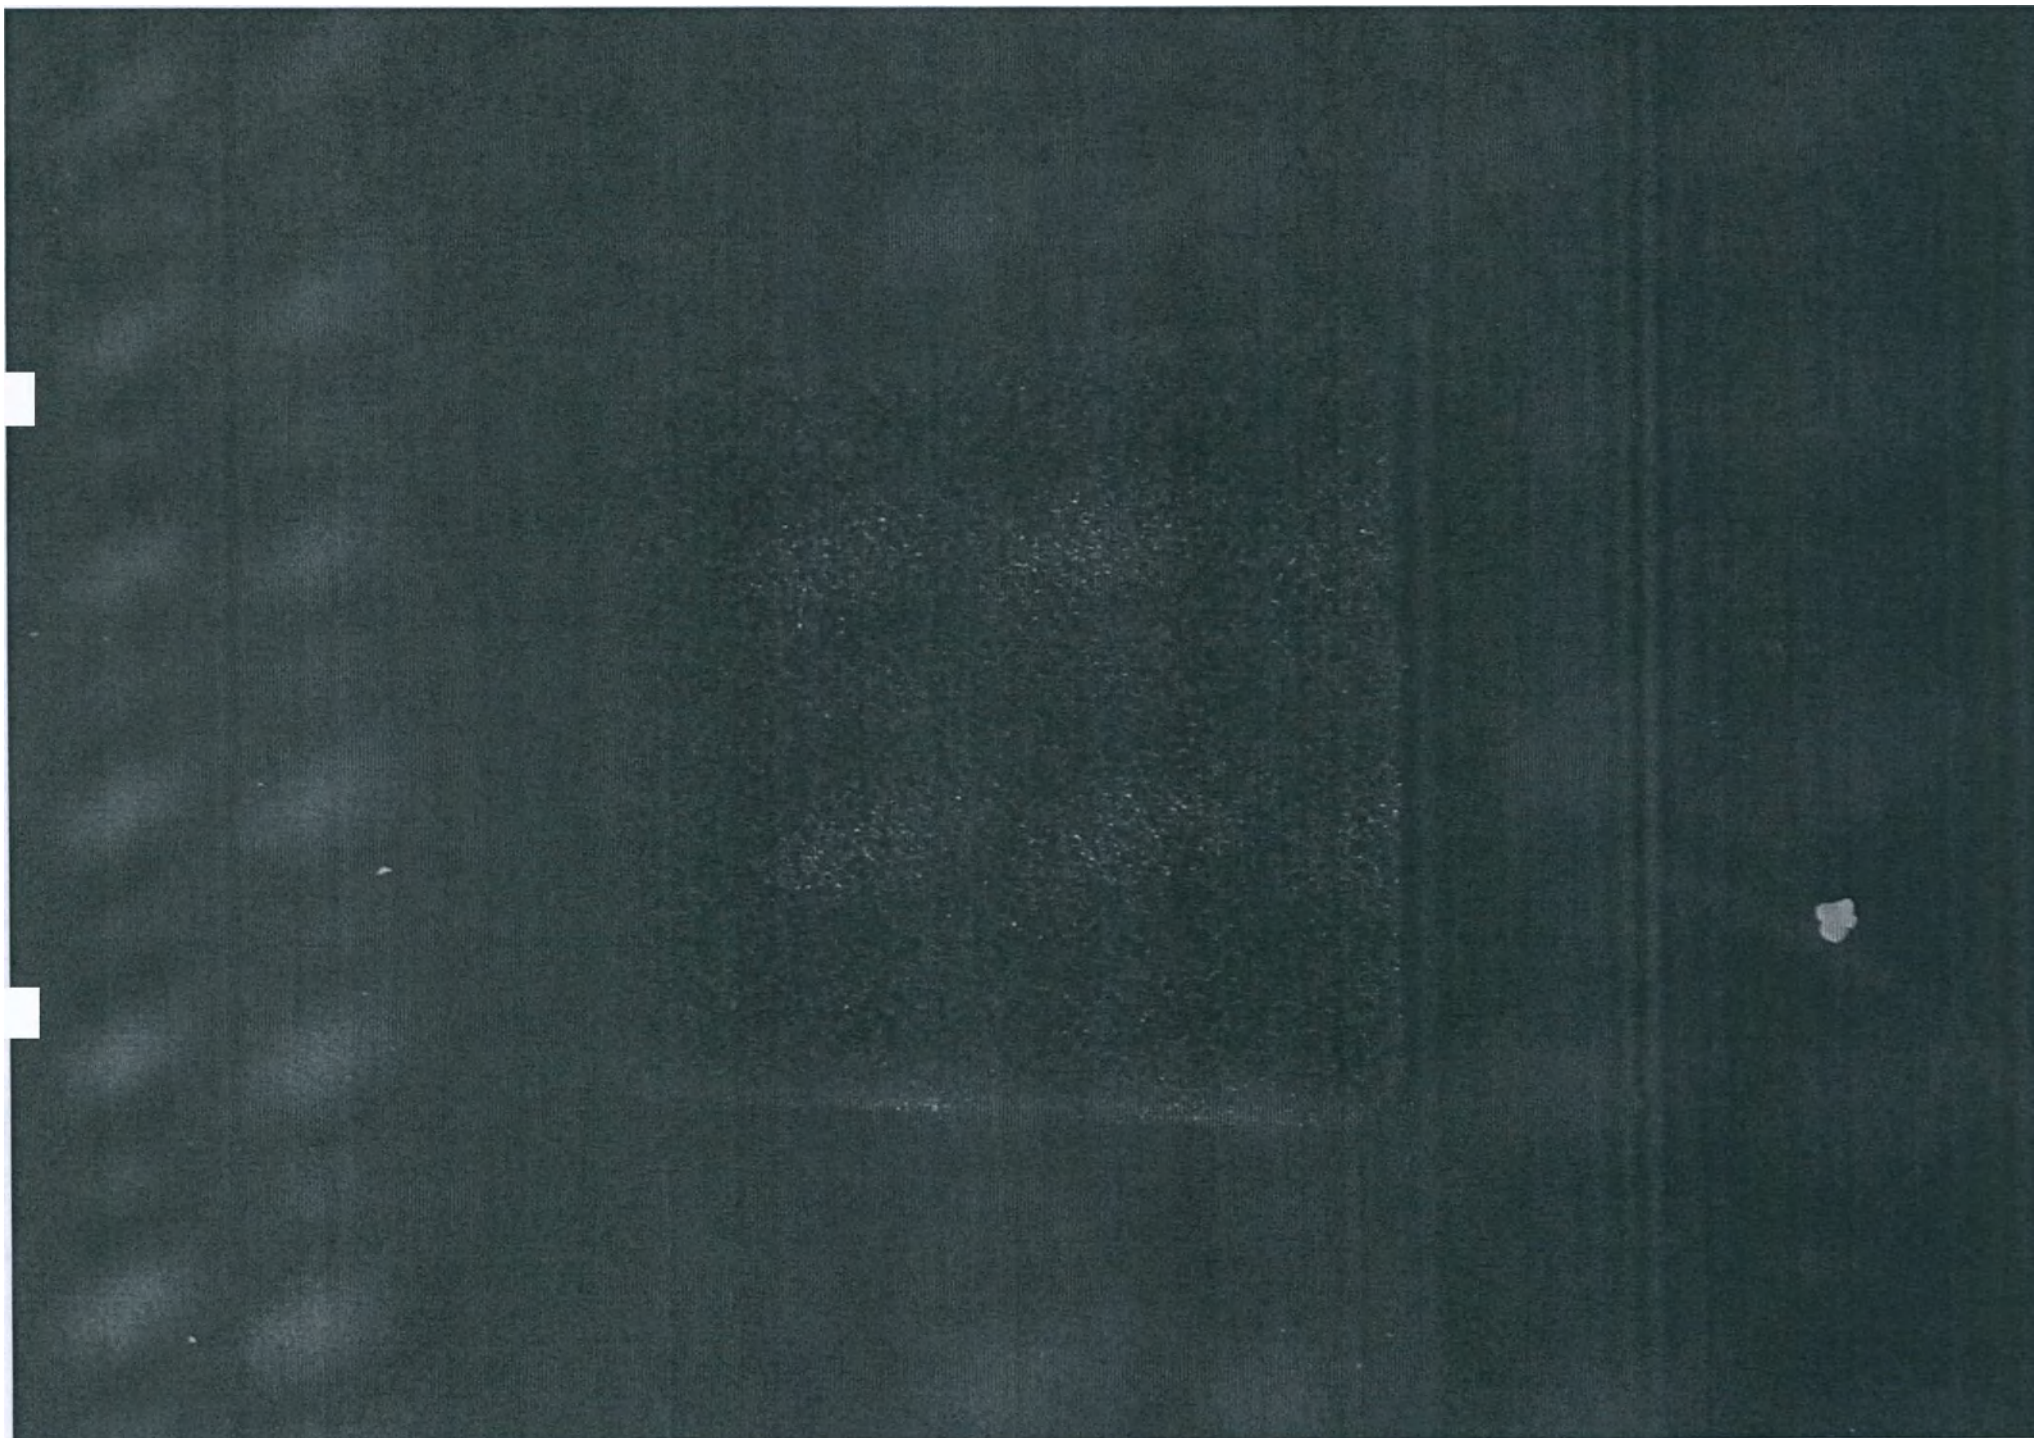


Рис. 48 – Фильтр грубой очистки

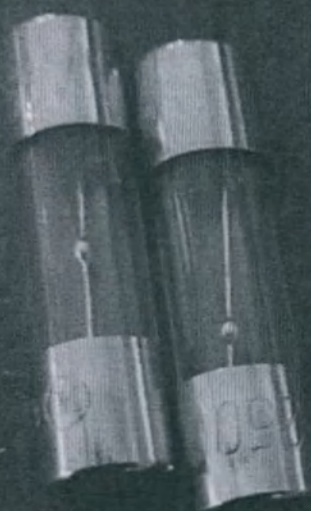


Рис. 49 – Предохранитель плавкий Т5АL250V (2 шт.)

VIII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3N, в составе:

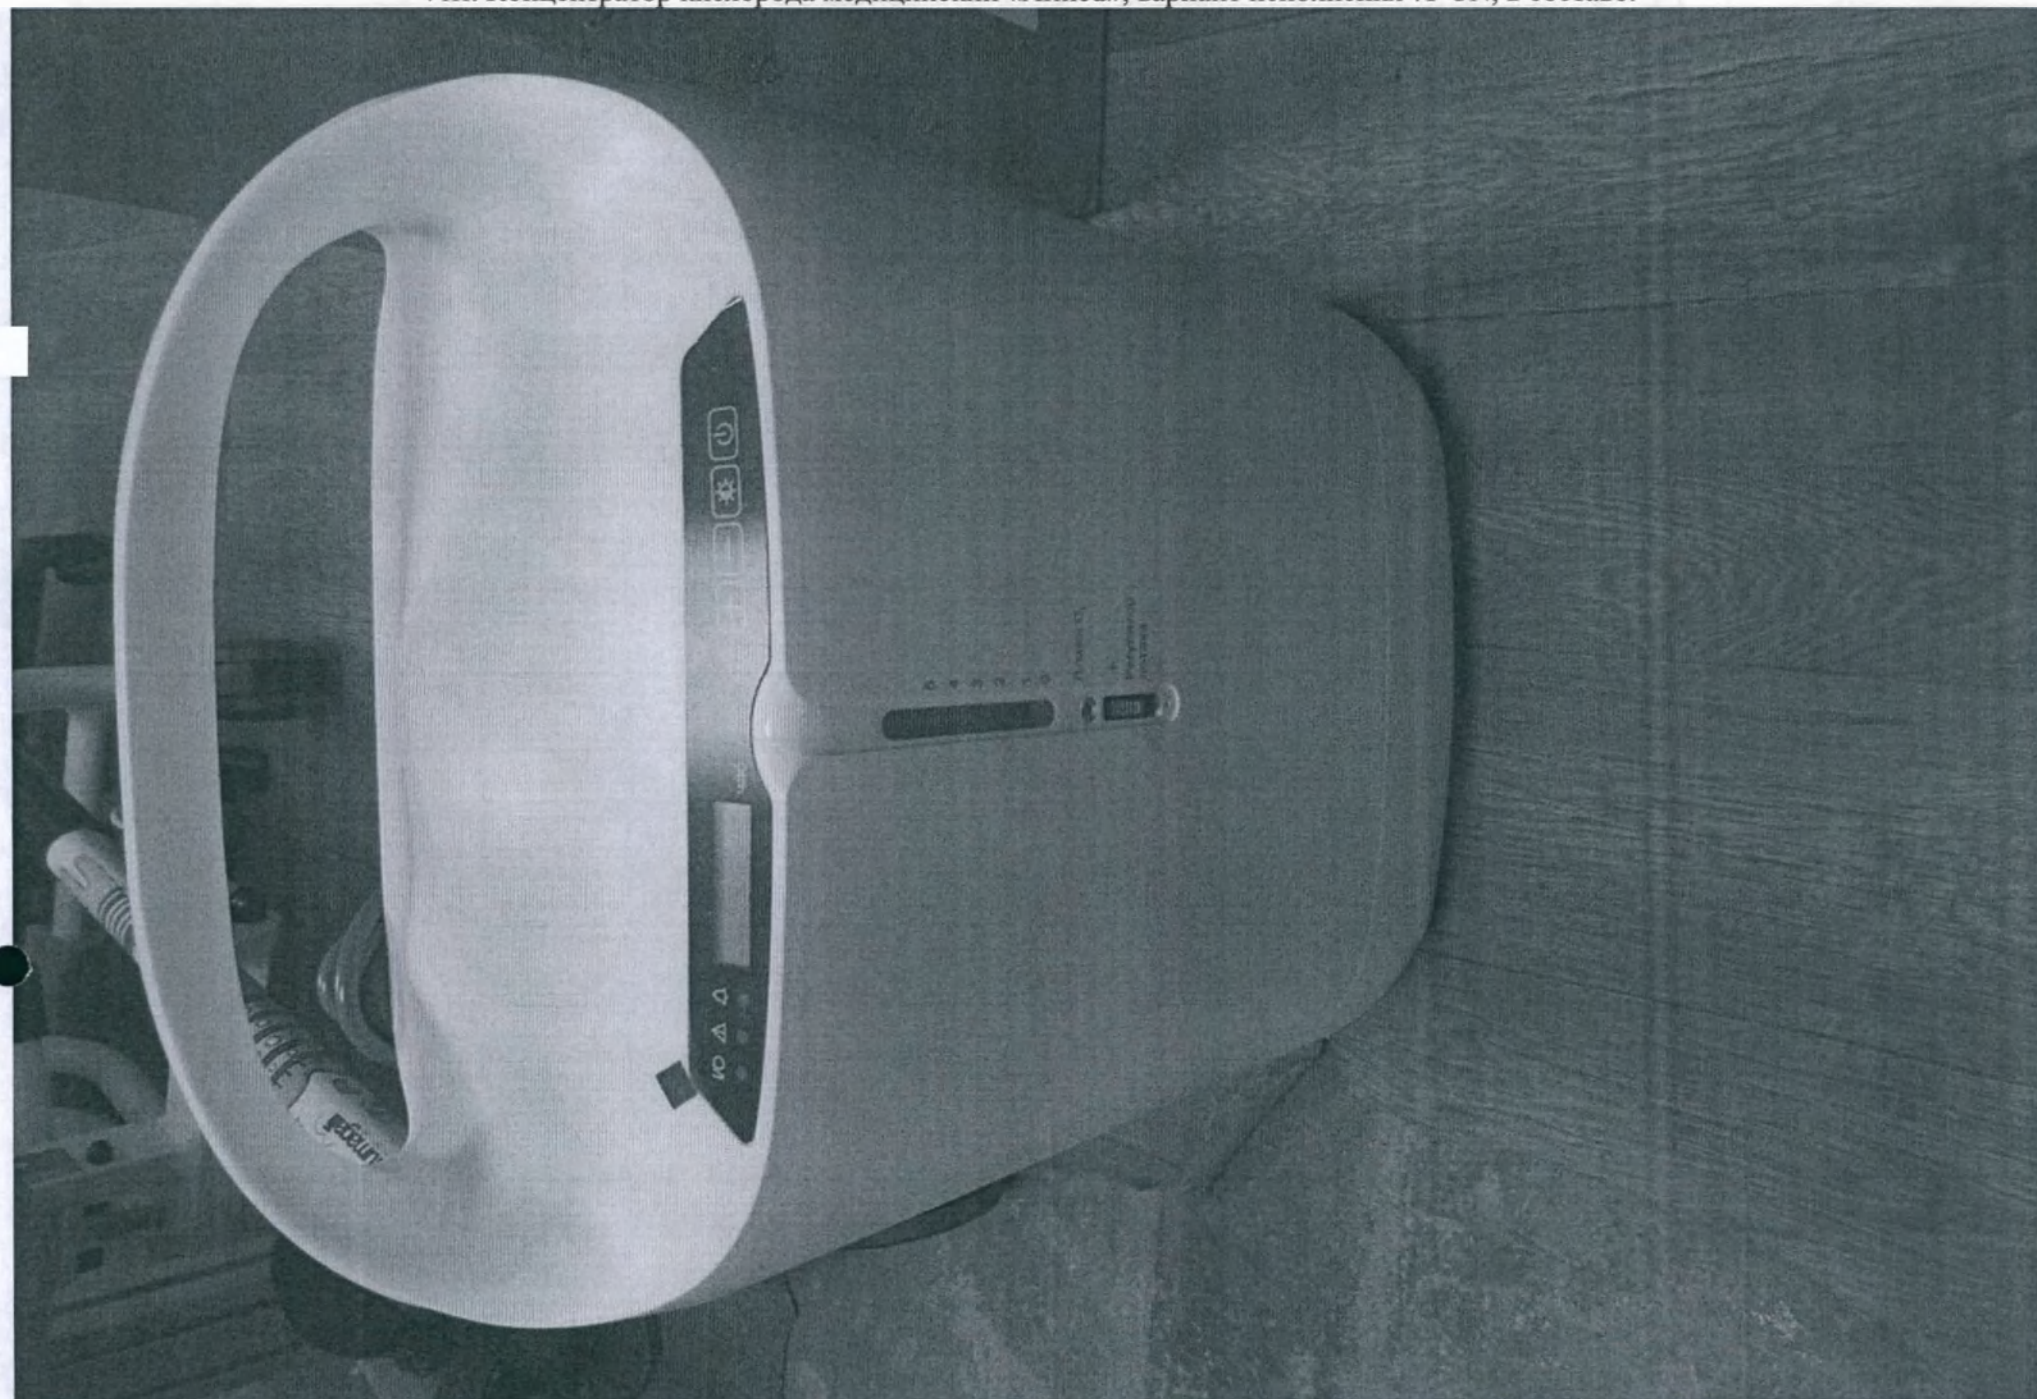


Рис. 50 – Концентратор кислорода

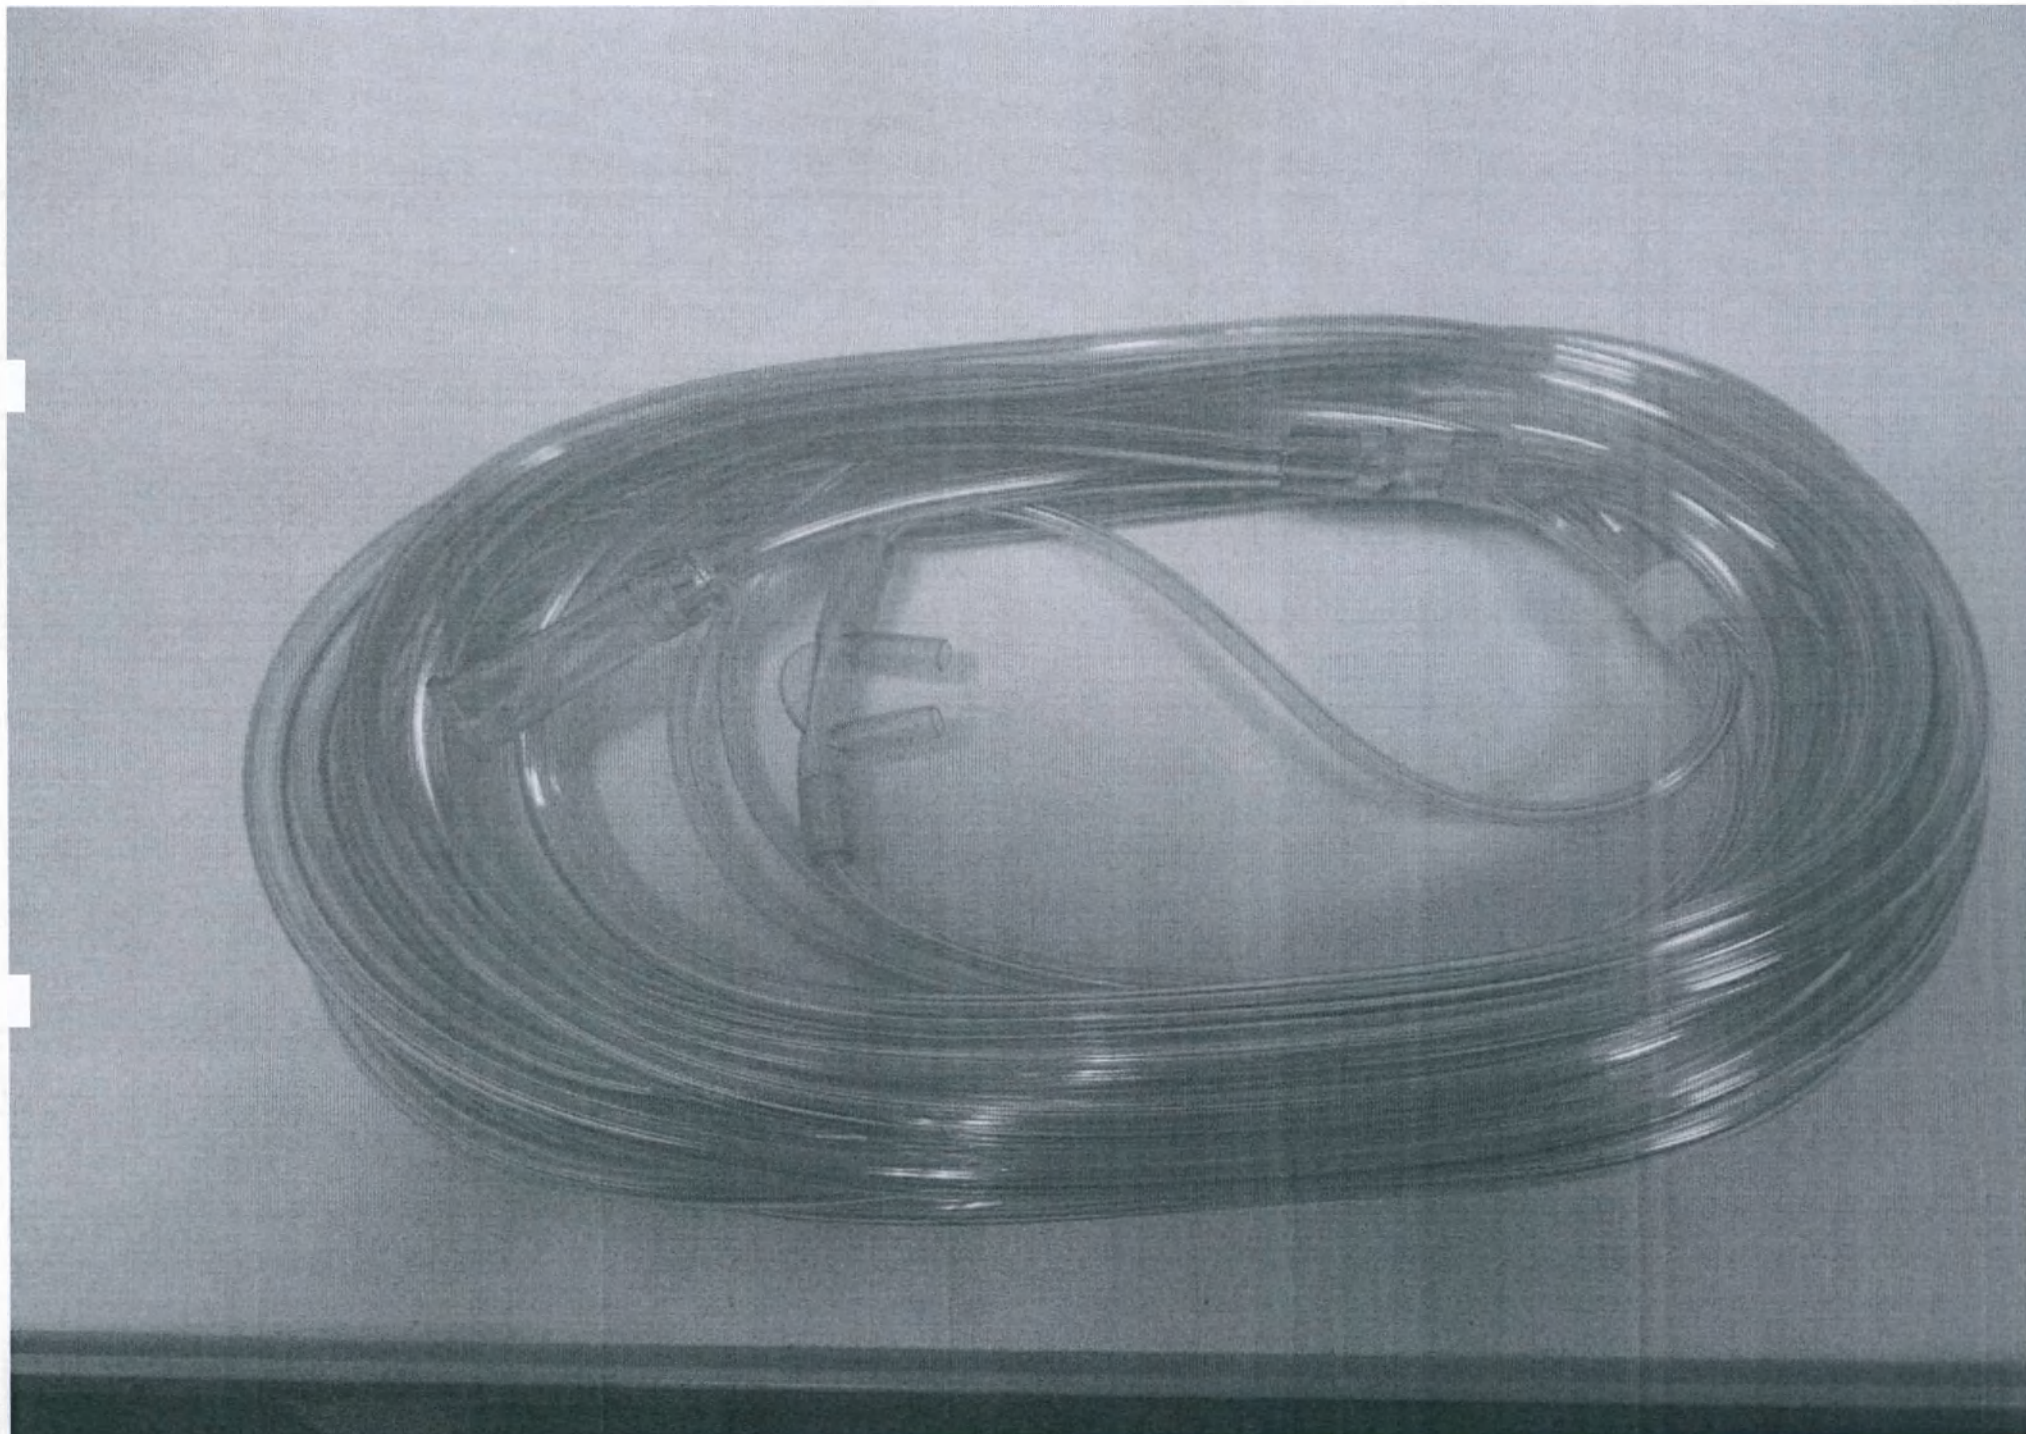


Рис. 51 – Канюля назальная большая

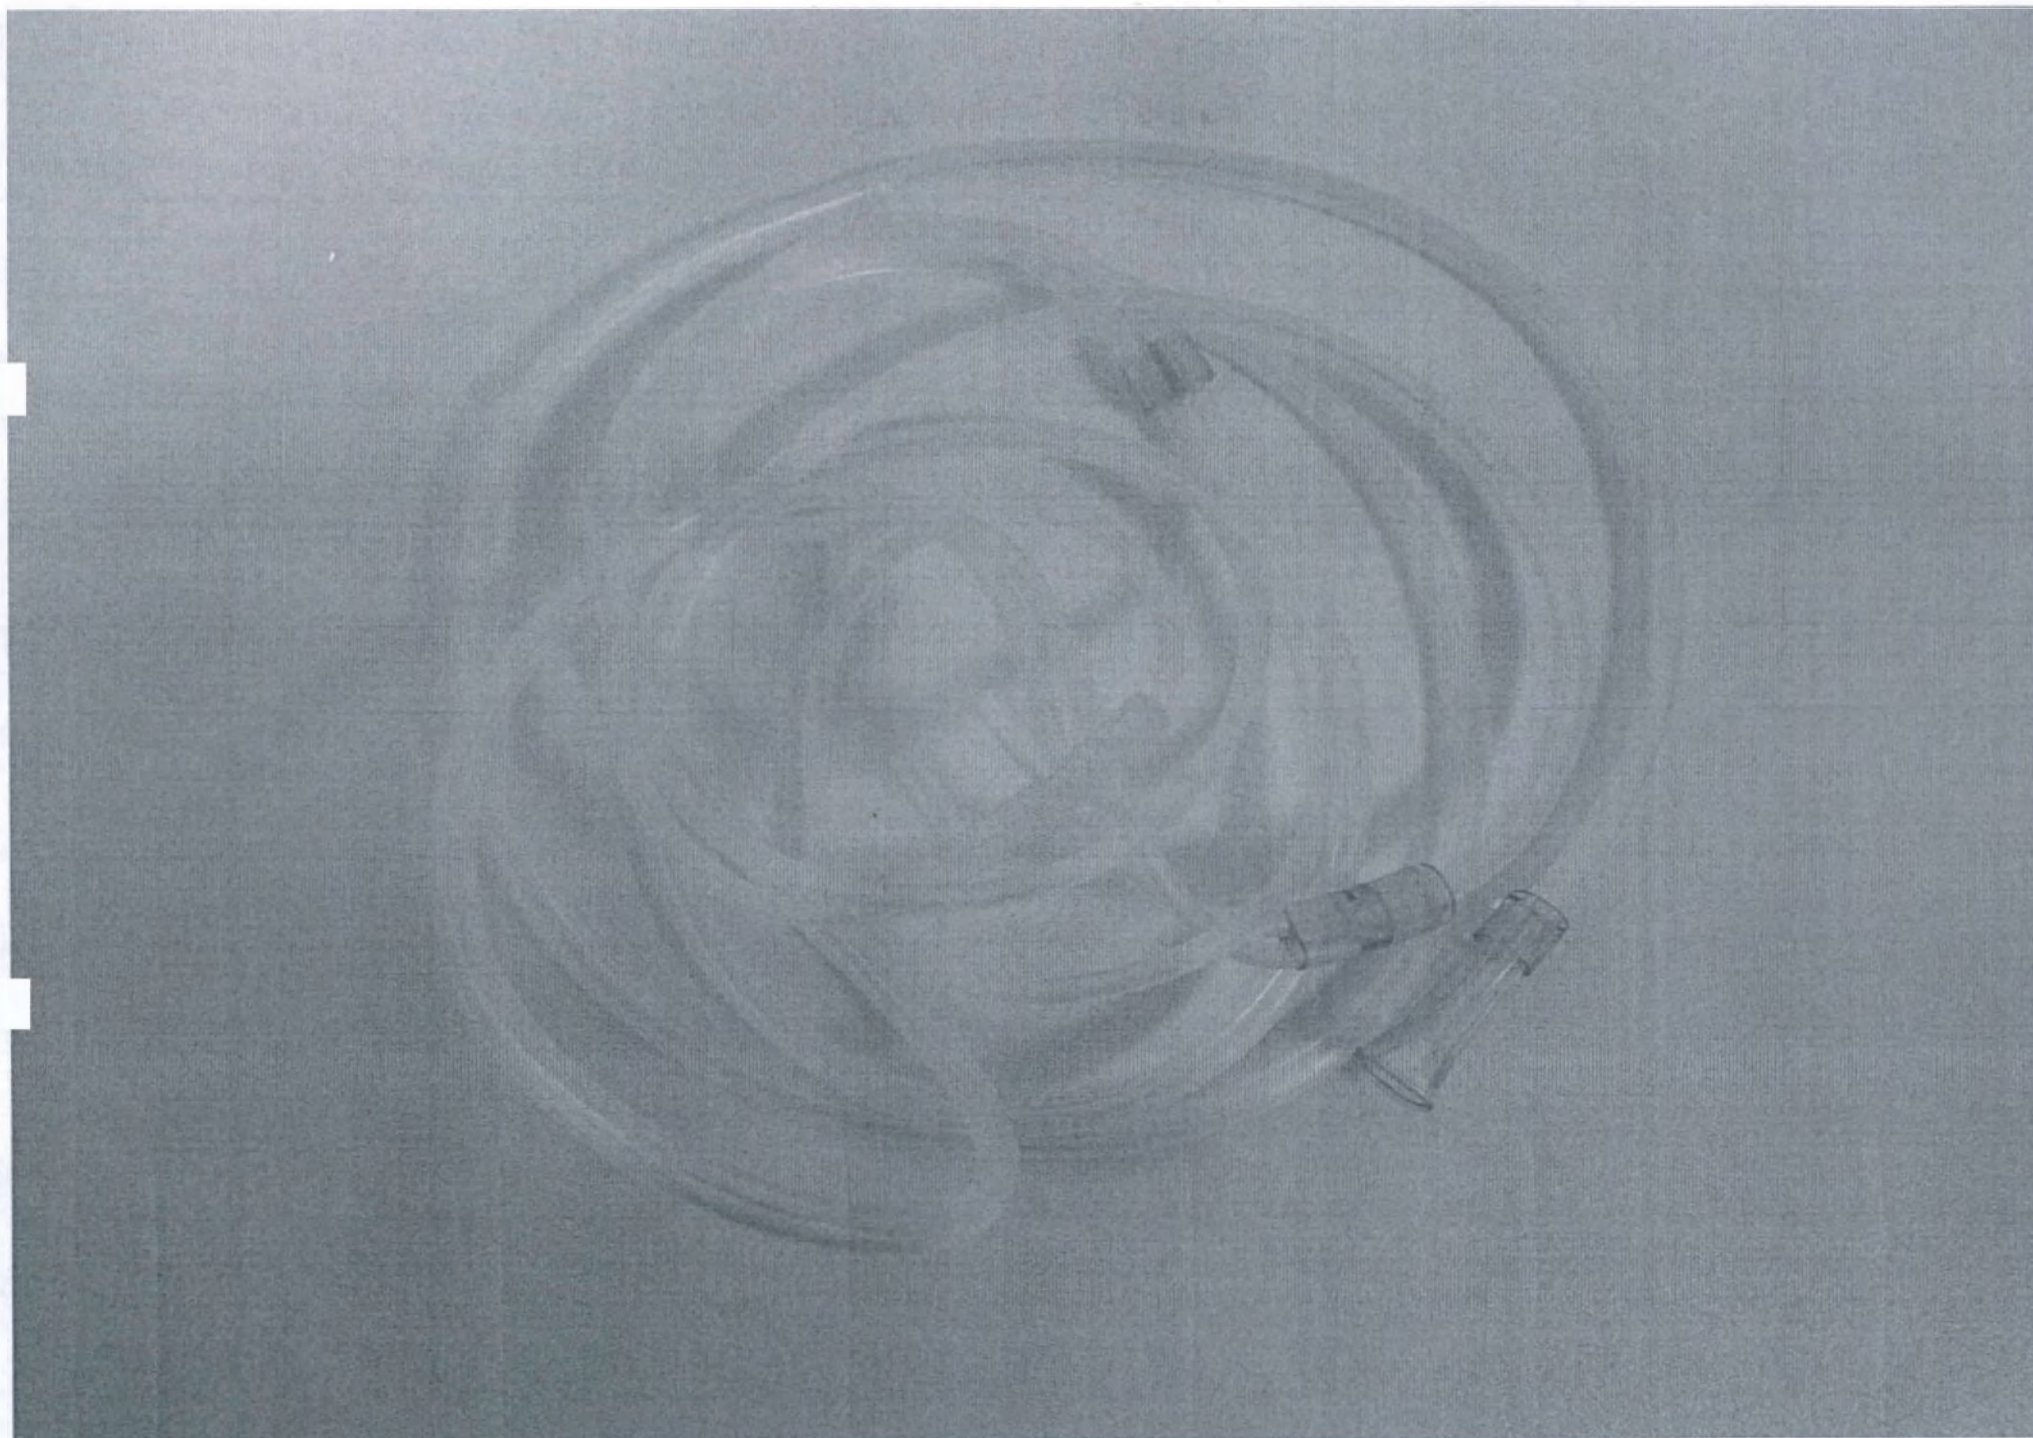


Рис. 52 – Канюля назальная малая

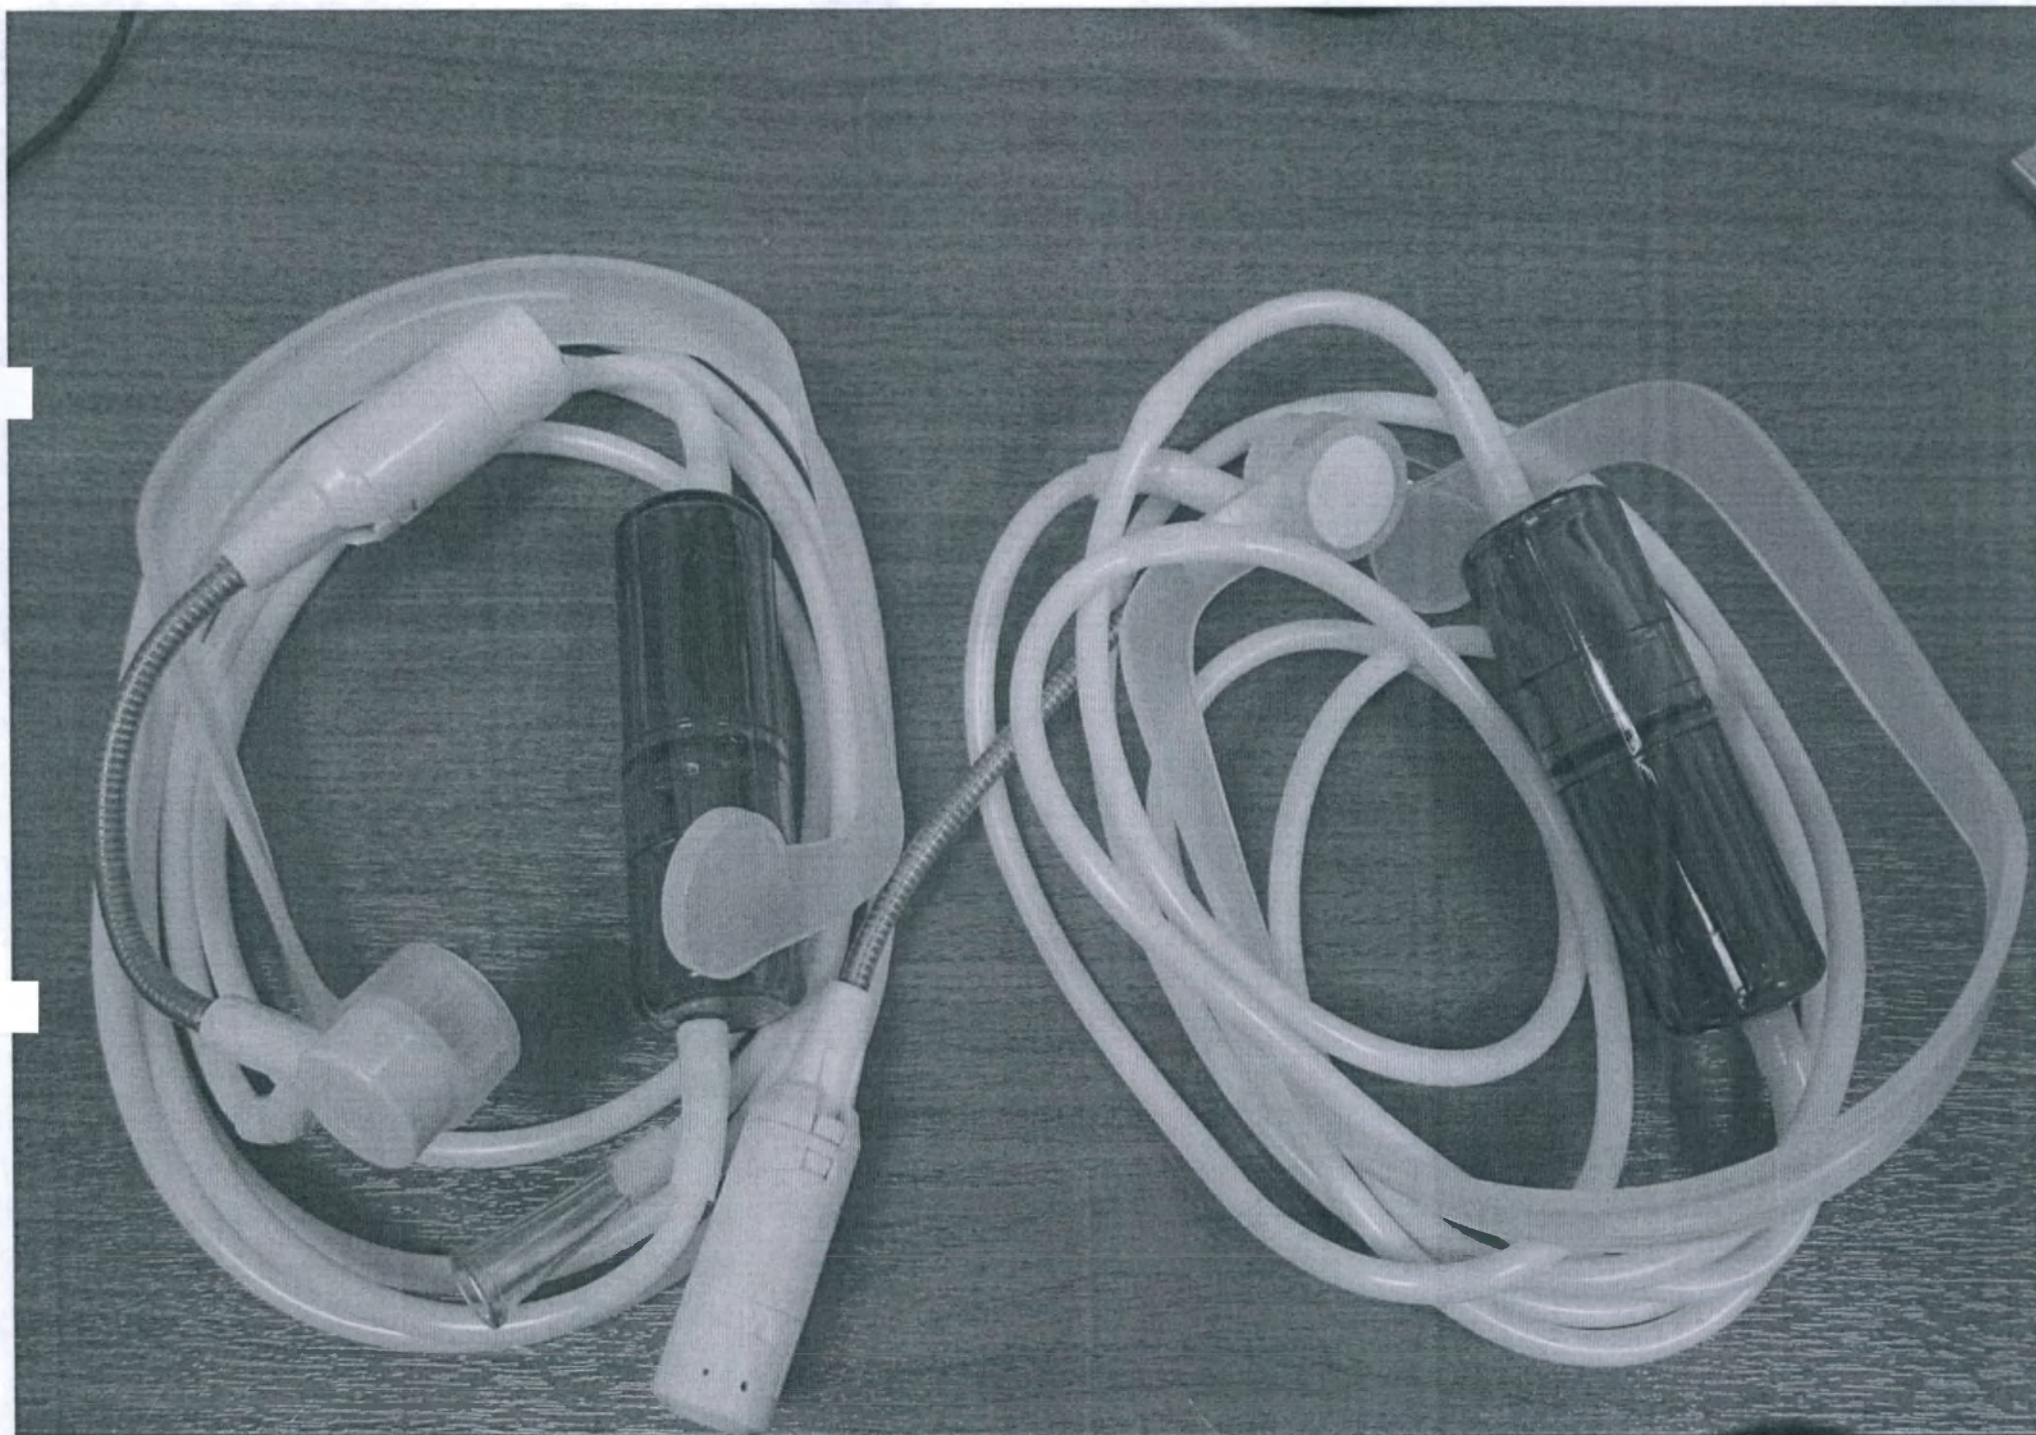


Рис. 53 – Диффузор (2 шт.)

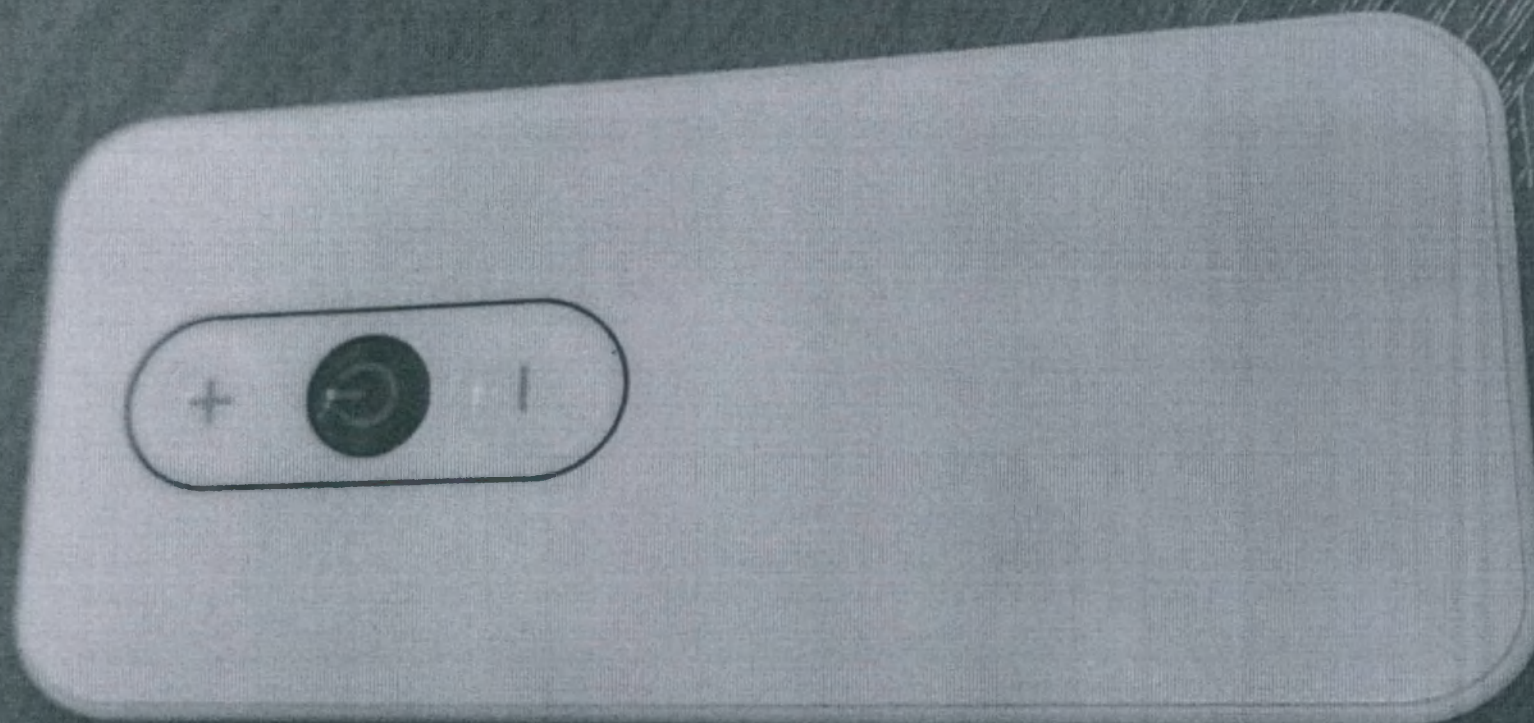


Рис. 54 – Пульт ДУ

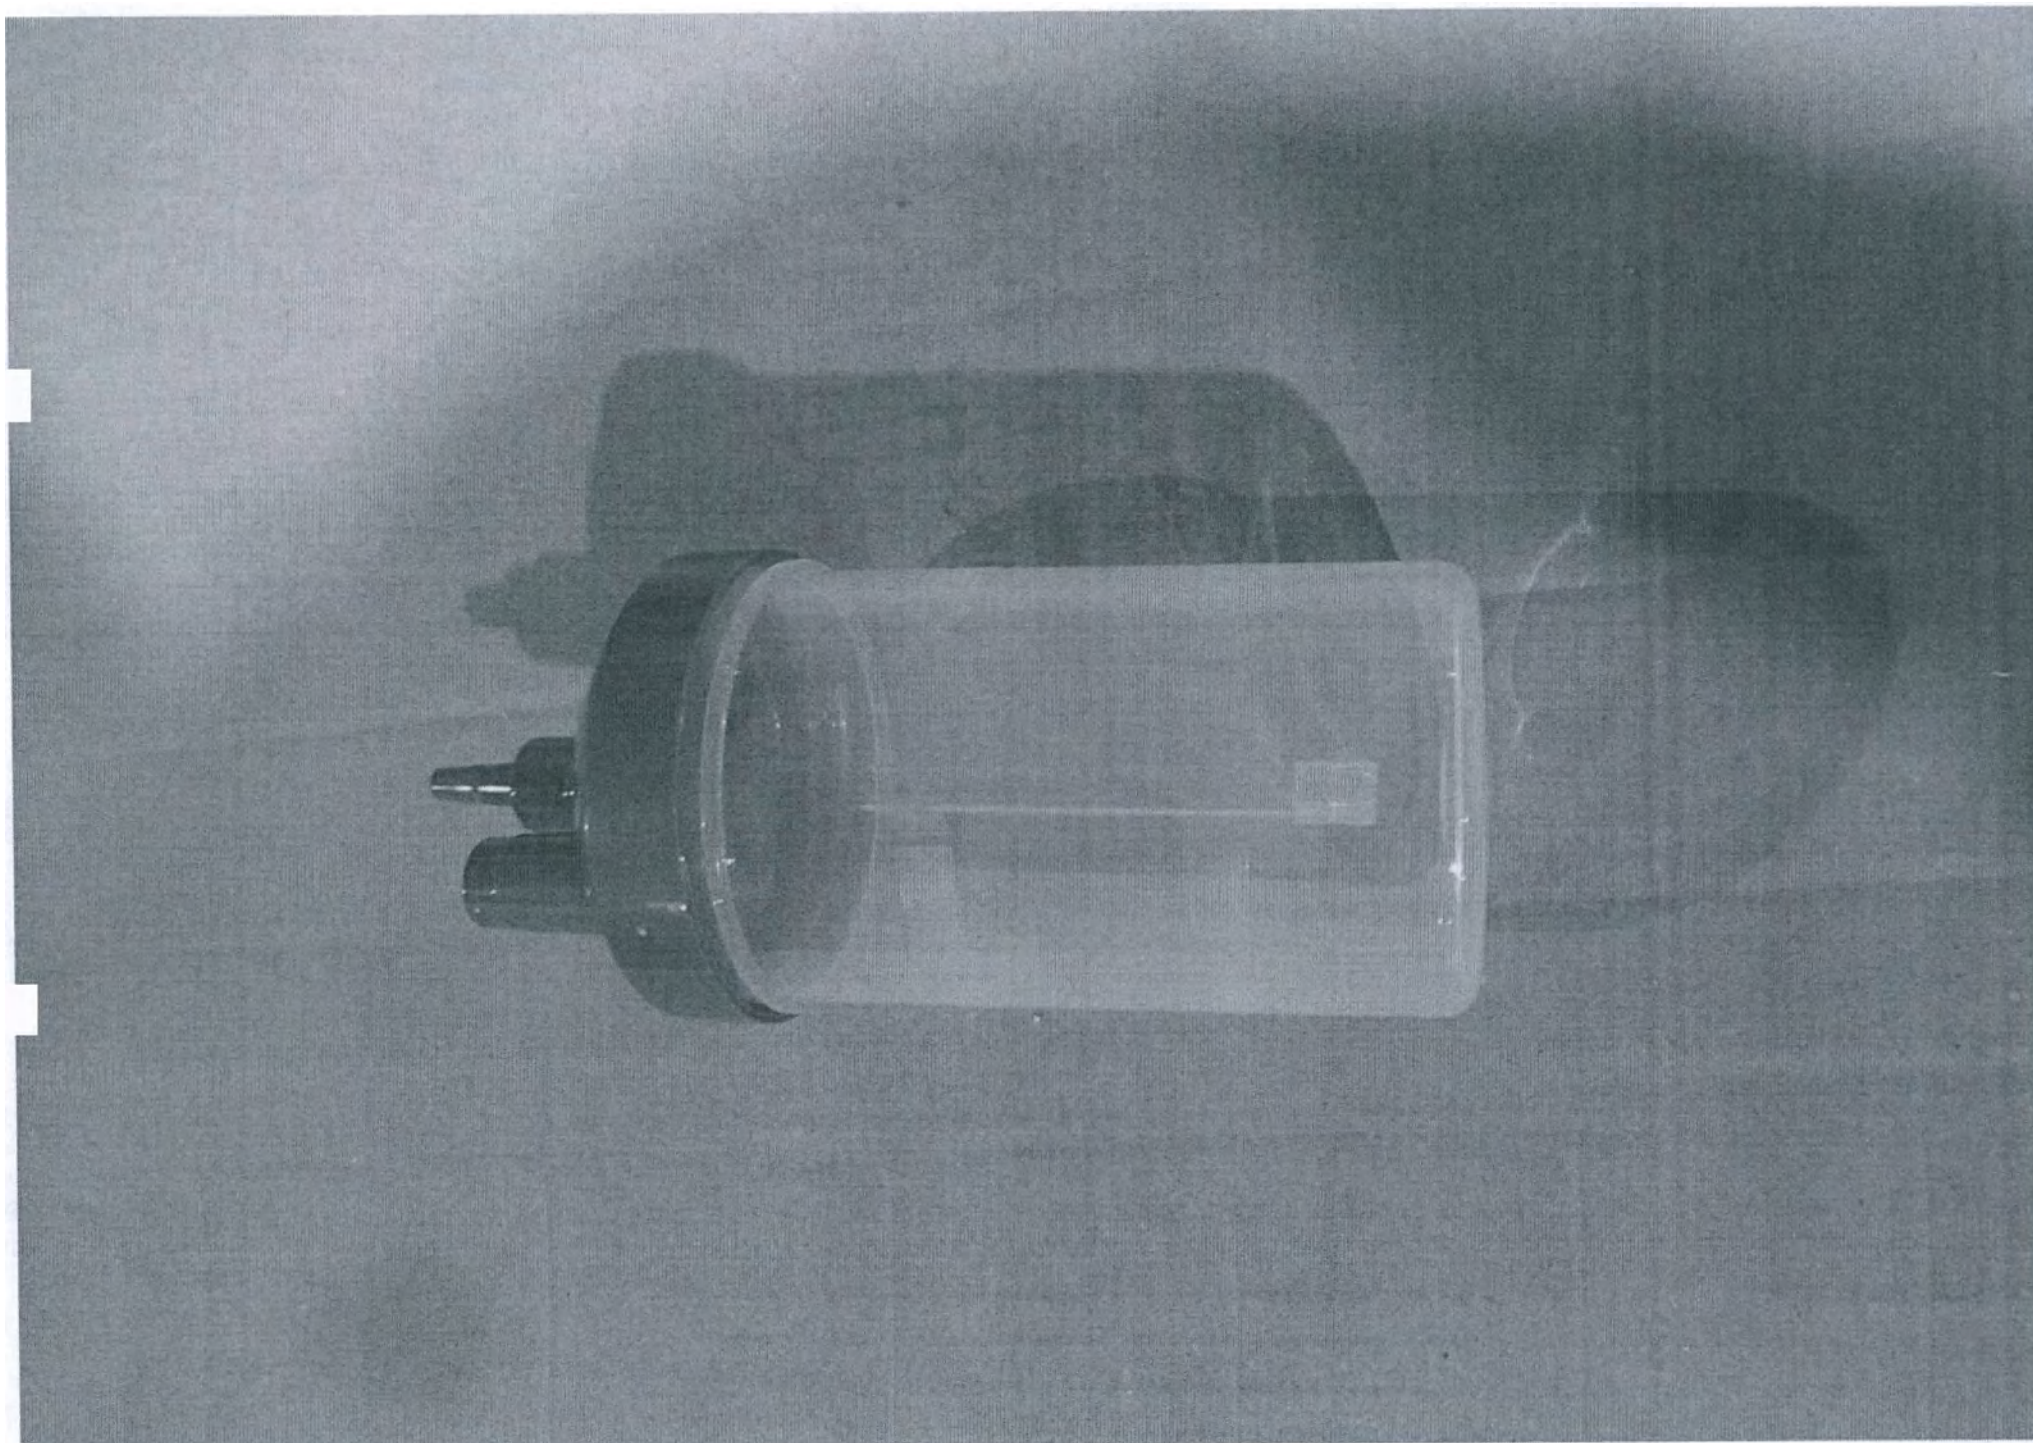


Рис. 55 – Увлажнитель

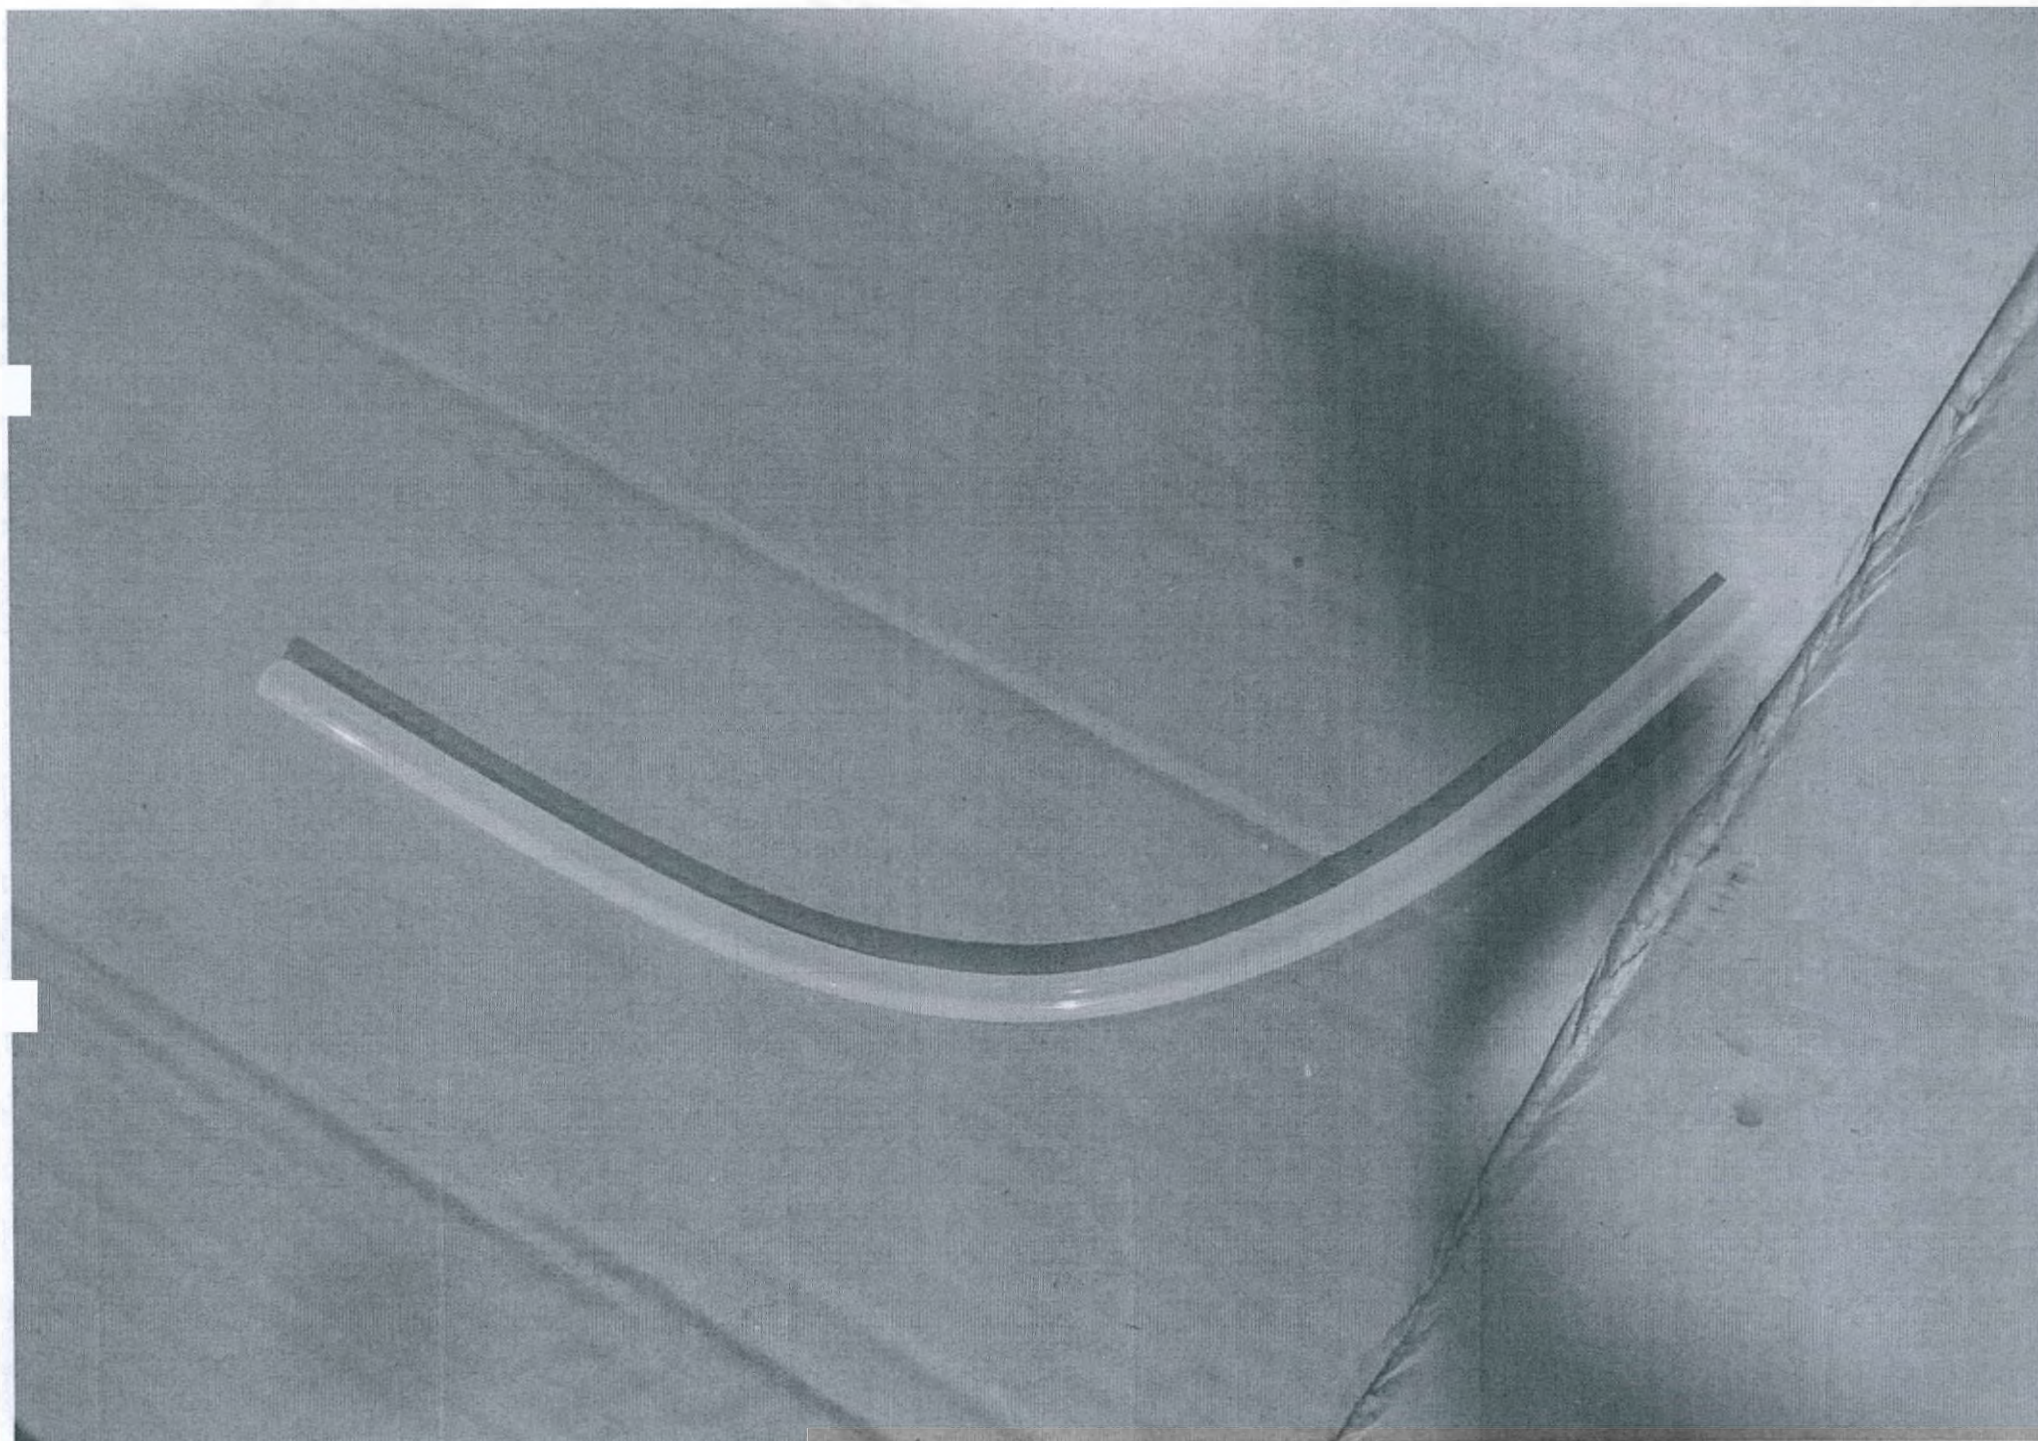


Рис. 56 – Шланг для увлажнителя

IX. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3NW, в составе:

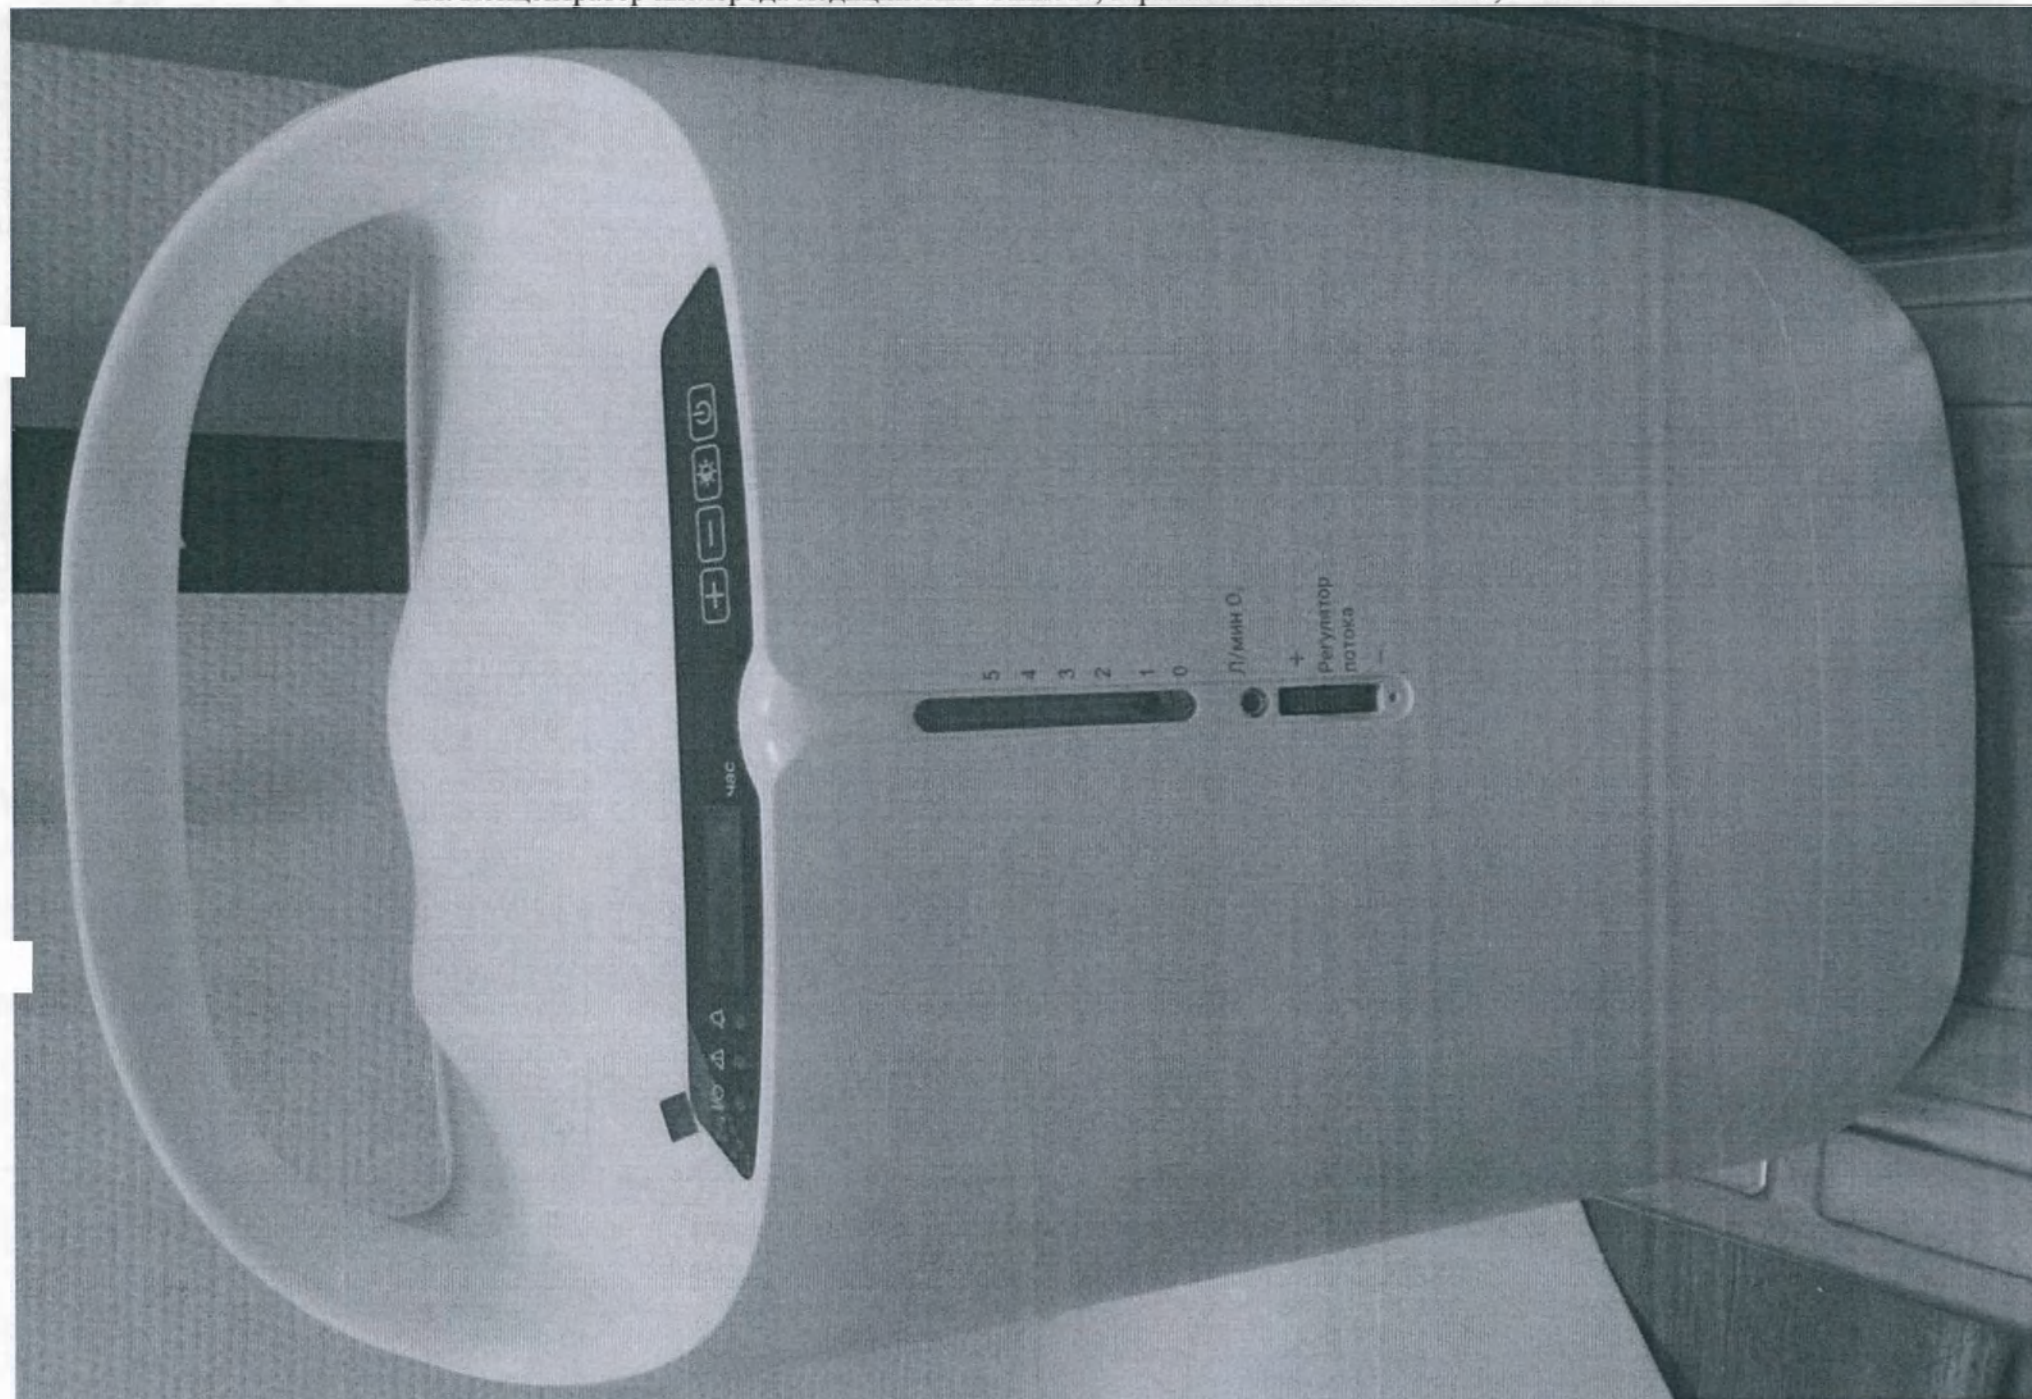


Рис. 57 – Концентратор кислорода

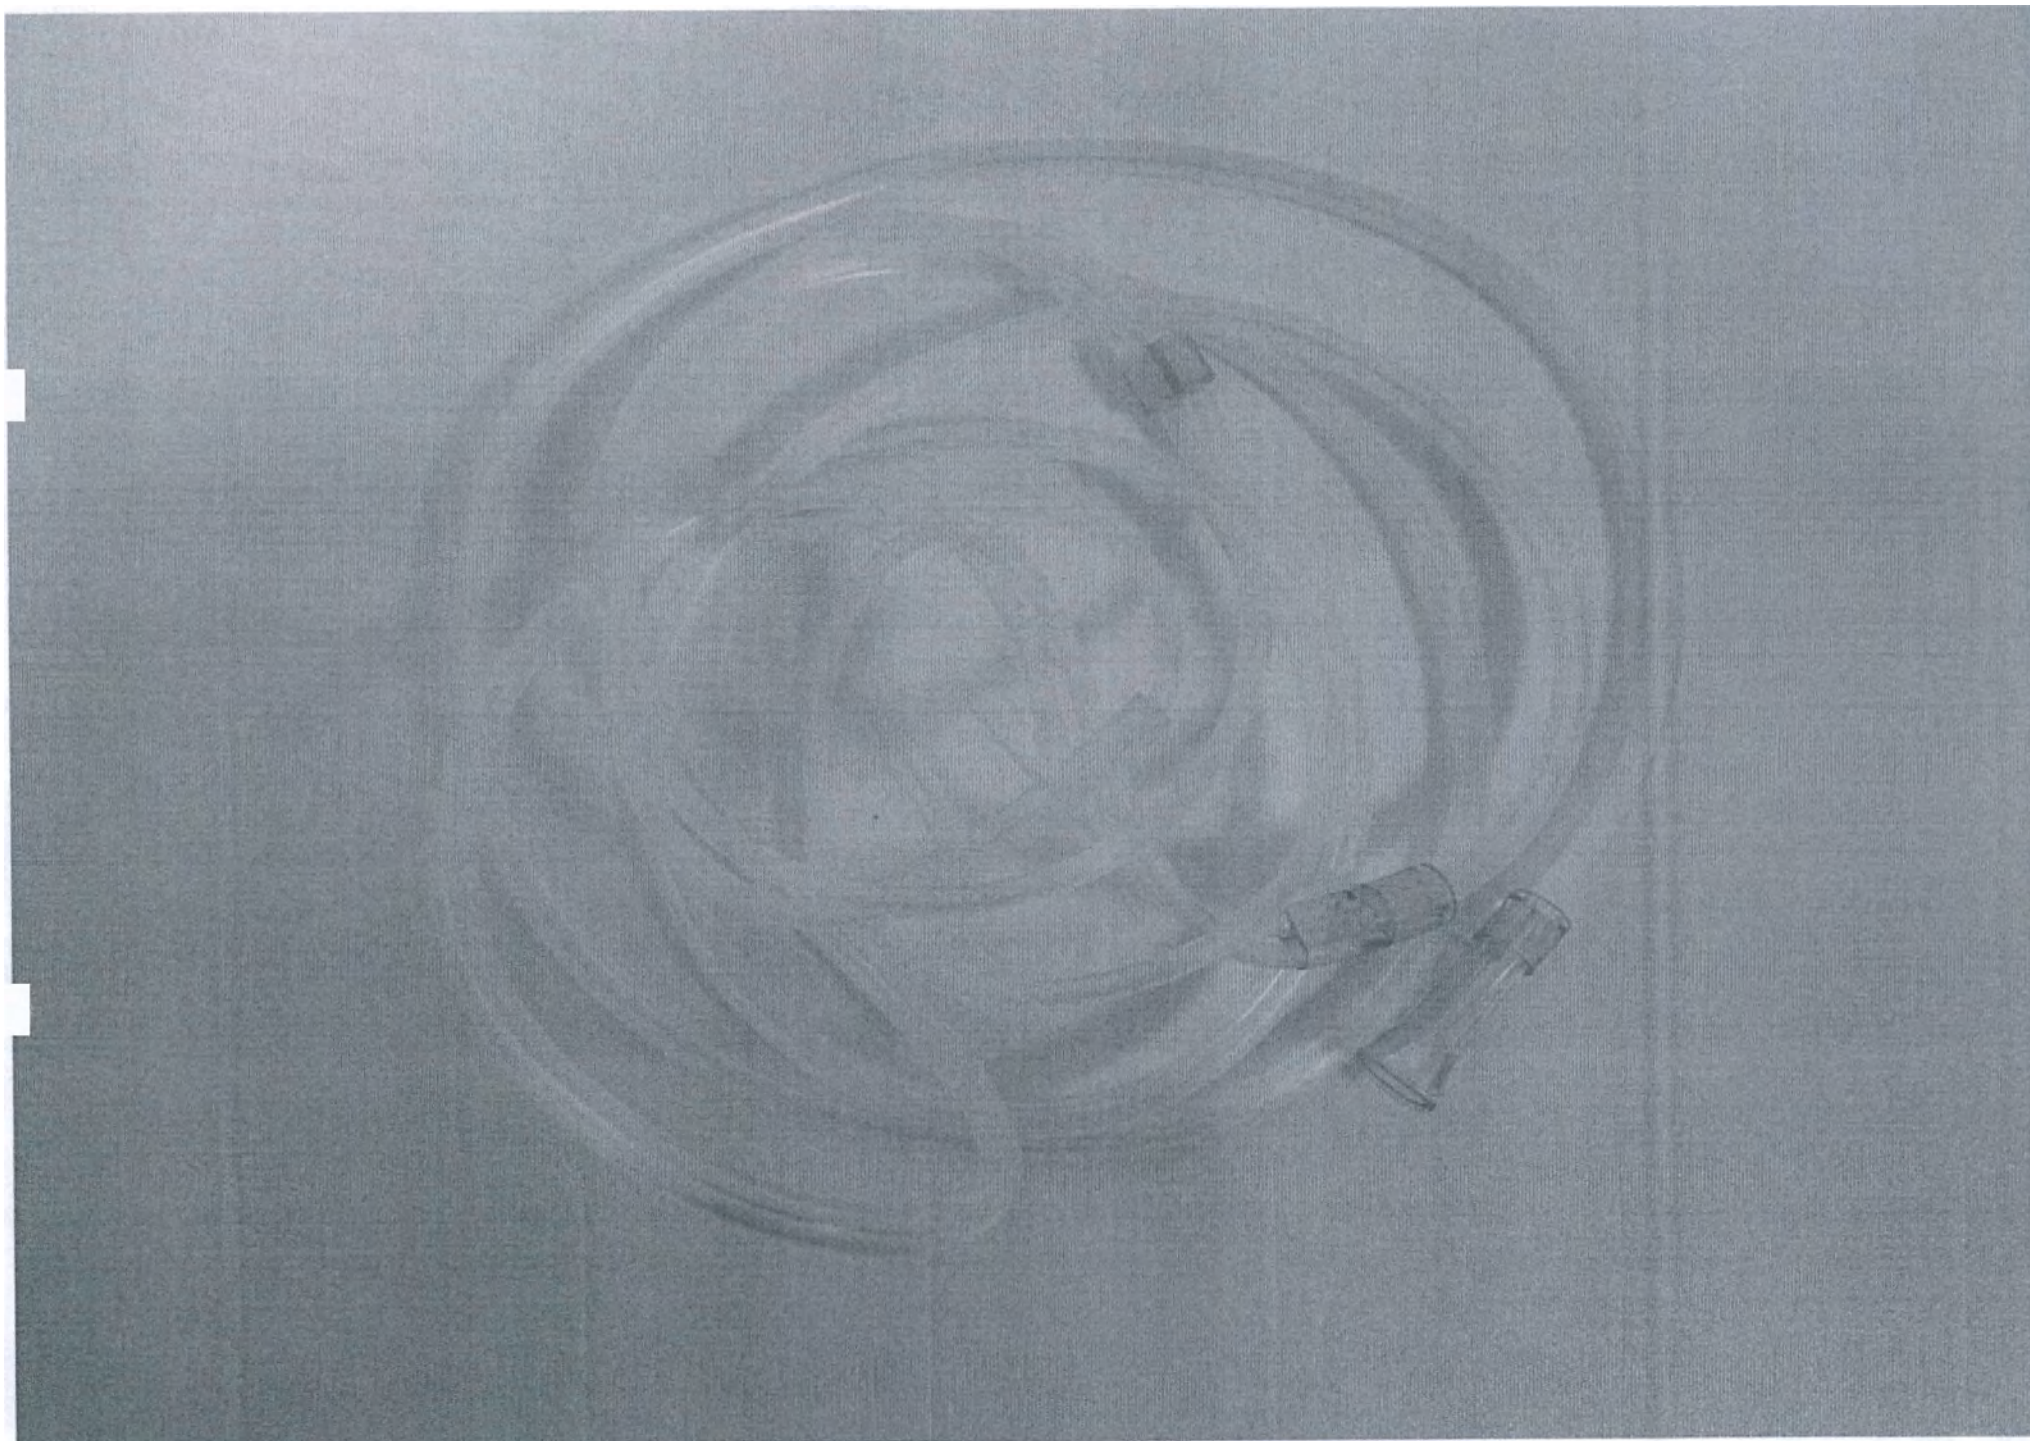


Рис. 58 – Канюля назальная малая

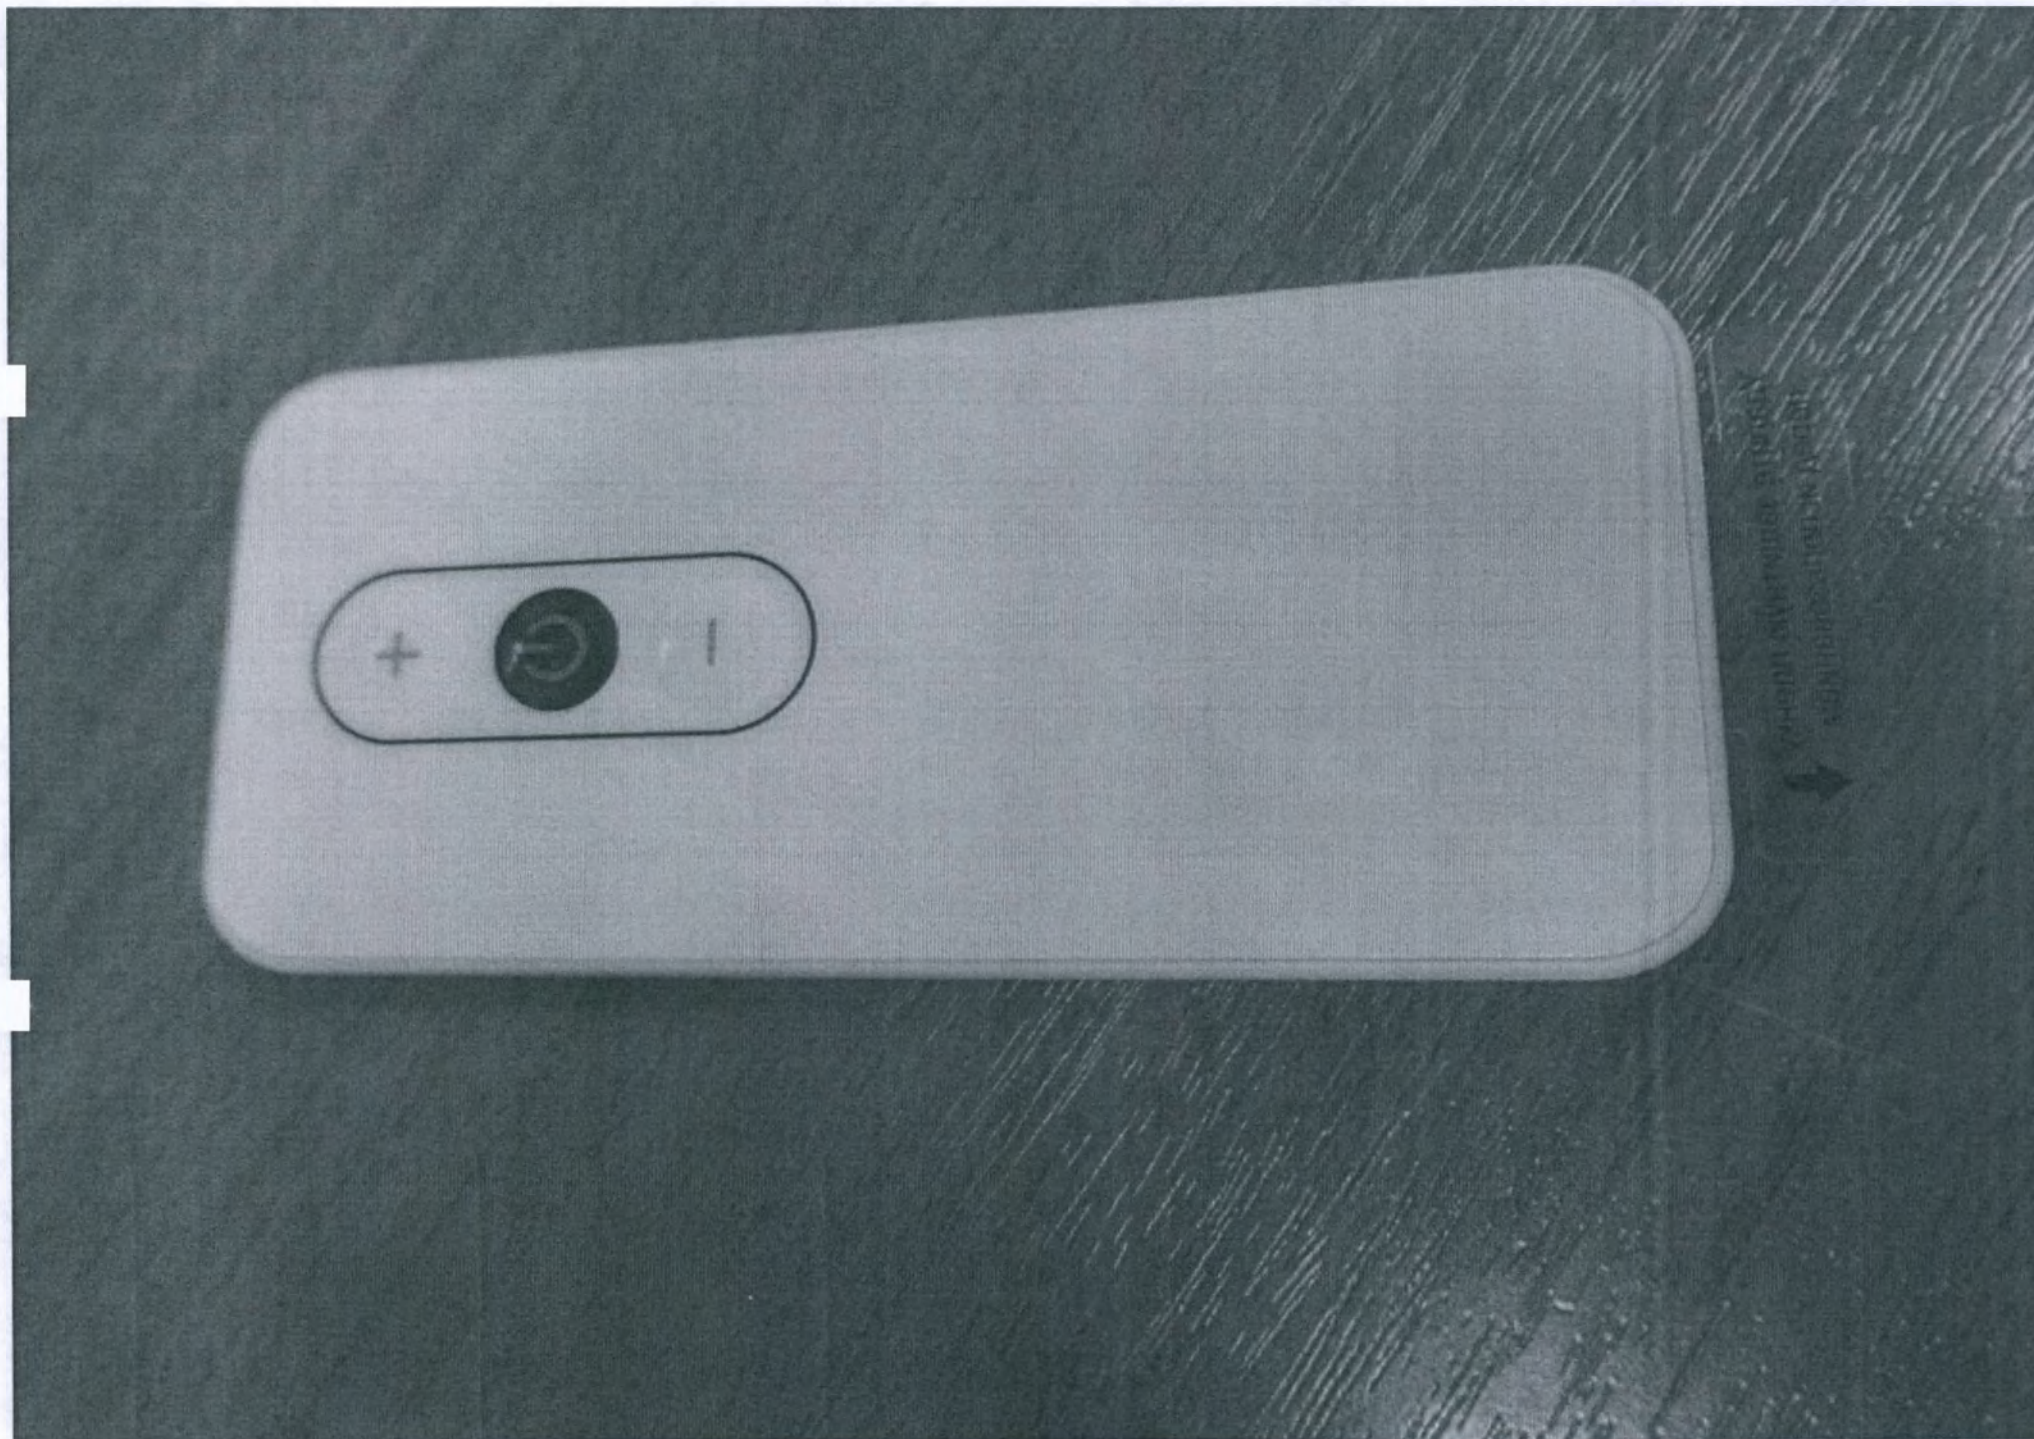


Рис. 59 – Пульт ДУ

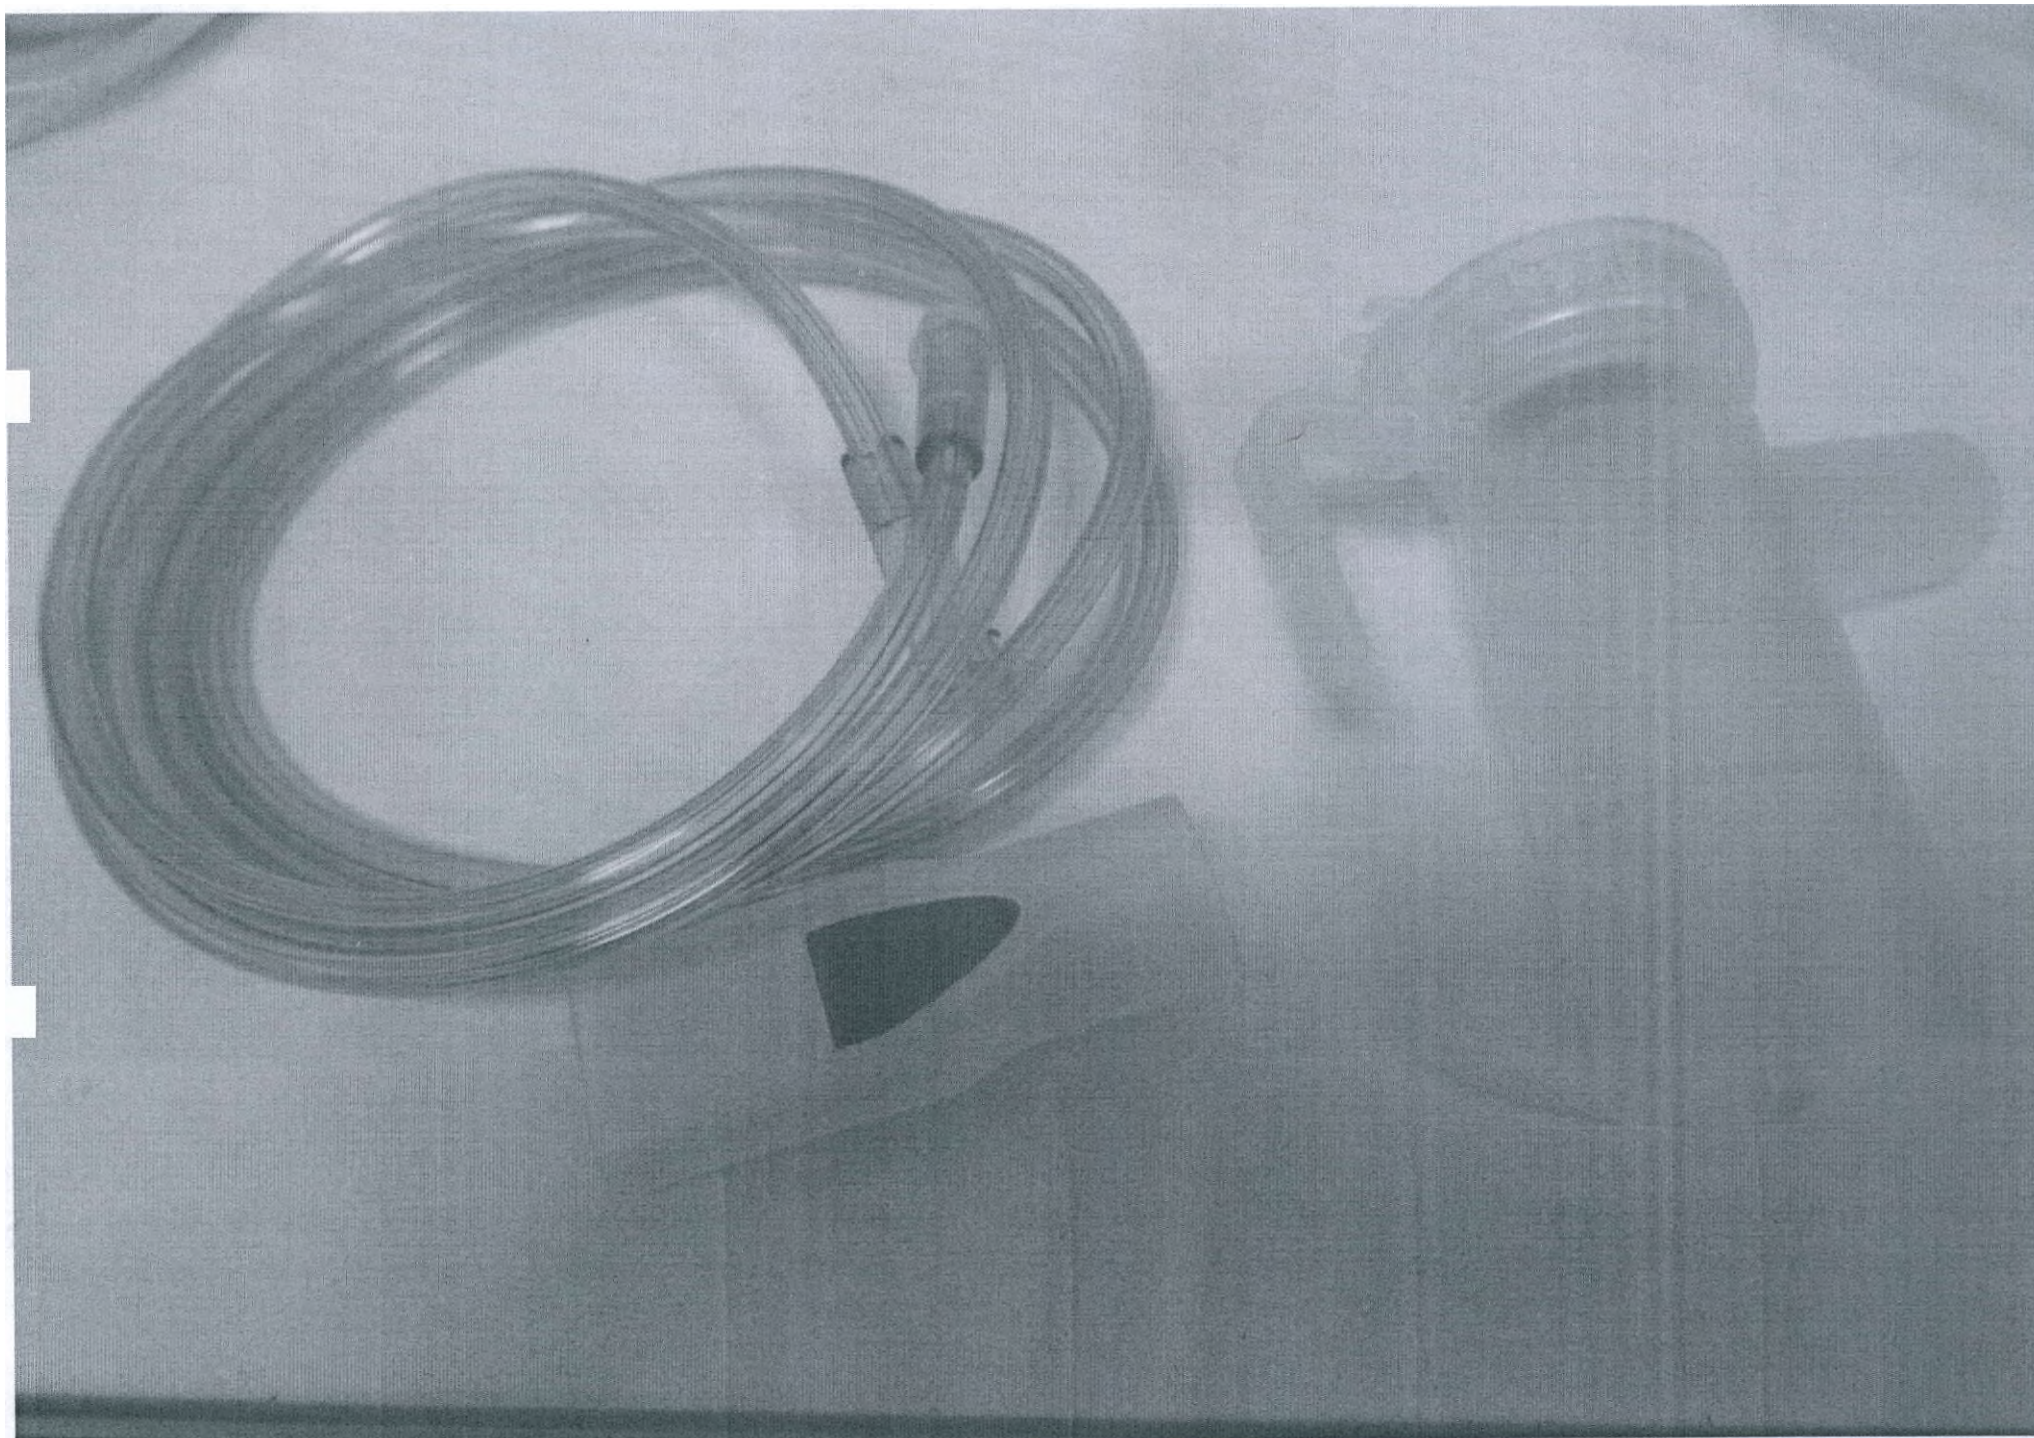


Рис. 60 – Комплект для ингаляции (тип I)

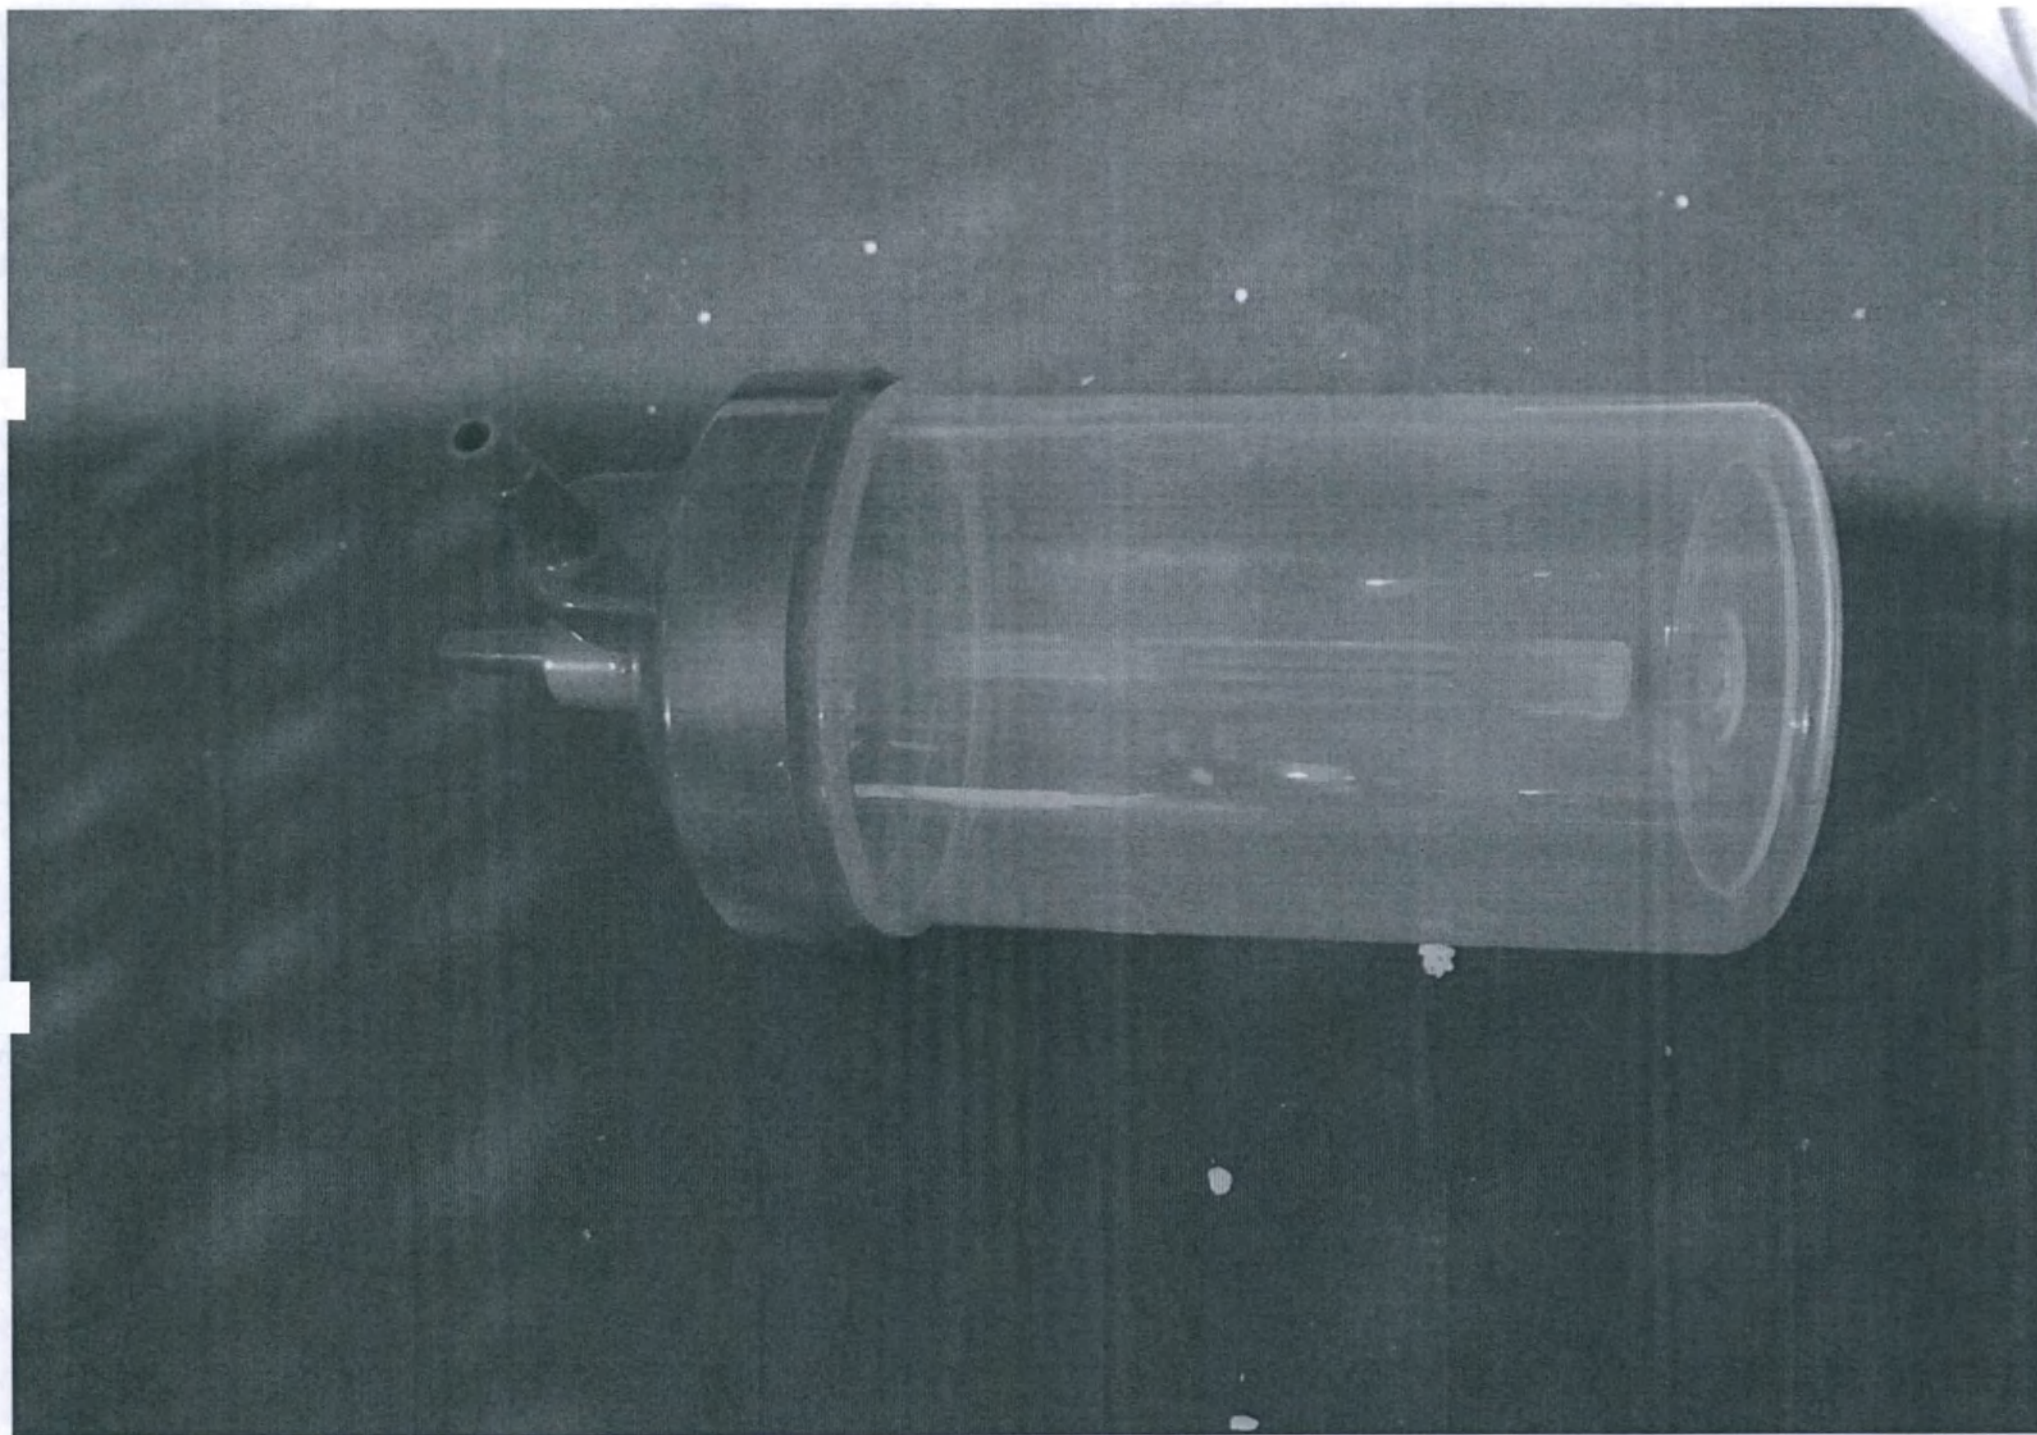


Рис. 61 – Увлажнитель

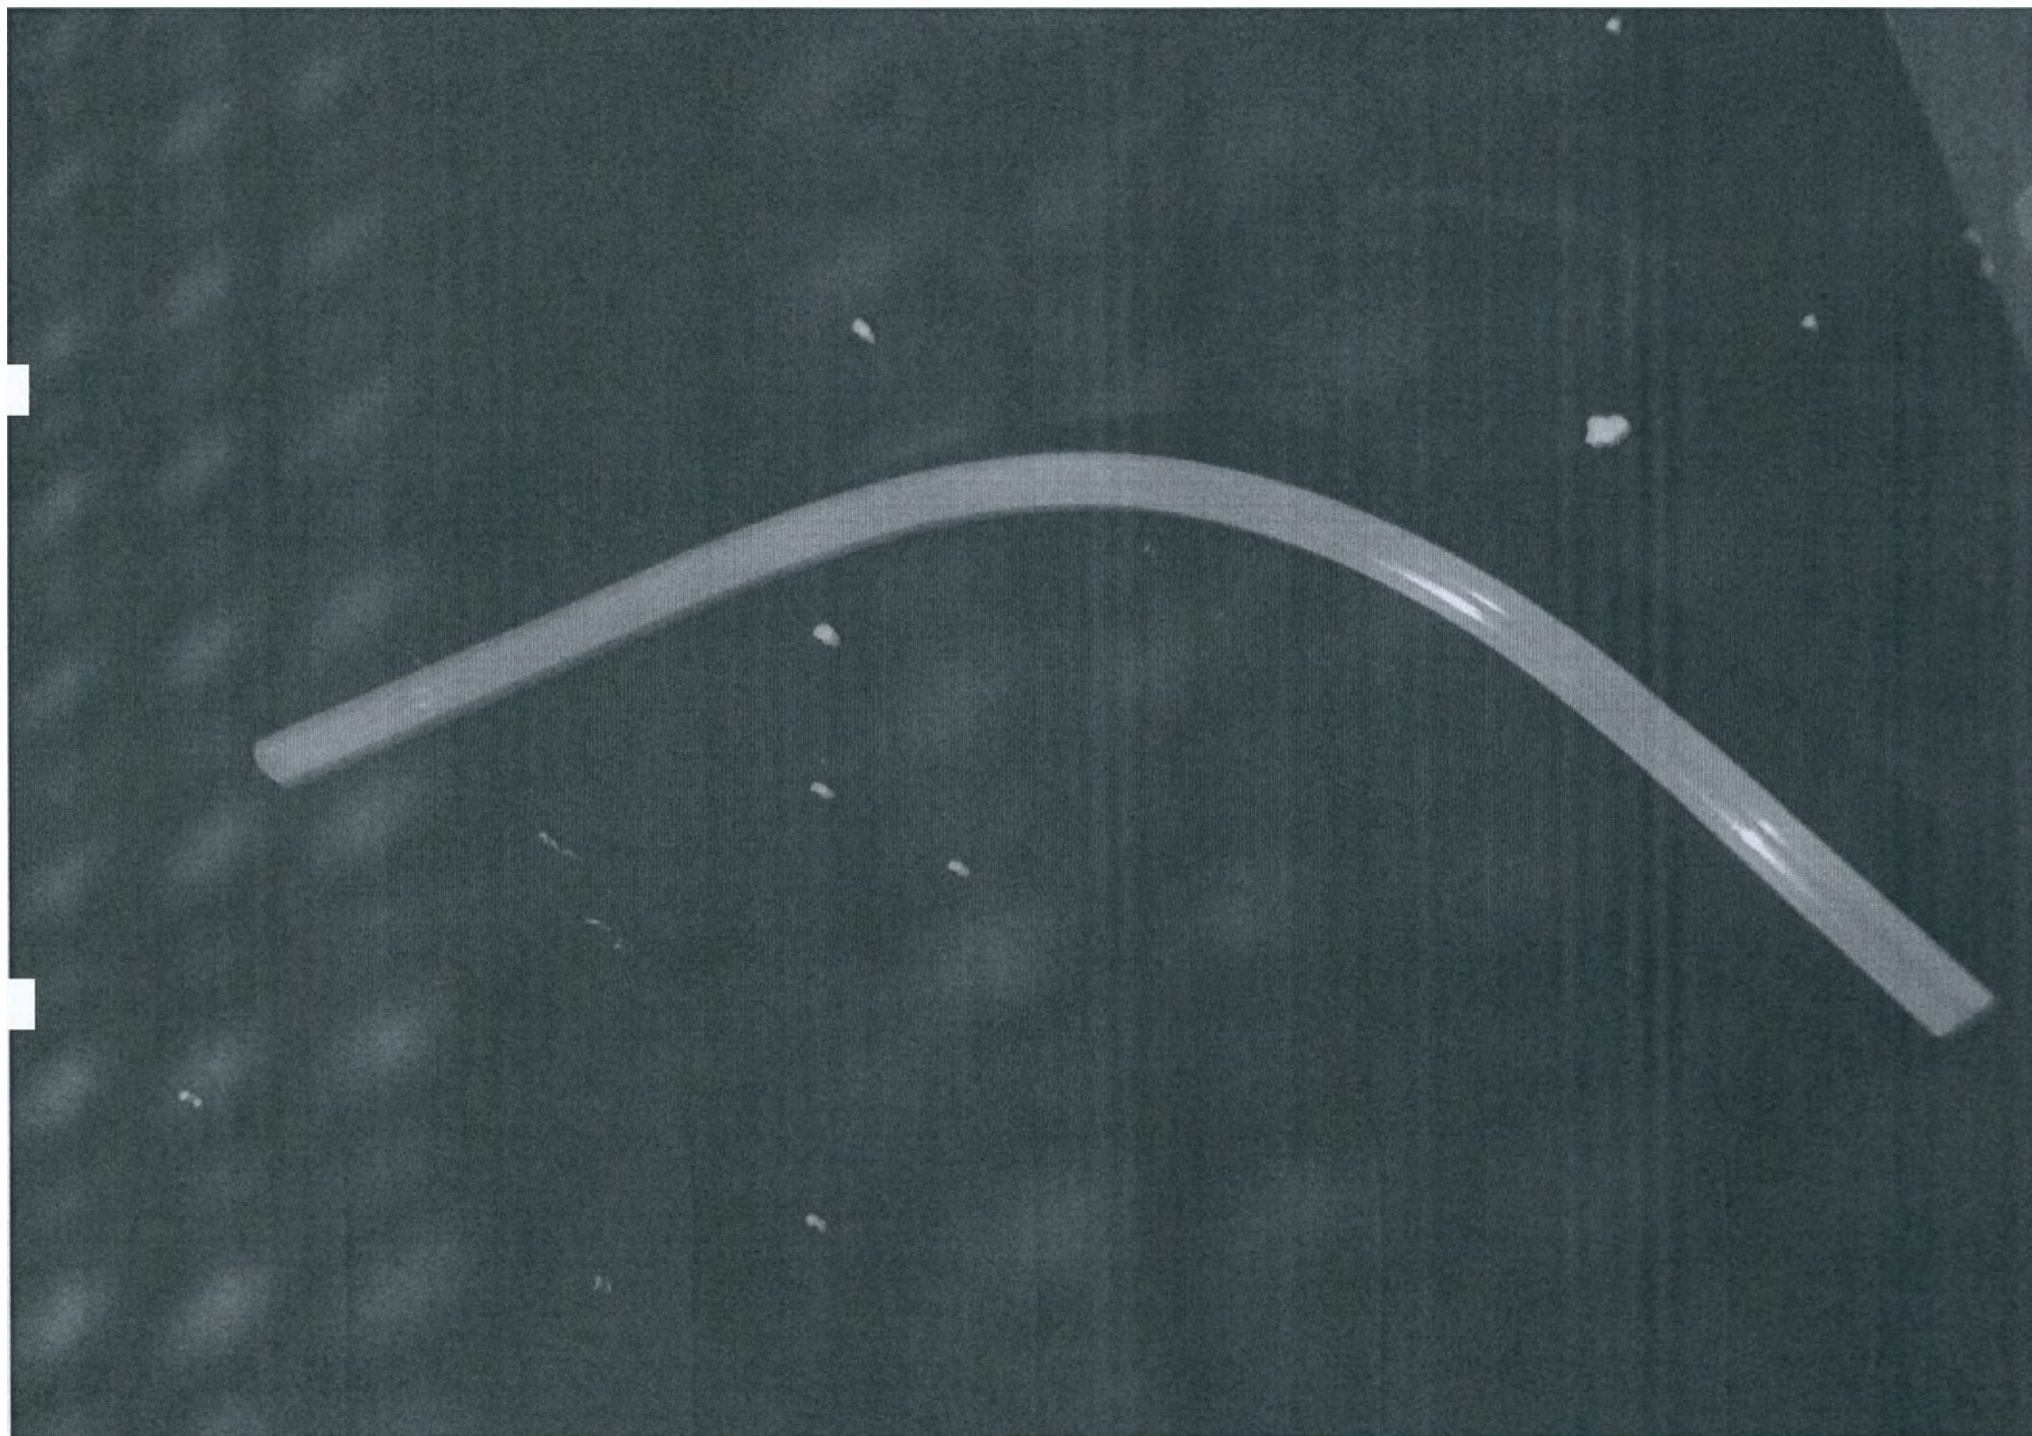


Рис. 62 – Шланг для увлажнителя

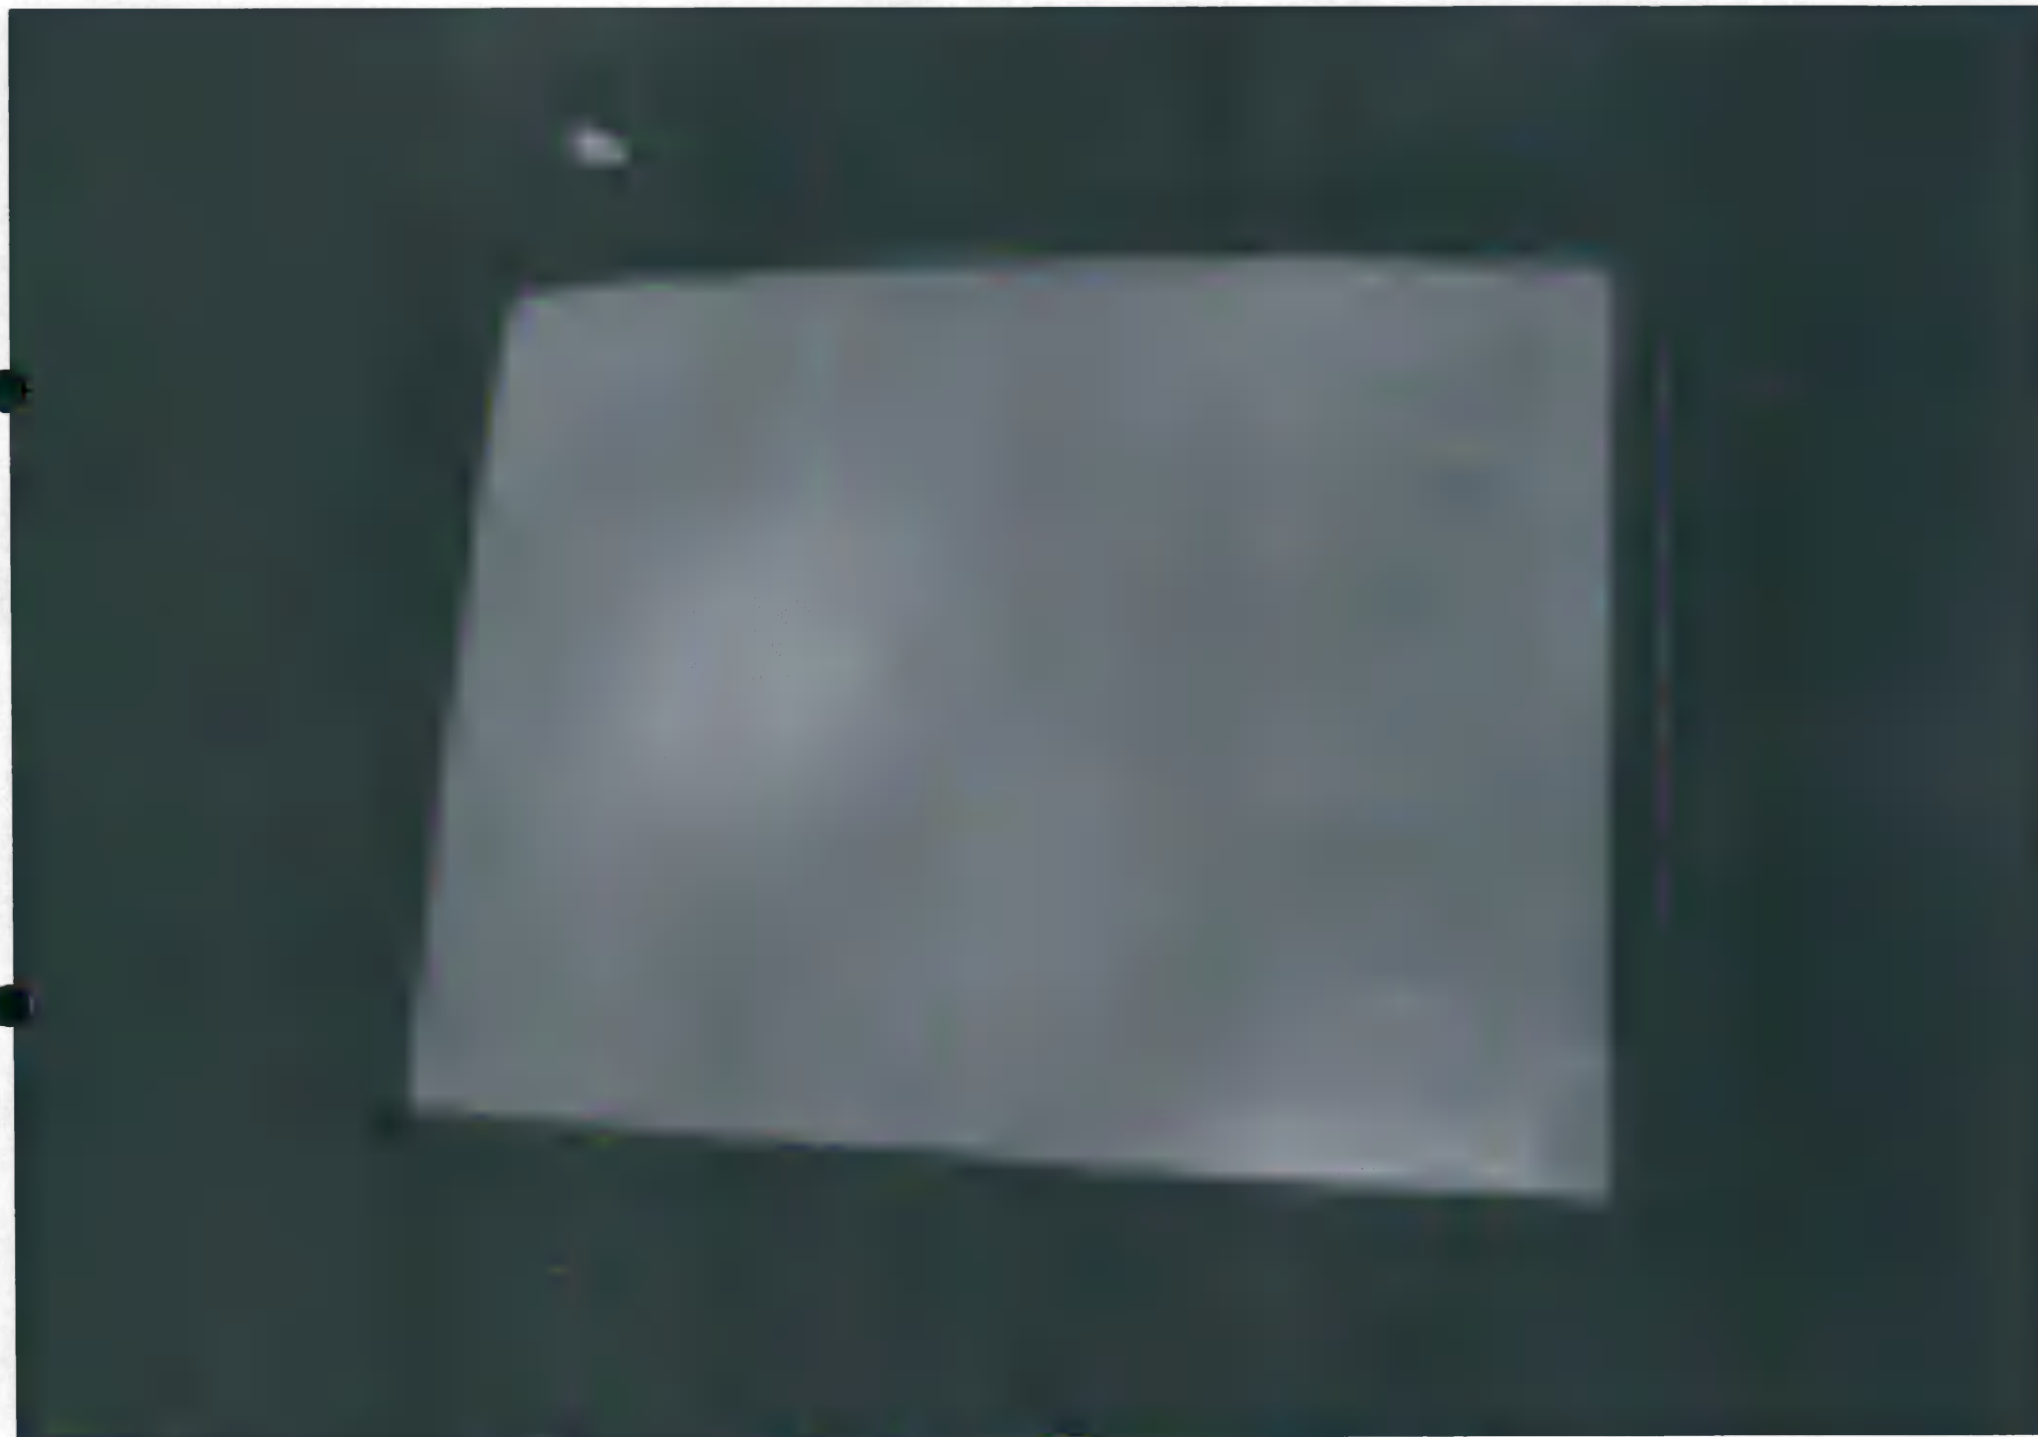


Рис. 63 – Фильтр тонкой очистки

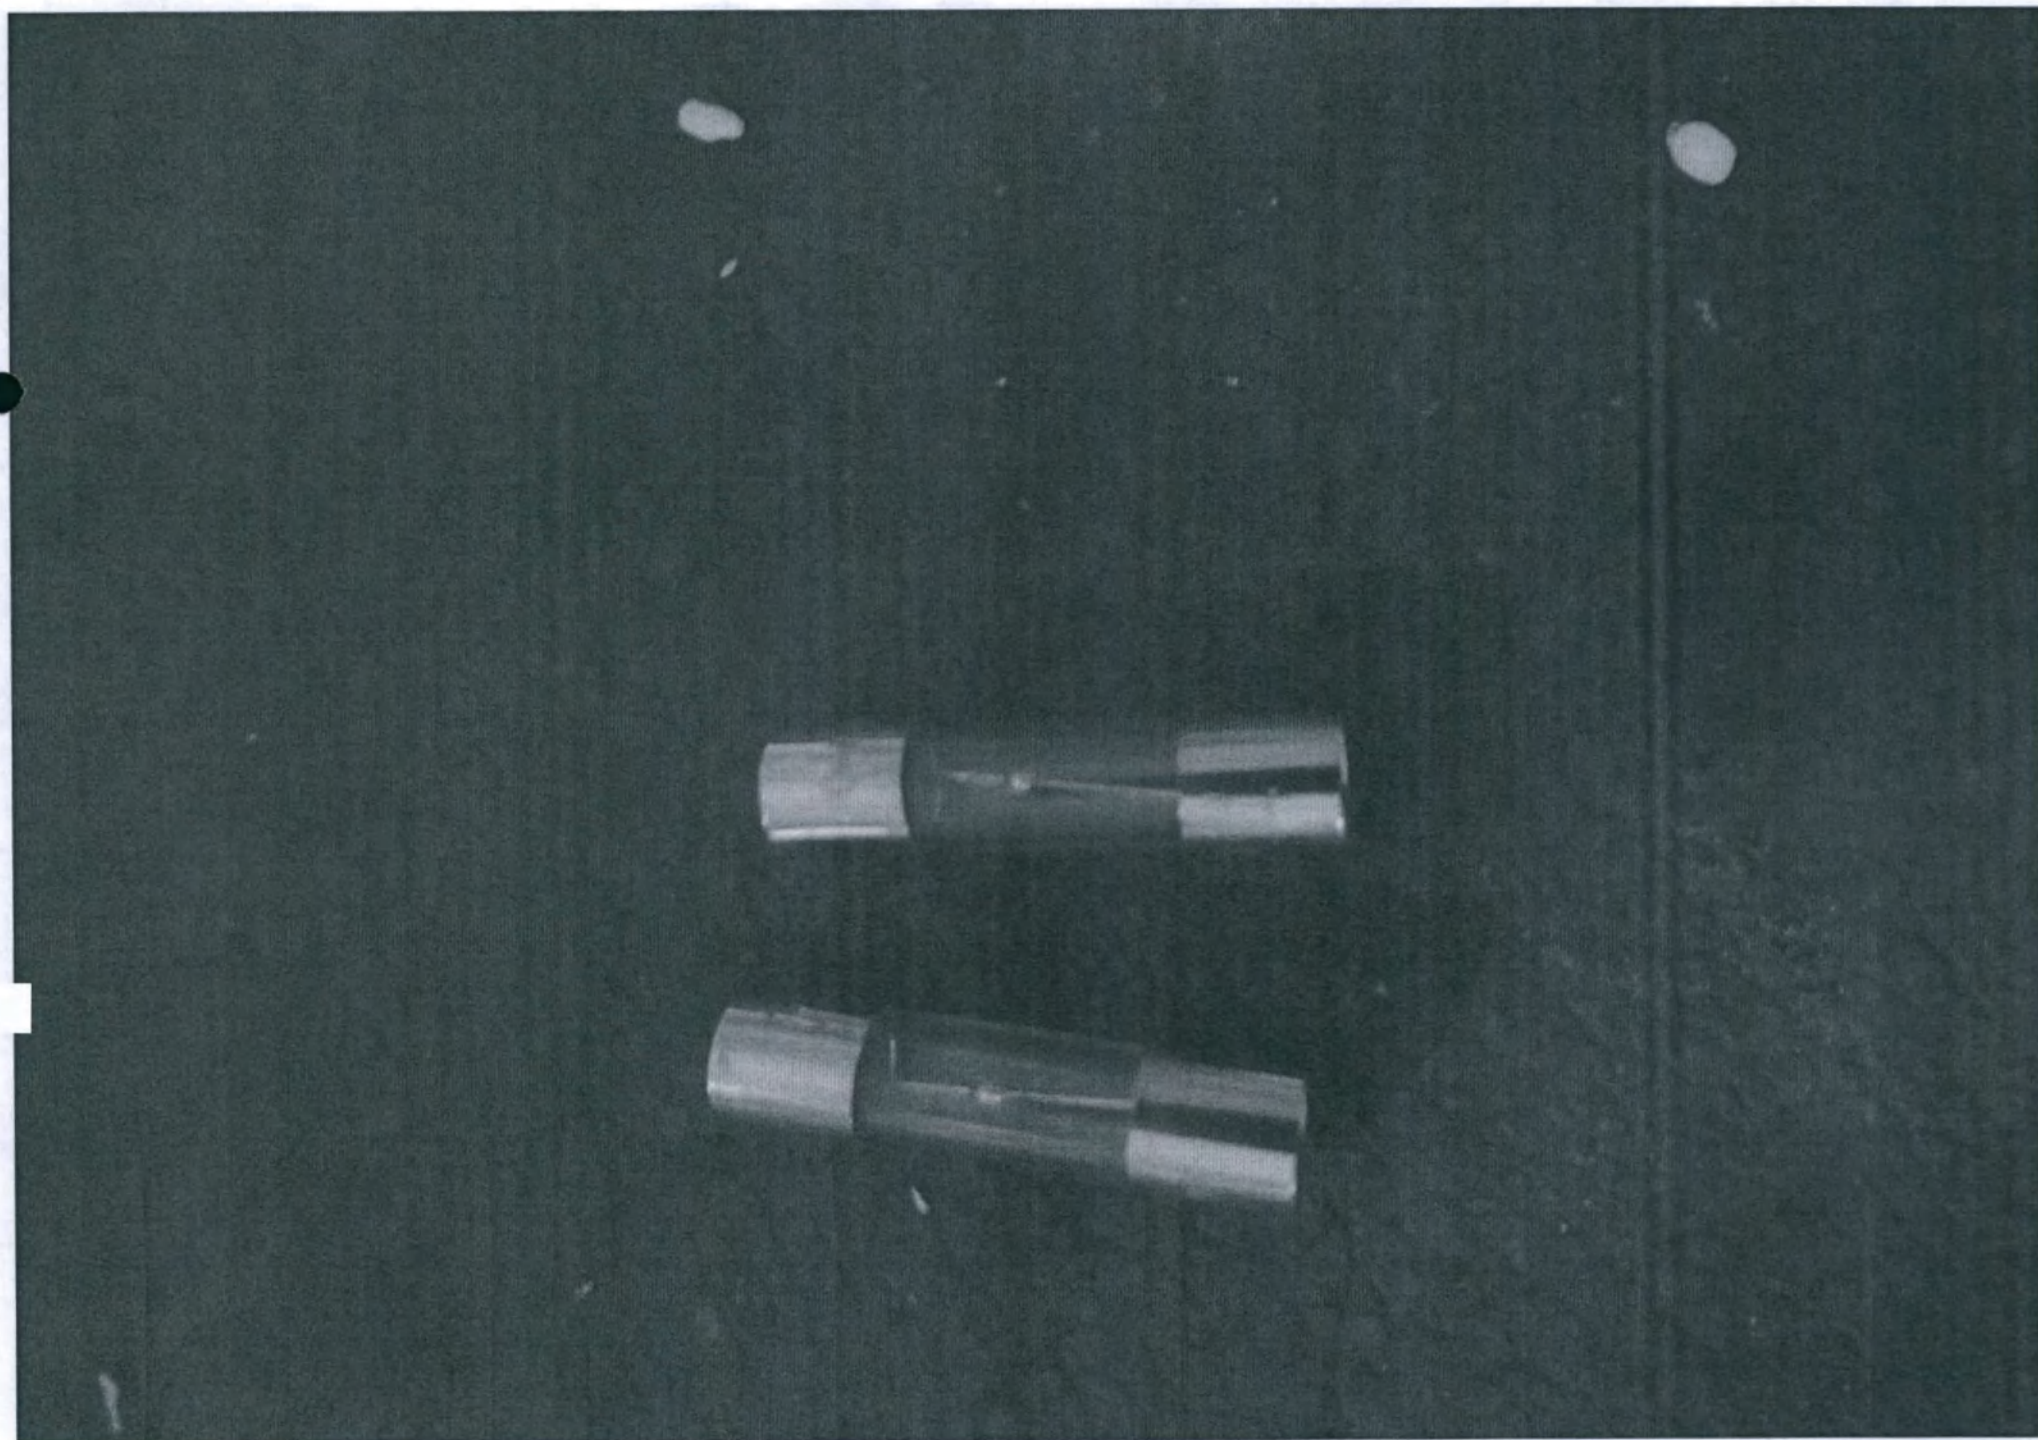


Рис. 64 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

Х. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-3W (5L), в составе:

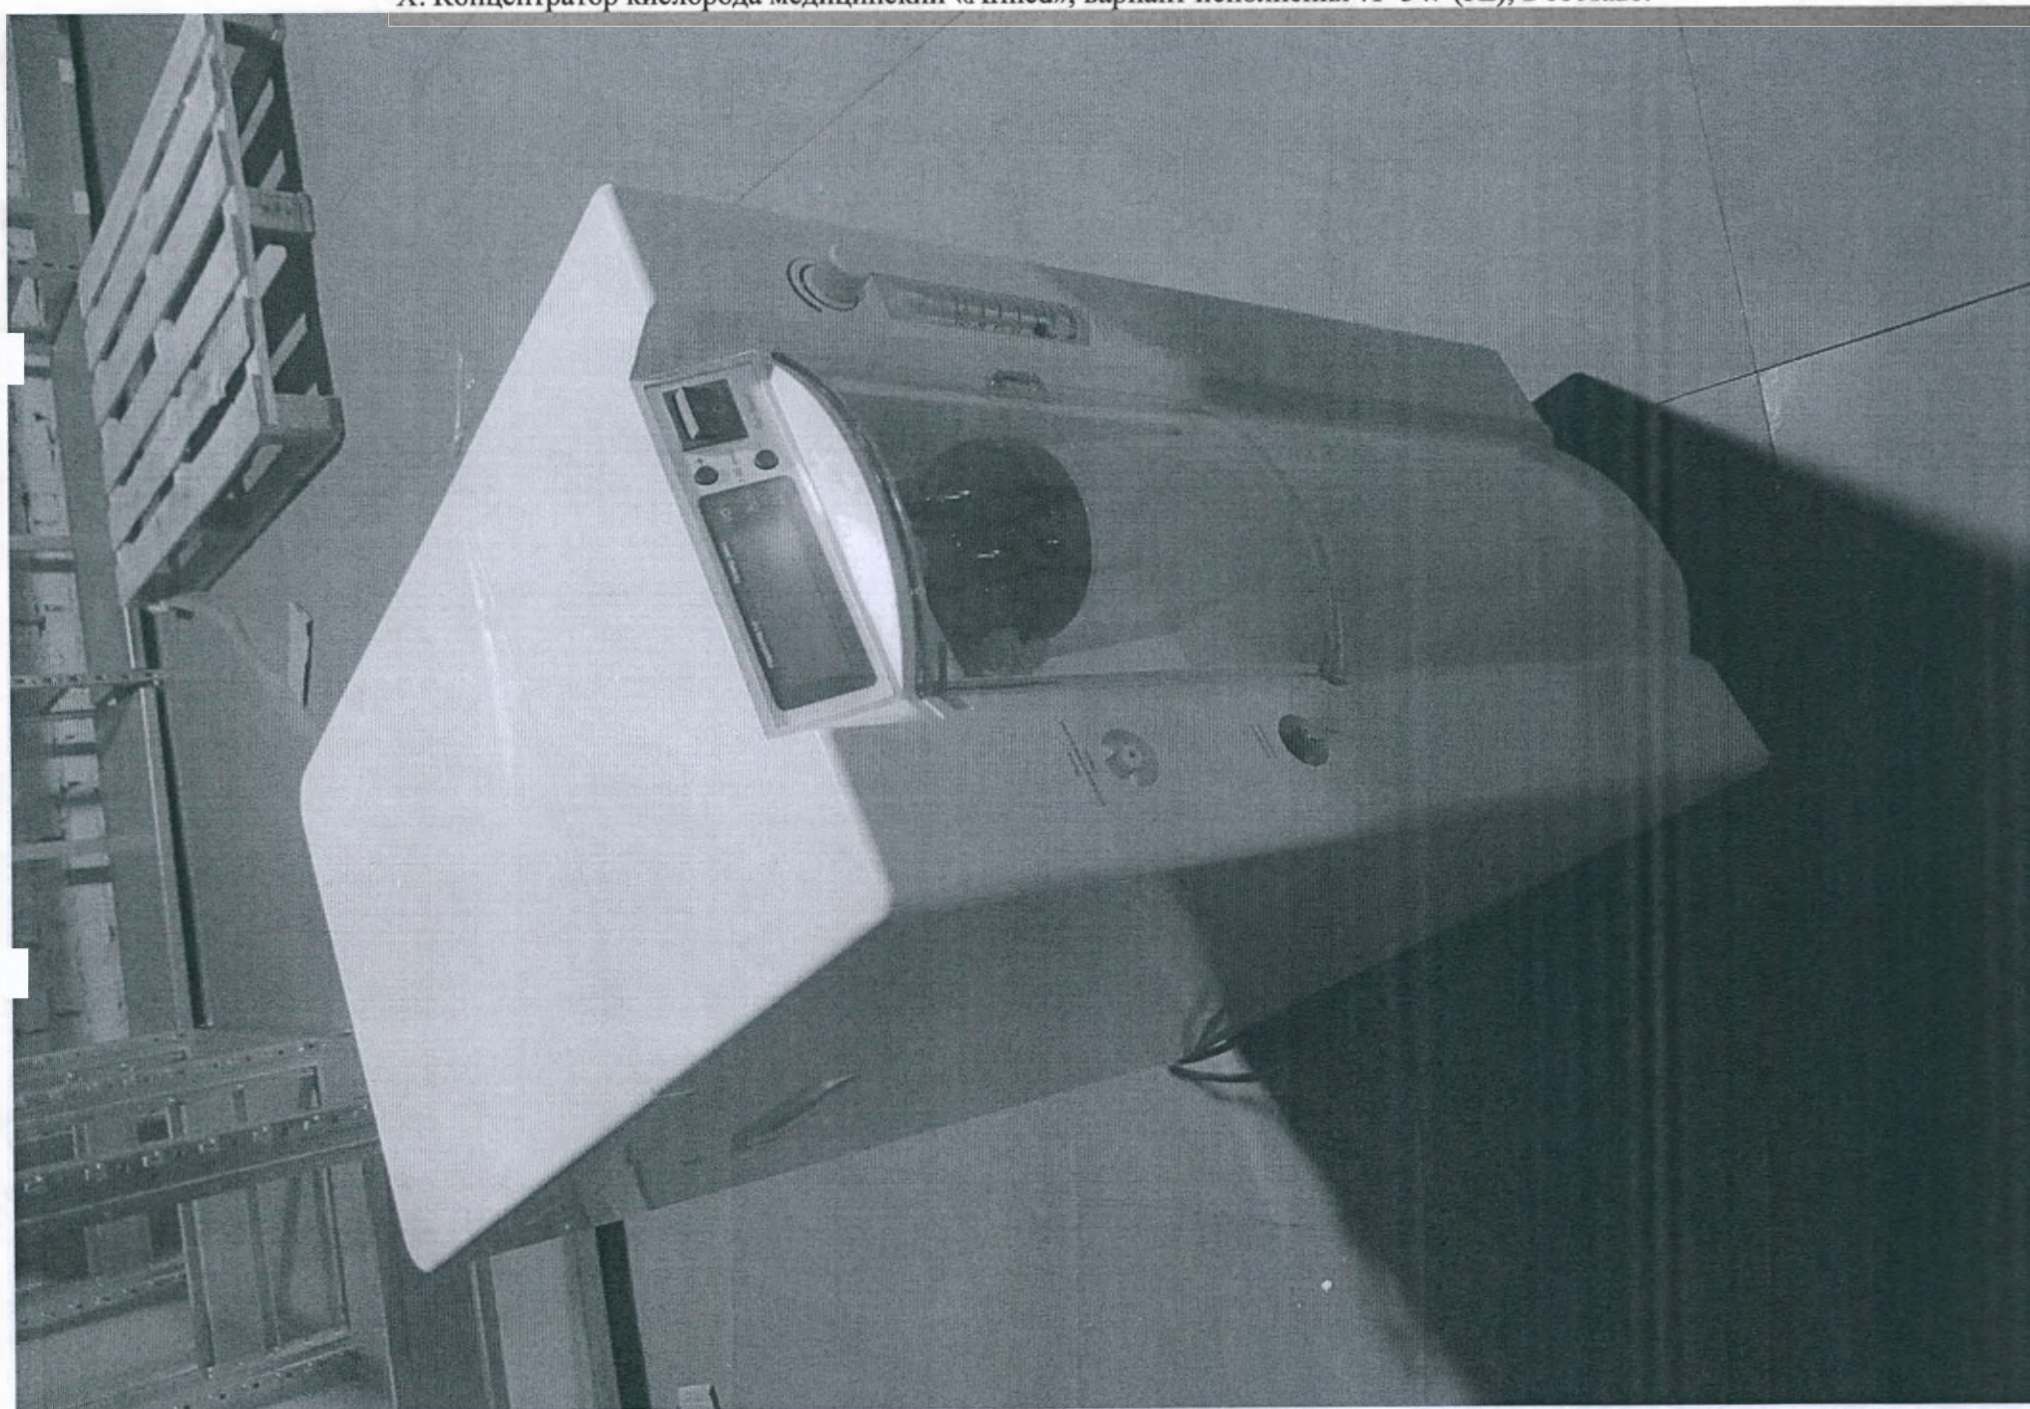


Рис. 65 – Концентратор кислорода

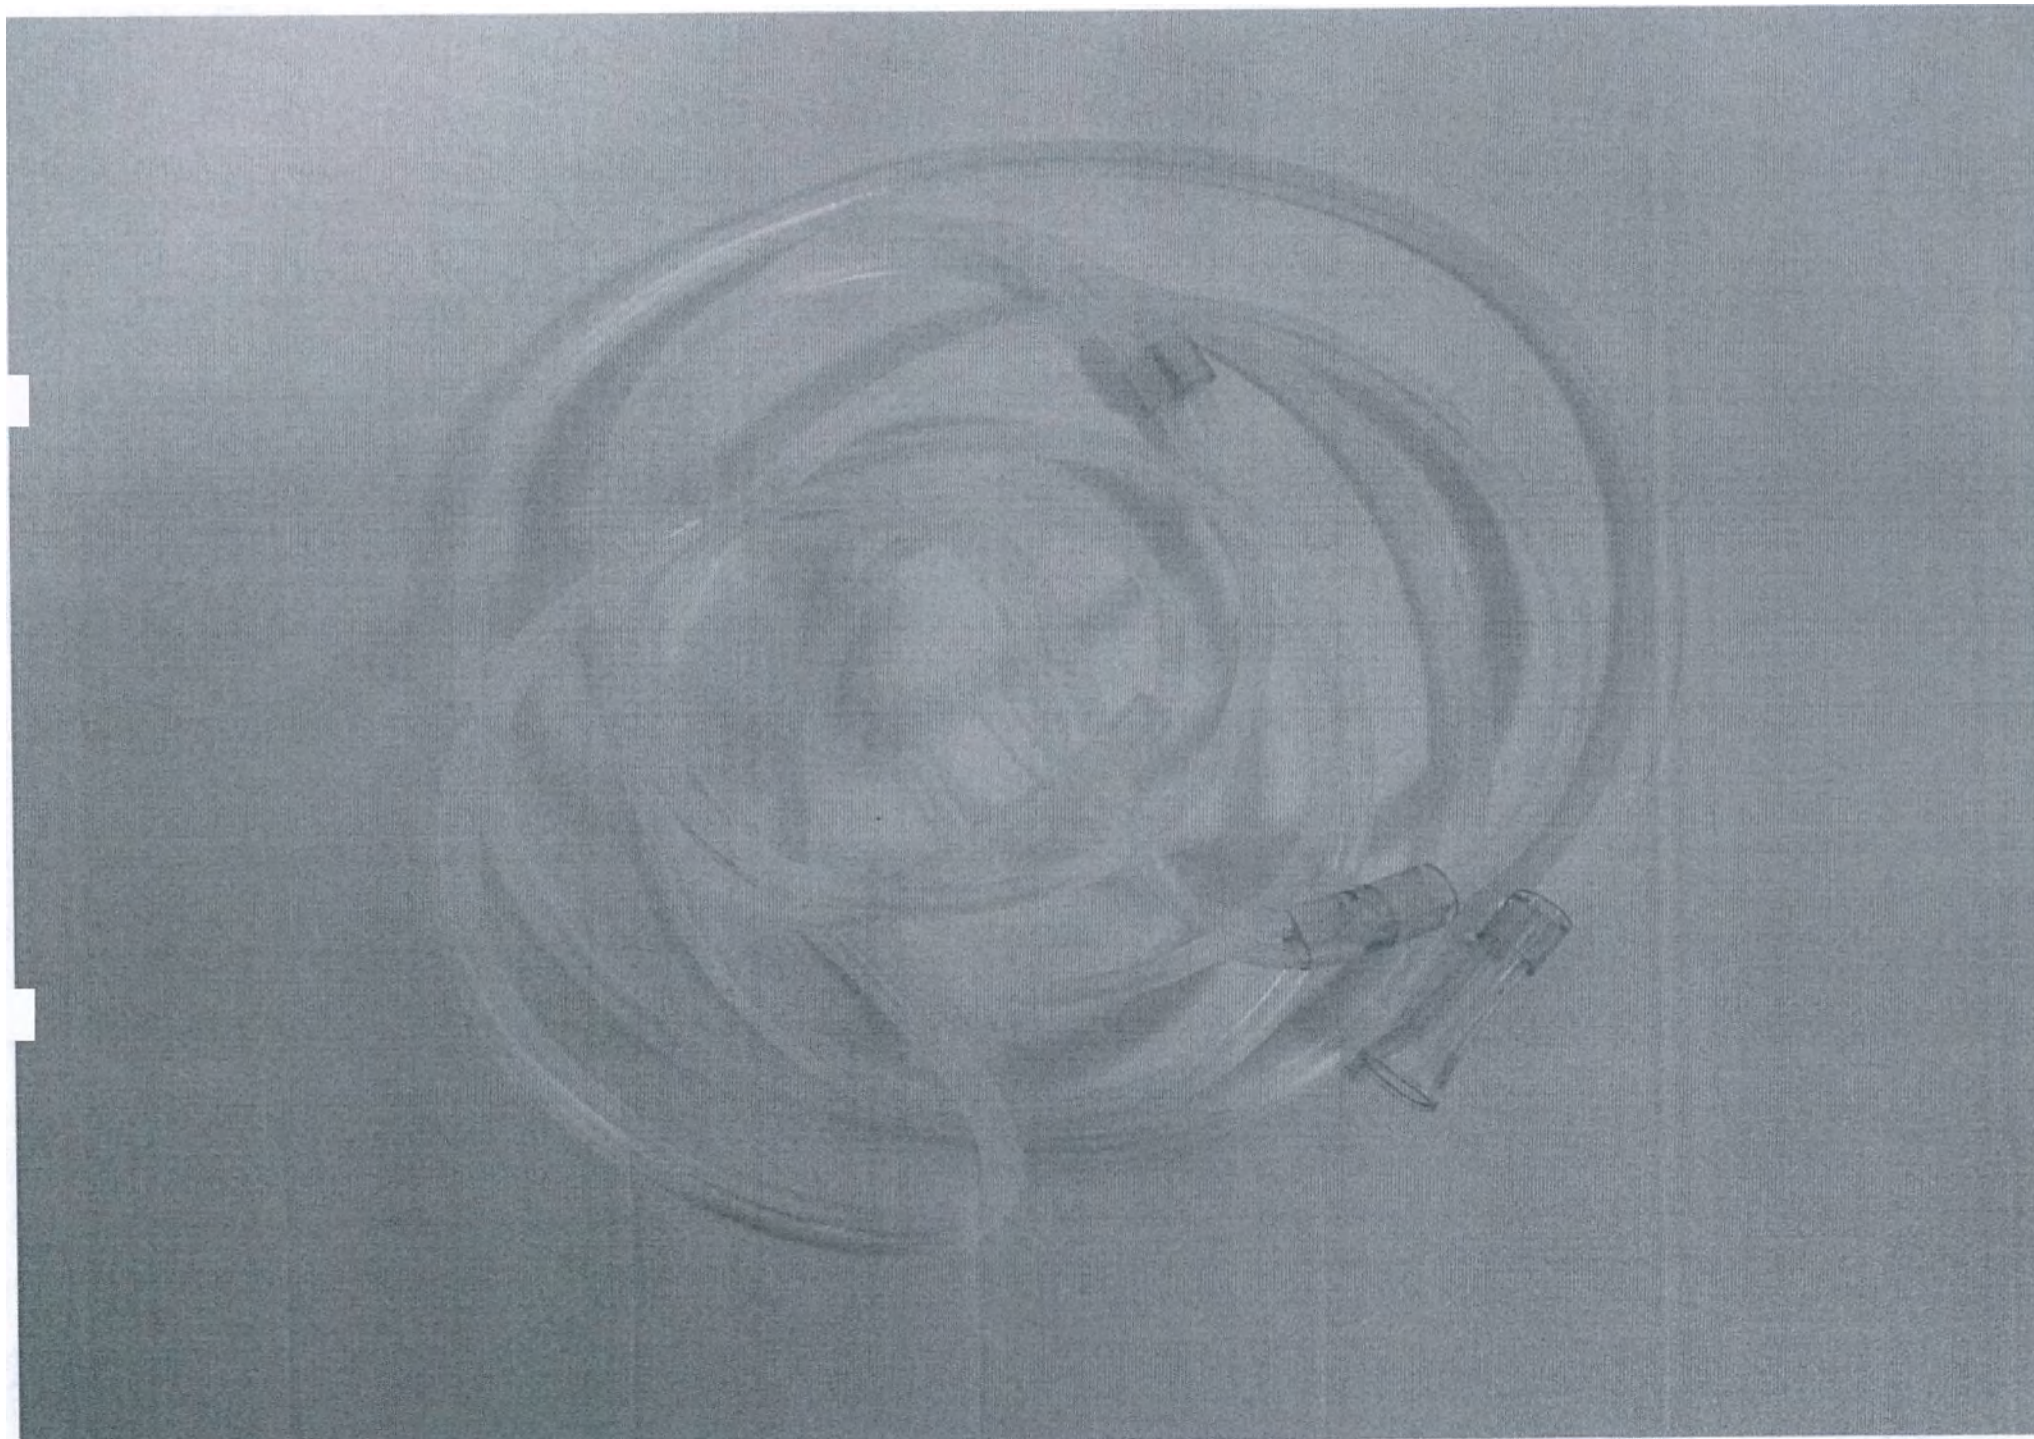


Рис. 66 -- Канюля назальная малая



Рис. 67 – Комплект для ингаляции (тип II)

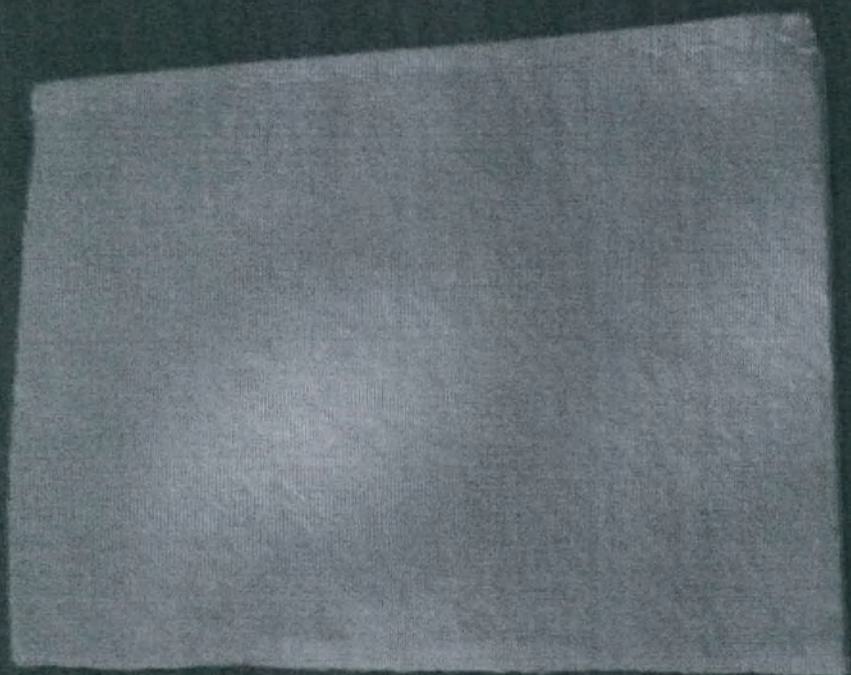


Рис. 68 – Фильтр тонкой очистки

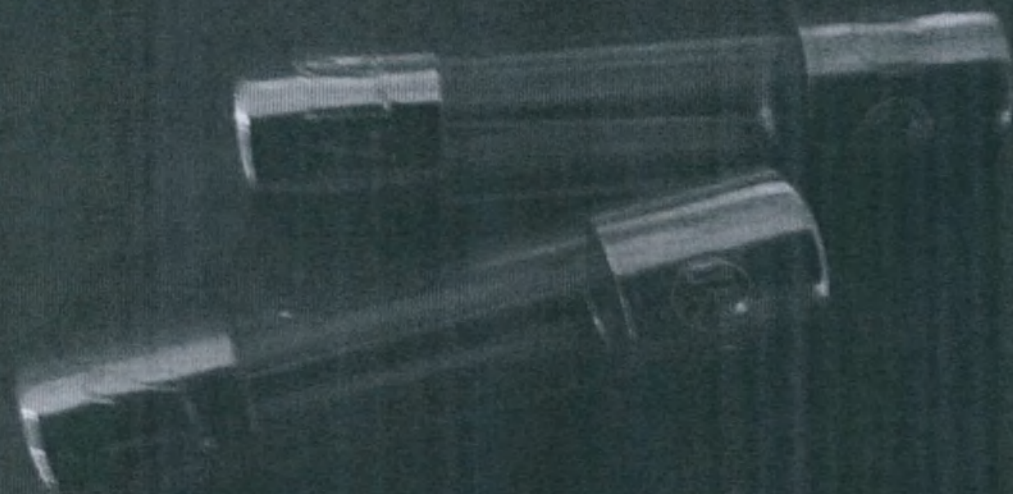


Рис. 69 – Предохранитель плавкий RF1A (2 шт.)



Рис. 70 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

XI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5B, в составе:



Рис. 71 – Концентратор кислорода

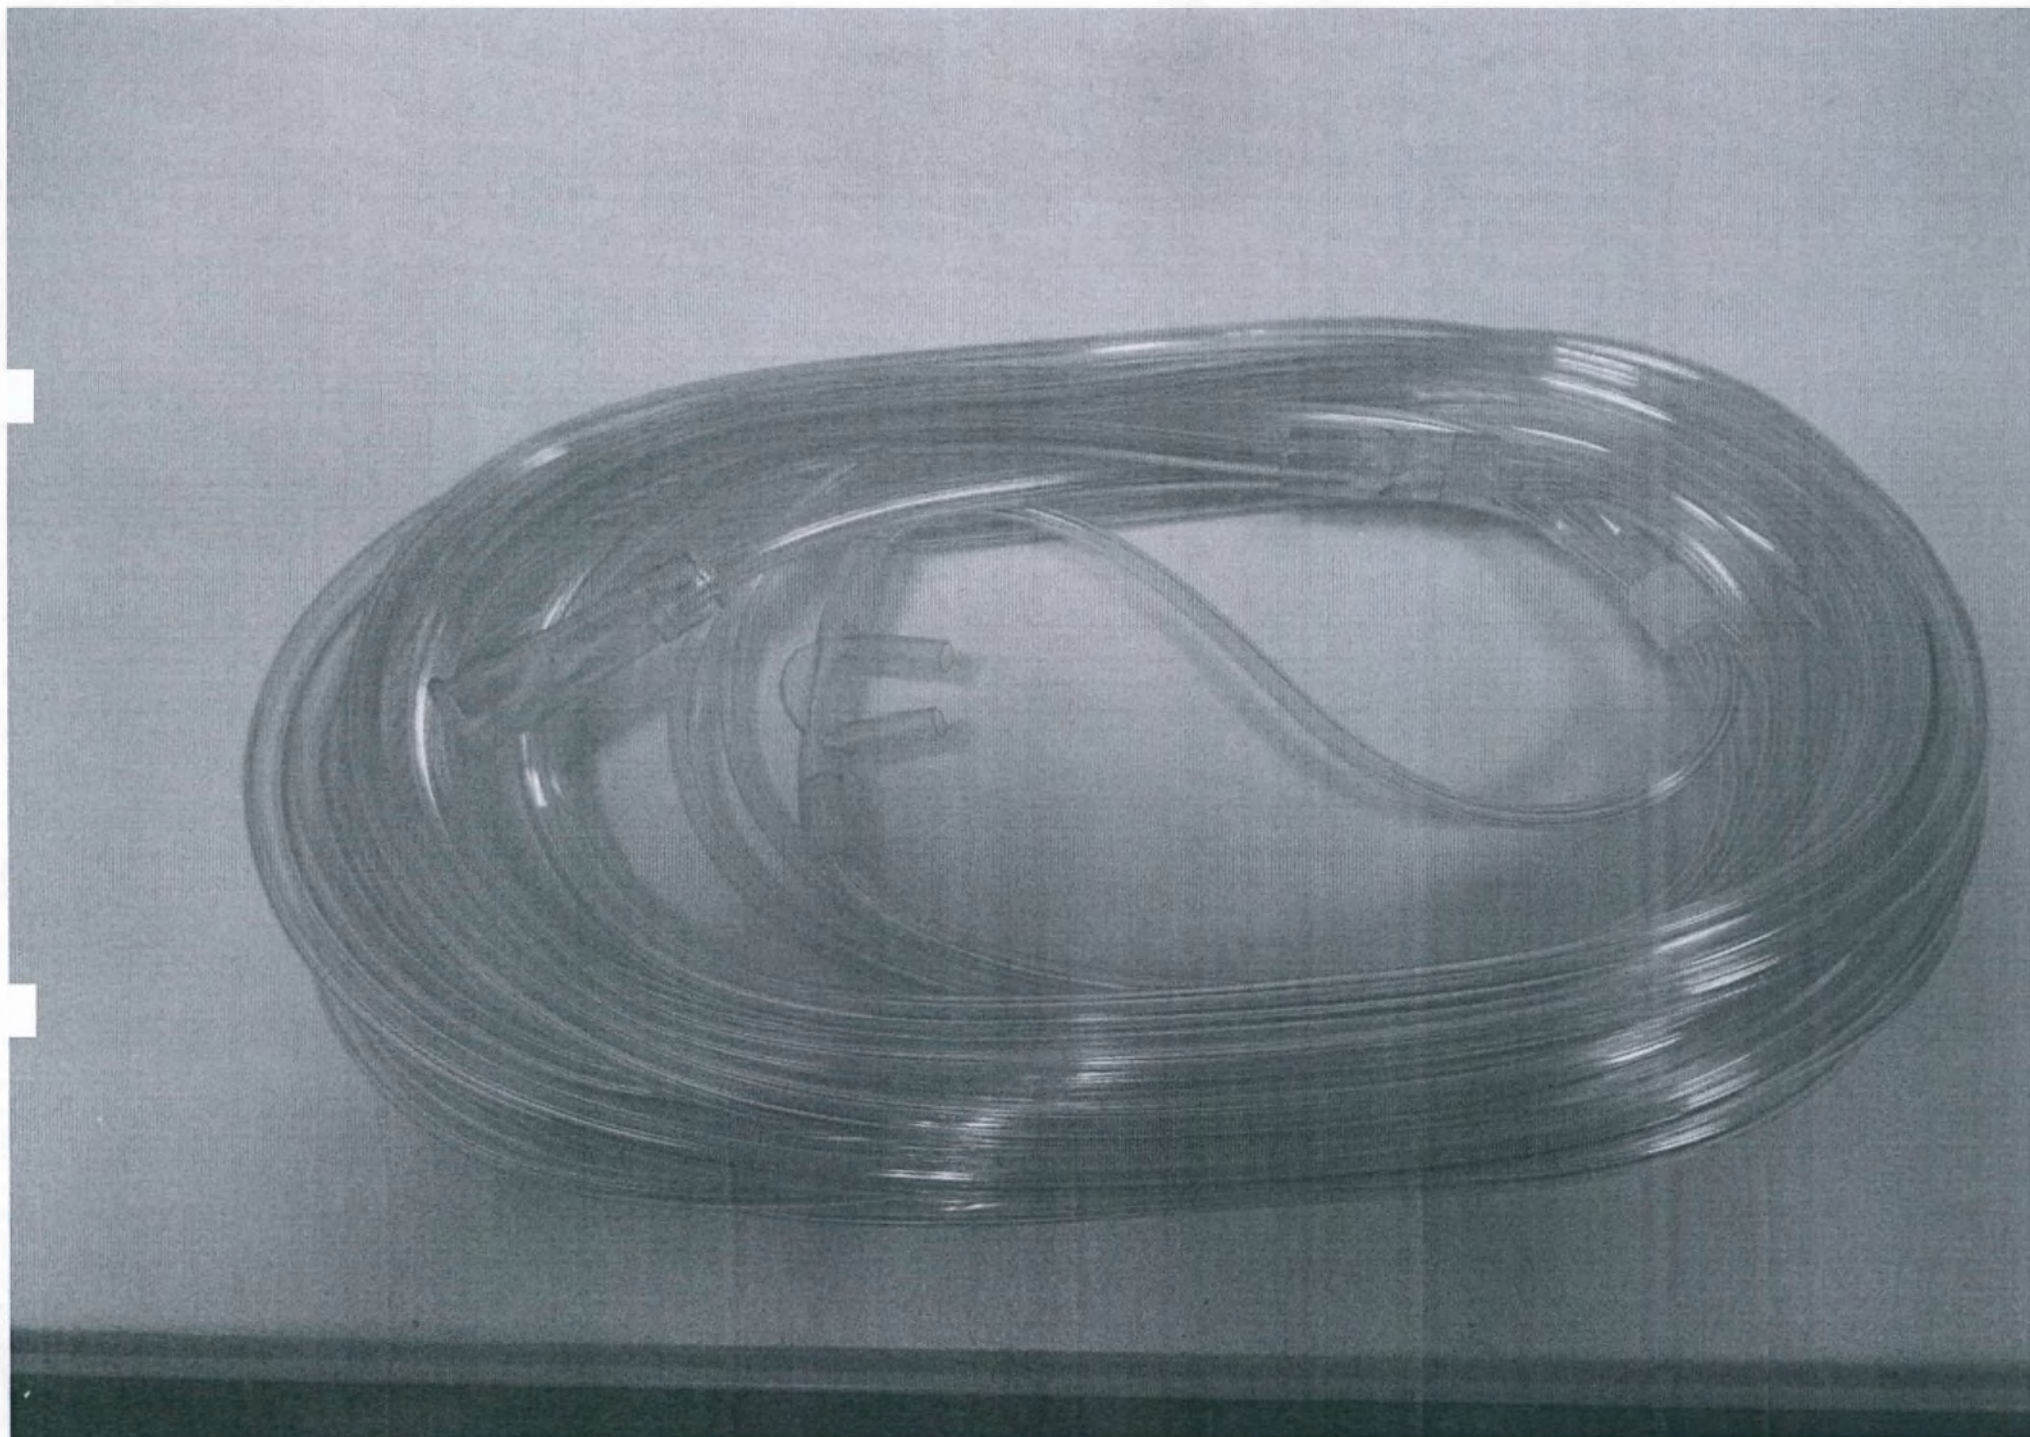


Рис. 72 – Канюля назальная большая

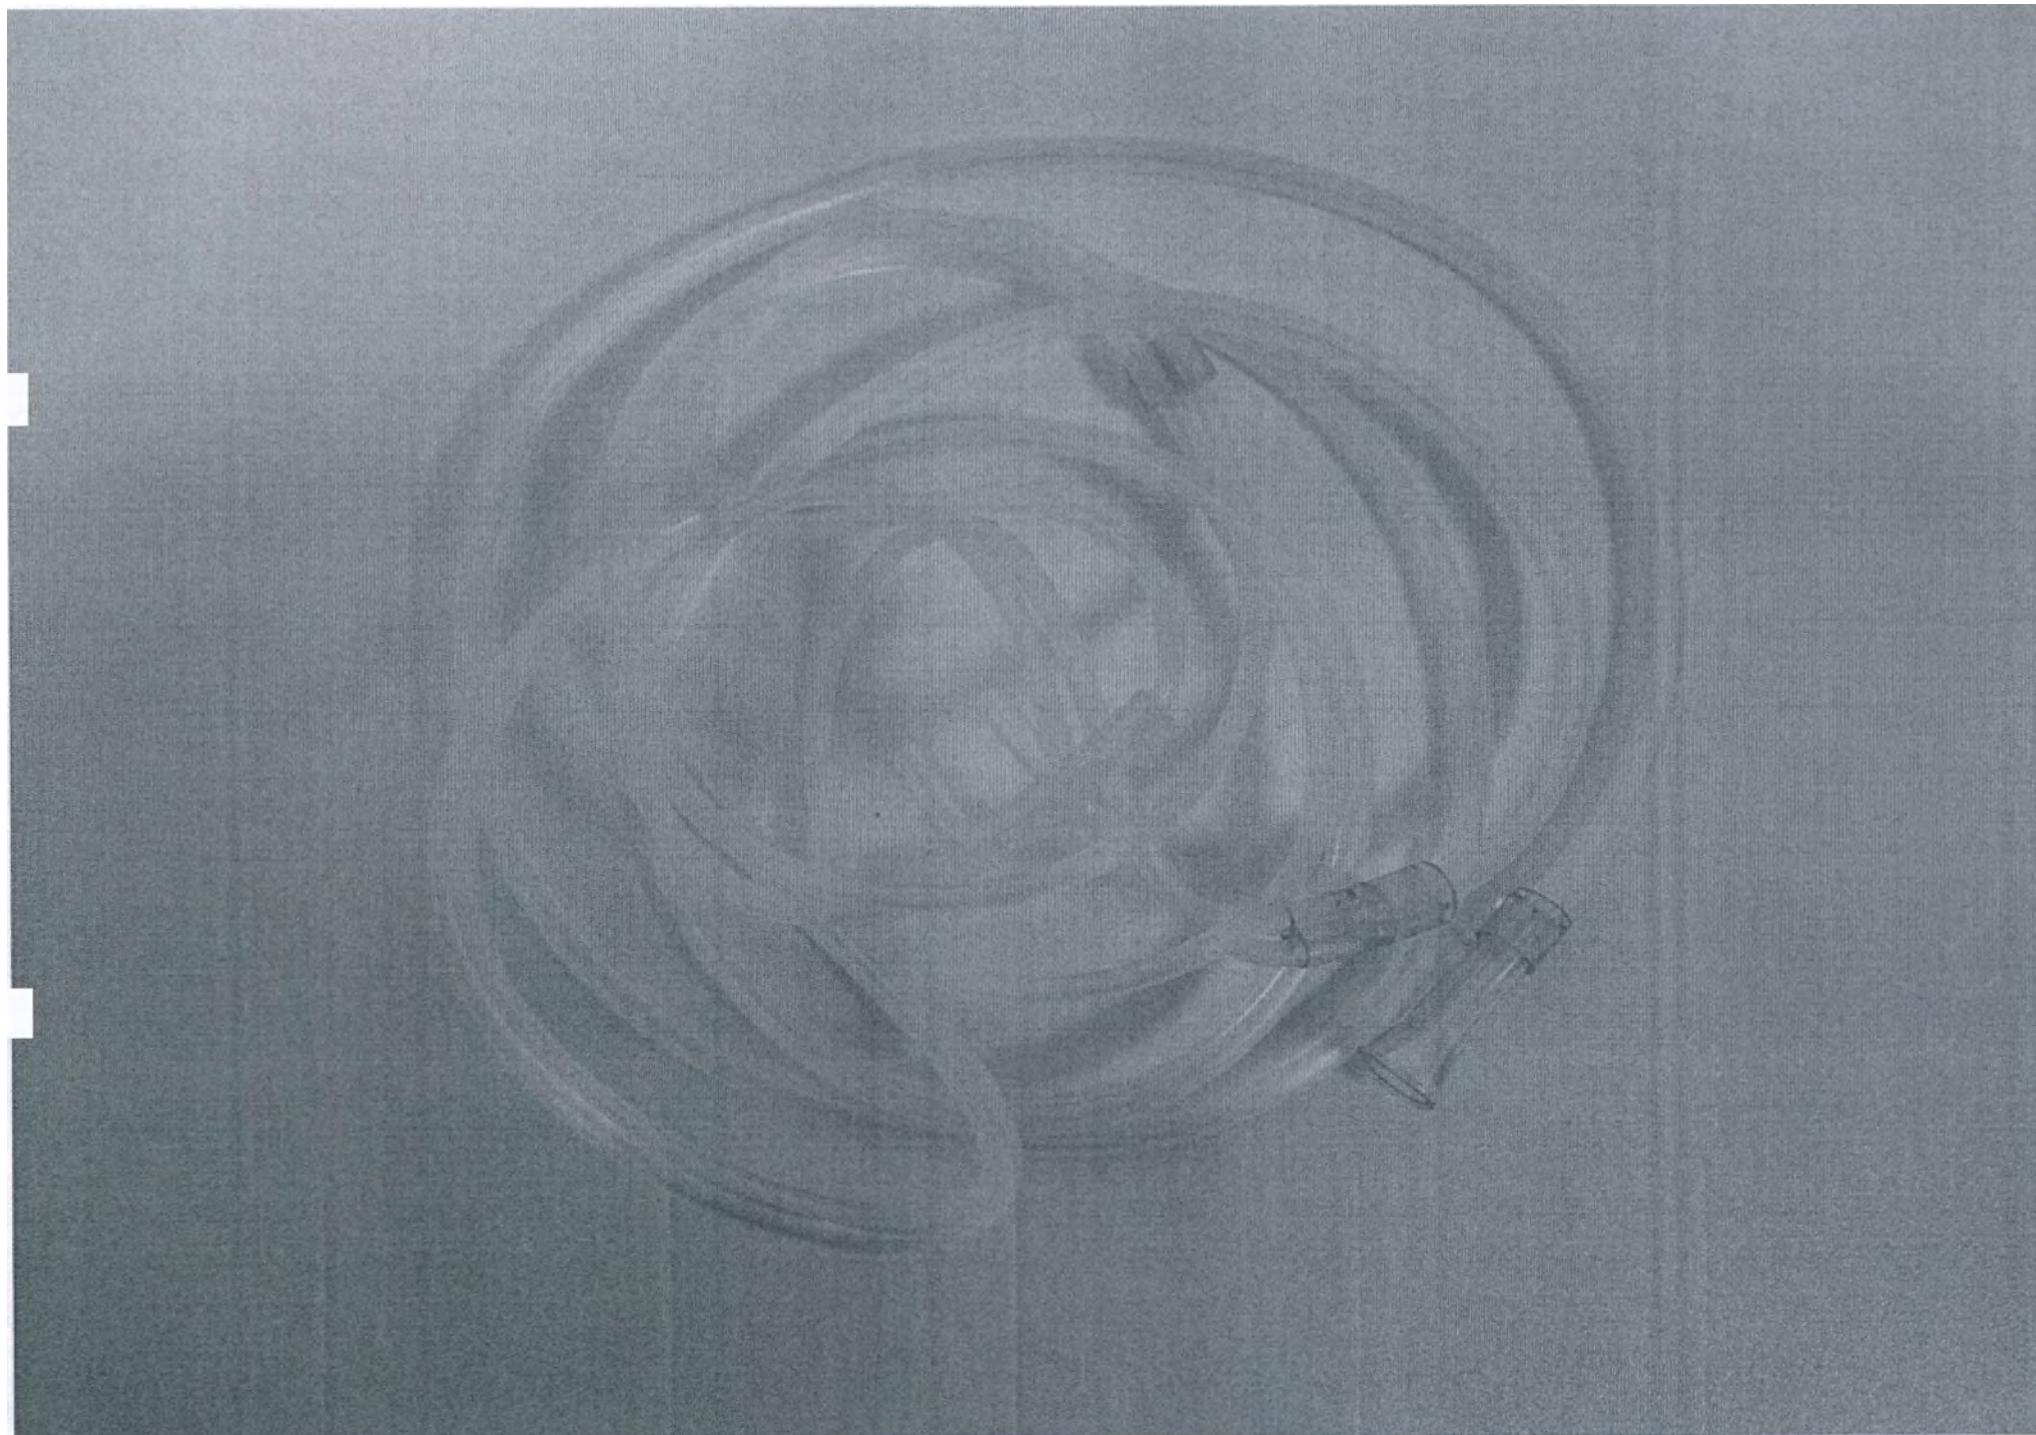


Рис. 73 – Канюля назальная малая

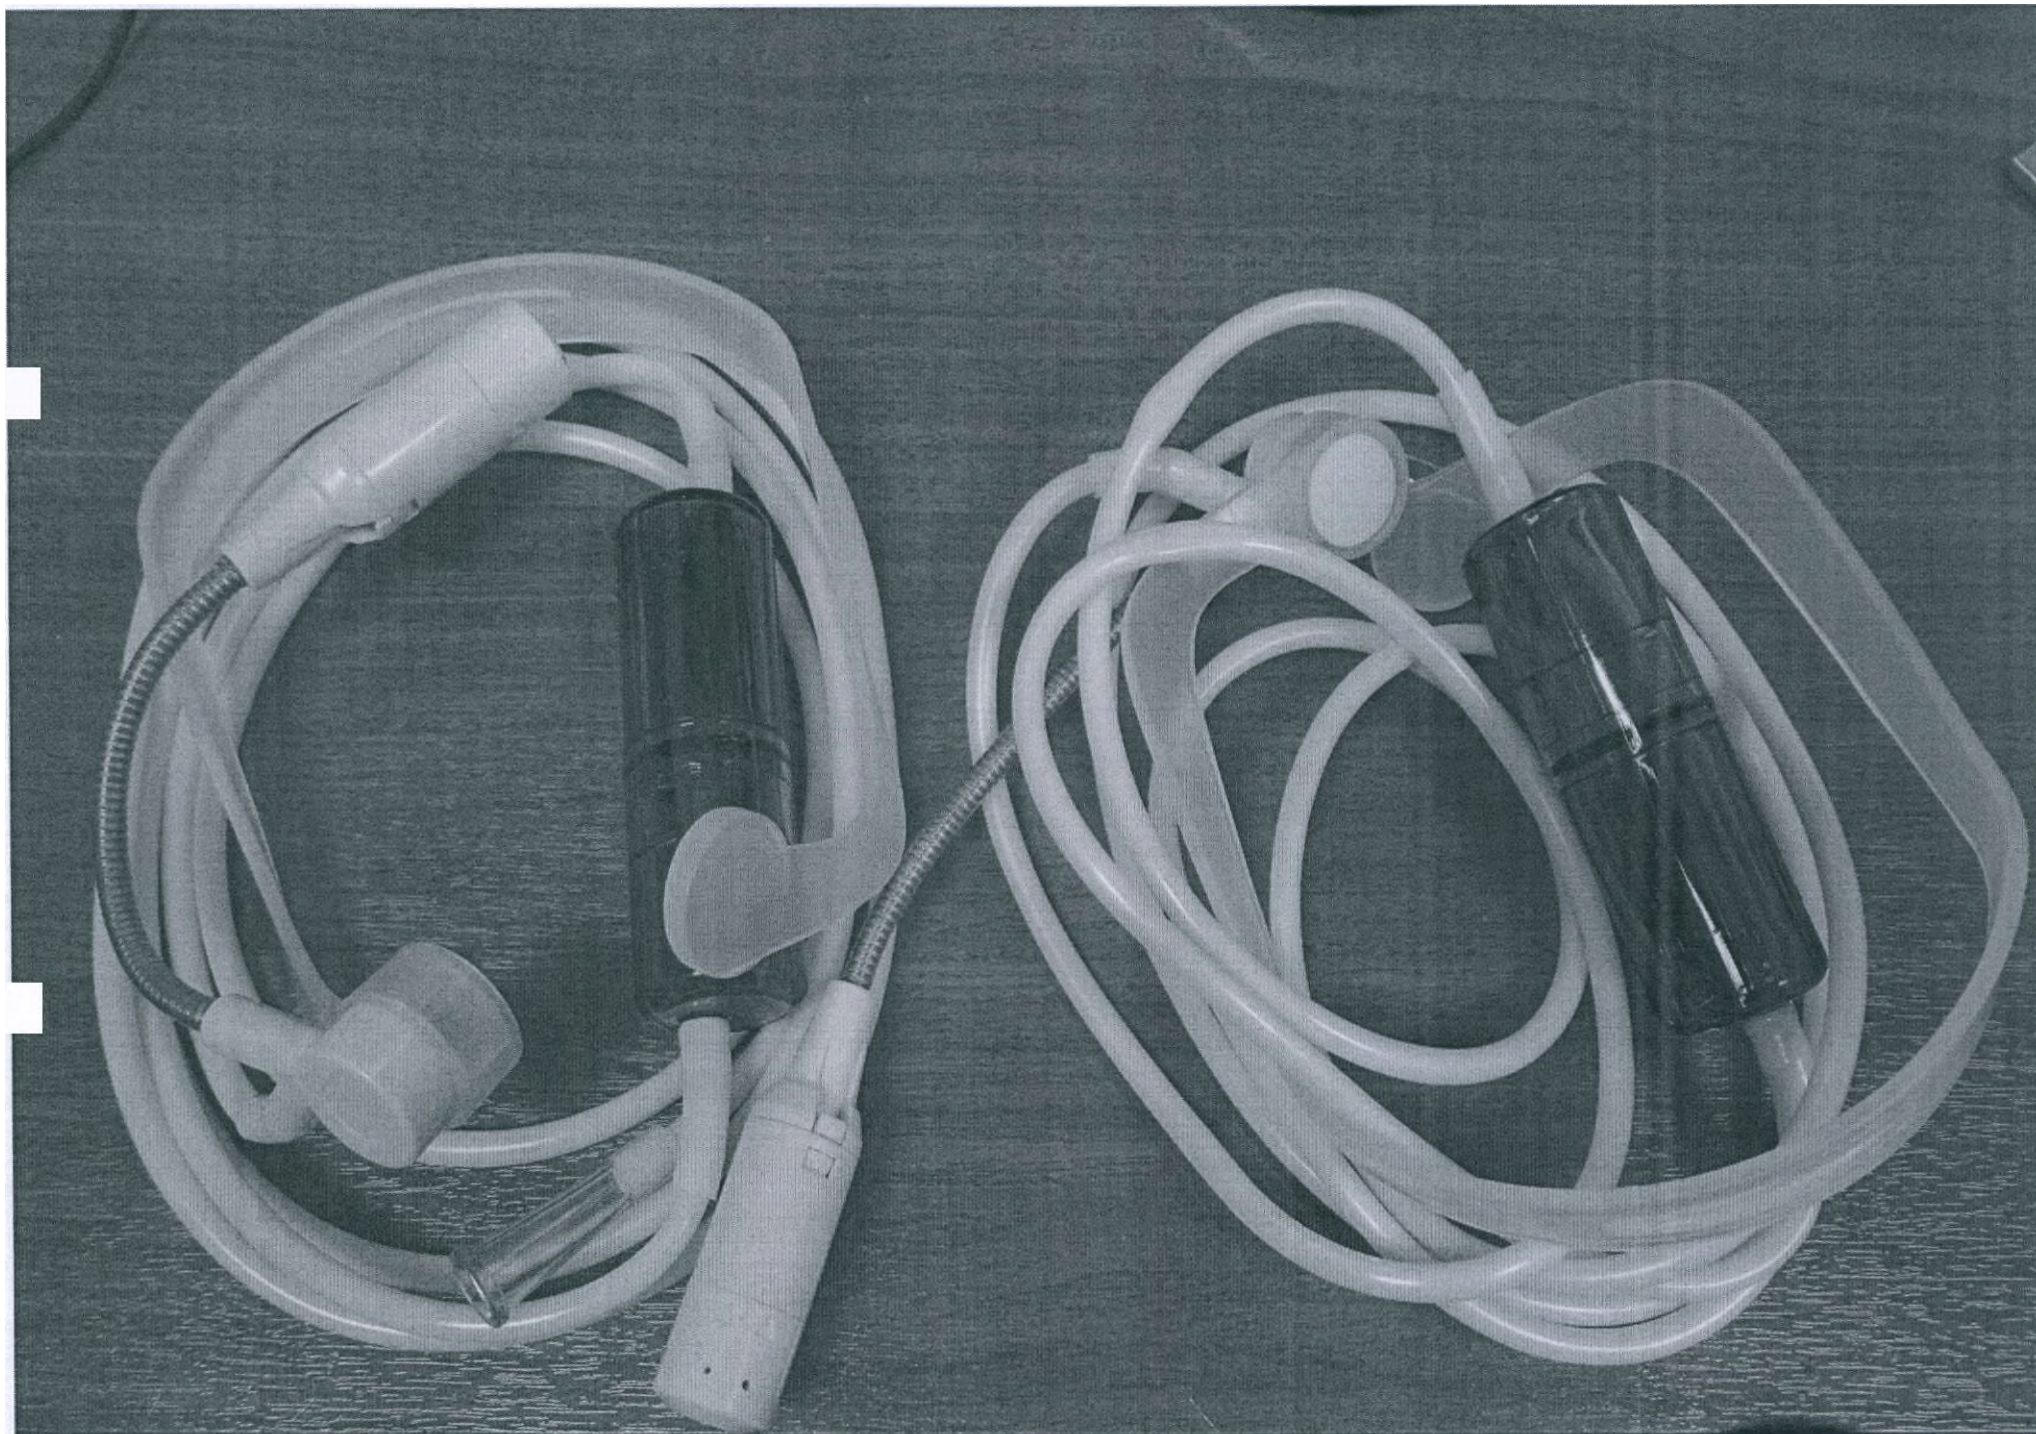


Рис. 74 – Диффузор (2 шт.)

ХII. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5BW, в составе:

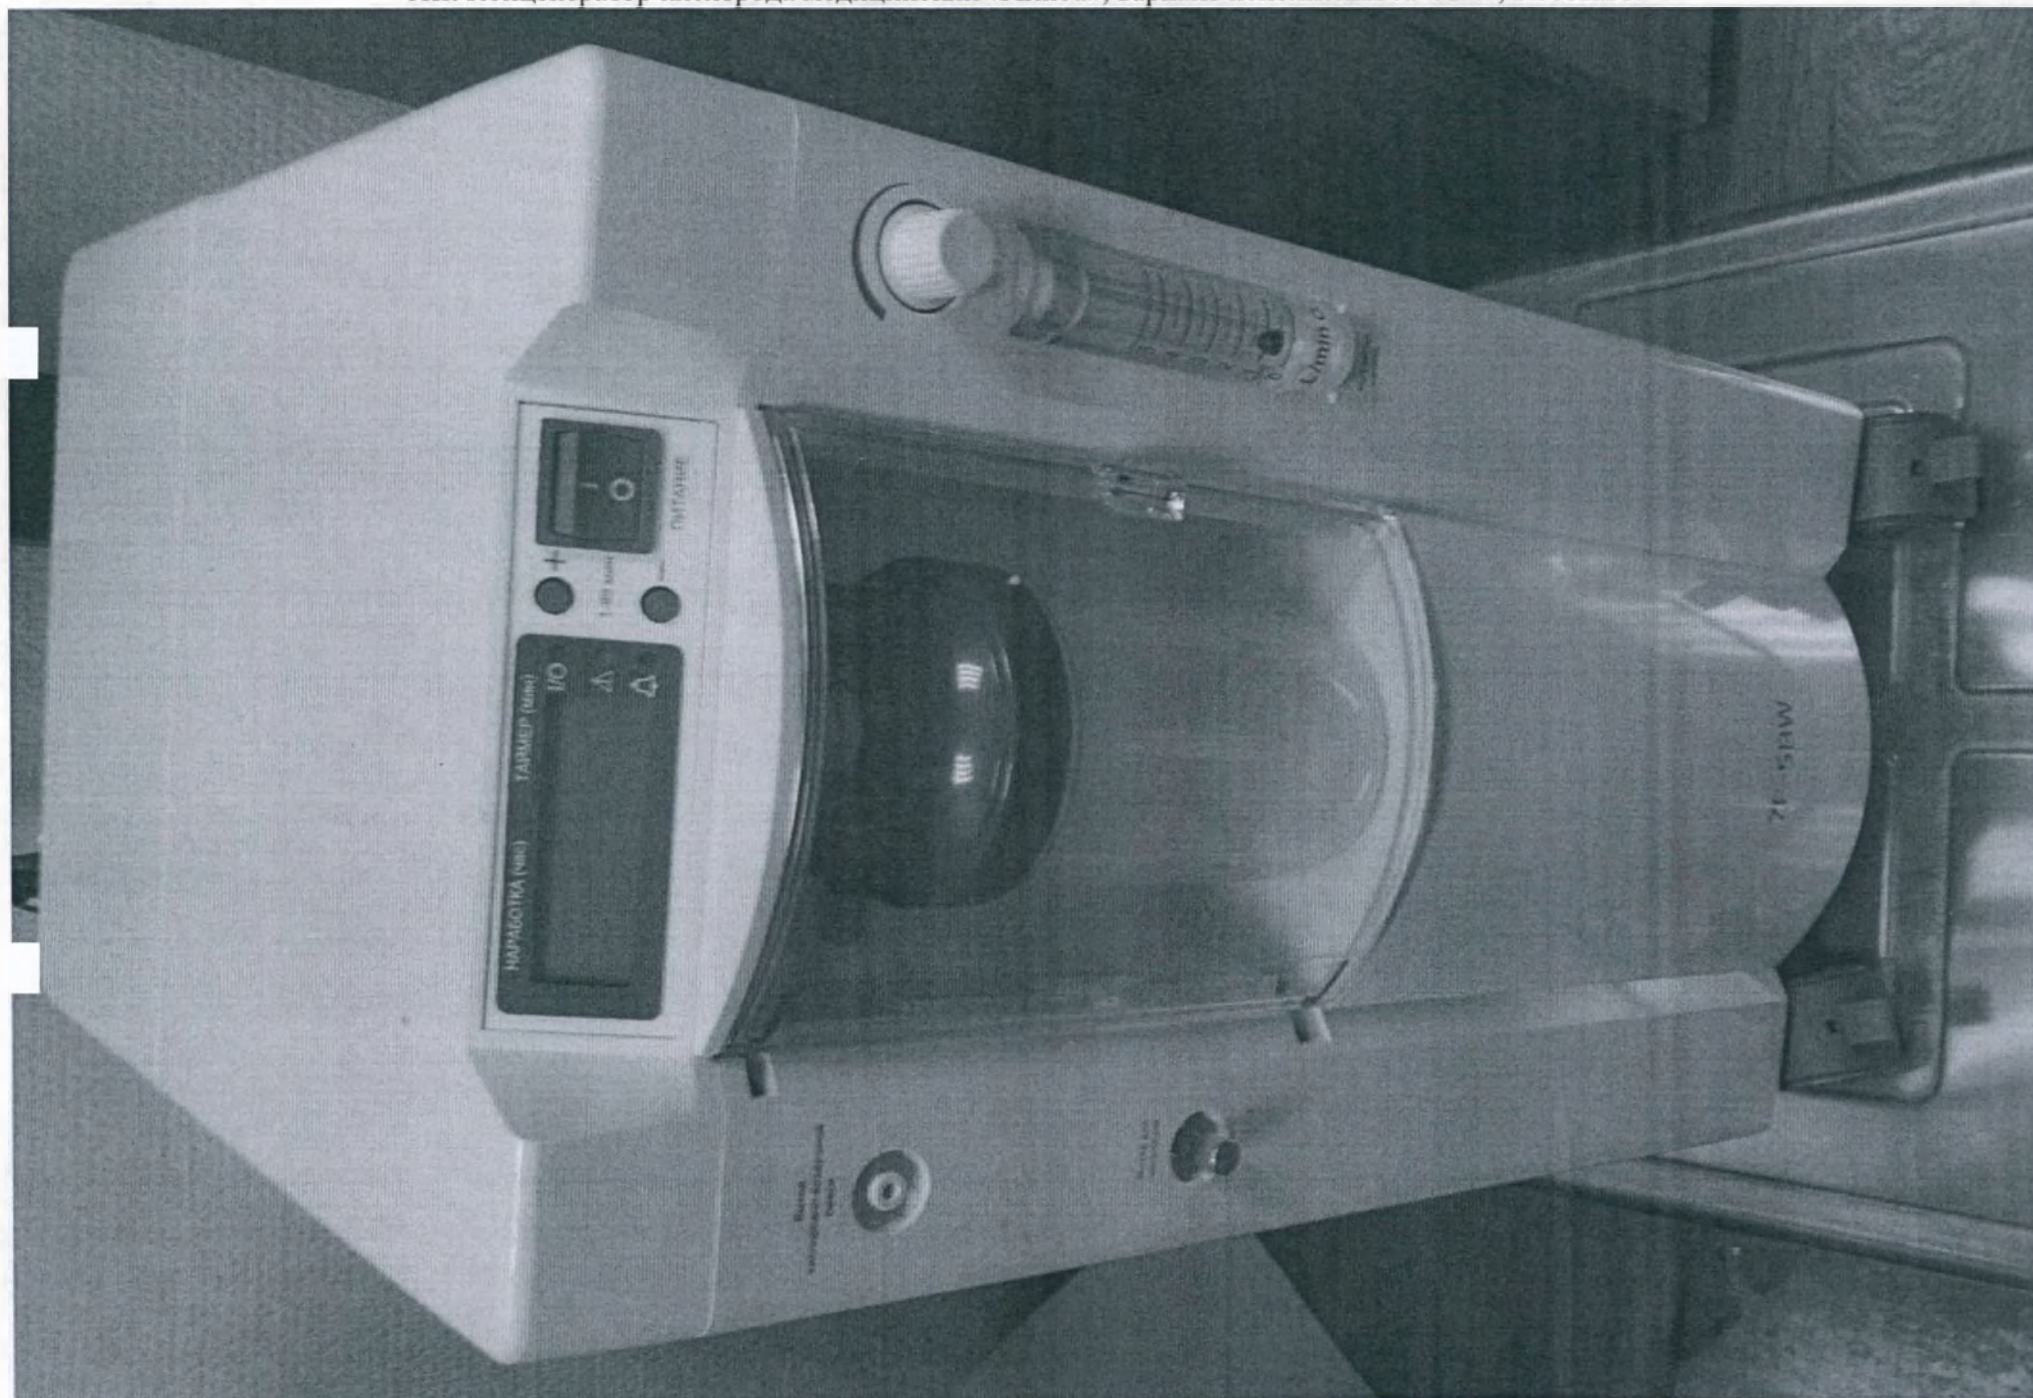


Рис. 75 – Концентратор кислорода

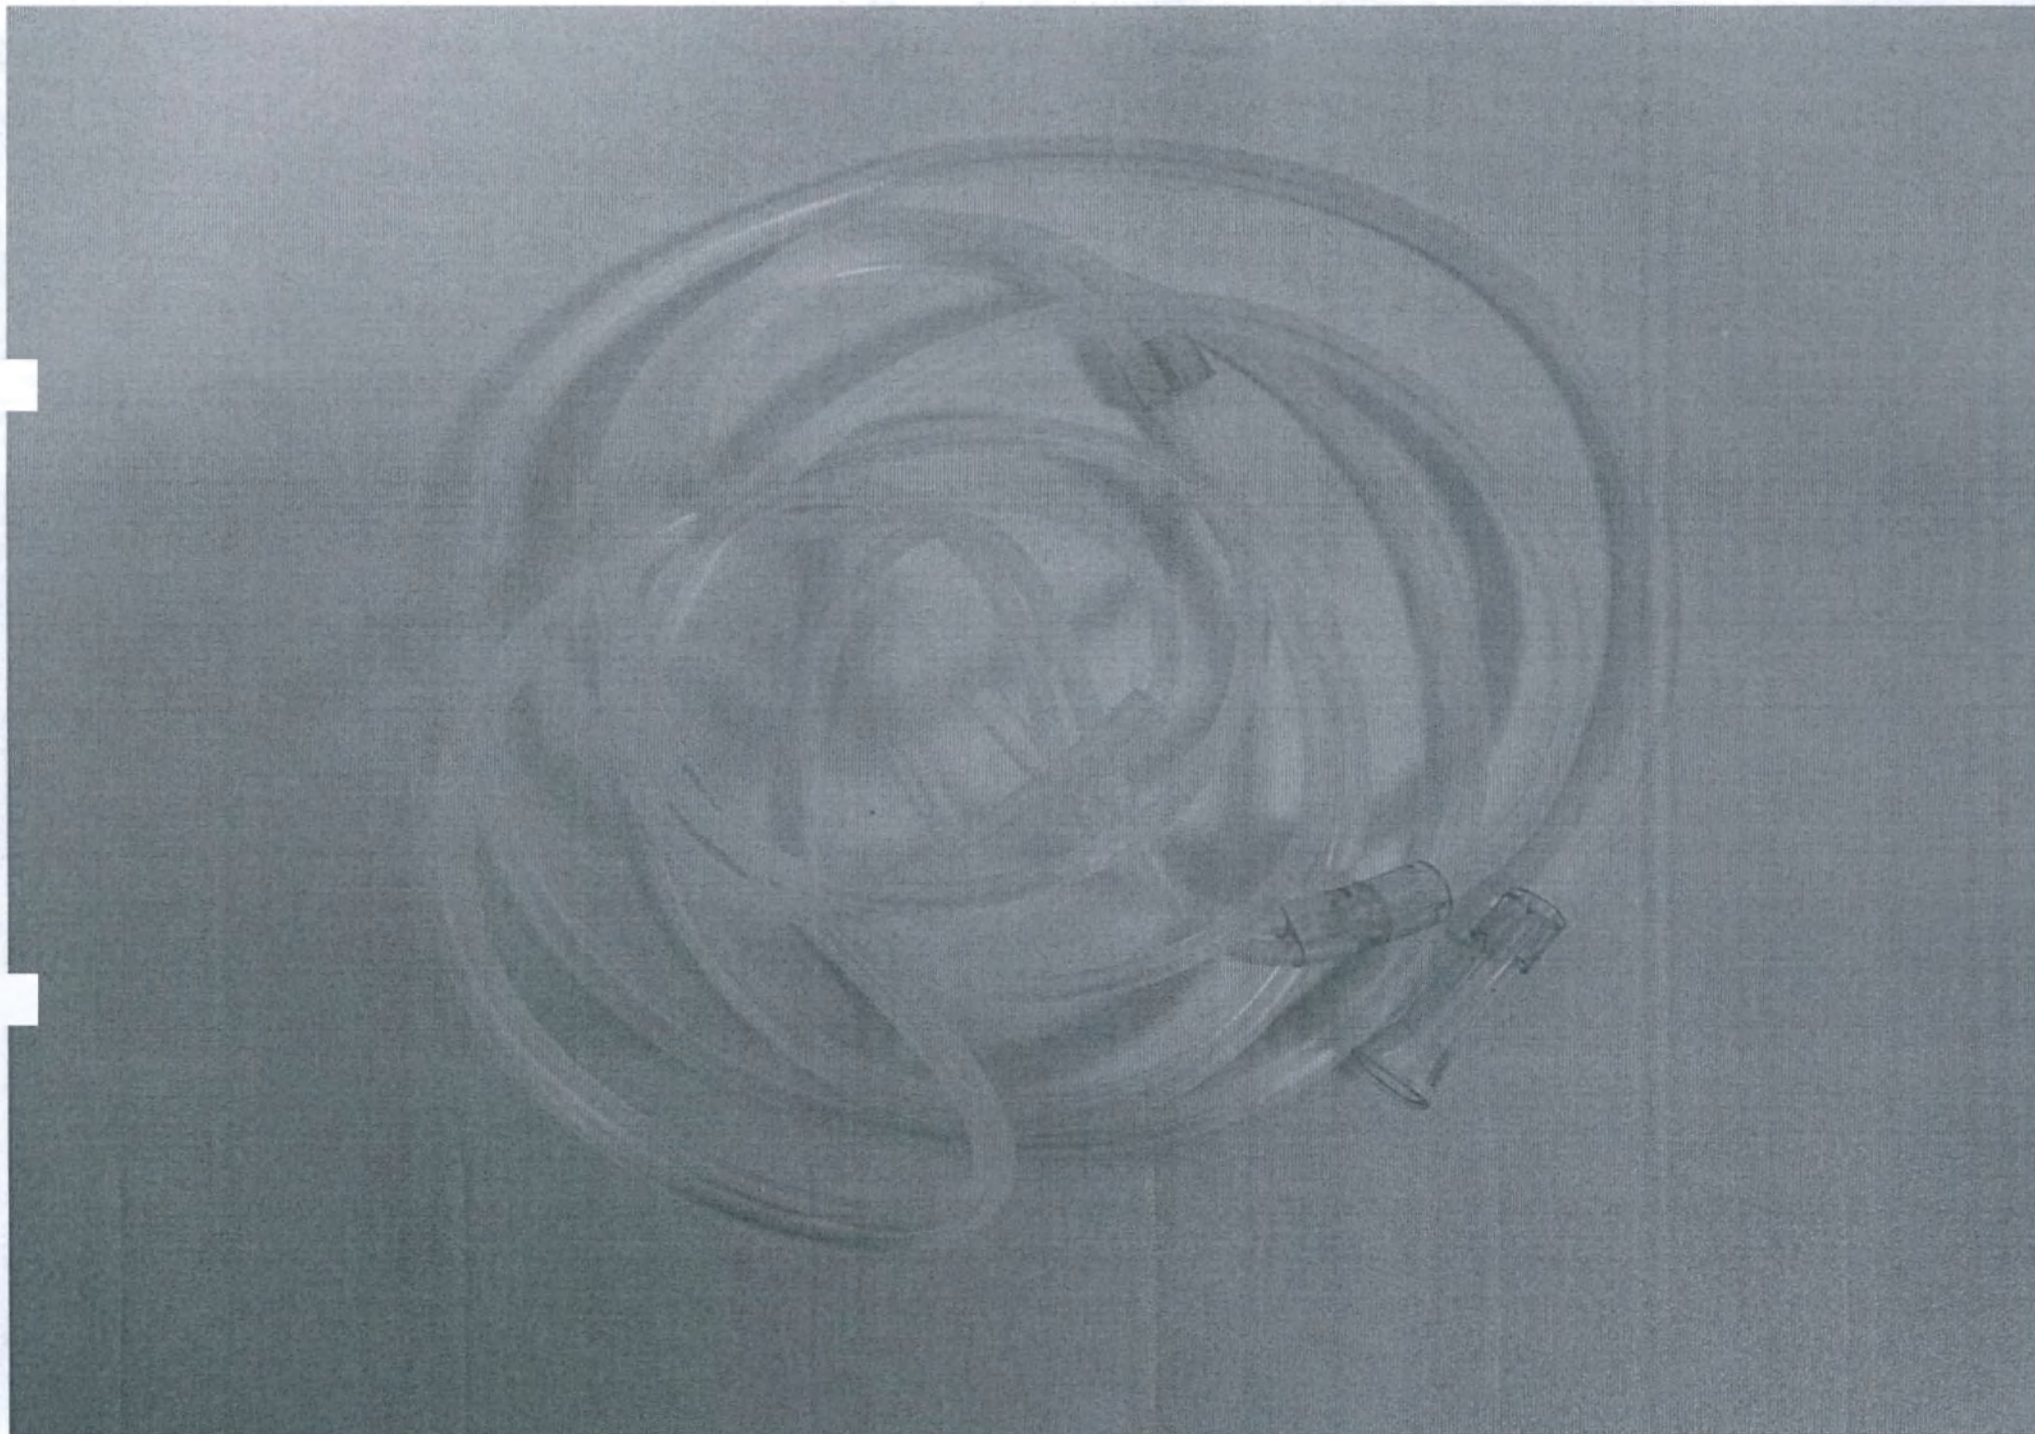


Рис. 76 – Канюля назальная малая

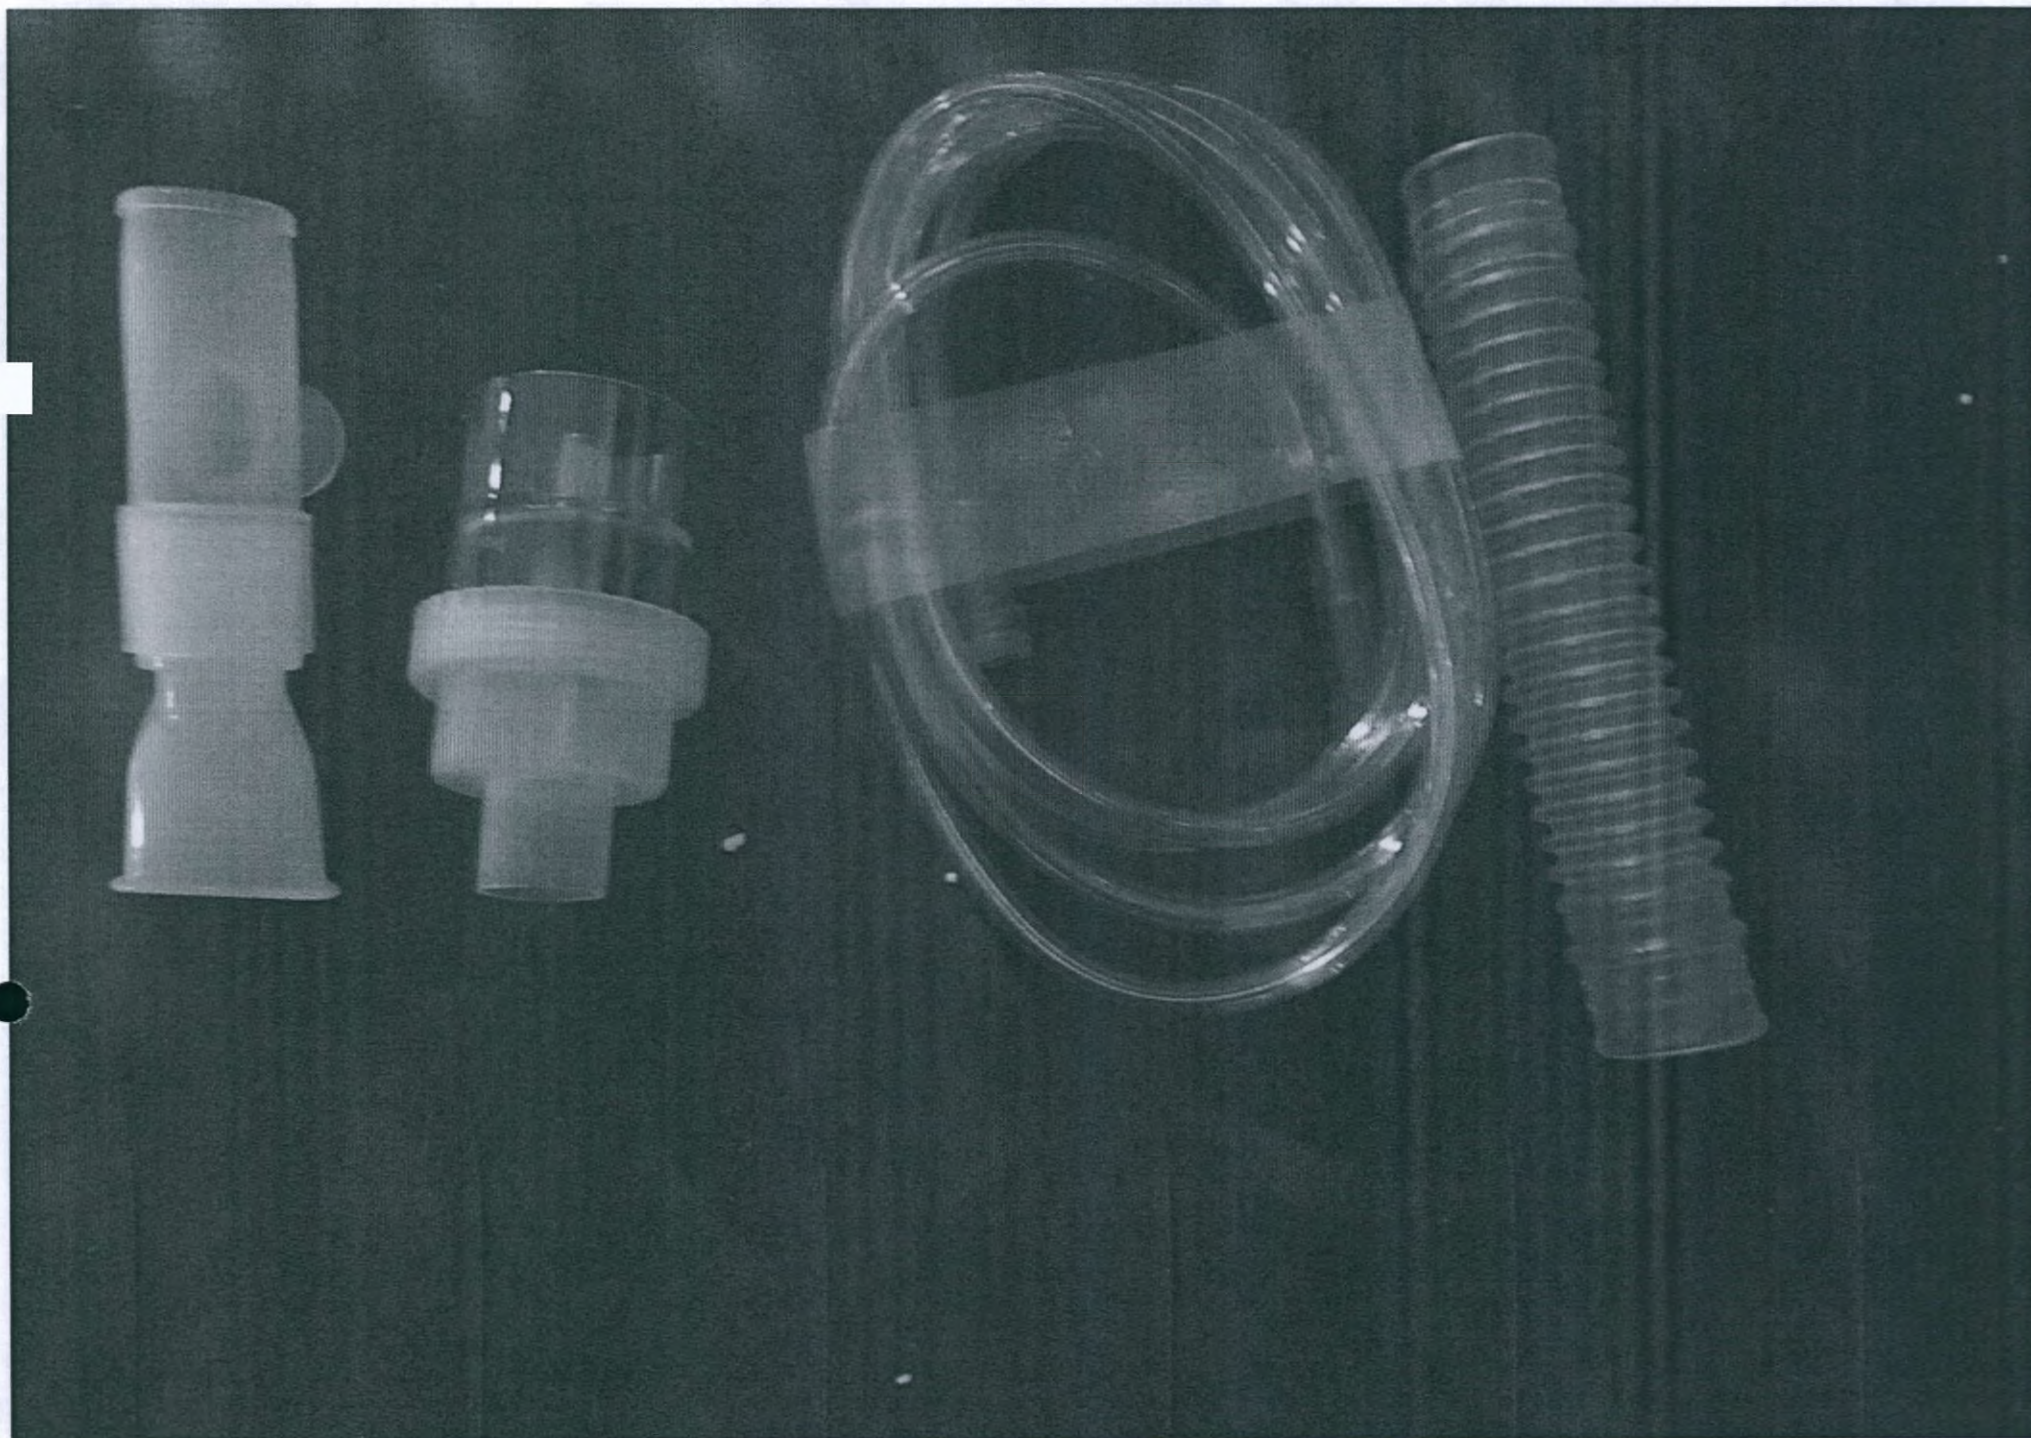


Рис. 77 – Комплект для ингаляции (тип II)

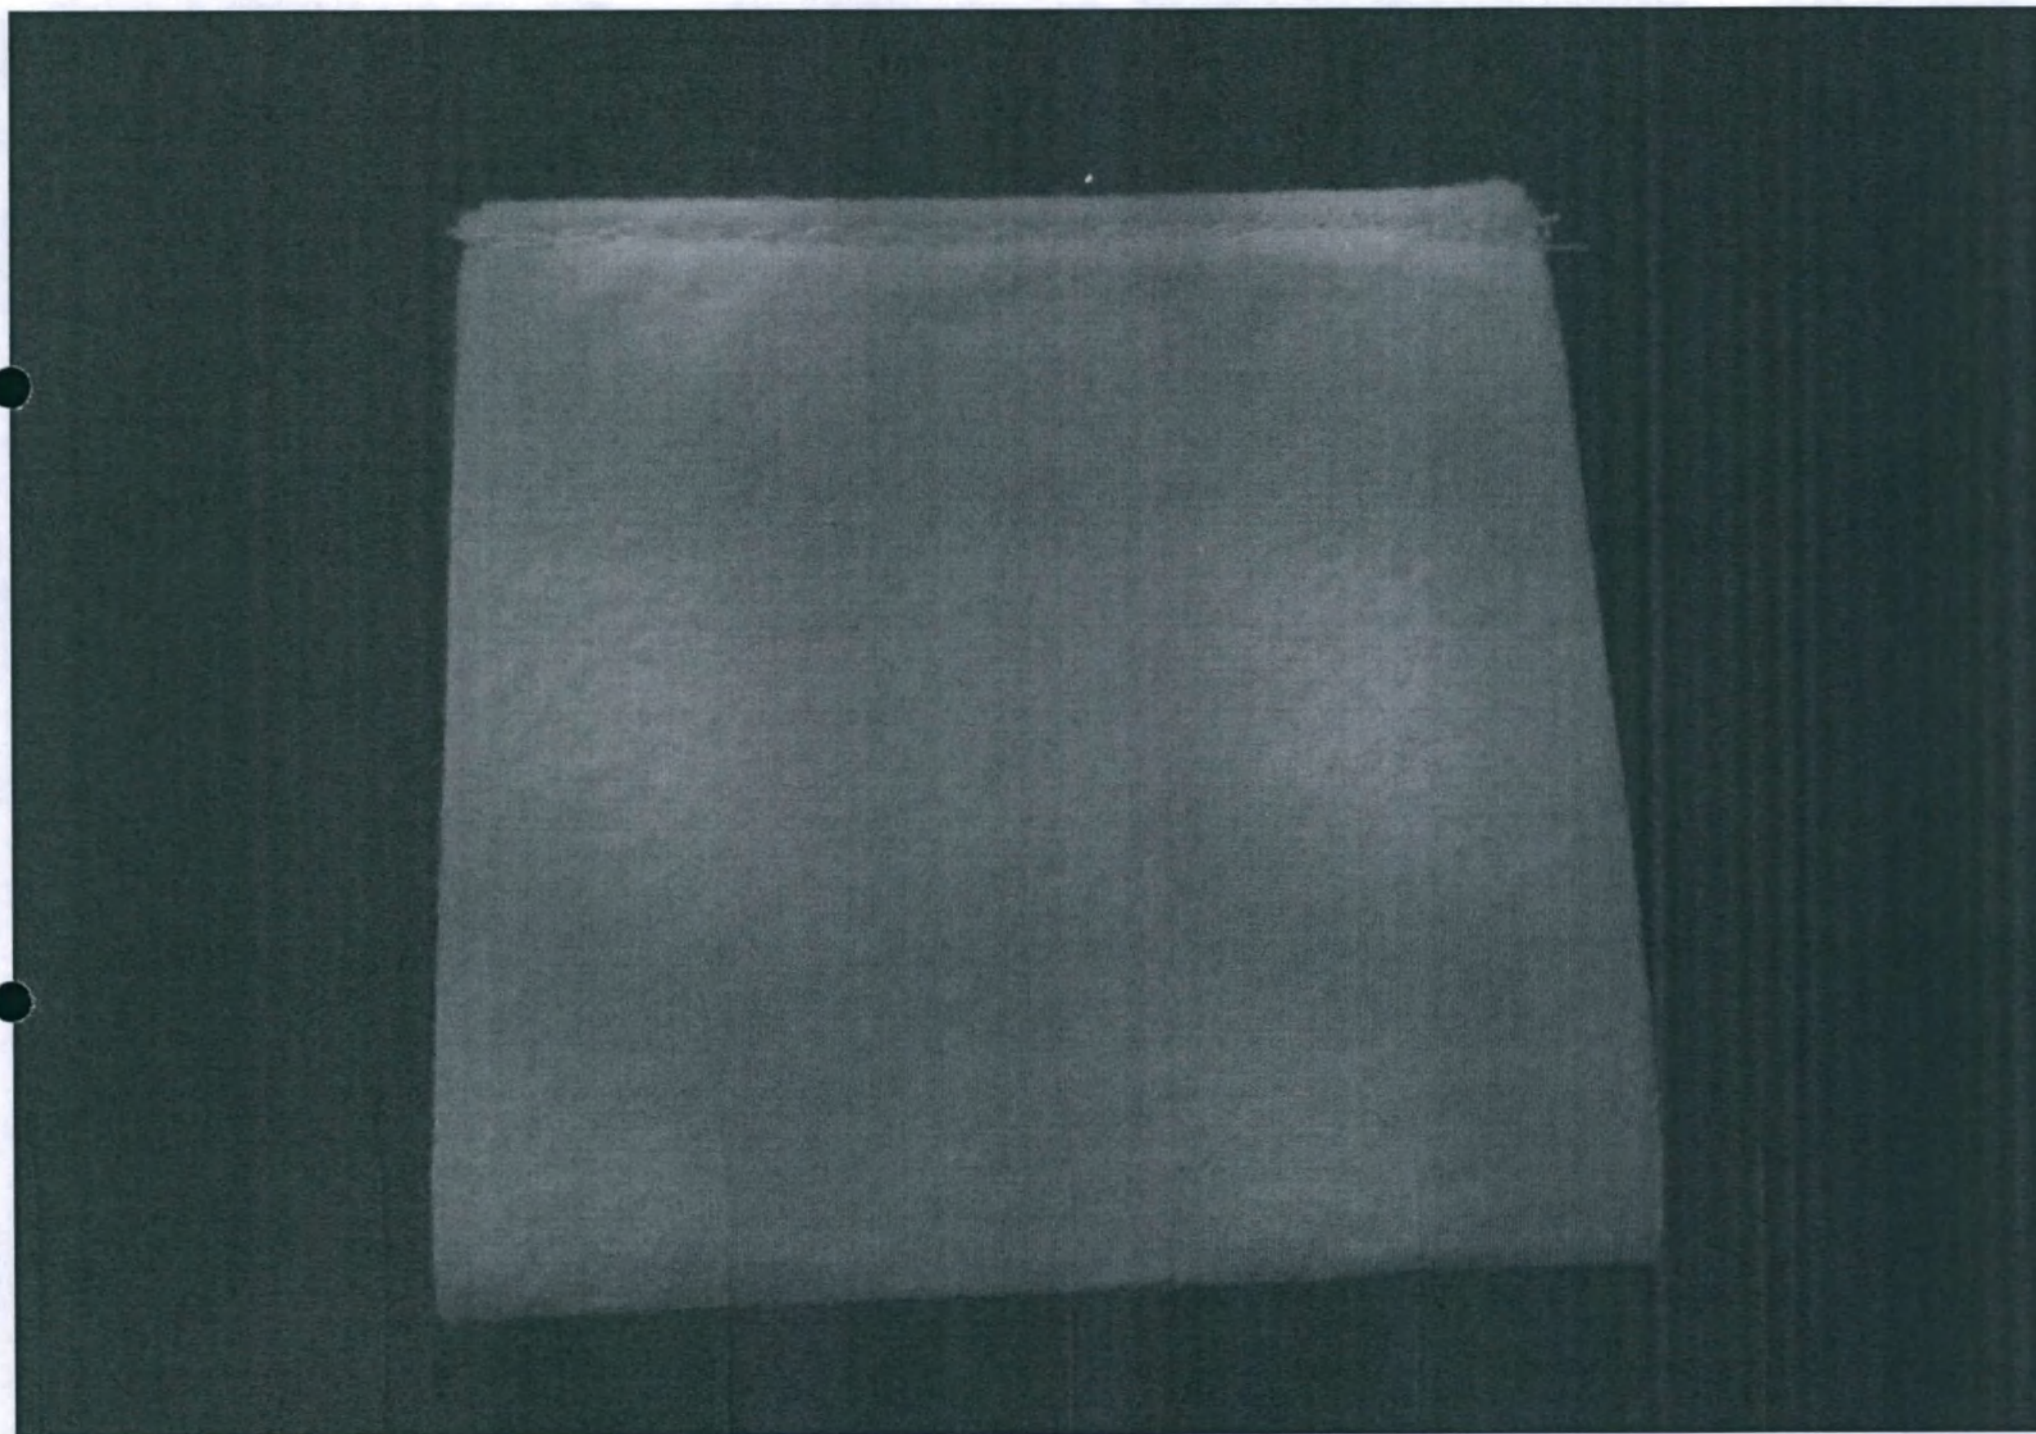


Рис. 78 – Фильтр тонкой очистки



Рис. 79 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

ХІІІ. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5C, в составе:

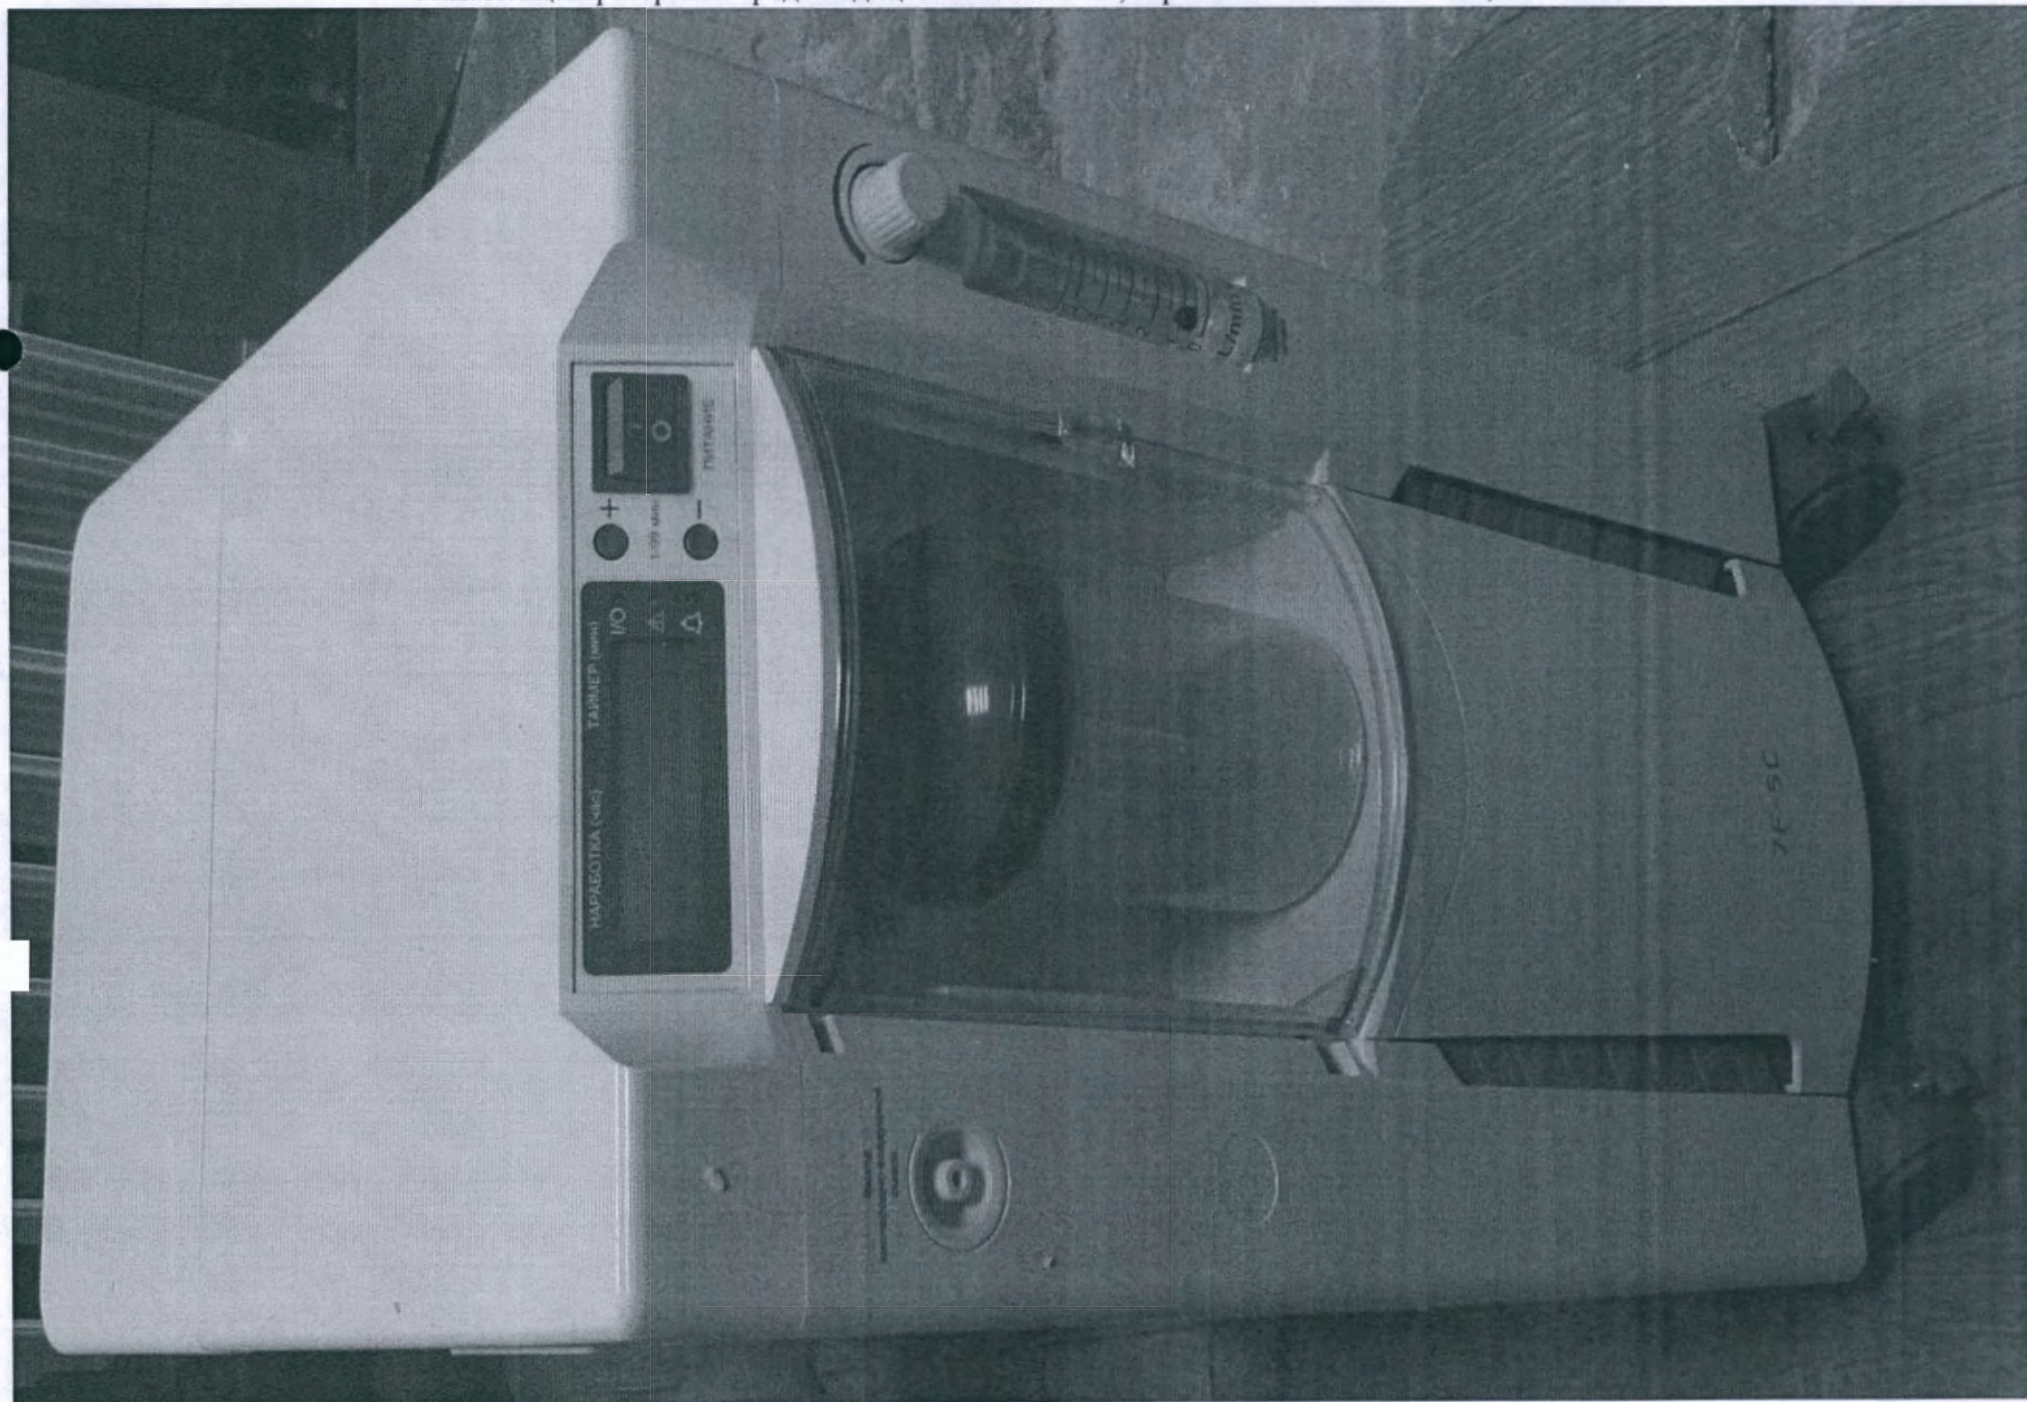


Рис. 80 – Концентратор кислорода

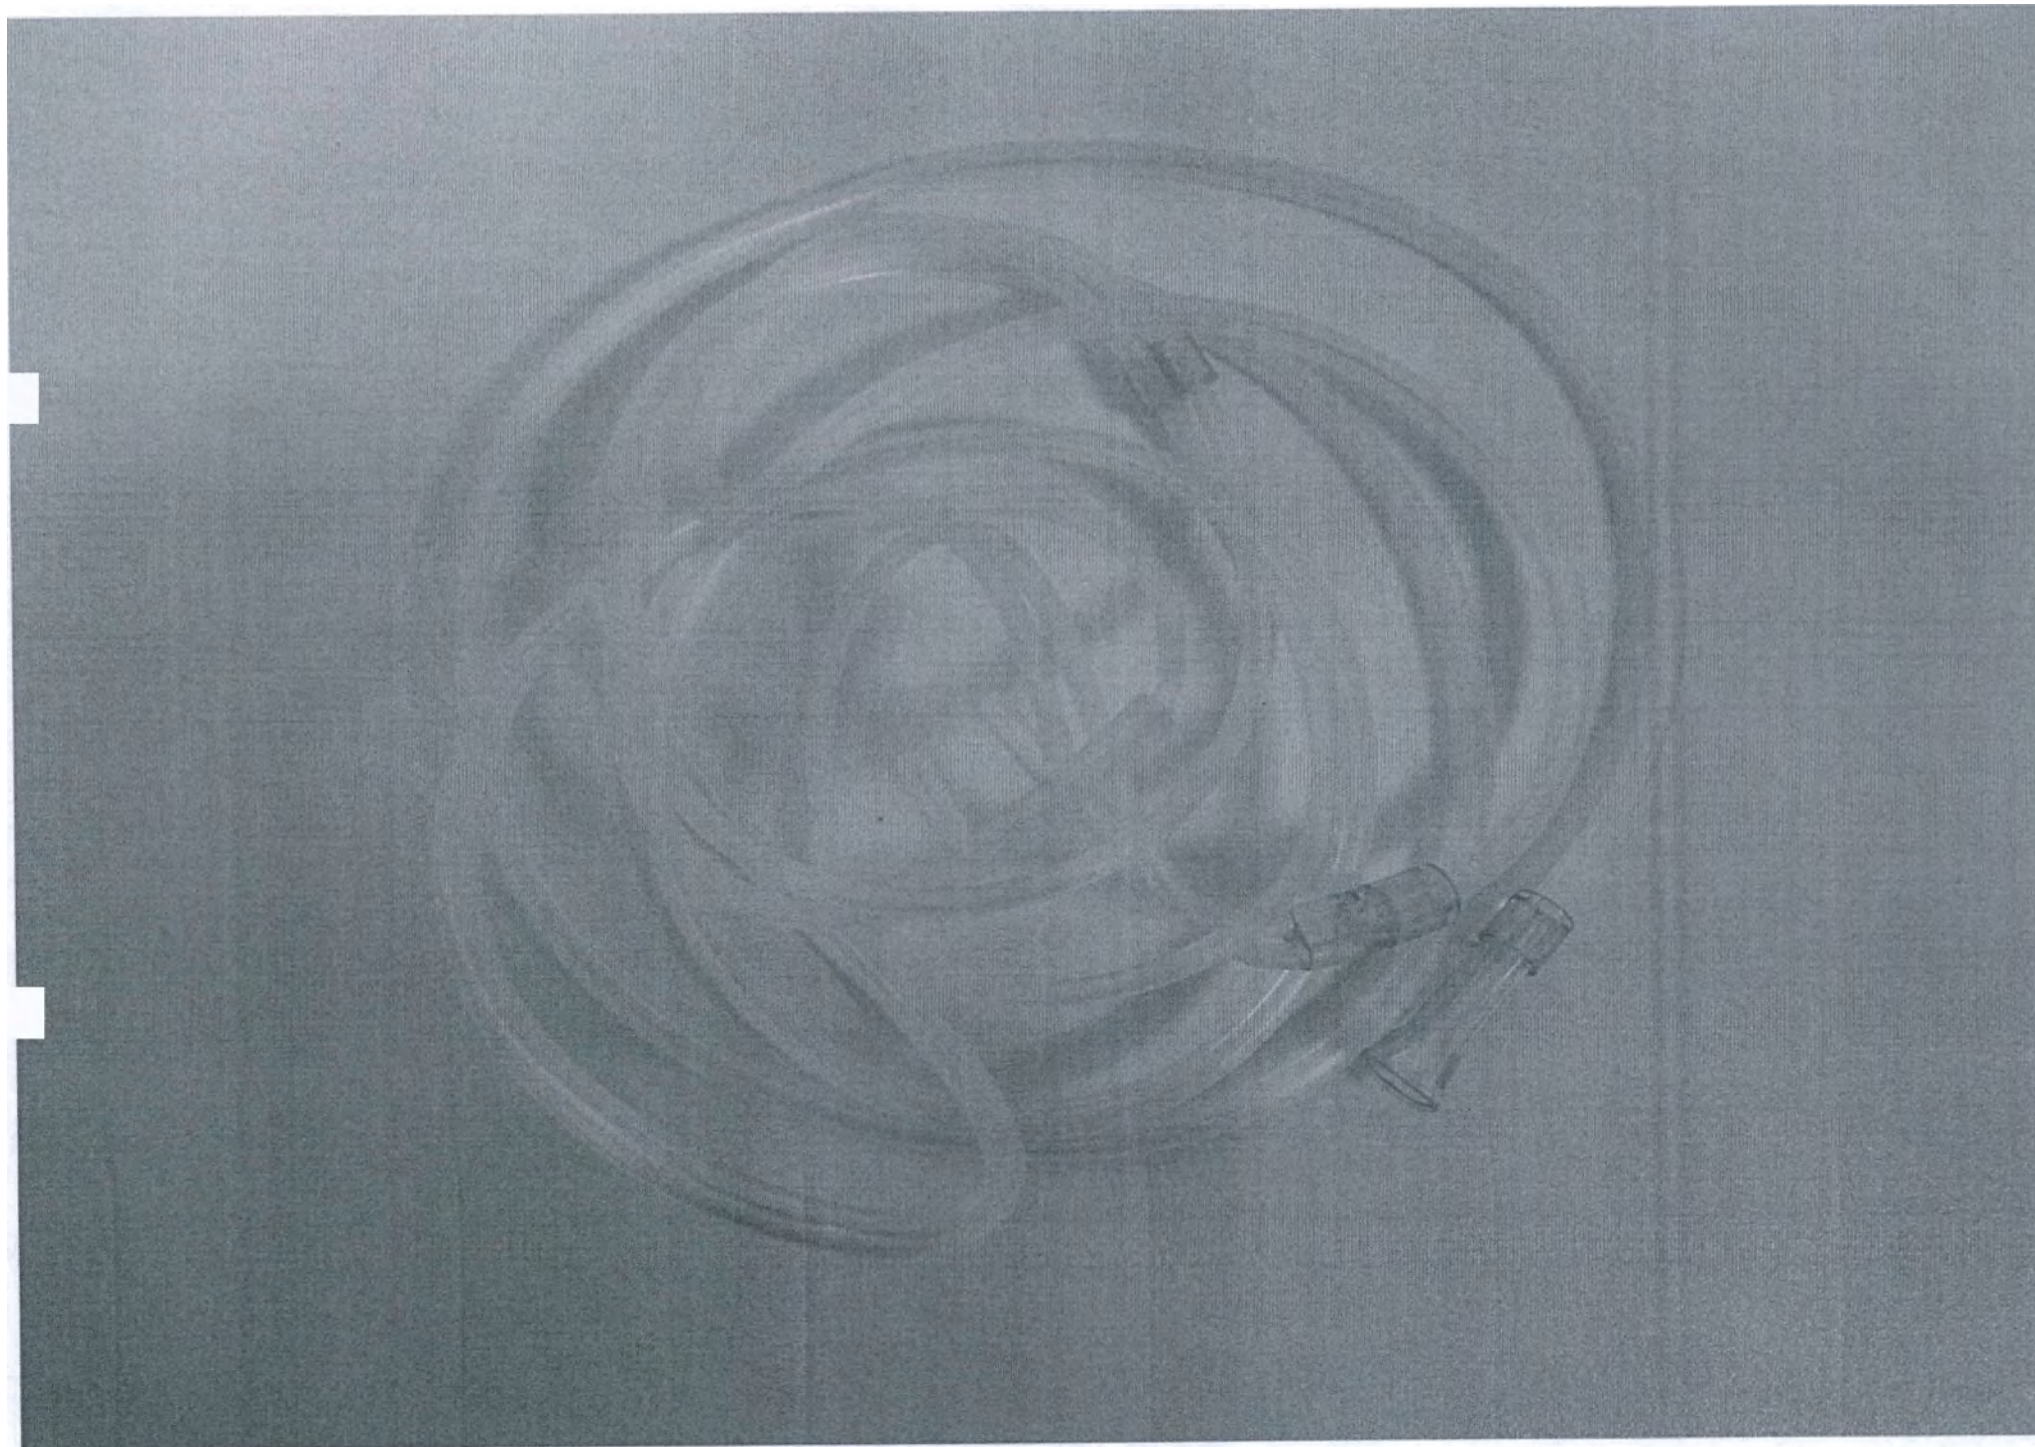


Рис. 81 – Канюля назальная малая

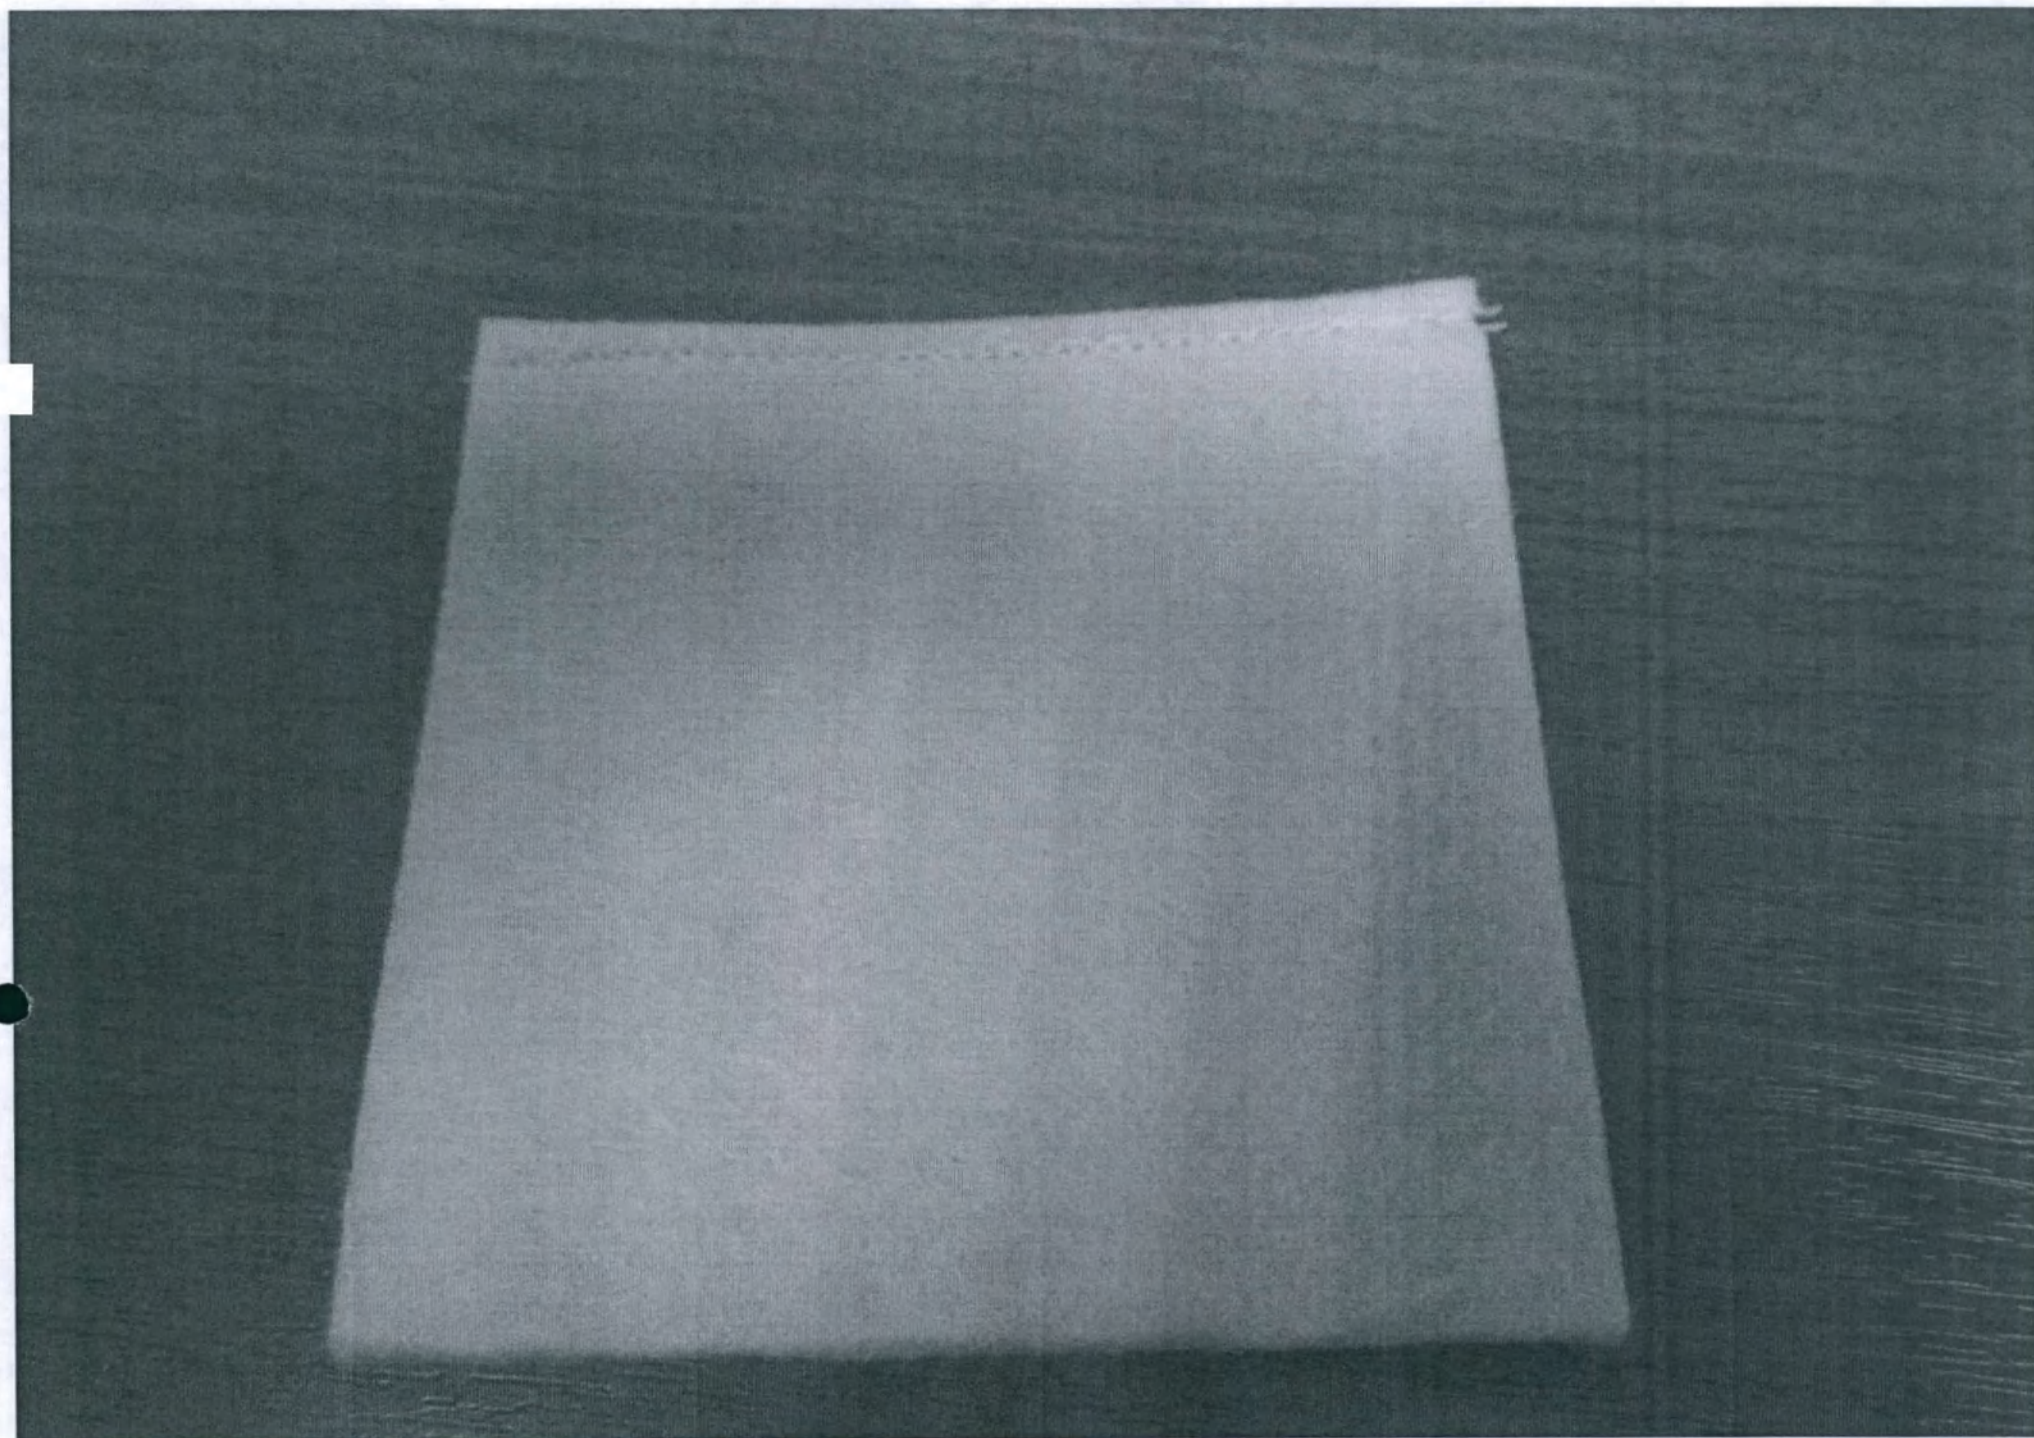


Рис. 82 – Фильтр тонкой очистки



Рис. 83 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

XIV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5CW, в составе:

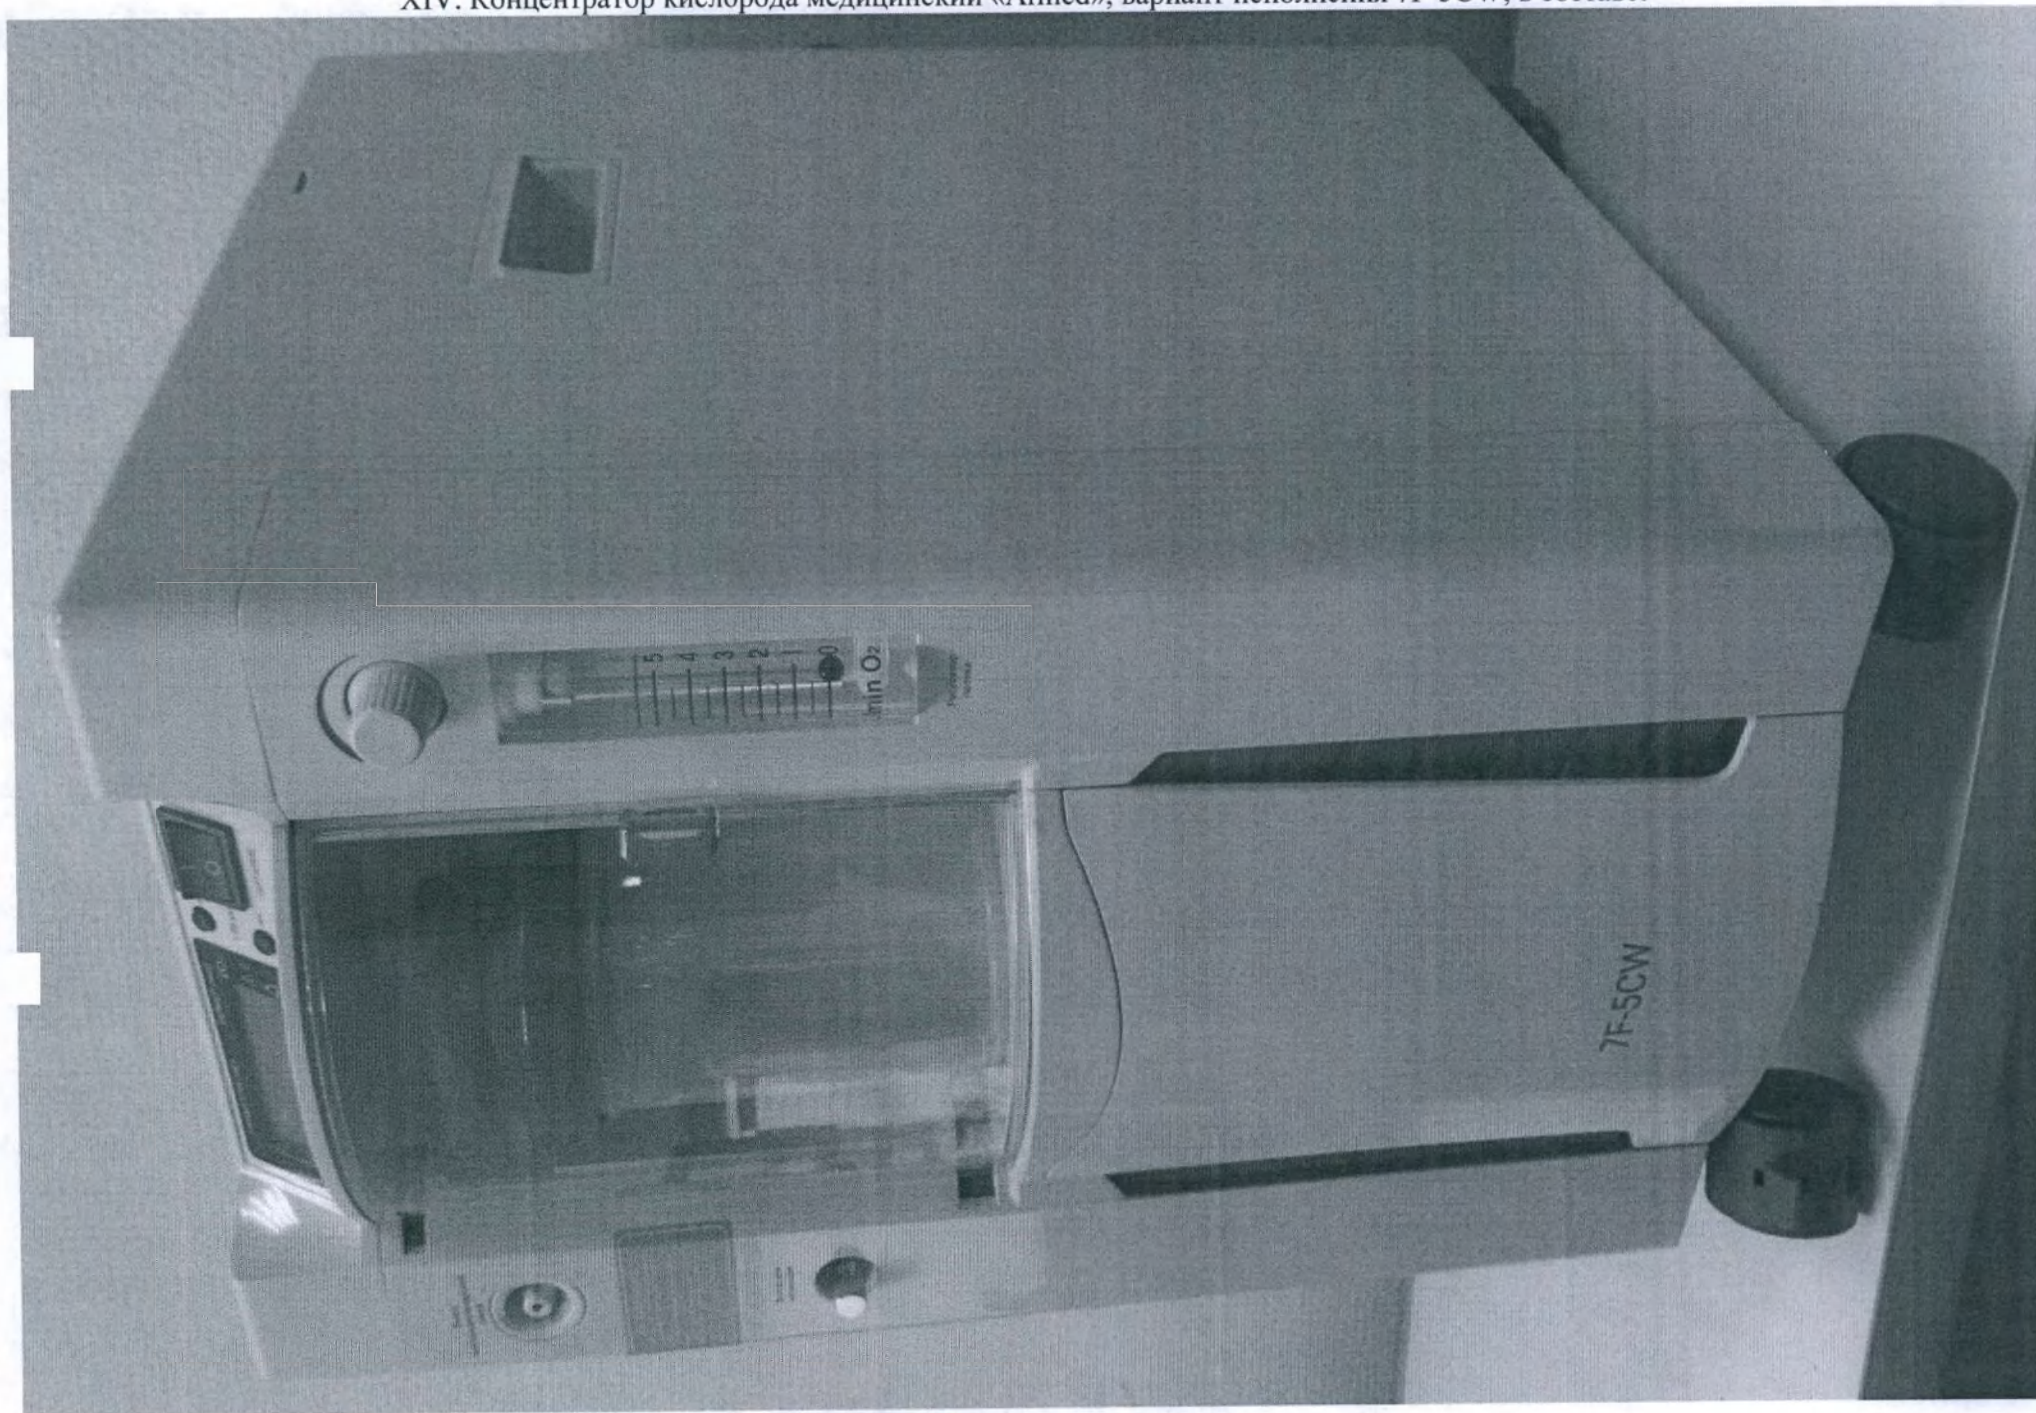


Рис. 84 – Концентратор кислорода

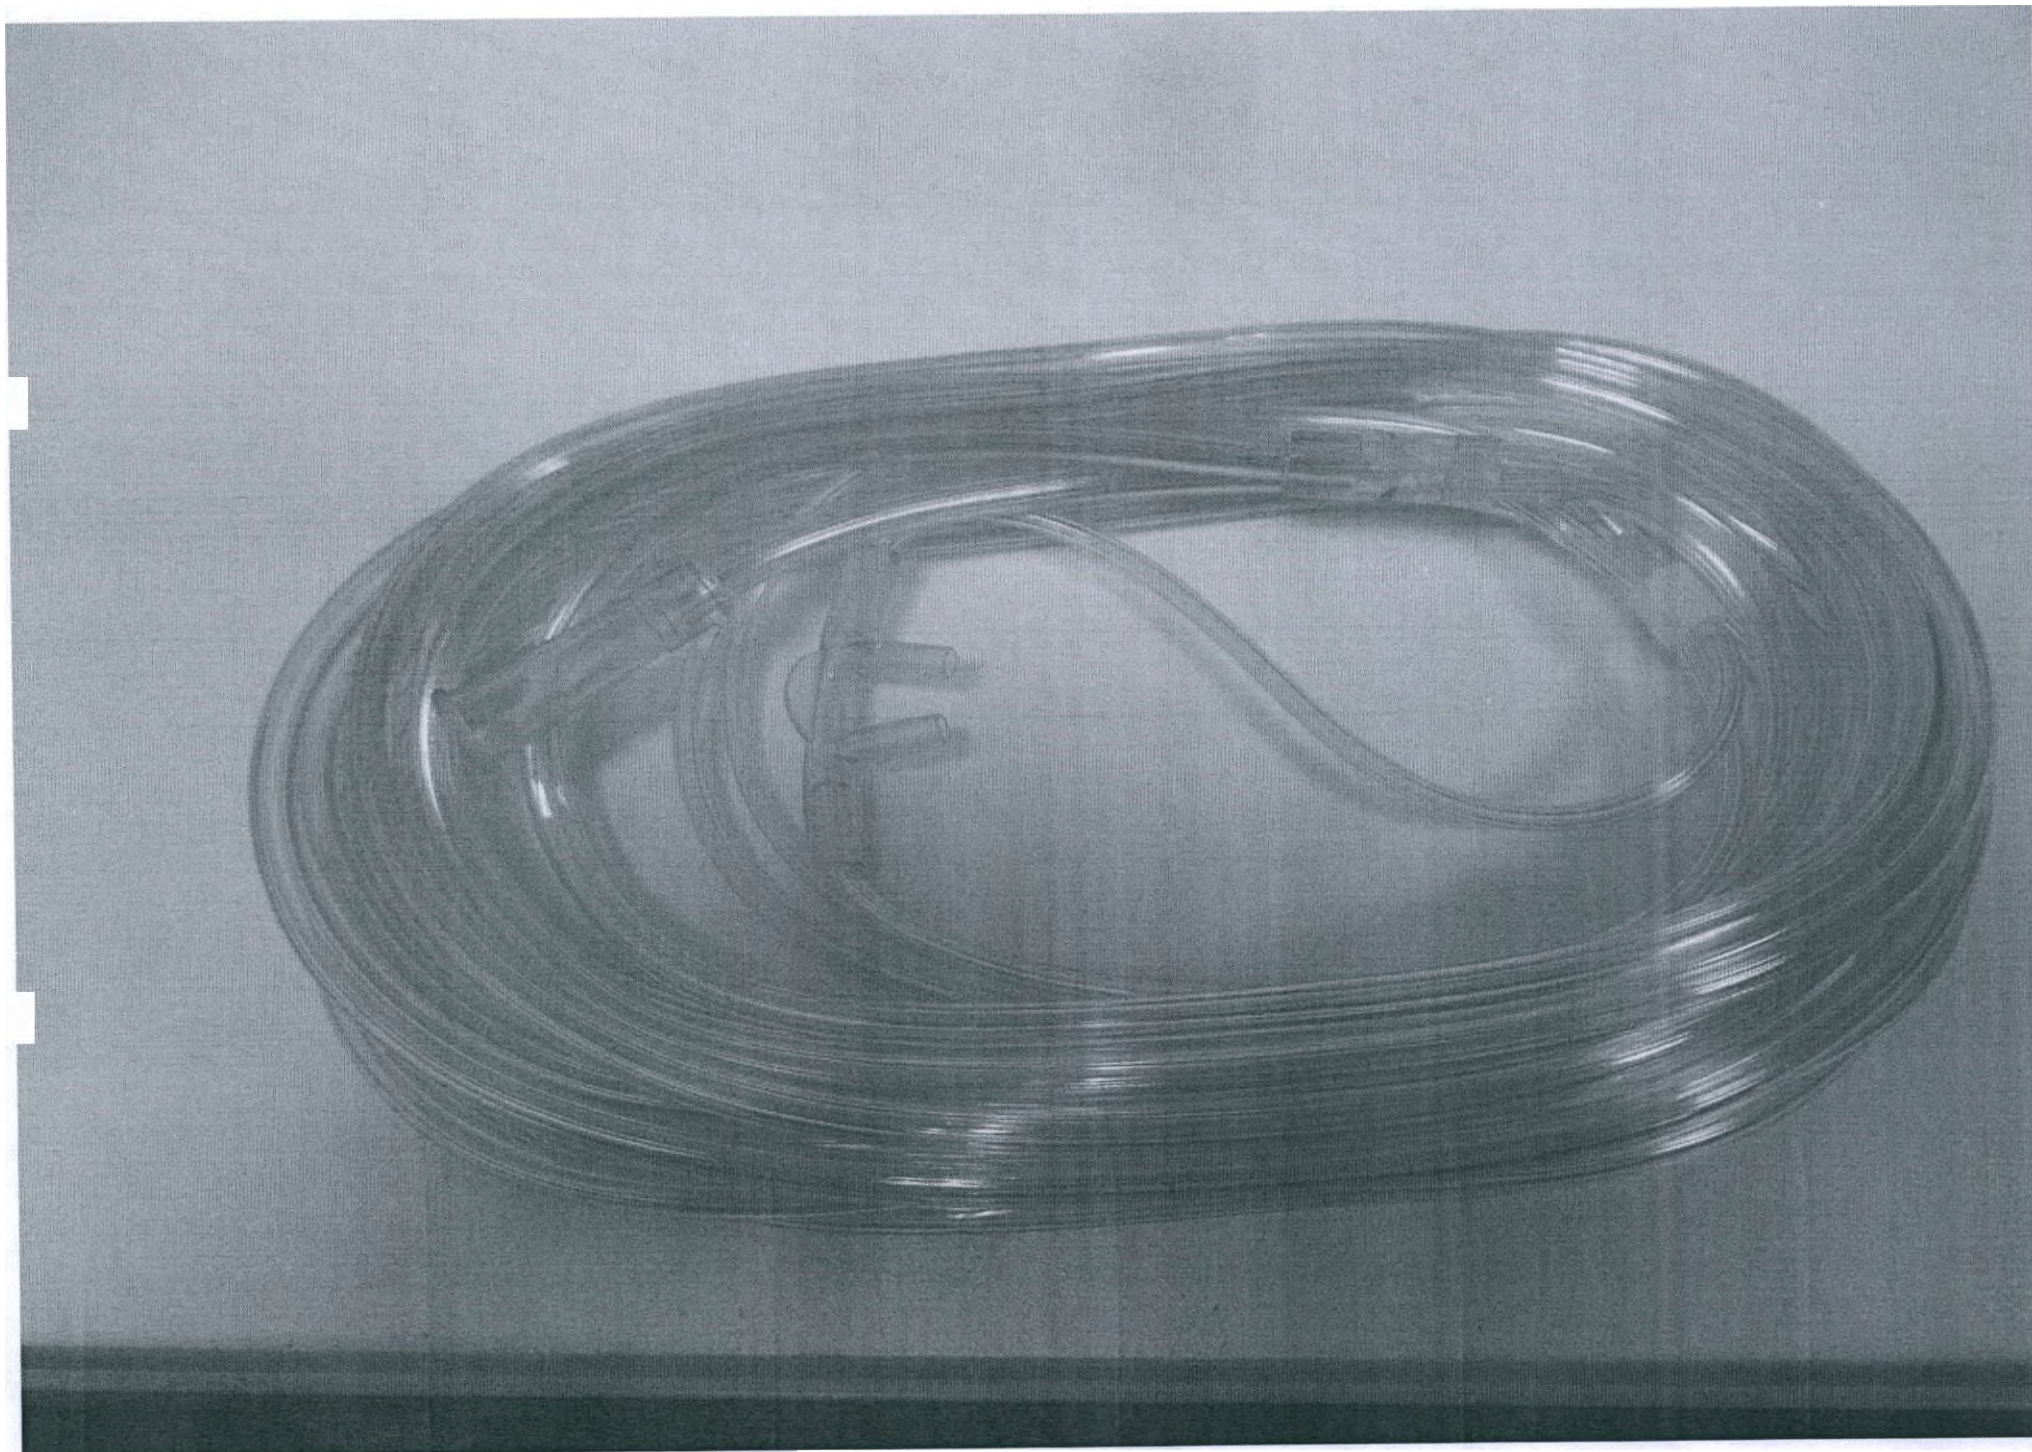


Рис. 85 – Канюля назальная большая

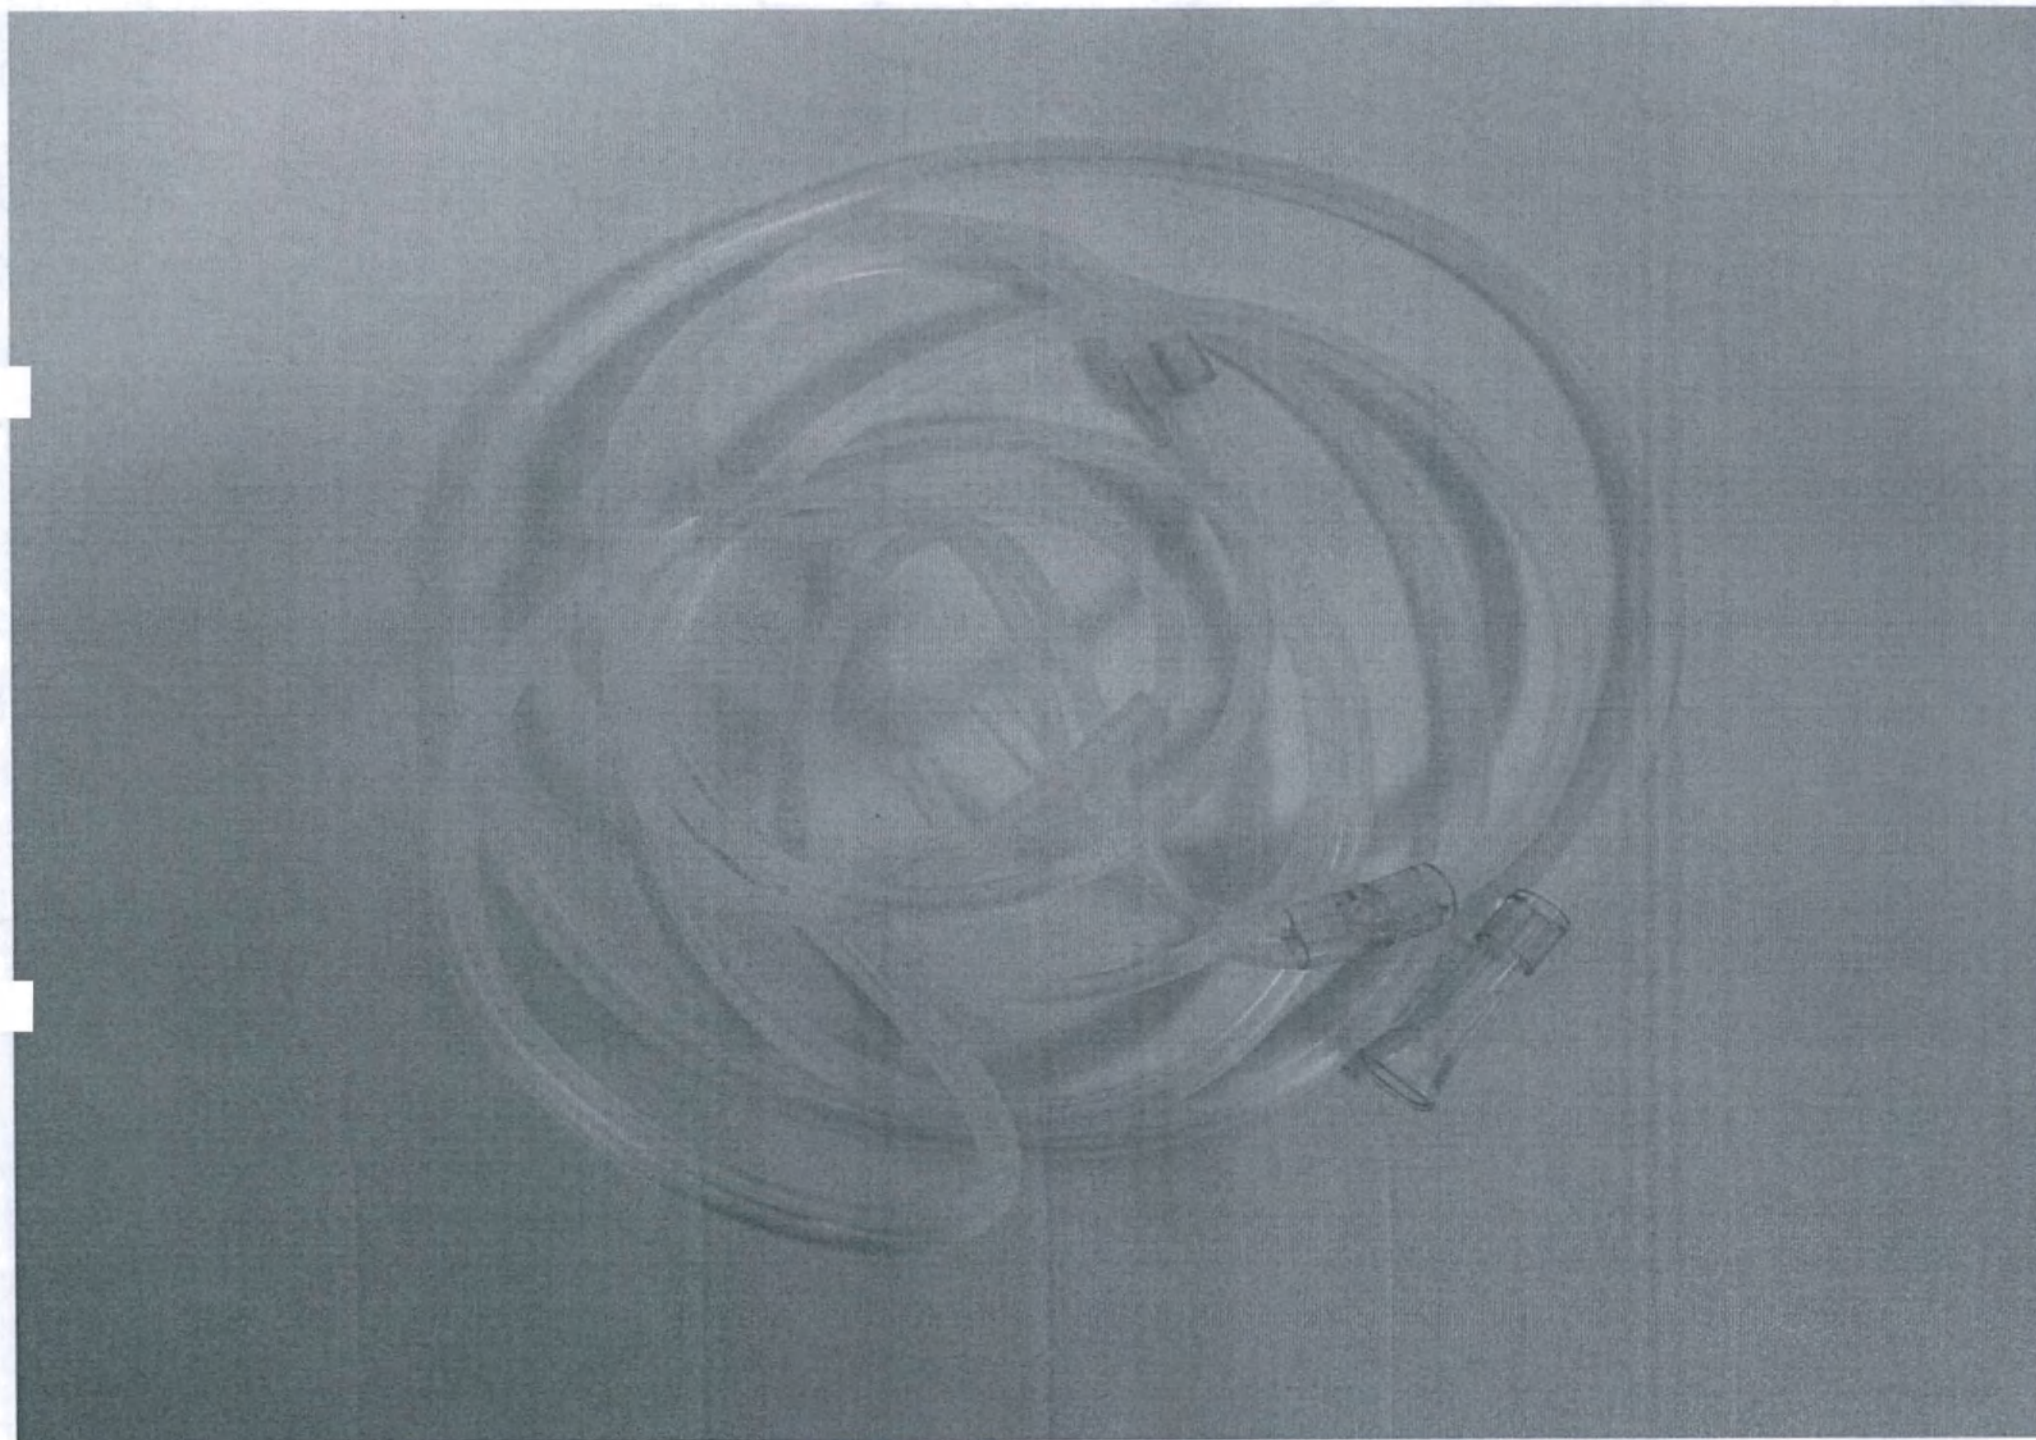


Рис. 86 – Канюля назальная малая

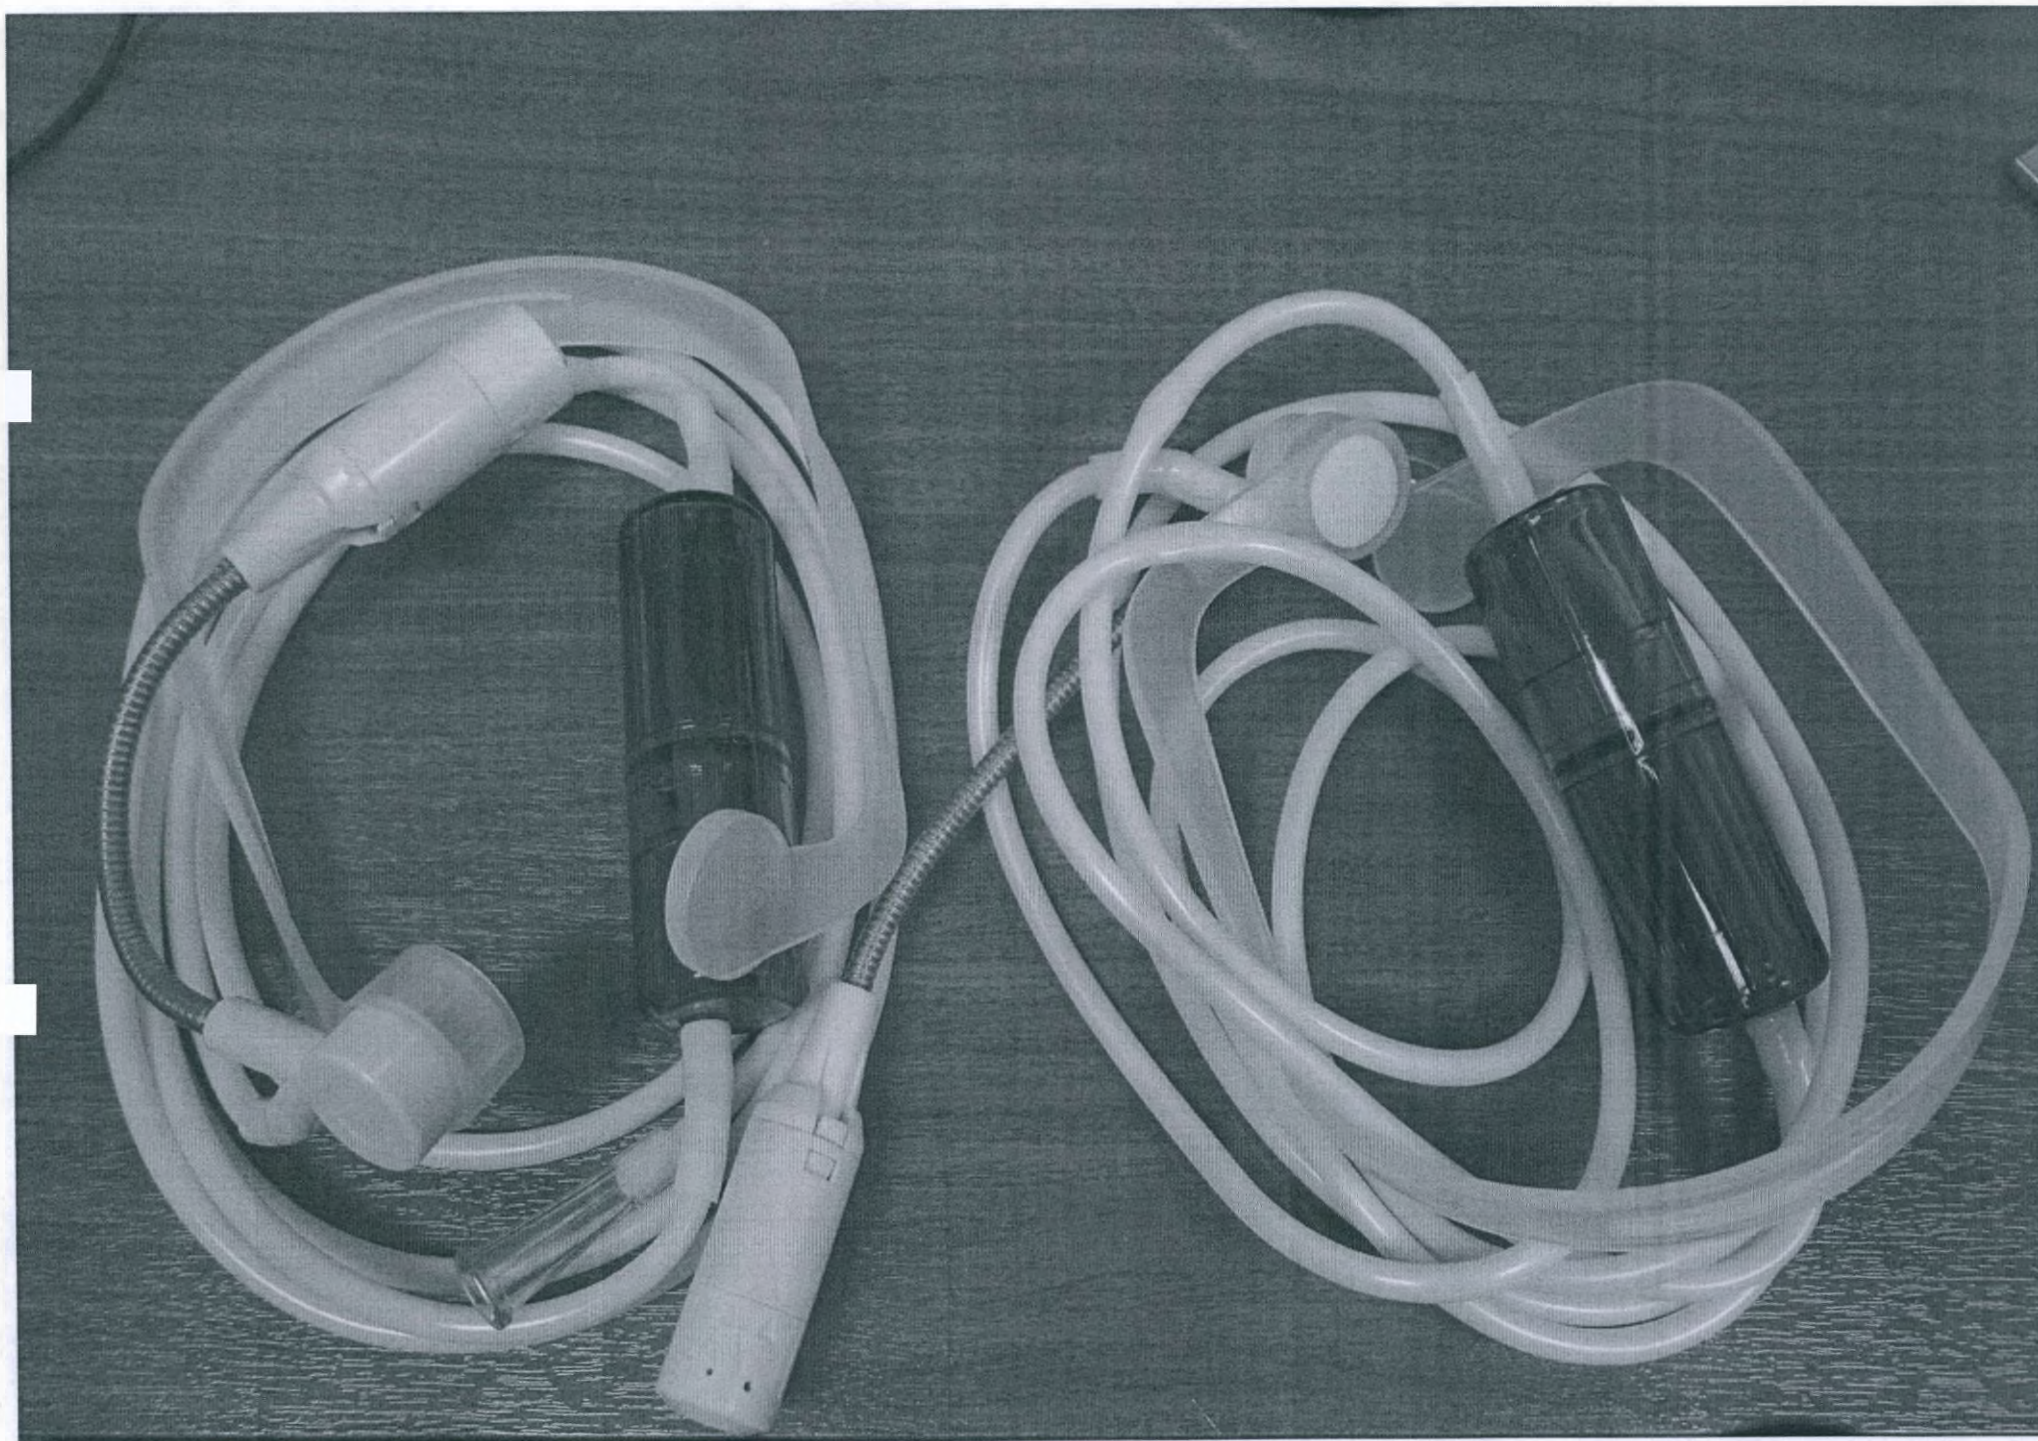


Рис. 87 – Диффузор (2 шт.)

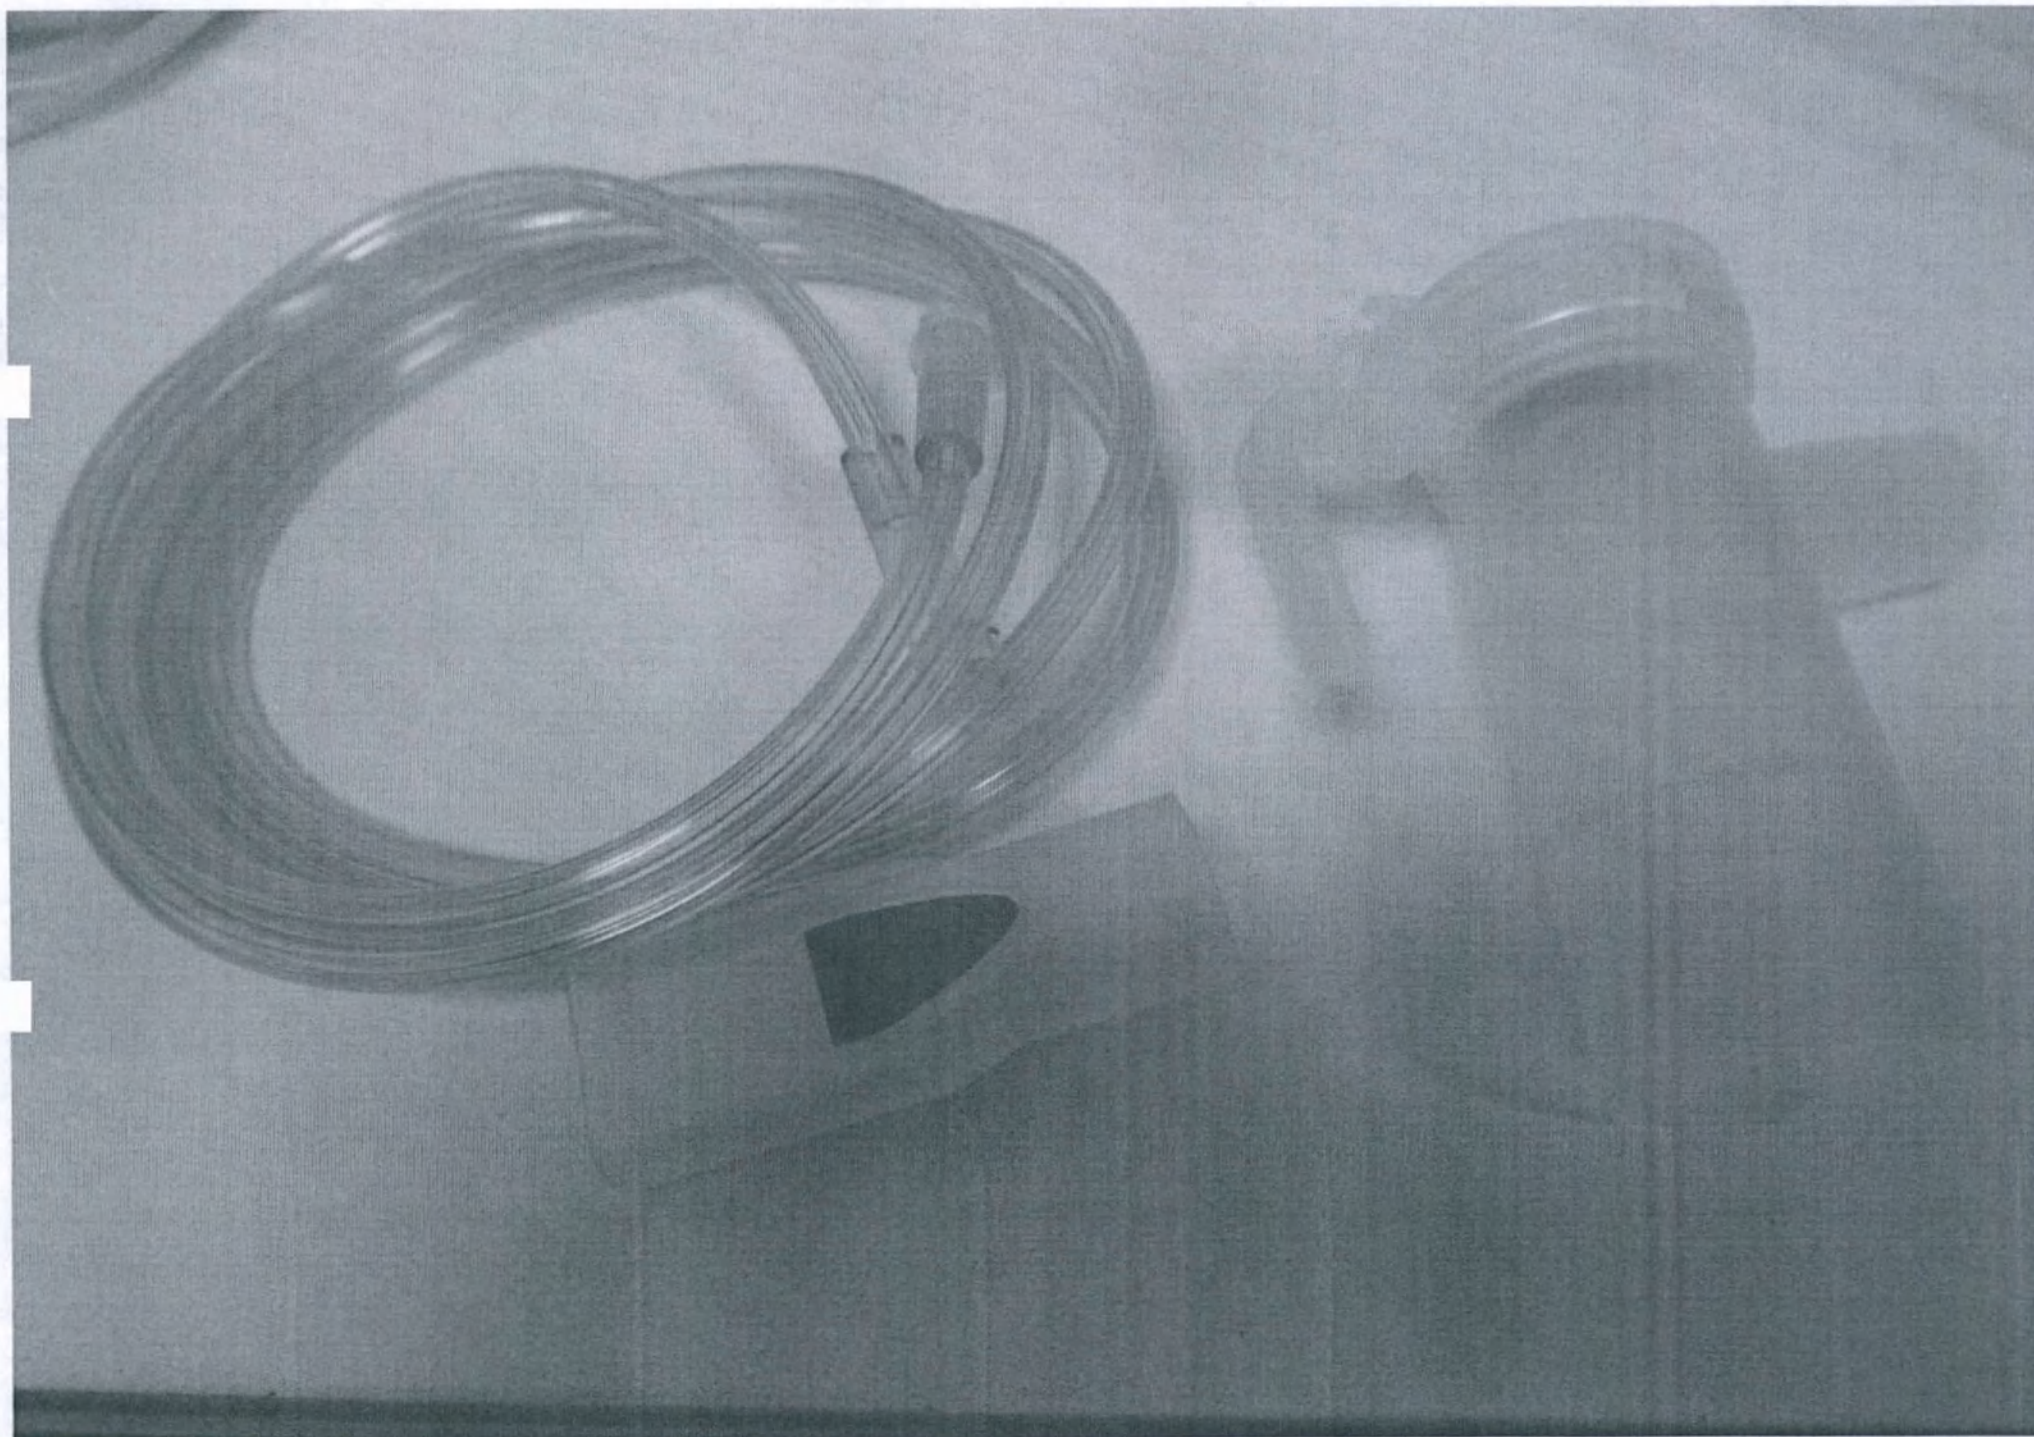


Рис. 88 – Комплект для ингаляции (тип I)

XV. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5E, в составе:

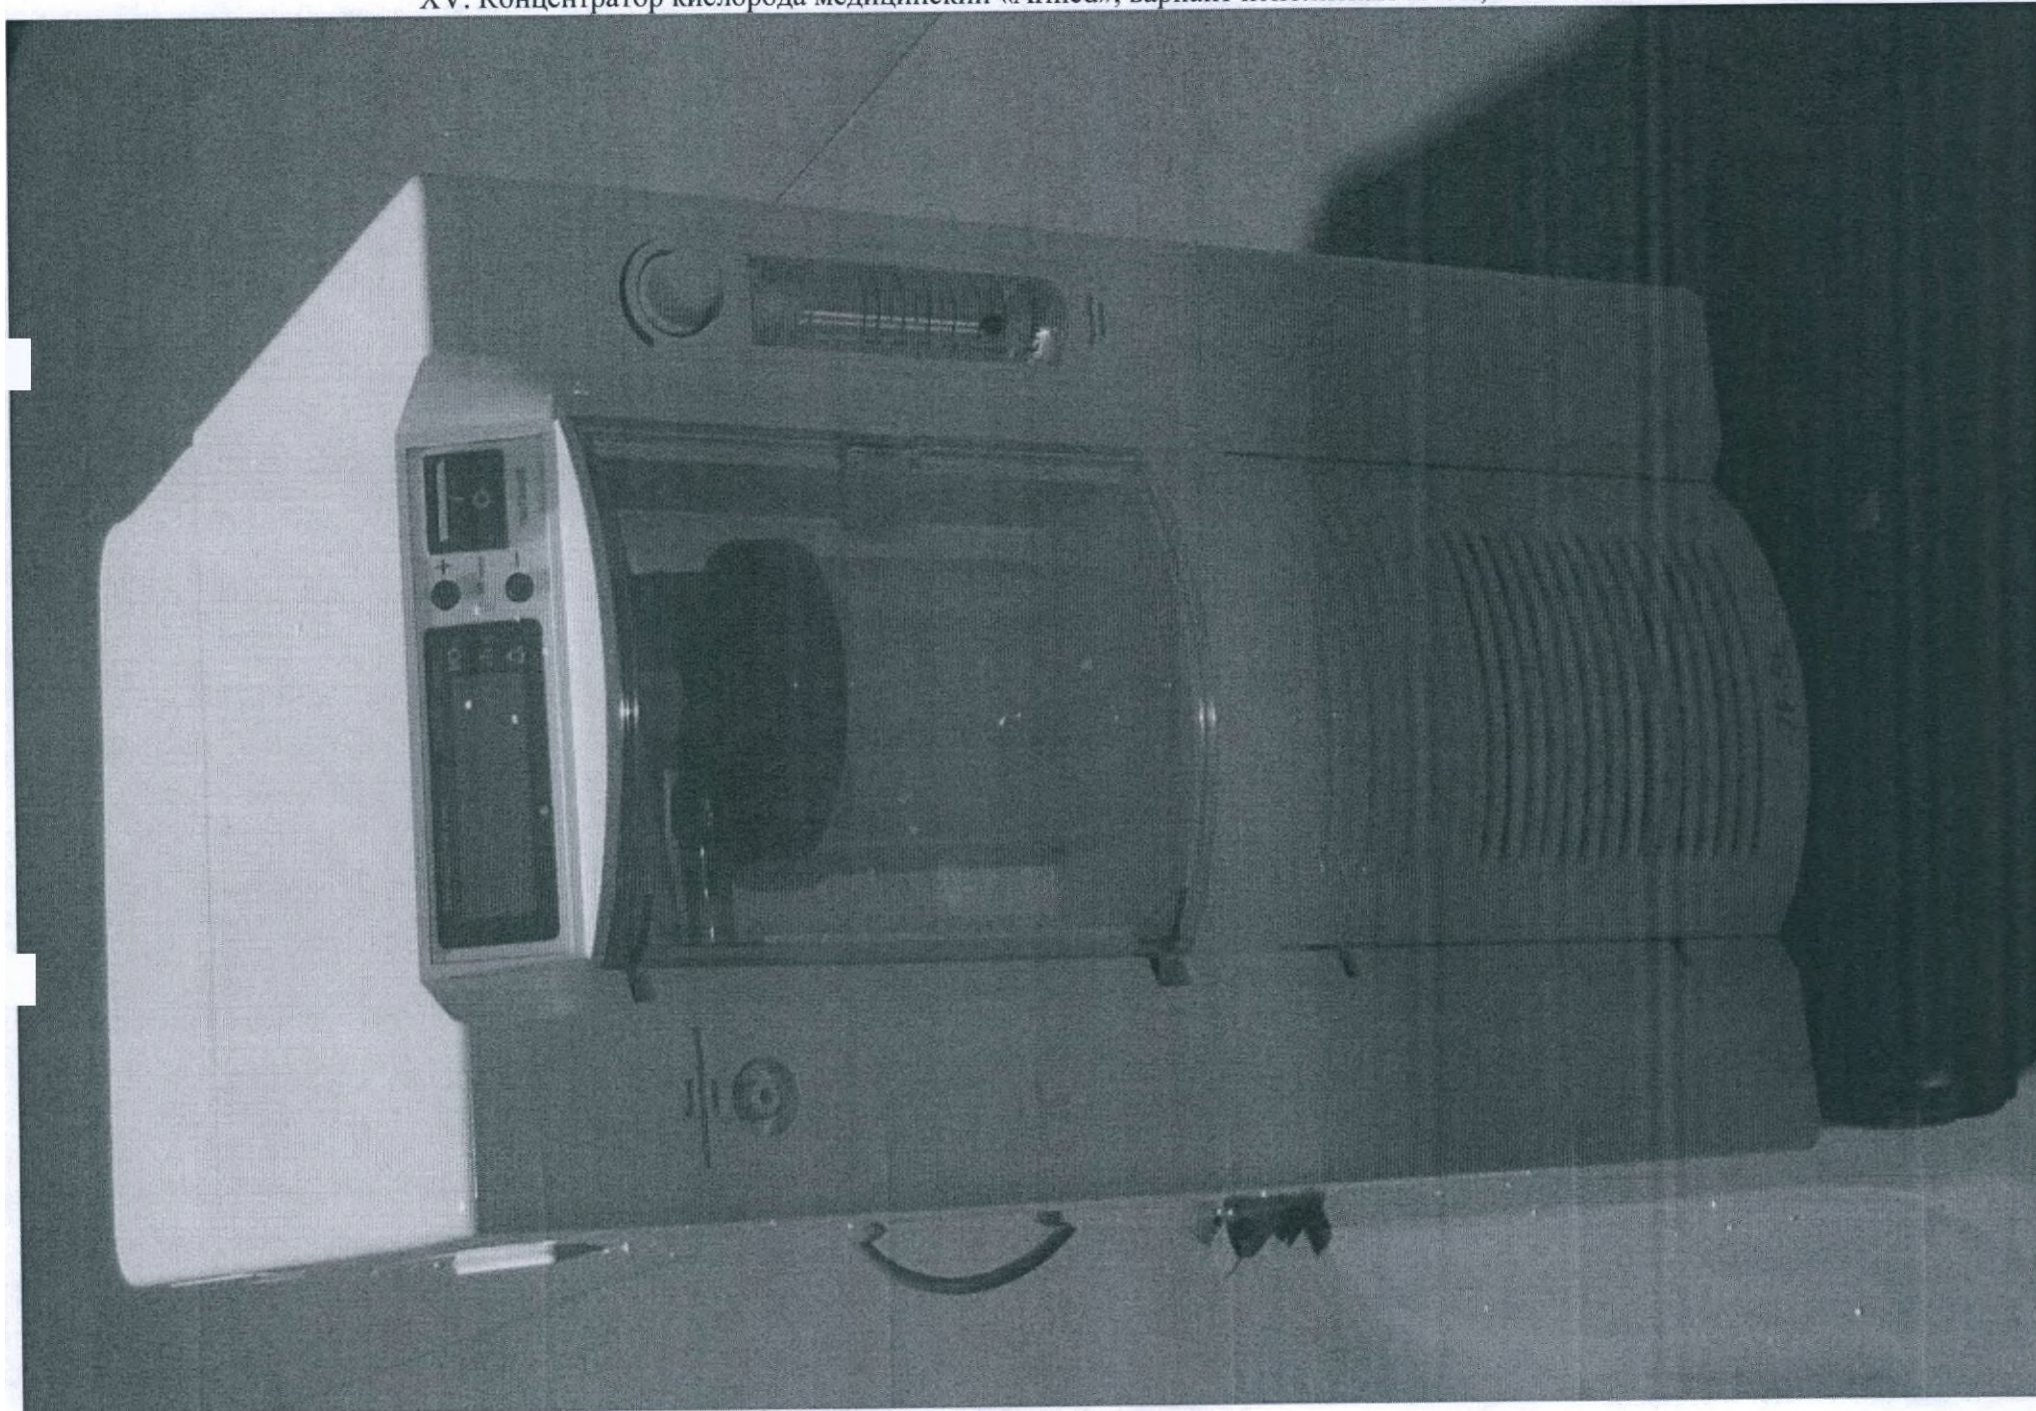


Рис. 89 – Концентратор кислорода

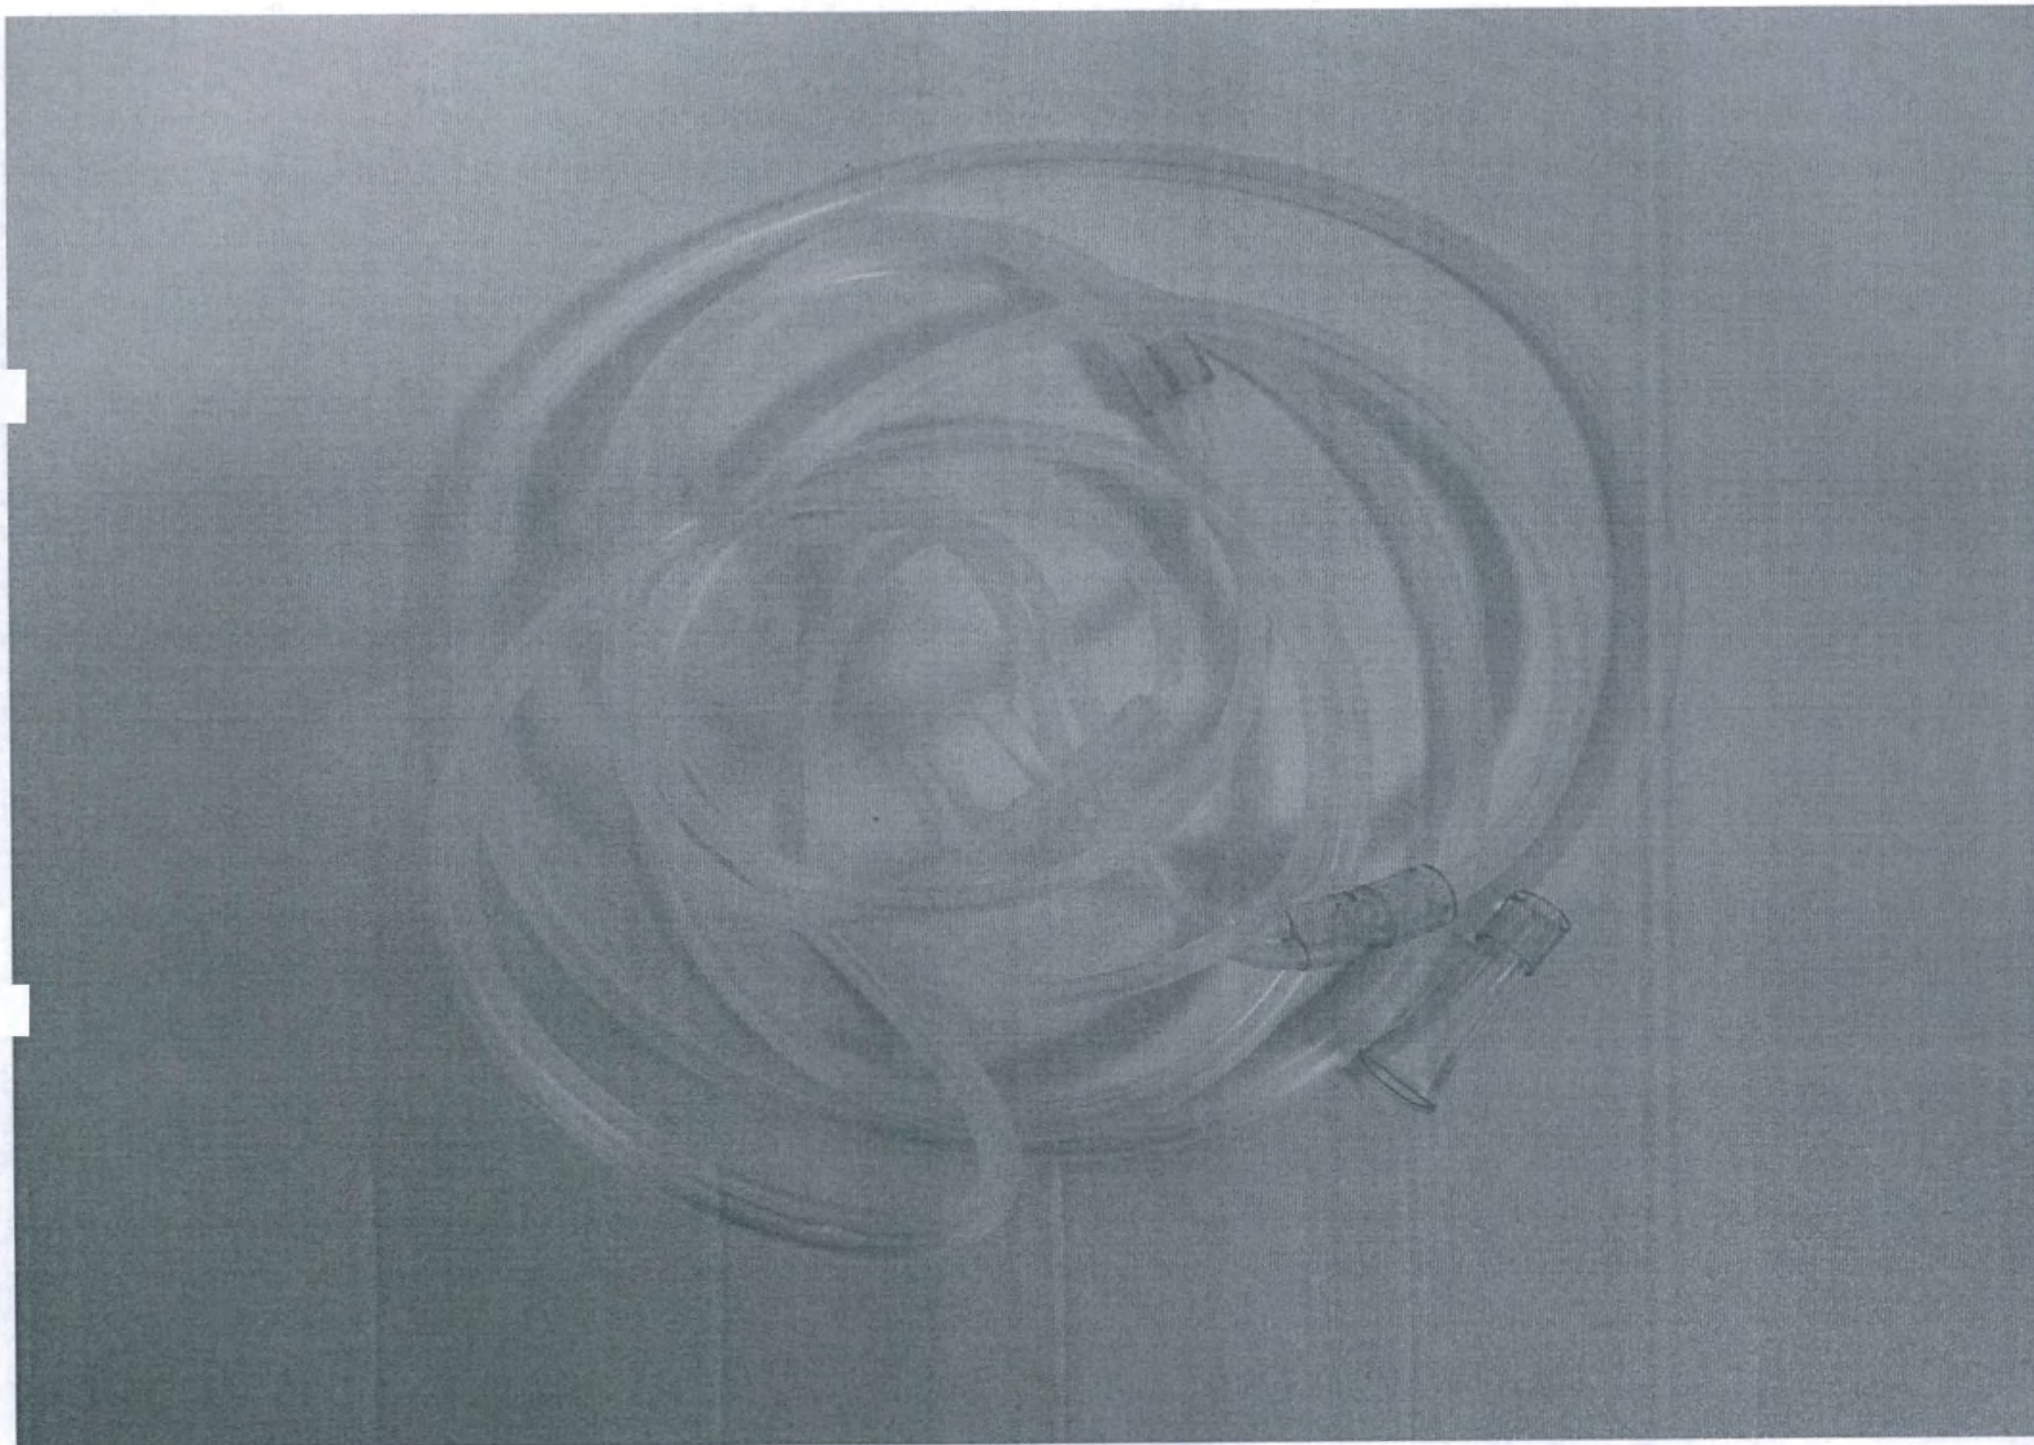


Рис. 90 – Канюля назальная малая

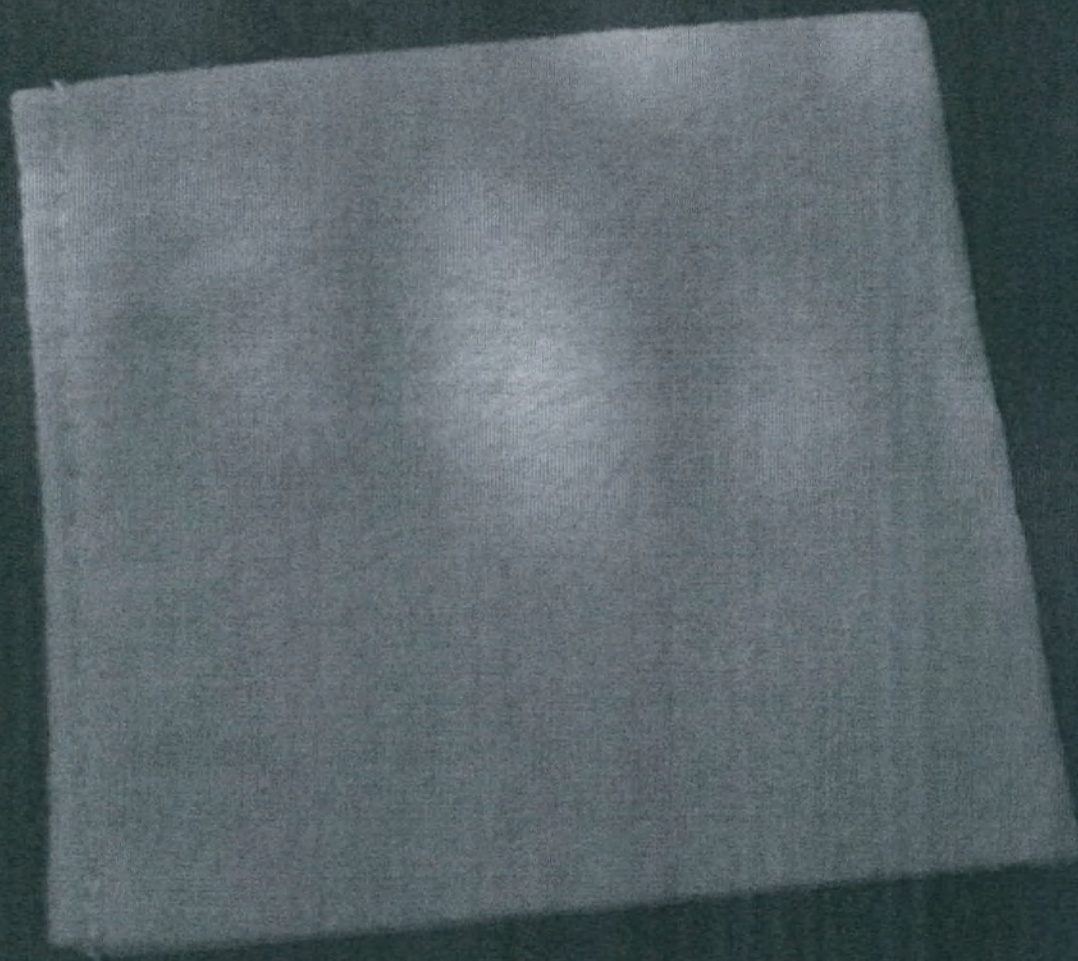


Рис. 91 – Фильтр тонкой очистки

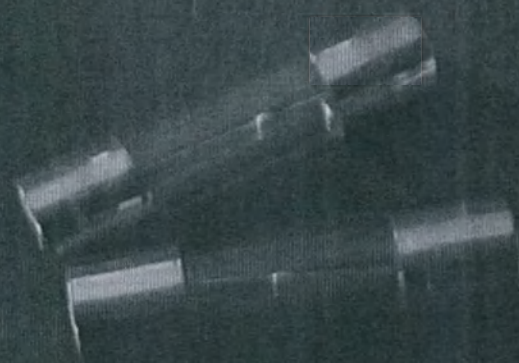


Рис. 92 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

XVI. Концентратор кислорода медицинский «Armed», вариант исполнения 7F-5EW, в составе:

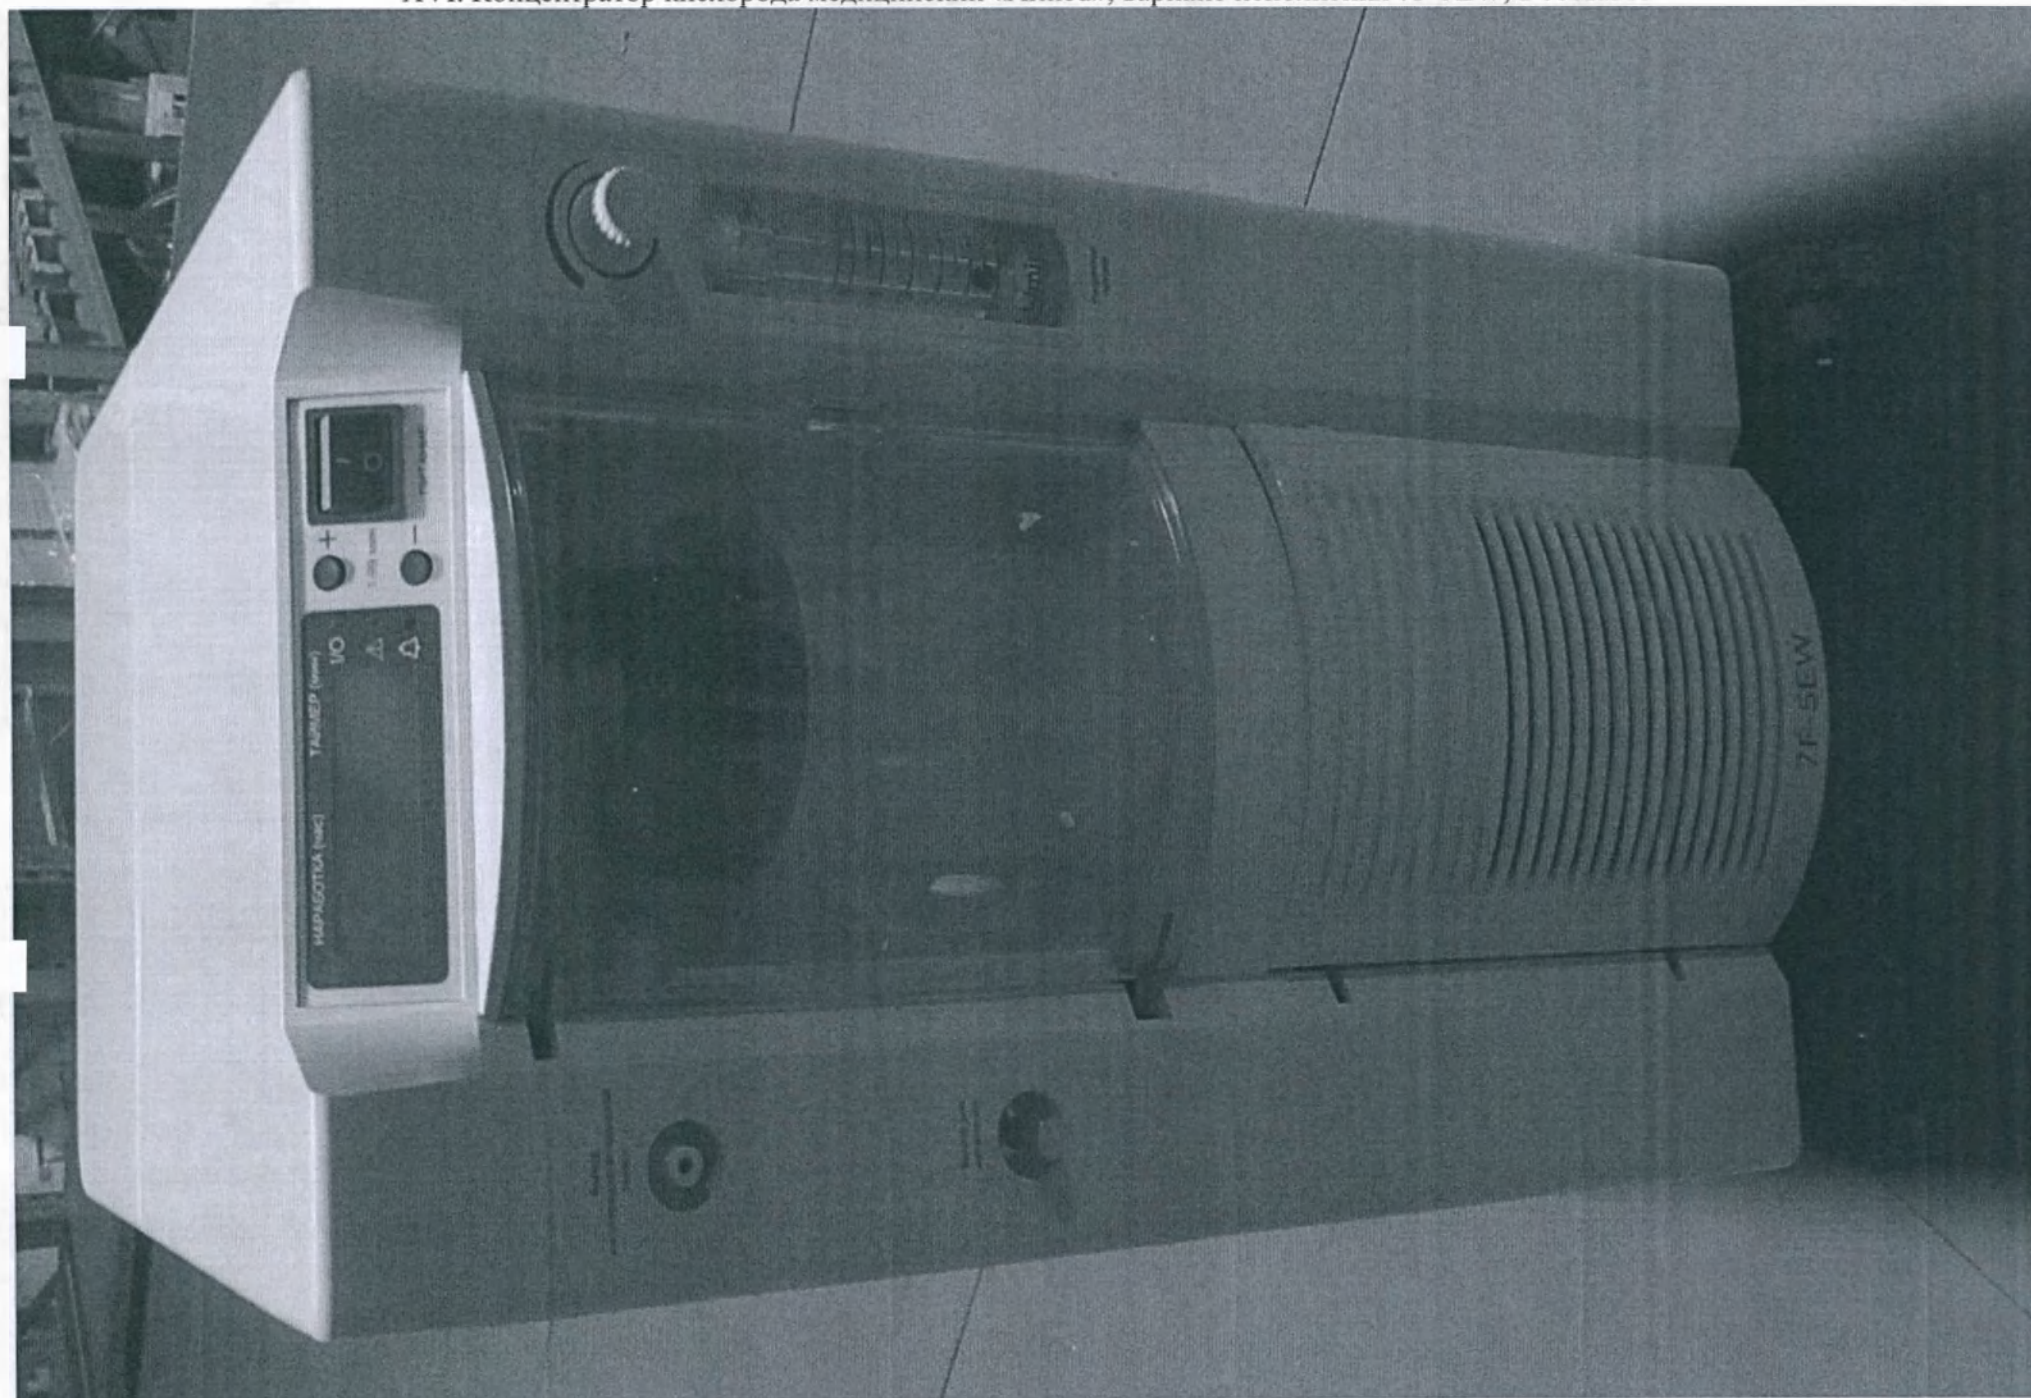


Рис. 93 – Концентратор кислорода

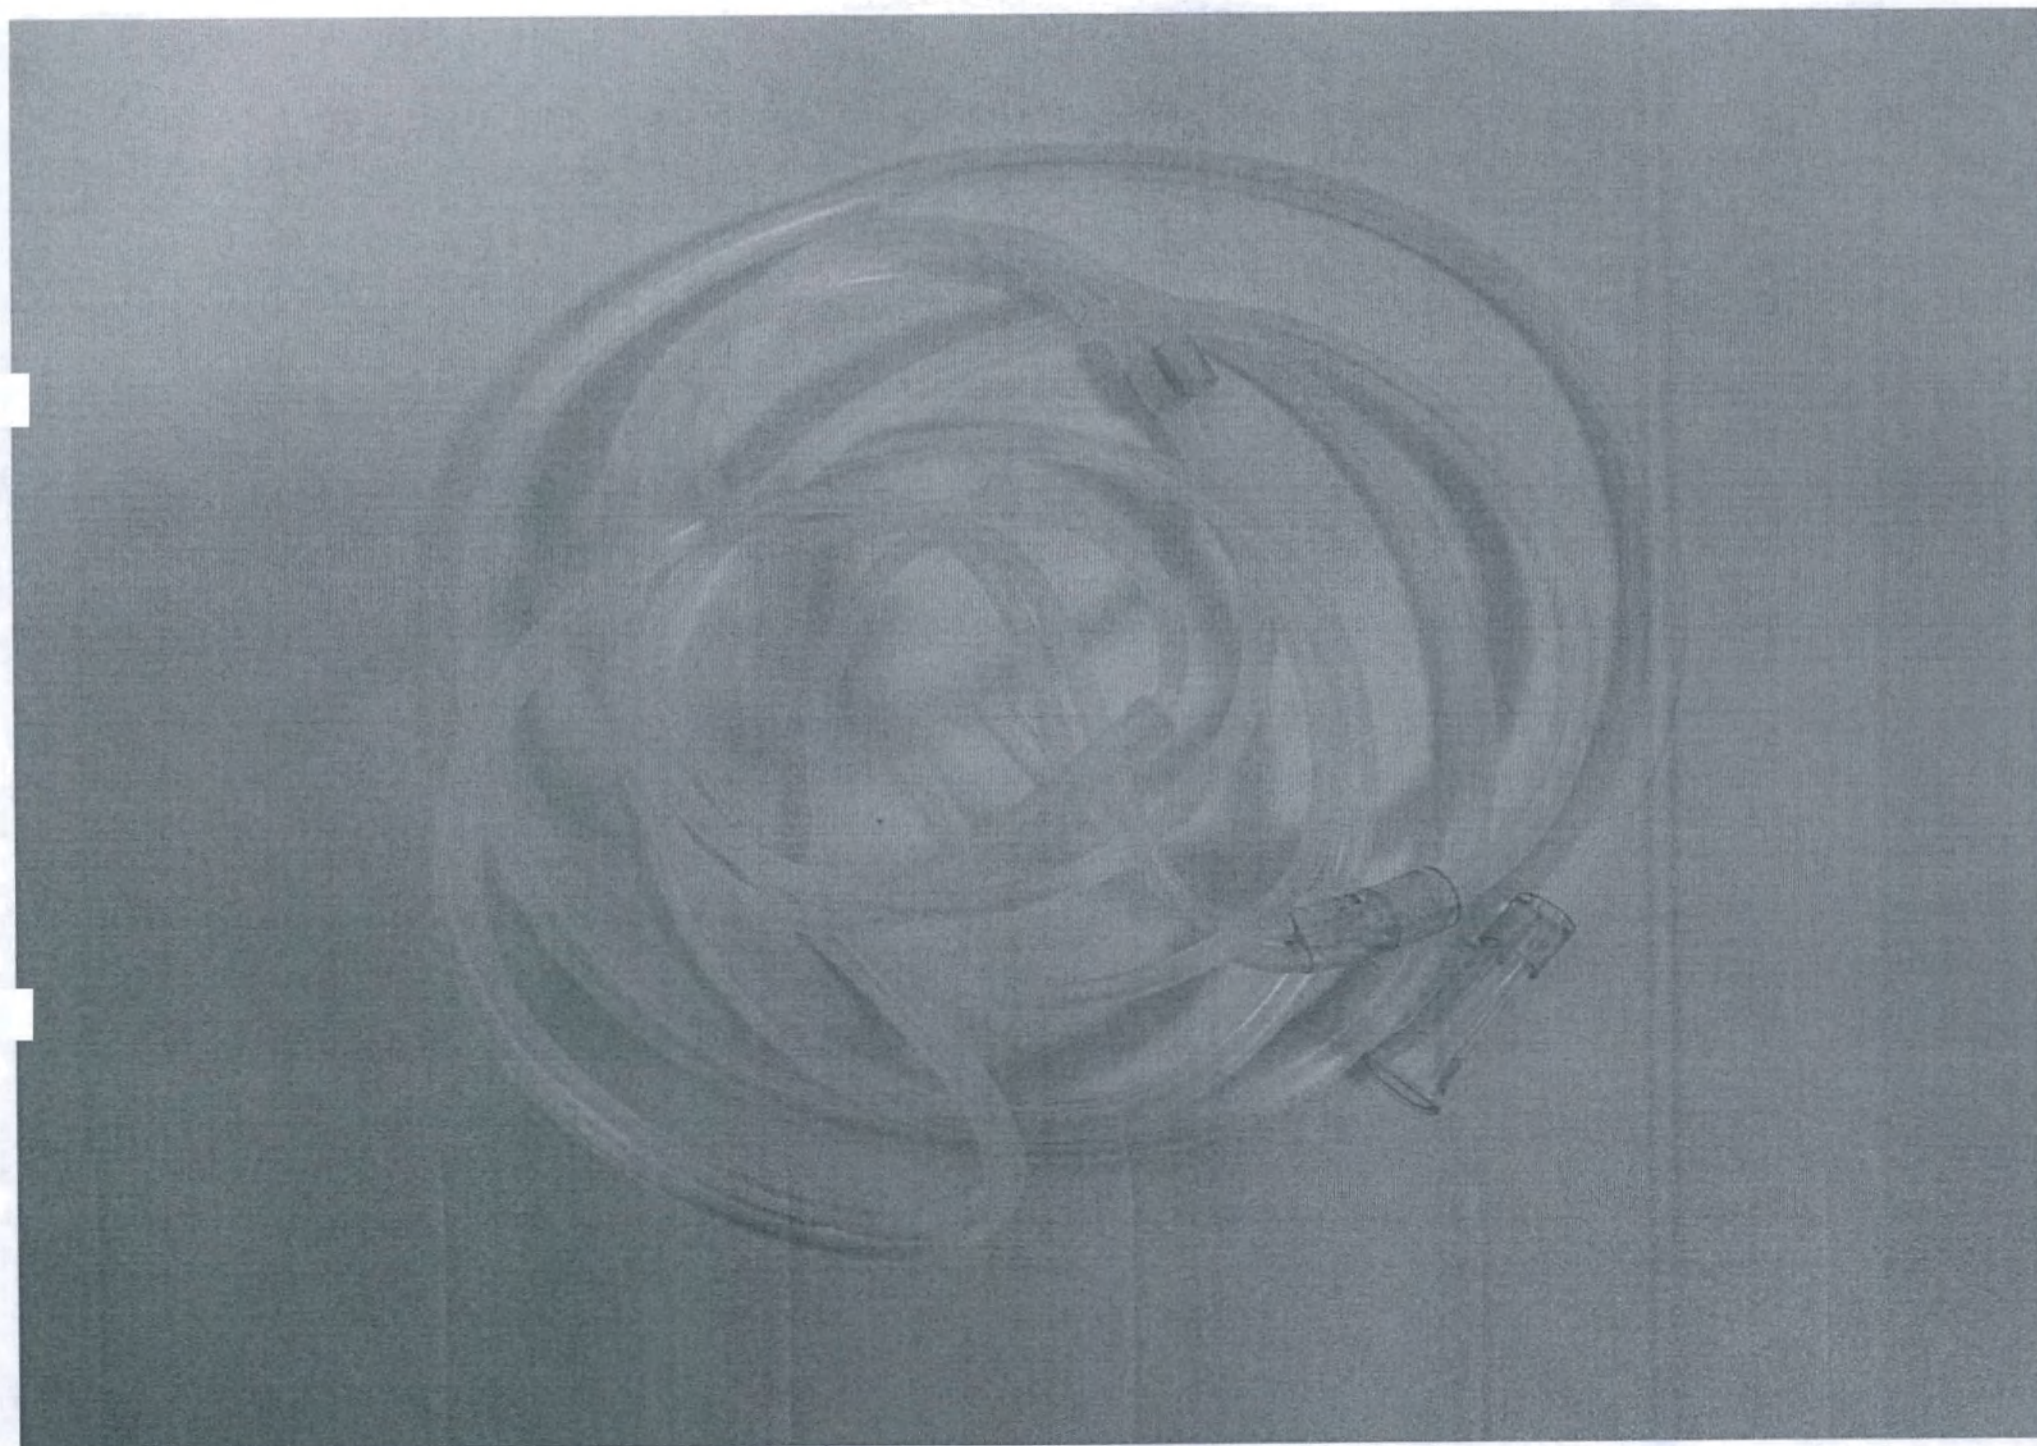


Рис. 94 – Канюля назальная малая

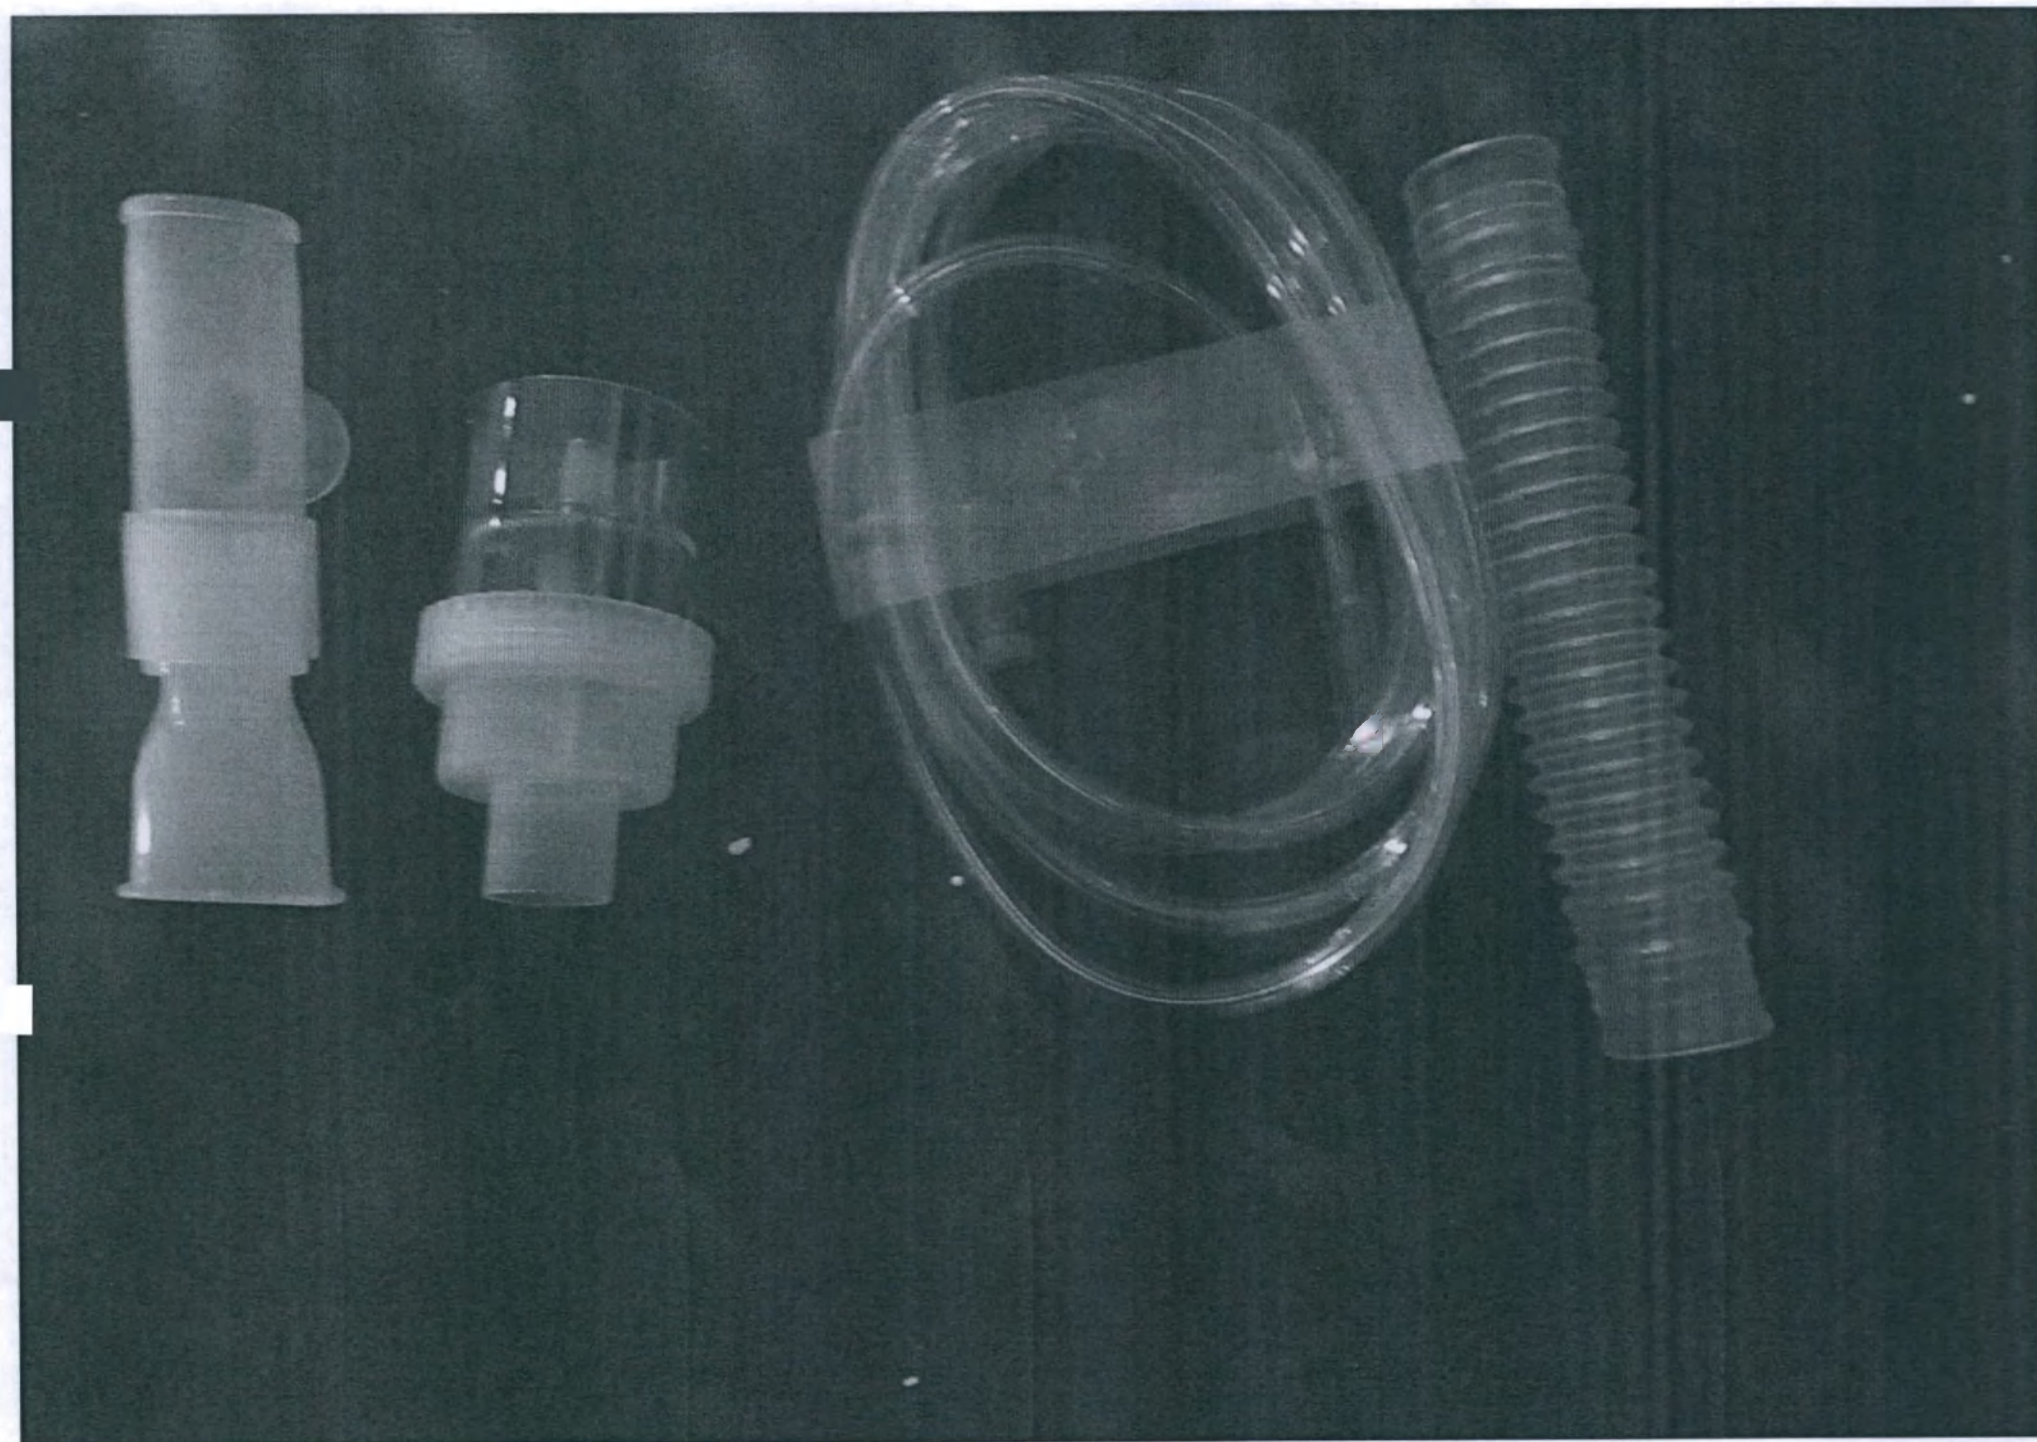


Рис. 95 – Комплект для ингаляции (тип II)

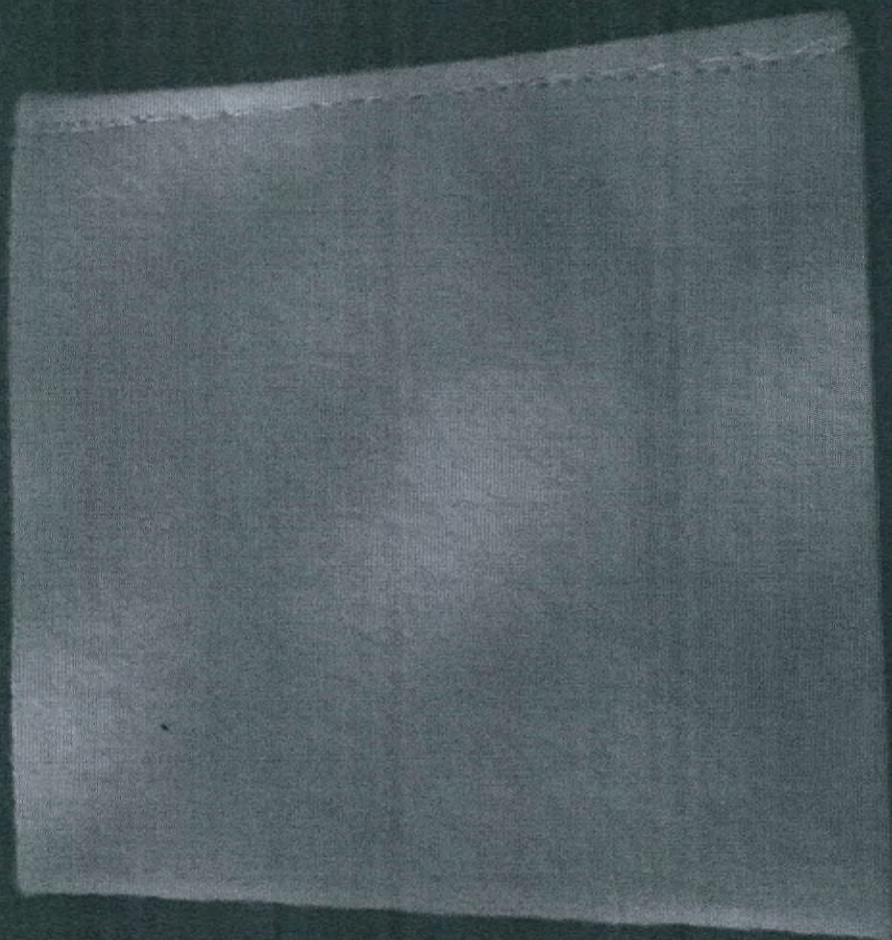


Рис. 96 – Фильтр тонкой очистки

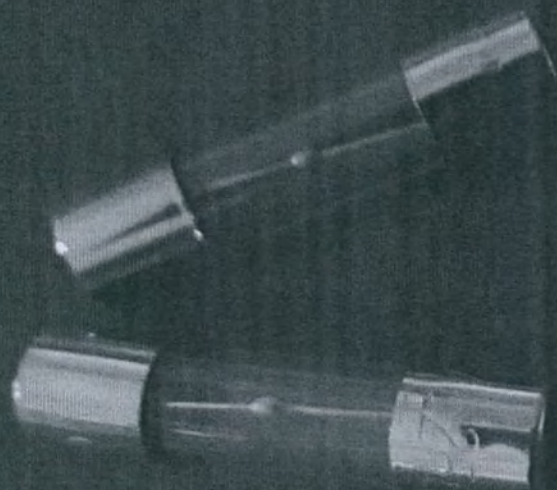


Рис. 97 – Предохранитель плавкий RT5A (2 шт.)

Снимите (извлеките)
крышку.

Тщательно просушите
фильтры, прежде чем
обратно
устанавливать их.

Рис. 98 – Макет этикетки на блоке фильтров тонкой очистки (только для 7F-3B, 7F-3W (5L), 7F-3CW, 7F-5B, 7F-5BW, 7F-5C, 7F-5CW, 7F-5E, 7F-5EW)



Потяните вверх,
чтобы открыть

Перед применением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

-  Запрещается курить вблизи концентратора. Не используйте масло или горюче-смазочные материалы. Не располагайте прибор вблизи источников огня и интенсивного тепла, легковоспламеняющихся предметов.
-  Не открывайте корпус прибора, подключенного к электрической сети. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности.
-  Скорость потока кислородно-воздушной смеси, режим и длительность терапии назначает врач.
-  Для защиты прибора от перепадов напряжения сети рекомендуется подключить стабилизатор напряжения.
-  В случае отключения электричества во избежание прекращения подачи кислородно-воздушной смеси пользователю необходимо иметь резервный источник кислорода.
-  Концентратор кислорода является дополнительным источником кислородно-воздушной смеси, а не жизнеобеспечивающим прибором.



Концентратор кислорода медицинский «Armed» YU360

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China

Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд., Юньянг Индастриал Парк, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, 212310, Китай

Импортер: ООО «ОПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

Номинальная концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси (при потоке 2 л/мин): 41-28% $\pm$ 5%

Потребляемая мощность: 150 ВА $\pm$ 10%

Напряжение: 230 В $\pm$ 10% **Частота:** 50/60 Гц $\pm$ 2%

Дата выпуска:

Заводской номер:



Концентратор кислорода медицинский «Armed» 7F-5EW

РУ № _____ ОТ _____ Г.

Производитель: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yuyang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China

Джиангсу Юю Медикал Эквипмент Энд Сапплай Ко., Лтд., Юньян Индастриал Парк, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, 212310, Китай

Импортер: ООО «ОПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

Номинальная концентрация кислорода в кислородно-воздушной смеси (при потоке 2 л/мин): 95,5-87,0% $\pm$ 3%

Потребляемая мощность: 500 ВА $\pm$ 10%


Напряжение: 230 В $\pm$ 10% **Частота:** 50/60 Гц $\pm$ 2%

Дата выпуска:

Заводской номер:




www.armed.ru

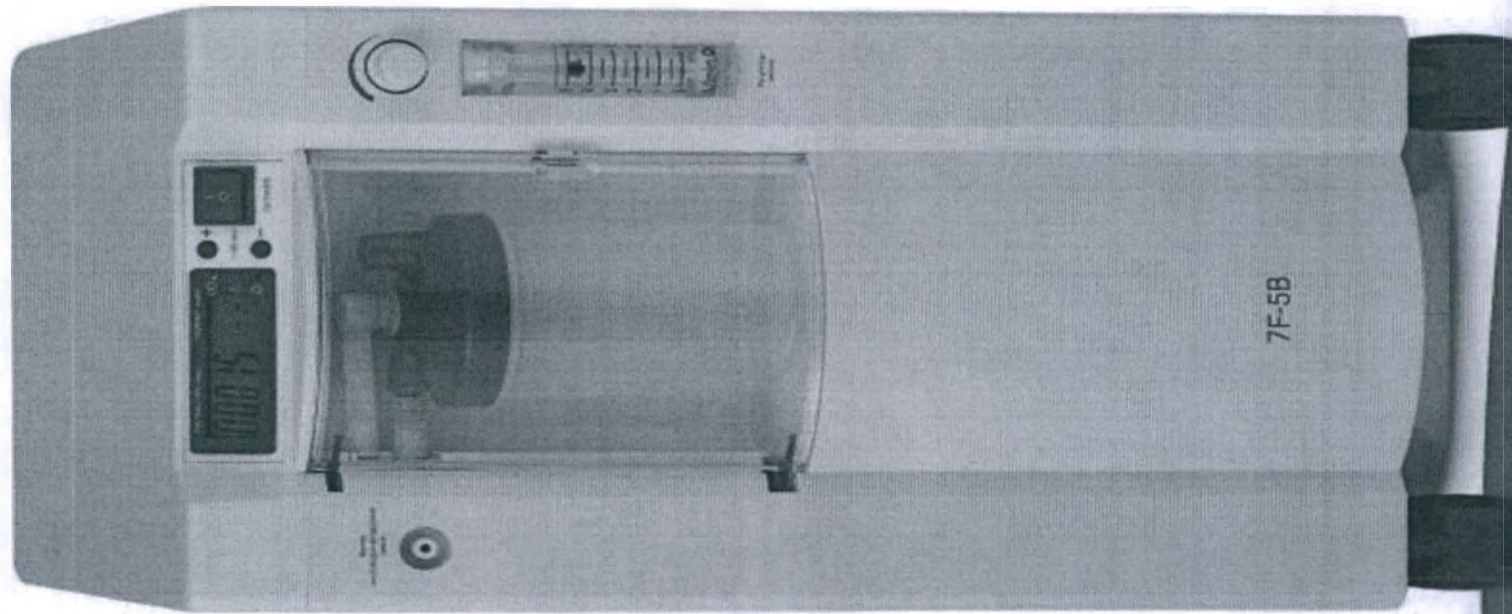

Концентратор кислорода
медицинский «Armed» **7F-5B**

Рис. 103 – Макет упаковки на примере варианта исполнения 7F-5B (вид спереди и сзади)

7F-5B Концентратор кислорода медицинский «Armed»

		
Гарантия 3 года	Высокая производительность до 5 л/мин	Срок службы 7 лет

Гарантийный срок хранения: 48 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 42 месяцев со дня изготовления.

Срок службы концентратора: не менее 7 лет

Дата упаковки:

Произведено: Jiangsu Yulu Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yuluang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China
Дистрибутор: Юло Медикал Эквипмент Энд Салпайз Ко., Лтд., Юньанг Индустриал Парк, Даньянг Сити, Дзянсу Провинс, 212310, Китай
Импортер: ООО «СПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. 1

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ от _____ г.

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РУКОВОДСТВО.**



Транспортировка концентратора кислорода производится только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении

Рис. 104 – Макет упаковки на примере варианта исполнения 7F-5B (вид сбоку 1)

7F-5B Концентратор кислорода медицинский «Agmed»



Выход кислородно-воздушной смеси



Удобная панель управления



Расходомер кислородно-воздушной смеси

Гарантийный срок хранения: 48 месяцев.
Гарантийный срок эксплуатации: 36 месяцев со дня отгрузки потребителю или со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 42 месяцев со дня изготовления.
Срок службы концентратора: не менее 7 лет
Дата упаковывания:

Произведено: Jiangsu Yulu Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yuluang Industrial Park, Danyang City, Jiangsu Province, 212310, China
Дистрибутор: Юло Медикал Эквипмент Энд Сатплай Ко., Лтд, Юньланг Индустриал Парк, Даянцзинг Сити, Дзянсу Провинция, 212310, Китай
Импортер: ООО «СПОРА», Россия, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, ул. Краснообск, ул. Саянская, д. 5, пом. 1

Предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) терапии пациентам с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Применяется в условиях различных медицинских учреждений, а также для индивидуального использования, как в стационаре, так и в домашних условиях.

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ от _____ г.

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
И ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ РУКОВОДСТВО.**



Транспортировка концентратора кислорода производится только в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении

Рис. 105 – Макет упаковки на примере варианта исполнения 7F-5B (вид сбоку 2)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 106
(сто шесть) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ОПОРА»
ЖУКОВ Р. С.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a few strokes.