

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор осаждающих реагентов для экстракции циклоспорина из образцов (цельная кровь человека, контроли, калибраторы) при его количественном определении иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i «Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Cyclosporine

Whole Blood Precipitation Reagent Kit




WHOLE BLOOD SOLUBILIZATION REAGENT

1 x 12.3 mL

WHOLE BLOOD PRECIPITATION REAGENT

1 x 45.0 mL



CONTAINS: METHANOL



Abbott Laboratories
Diagnostics Division
Abbott Park, IL 60064 USA

EC REP

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD




PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
940 Crossroads Blvd.
Seguin, TX 78155
USA


PRODUCT OF USA


Фотографическое изображение вида упаковки **Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)**


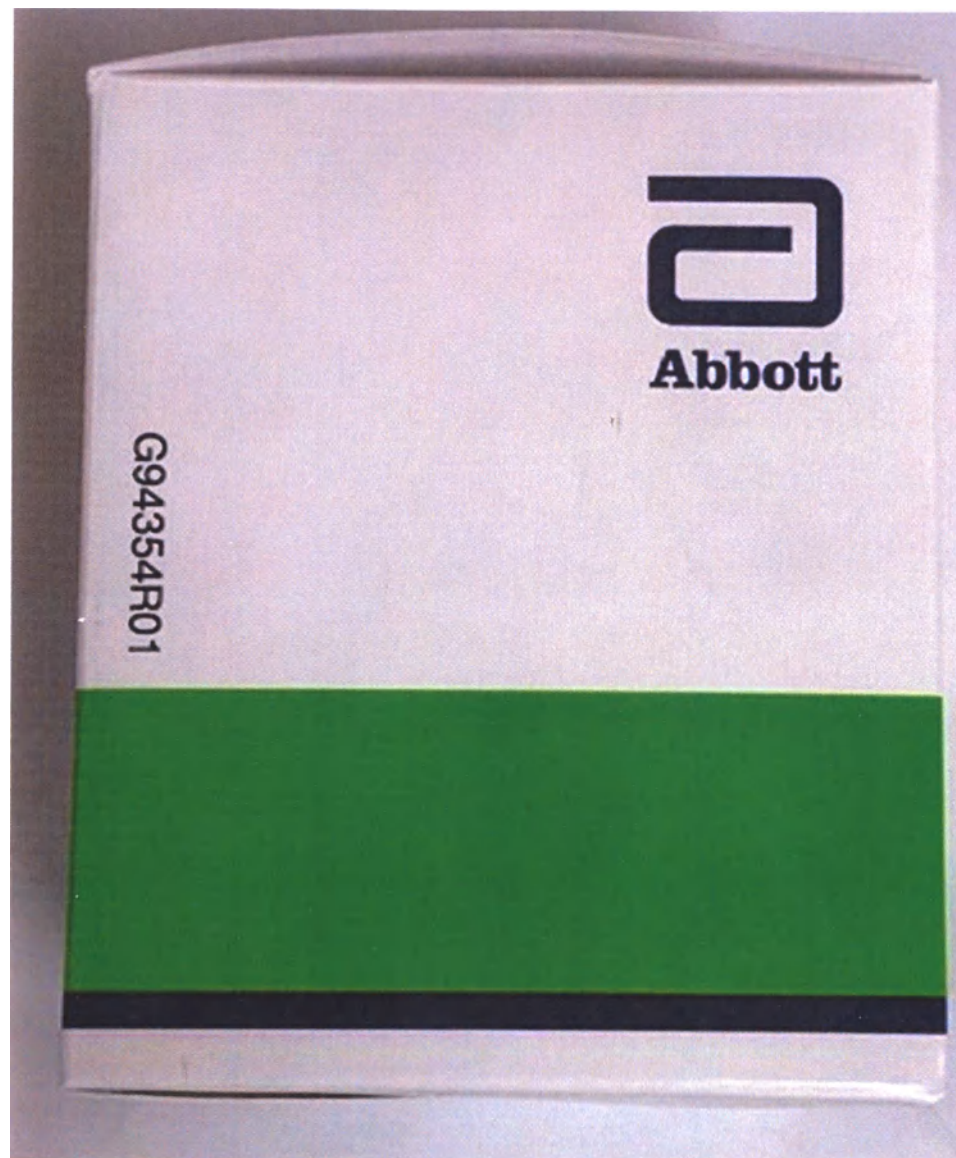



Фотографическое изображение вида упаковки Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)



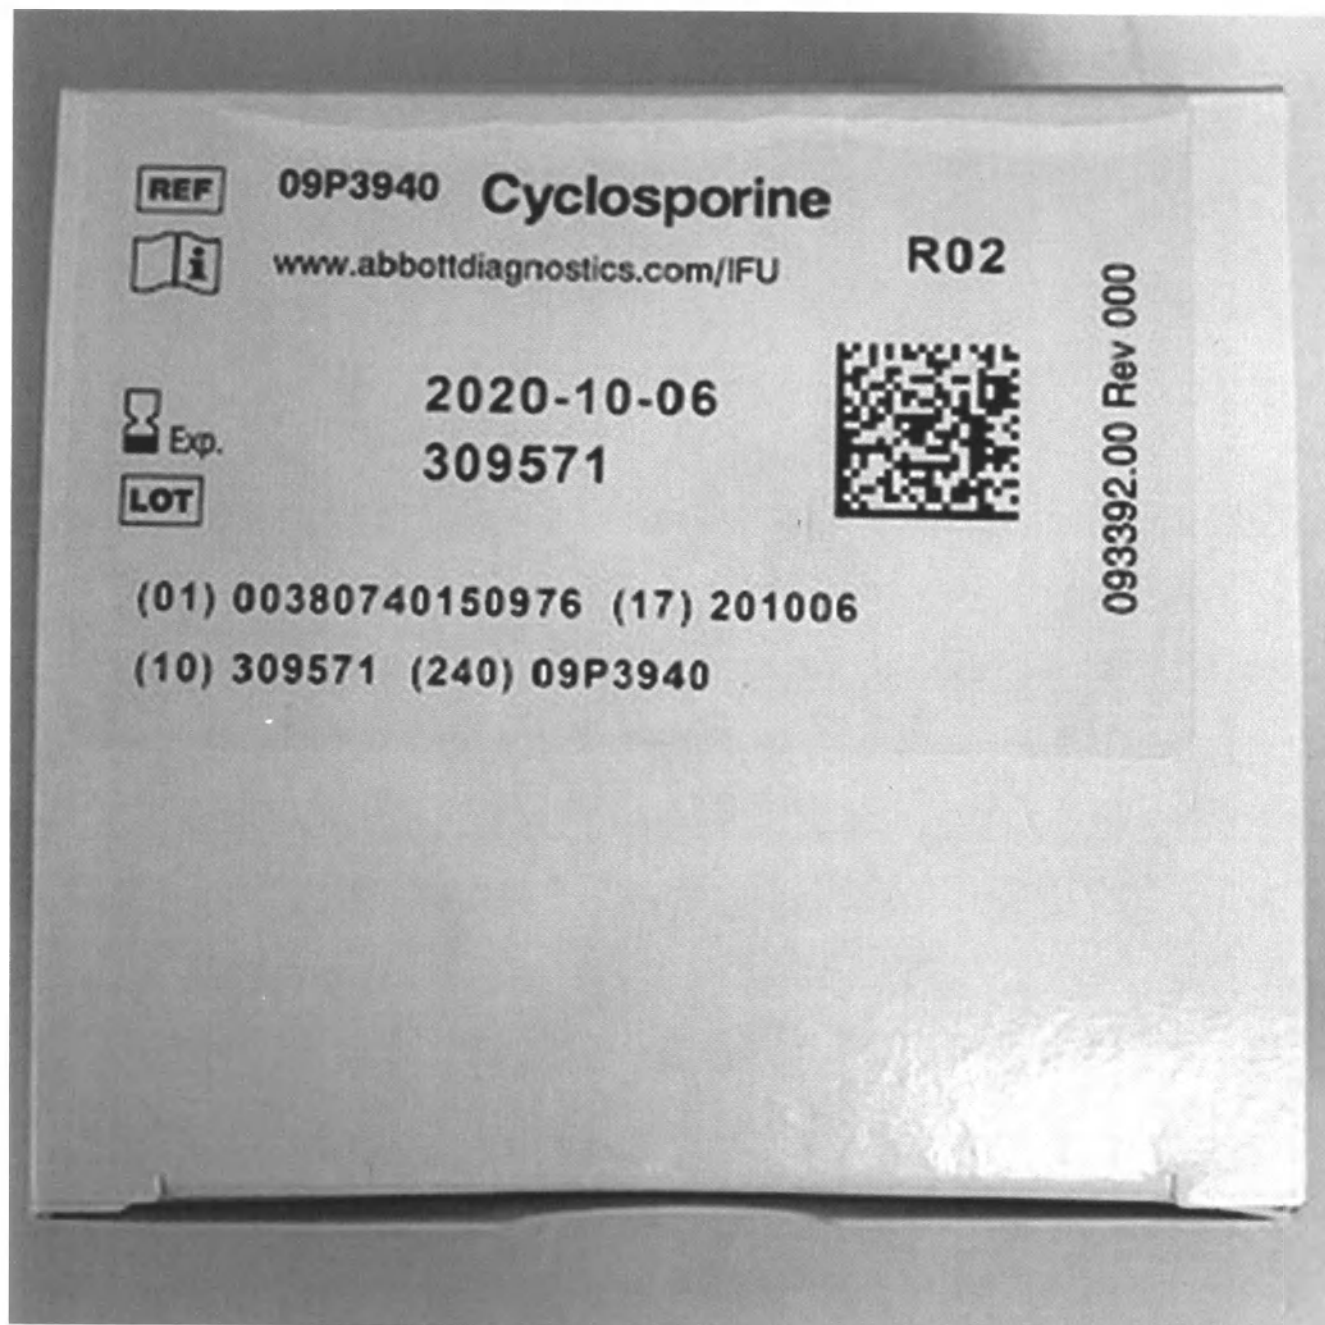

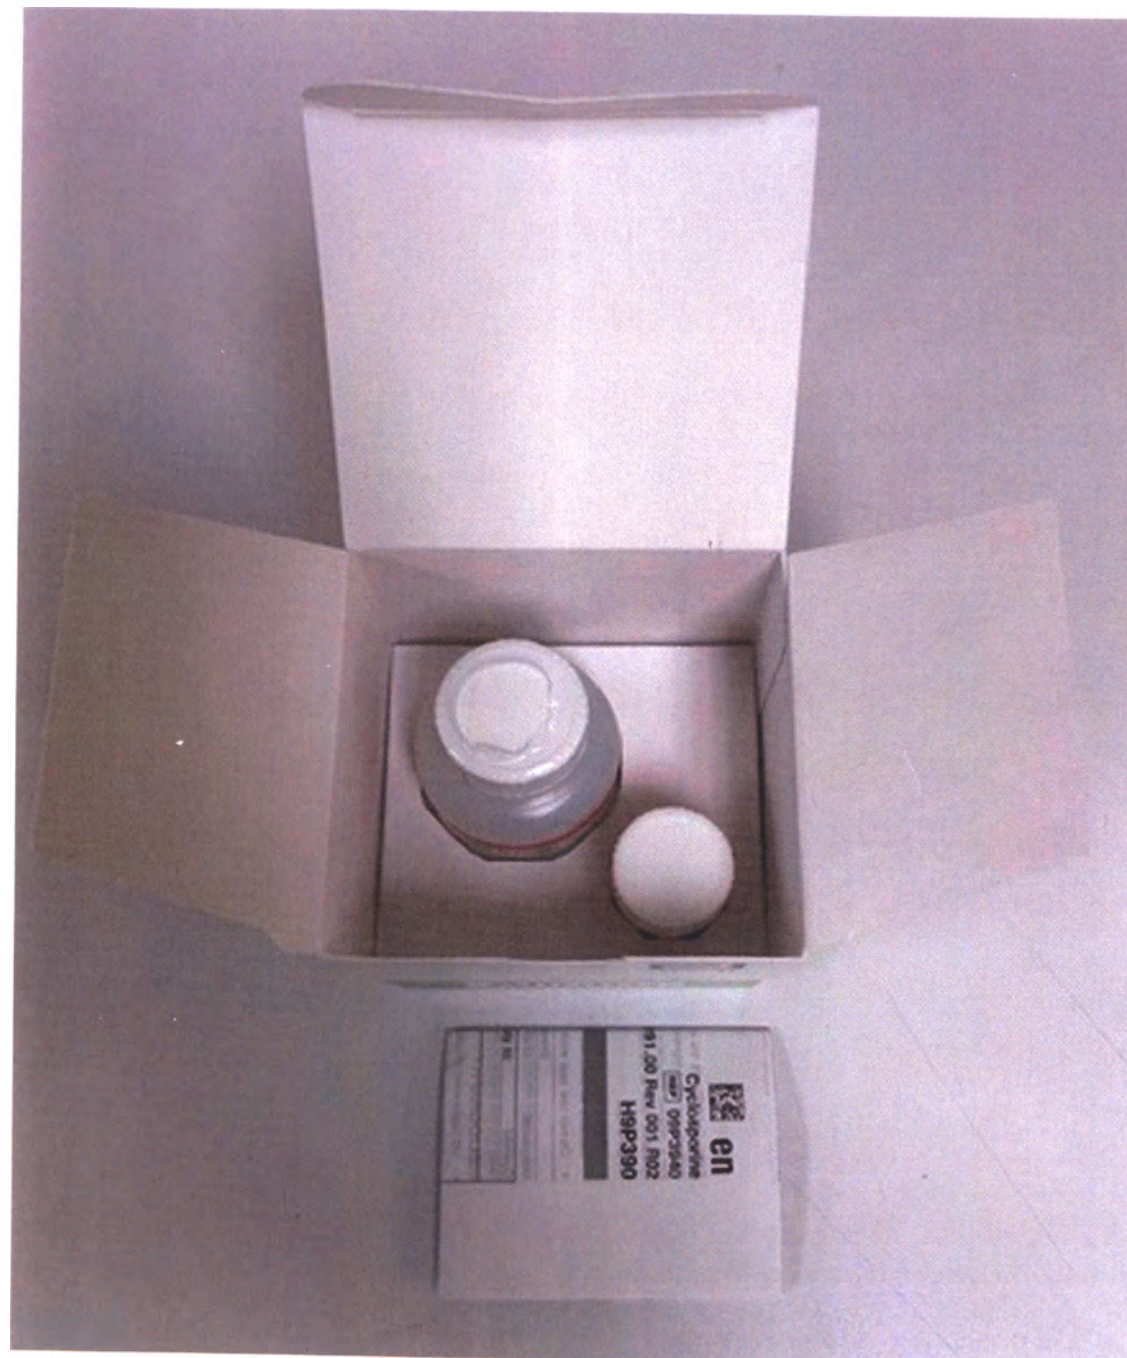

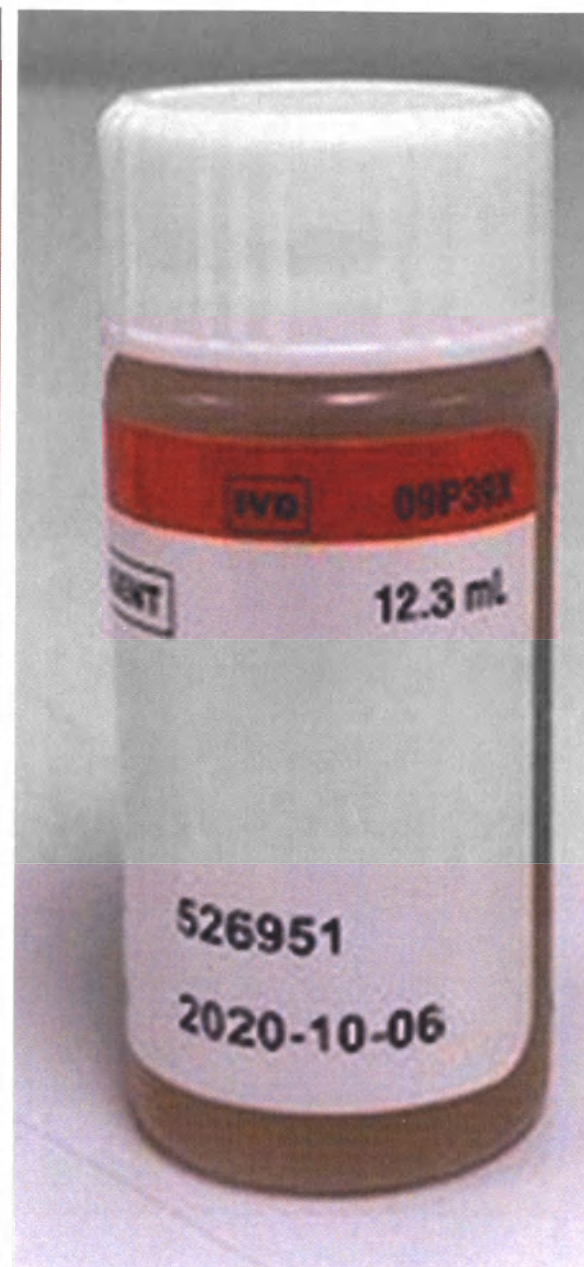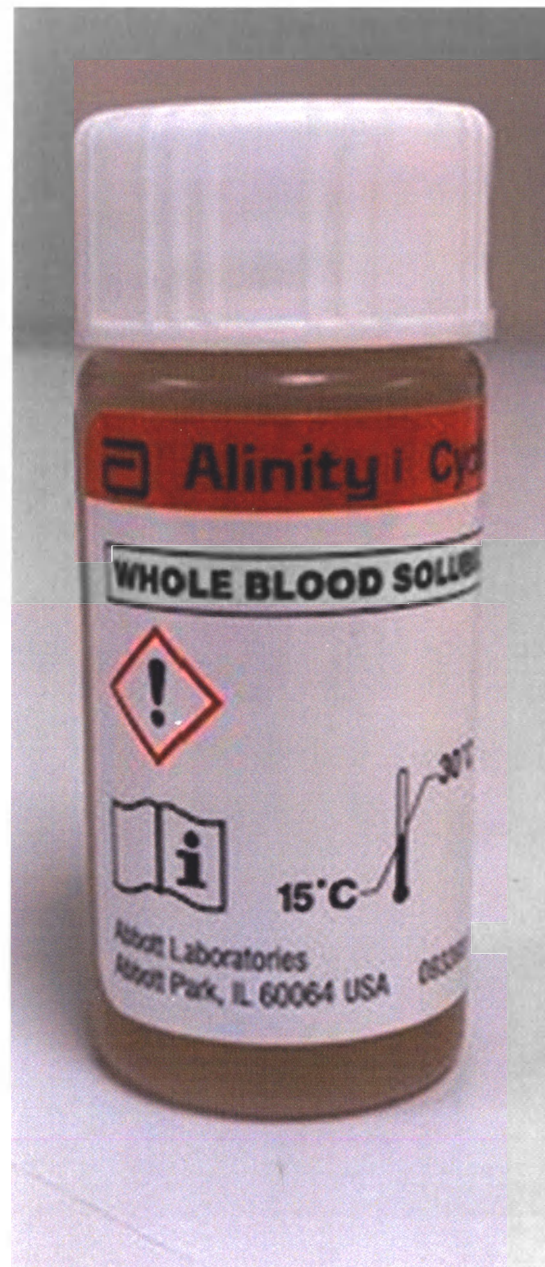

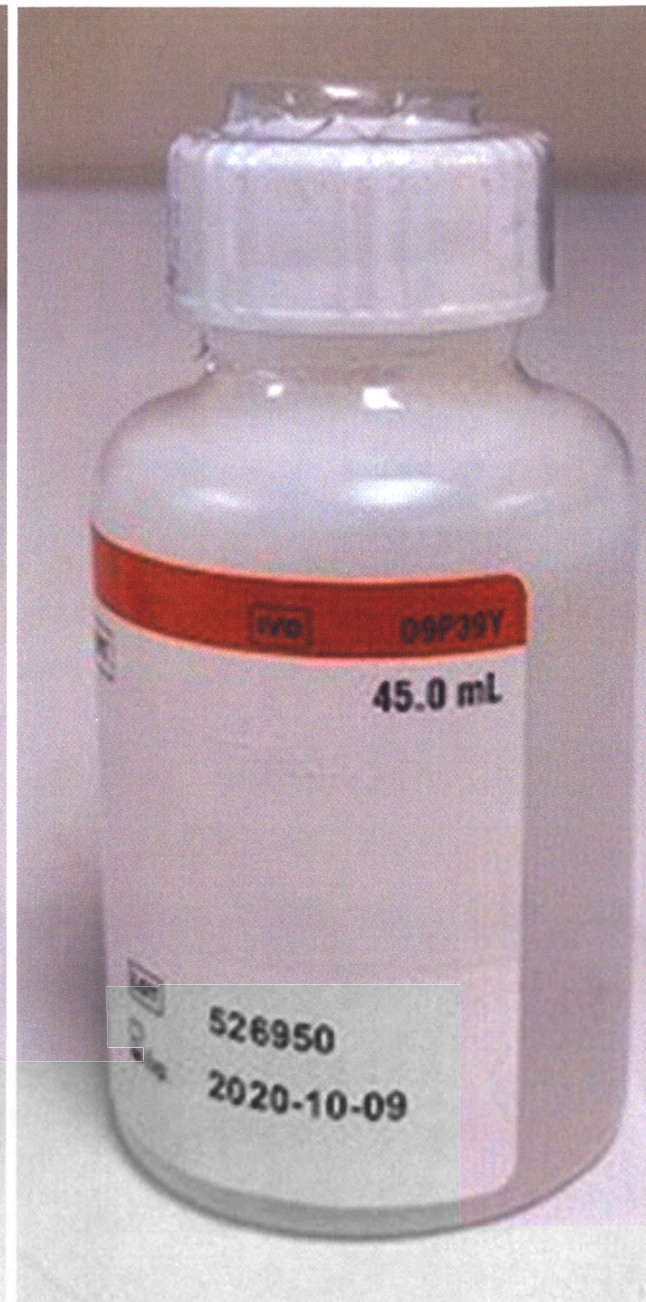

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор осаждающих реагентов для экстракции циклоспорина из образцов (цельная кровь человека, контроли, калибраторы) при его количественном определении иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i «Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)»

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood
Precipitation Reagent Kit)



REF

09P3940

IVD



Набор осаждающих реагентов для экстракции циклоспорина из образцов (цельная кровь человека, контроли, калибраторы) при его количественном определении иммунохемилюминесцентным методом на иммунохимических анализаторах Alinity i «**Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)**»


в составе: реагент солюбилизующий (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Solubilization Reagent) - 1 флакон х 12,3 мл.; Реагент осаждающий (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent) - 1 флакон х 45,0 мл.; Инструкция по применению/Производитель: Abbott Laboratories Diagnostics Division, 100 Abbott Park Road, Abbot Park, IL 60064, USA /Место производства: Fujirebio Diagnostics, Inc., 940 Crossroads Blvd. Seguin, TX 78155, USA/ Страна происхождения: США/ РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения и знаки опасности указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)

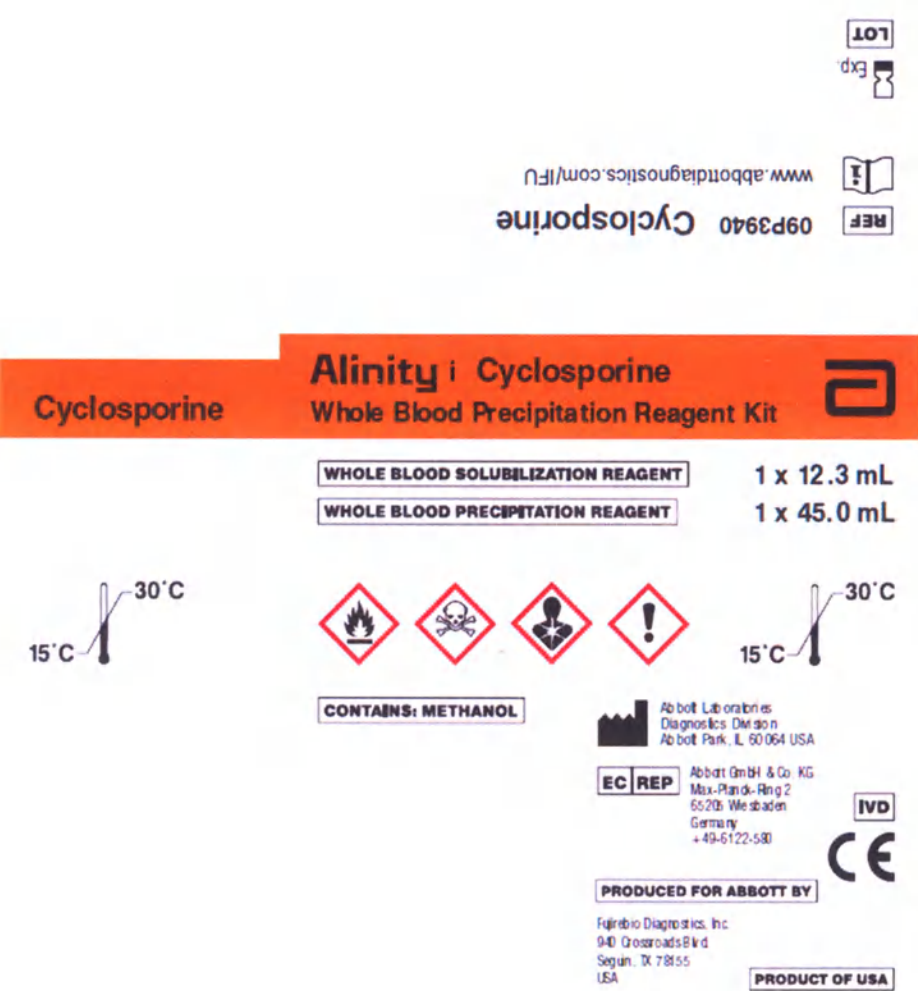

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Циклоспорин Цельная кровь Реагенты осаждающие (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit)

- Реагент солюбилизирующий (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Solubilization Reagent)

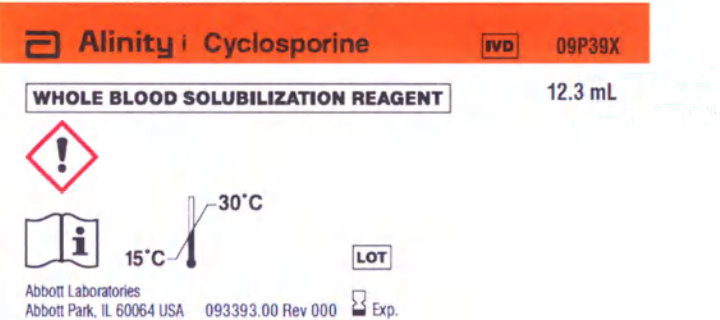

- Реагент осаждающий (Alinity i Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent)

Alinity i Cyclosporine **IVD** 09P39Y

WHOLE BLOOD PRECIPITATION REAGENT


45.0 mL



CONTAINS: METHANOL



Abbott Laboratories
Abbott Park, IL 60064 USA



LOT



093394.00 Rev 000

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

ЛИСТОВ

Подпись