



**БИОФАРМА  
ХОЛДИНГ**

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д.18, стр.33  
+7 (495) 741 49 90  
[www.collost.ru](http://www.collost.ru)

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ» для заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия неинфицированных раневых поверхностей» по ТУ 9393-001-56533116-2015



Инструкция по применению медицинского изделия

«Методика калибровки разлитых в ампулы гелей КОЛЛОСТ® для закаливания инфракрасным излучением»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Методика калибровки разлитых в ампулы гелей КОЛЛОСТ® для закаливания инфракрасным излучением. Назначение: калибровка гелей КОЛЛОСТ® для закаливания инфракрасным излучением. Калибровка гелей КОЛЛОСТ® для закаливания инфракрасным излучением. Калибровка гелей КОЛЛОСТ® для закаливания инфракрасным излучением.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Описание изделия

«КОЛЛОСТ®» гели - это жидкие кристаллы, состоящие из органических соединений, обладающих способностью к самоорганизации в упорядоченную структуру при нагревании.

2.2. Материал изделия

Материал изделия - это жидкие кристаллы, состоящие из органических соединений, обладающих способностью к самоорганизации в упорядоченную структуру при нагревании.

КОЛЛОСТ®

Гель 7% 0,8 мл

КОЛЛОСТ®

Гель 7% 0,8 мл

00082021  
12.06.2021  
12.06.2024

RU 9393-001-56533116-2015

STERILE R

КОЛЛОСТ® Гель 7% 0,8 мл


00082021  
12.06.2021  
12.06.2024

КОЛЛОСТ® Гель 7% 0,8 мл


00082021  
12.06.2021  
12.06.2024


КОЛЛОСТ®

Гель

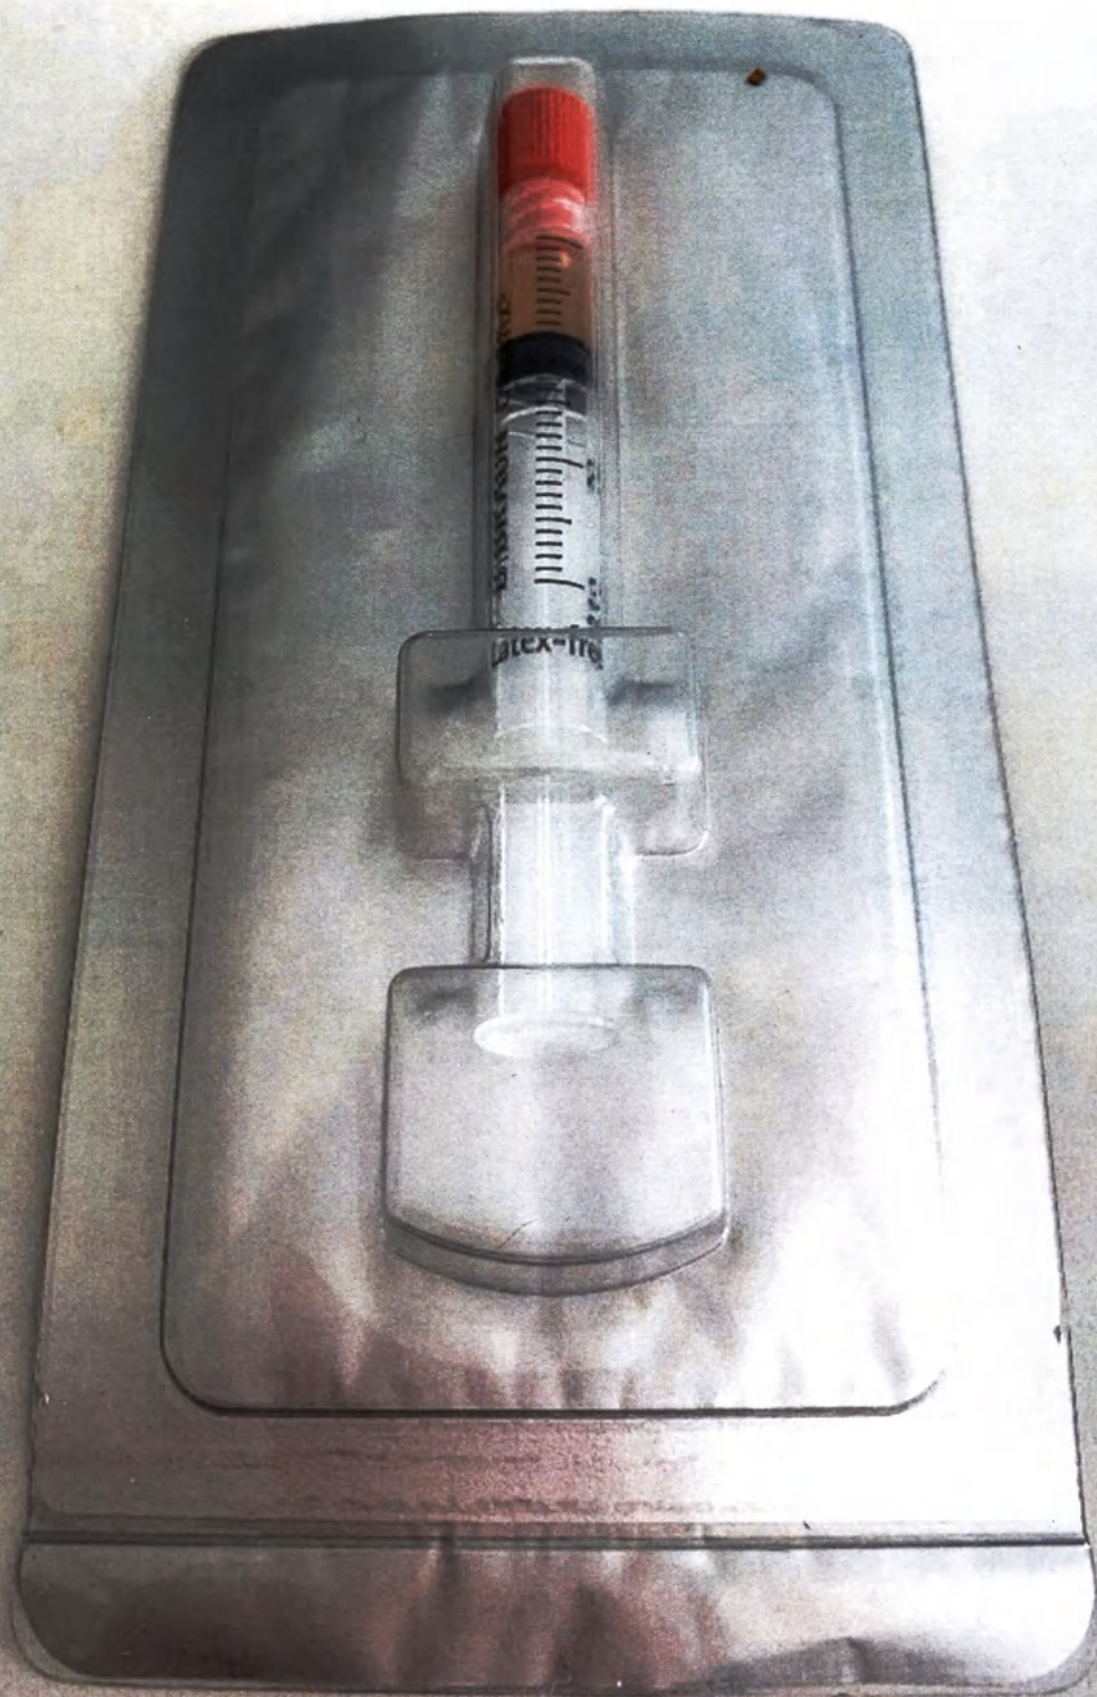

КОПЬЕ  
ГЛАВ

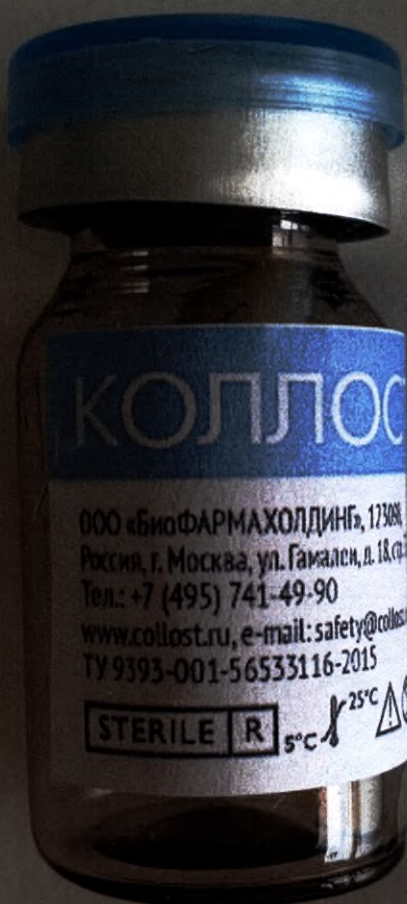

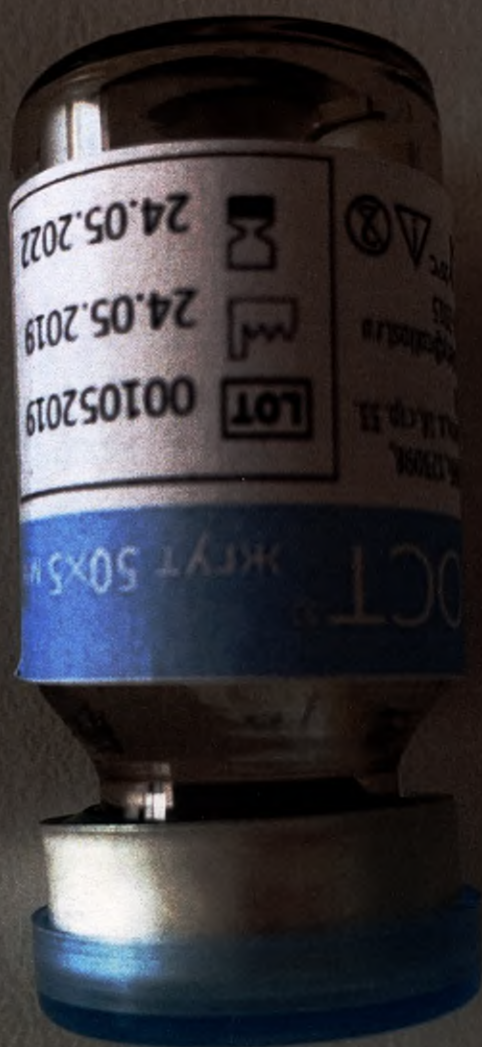



# ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

«Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия неинфицированных раневых поверхностей по ТУ 9393-001-56533116-2015» в исполнениях: мембры 15х15х0,1 мм / 30х20х0,1 мм / 60х50х1,5 мм / 100х60х1,5 мм / 100х20х0,7 мм / 120х20х0,7 мм, жгут 50х5 мм, шарик 8 мм; порошок – 0,2 г / 0,5 г / 1,0 г / 2,0 г / 10,0 г, гель 7 % – 0,8 см<sup>3</sup> / 2,0 см<sup>3</sup>.


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия неинфицированных раневых поверхностей» (далее по тексту – «КОЛЛОСТ®») применяется в травматологии, ортопедии, клинической, челюстно-лицевой, акушерской и общей гинекологии, стоматологии с целью заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия



|                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛЛОСТ жгут 50х5 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052019<br>24.05.2019<br>24.05.2022 | КОЛЛОСТ жгут 50х5 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052019<br>24.05.2019<br>24.05.2022 |
| КОЛЛОСТ жгут 50х5 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052019<br>24.05.2019<br>24.05.2022 | КОЛЛОСТ жгут 50х5 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052019<br>24.05.2019<br>24.05.2022 |



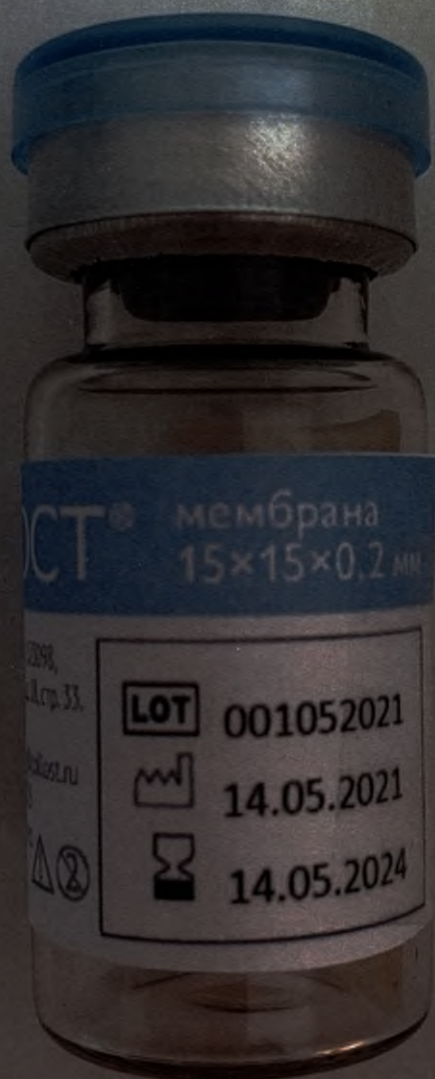

CT® мембрана  
15x15x0,2 мм

LOT 001052021

14.05.2021


14.05.2024

[illegible]

Медицинское изделие «Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, который склеивает и покрывает неинфицированных раневых поверхностей» (далее по тексту – «КОЛЛОСТ®») применяется в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой, пластической и общей хирургии, акушерстве, гинекологии, стоматологии с целью заполнения дефектов костей, который склеивает и покрывает



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛЛОСТ мембрана 15х15х0,2 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052021<br> 14.05.2021<br> 14.05.2024     | КОЛЛОСТ мембрана 15х15х0,2 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052021<br> 14.05.2021<br> 14.05.2024     |
| КОЛЛОСТ мембрана 15х15х0,2 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052021<br> 14.05.2021<br> 14.05.2024 | КОЛЛОСТ мембрана 15х15х0,2 мм<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 001052021<br> 14.05.2021<br> 14.05.2024 |

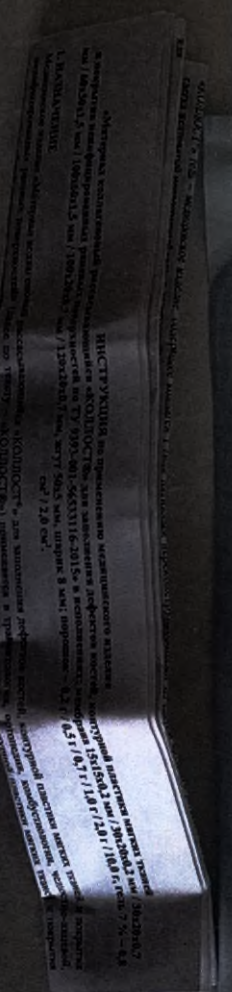[illegible]



# КОЛЛОСТ® мембрана 100×20×0,7 мм

ООО «БИОФАРМАХОЛДИНГ», 123098,  
Россия, г. Москва, ул. Гамзели, д. 18, стр. 33.  
Тел.: +7 (495) 741-49-90

[www.collost.ru](http://www.collost.ru),  
e-mail: [safety@collost.ru](mailto:safety@collost.ru)  
ТУ 9393-001-56533116-2015

STERILE R

5°C

25°C

!

⊗

○

БИОФАРМА  
ХОЛДИНГ

LOT 001072021

20.07.2021

20.07.2024

КОЛЛОСТ

STERILE R 5°C 25°C                                                                                                                                     


 0001077041  
 20.07.2013  
 20.07.2014

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd  
Journal of Internal Medicine 260: 103–112

[illegible]

|           |            |
|-----------|------------|
| 001672021 | 20.07.2021 |
| 001672021 | 20.07.2021 |

|            |            |
|------------|------------|
| 20.07.2024 | 20.07.2024 |
|------------|------------|

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KONTAKT: <a href="mailto:info@lms.com">info@lms.com</a> 1200-200-7 4000<br>0000 + <a href="mailto:info@lms.com">info@lms.com</a> 1200-200-7 4000 | KONTAKT: <a href="mailto:info@lms.com">info@lms.com</a> 1200-200-7 4000<br>0000 + <a href="mailto:info@lms.com">info@lms.com</a> 1200-200-7 4000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| 001072011 | 001072011 |
| 001072011 | 001072011 |

|            |            |
|------------|------------|
| 20.07.2024 | 20.07.2024 |
| 20.07.2024 | 20.07.2024 |

# КОЛЛОСТ® мембрана 120×20×0,7 мм

ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», 123098,  
Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 33.  
Тел.: +7 (495) 741-49-90

www.collost.ru,  
e-mail: safety@collost.ru  
Тү 9393-001-565331 16-2015

STERILE R

5°C

25°C

⚠

Ⓢ


○


БИОФАРМА  
ХОЛДИНГ

001072021  
20.07.2021  
20.07.2024

Вариант исполнения шарик 8 мм 2 шт.




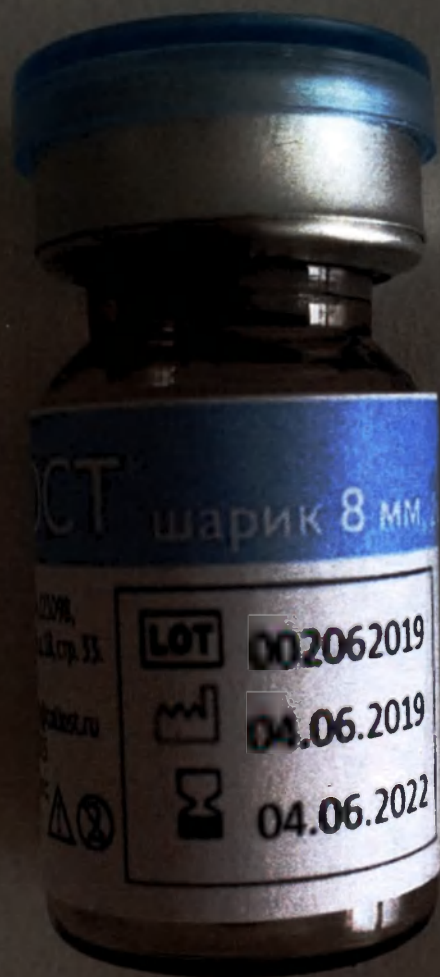

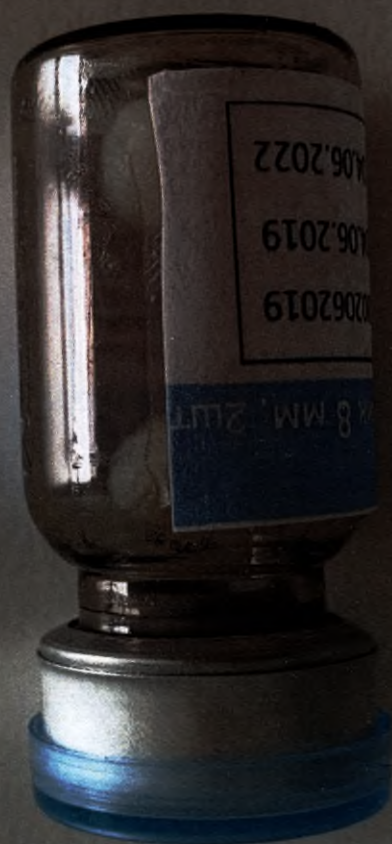



[illegible]

Медицинское изделие «Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, костной ткани и покрывной мембраны неинфицированных раневых поверхностей» (далее по тексту – «КОЛЛОСТ®») применяется в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и общей хирургии, акушерстве гинекологии, стоматологии с целью заполнения дефектов костей, костной ткани и покрывной

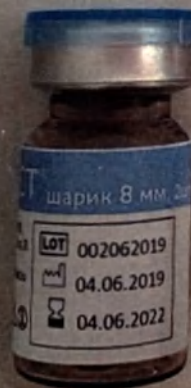

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛЛОСТ шарик 8 мм, 2 шт.<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 002062019<br> 04.06.2019<br> 04.06.2022 | КОЛЛОСТ шарик 8 мм, 2 шт.<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 002062019<br> 04.06.2019<br> 04.06.2022 |
| КОЛЛОСТ шарик 8 мм, 2 шт.<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 002062019<br> 04.06.2019<br> 04.06.2022 | КОЛЛОСТ шарик 8 мм, 2 шт.<br>ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»<br>LOT 002062019<br> 04.06.2019<br> 04.06.2022 |

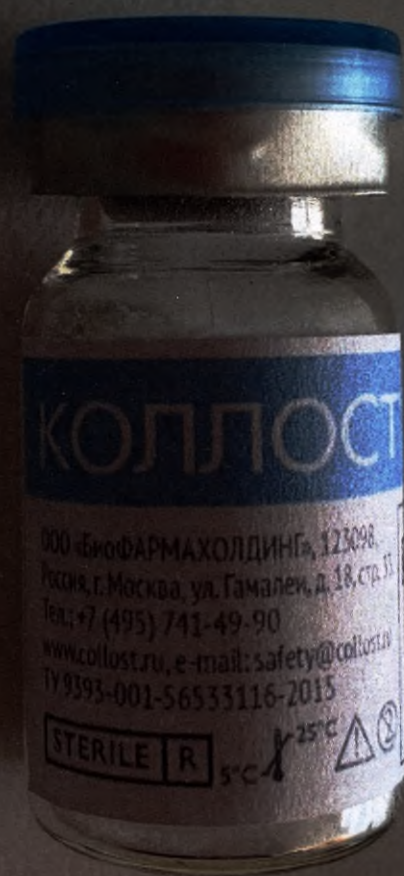

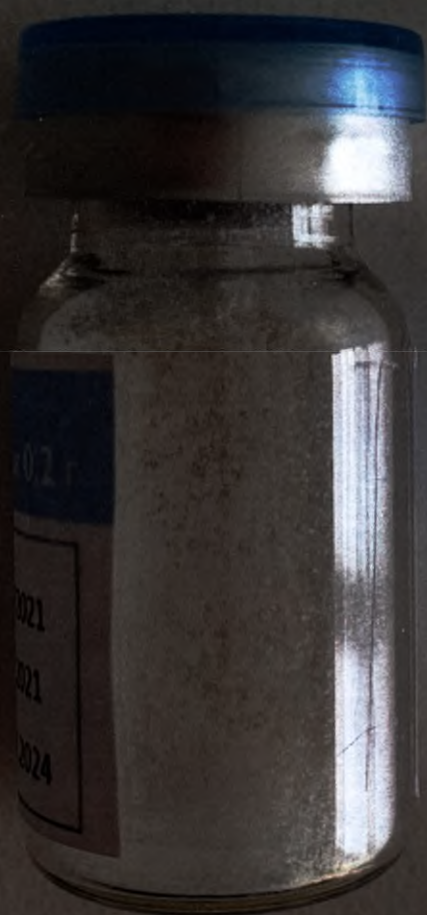

ИЛН

# ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия

«Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, костной ткани и покрытия неинфицированных раневых поверхностей по ТУ 9393-001-56533116-2015» в исполнениях: мембрана 15х15х1 мм / 30х20х0,7 мм / 60х50х1,5 мм / 100х60х1,5 мм / 100х20х0,7 мм / 120х20х0,7 мм, жгут 50х5 мм, шарик 8 мм; порошок – 0,2 г / 0,5 г / 1 г / 1,5 г / 2 г / 3 г / 5 г / 10 г / 20 г / 50 г / 100 г, гель 7 % – 0,8 см<sup>3</sup> / 2,0 см<sup>3</sup>.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ®» для заполнения дефектов костей, костной ткани и покрытия неинфицированных раневых поверхностей» (далее по тексту – «КОЛЛОСТ®») применяется в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой, общей хирургии, акушерстве, гинекологии, стоматологии с целью заполнения дефектов костей, костной ткани и покрытия



КОЛЛОСТ порошок 0,2 г  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»  
LOT 002072021  
09.07.2021  
09.07.2024

КОЛЛОСТ порошок 0,2 г  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»  
LOT 002072021  
09.07.2021  
09.07.2024

КОЛЛОСТ порошок 0,2 г  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»  
LOT 002072021  
09.07.2021  
09.07.2024

КОЛЛОСТ порошок 0,2 г  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»  
LOT 002072021  
09.07.2021  
09.07.2024

Ненюков А.К.



еральный директор  
О «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

3Ф2-СОП-01-07-В1

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

12 (Светлана Гиги) лист 02

Генеральный директор ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ» Нешков А.К.

МОСКВА




### **Макеты новой упаковки на медицинское изделие**

«Материал коллагеновый рассасывающийся «КОЛЛОСТ» для заполнения дефектов костей, контурной пластики мягких тканей и покрытия неинфицированных раневых поверхностей» по ТУ 9393-001-56533116-2015

Макет упаковки геля 7% (объем 2,0 см3):


Первичная упаковка:



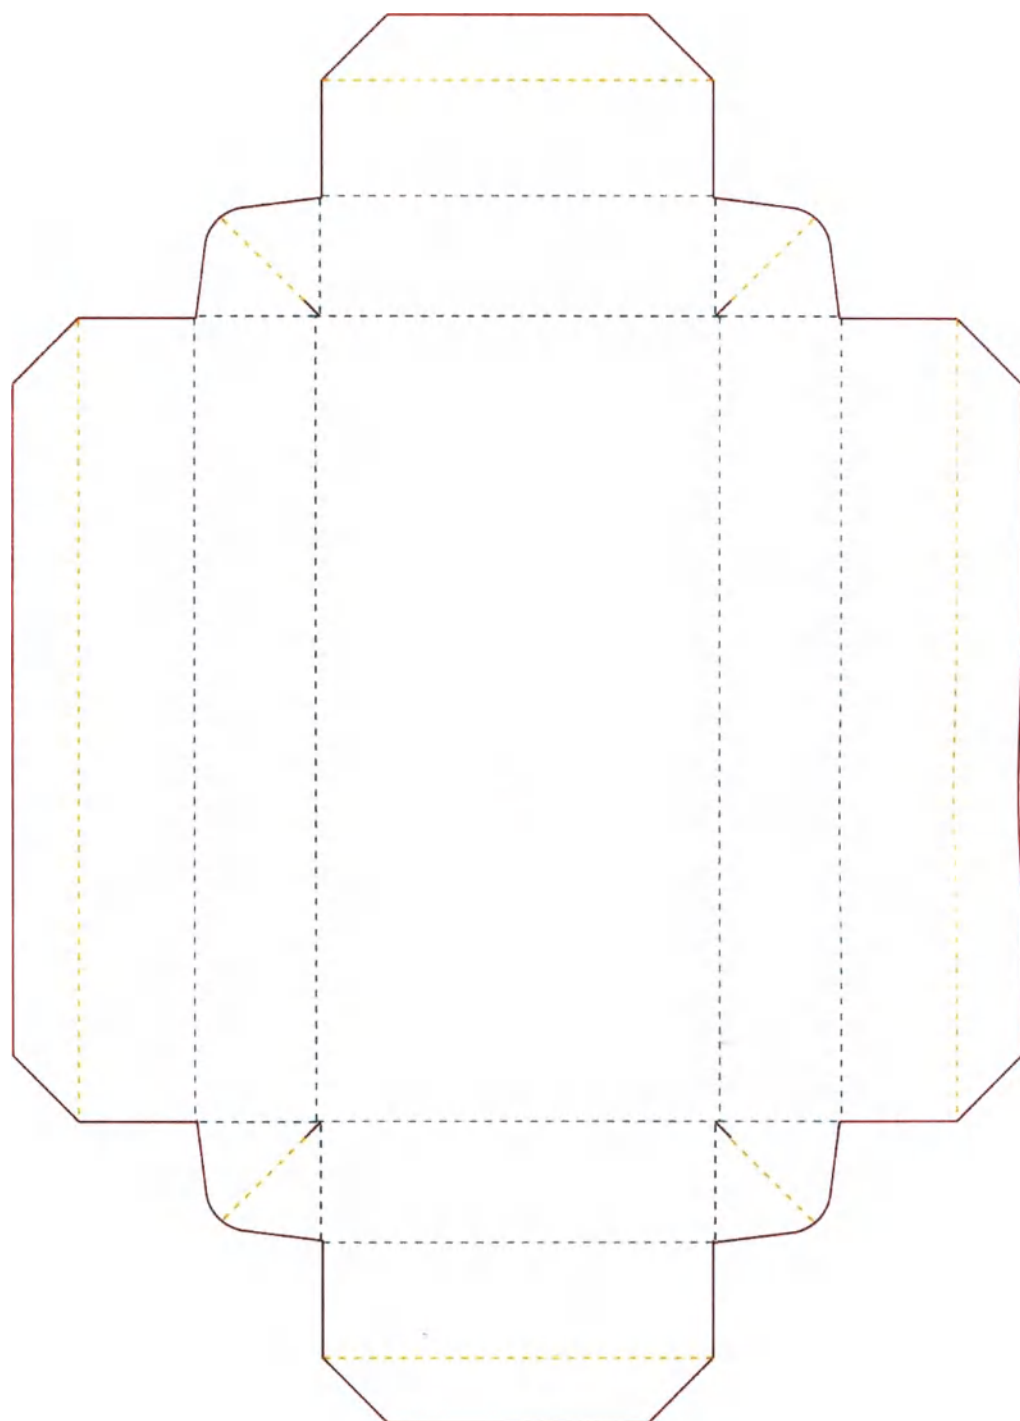

Листок:

**Холдер:**

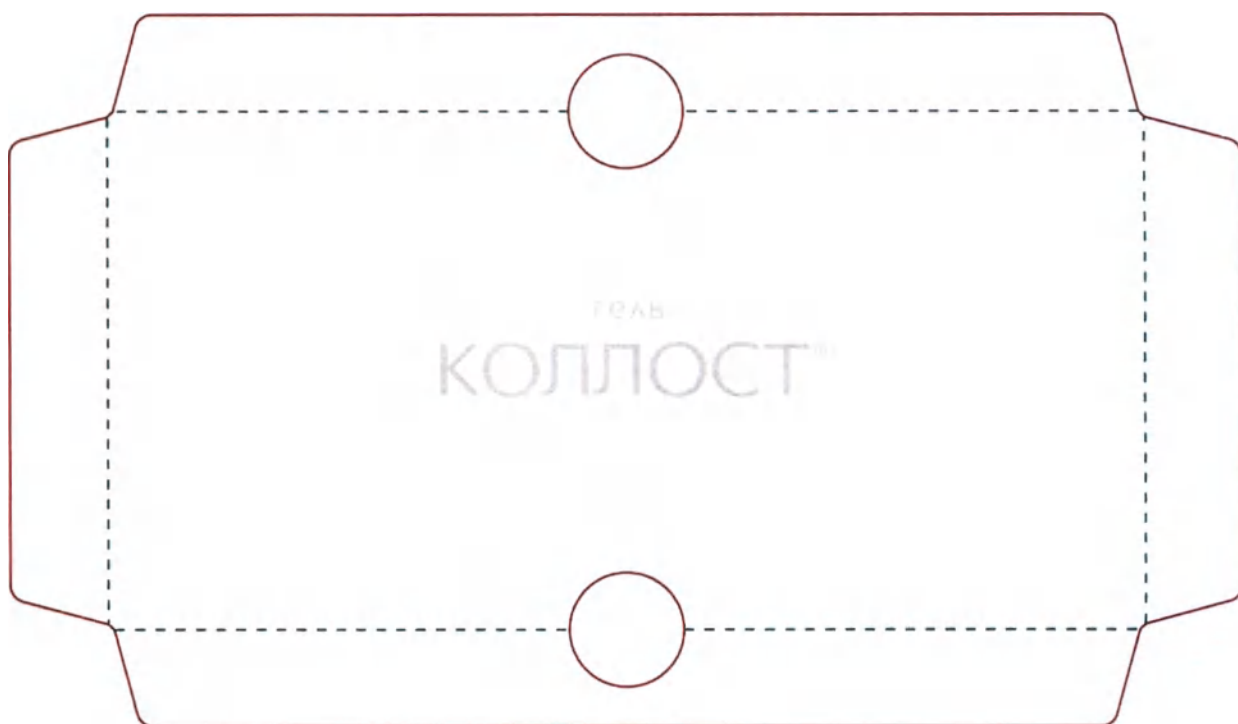


Шубер пачки:



## Макет упаковки геля 7% (объем 0,8 см<sup>3</sup>):


Первичная упаковка:



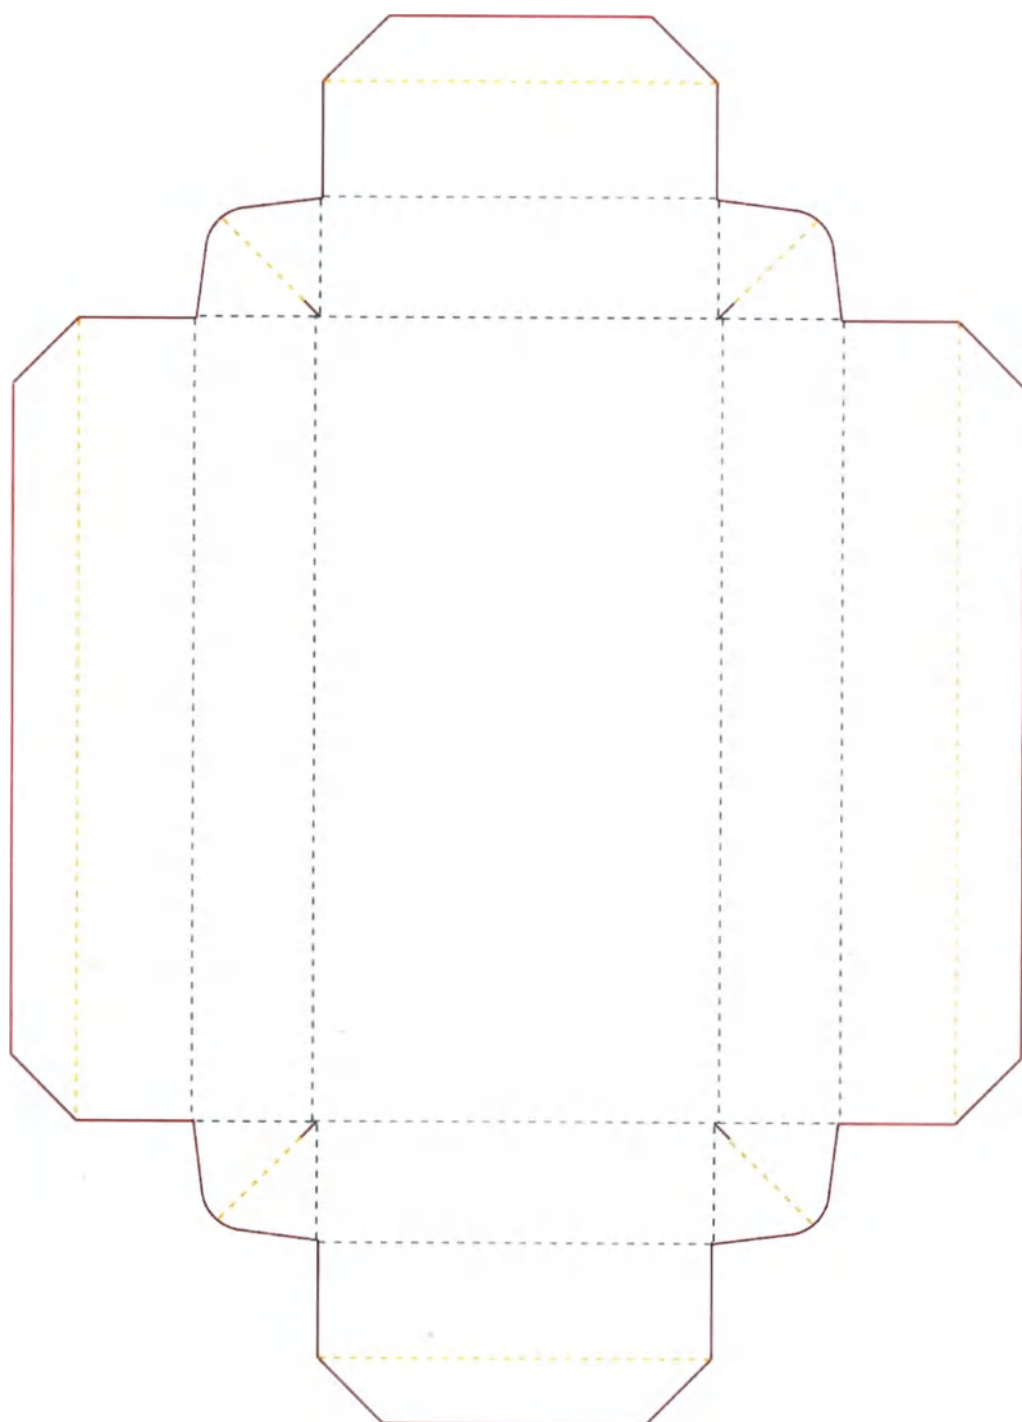

Листок:

**Холдер:**

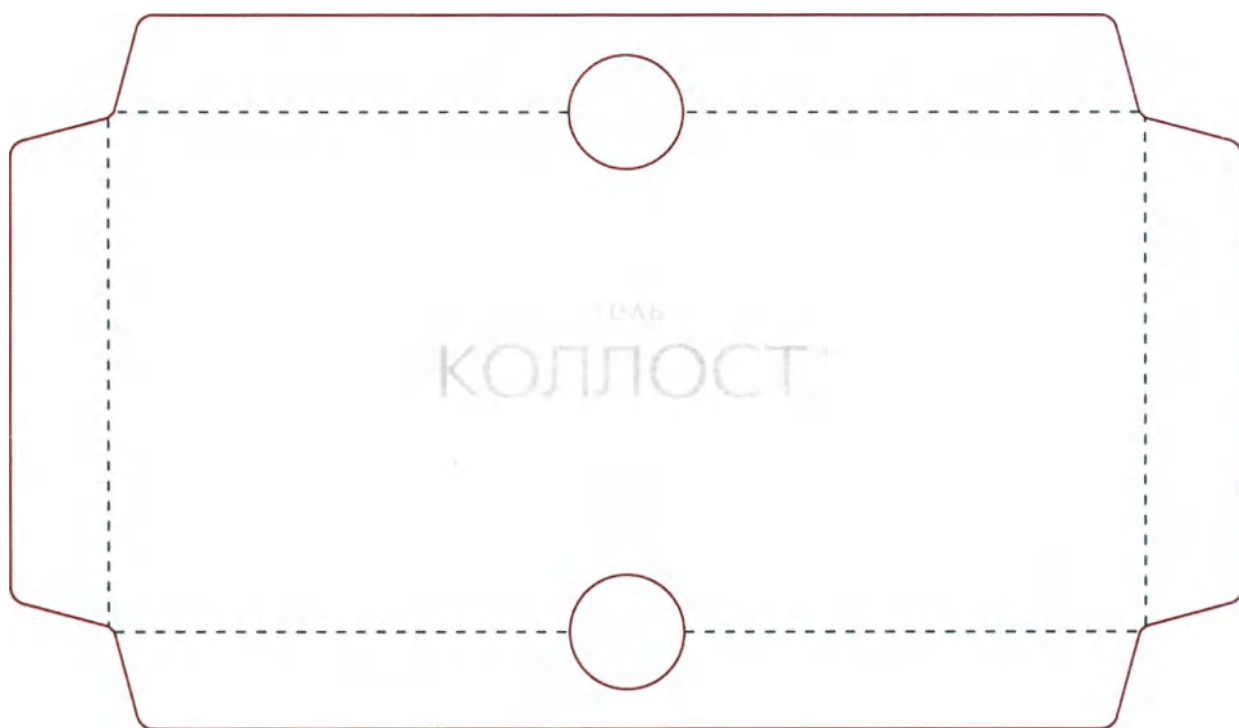


Шубер пачки:



## Макет упаковки геля 15% (объем 1,0 см3):


Первичная упаковка:



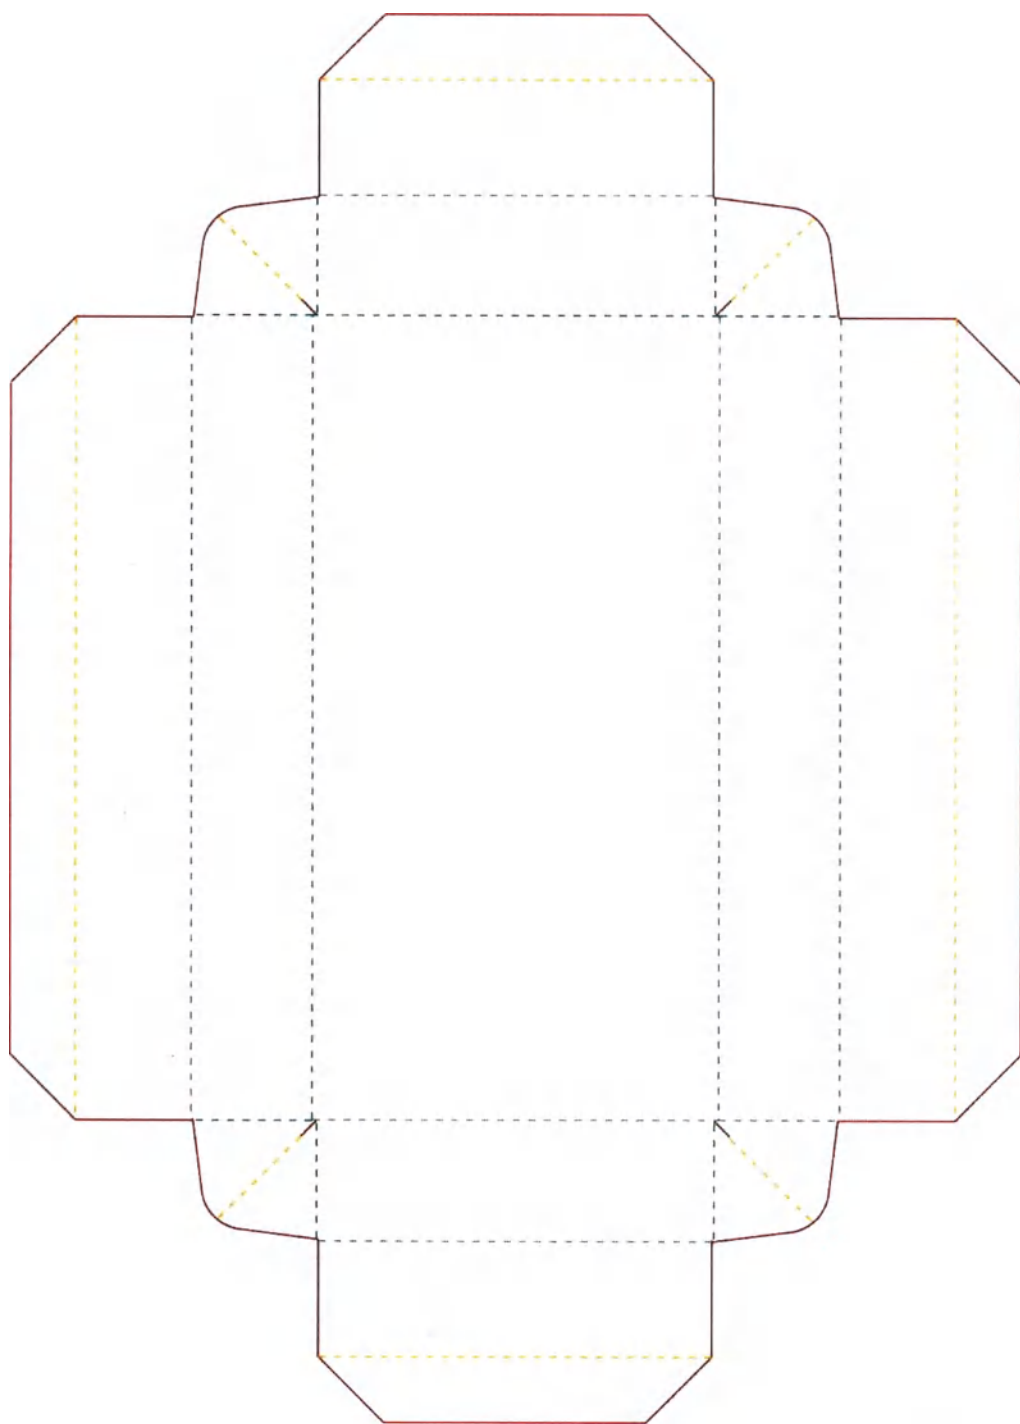


ЛЮТОК:

Холдер:

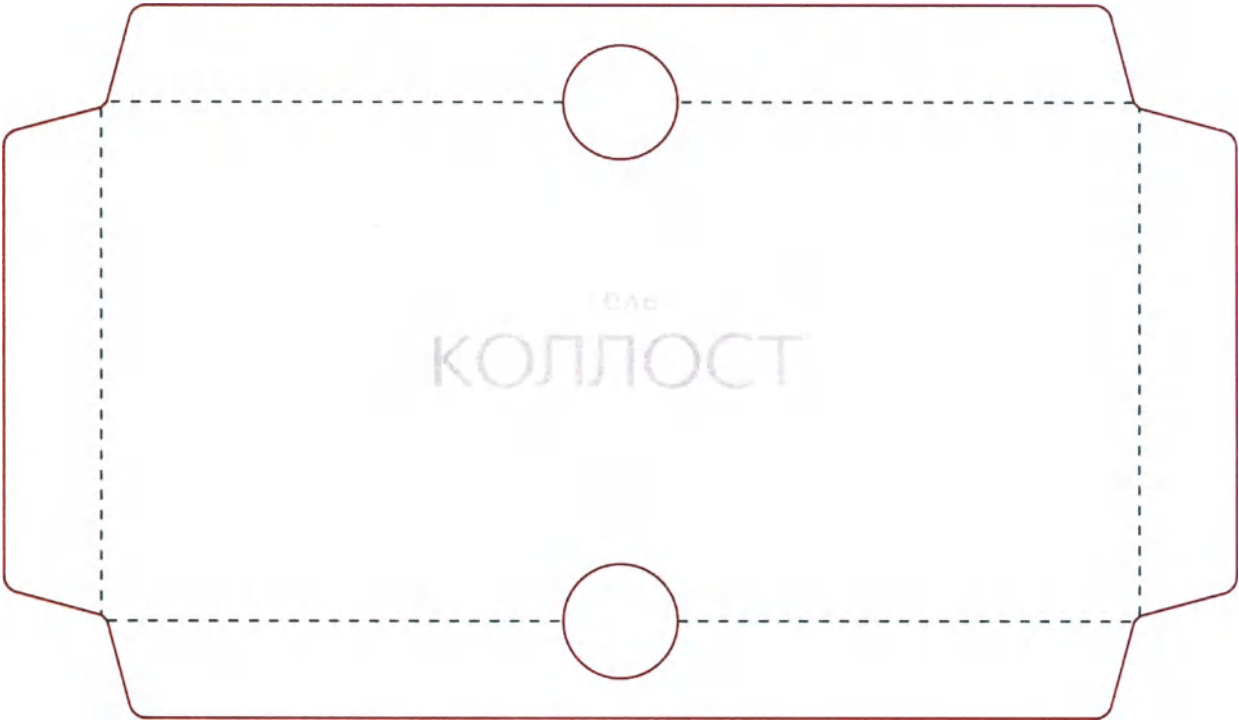














Шыбер папки:

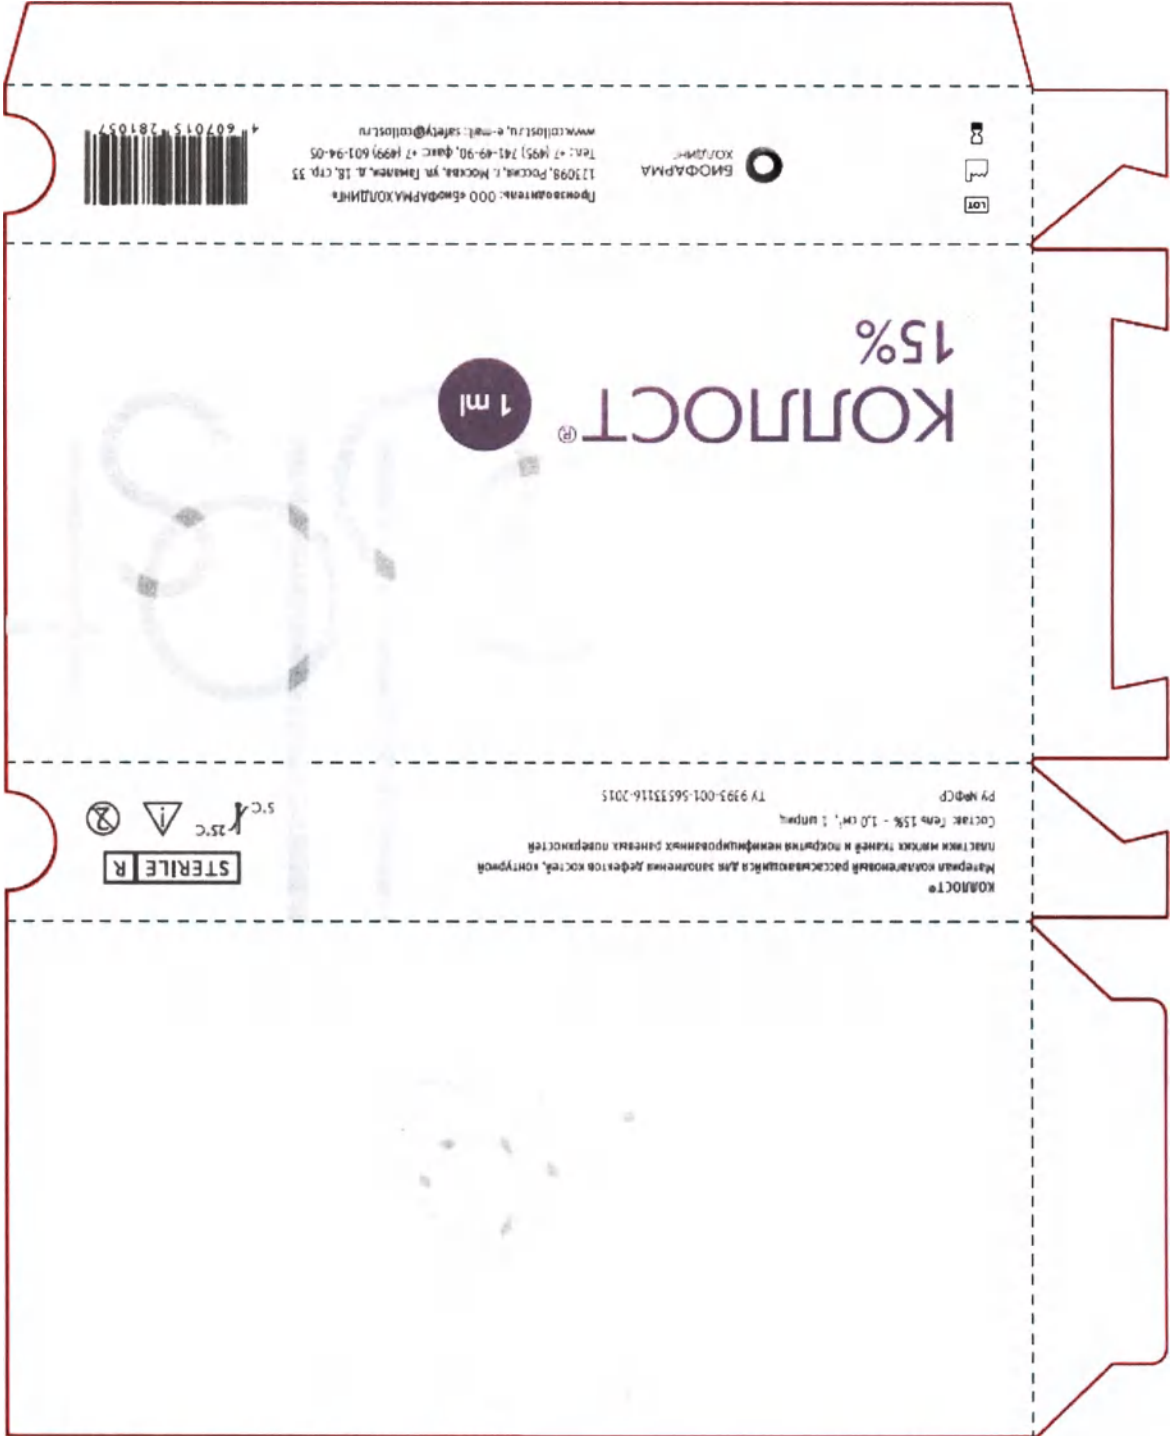


## Макет упаковки:

- мембран (15x15x0,2 / 30x20x0,2 / 30x20x0,7 / 60x50x1,5 / 100x60x1,5 мм);
- жгута 50x5 мм;
- шарика 8 мм (2 шт./ 4 шт.);
- порошка (0,2 / 0,5 / 0,7 / 1,0 / 2,0 / 10,0 г)

## Этикетка первичной упаковки:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>КОЛЛОСТ® мембрана 60x50x1,5 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br> | <b>КОЛЛОСТ® мембрана 100x60x1,5 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>      | <b>КОЛЛОСТ® жгут 50x5 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>                |
| <b>КОЛЛОСТ® мембрана 30x20x0,7 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br> | <b>КОЛЛОСТ® порошок 0,2 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>               | <b>КОЛЛОСТ® порошок 0,5 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>               |
| <b>КОЛЛОСТ® шарик 8 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>      | <b>КОЛЛОСТ® порошок 1,0 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>         | <b>КОЛЛОСТ® порошок 2,0 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>         |
| <b>КОЛЛОСТ® порошок 0,7 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>   | <b>КОЛЛОСТ® мембрана 30x20x0,2 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br> | <b>КОЛЛОСТ® мембрана 15x15x0,2 мм</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br> |
| <b>КОЛЛОСТ® порошок 10,0 г</b><br><small>ООО «БИОФАРМАКОЛДНГ», 125098, Россия, г. Москва, ул. Гамалей, д. 18, стр. 55<br/>Тел.: +7 (495) 741-49-90<br/>www.kollost.ru, e-mail: safety@kollost.ru<br/>ТУ 9395-001-56533116-2015</small><br><br><br>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Пачка (на примере жгута 50х5 мм):

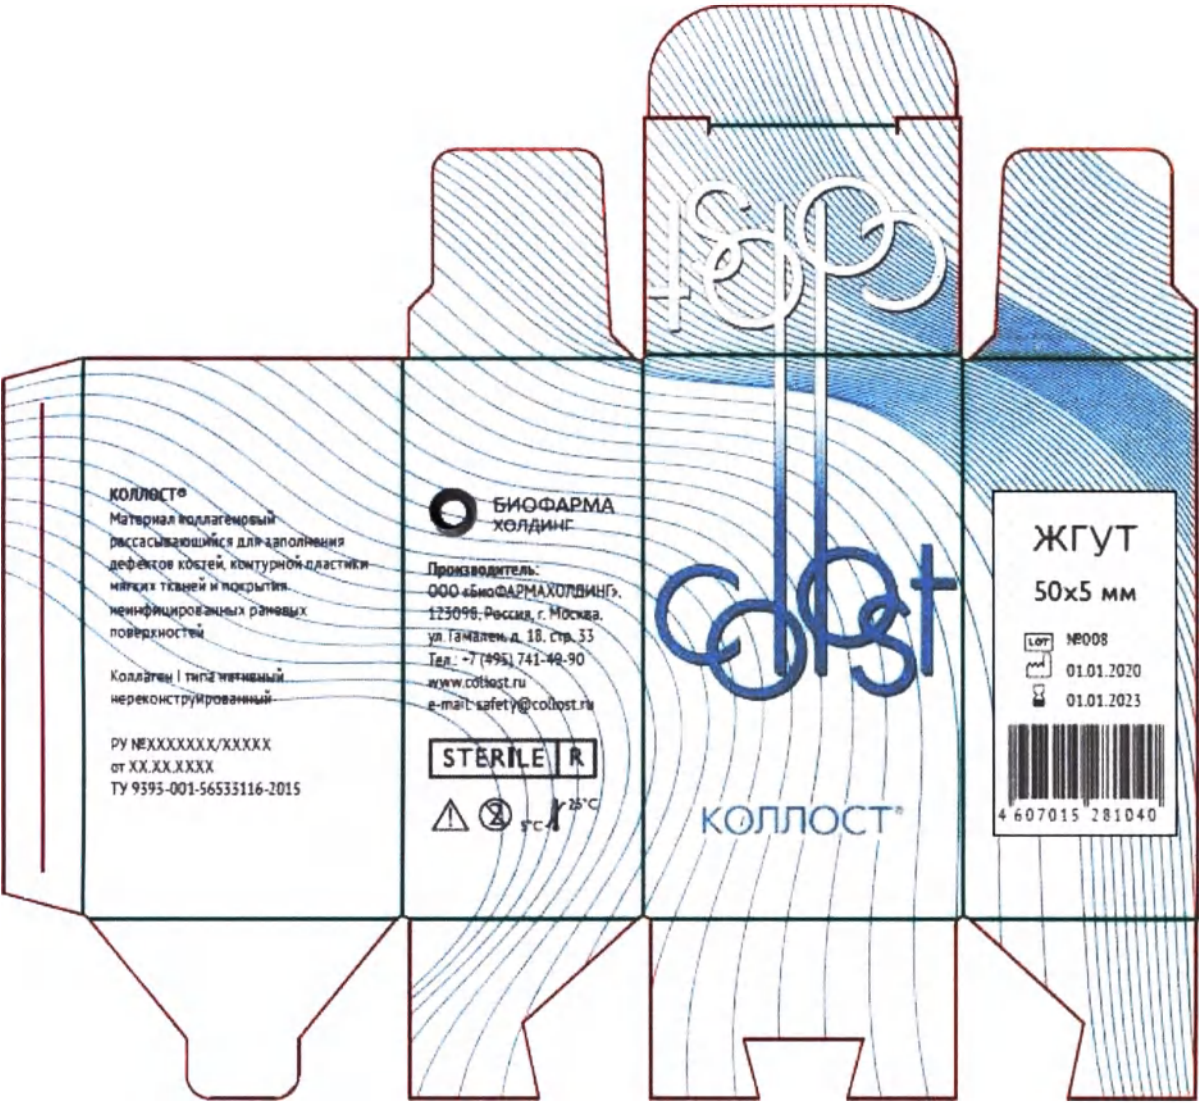


## Макет упаковки мембран 100х20х0,7 мм и 120х20х0,7 мм

Этикетка первичной упаковки:

КОЛЛОСТ® мембрана  
120×20×0,7 мм

ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», 123098,  
Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 33.  
Тел.: +7 (495) 741-49-90




www.collost.ru,  
e-mail: safety@collost.ru  
ТУ 9393-001-56533116-2015



КОЛЛОСТ® мембрана  
100×20×0,7 мм

ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ», 123098,  
Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 33.  
Тел.: +7 (495) 741-49-90

www.collost.ru,  
e-mail: safety@collost.ru  
ТУ 9393-001-56533116-2015



лечка:



Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»



Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 02

Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 02

Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 02

Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 02

Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 00

Ненюков А.К.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

ЗФЭ-СОП-01-07-В1

Генеральный директор  
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

лист 00

Ненюков А.К.