


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВс IgM Калибраторы (Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators)»**





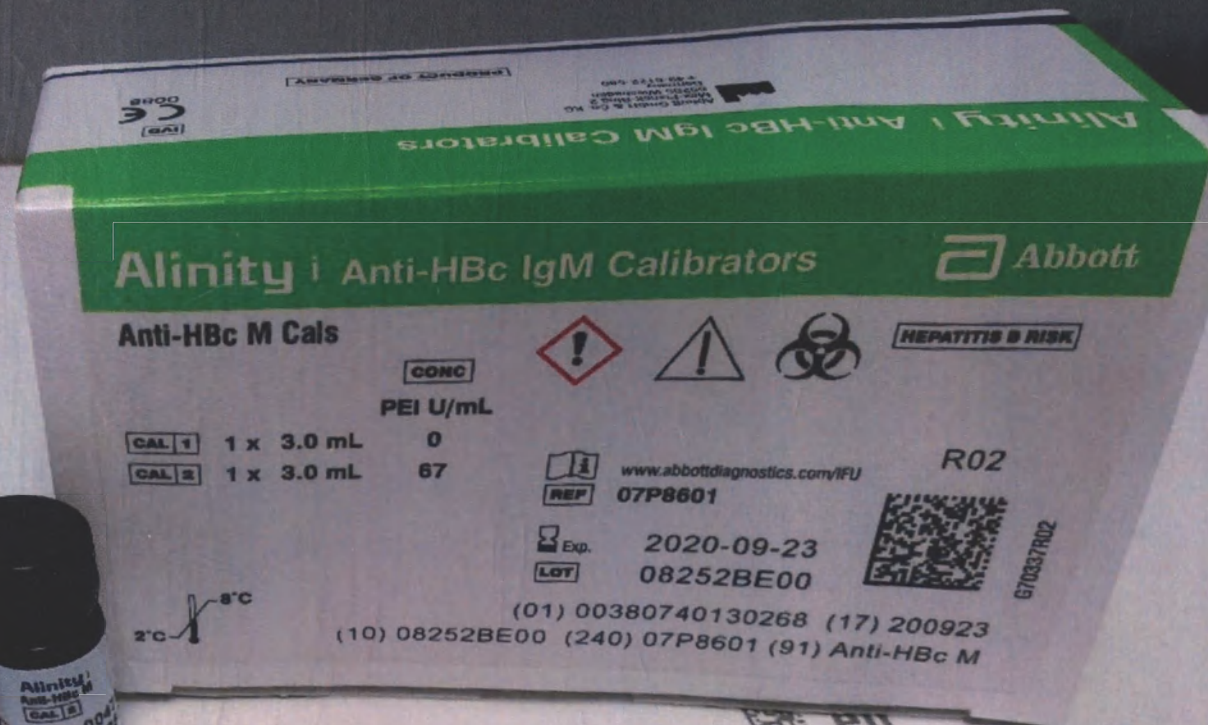

Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators

Abbott

Anti-HBc M Cals

CONC

PEI U/mL

CAL 1	1 x 3.0 mL	0
CAL 2	1 x 3.0 mL	67



HEPATITIS B RISK



www.abbottdiagnostics.com/IFU
REF 07P8601


R02



Exp. 2020-09-23
LOT 08252BE00



G70337R02



(01) 00380740130268 (17) 200923
(10) 08252BE00 (240) 07P8601 (91) Anti-HBc M

Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators

Created August 2016.

NAME

Anti-HBc IgM Calibrators (also referred to as Anti-HBc M


The following warnings and precautions apply to: CAL 1 and CAL 2



WARNING

Contains methylisocyanolones.

May cause an allergic skin reaction.

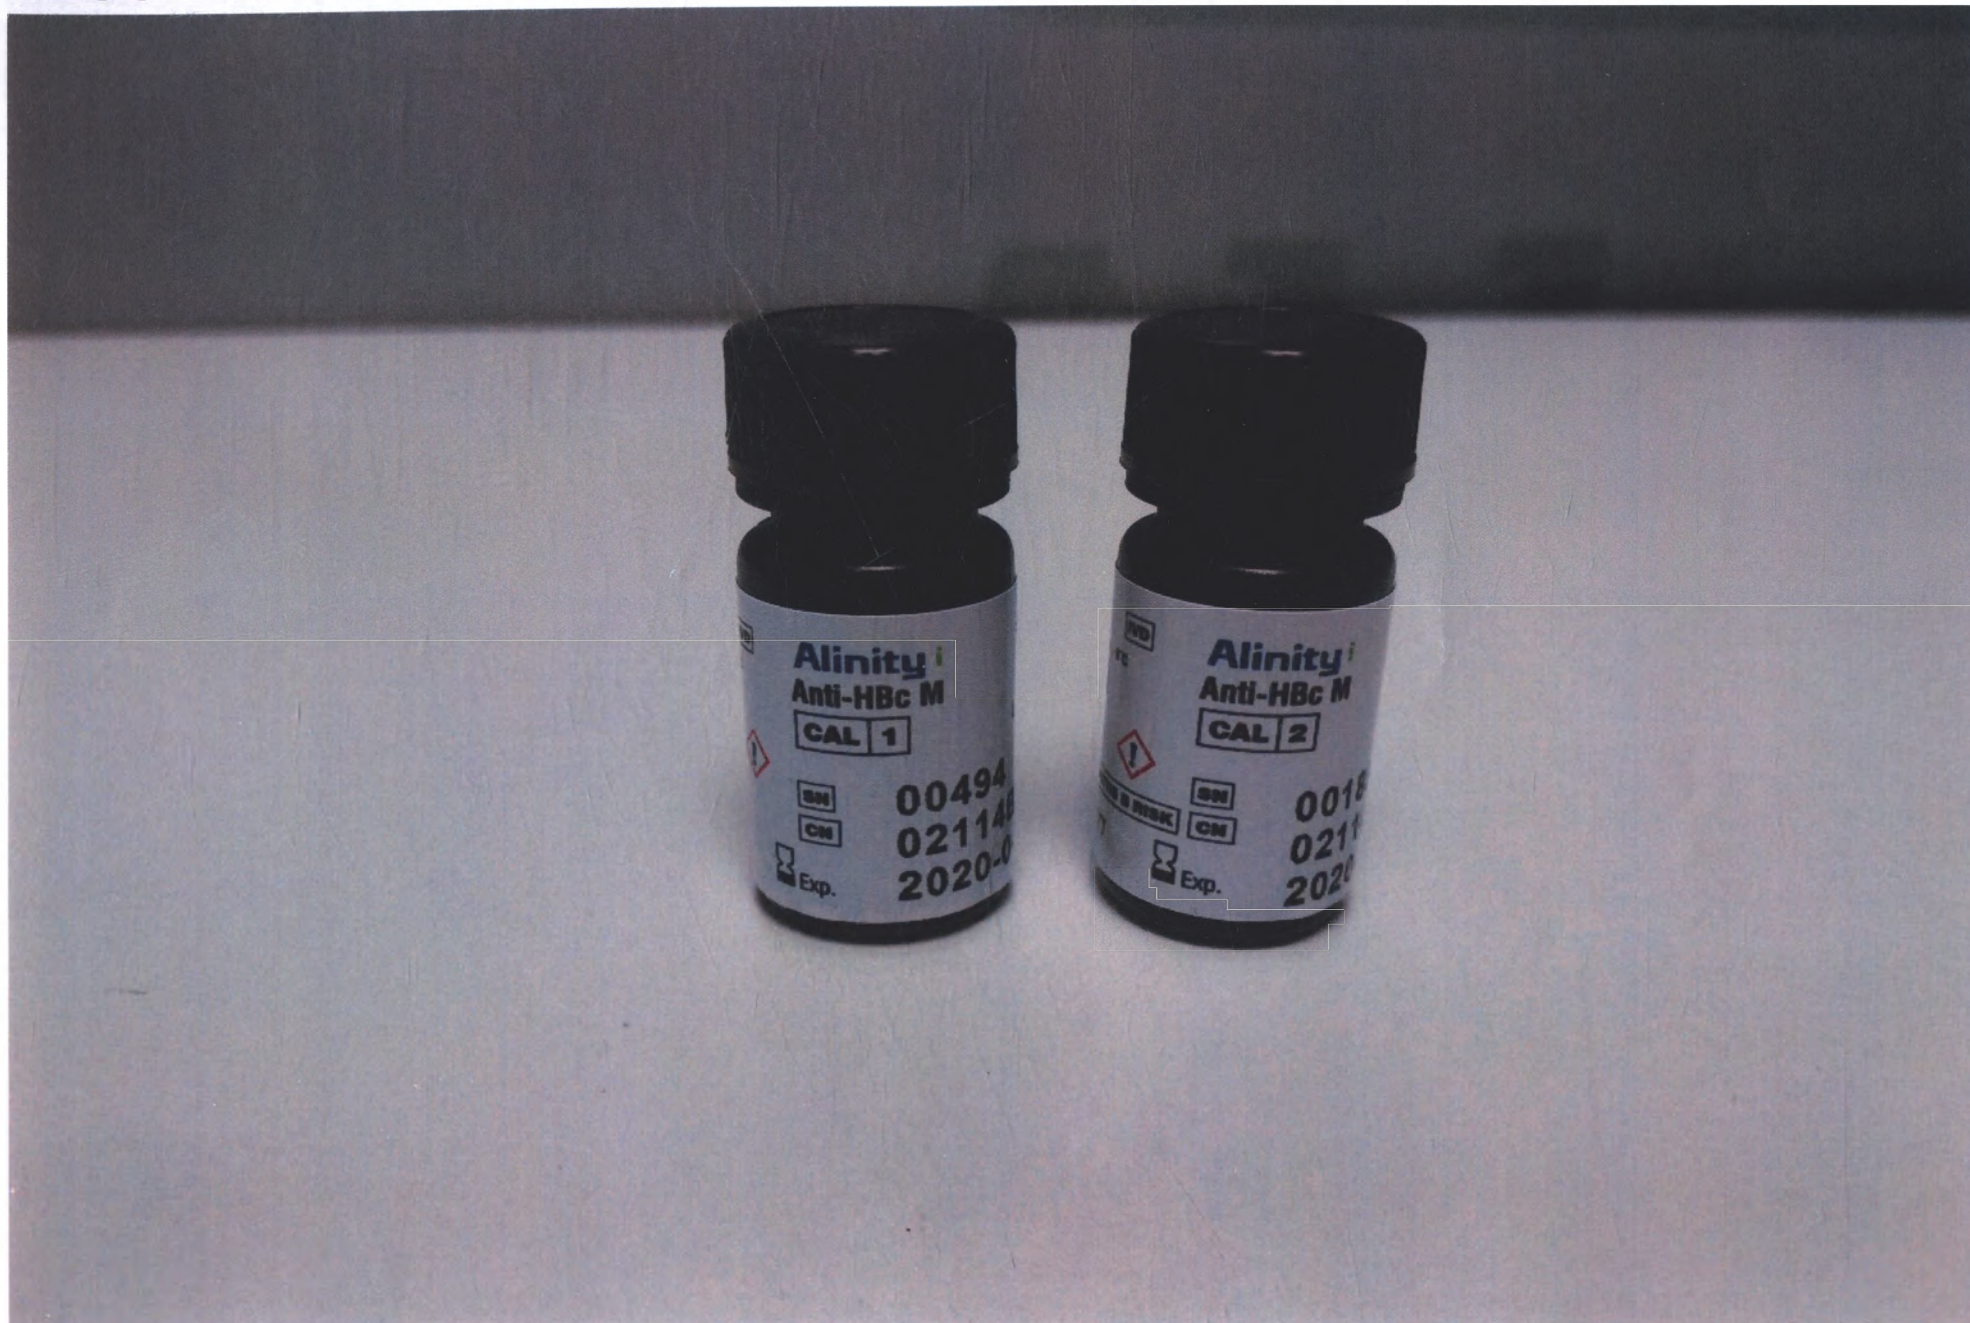

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-НВс IgM Калибраторы (Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



07P8601



Калибраторы для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Анти-НВс IgM Калибраторы (Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators)»

В составе: Калибратор 1 (Alinity i Anti-HBc IgM CAL1) – 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор 2 (Alinity i Anti-HBc IgM CAL2) – 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № _____ / от _____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия Анти-НВс IgM Калибраторы (Alinity i Anti-HBc IgM Calibrators)

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04

G70337R04


G70337R04

G70337R04


G70337R04

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (Alinity i Anti-HBc IgM CAL1)

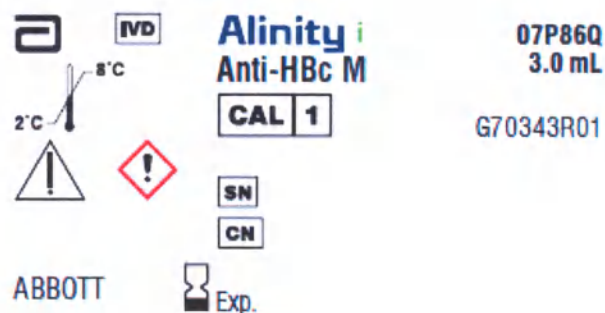

- Калибратор 2 (Alinity i Anti-HBc IgM CAL2)

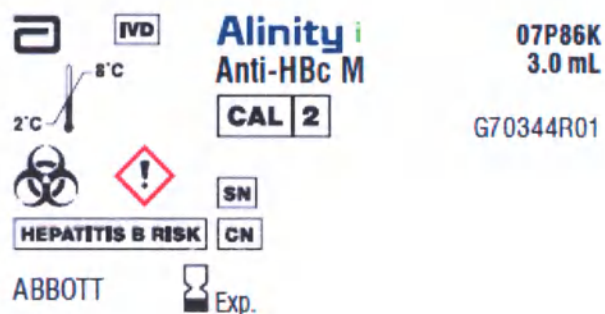

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 ЛИСТОВ

«Эбботт Лабораториз»

Подпись _____
Abbott Laboratories