

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Syphilis TP Калибратор (Alinity i Syphilis TP Calibrator)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Syphilis TP Calibrator

Abbott

Syphilis Cal

CAL 1 1 x 3.0 mL



CONTAINS: AZIDE


R02



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

07P6001



Exp.


2018-08-23

LOT


81070LI00





G70065R02




(01) 00380740121624 (17) 180823
(10) 81070LI00 (240) 07P6001 (91) Syphilis

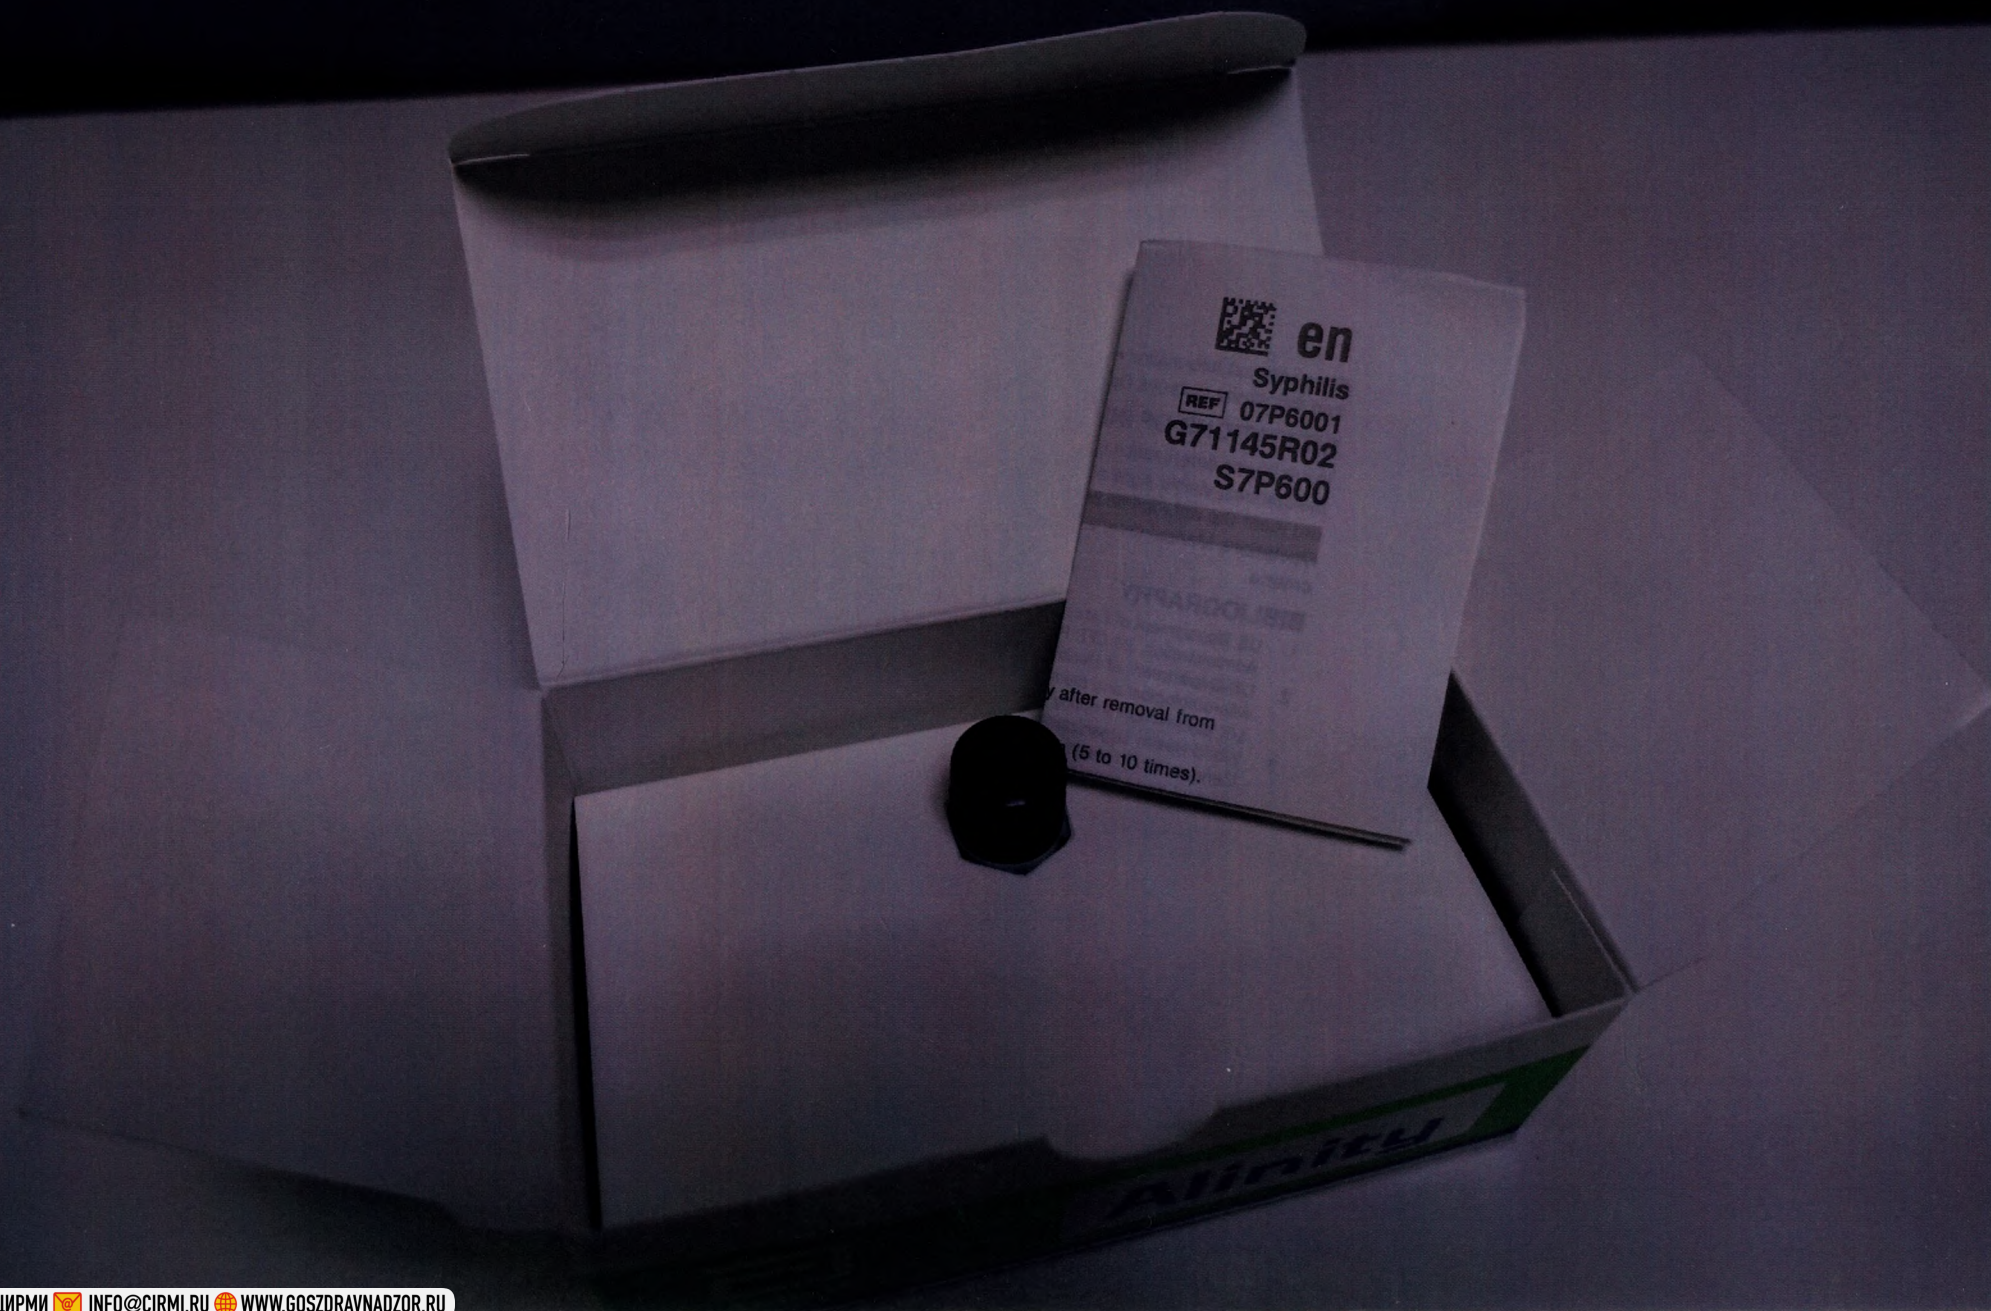

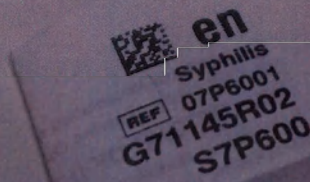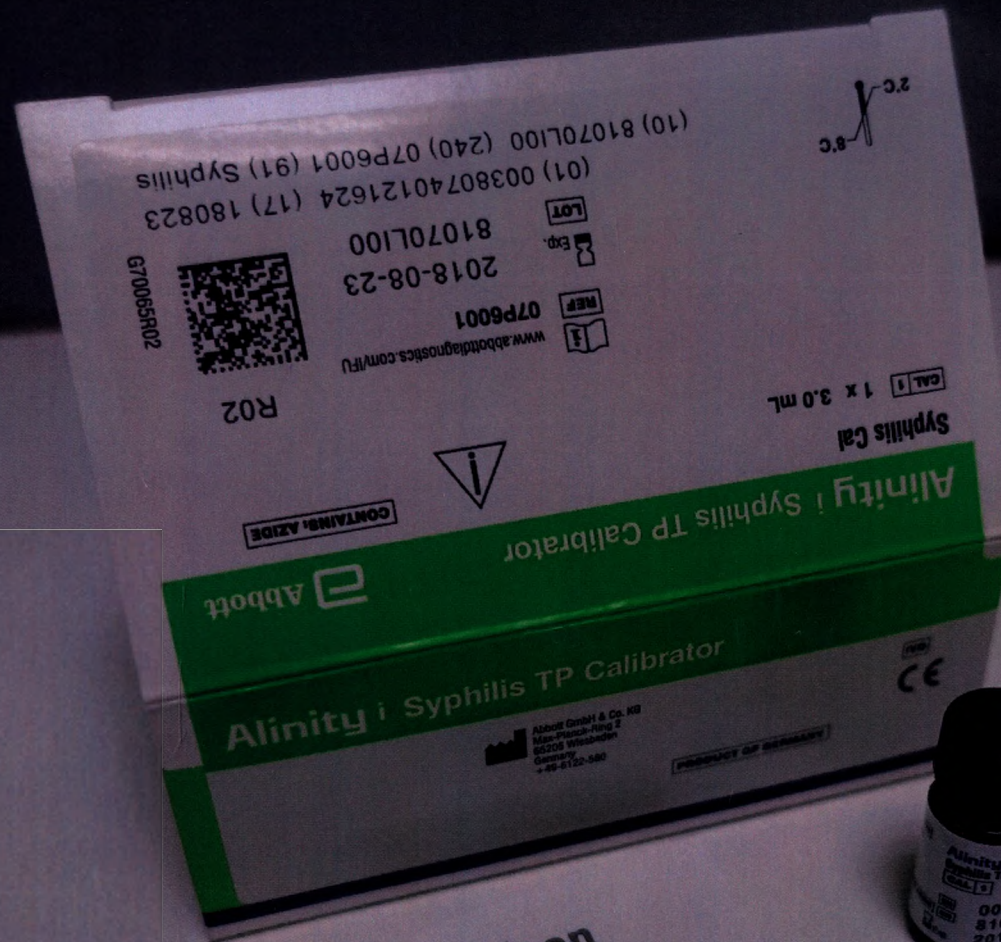



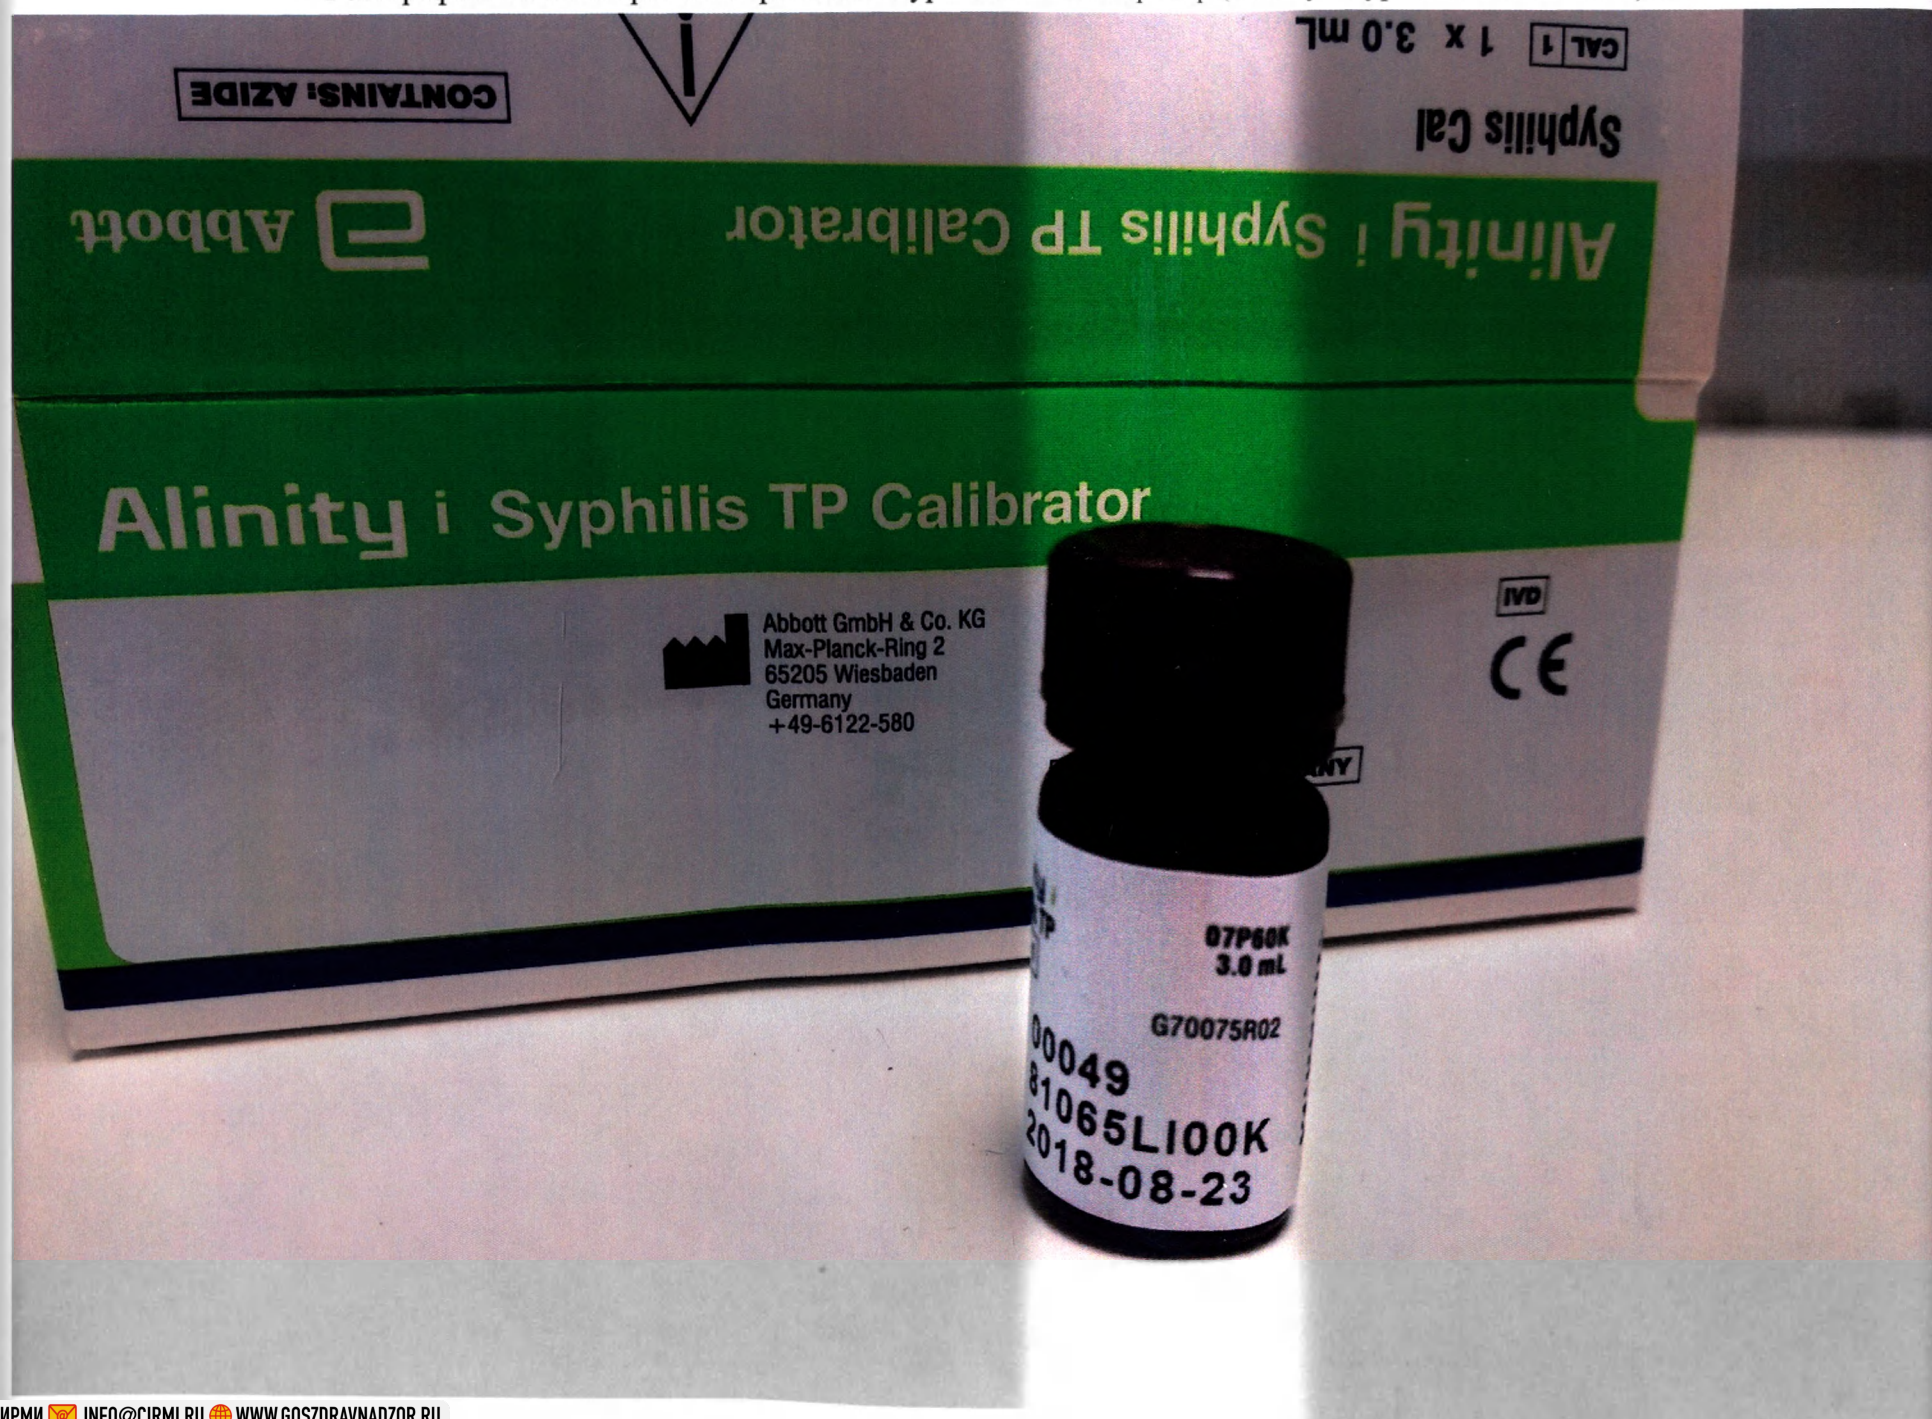

Пронумеровано, прошито
скреплено печатью на _____



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и
плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Syphilis
TP Калибратор (Alinity i Syphilis TP Calibrator)»**



REF 07P60-01

IVD



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к Syphilis TP иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Syphilis TP Калибратор (Alinity i Syphilis TP Calibrator)»

в составе:

- Калибратор 1 (Alinity i Syphilis TP CAL 1) -1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют / Инструкцию по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU /

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г.


Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

File: 07P60-TF-01_Eng_P01e.indd
Template: 1
Size: 155 mm x 105 mm
See drawing for stamp fields and material
Text, Symbols: Black
Brand: PMS 375 c
Paper

16.08.2016 14:21:19

07P60-TF-01_Eng_P01e.indd 1



Syphilis Cal



PRODUCT OF GERMANY

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

Abbott

Alinity i Syphilis TP Calibrator

Alinity i Syphilis TP Calibrator

Abbott

Syphilis Cal

CAL 1 1 x 3.0 mL



CONTAINS: AZIDE

www.abbottdiagnostics.com/IFU


REF

07P6001


Exp.

LOT

G70065R02



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

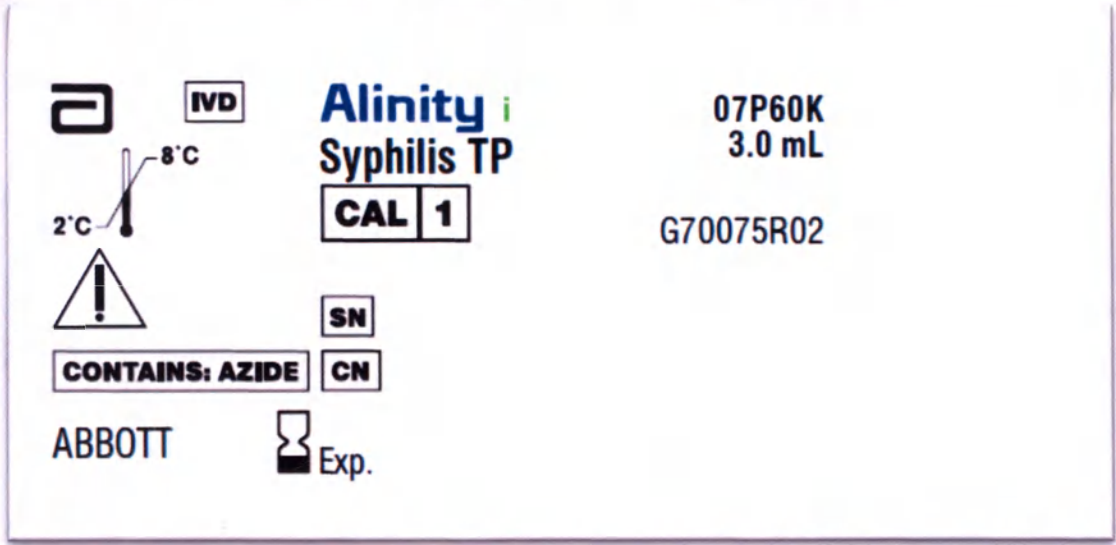

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Пронумеровано, прош
скреплено печатью на

