

Фотографические изображения DESIRIAL (содержимое упаковки)



Фотографические изображения DESIRIAL (содержимое блистера)



Гель инъекционный на основе глицериновой кислоты Desiral® (1,9%), предназначенный для женских половых органов, в составе:

1. Гель инъекционный на основе глицериновой кислоты Desiral® (1,9%) в предварительно наполненном шприце 2мл. – 2 шт.,
2. Игла в футляре 27G½" (0,4мм х 13мм), производства «ТСК Лаборатори», Япония, RU NIFCS 2011/10609 – 2 шт.,
3. Игла в футляре 30G½" (0,3мм х 13мм), производства «ТСК Лаборатори», Япония, RU NIFCS 2011/10609 – 2 шт.,
4. Этикетка с номером партии – 4 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
 Laboratoires Vivacy s.a.s. (Laboratoires VIVACY) / Лабораторис Виваси с.а.с. (Лабораторис ВИВАСИ), Франция 252 rue Douglas Engelbart, Archamps Technopôle, 74150 Archamps, France/
 252 rue Douglas Engelbart, Archamps Technopôle, 74150 Archamps, France

Адрес места производства:
 Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:
 Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ БСК» (ООО «ФАРМ БСК») 119602, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.1, корп.1 пом. III, пом.1-6,
 Российская Федерация, тел.: +7 (495) 934-12-01, e-mail: farmbsk2005@mail.ru, website: www.farmbsk.ru

Регистрационное удостоверение №
 Нематерованное изделие относится к классу А, использованное – классу Б и должно утилизироваться местными органами здравоохранения в соответствии с СанПином 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Транспортировка всеми видами крытого транспорта при соблюдении условий хранения.

Syringes
Needles

STERILE	1	2x 1 ml
STERILE	R	2x 30G½"
STERILE	R	2x 27G½"

LOT
GAD21274J/E1
2024 - 03


Desiral®
 252 rue Douglas Engelbart
 Archamps Technopôle
 74150 ARCHAMPS - FRANCE
 Made in France

2 x 1 mL

STERILE
VIVACY
 0344

CE
 0344

Фотографические изображения DESIRIAL PLUS

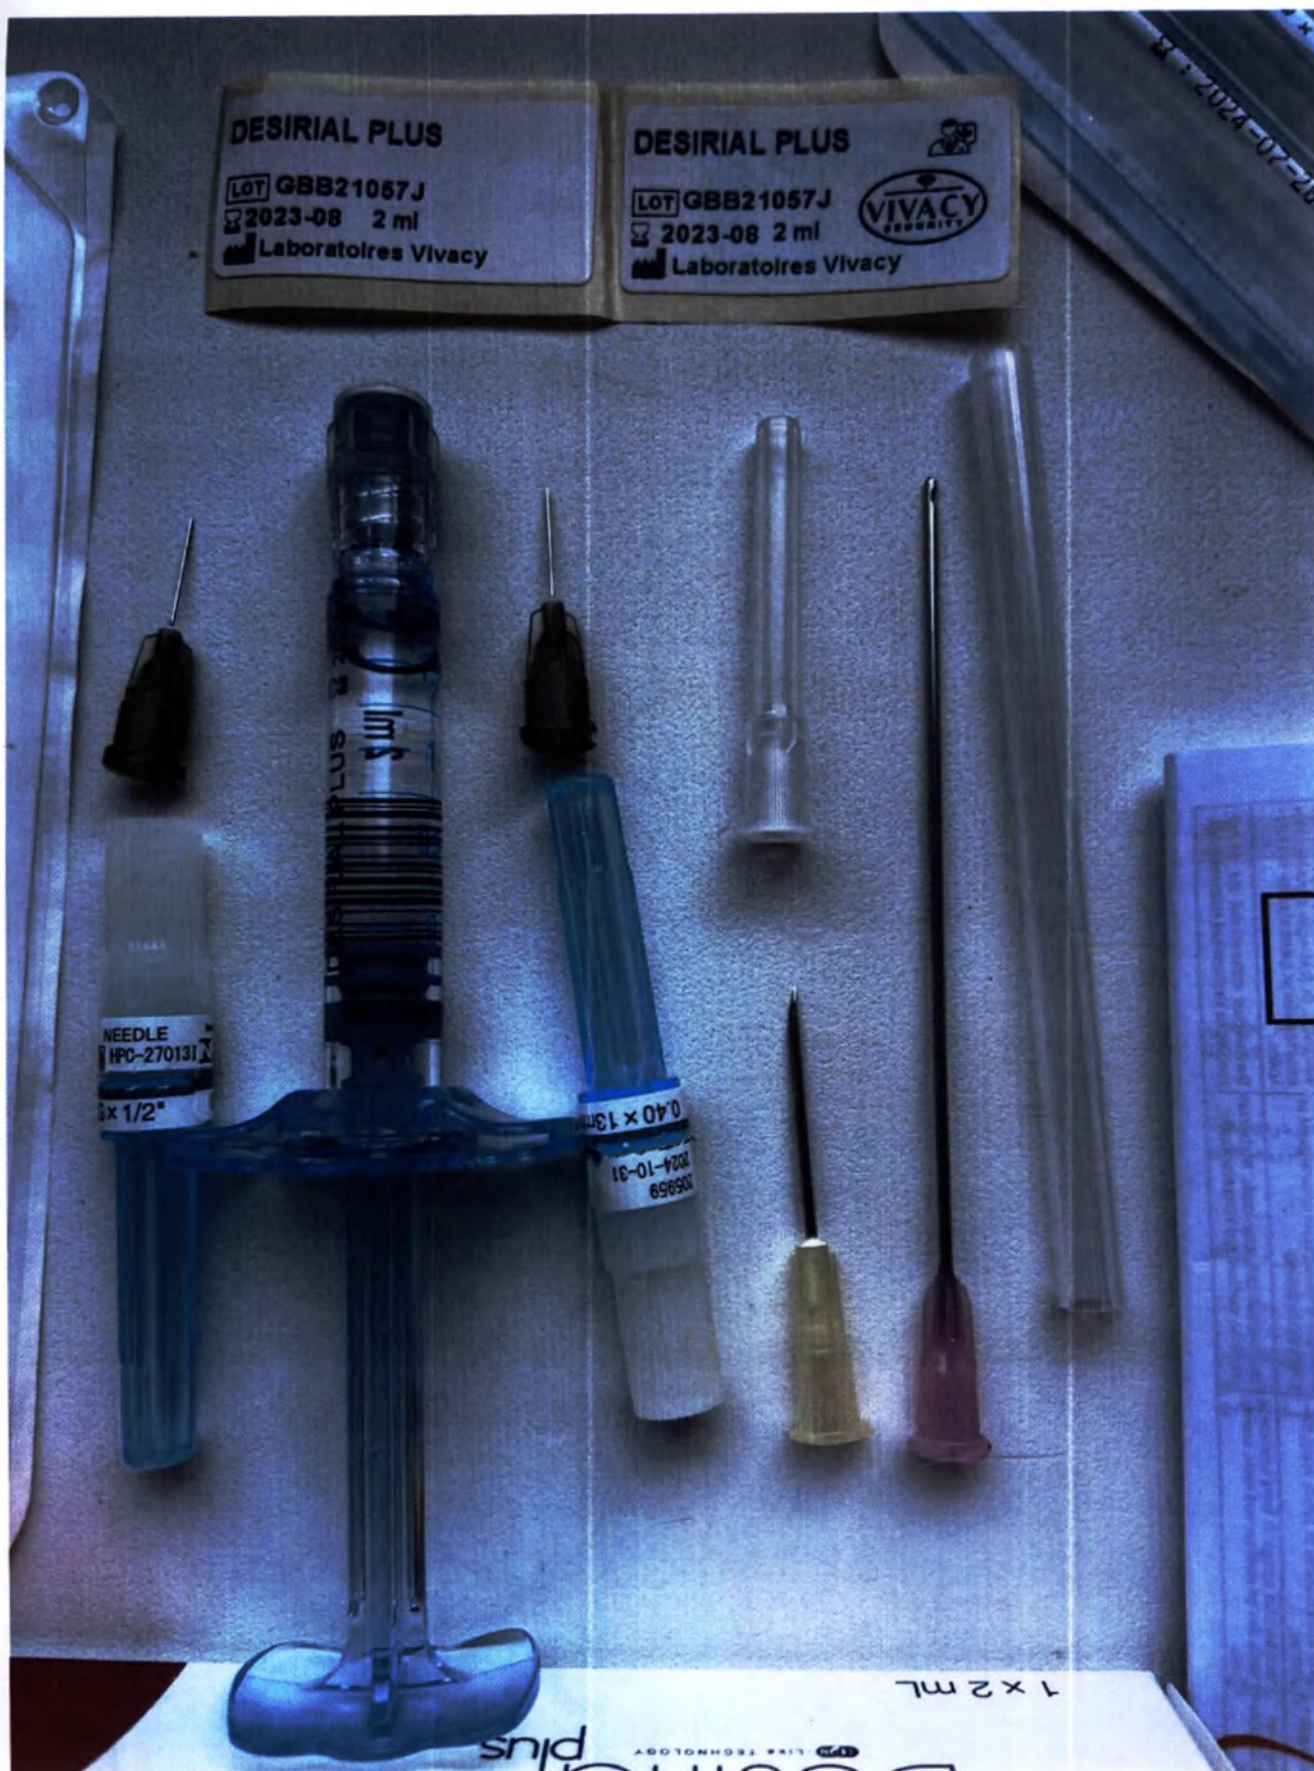

Фотографические изображения DESIRIAL PLUS (содержимое упаковки)



Гель инъекционный на основе гиалуроновой кислоты Desirial® Plus (2,1%), предназначенный для женских половых органов, в составе:

1. Гель инъекционный на основе гиалуроновой кислоты Desirial® Plus (2,1%) в предварительно наполненном шприце 2мл. – 1 шт.
2. Игла в футляре 27Gx1 (0,4мм x 13мм) – 2 шт.
3. Кондон 18G80mm (1,3-1,5мм x 80мм) – 1 шт.
4. Игла для прокола 19G (1,0-1,1мм x 25мм), производителя «Бентон Дункинсон С.А.», Испания, RU №ФС 2011/08975 - 1 шт.
5. Этикетка с номером партии – 2 шт.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Laboratoire Vivacy s.a.s. (Laboratoire VIVACY) / Лаборатория Вивакс эс.эй.с. (Лаборатория ВИВАЦИ), Франция 252 rue Douglas Englebart, Arcamont Technopolis, 74160 Arcamont, France/252 rue Douglas Englebart, Arcamont Technopolis, 74160 Аркант, Франция

Адрес места производства:

- 252 rue Douglas Englebart, Arcamont Technopolis, France/252 rue Douglas Englebart, Arcamont Technopolis, 74160 Аркант, Франция

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ БОС» (ООО «ФАРМ БОС») 119602, г. Москва, ул. Мининский проспект, Олимпийский Аtrium, д.1, корп.1 пом. III, ком.1-5, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 934-17-01, e-mail: farmbos2005@mail.ru, website: www.farmbos.ru

Регистрационное удостоверение №

Несомозадающее изделие относится к товару Класс А, используемое – Класс В и должно утилизироваться местными трудно-правовыми организациями в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организациям и производству санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Гарантируется всеми видами крайнего транспорта при соблюдении условий хранения.

Syringes	STERILE	1	1x 2ml
Canula	STERILE EO	1x 18G80mm	
Needles	STERILE R	2x 27G 1/2"	
	STERILE EO	1x 19G1"	

LOT GBB21067J/E1

2023 - 08

1 x 2 mL

Desirial® plus

Laboratoire VIVACY
252 rue Douglas Englebart
Arcamont Technopolis
74160 ARCAMONT - FRANCE
Made in France

CE 0344

VIVACY

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Шесть) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «ФАРМ БСК»

С.М. Бундова

