



Фотографические изображения общего вида и макеты этикеток медицинского изделия:


**«Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями», производства МЕДЕНТИКА
ГмбХ (MEDENTiKA GmbH), Германия**

Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями:

I Состав:

1. Абатменты:

1.1 Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента:

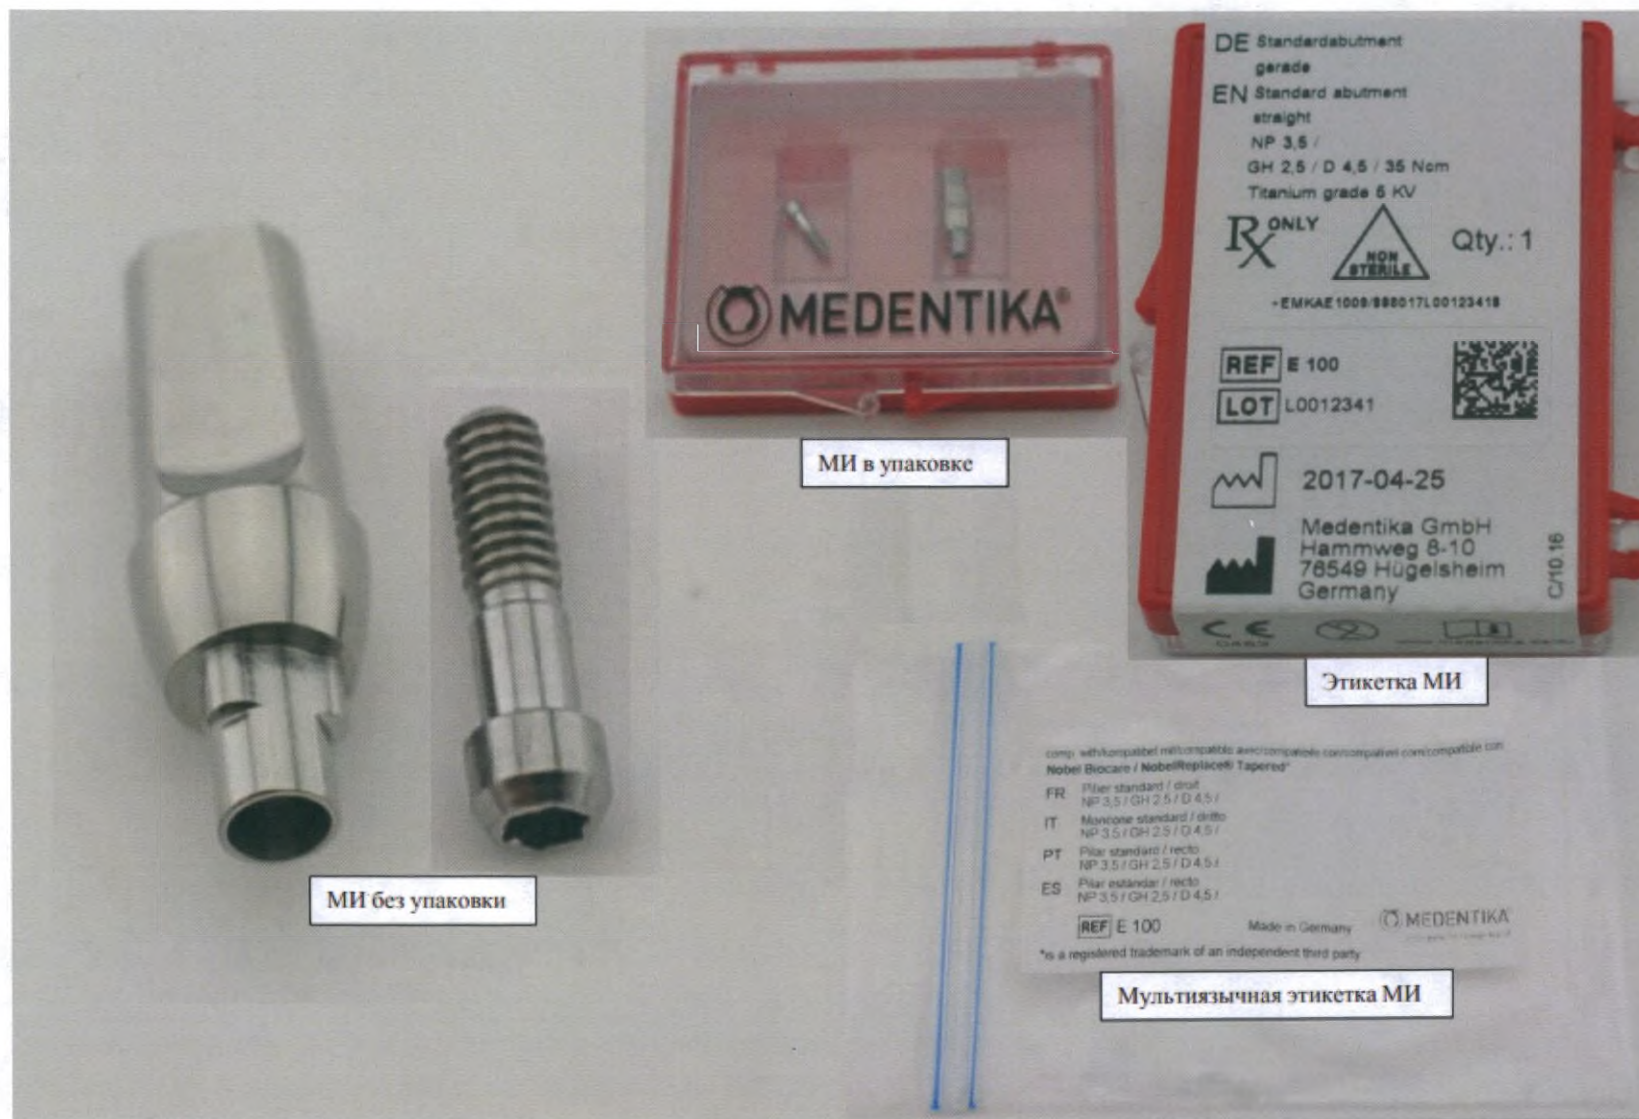



MEDENTIKA®

DE Standardabutment / gerade
EN Standard abutment / straight
FR Pilier standard / droit
IT Moncone standard / dritto
PT Pilar standard / recto
ES Pilar estándar / recto
/ GH 1.0/4.5 / D 5.3 / 20 Ncm
Titanium Grade 5
Compatible with: D 3.8
Altatec / Camlog®

 REF C 110-3
LOT L0087088
(0104261574806734)(11)(210624)(10)(L0087088)


MD


Made in Germany  2021-06-24 Qty.: 1
MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE 0483 B03 20
Rx ONLY 


    

is a registered trademark of an independent third party
www.medentika.com/ru

1.2-1.3 Абатмент стандартный угловой 16°, включ инт абатмента

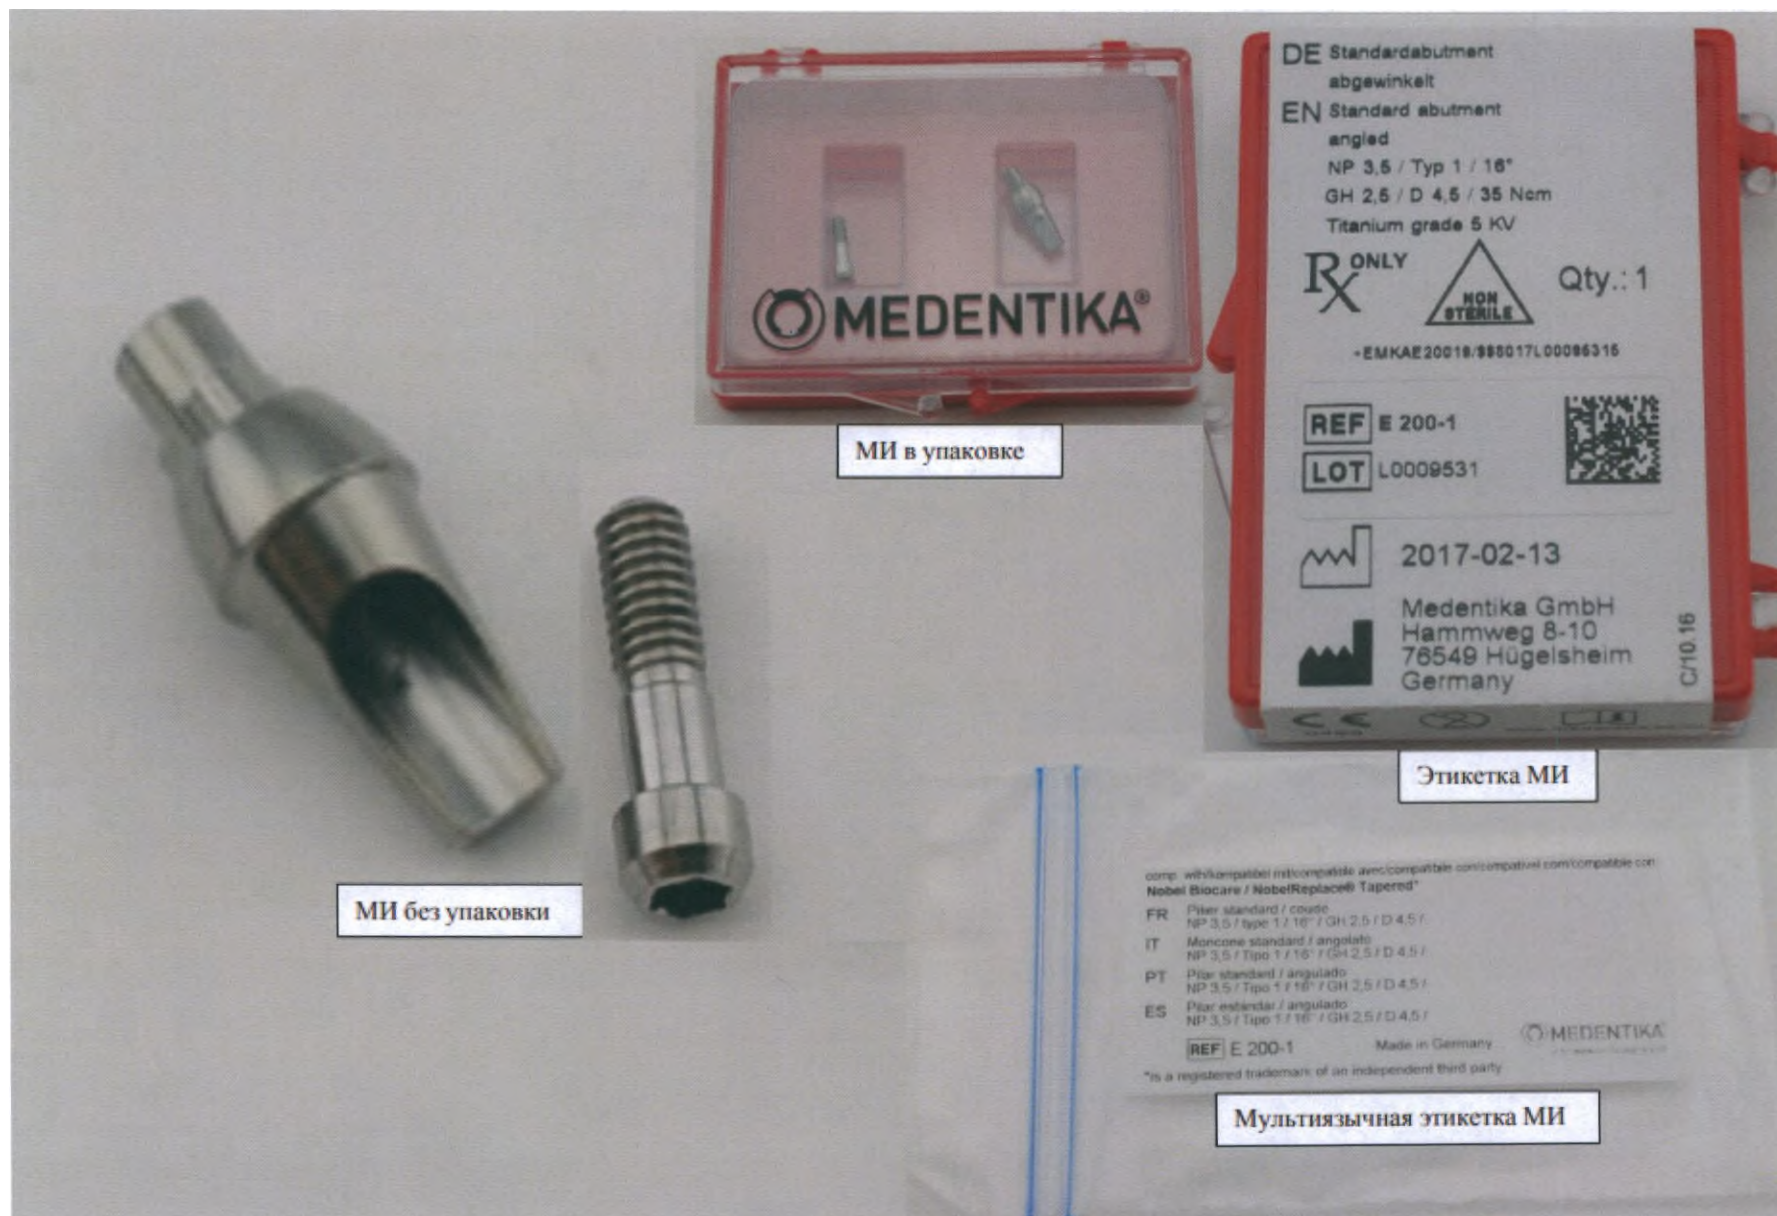

1.4. Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента:

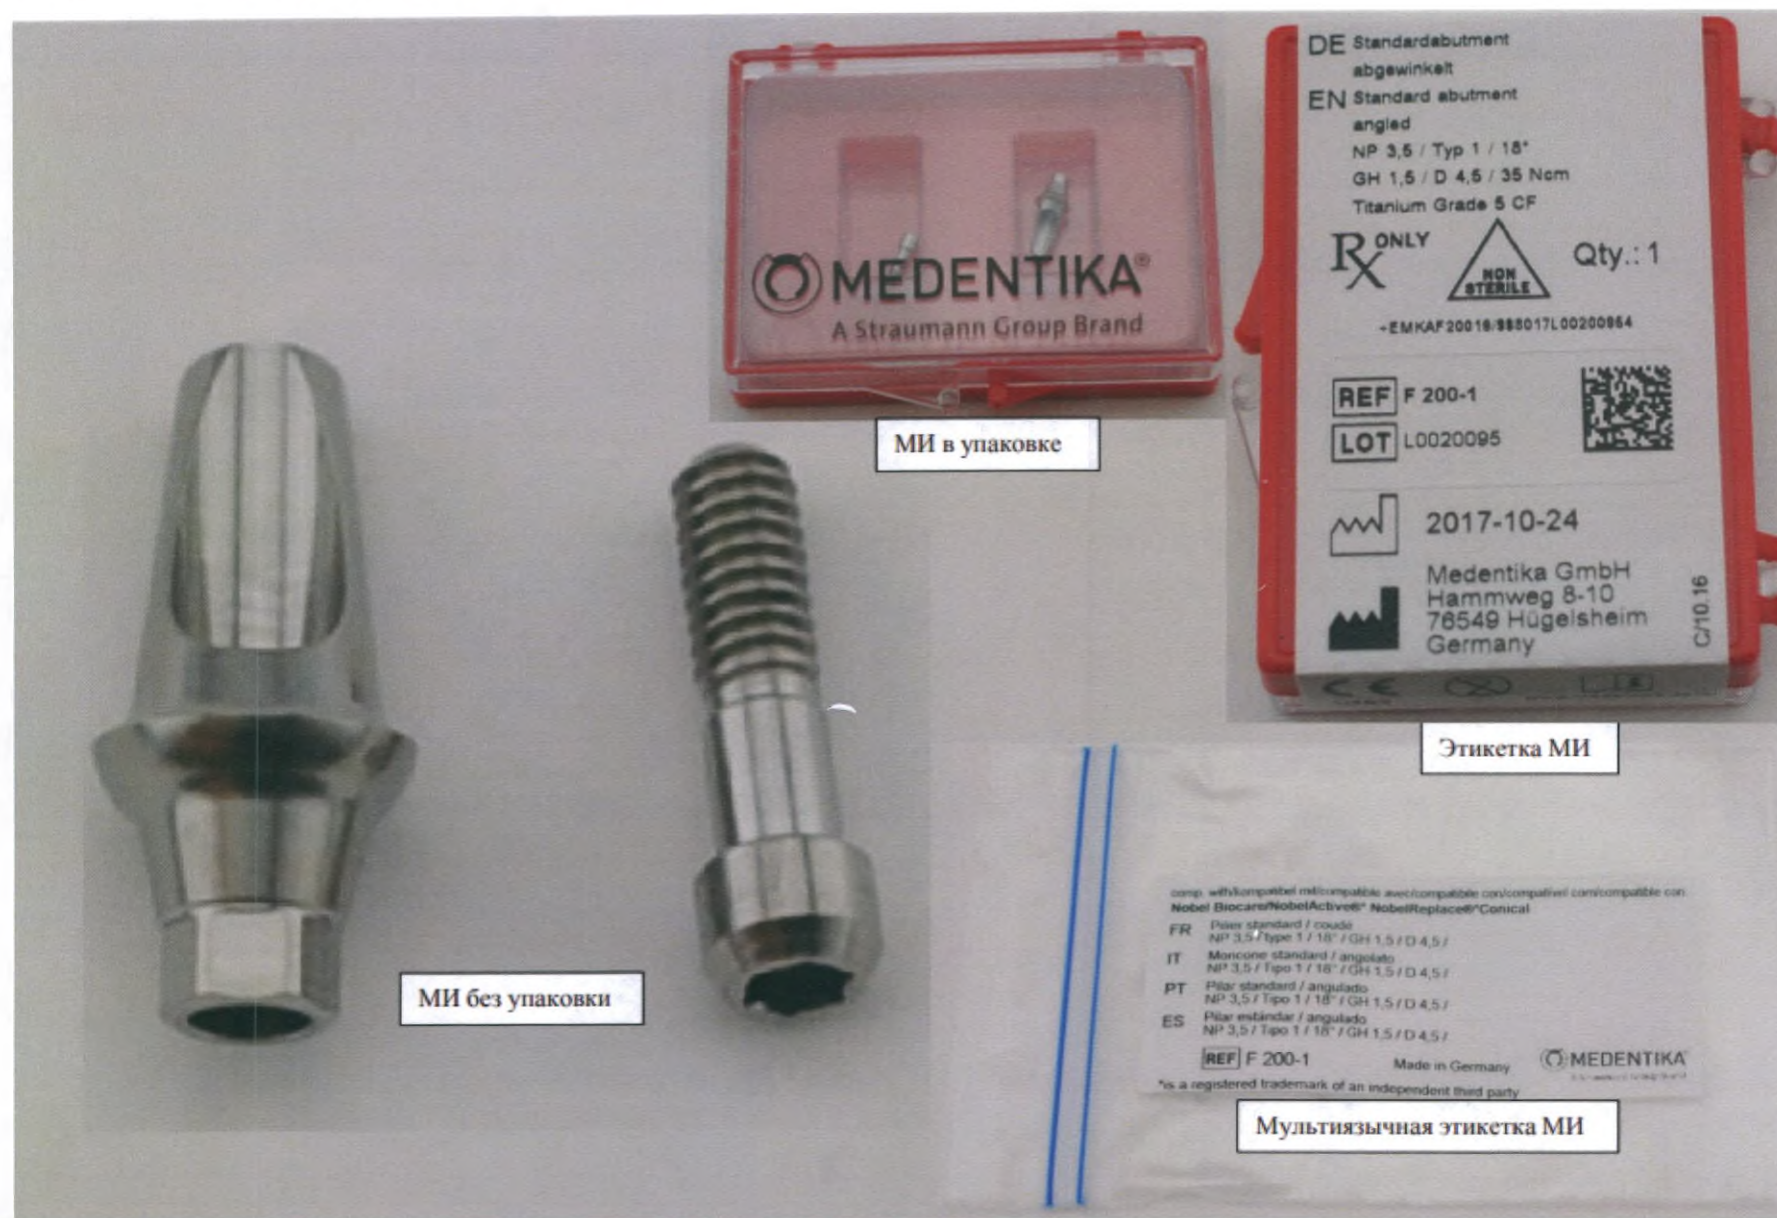

1.4.1. Тип 1:




1.4.2. Тип 2:



1.5. Абатмент стандартный угловой 21°, включая абатмента:



1.6. Абатмент модифицируемый прямой:

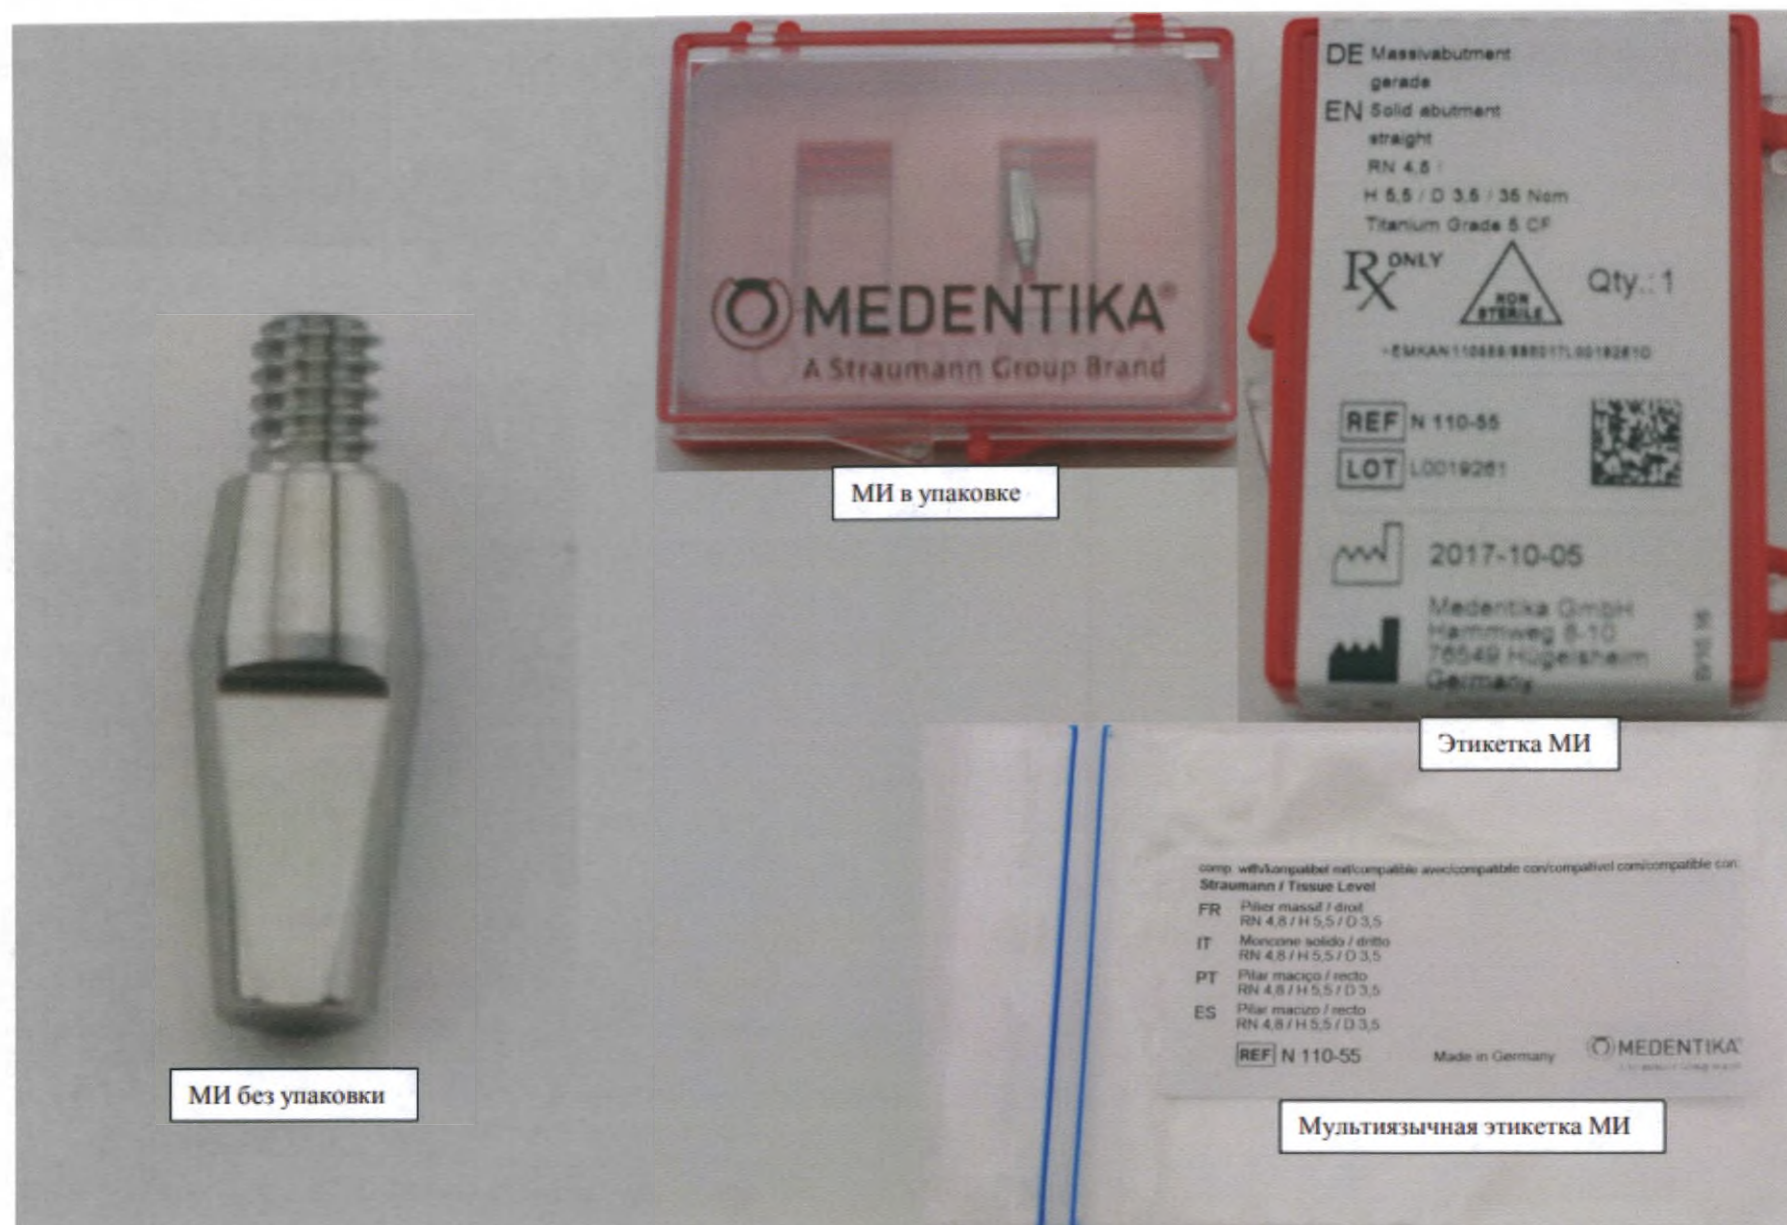

МИ в упаковке

Этикетка МИ

МИ без упаковки

Мультиязычная этикетка МИ

1.7. Абатмент модифицируемый прямой, включаят абатмента и винт лабораторный:



МИ в упаковке

Этикетка МИ



МИ без упаковки



comp. with/compatibel mit/compatible avec/compatible con/compatível com/compatible con:
Nobel Biocare / NobelReplace® Tapered
FR Pilier massif / droit
NP 3,5 / GH 3,5 / D 4,8
IT Moncone solido / dritto
NP 3,5 / GH 3,5 / D 4,8
PT Pilar maciço / recto
NP 3,5 / GH 3,5 / D 4,8
ES Pilar macizo / recto
NP 3,5 / GH 3,5 / D 4,8
REF E 400 Made in Germany MEDENTIKA
*is a registered trademark of an independent third party

Мультиязычная этикетка МИ

1.8-1.9 Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный:



1.10. Абатмент MedentiBASE прямой:


Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки




МИ в упаковке с этикеткой

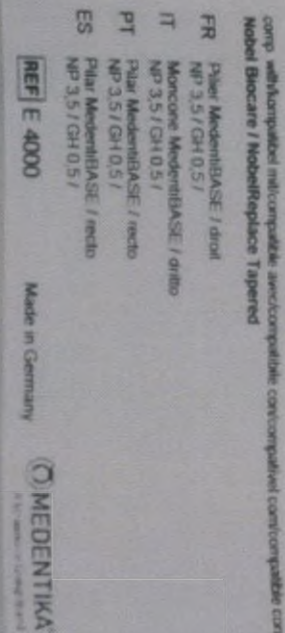

Мультиязычная этикетка МИ

1.11. Абатмент MedentiLOC прямой:

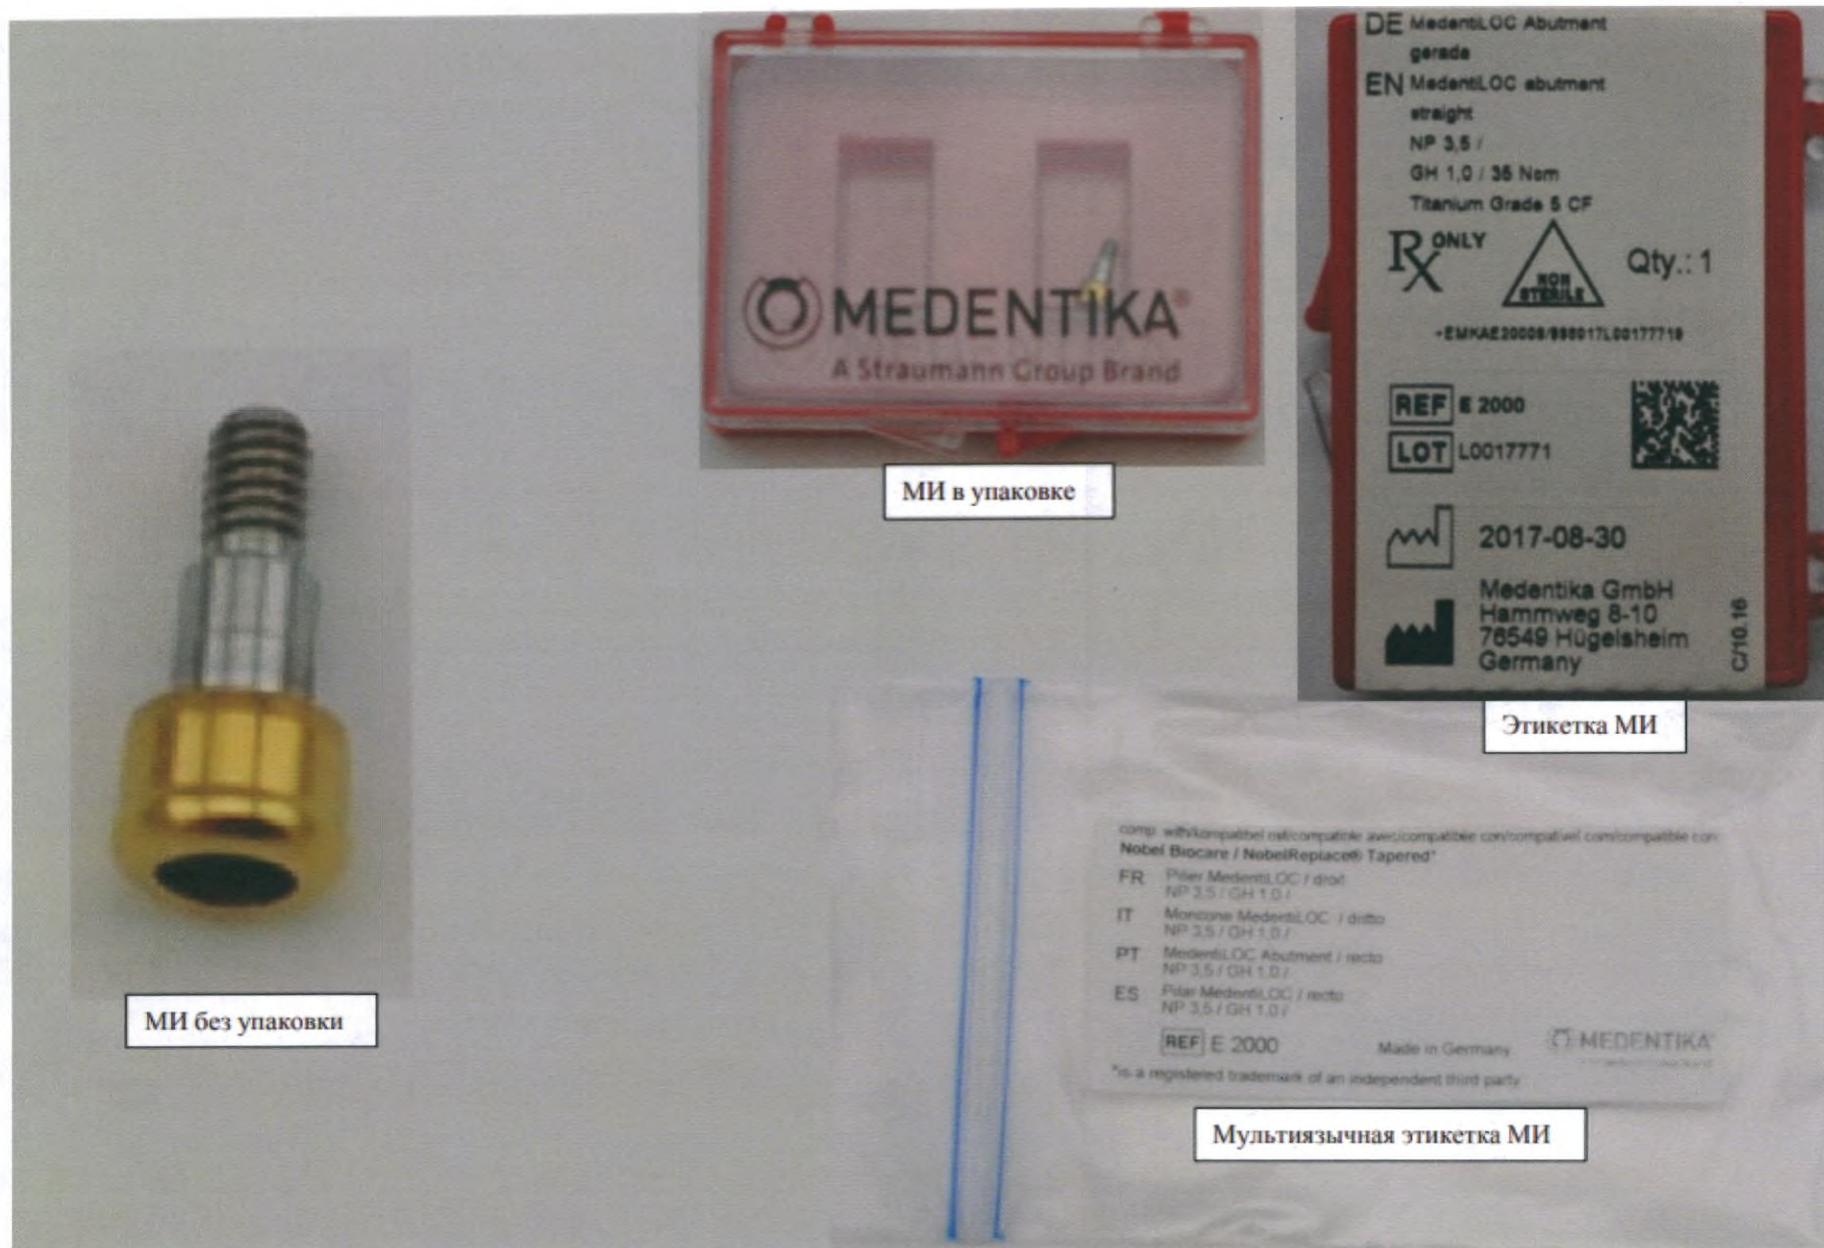



1.12-1.13 Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC:



1.14. Абатмент Novaloc прямой:



МИ без упаковки



МИ в упаковке



Этикетка МИ

comp. with/compatible mit/compatible avec/compatibile con/compatível com/compatible con
Nobel Biocare / NobelReplace® Tapered

FR Piler Novaloc / droit
NP 3,5 / GH 1,0 /

IT Moncone Novaloc / dritto
NP 3,5 / GH 1,0 /

PT Pilar Novaloc / recto
NP 3,5 / GH 1,0 /

ES Pilar Novaloc / recto
NP 3,5 / GH 1,0 /

REF E 6000

Made in Switzerland

 MEDENTIKA

*is a registered trademark of an independent third party

Мультиязычная этикетка МИ



Novaloc abutment
REF MG 6300
LOT L0087142

Novaloc abutment
REF MG 6300
LOT L0087142

MEDENTIKA®

DE Novaloc Abutment / gerade
EN Novaloc abutment / straight
FR Pilier Novaloc / droit
IT Moncone Novaloc / dritto
PT Pilar Novaloc / recto
ES Pilar Novaloc / recto

/ GH 4.0 / 30 Ncm
Titanium Grade 5
Compatible with: Ø 3.5-8.0
Mogagen AnyRidge®

REF MG 6300
LOT L0087142

2021-06-24 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE 0483 B03 20

Made in Switzerland

MD

Rx ONLY

www.medentika.com/ifu

* is a registered trademark of an independent third party

1.15-1.16 Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc:






1.16.2. Тип 2:



1.17. Абатмент Optiloc прямой:

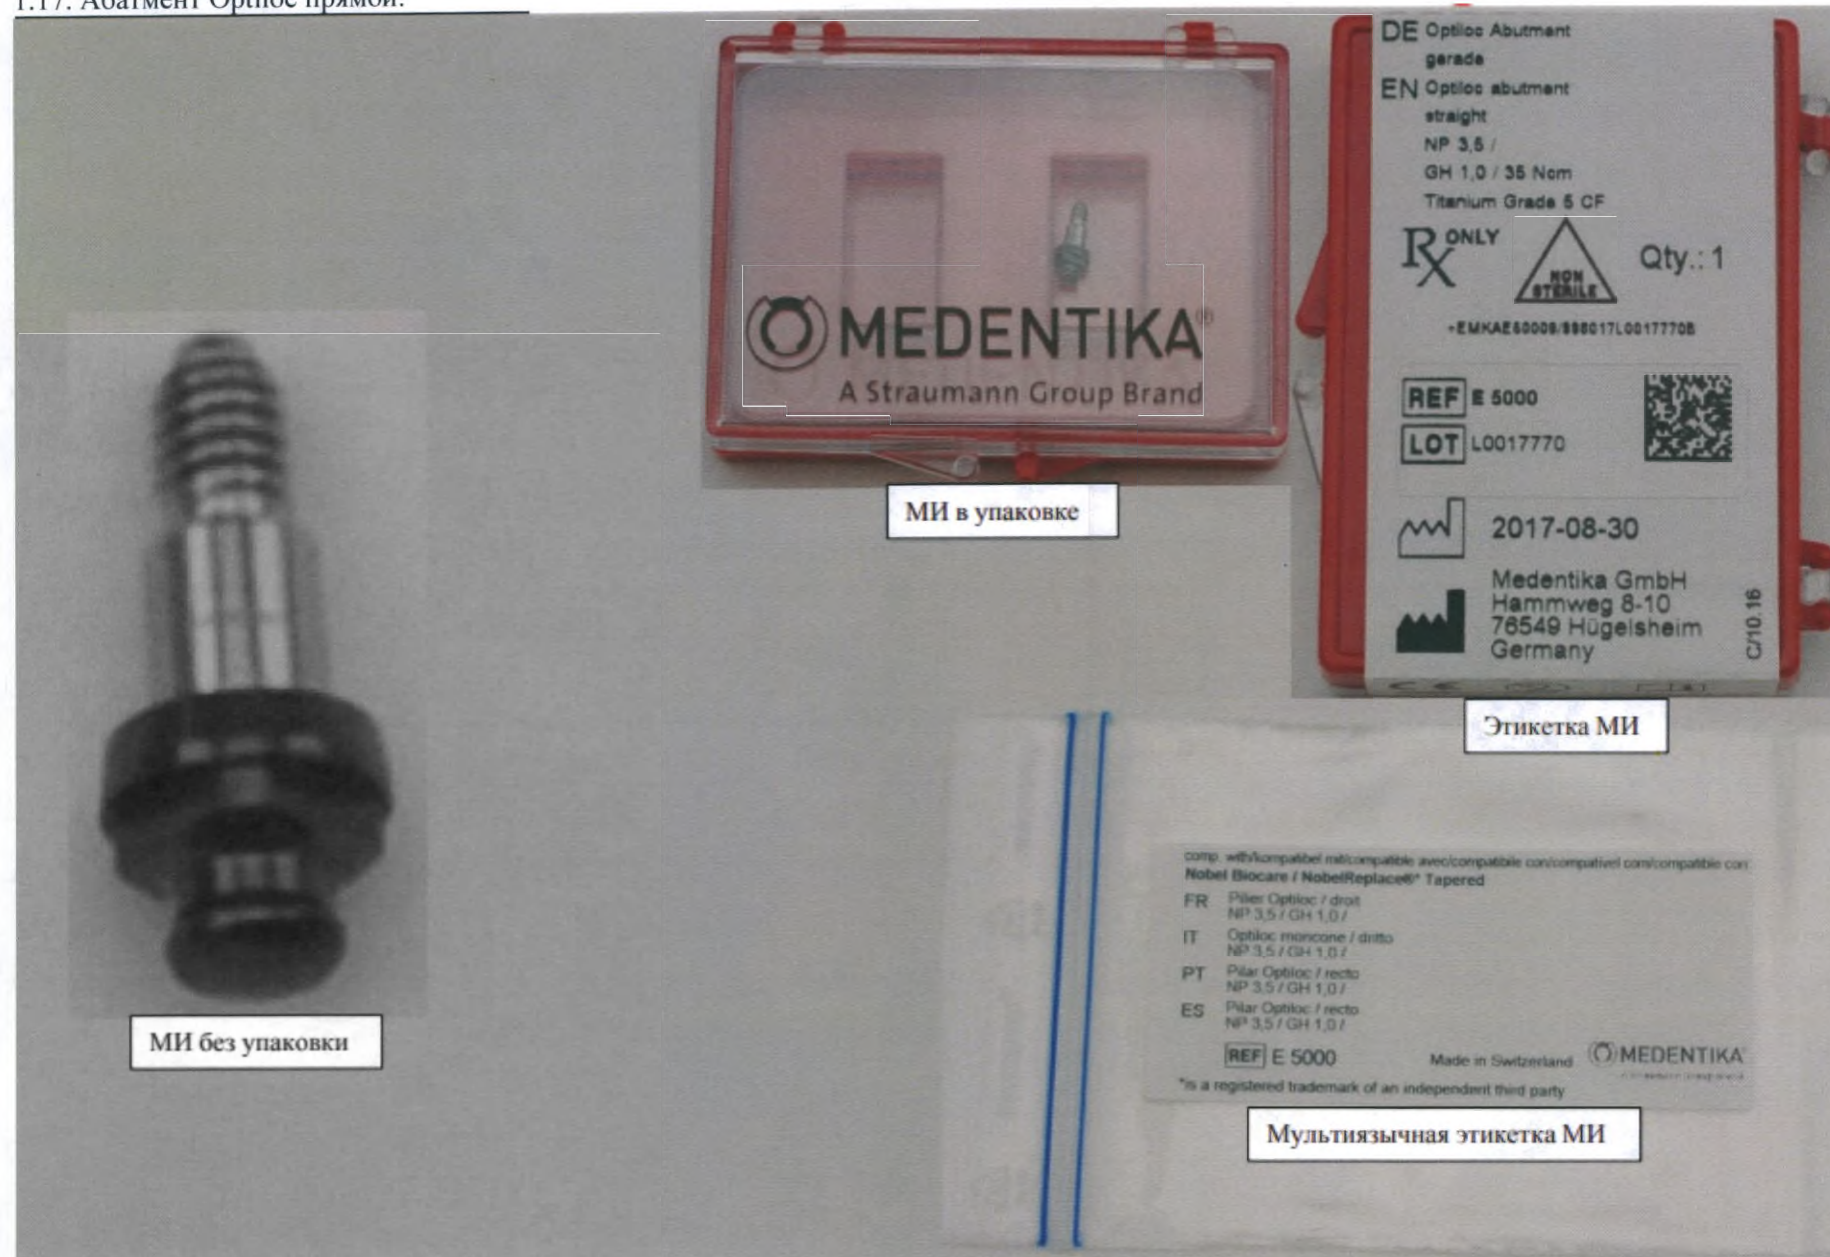

Optiloc Abutment
32 Ncm
REF NE 5400
LOT L0079298

Optiloc Abutment
32 Ncm
REF NE 5400
LOT L0079298



MEDENTIKA®

DE Optiloc Abutment / gerade
EN Optiloc abutment / straight
FR Pilier Optiloc / droit
IT Optiloc moncone / dritto
PT Pilar Optiloc / recto
ES Pilar Optiloc / recto
/ GH 5.0 / 32 Ncm
Titanium Grade 5 CF
Compatible with: SP D 3.5-6.5
NEOSS® - ProActive®

REF NE 5400
LOT L0079298

(01)04251674864780(11)210206(10)L0079298

2021-02-05 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany


CE 0483 B03.20

MD


is a registered trademark of an independent third party

www.medentika.com/ifu

1.18. Абатмент РОС, включая винт абатмента:

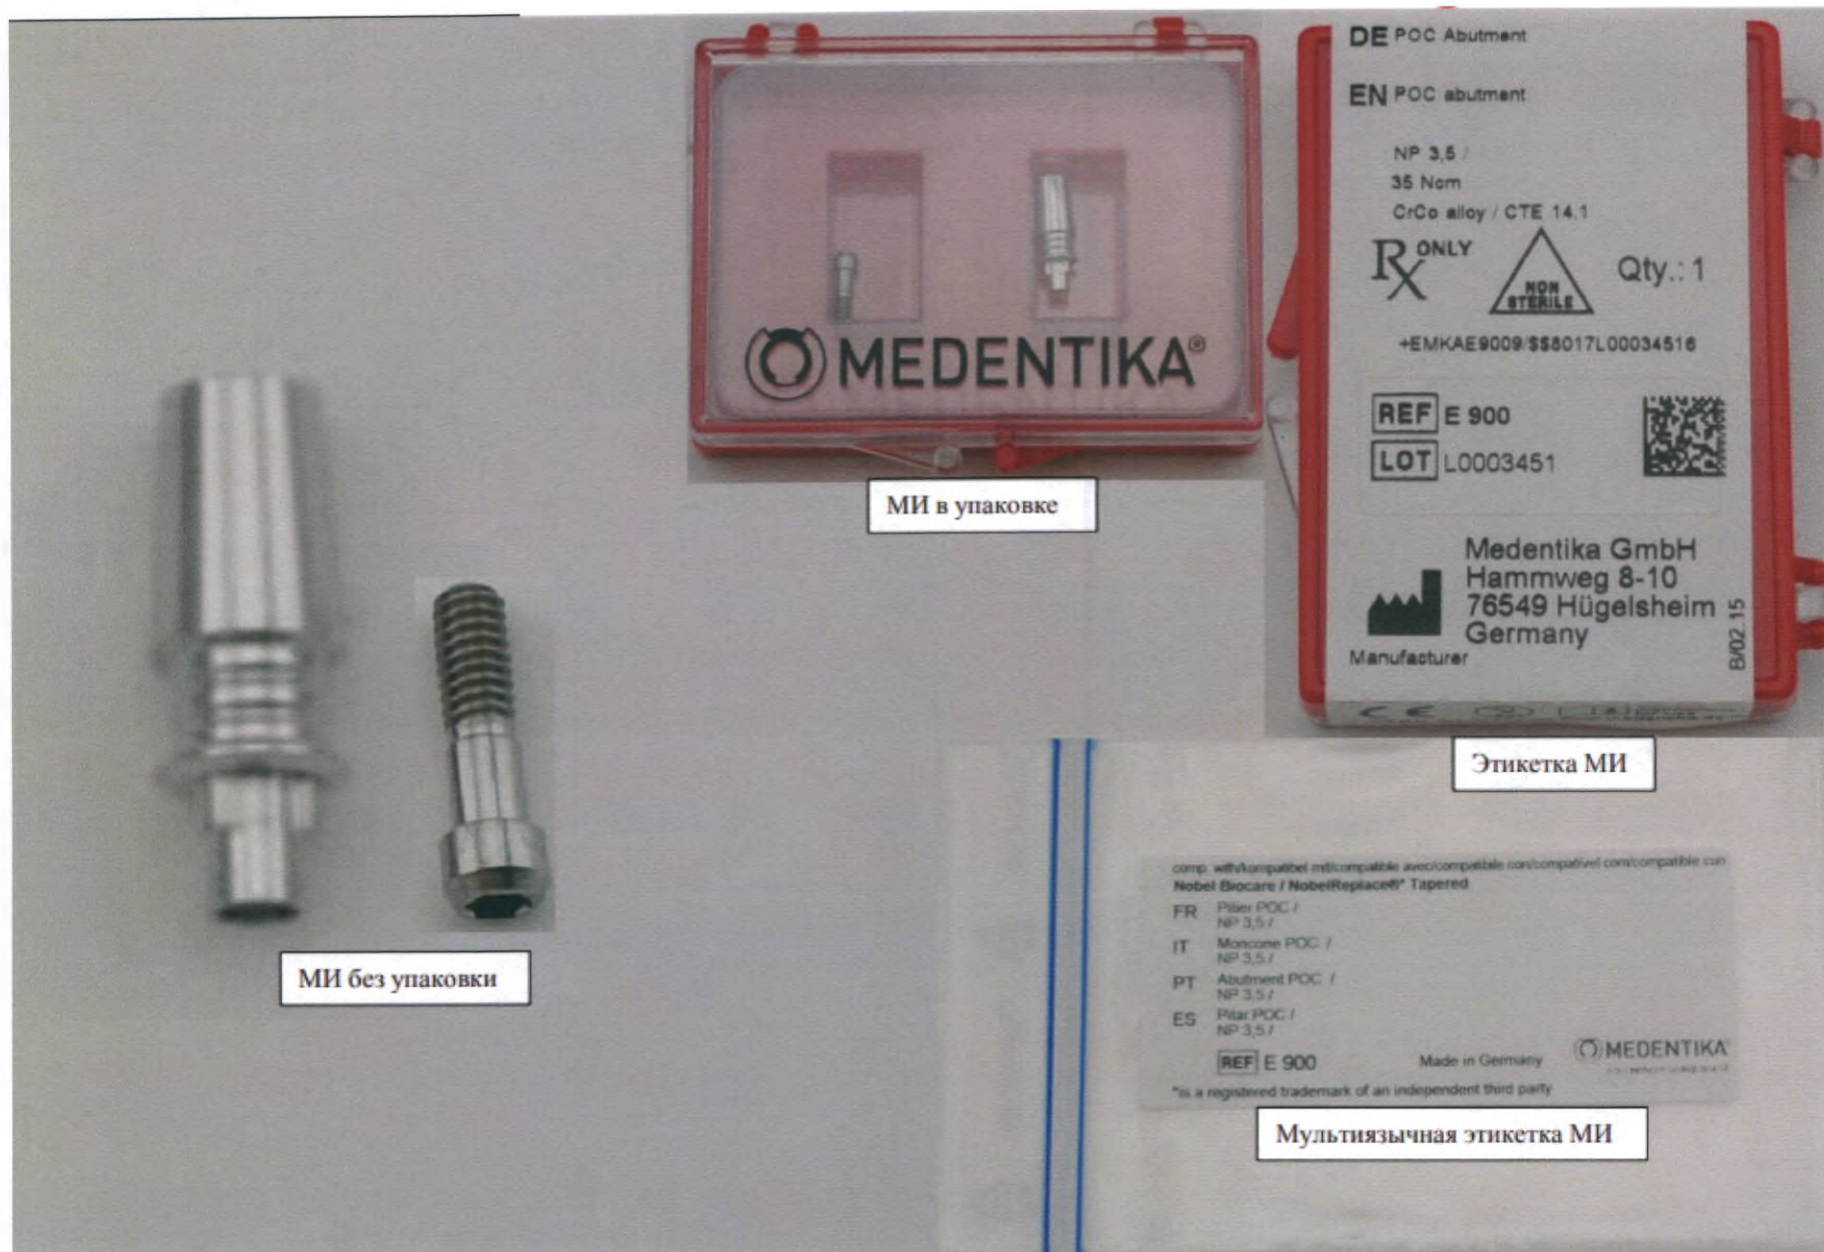


1.19. Абатмент кобальт-хромовый приливаемыйротационный, включая винт абатмента:

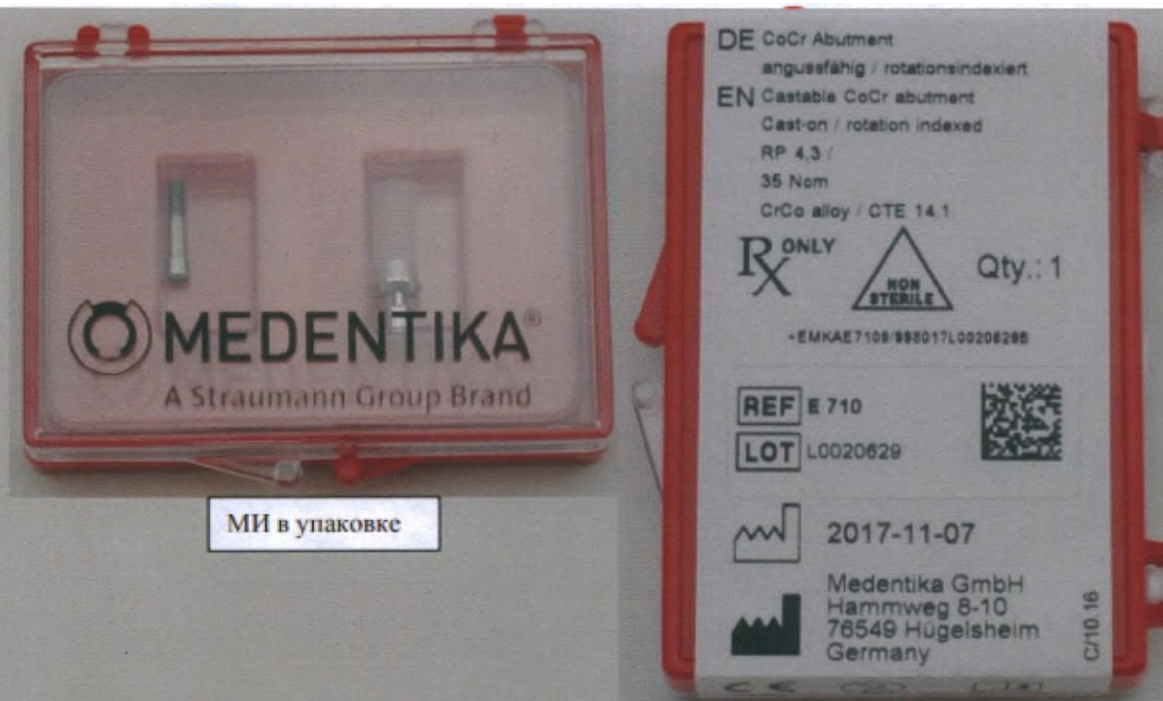


МИ в упаковке

Этикетка МИ

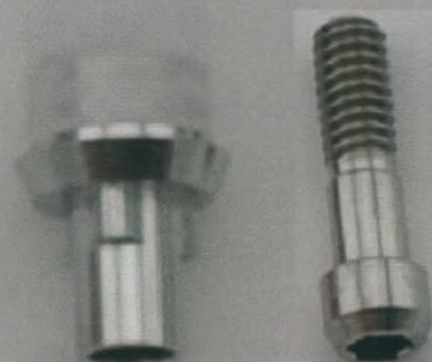


МИ без упаковки

comp. with/compatible mit/compatible avec/compatible con/compatível com/compatible con
Nobel Biocare / NobelReplace® Tapered
FR Pilier CoCr / Coulee possible / rotation indexée
RP 4,3 /
IT Moncone CoCr / Per sovrapposizioni / con indicatore di rotazione
RP 4,3 /
PT Pilar CoCr / sobrefundível / indexado p/ rotação
RP 4,3 /
ES Pilar CoCr / Colado / con indexación de rotación
RP 4,3 /
REF E 710 Made in Germany 
*is a registered trademark of an independent third party

Мультиязычная этикетка МИ


1.20. Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента:

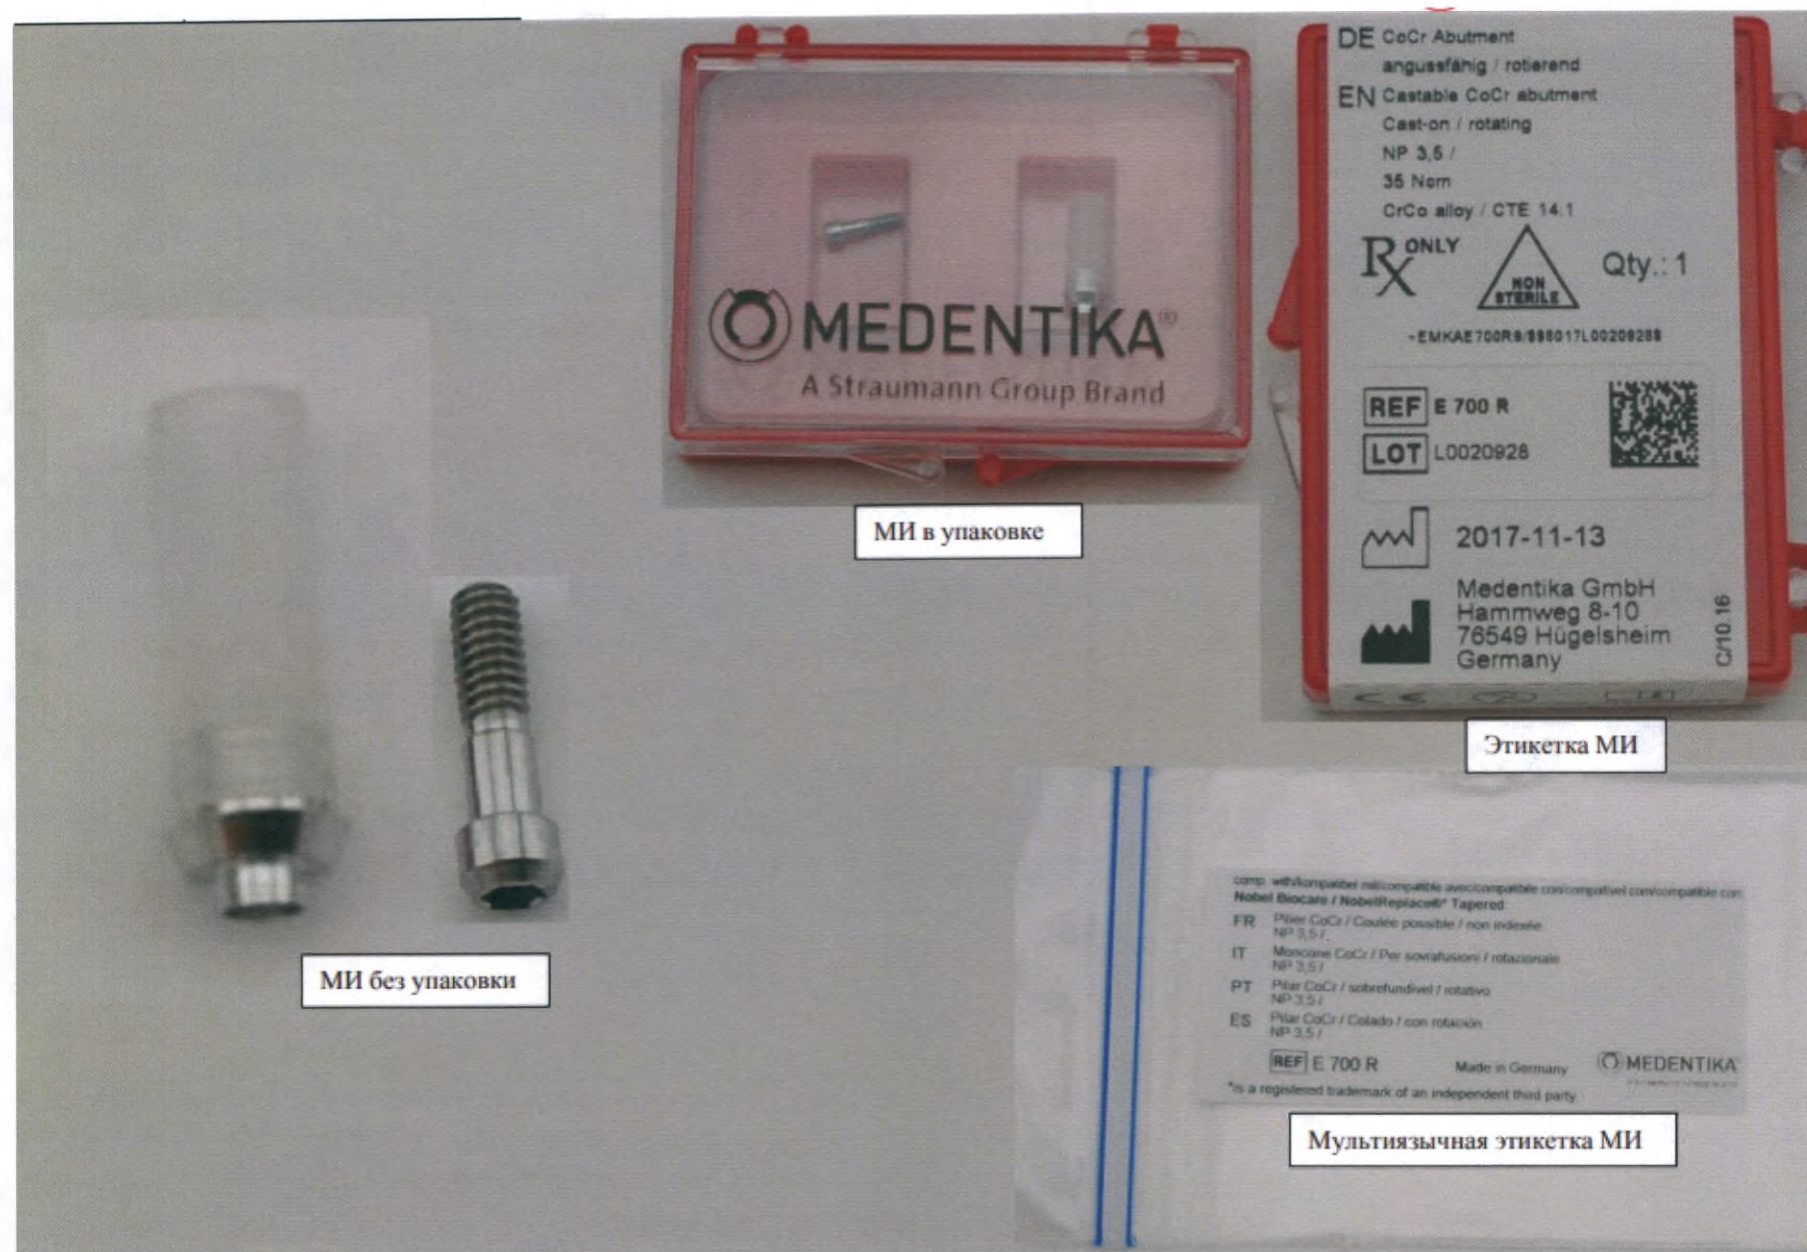

1.21. Абатмент PreFace, включая винт абатмента:




1.23. Абатмент временный угловой, включая винт абатмента:

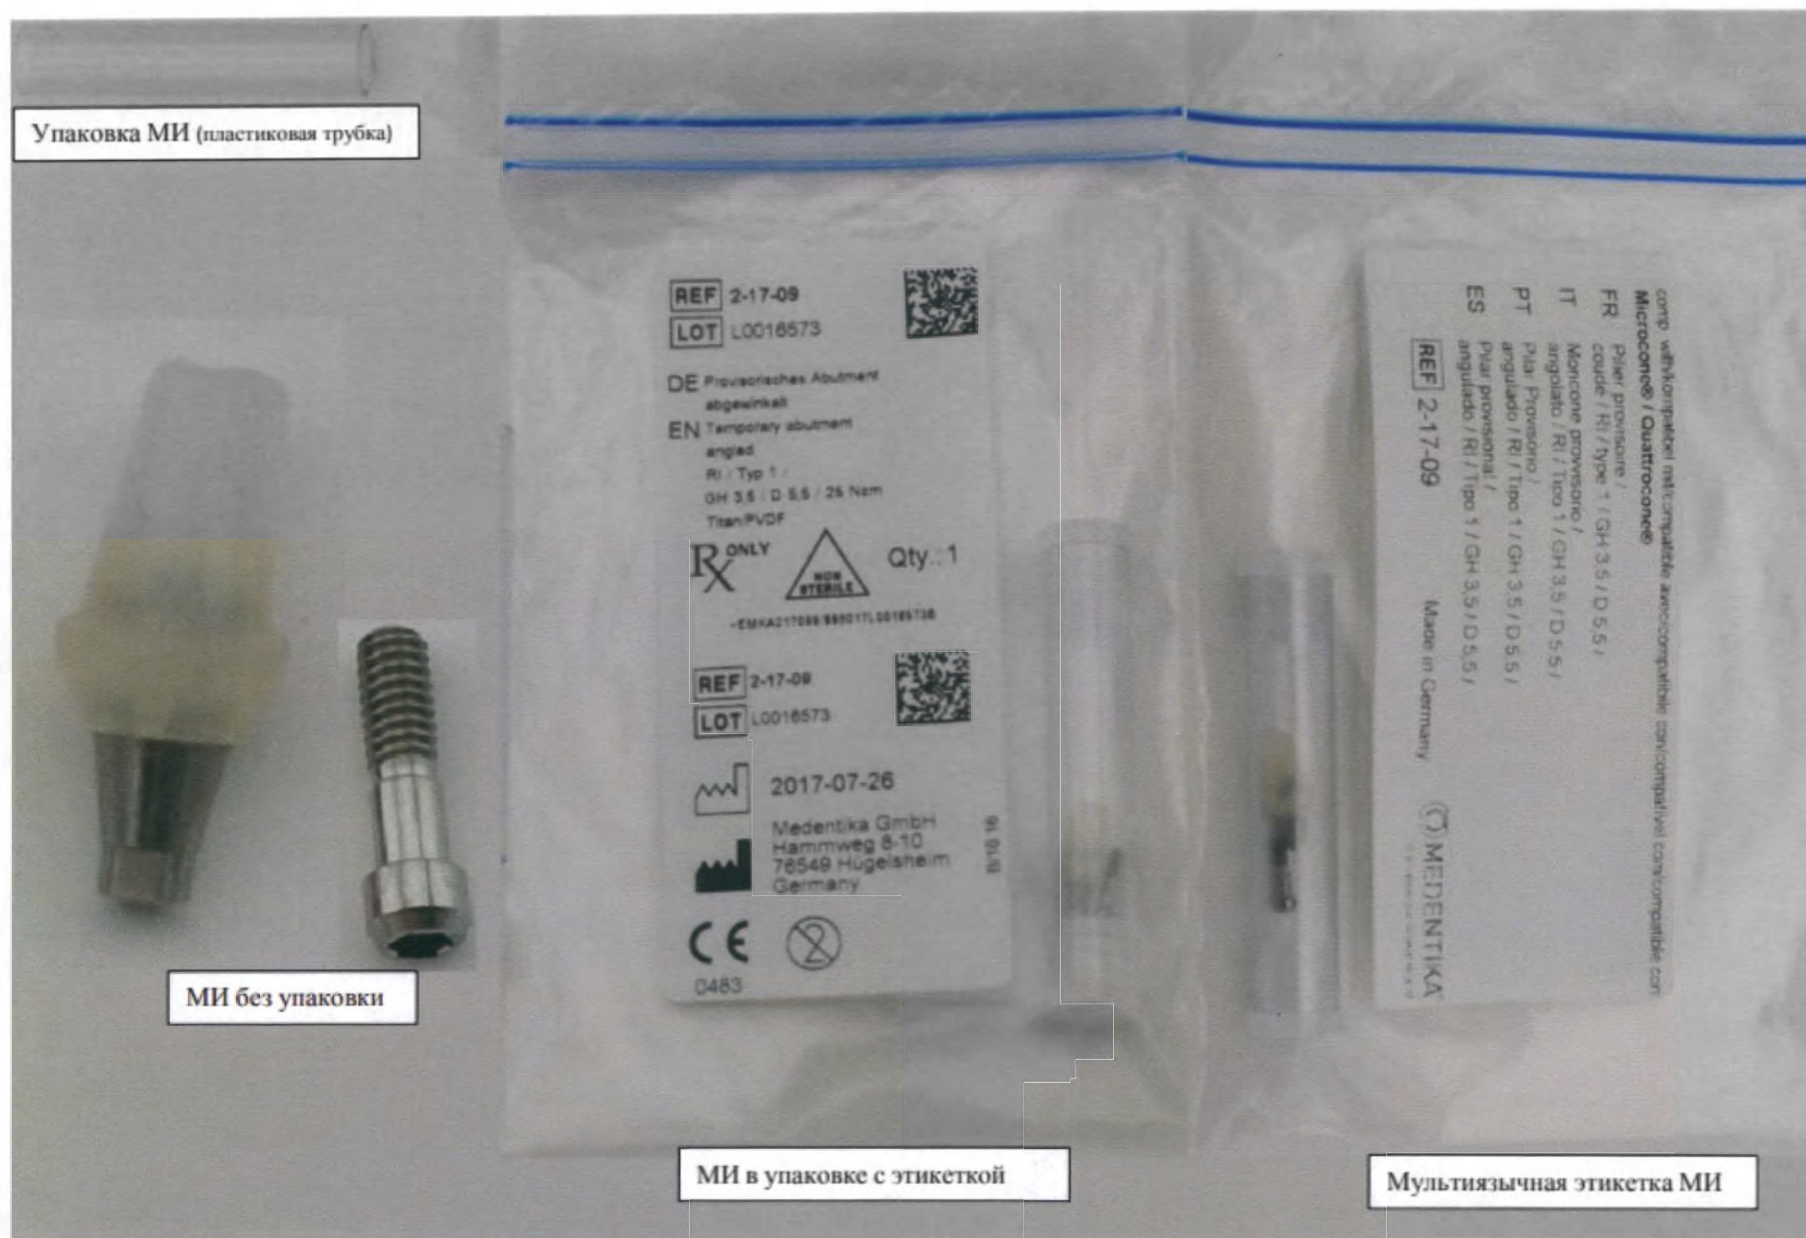

1.24. Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)

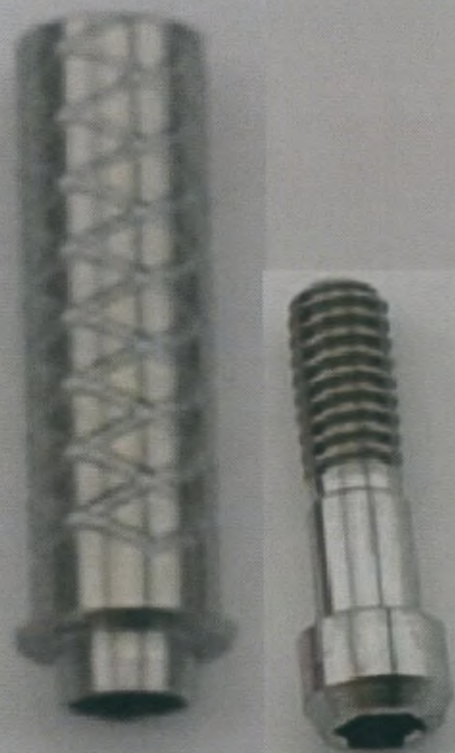

МИ без упаковки

REF E 3700
LOT L0009089

DE Provisorisches Abutment
rotierend

EN Temporary abutment
rotating

NP 3.5
35 mm

Titanium grade 5 HV

RX ONLY

STERILE

Qty: 1

-E81A62700A-900171L-00000000

REF E 3700
LOT L0009089

2017-02-01

Medentika GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE

0483

МИ в упаковке с этикеткой

comp. with/compatible microcapsule dimensions: con/compatible con/capsule dimensions: comp.
Noble Bioscare / NobelBioscare Tapered

FR Plate provisoire /
non rotative / NP 3.5 /
IT Marcione provvisorio /
rotazionale / NP 3.5 /
PT Abutment temporário /
rodante / NP 3.5 /
ES Pílar provisional /
con rotación / NP 3.5 /

REF E 3700

Made in Germany

MEDENTIKA

Мультязычная этикетка МИ

1.25. Абатмент временный прямой, включая винт абатмента:




1.26. Абатмент временный, включая винт абатмента.


Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки

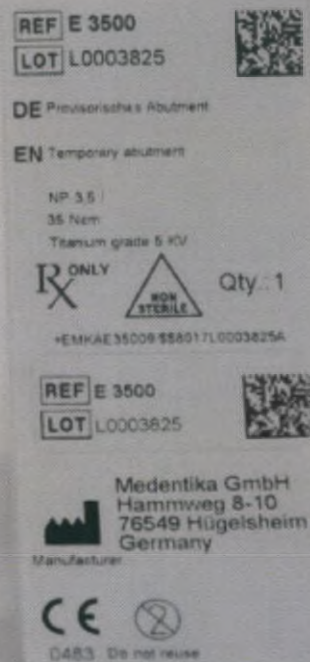

МИ в упаковке с этикеткой

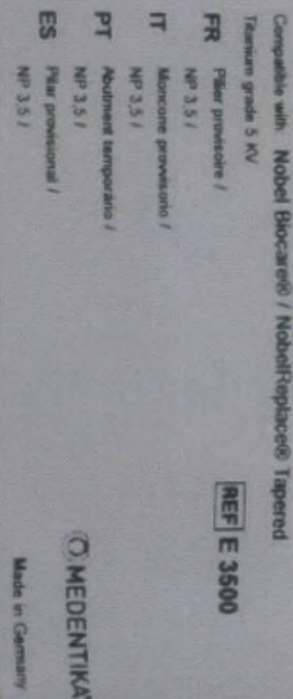

Мультязычная этикетка МИ

1.27. Абатмент TI-Forms для Ceramill:



1.28. Абатмент TI-Forms для М-серии:



2. Винты, в вариантах исполнения:

2.1. Винт углового абатмента MedentiLOC:



МИ без упаковки

МИ в упаковке с этикеткой

Мультязычная этикетка МИ

Abutment screw
REF N 88-ET
LOT L0087137

Abutment screw
REF N 88-ET
LOT L0087137

MEDENTIKA

DE Abutmentschraube
EN Abutment screw
FR Vis de pilier
IT Vite per moncone
PT Parafuso para pilar
ES Tornillo de pilar
M1.6 / 36 Nm
Titanium Grade 5
Compatible with:
Straumann / Tissue Level

REF N 88-ET
LOT L0087137

2021-06-24
MEDENTIKA
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

MEDENTIKA

DE Abutmentschraube
EN Abutment screw
FR Vis de pilier
IT Vite per moncone
PT Parafuso para pilar
ES Tornillo de pilar
M1.6 / 36 Nm
Titanium Grade 5
Compatible with:
Straumann / Tissue Level

REF N 88-ET
LOT L0087137

1914055174030781110198241814087137


2021-06-24 Qty.: 1


MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

Made in Germany
! X ONLY
STERILE

www.medentika.com/ru

2.3. Винт абатмента:

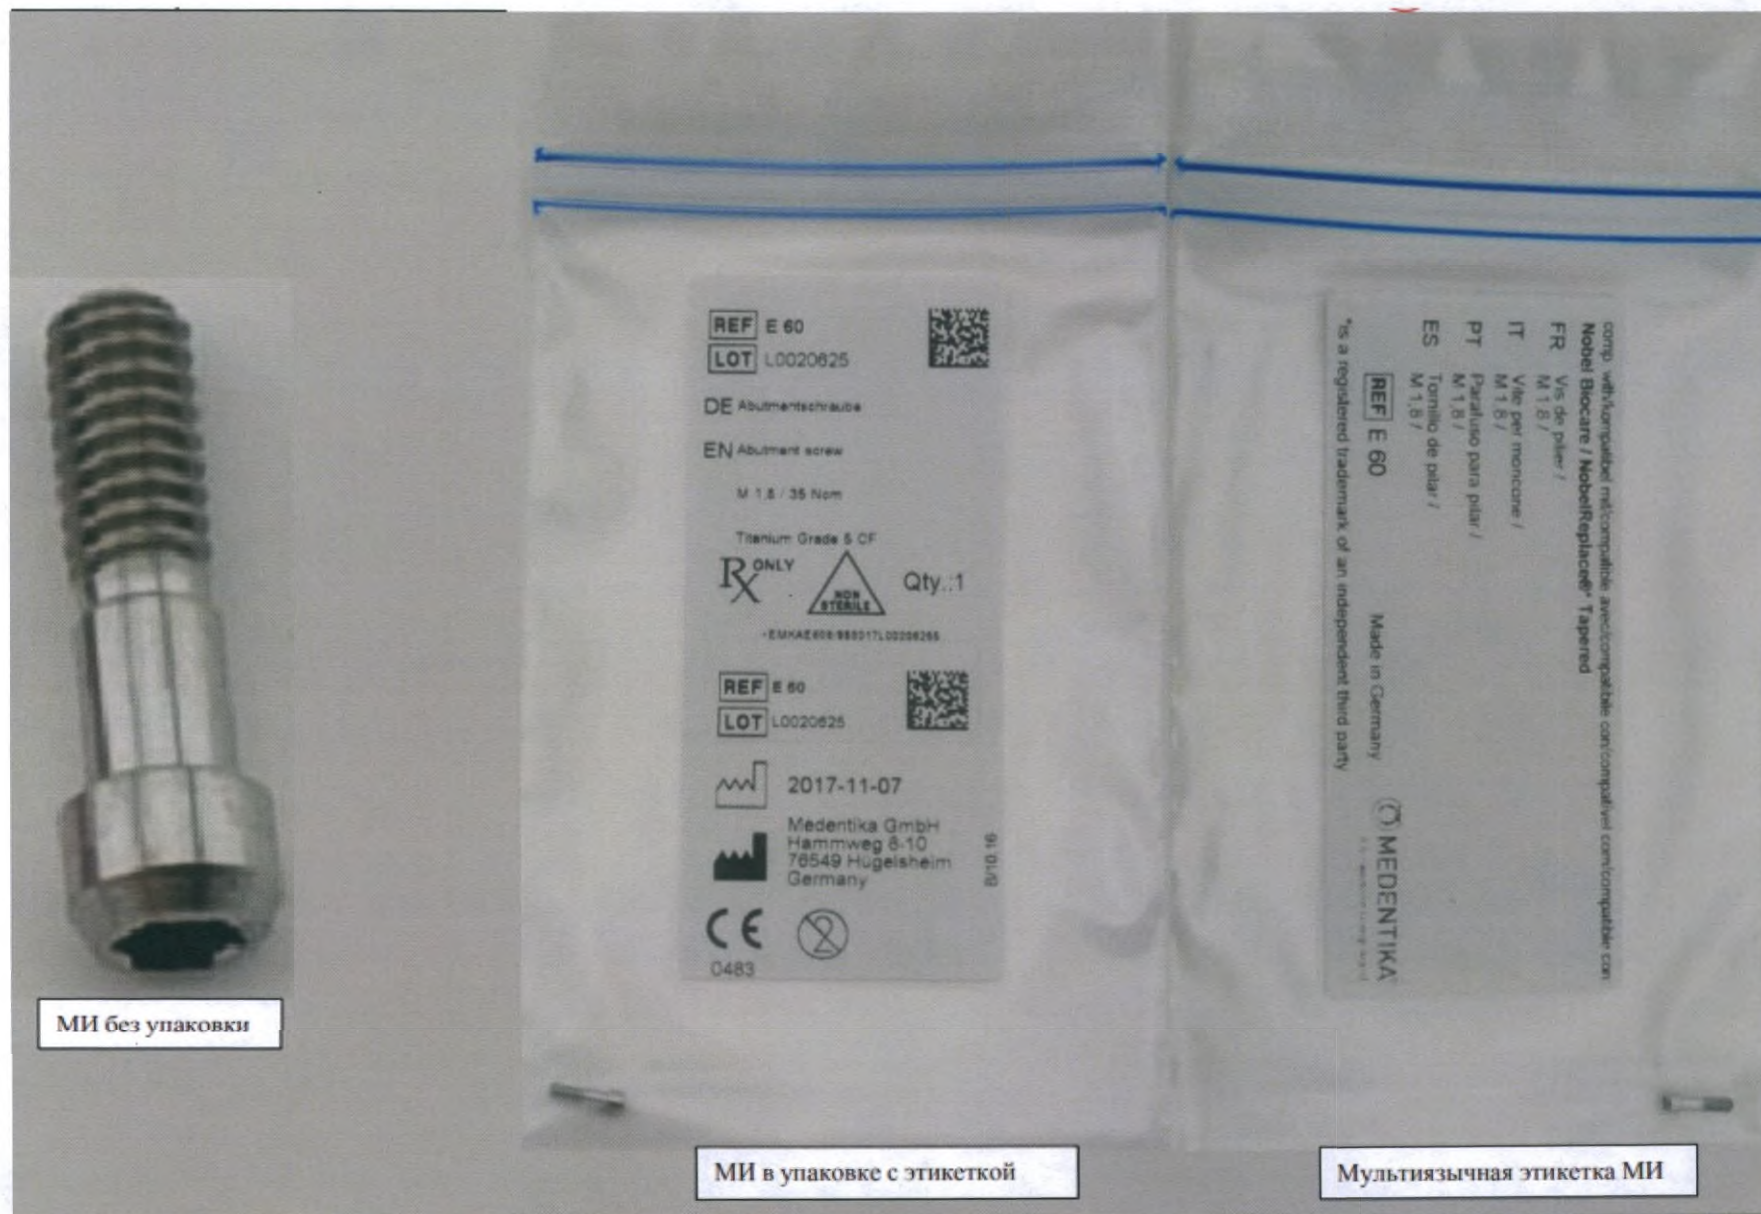

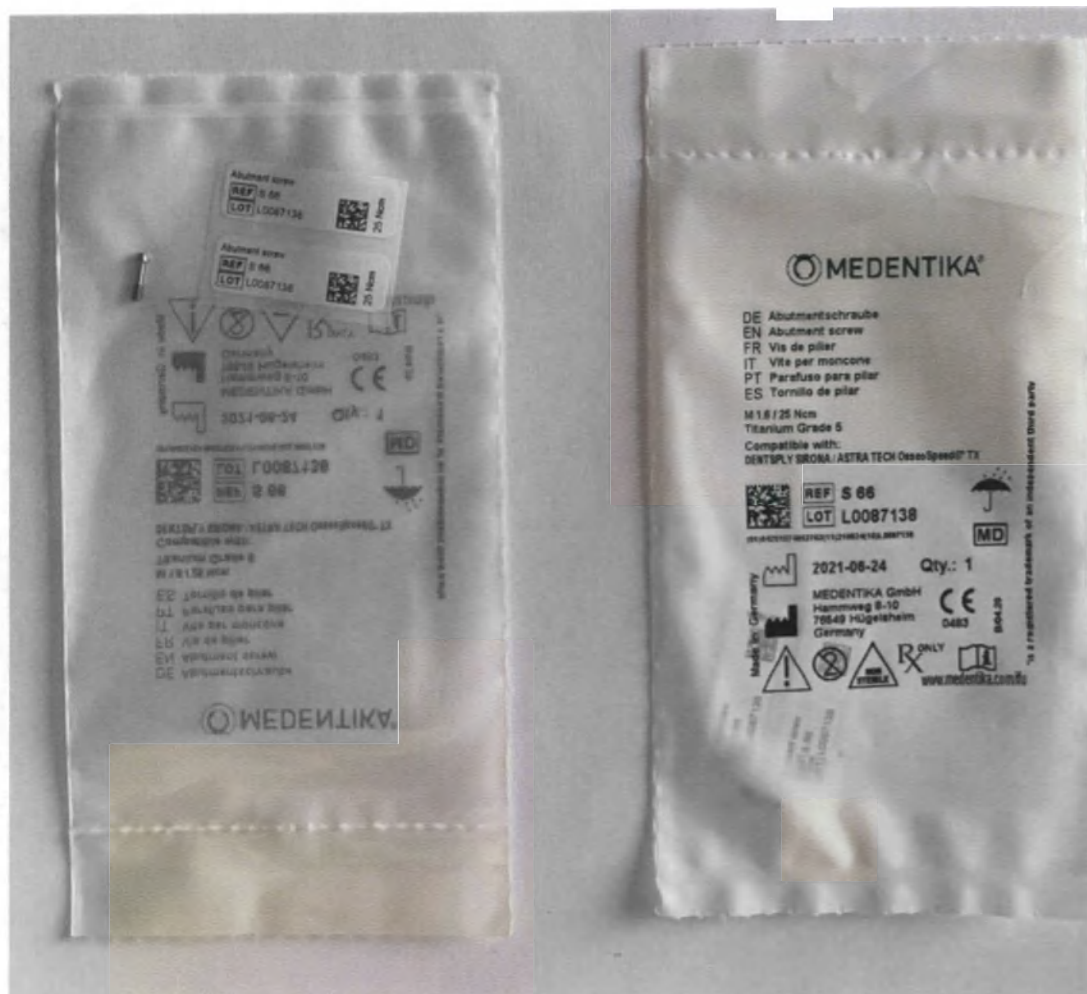

[illegible]



2.5. Винт абатмента Multi-unit:


Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

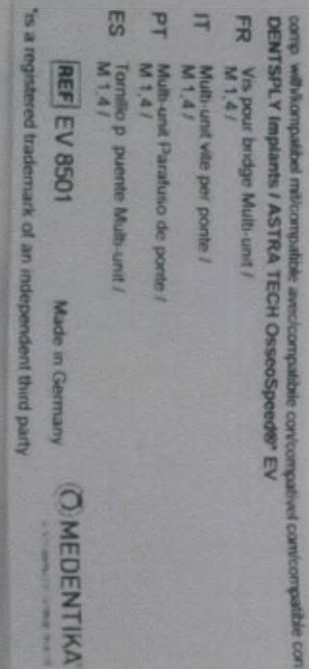

Мультиязычная этикетка МИ

MEDENTIKA®

DE Multi-unit Brückenschraube
 EN Multi-unit bridge screw
 FR Vis pour pont Multi-unit
 IT Vite per ponte Multi-unit
 PT Multi-unit Parafuso de ponte
 ES Tornillo p. puente Multi-unit

M1.4115 Ncm
 Titanium Grade 5
 Compatible with:
 MICROCONE / QUATTROCONE

REF 0-31-02-ET
 LOT L0087131

2021-06-24 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
 Hammweg 8-10
 78649 Hügelsheim
 Germany

Made in Germany

MD

CE

0483

04.20

ONLY

STERILE

www.medentika.com

MEDENTIKA®

DE Multi-unit Brückenschraube
 EN Multi-unit bridge screw
 FR Vis pour pont Multi-unit
 IT Vite per ponte Multi-unit
 PT Multi-unit Parafuso de ponte
 ES Tornillo p. puente Multi-unit

M1.4115 Ncm
 Titanium Grade 5
 Compatible with:
 MICROCONE / QUATTROCONE

REF 0-31-02-ET
 LOT L0087131

2021-06-24 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
 Hammweg 8-10
 78649 Hügelsheim
 Germany

Made in Germany

MD

CE

0483

04.20

ONLY

STERILE

www.medentika.com

2.6. Винт-заглушка MedentiBASE:


Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

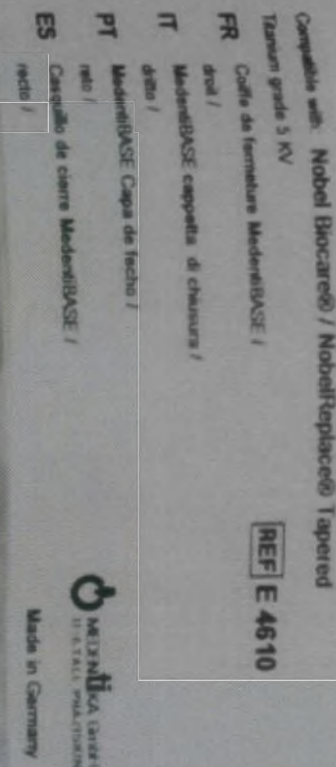

Мультиязычная этикетка МИ

2.7. Винт-заглушка Multi-unit:





2.8. Винт-патрица MedentiLOC для мостовидного протеза:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки

REF 2000
LOT L0021430

DE MedentiLOC Schraubpatriz
Stange /
EN MedentiLOC screw patriz
Screw /
M 2.0 /
35 Nm
Titanium Grade 5 CP

RX ONLY  Qty.: 1

-EMKA00008 985017/0031430P

REF 2000
LOT L0021430

2017-11-22

Medentika GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE 0483   www.medentika.de/tu

C/10 16

МИ в упаковке с этикеткой

comp. with/compatibile /mésocompatible /medicompabile /compensabile /compensabile con:

FR Patriz mâle pour vis MedentiLOC / Barres /
M 2.0 /
IT Patrizia a vite MedentiLOC / Barre /
M 2.0 /
PT MedentiLOC Macho roscaado / Barras /
M 2.0 /
ES Macho roscaado MedentiLOC / Barras /
M 2.0 /

REF 2000

Made in Switzerland

 MEDENTIKA

Мультиязычная этикетка МИ



2.9. Винт-патрица Novaloc для мостовидного протеза:





2.10. Винт-патрица Optiloc для мостовидного протеза:



3. Колпачки:

3.1. Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ



3.2. Колпачок Multi-unit титановый, включая винт компонента Multi-unit:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой


Мультязычная этикетка МИ

3.3-3.4 Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента Mede.....ASE:



3.5. Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)

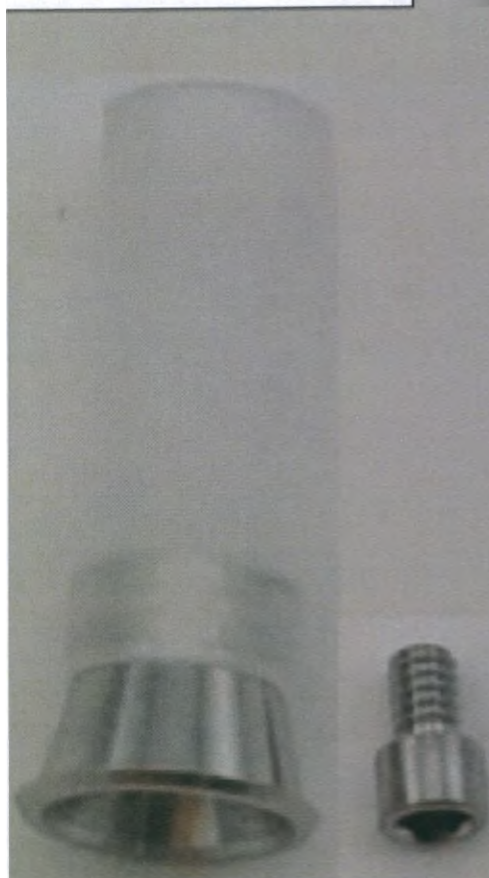

МИ без упаковки




МИ в упаковке с этикеткой


Мультиязычная этикетка МИ




3.6. Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных (в комплекте 5 шт.):

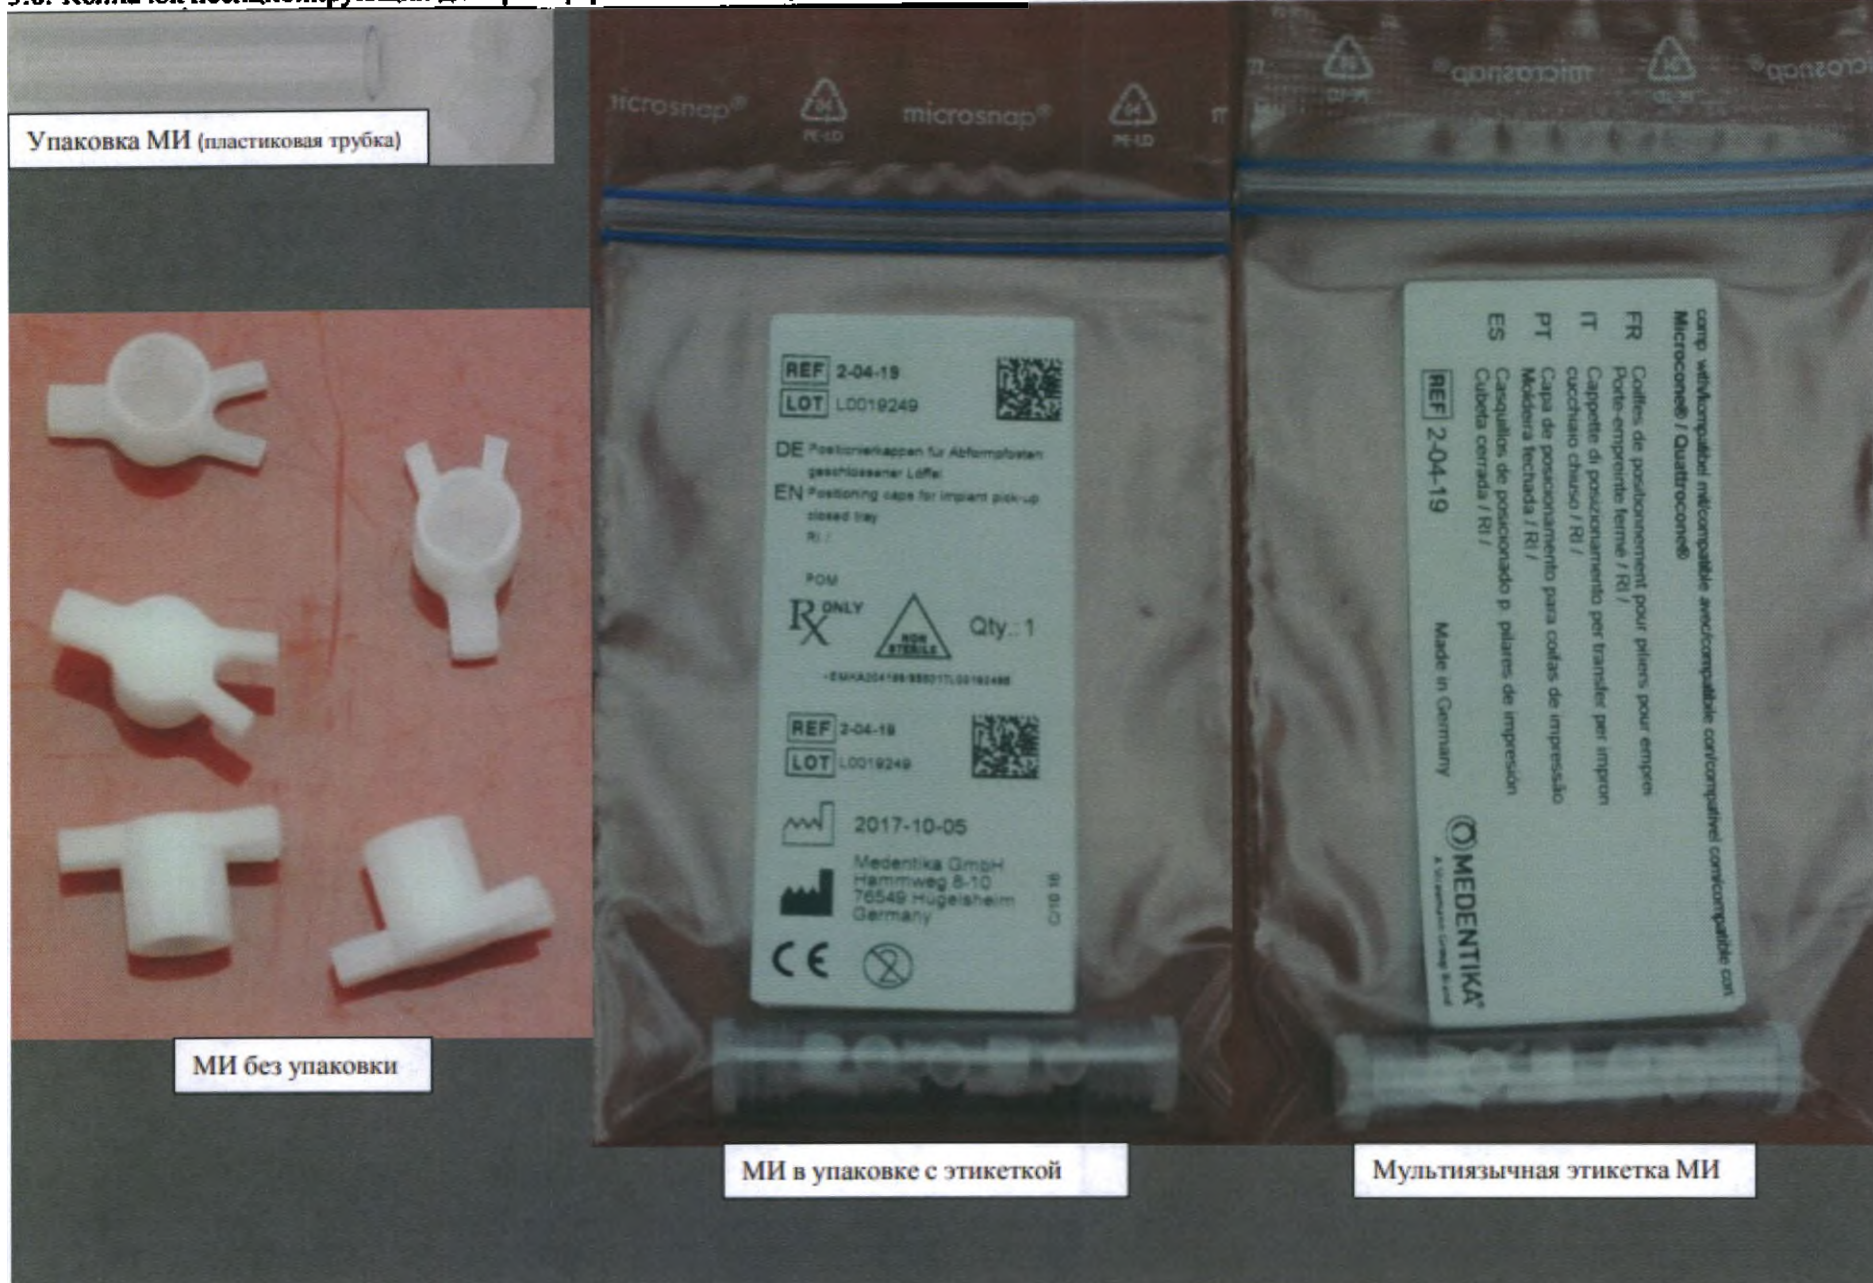

3.7. Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая линт абатмента MedentiBASE:

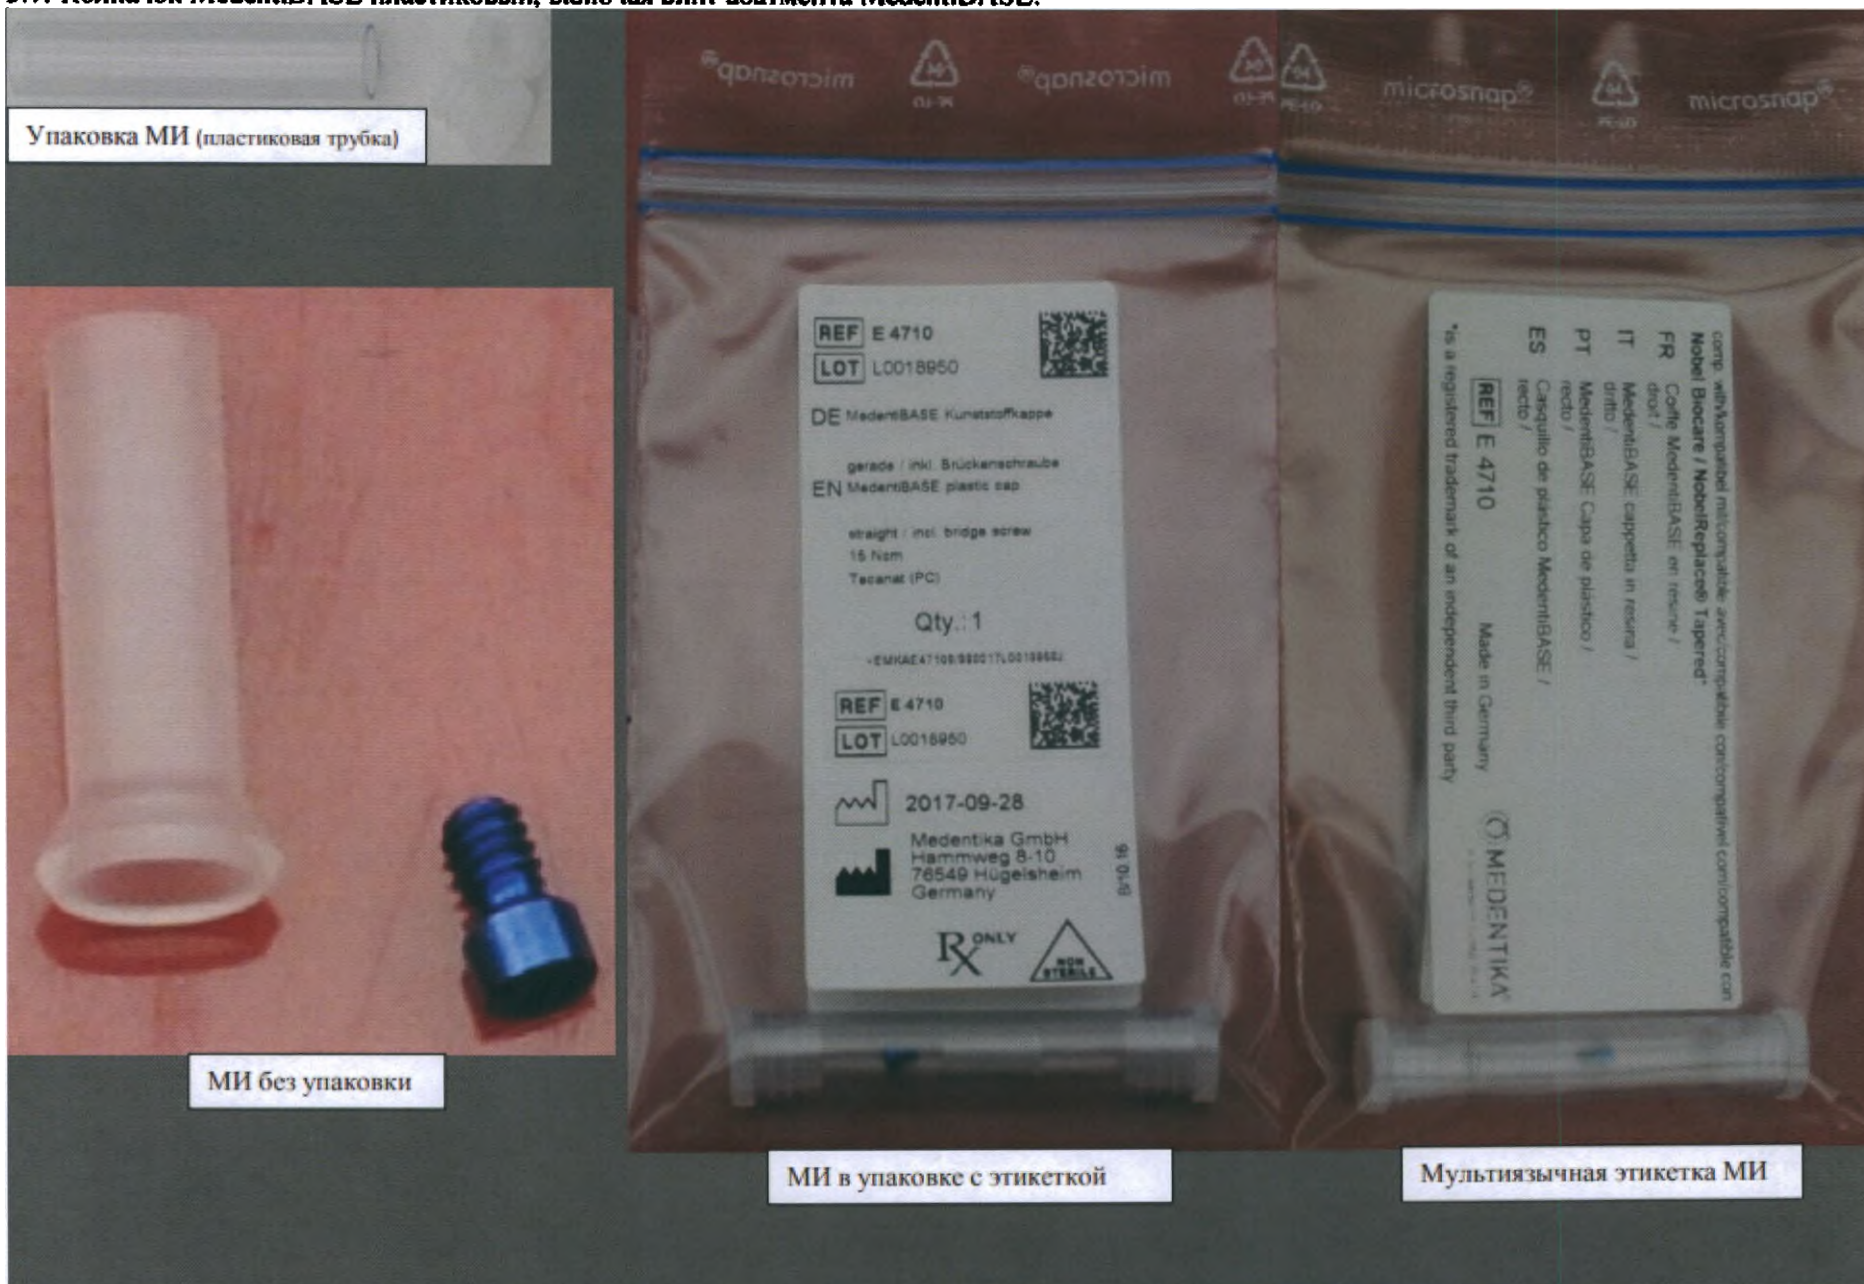

3.8-3.9 Колпачок MedentiBASE пластиковый клеиваемый, короткий, включая винт для моделирования:

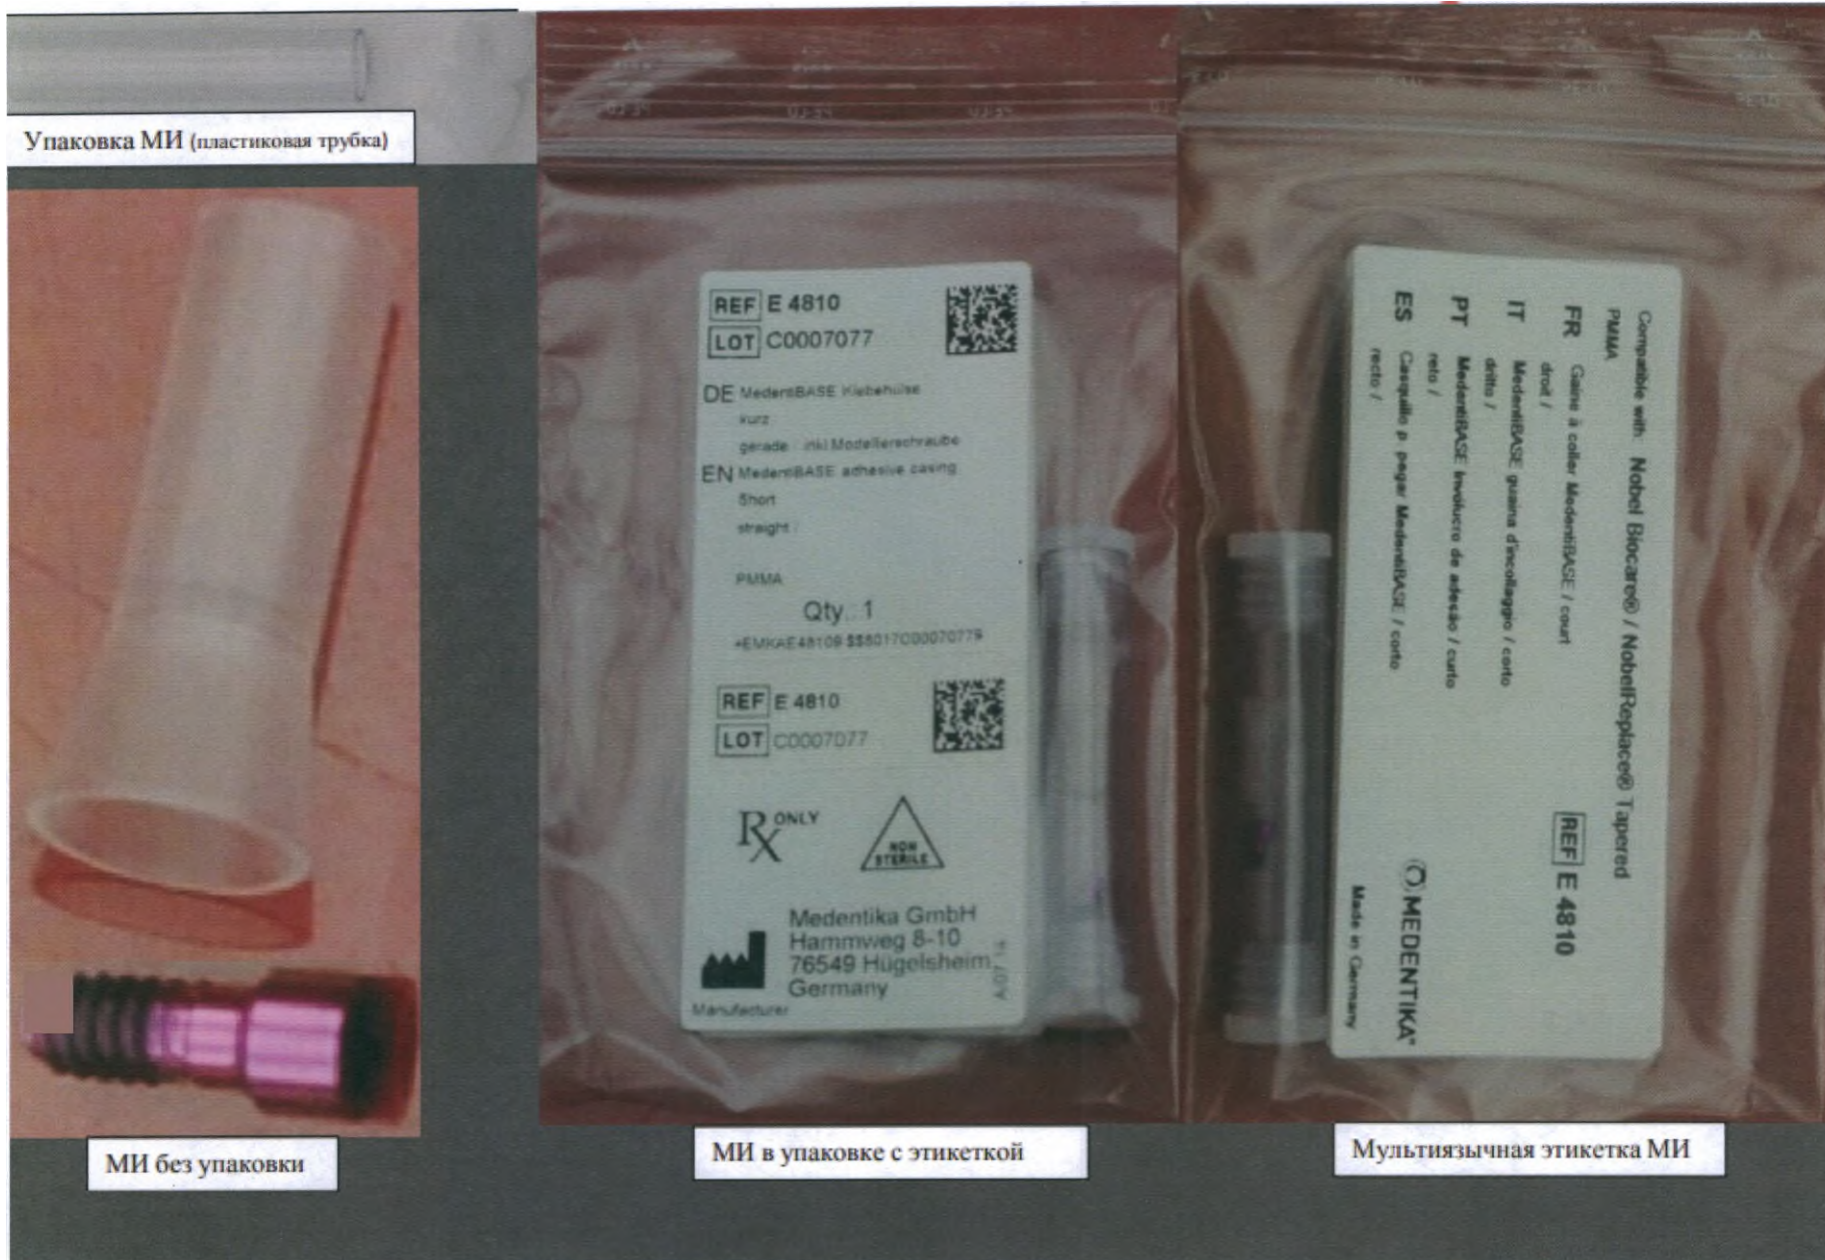


Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

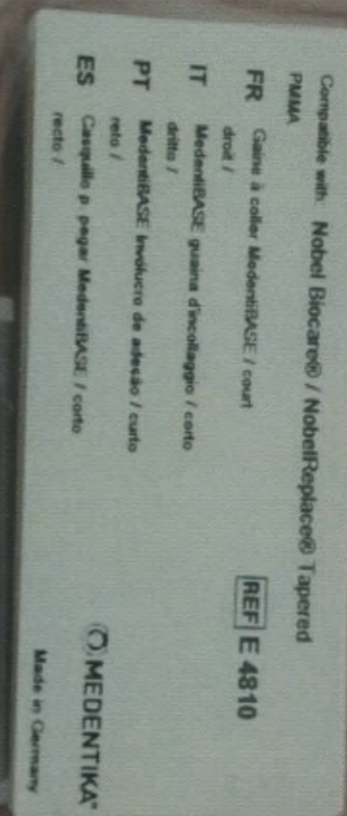

Мультиязычная этикетка МИ

3.10. Колпачок Multi-unit пластиковый:




3.11. Колпачок трансфера слепочного индивидуального:



3.12. Колпачок для основания титанового прямойстиковый:



3.13. Колпачок для основания титанового угловой пластиковый:

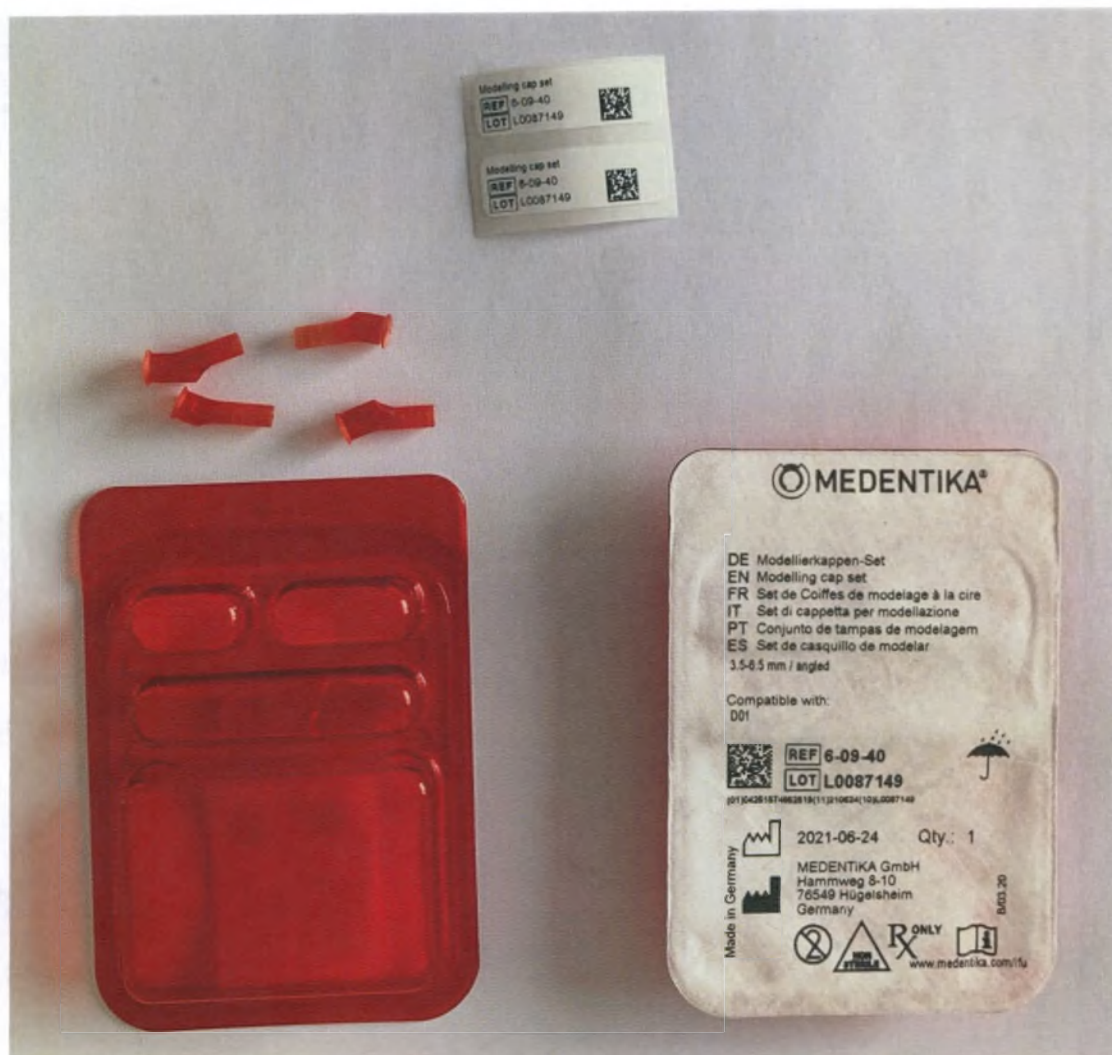


4. Основания, в вариантах исполнения:

4.1. Основание титановое, включая винт абатмента:






4.2. Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента:

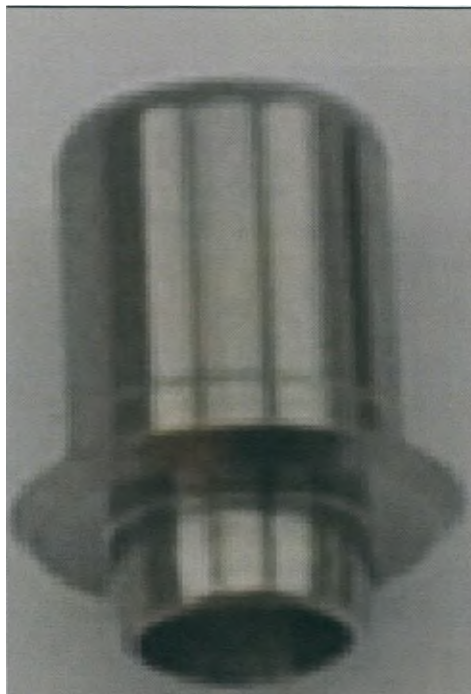


МИ в упаковке



Этикетка МИ

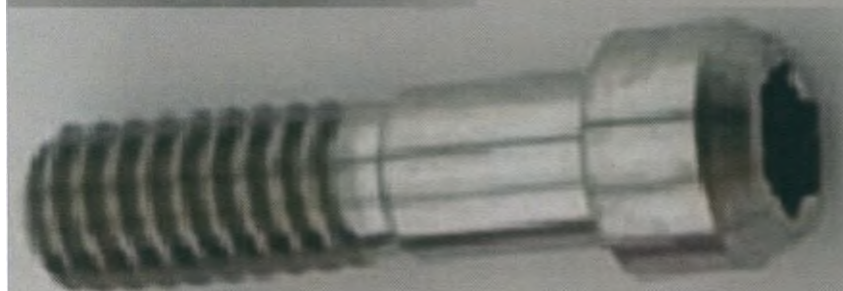

МИ без упаковки

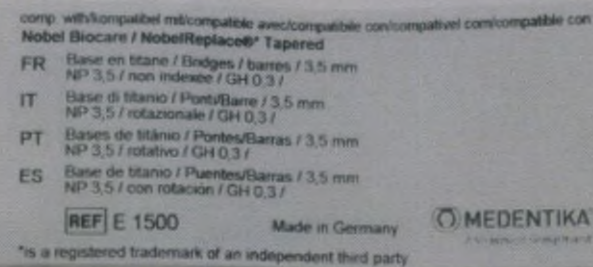

Мультиязычная этикетка МИ



4.3. Основание MedentiBASE титановое, включая ____ г абатмента MedentiBASE:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ

MedentiBASE titanium base
REF 6-28-02
LOT L0086312

MedentiBASE titanium base
REF 6-28-02
LOT L0086312



MEDENTIKA®

DE MedentiBASE Titanbasis / ASC
EN MedentiBASE titanium base / ASC
FR Base titane MedentiBASE / ASC
IT Base di titanio MedentiBASE / ASC
PT MedentiBASE Base de titânio / ASC
ES Base de titanio MedentiBASE / ASC

/ 15 Ncm
Titanium Grade 5
Compatible with:
alle Systeme

REF 6-28-02
LOT L0086312

(01)04261674848982(11)3210611(10)L0086312

MD

2021-06-11 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE 0483 B003.20

Made in Germany

www.medentika.com/lifu

4.4. Основание Multi-unit титановое, включая винт компонента Multi-unit:



Multi-unit Titanbasis
15 Nom
REF Y 8508
LOT L0074035

Multi-unit Titanbasis
15 Nom
REF Y 8508
LOT L0074035



MEDENTIKA®

DE Multi-unit Titanbasis
EN Multi-unit titanium base
FR Base titane Multi-unit
IT Base di titanio Multi-unit
PT Multi-unit Base de titânio
ES Base de titanio Multi-unit
/ 15 Nom
Titanium Grade 5 CF
Compatible with:
DENTSPLY SIRONA / ANKYLOS C/X

REF Y 8508
LOT L0074035

(21) 0428 187 48 48354(1) 1201907(10) 007 4035

2020-10-07 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE 0483 8003 20


Made in Germany

⚠ ⚡ ⚠ Rx ONLY

www.medentika.com/ru

is a registered trademark of an independent third party

4.5. Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента:

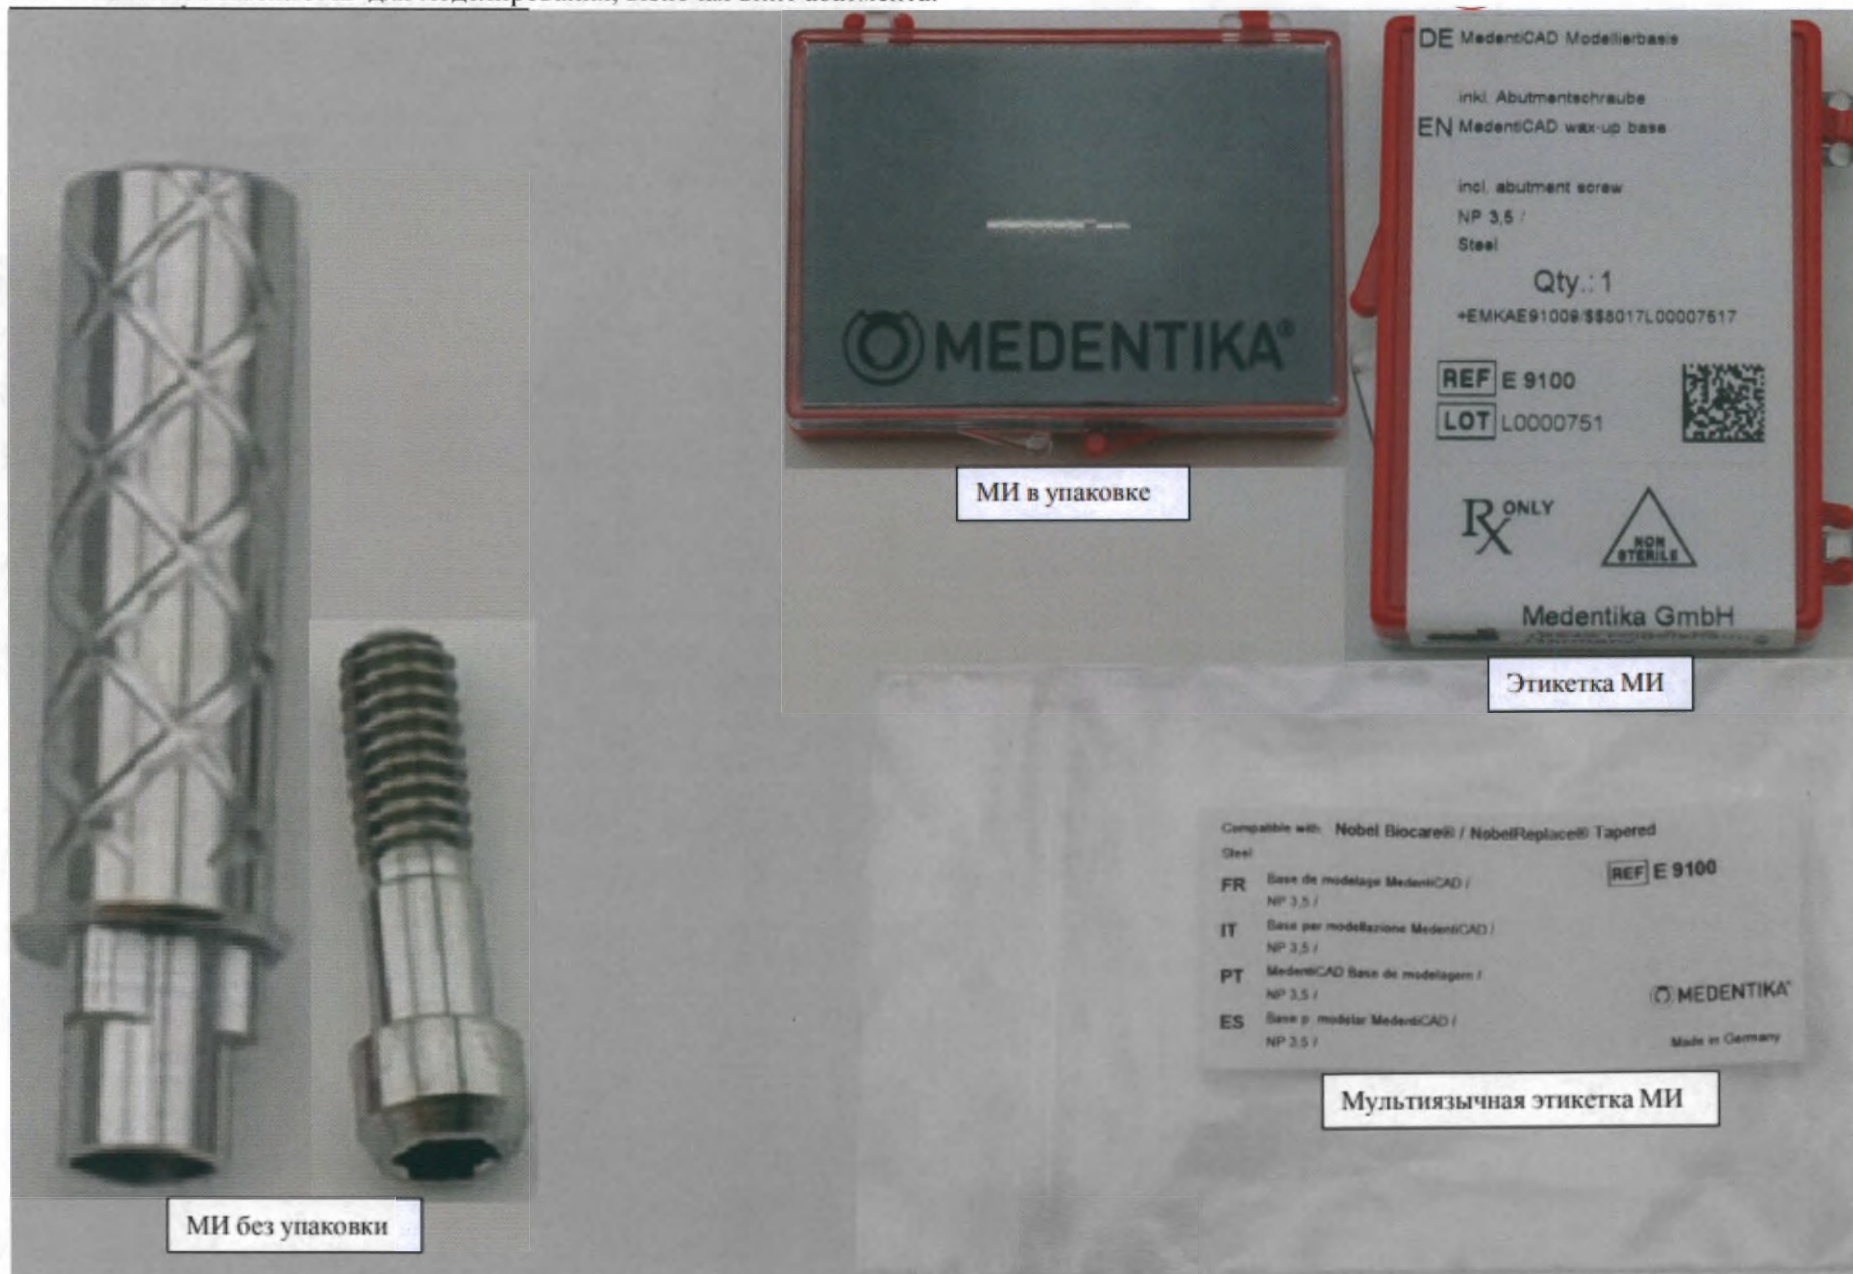

II. Принадлежности.

1. Абатменты для планирования:

1.1. Абатмент для планирования прямой:



1.2-1.3 Абатмент для планирования угловой:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки

REF EP 200-1
LOT C0006409



DE Planungsabutment

rot beschichtet / abgewinkelt

EN Planning abutment

red coated / angled

NP 3.5 / Type 1 / 16° / GH 1.0/2.5

Aluminium

Qty.: 1

*EUKAEP20019 398017C0006409M

REF EP 200-1
LOT C0006409



RX ONLY



Medentika GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

Manufacturer

1.00V

Compatible with Nobel Biocare® / NobelReplace® Tapered
Abutments
FR Fillet pour planification / saute
NP 3.5 / Type 1 / 16° / GH 1.0/2.5 / revêtement rouge
IT Montcone di prova / inclinato
NP 3.5 / Type 1 / 16° / GH 1.0/2.5 / rivestimento rosso
PT Abutment de planejamento / angulado
NP 3.5 / Type 1 / 16° / GH 1.0/2.5 / revestimento rosso
ES Pilar de planificación / acodado
NP 3.5 / Type 1 / 16° / GH 1.0/2.5 / revestimiento rojo

REF EP 200-1



Medentika GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany


МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ

1.4-1.15 Набор абатментов для планирования




МИ без упаковки

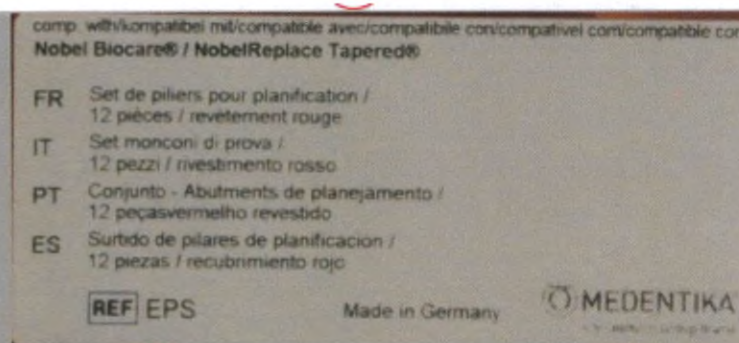

Мультиязычная этикетка МИ



МИ в упаковке + вторичная упаковка

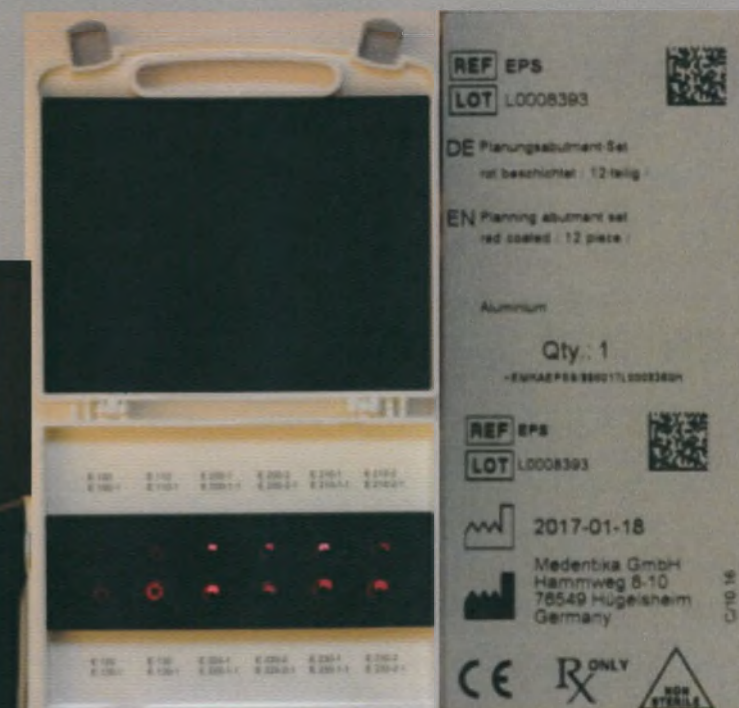

Этикетка МИ

МИ в упаковке (пластиковый чемоданчик)

2. Абатменты для сканирования:

2.1. Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ

 **MEDENTIKA®**

DE Scanbody / spezialbeschichtet
EN Scanbody / specially coated
FR Scanbody / revêtement spécial
IT Scanbody / con rivestimento speciale
PT Scanbody / revestimento especial
ES Scanbody / con recubrimiento especial

10 Nm

Titanium

Compatible with: SC 2.9

Straumann / Bone Level



REF L 1420

LOT L0085416

(01)0425157-4847669(11)210627(10)L0085416



MD



Made in Germany

2021-05-27

Qty.: 1



MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE

B703 20




RX ONLY




www.medentika.com/ru

2.2. Абатмент MedentiBASE для сканирования, винт абатмента MedentiBASE:

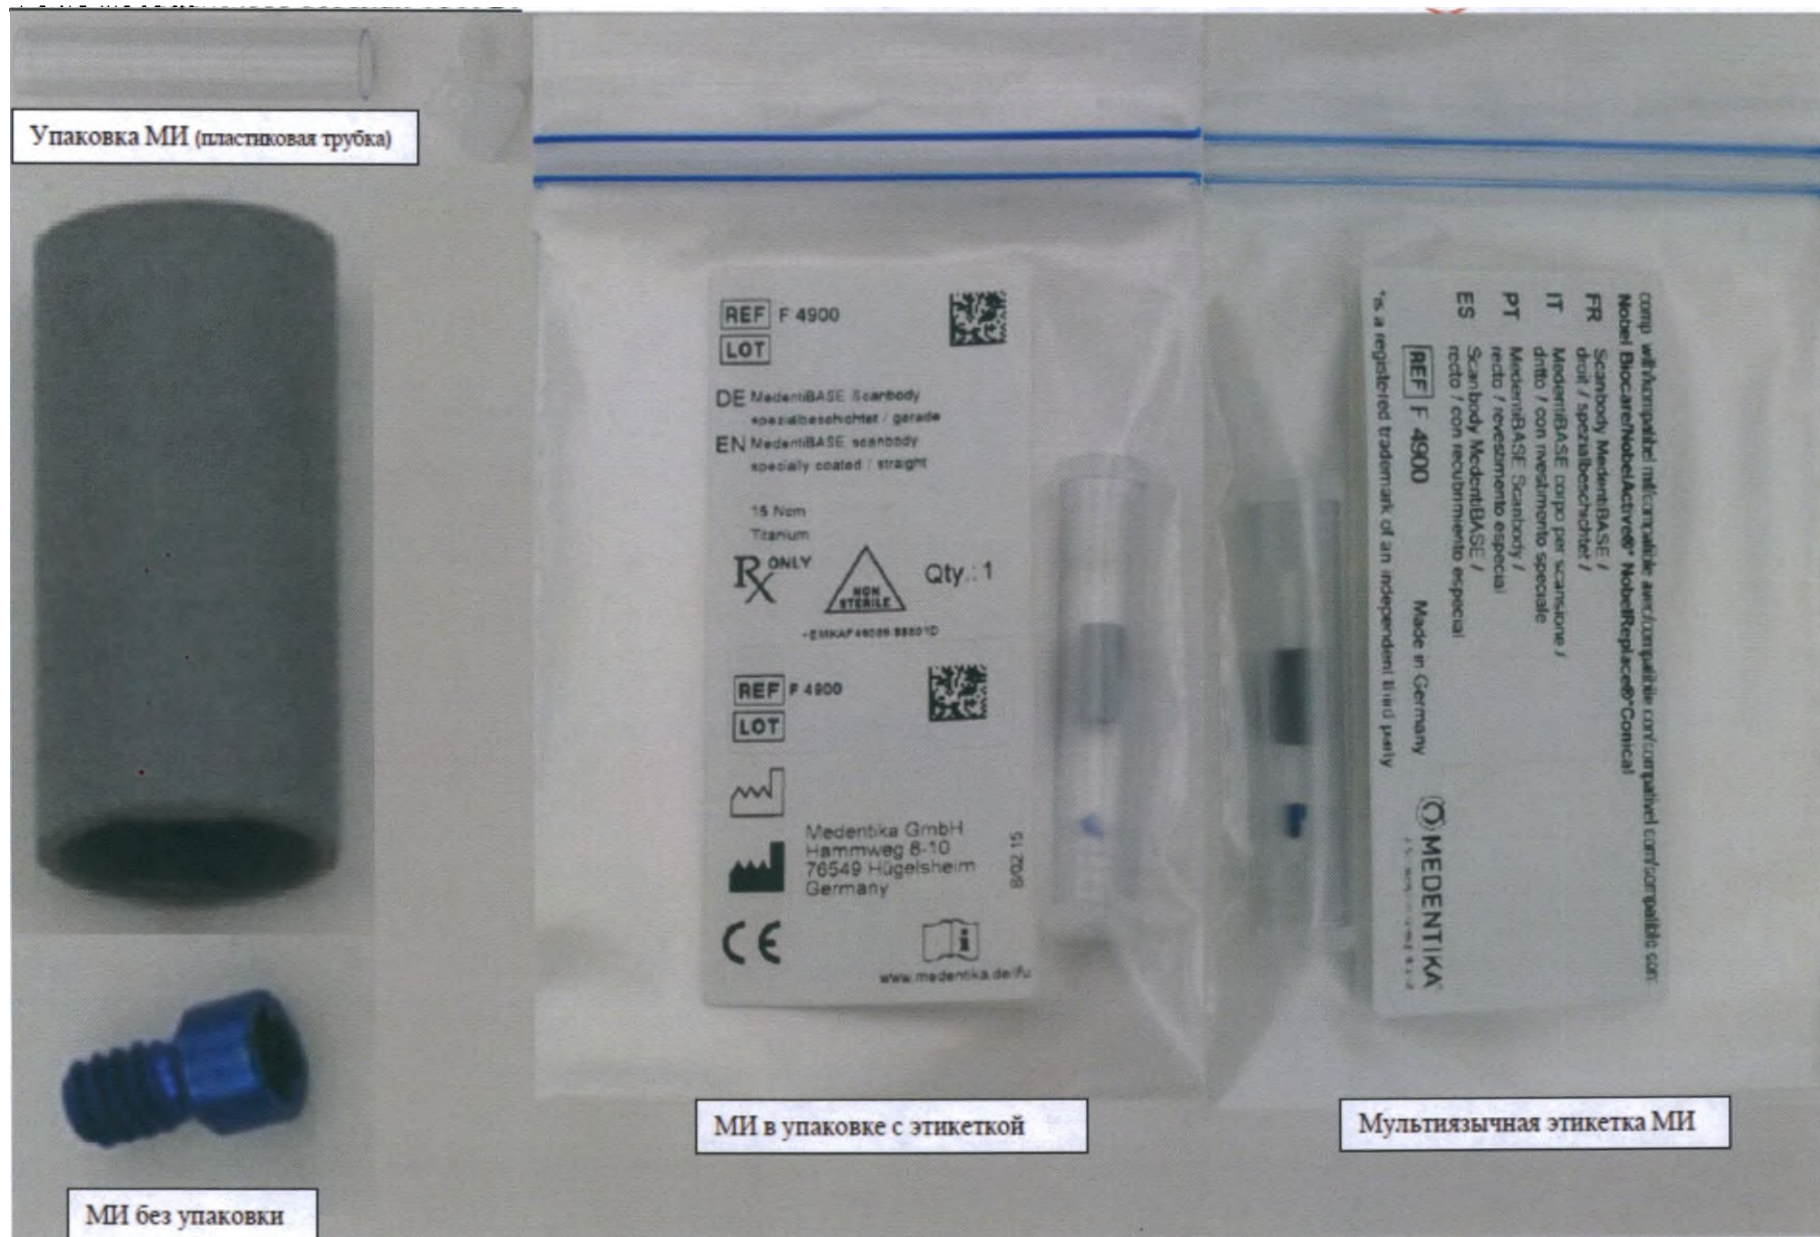


2.3. Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit:

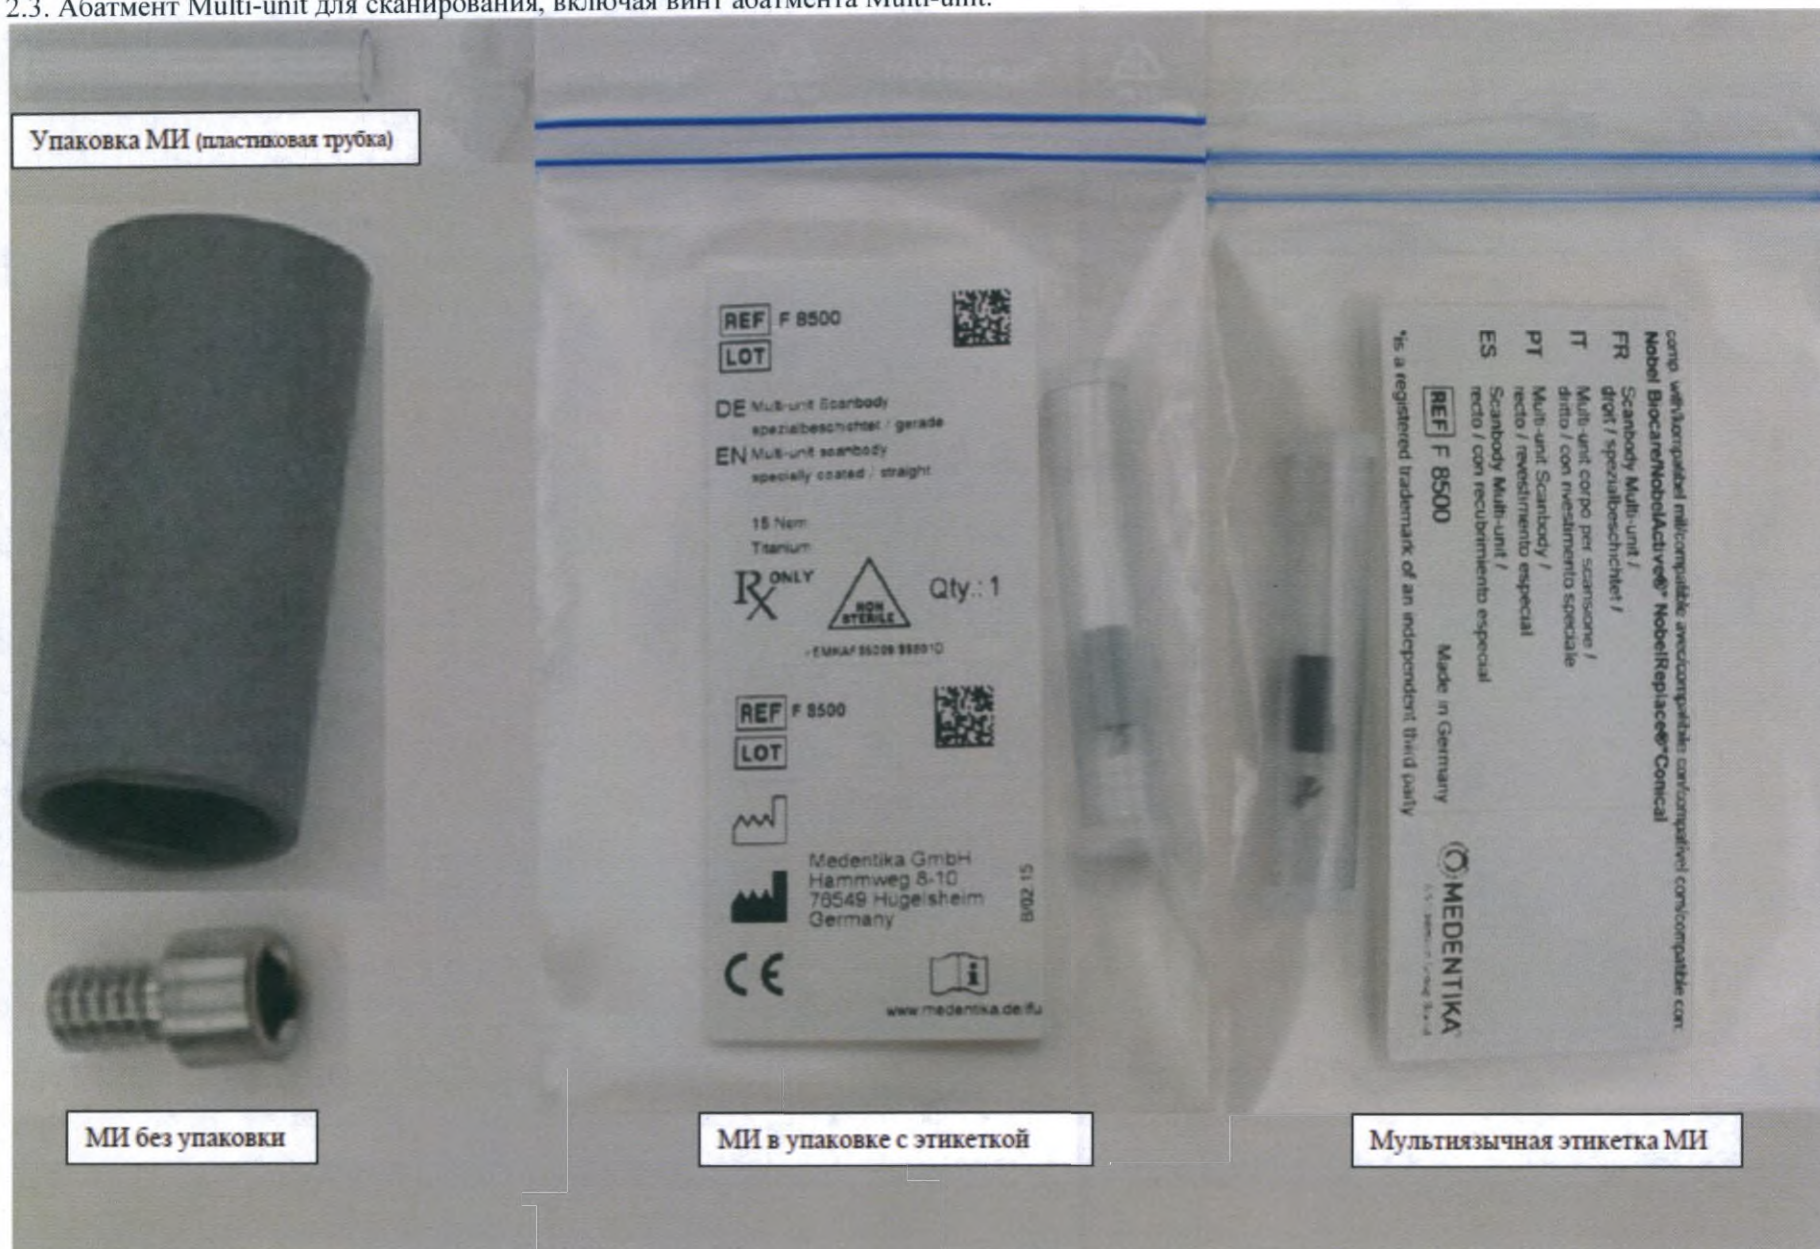



2.4. Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit:

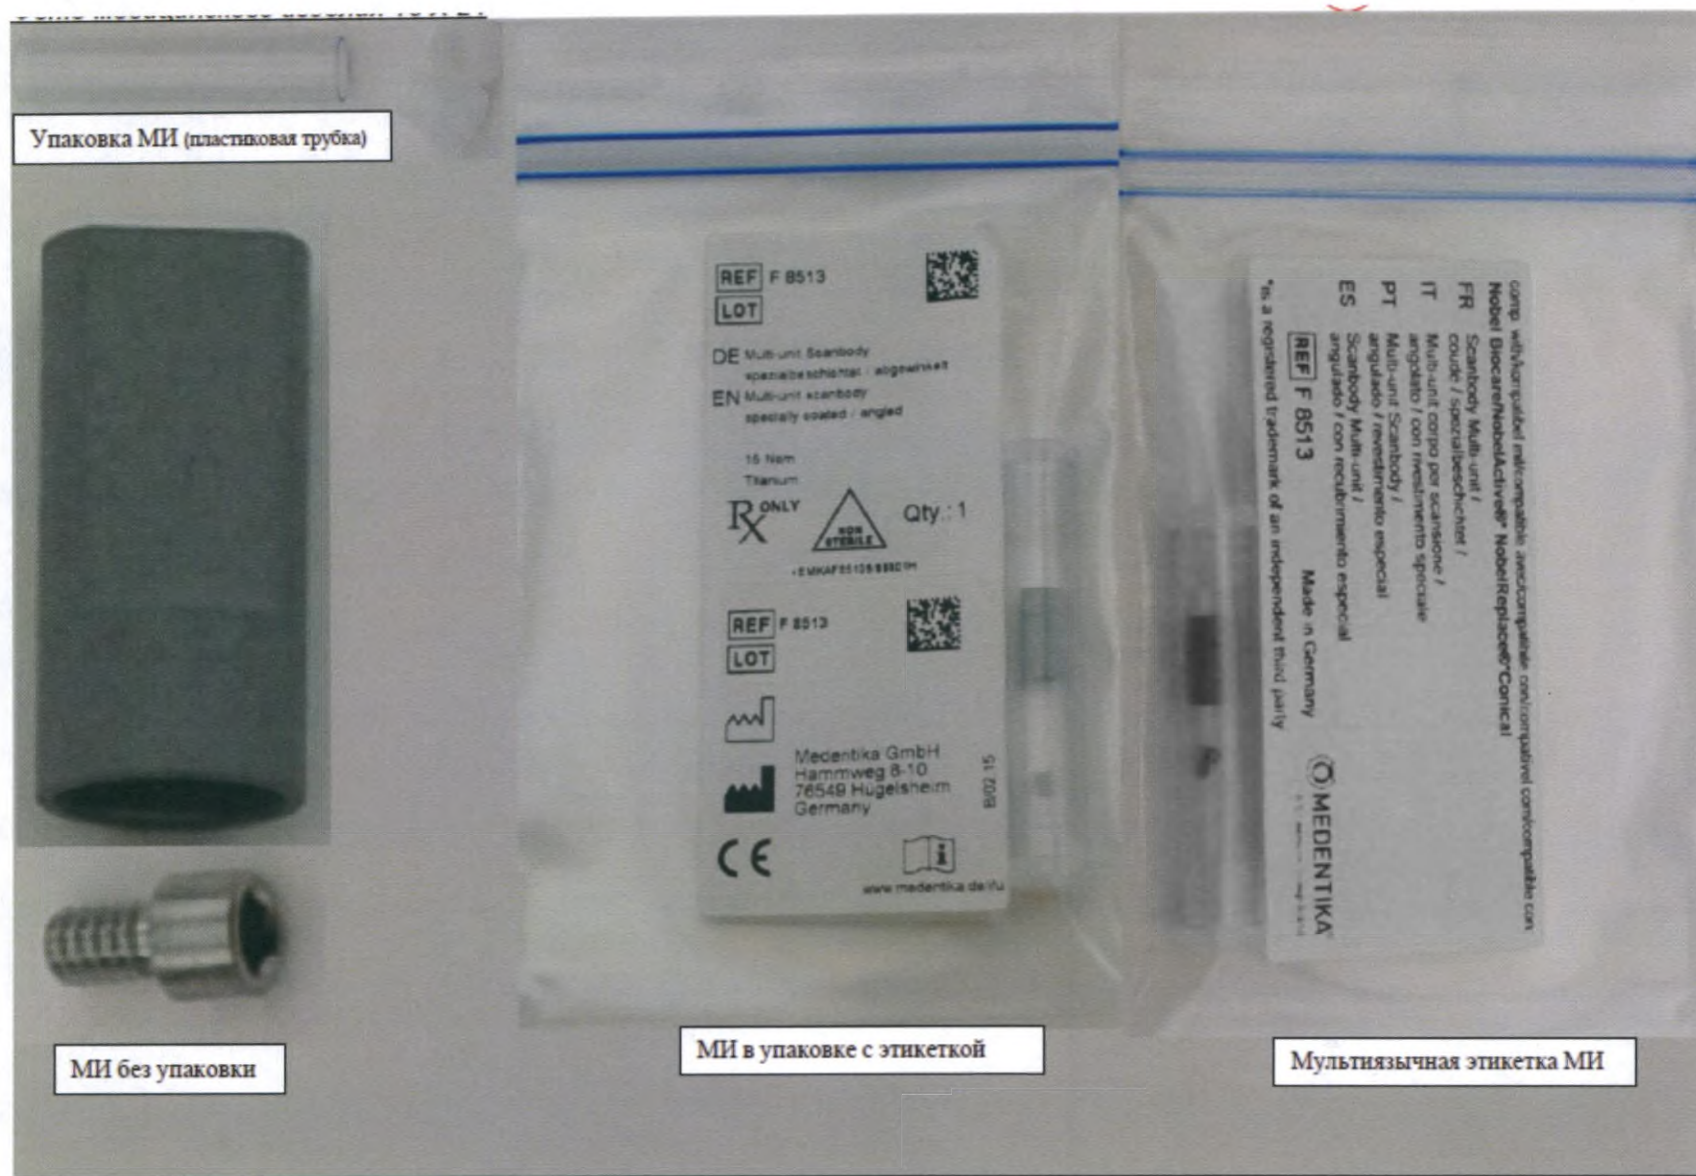

8513

 MEDENTIKA®

DE Multi-unit Scanbody
EN Multi-unit scanbody
FR Scanbody Multi-unit
IT Scanbody Multi-unit
PT Multi-unit Scanbody
ES Scanbody Multi-unit
incl. Screw: MG 8501
/ 10 Ncm
Titanium
Compatible with:
Multi-unit



REF MG 8513
LOT L0087148

(01)04261874864644(11)210624(10)L0087148



MD



2021-06-24 Qty.: 1

Made in Germany



MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany

CE



RX ONLY




C05 21

www.medentika.com/rfu

3. Трансферы:


3.1. Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий:

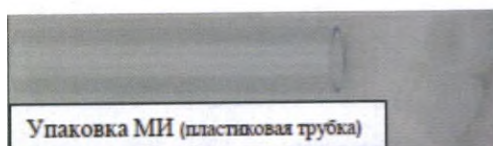

Мультиязычная этикетка МИ



3.2. Трансфер слепочный индивидуальный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий:


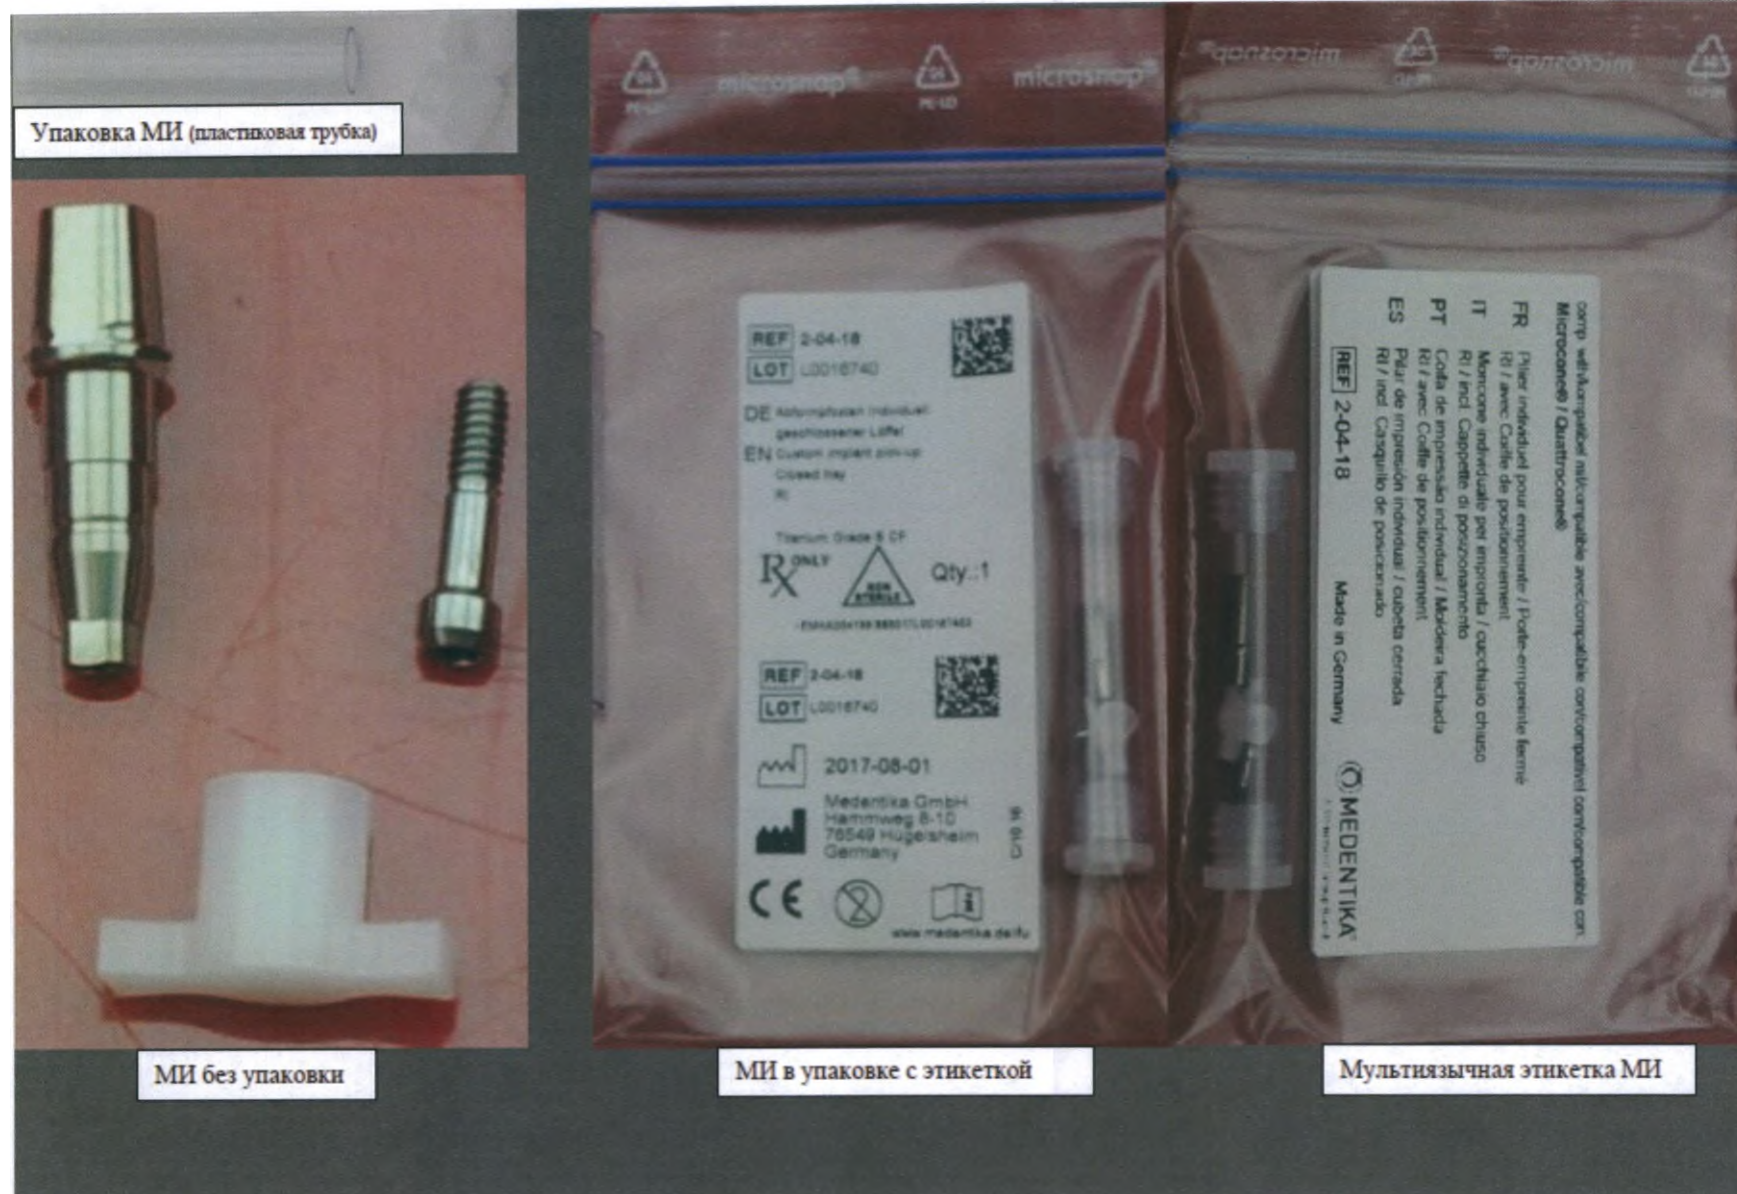




3.4. Трансфер слепочный длинный для открытойки, включая винт для фиксации:




3.5-3.6 Трансфер слепочный индивидуальный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации:

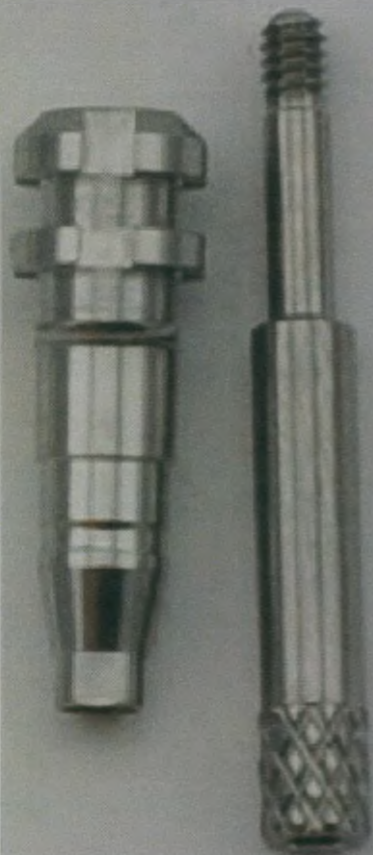

МИ без упаковки




МИ в упаковке с этикеткой

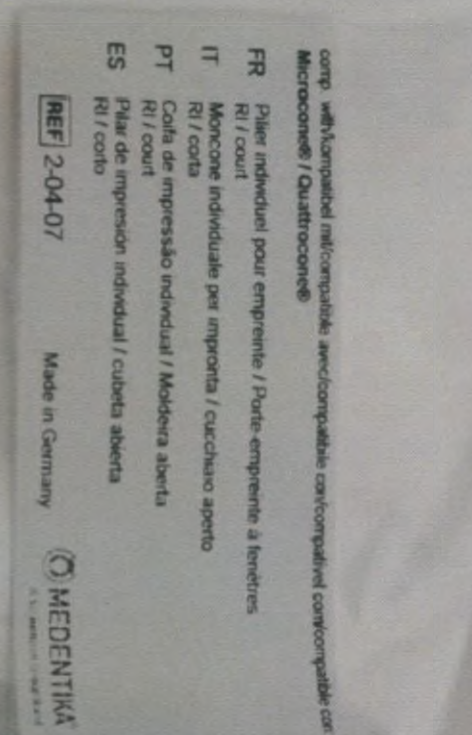


Мультиязычная этикетка МИ

3.7. Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, в чая винт для фиксации:


Упаковка МИ (пластиковая трубка)

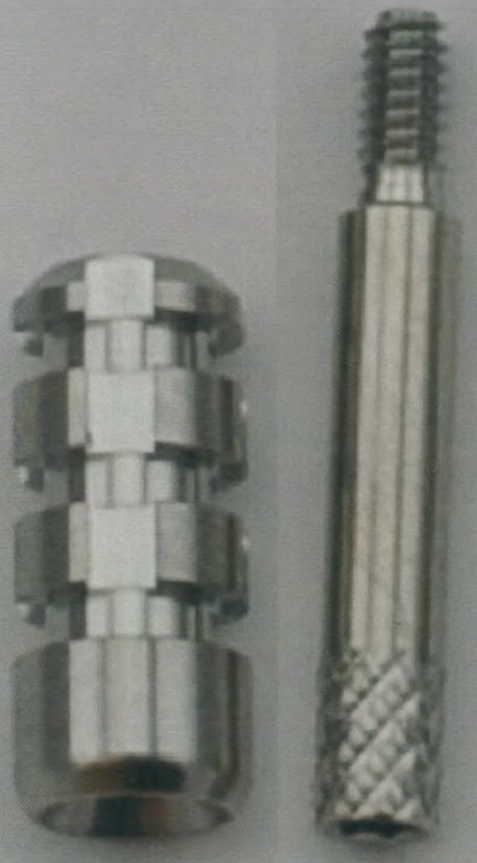

МИ без упаковки

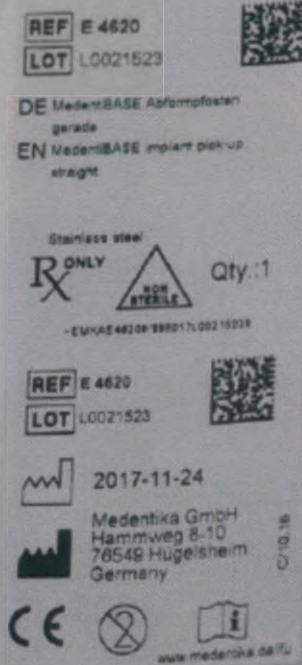

МИ в упаковке с этикеткой

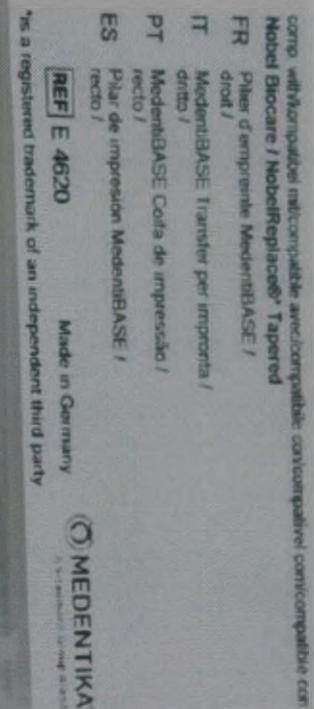

Мультиязычная этикетка МИ

3.8. Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации:





 MEDENTIKA®

DE Multi-unit-Abformpfosten
EN Multi-unit implant pick-up
FR Transfert d'empreinte Multi-unit
IT Transfer per impronta Multi-unit
PT Multi-unit Coifa de impressão
ES Pilar de impresión Multi-unit

Titanium Grade 5
Compatible with:
Multi-unit / Multi-unit Plus



REF E 8503
LOT L0087146

(01)04381674801222(11)210624(10)L0087146

Made in Germany

2021-06-24 Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammerweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany




ONLY
www.medentika.com/it



C05 21

4. Аналоги:


4.1. Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiLOC:

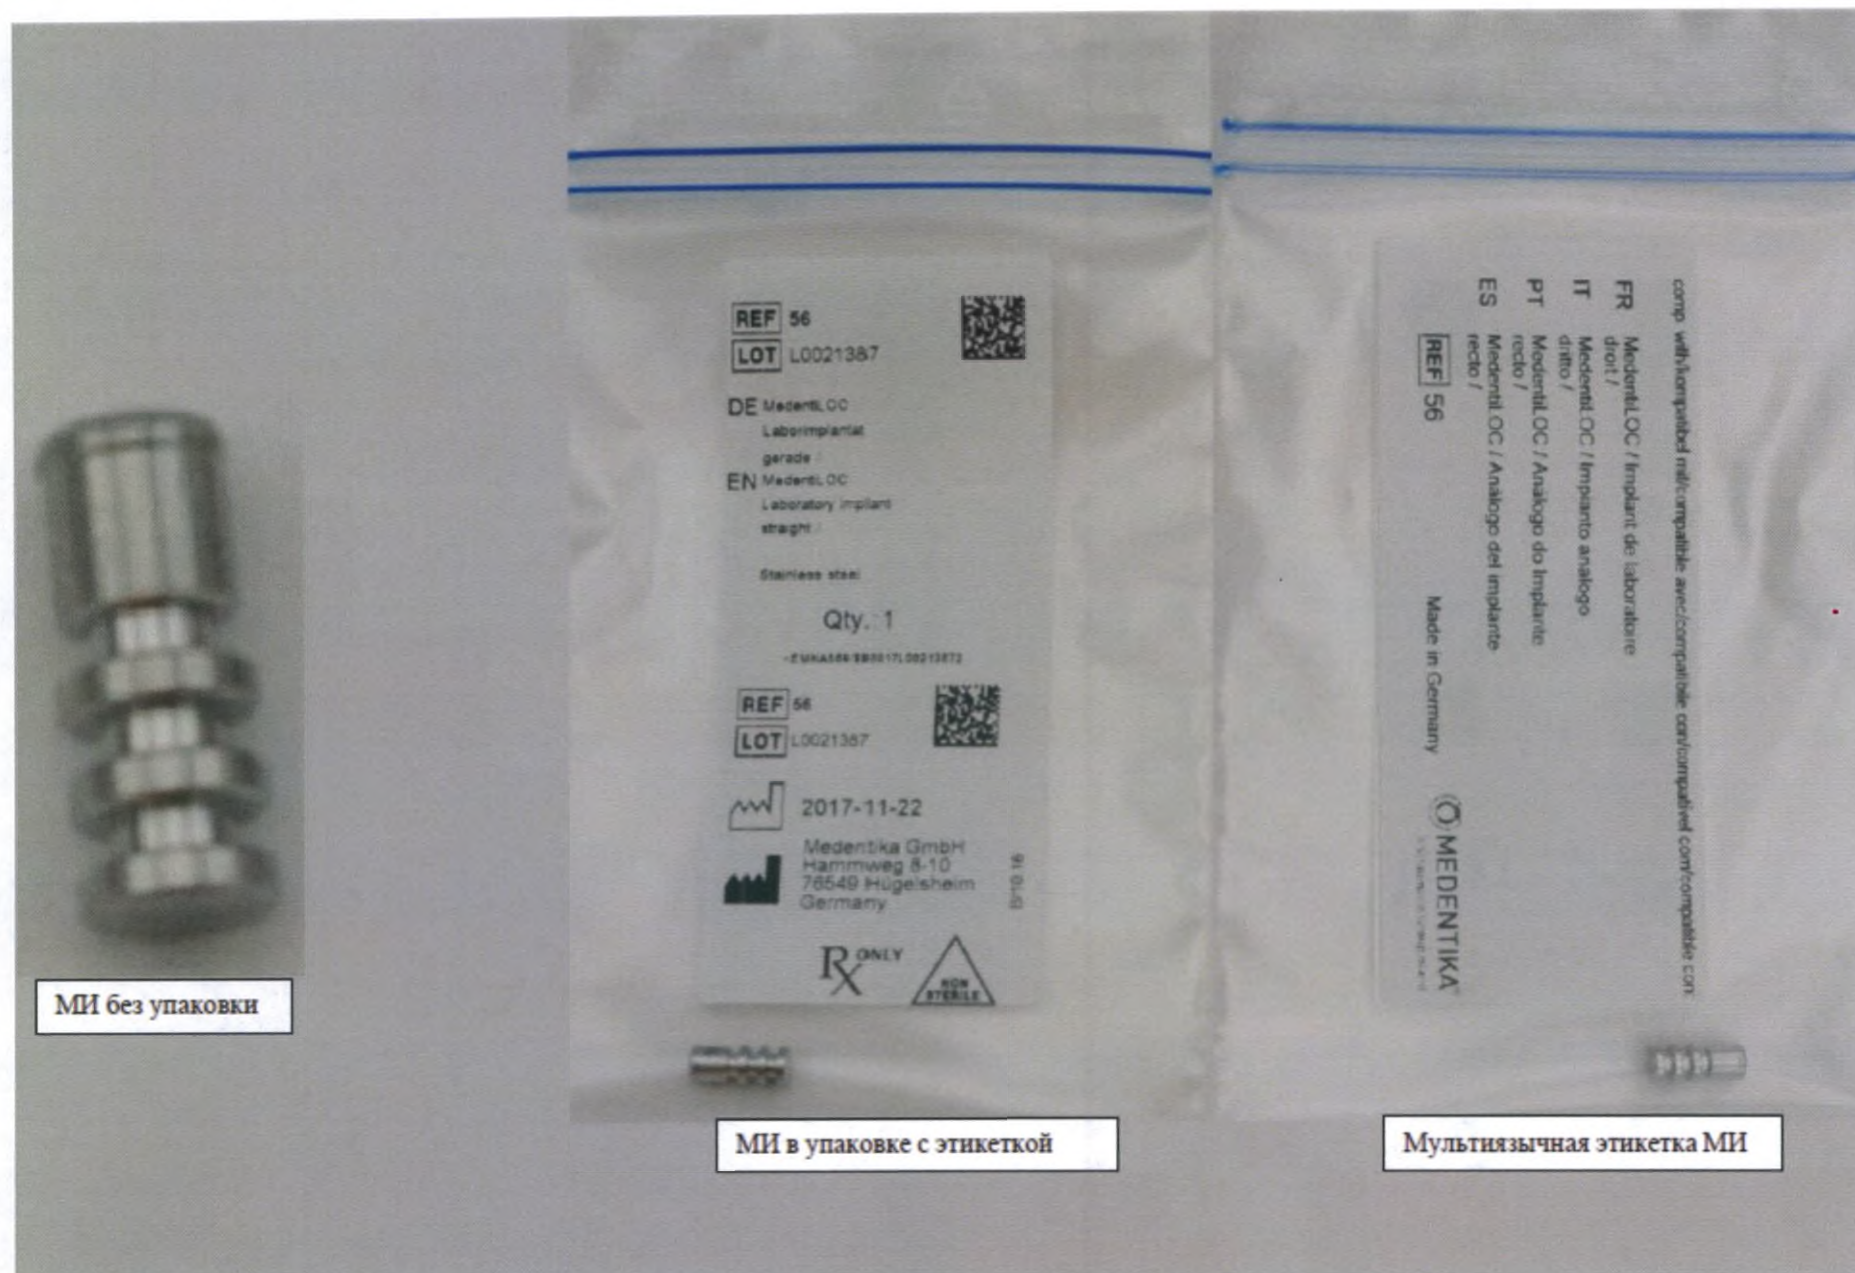


4.2. Аналог лабораторный углового абатмента Мс.....iLOC:



4.3. Аналог лабораторный прямого абатмента Novaloc:

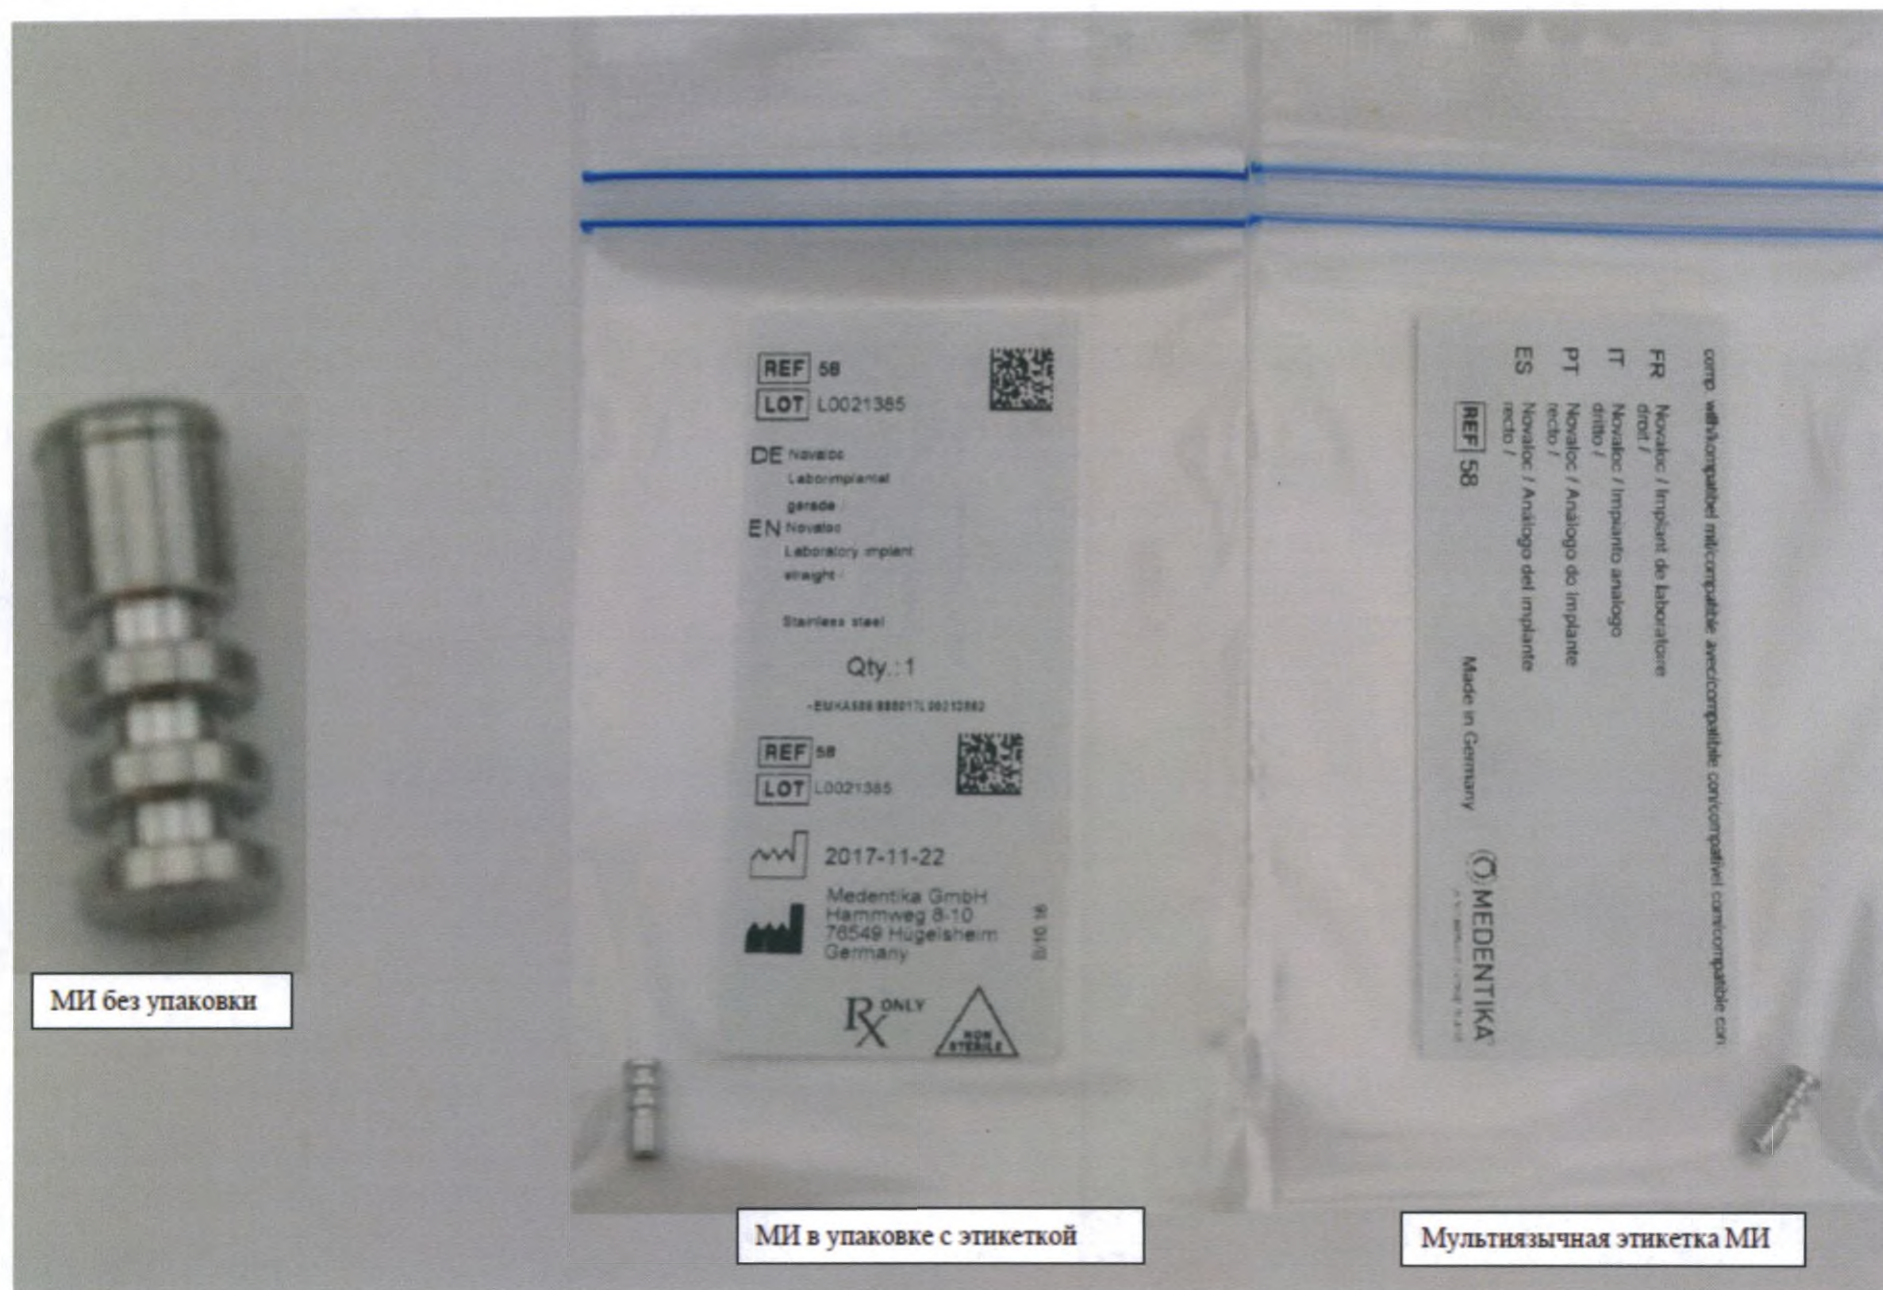


4.4. Аналог лабораторный углового абатмента No 5:

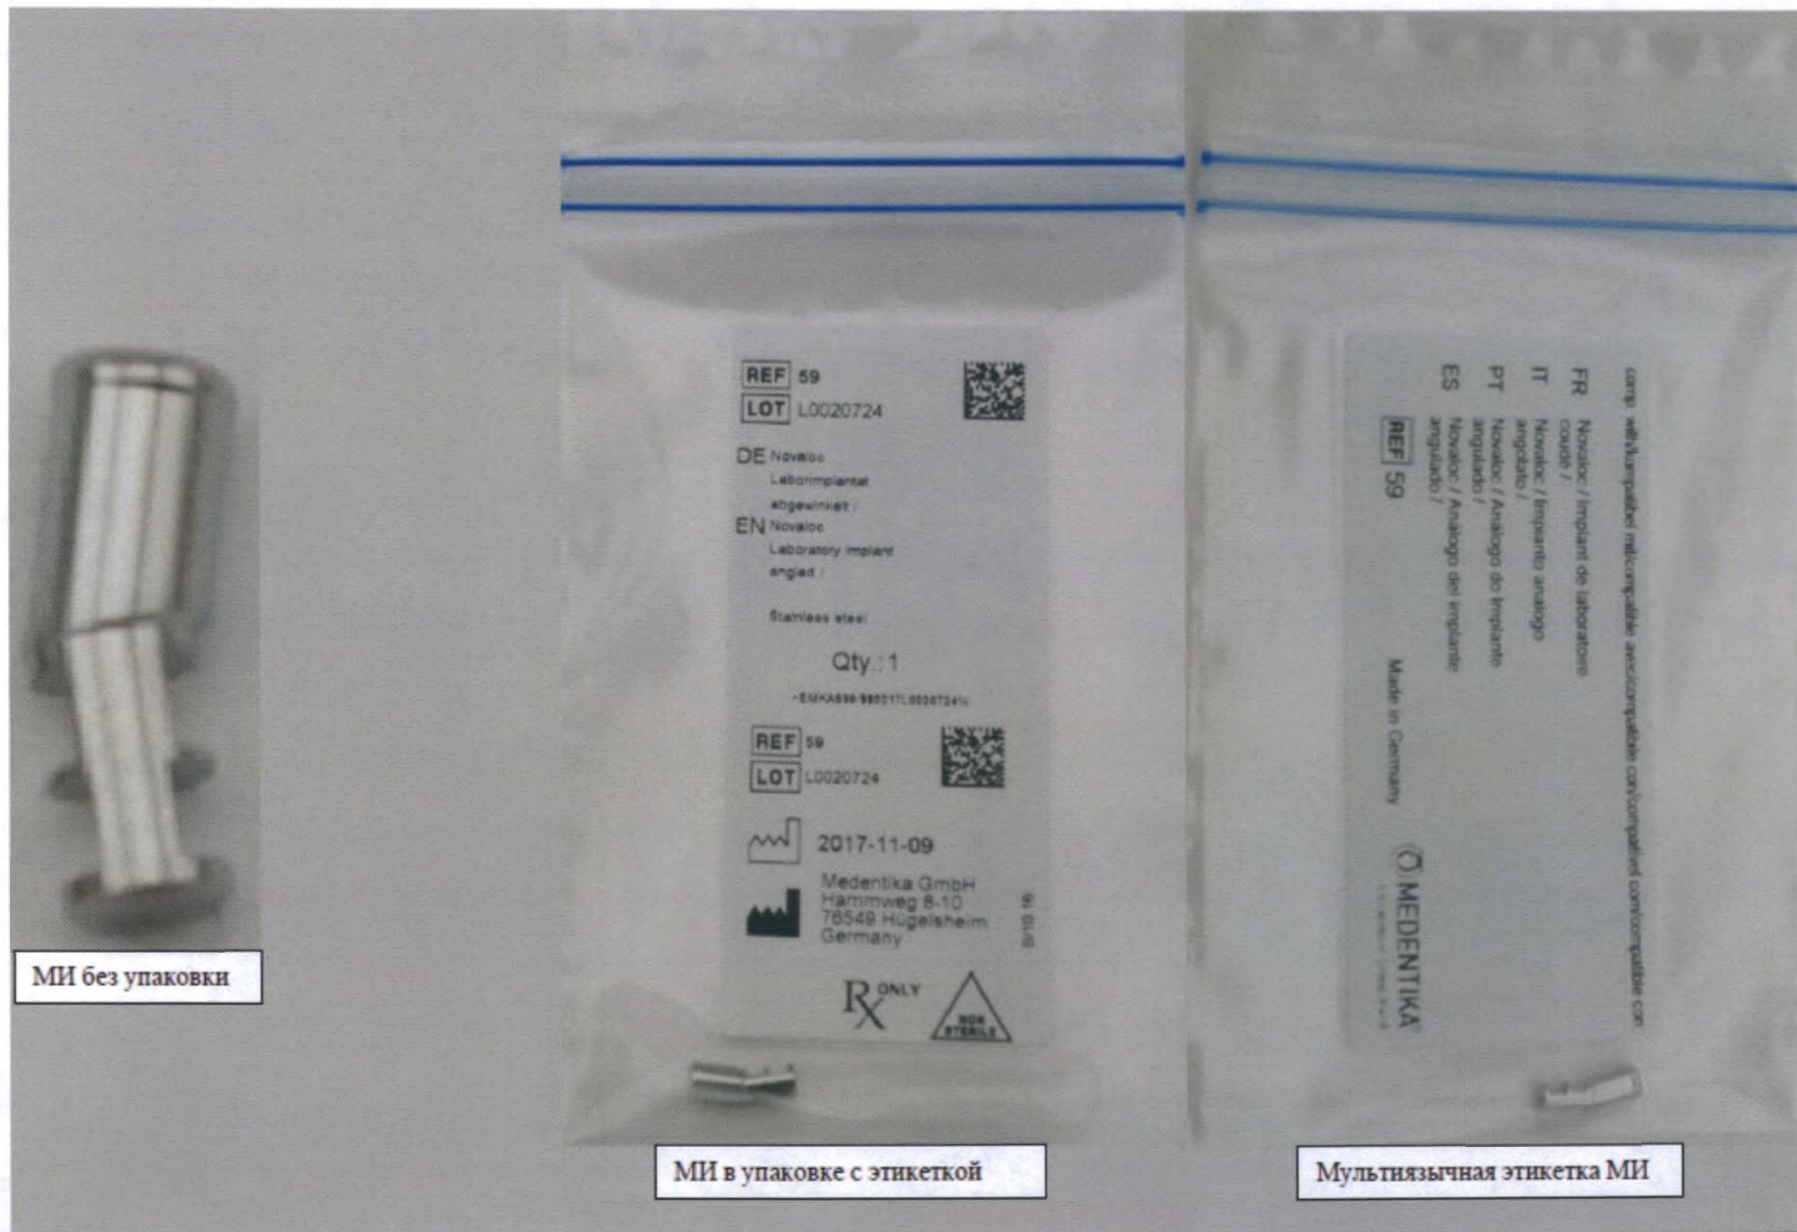


4.5. Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE:




4.6. Аналог лабораторный абатмента Multi-unit:

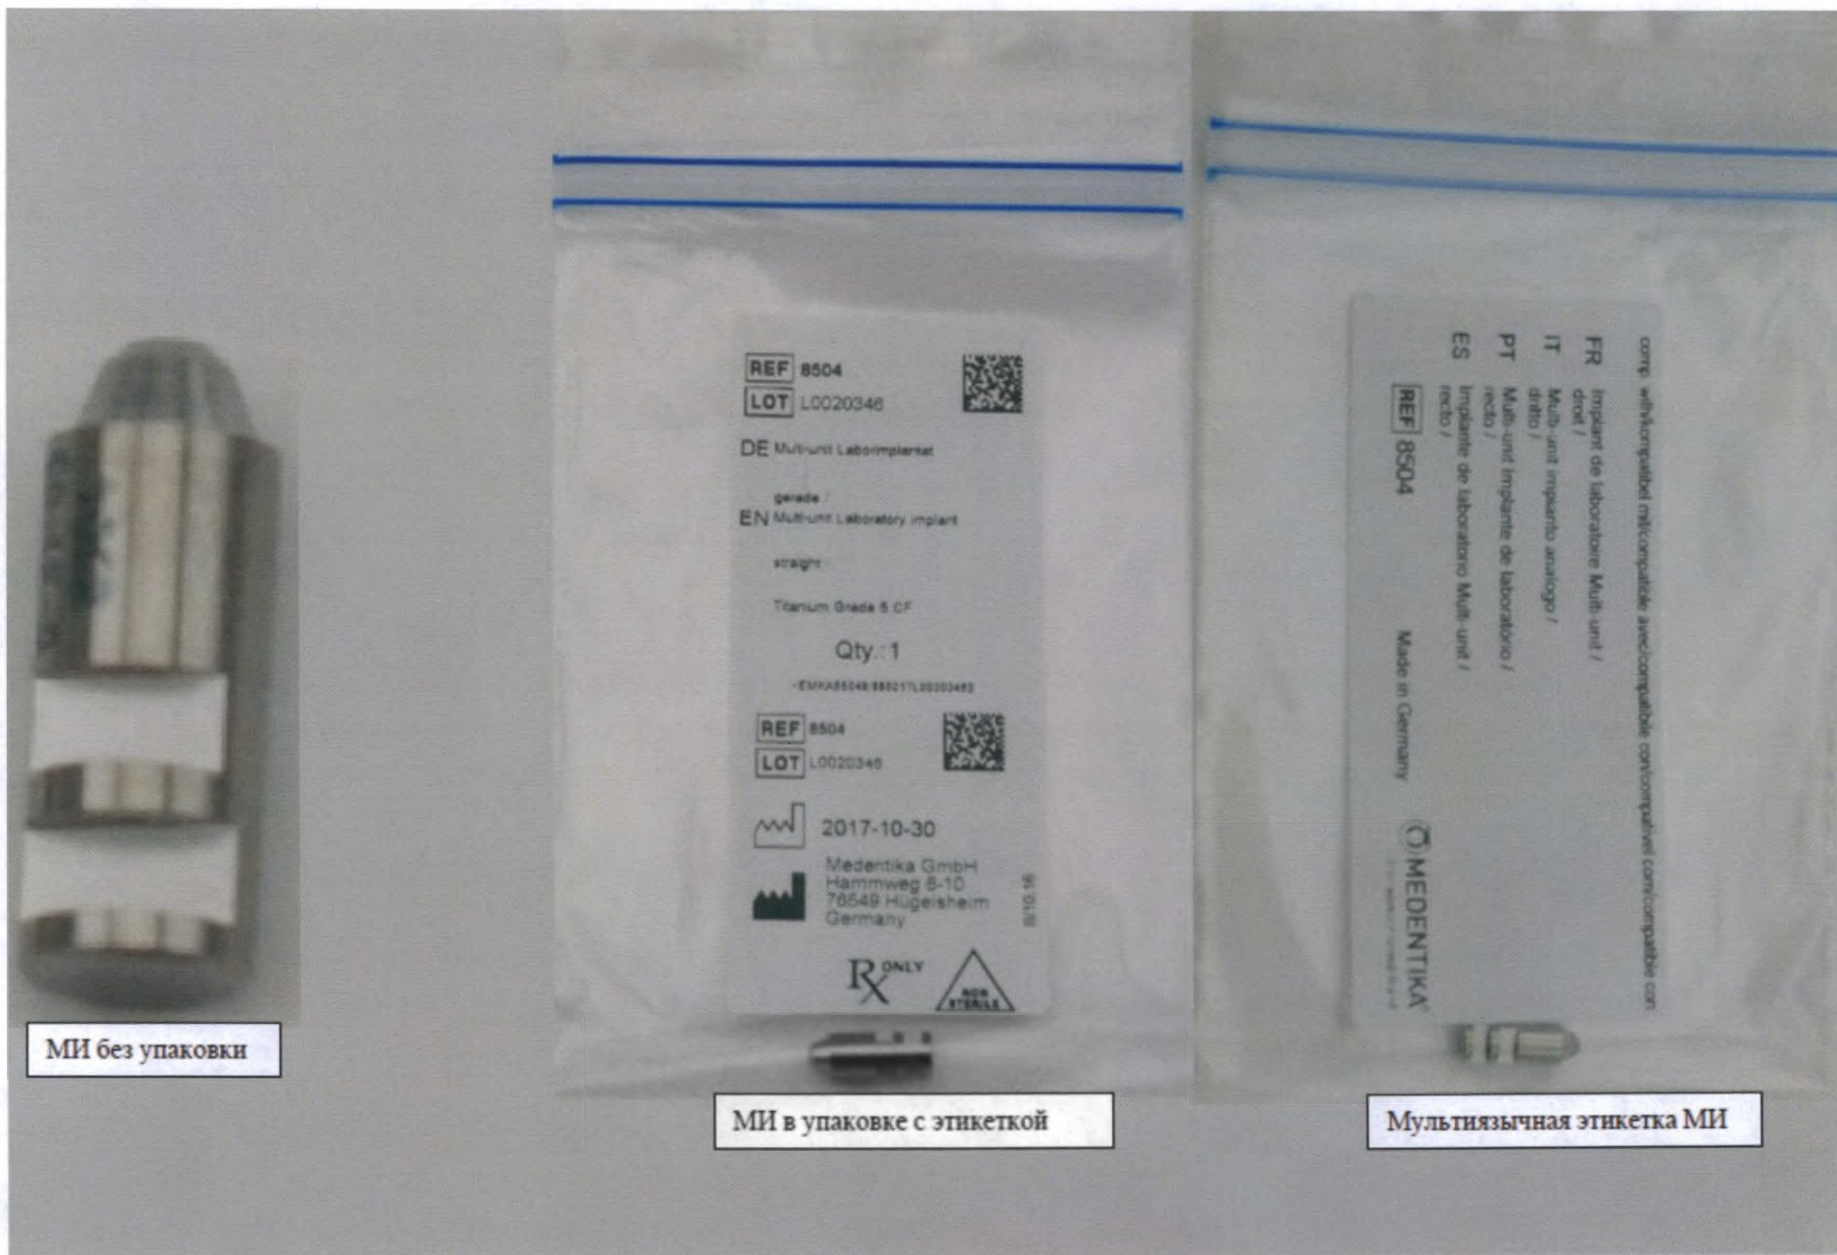

4.7-4.8 Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit:

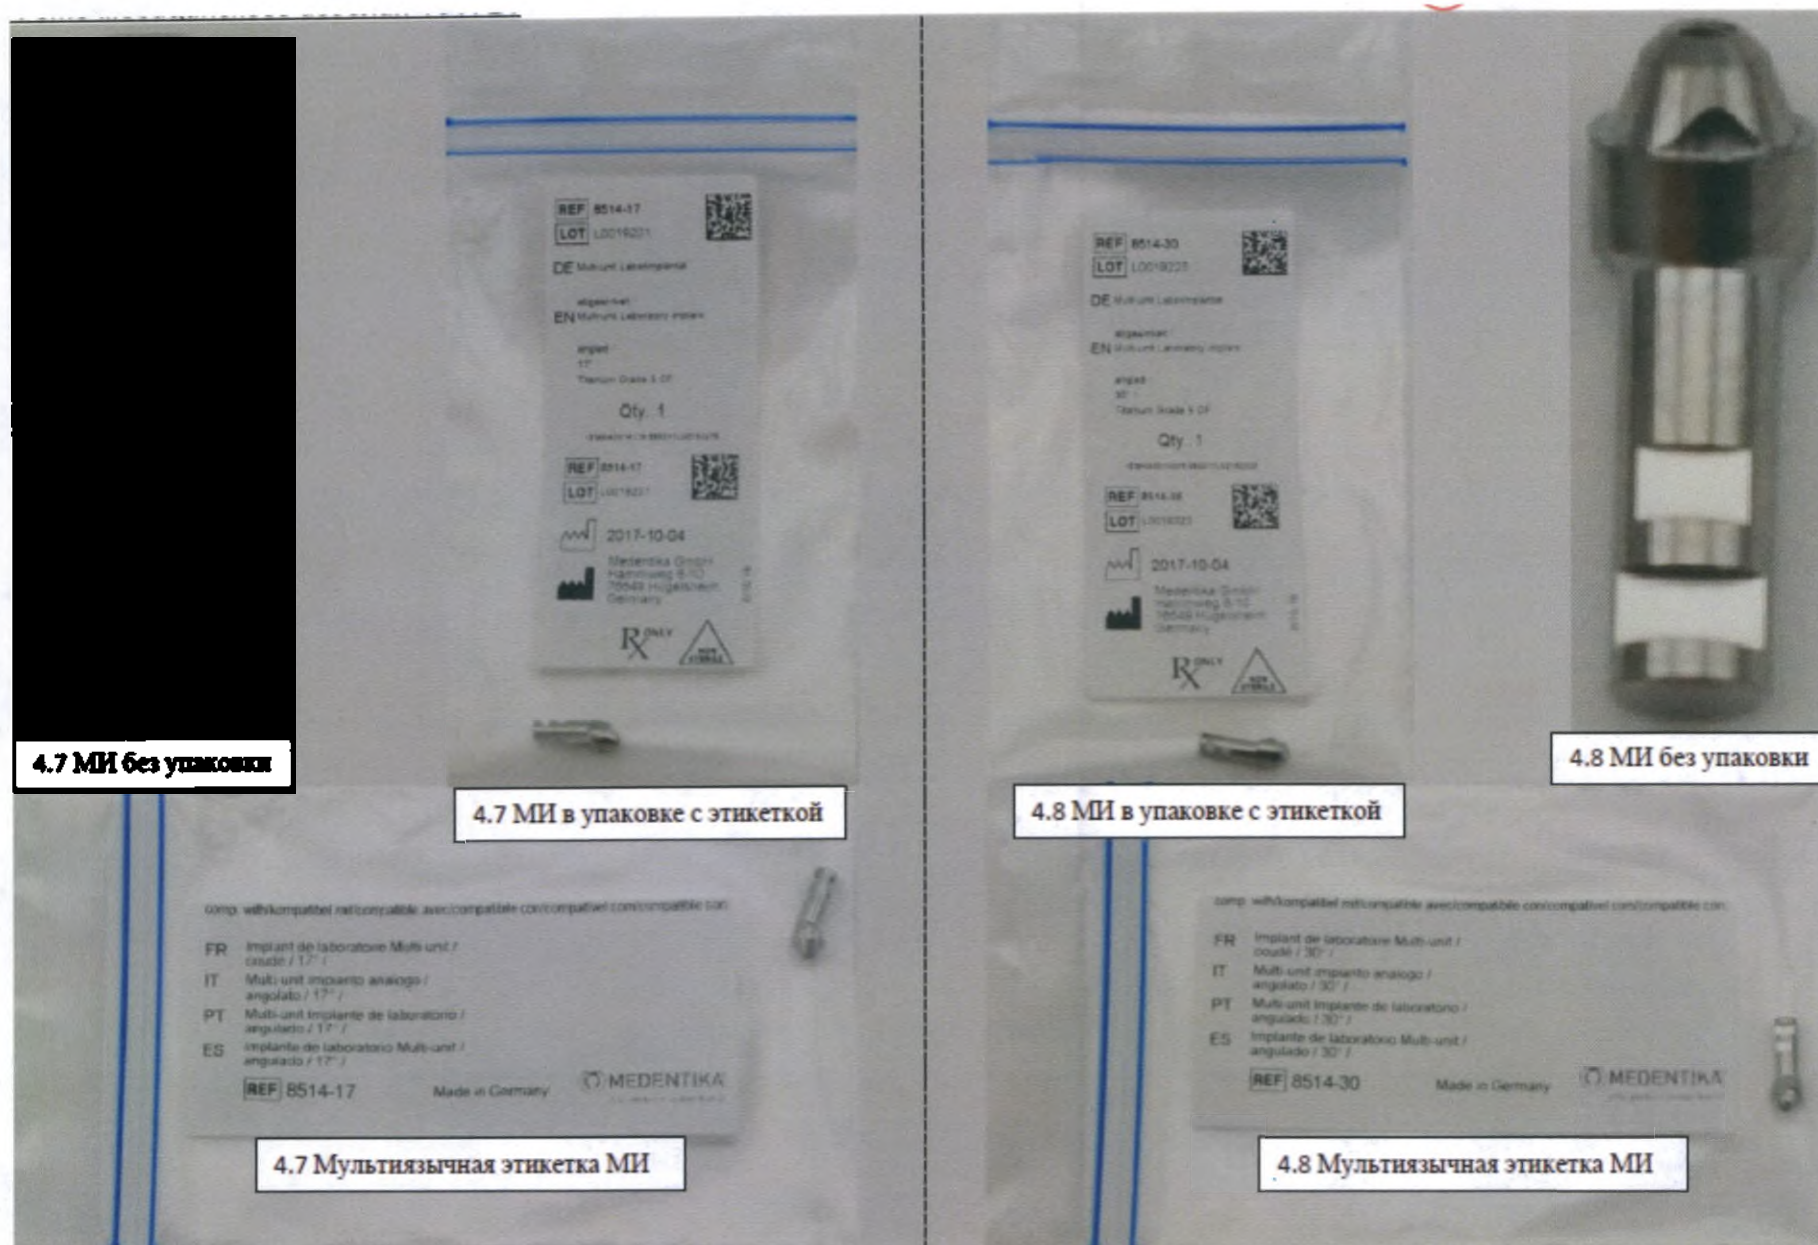

4.9-4.10 Аналог лабораторный абатмента Medenti E CAD/CAM:

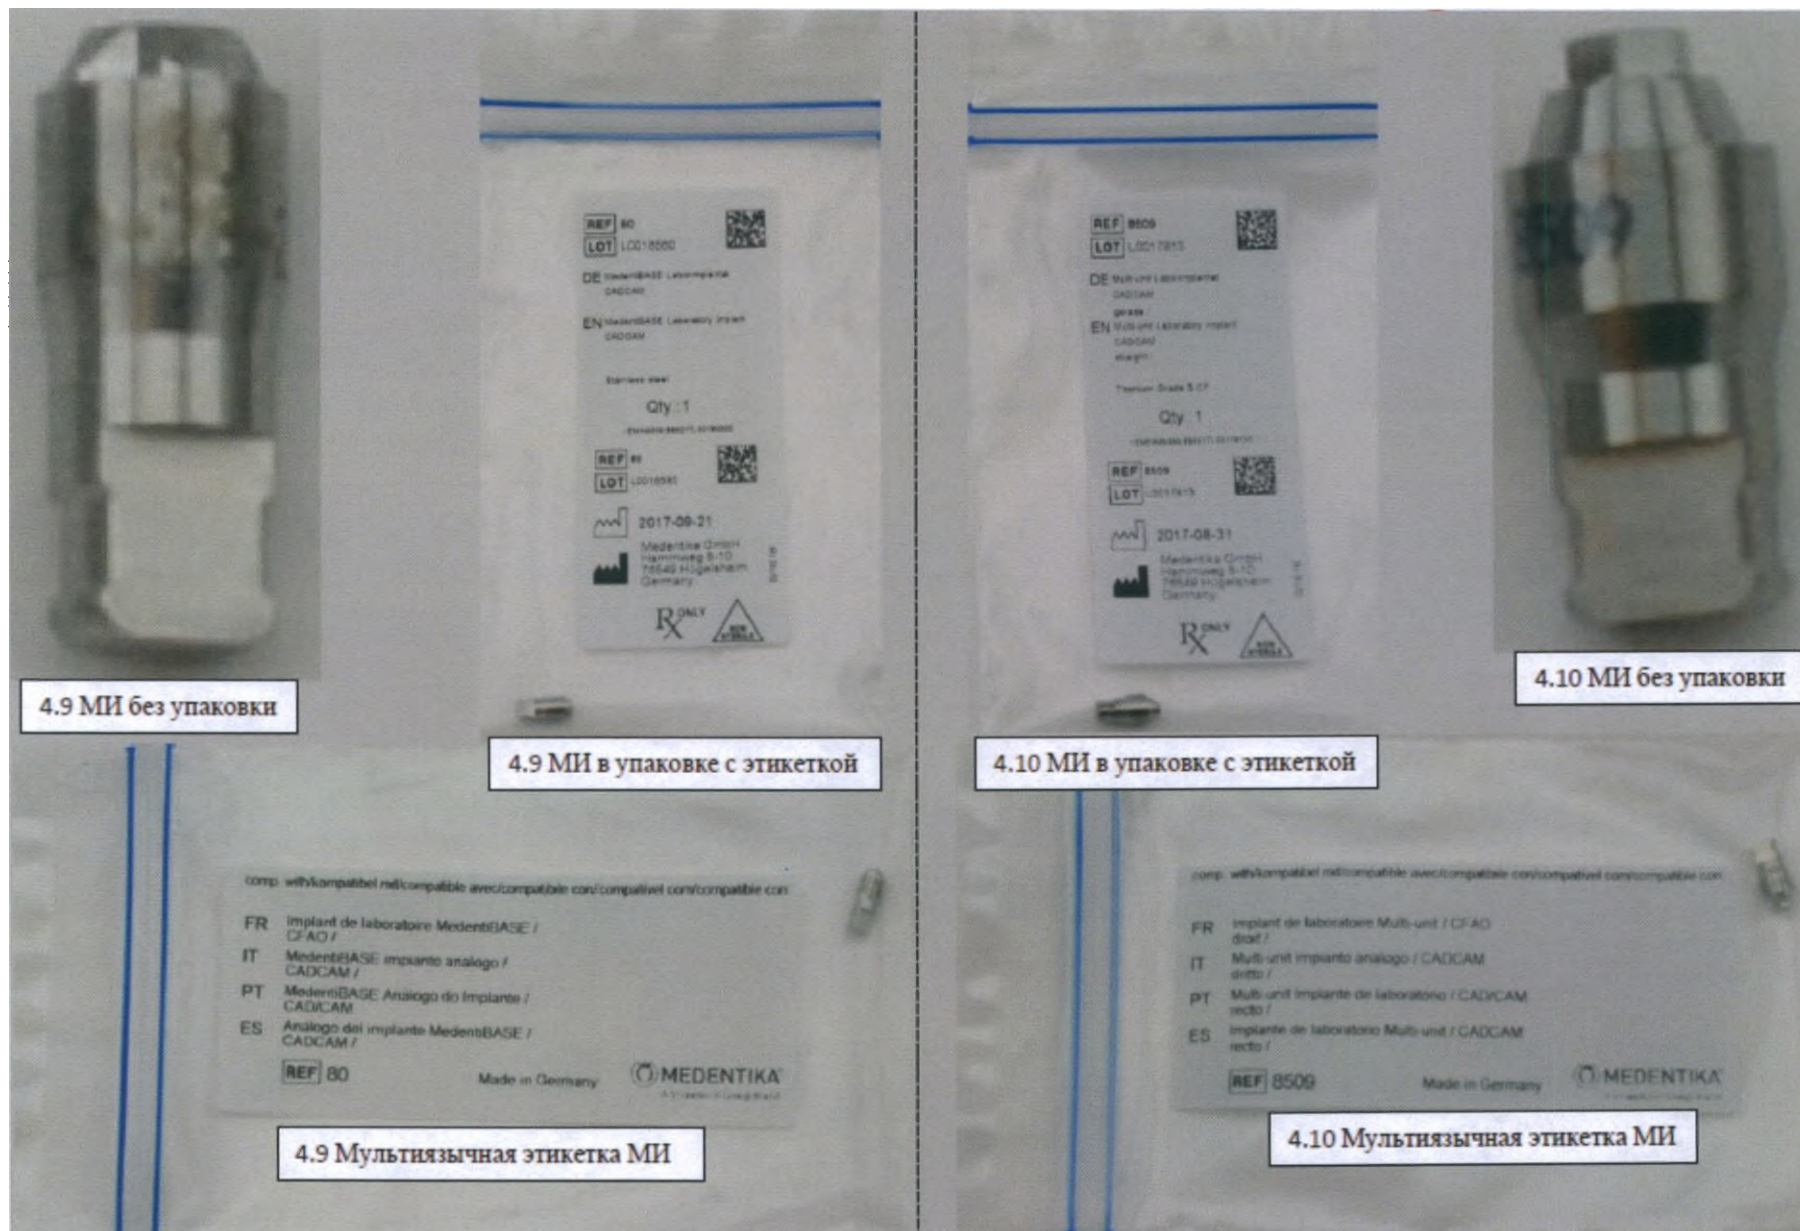

MEDENTIKA®

DE MedentiBASE Laborimplantat / CAD/CAM
EN MedentiBASE Laboratory implant / CAD/CAM
FR Analogue d'implant MedentiBASE / CFAO
IT Analogo di impianto MedentiBASE / CAD/CAM
PT MedentiBASE Análogo do implante / CAD/CAM
ES Análogo del implante MedentiBASE / CAD/CAM

Stainless steel
Compatible with:




REF 80-ET
LOT L0087327



2021-06-28

Qty.: 1

MEDENTIKA GmbH
Hammweg 9-10
76549 Hügelsheim
Germany



RX ONLY

804.29

MEDENTIKA®

DE MedentiBASE Laborimplantat / CAD/CAM
EN MedentiBASE Laboratory implant / CAD/CAM
FR Analogue d'implant MedentiBASE / CFAO
IT Analogo di impianto MedentiBASE / CAD/CAM
PT MedentiBASE Análogo do implante / CAD/CAM
ES Análogo del implante MedentiBASE / CAD/CAM

Stainless steel
Compatible with:



REF 80-ET
LOT L0087327


Qty.: 1


MEDENTIKA GmbH
Hammweg 9-10
76549 Hügelsheim
Germany






4.11-4.12 Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit CAD/CAM:

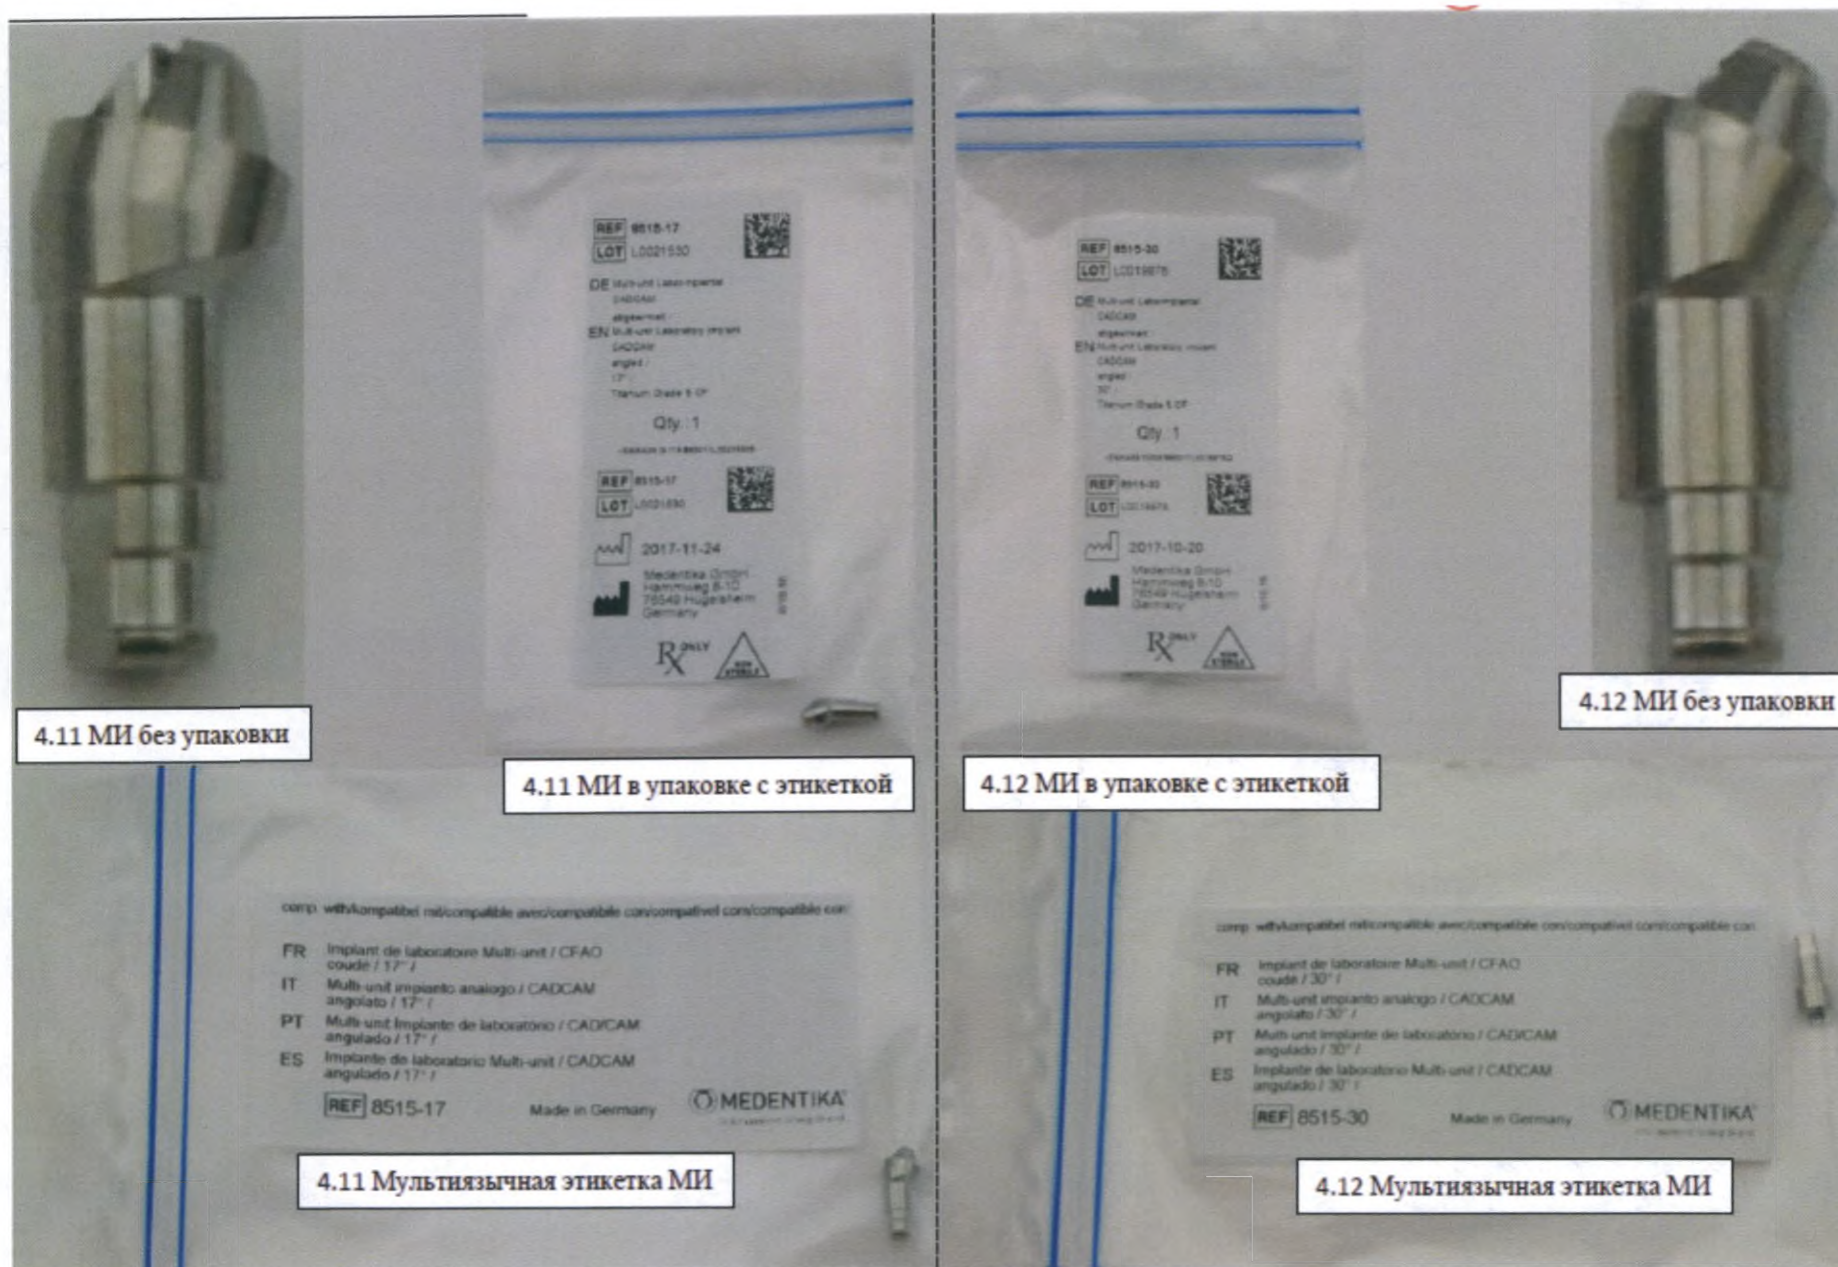

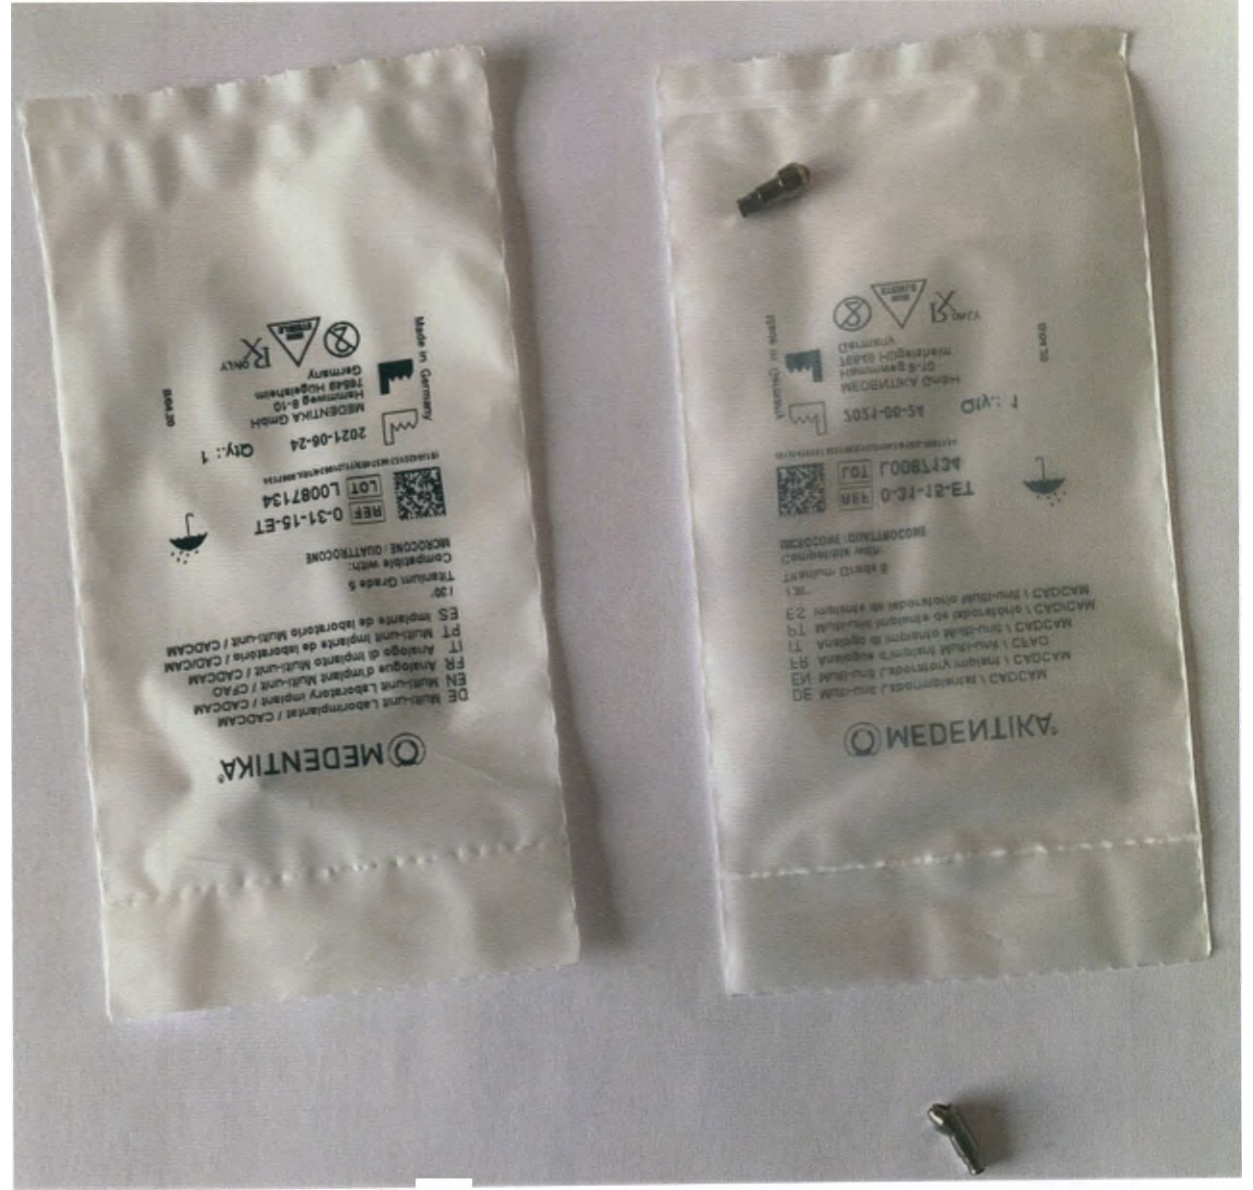

4.13. Аналог лабораторный CAD/CAM:

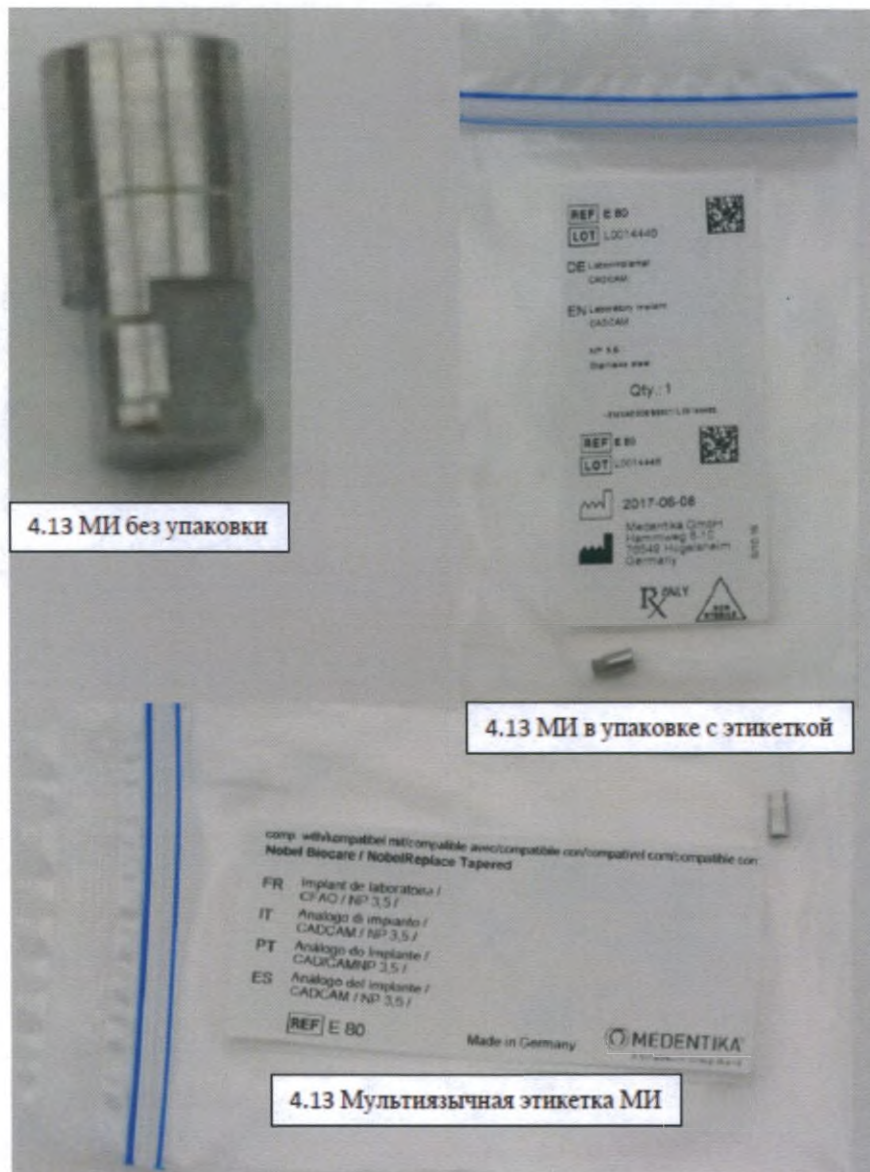



MEDENTIKA®

DE Laborimplantat / CAD/CAM
EN Laboratory Implant / CAD/CAM
FR Analogues d'implant / CAD/CAM
IT Analogo di implante / CAD/CAM
PT Análogo do implante / CAD/CAM
ES Análogo del implante / CAD/CAM

Titanium Grade 5
Compatible with: C/X 3.5-7.0
DENTIPLY BROWA / ANKYLO90 CX

REF Y 80X-ET
LOT L0087140

2021-06-24
MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76548 Hügelsheim
Germany

MEDENTIKA®


DE Laborimplantat / CAD/CAM
EN Laboratory Implant / CAD/CAM
FR Analogues d'implant / CAD/CAM
IT Analogo di implante / CAD/CAM
PT Análogo do implante / CAD/CAM
ES Análogo del implante / CAD/CAM

Titanium Grade 5
Compatible with: C/X 3.5-7.0
DENTIPLY BROWA / ANKYLO90 CX

REF Y 80X-ET
LOT L0087140

2021-06-24 Qty.: 1
MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76548 Hügelsheim
Germany


4.14. Аналог лабораторный абатмента модифицир_ого:

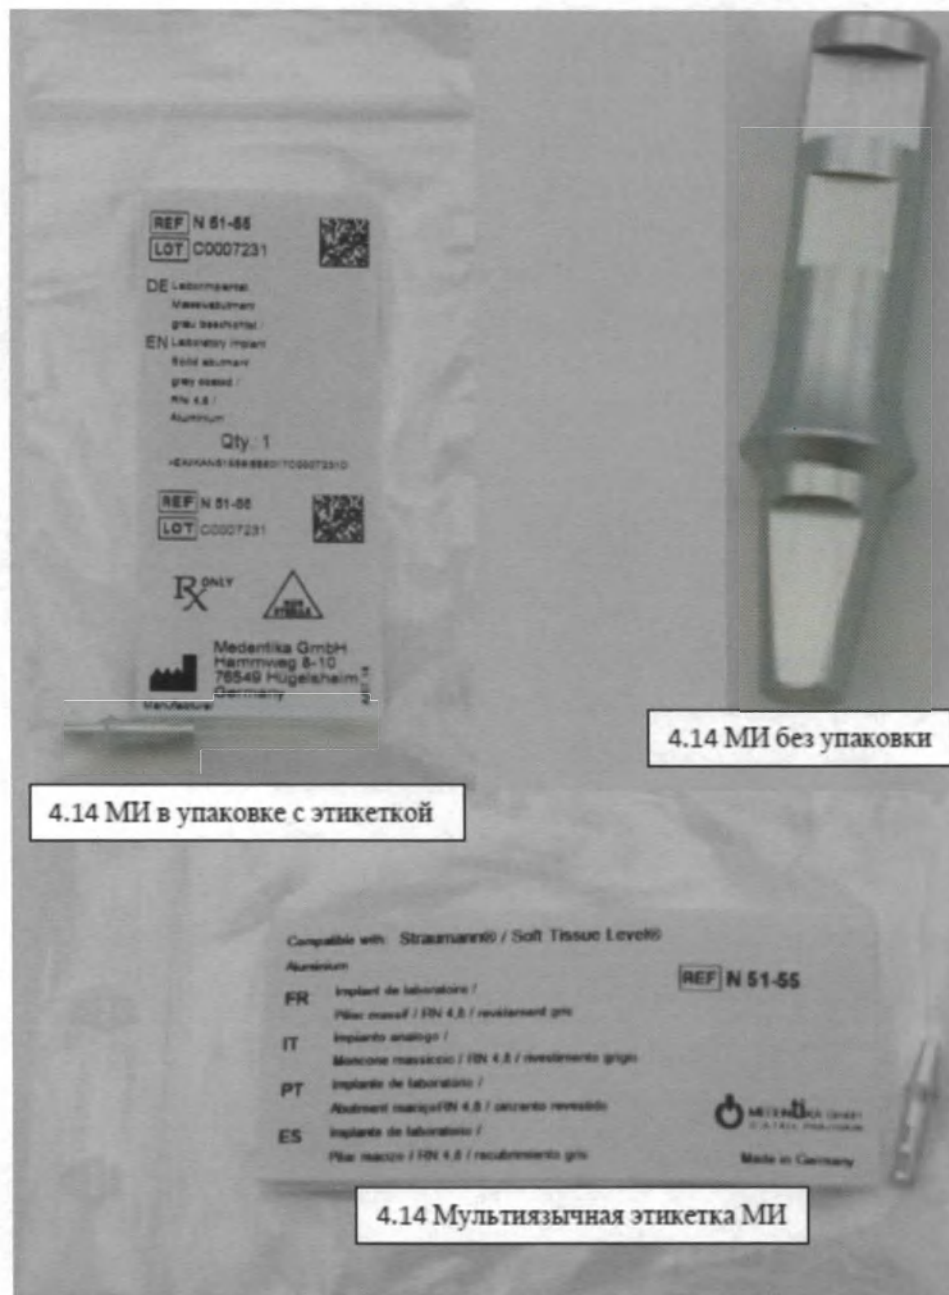


4.15. Аналог лабораторный имплантата:



МИ без упаковки

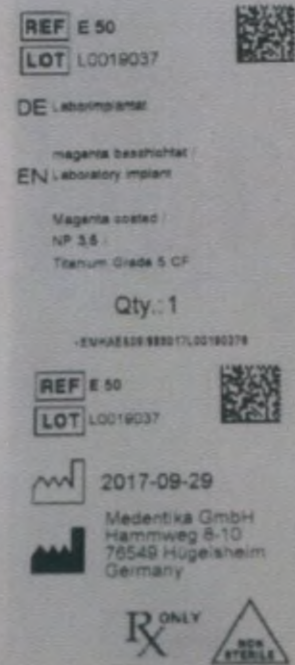

МИ в упаковке с этикеткой

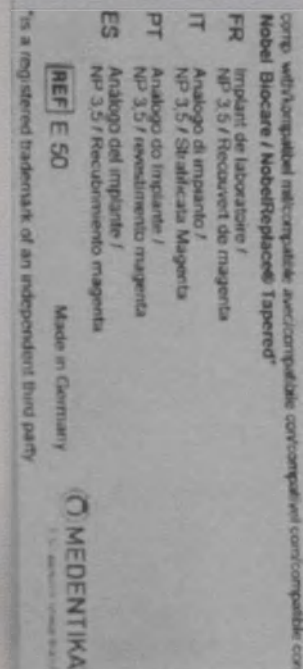

Мультиязычная этикетка МИ

МИ без упаковки

МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ



 **MEDENTIKA®**

- DE Laborschraube
- EN Laboratory screw
- FR Vis de laboratoire
- IT Vite da laboratorio
- PT Parafuso de laboratório
- ES Tornillo de laboratorio

M 1.6 / 25 Ncm
Titanium Grade 5
Compatible with:
DENTSPLY SIRONA / XIVE® S




REF T 60 L-ET
LOT L0087139

(01)04261674837820;(11)210824(10);L0087139



Made in Germany



2021-06-24 Qty.: 1
MEDENTIKA GmbH
Hammweg 8-10
76549 Hügelsheim
Germany



BUD 20

*is a registered trademark of an independent third party

6. Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки:

Упаковка МИ (пластиковая трубка)



МИ без упаковки



МИ в упаковке с этикеткой

Мультязычная этикетка МИ



7. Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный:



МИ без упаковки




МИ в упаковке с этикеткой

Мультиязычная этикетка МИ


8. Насадка для держателей протезных конструкций....



МИ без упаковки

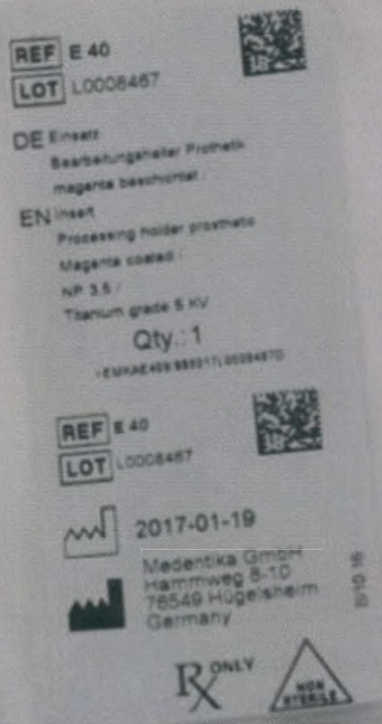


МИ в упаковке с этикеткой

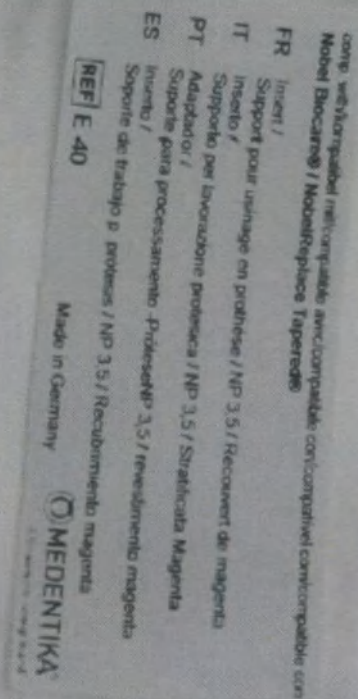


Мультиязычная этикетка МИ

9. Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма:

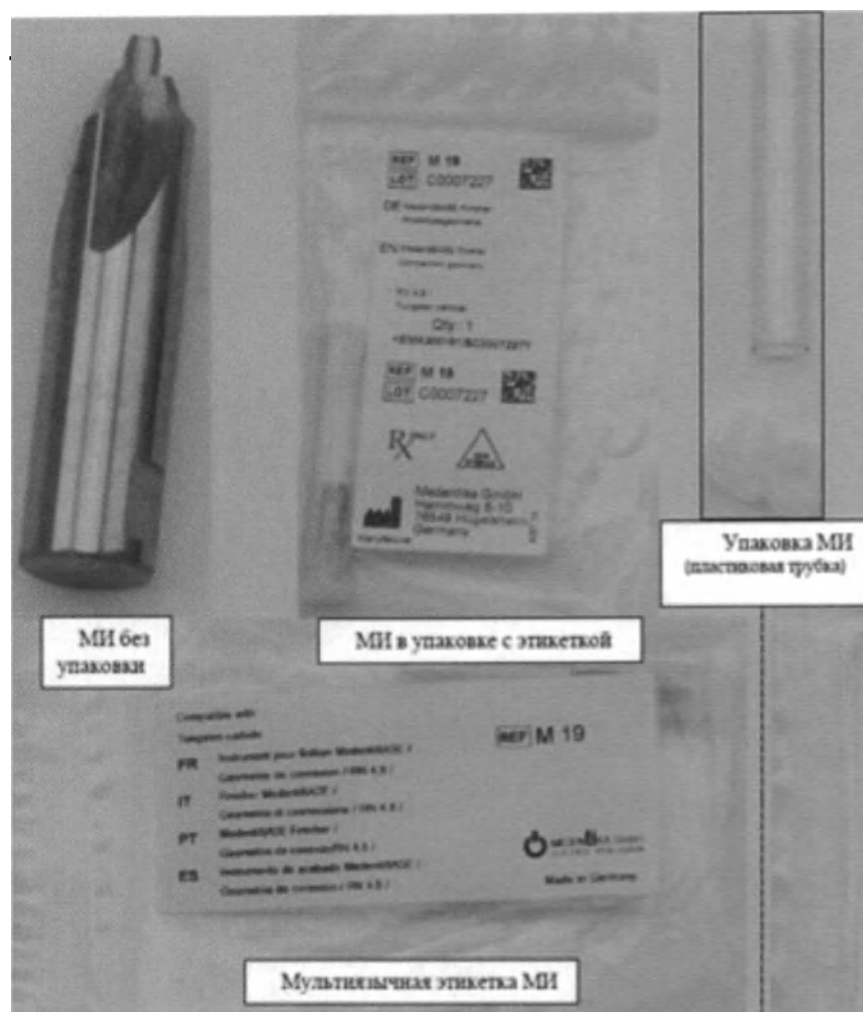

10. Развёртка MedentiBASE для шляпки винта:

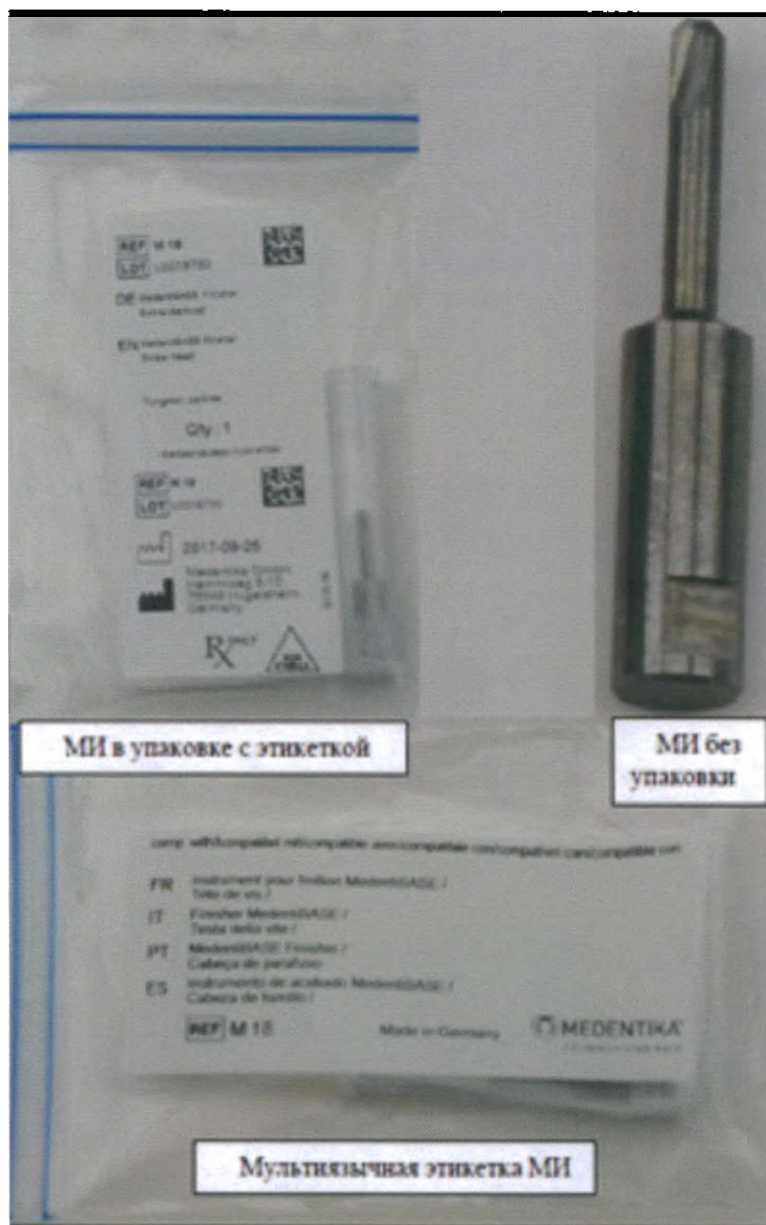

Дополнительная этикетка с маркировкой на русском языке

Сведения о совместимости с системами дентальной имплантации

Наименование на русском языке

Технические параметры

Номер по каталогу

Сведения о стране производства

Информация об уполномоченном представителе в РФ

Информация о применении

Сведения о сроке годности

Совместимо с Straumann/Tissue Level

RUS Абатмент стандартный угловой 21°, включая винт абатмента.

RN 4,8

REF N 210-2-21 Сделано в Германии

Уполномоченный представитель в России:

ООО "Штрауманн", 119571, Россия, г.

Москва, Ленинский проспект, д. 119А.

T.: +7 (495) 139-74-74

E.: info.ru@straumann.com

РУ № XXXX от XX.XX.XXXX



MEDENTIKA®

A Straumann Group Brand

Не применять при нарушении целостности потребительской упаковки. Срок годности не ограничен.

Номер и дата
регистрационного
удостоверения

Прошнуровано _____ листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»



М.А. Гребенкина