MEDENTiKA®
A Straumann Group Brand

Инструкция по применению

медицинского изделия

Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями

19.12.2022

Manufacturer/
Производитель:

MEDENTiKA GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
Germany

МЕДЕНТиКА ГмбХ
Хаммвег 8–10
76549 Хюгельсхайм
Германия

Contact persons/
Представители:

Sergiy Kolesnichenko
Expert Regulatory Affairs
Emerging Market

Сергий Колесниченко
Эксперт по регистрации в странах с формирующимся рынком

Tel./тел.: +49 (0)7229 69912-136
Email: sergiy.kolesnichenko@medentika.de

Thonas Jaberg
CEO

Томас Яберг
Директор

Tel./тел.: +49 (0)7229 69912-10

RELEASE/ВЫПУСК:
Hügelsheim/Хюгельсхайм, 22. Dez. 2022

Georg Krähling //Георг Крэлинг

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

UVZ 3074 / 2022

Vorstehende vor mir vollzogene Unterschrift von

Herr Georg Krähling,
geboren am 03.03.1960,
geschäftsansässig Hammweg 8 - 10, 76549 Hügelsheim
dem Notar von Person her bekannt

beglaubige ich hiermit öffentlich.

Der vorstehende Text ist in ausländischer Sprache verfasst. Der beglaubigende Notar ist dieser Sprache nicht mächtig und kann den Inhalt der Urkunde daher rechtlich nicht bewerten.

Gernsbach, den 22.12.2022

Dr. Kevin Kosche
Notar

DR. KEVIN KOSCHE
NOTAR IN GERNSBACH

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....6

1.1 Наименование медицинского изделия.....6

1.2 Сведения о производителе и уполномоченном представителе.....6

1.3 Назначение.....6

1.4 Область применения.....6

1.5 Условия применения..... 6

1.6 Потенциальные потребители медицинского изделия..... 6

1.7 Показания.....7

1.8 Противопоказания.....7

1.9 Рекомендации по применению..... 7

1.10 Возможные побочные действия.....7

1.11 Классификация медицинского изделия.....7

2. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ..... 8

2.1 Перечень исполнений..... 8

2.2 Серии медицинского изделия..... 19

2.3 Комплект поставки.....20

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.....21

3.1 Абатменты, винты, колпачки и основания..... 21

3.1.1 «прямые» и «угловые».....21

3.1.2 Разные углы угловых абатментов.....21

3.1.3 Разъём имплантата; серии + Типы (1 или 2) угловых абатментов.....21

3.1.4 Разъём имплантата: различный диаметр, например, NC 3,3 и RC 4,1/4,8.....24

3.1.5 Ротационные и антиротационные.....24

3.1.6 Гингивальная высота (высота десны).....24

3.1.7 Материал.....24

3.1.8 Функциональные и эксплуатационные характеристики.....25

3.2 Габаритные размеры медицинских изделий.....205

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....206

4.1 Способ применения.....206

4.1.1 Абатмент стандартный прямой/угловой.....206

4.1.2 Абатмент модифицируемый прямой/угловой.....207

4.1.3 Абатмент MedentiBASE прямой, винт и колпачок.....209

4.1.4 Абатмент MedentiLOC.....210

4.1.5 Абатмент Novaloc/Optiloc.....211

4.1.6 Абатмент POC.....212

4.1.7 Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный/антиротационный.....214

4.1.8 Абатмент PreFace.....215

4.1.9 Абатмент MedentiCAD.....217

4.1.10 Абатмент временный.....219

4.1.11 Винт углового абатмента MedentiLOC и Novaloc.....220

4.1.12 Винт абатмента.....221

4.1.13 Винт абатмента MedentiBASE.....221

4.1.14 Винт абатмента Multi-unit.....221

4.1.15 Винт-заглушка MedentiBASE.....221

4.1.16 Винт-заглушка Multi-unit.....221

4.1.17 Винт-патрица MedentiLOC для мостовидного протеза.....221

4.1.18 Винт-патрица Novaloc и Optiloc для мостовидного протеза.....222

4.1.19 Колпачок титановый MedentiBASE.....222

4.1.20 Колпачок титановый Multi-unit.....222

4.1.21 Колпачок титановый вклеиваемый MedentiBASE.....222

4.1.22 Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit.....222

4.1.23 Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных.....222

4.1.24 Колпачок пластиковый MedentiBASE.....223

4.1.25 Колпачок пластиковый вклеиваемый MedentiBASE.....223

4.1.26 Колпачок пластиковый Multi-unit.....223

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1.27 Колпачок трансфера слепочного индивидуального.....223

4.1.28 Основание титановое.....224

4.1.29 Основание титановое MedentiBASE.....225

4.1.30 Основание титановое Multi-unit.....225

4.1.31 Основание для моделирования MedentiCAD.....226

4.1.32 Абатмент для планирования прямой/угловой.....226

4.1.33 Абатменты для планирования, в наборах.....226

4.1.34 Абатмент для сканирования.....226

4.1.35 Абатмент для сканирования MedentiBASE.....227

4.1.36 Абатмент для сканирования Multi-unit (угловой).....227

4.1.37 Трансфер слепочный.....227

4.1.38 Аналоги лабораторные имплантатов и абатментов.....228

4.1.39 Аналоги имплантатов лабораторные абатментов модифицируемых.....228

4.1.40 Винт лабораторный.....228

4.1.41 Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки.....228

4.1.42 Держатель протезных конструкций.....229

4.1.43 Насадка для держателей протезных конструкций.....229

4.1.44 Развёртки MedentiBASE.....229

4.2 Условия применения.....229

5. МАРКИРОВКА.....230

6. УПАКОВКА.....231

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....247

8. СТЕРИЛЬНОСТЬ.....247

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.....248

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....248

11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....248

12. РЕКЛАМАЦИЯ.....248

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1 Наименование медицинского изделия

Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями.

1.2 Сведения о производителе и уполномоченном представителе

Производитель: «МЕДЕНТиКА ГмбХ» («MEDENTiKA GmbH»), Хаммвег 8-10, 76549 Хюгельсхайм, Германия (Hammweg 8-10, 76549 Hügelsheim, Germany). Тел.: +49 (0)7229 69912-136. Факс: +49 (0)7229 69912-20. E-mail:info@medentika.de. Сайт: www.medentika.de.

Уполномоченный представитель: Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн» (ООО «Штрауманн»), 119571, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 119А. Тел.: +7 495 139-74-74. E-mail: reginfo.ru@straumann.com

1.3 Назначение

"Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями" (далее – "медицинское изделие") предназначены для изготовления и установки одно- и многокомпонентной протезной реставрации с опорой на остеоинтегрированные дентальные имплантаты.

1.4 Область применения

Стоматология.

1.5 Условия применения

- клинические «стоматологические кабинеты» (для определения процесса лечения, проведения необходимых измерений в ротовой полости пациента и выбора компонентов, а также проведения комплексной дентальной протезной реставрации с опорой на остеоинтегрированные дентальные имплантаты);

- лабораторные «зуботехнические лаборатории» (для изготовления необходимых для проведения комплексной дентальной протезной реставрации компонентов и конструкций).

1.6 Потенциальные потребители медицинского изделия

Потенциальными потребителями медицинского изделия являются пациенты с отсутствующим одним или всеми зубами. Потенциальными пользователями медицинского изделия, в ходе осуществления лечения потенциальных потребителей (вышеупомянутых пациентов) с указанными в Техническом Файле и в Эксплуатационной Документации показаниями, являются стоматологи-хирурги и стоматологи-ортопеды.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.7 Показания

Для восстановления эстетики и функциональности зубов у частично или полностью беззубых пациентов, которые уже прошли лечение зубными имплантатами.

1.8 Противопоказания

- Аллергические реакции или сверхчувствительность на химические элементы используемых материалов.
- Инфекционные или воспалительные заболевания ротовой полости.
- Дефекты или нарушения целостности кости.
- Сахарный диабет.

1.9 Рекомендации по применению

• Медицинские изделия определённых серий можно комбинировать только с соответствующей совместимой системой имплантатов, например, серия «E» (абатменты, винты, колпачки, основания и принадлежности) только в комбинации с Nobel Biocare® / NobelReplace® Tapered (см. Таблицу № 2: Совместимость серий медицинского изделия с системами дентальной имплантации).

• Любой способ дообработки разъёмной геометрии к имплантату ведёт к образованию неточностей прилегания, которые исключают дальнейшее использование.

• При использовании абатментов MedentiBASE или Multi-unit запрещается обтачивание и изменение разъёма для соединения с протетическими компонентами, так как он является необходимым для обеспечения достаточной стабильности и прилегания.

• Все абатменты, винты, колпачки и основания предусмотрены исключительно для одноразового использования.

1.10 Возможные побочные действия

• В очень редких случаях возможны аллергические реакции и сверхчувствительность в связи с использованием сплавов.

• Разные типы сплавов в ротовой полости могут привести к гальваническим реакциям в случае окклюзального или проксимального контактов.

1.11 Классификация медицинского изделия.

«Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями» относятся к классу

2б – медицинское изделие с повышенной степенью риска – согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4 н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

2.1 Перечень исполнений

Медицинское изделие состоит из указанных ниже 26 видов абатментов, 10 видов винтов, 11 видов колпачков, 5 видов оснований и 10 видов принадлежностей, необходимых для надлежащего использования медицинского изделия. Оно представлено с 19 различными разъёмами для совместимости с 25 различными системами дентальной имплантации (серии медицинского изделия – см. Таблицу № 2).

Таблица № 1. Состав и принадлежности медицинского изделия и их назначение

Наименование медицинского изделия	Внешний вид медицинского изделия	Назначение
I.I Состав		
1. Абатменты, в вариантах исполнения		
1.1-1.5. Абатмент стандартный прямой/угловой, включая винт абатмента		Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для цементной фиксации одно- или многокомпонентной конструкции к абатменту и винтом к имплантату.
1.6-1.9. Абатмент модифицируемый прямой/угловой, включая винт абатмента и винт лабораторный		Для мануального адаптирования к требованиям пациента при помощи шлифования. Для цементной фиксации одно- или многокомпонентной конструкции к абатменту. Фиксация к имплантату: вкручивается или винтом.
1.10. Абатмент MedentiBASE прямой		Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для винтовой фиксации многокомпонентной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		конструкции к абатменту и винтом к имплантату. Фиксация к имплантату: вкручивается.
1.11-1.13. Абатмент MedentiLOC прямой/угловой, включая винт углового абатмента MedentiLOC		Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для съёмной конструкции. Фиксация к имплантату: вкручивается или винтом.
1.14-1.16. Абатмент Novaloc прямой/угловой, включая винт углового абатмента Novaloc		Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для съёмной конструкции. Фиксация к имплантату: вкручивается или винтом.
1.17. Абатмент Optiloc прямой		Стандартное практическое применение без необходимости дальнейшего адаптирования к требованиям пациента. Для съёмной конструкции. Фиксация к имплантату: вкручивается.
1.18. Абатмент POC, включая винт абатмента		Для изготовления так называемого «гибрид-абатмента». Вторая часть абатмента напрессовывается традиционным методом на абатмент POC, а весь гибрид-абатмент крепится винтом к имплантату.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.19-1.20. Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный/ротационный, включая винт абатмента		Для мануального адаптирования к требованиям пациента при помощи приливания соответствующих кобальт-хромовых сплавов в виде коронки. Фиксируется винтом к имплантату.
1.21. Абатмент PreFace, включая винт абатмента		Для мануального адаптирования к требованиям пациента при помощи CAD/CAM (системой компьютерного моделирования и изготовления индивидуальной продукции). Для цементной фиксации конструкции к абатменту и винтом к имплантату.
1.22. Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента		Для изготовления индивидуального абатмента при помощи CAD/CAM. Для цементной фиксации конструкции к абатменту и винтом к имплантату.
1.23-1.26. Абатмент временный угловой/прямой/ротационный, включая винт абатмента		Для временной реставрации, на время изготовления постоянной одно- или многокомпонентной конструкции.
2. Винты, в вариантах исполнения		
2.1. Винт углового абатмента MedentiLOC		Фиксация углового абатмента MedentiLOC к остеоинтегрированному дентальному имплантату.
2.2. Винт углового абатмента Novaloc		Фиксация углового абатмента Novaloc к остеоинтегрированному дентальному имплантату.
2.3. Винт абатмента		Фиксация абатмента к остеоинтегрированному дентальному имплантату.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.4. Винт абатмента MedentiBASE		Фиксация многокомпонентной конструкции к абатменту MedentiBASE.
2.5. Винт абатмента Multi-unit		Фиксация многокомпонентной конструкции к абатменту Multi-unit.
2.6. Винт-заглушка MedentiBASE		Защита абатмента MedentiBASE и его винтового канала от повреждений и загрязнений. Предотвращение роста десны (гингивы) над абатментом MedentiBASE.
2.7. Винт-заглушка Multi-unit		Защита абатмента Multi-unit и его винтового канала от повреждений и загрязнений. Предотвращение роста десны (гингивы) над абатментом Multi-unit.
2.8-2.10. Винт-патрица MedentiLOC/ Novaloc/ Optiloc для мостовидного протеза		Для съёмной конструкции. Фиксация к абатменту или к мостовидной конструкции, на которой в последствии будет держаться протез.
3. Колпачки, в вариантах исполнения		
3.1. Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE		Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту MedentiBASE в клинических и лабораторных условиях.
3.2. Колпачок Multi-unit, титановый включая винт абатмента Multi-unit		Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту Multi-unit в клинических и лабораторных условиях.
3.3-3.4. Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт абатмента MedentiBASE		Для уменьшения внутреннего напряжения сжатия и растяжения при размещении мостовидной конструкции на абатментах MedentiBASE в

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		клинических условиях.
3.5. Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit		Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту Multi-unit в клинических и лабораторных условиях.
3.6. Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных		Для определения точного месторасположения абатмента и остеоинтегрированного имплантата при снятии слепка в клинических условиях.
3.7. Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE		Для моделирования многокомпонентной конструкции в лабораторных условиях.
3.8-3.9. Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт для моделирования		Для моделирования многокомпонентной конструкции для абатмента MedentiBASE в лабораторных условиях.
3.10. Колпачок Multi-unit пластиковый		Для моделирования многокомпонентной конструкции для абатмента Multi-unit в лабораторных условиях.
3.11. Колпачок трансфера слепочного индивидуального		Для определения точного месторасположения формирователя десны и остеоинтегрированного имплантата при снятии слепка трансфером слепочным индивидуальным закрытой ложки в клинических условиях.
4. Основания, в вариантах исполнения		
4.1-4.2. Основание титановое/Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента		- для изготовления однокомпонентной конструкции (циркониевого абатмента/циркониевой коронки) на титановом основании при помощи фиксации циркониевого компонента цементом к

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		основанию. - для изготовления многокомпонентной мостовидной конструкции из диоксида циркония при помощи фиксации циркониевой конструкции цементом к основанию. Фиксируются винтом к имплантату.
4.3. Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE		Для изготовления и размещения одно- или многокомпонентной конструкции (циркониевого абатмента/циркониевой коронки/мостовидной конструкции из диоксида циркония) на абатменте MedentiBASE на титановом основании при помощи фиксации циркониевого компонента цементом к основанию винтом абатмента MedentiBASE к абатменту MedentiBASE.
4.4. Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit		Для изготовления и размещения одно- или многокомпонентной конструкции (циркониевого абатмента/циркониевой коронки/мостовидной конструкции из диоксида циркония) на абатменте Multi-unit на титановом основании при помощи фиксации циркониевого компонента цементом к основанию винтом абатмента Multi-unit к абатменту Multi-unit.
4.5. Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента		Для воскового моделирования одно- или многокомпонентной конструкции в лабораторных условиях.
II. Принадлежности		
1. Абатменты для планирования		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.1-1.3. Абатмент для планирования прямой/угловой		Для планирования одно- или многокомпонентной конструкции на модели в лабораторных условиях. Имитирует соответствующий абатмент с определённым разъёмом.
1.4-1.15. Набор абатментов для планирования		Для планирования одно- или многокомпонентной конструкции на модели в лабораторных условиях. Наборы скомпонованы по сериям.
2. Абатменты для сканирования		
2.1. Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации		Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения абатмента и остеоинтегрированного имплантата.
2.2. Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE		Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения абатмента MedentiBASE.
2.3. Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit		Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения абатмента Multi-unit.
2.4. Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit		Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения углового абатмента Multi-unit.
3. Трансферы		
3.1. Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий		Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости методом закрытой ложки (высота,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		направление, позиция) в клинических условиях.
3.2. Трансфер слепочный индивидуальный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий		Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости, а также прилегающей к имплантату сформированной десны методом закрытой ложки при помощи колпачка трансфера слепочного индивидуального (высота, направление, позиция) в клинических условиях.
3.3-3.4. Трансфер слепочный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации		Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости методом открытой ложки (высота, направление, позиция) в клинических условиях.
3.5-3.6. Трансфер слепочный индивидуальный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации		Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости, а также прилегающей к имплантату сформированной десны методом открытой ложки при помощи колпачка трансфера слепочного индивидуального (высота, направление, позиция) в клинических условиях.
3.7. Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации		Для снятия слепка с абатмента MedentiBASE в клинических условиях.
3.8. Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации		Для снятия слепка с абатмента Multi-unit в клинических условиях.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Аналоги		
4.1-4.2. Аналог лабораторный прямого/углового абатмента MedentiLOC		Для планирования и изготовления съёмной многокомпонентной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент MedentiLOC.
4.3-4.4. Аналог лабораторный прямого/ углового абатмента Novaloc		Для планирования и изготовления съёмной многокомпонентной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент Novaloc.
4.5. Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент MedentiBASE.
4.6. Аналог лабораторный абатмента Multi-unit		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент Multi-unit.
4.7-4.8. Аналог лабораторный углового 17°/30° абатмента Multi-unit		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует угловой 17°/30° абатмент Multi-unit.
4.9. Аналог лабораторный абатмента MedentiBASE CADCAM		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		конструкции на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент MedentiBASE.
4.10. Аналог лабораторный абатмента Multi-unit CADCAM		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной конструкции на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях. Имитирует абатмент Multi-unit.
4.11-4.12. Аналог лабораторный углового 17° /30°абатмента Multi-unit CADCAM		Для планирования и изготовления фиксированной многокомпонентной конструкции на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях. Имитирует угловой 17°/30° абатмент Multi-unit CADCAM.
4.13. Аналог лабораторный CADCAM		Для планирования и изготовления одно- или многокомпонентной, фиксированной или съёмной конструкции на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях. Имитирует имплантат соответствующей серии.
4.14. Аналог лабораторный абатмента модифицируемого		Для планирования и изготовления одно- или многокомпонентной фиксированной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях. Имитирует имплантат с вкрученным в него цельным абатментом серии N следующих каталожных номеров: N 110-40, N 110-55, N 110-70, N 120-40, N

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

		120-55.
4.15. Аналог лабораторный имплантата		Для планирования и изготовления одно- или многокомпонентной конструкции на модели в лабораторных условиях. Имитирует имплантат с соответствующим разъёмом.
5. Винт лабораторный		Для фиксации различных компонентов при планировании и изготовлении одно- или многокомпонентной конструкции на модели в лабораторных условиях.
6. Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки		Для фиксации трансфера слепочного во время снятия слепка методом открытой ложки в клинических условиях.
7. Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный		Для моделирования и работы над протезными конструкциями в лабораторных условиях при помощи насадок.
8. Насадка для держателей протезных конструкций		Для имитации соответствующего разъёма имплантата при моделировании и работе над протезными конструкциями в лабораторных условиях при помощи держателя.
9. Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма		Для финальной обработки протезных конструкций перед позиционированием на абатмент MedentiBASE.
10. Развёртка MedentiBASE для шляпки винта		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.2 Серии медицинского изделия

Каждая серия медицинского изделия совместима с только с одной системой дентальной имплантации (исключение: Серия «R» совместима с 3 различными системами дентальной имплантации).

Сопоставление между сериями медицинского изделия и соответствующими совместимыми системами дентальной имплантации приведено в Таблице 2.

Таблица 2. Совместимость серий медицинского изделия с системами дентальной имплантации

№	Серия медицинского изделия	Наименование совместимой системы дентальной имплантации	Производитель совместимой системы дентальной имплантации
1	Серия «B»	SKY Implant System	Bredent Medical
2	Серия «BS»	Semados Implant Systems	BEGO GmbH
3	Серия «C»	Implant Systems: Camlog Screw-Line Root-Line	Altatec
4	Серия «CX»	ICX Implant System	Medentis Medical
5	Серия «D»	Conelog Implant System	Altatec
6	Серия «E»	Replace Select Tapered Implant System	Nobel Biocare
7	Серия «EV»	ASTRA TECH Osseospeed EV Implant System	Dentsply Implants
8	Серия «F»	Implant Systems: NobelActive Nobel Replace Conical	Nobel Biocare
9	Серия «H»	Osseotite Certain Implant System	Biomet 3i
10	Серия «I»	Osseotite Implant System	Biomet 3i
11	Серия «K»	Branemark Implant System	Nobel Biocare
12	Серия «L»	Bone Level Implant System	Straumann
13	Серия «N»	Standard Implant System	Straumann
14	Серия «R*»	Tapered Screw-Vent Implant System	Zimmer
		SEVEN Internal Hex Implant System	MIS
		Implant Systems: Tapered Internal Internal Plus Tissue Level	BioHorizons
15	Серия «S»	ASTRA TECH OsseoSpeed Implant System	Dentsply Implants
16	Серия «T»	Xive Implant System	Dentsply Implants
17	Серия «Y»	Ankylos Implant System	Dentsply Implants
18	Microcone / Quattrocone	Microcone/ Quattrocone Implant Systems	MEDENTiKA GmbH
19	Quattrocone 30°	Quattrocone 30° Implant System	MEDENTiKA GmbH

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

*Изделия серии «R» совместимы с тремя системами имплантатов, имеющими одинаковый разъём.

2.3 Комплект поставки

Все изделия поставляются укомплектованными в соответствии с их наименованием в индивидуальной упаковке, исключение составляют 2 позиции:

I. 3.6 Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных: 1-04-07; 2-04-19; 30; 31. (Колпачки упаковываются по пять штук).

II. 1.4-1.15 Набор абатментов для планирования: 1-15-07; 2-15-10; EPS; FPS; HPS; IPS; KPS; LPS; NPS; RPS; SPS; TPS. (Наборы абатментов для планирования комплектуются изделиями позиций II. 1.1 и II. 1.2-1.3 согласно нижеприведённой Таблице 3).

Таблица 3.

Каталожный номер набора	Перечень абатментов для планирования, входящих в соответствующий набор
1-15-07	1-15-01, 1-15-02, 1-15-03, 1-15-04, 1-15-05, 1-15-06
2-15-10	2-15-01, 2-15-02, 2-15-03, 2-15-04, 2-15-05, 2-15-06, 2-15-07, 2-15-08, 2-15-09
EPS	EP 100, EP 110, EP 120, EP 130, EP 200-1, EP 210-1, EP 220-1, EP 230-1, EP 200-2, EP 210-2, EP 220-2, EP 230-2
FPS	FP 100-3, FP 110-3, FP 200-1-3, FP 200-2-3, FP 210-1-3, FP 210-2-3
HPS	HP 100-3, HP 110-3, HP 120-3, HP 200-1-3, HP 210-1-3, HP 220-1-3, HP 200-2-3, HP 210-2-3, HP 220-2-3
IPS	IP 110, IP 210-1, IP 210-2
KPS	KP 110, KP 210-1, KP 210-2
LPS	LP 100-3, LP 110-3, LP 200-1-3, LP 210-1-3, LP 200-2-3, LP 210-2-3
NPS	NP 100, NP 110, NP 120, NP 200, NP 210-1, NP 210-1-21, NP 220-1, NP 210-2, NP 210-2-21, NP 220-2
RPS	RP 100, RP 110, RP 120, RP 200-1, RP 200-2, RP 210-1, RP 210-2, RP 220-1, RP 220-2
SPS	SP 100-3, SP 110-3, SP 120-3, SP 200-3, SP 210-3, SP 220-3
TPS	TP 100, TP 105, TP 110, TP 120, TP 200-1, TP 205-1, TP 210-1, TP 220-1, TP 200-2,TP 205-2, TP 210-2, TP 220-2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

3.1 Абатменты, винты, колпачки и основания

Абатменты, винты, колпачки и основания могут отличаться, кроме своего соответствующего назначения, ещё и следующими параметрами:

3.1.1 «прямые» и «угловые»



Угловой абатмент, в отличие от прямого, изменяет направление имплантата в соответствии с определённым углом (например, 16°, 18° или 30°).

3.1.2 Разные углы угловых абатментов, например, 15°, 16°, 18° и т. д.

3.1.3 Разъём имплантата; серии + Типы (1 или 2) угловых абатментов.

Принадлежность абатментов и других компонентов (таких как: винт, колпачок, основание и т. д.) к сериям обозначена соответствующей буквой серии в каталожном номере абатмента или соответствующего компонента и означает, что геометрический разъём этих изделий является совместимым с разъёмом соответствующего имплантата.

Тип 1 и тип 2 отличаются между собой наклоном абатмента к грани (тип 1) или к выступу (тип 2) разъёма (см. Таблицу 4).

Таблица 4.

Серия	Схематическое изображение
Серия «B» - Bredent Medical (SKY)	Тип 1 – наклон абатмента к грани
Серия «BS» - BEGO Implant Systems (Semados S-Line / Semados RS/RSX-Line / Semados RI-Line)	
Серия «C» - Altatec (Camlog Screw-Line – Root-Line 2)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия «CX» - Medentis Medical (ICX)		
Серия «D» - Altatec (Connelog)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «E» - Nobel Biocare (NobelReplace Tapered)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
		
Серия «EV» - DENTSPLY Implants (ASTRA TECH OsseoSpeed EV)		
Серия «F» - Nobel Biocare (NobelActive / NobelReplace Conical)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «H» - BIOMET 3i (Certain)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «I» - BIOMET 3i (External Hex)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «K» - Nobel Biocare (Brånemark)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия «L» - Straumann (Bone Level)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «N» - Straumann (Tissue Level)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «R»: Zimmer Dental (Tappered Screw-Vent) MIS (SEVEN Internal Hex) BioHorizons (Tapered Internal / Internal Plus / Tapered Tissue Level) Lifecore RENOVA	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «S» - DENTSPLY Implants (ASTRA TECH OsseoSpeed TX)		
Серия «T» - DENTSPLY Implants (XiVE S)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу
Серия «Y» - DENTSPLY Implants (ANKYLOS)		
MEDENTiKA (Microcone/Quattrocone)	Тип 1 – наклон абатмента к грани	Тип 2 – наклон абатмента к выступу

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	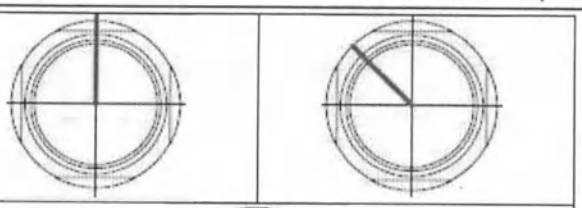
MEDENTiKA (Quattrocone 30°)	

3.1.4 Разъём имплантата: различный диаметр, например, NC 3,3 и RC 4,1/4,8

На этикетке указывается соответствующий диаметр медицинского изделия, что является вспомогательным для выбора стоматологом по диаметру подходящего медицинского изделия или принадлежности для безопасного применения в комбинации с другими медицинскими изделиями.

3.1.5 Ротационные и антиротационные

Антиротационные абатменты и принадлежности определённой серии имеют разъём соответствующего имплантата и фиксируются в разъёме винтом абатмента, что не даёт возможности вращения вокруг своей оси из-за геометрической конструкции.

Ротационные абатменты и принадлежности фиксируются винтом абатмента к верхней части имплантата, не достигая его разъёма, и могут проворачиваться вокруг своей оси, перед тем как будут надёжно зафиксированы винтом абатмента.

3.1.6 Гингивальная высота (высота десны)

3.1.7 Материал

Таблица 5.

№	Наименование материала	Поставщик материала	Страна	Контакт с пациентом
1	Титан класса 5	Zapp Precision Metals GmbH	Германия	да
2	Титан класса 4	Zapp Precision Metals GmbH	Германия	да
3	Кобальт-хром-молибденовый сплав	Zapp Precision Metals GmbH	Германия	да
4	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305	Zapp Precision Metals GmbH	Германия	да
5	Покрытие нитридом титана	Notter GmbH	Германия	да
6	Покрытие плазменно-химическим осаждением из газовой формы (ПХГФО) - ADLC	OC Oerlikon Balzers AG	Лихтенштейн	да
7	Поливинилиденфторид ПВДФ/PVDF	DentalPlus GmbH	Германия	да

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8	Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) - PEEK	Ensinger GmbH	Германия	да
9	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC	Ensinger GmbH	Германия	нет
10	Полиформальдегид (полиоксиметилен) - POM	Ensinger GmbH	Германия	нет
11	Алюминий	Ferd. Haecker KG	Германия	нет
12	Твёрдый сплав: Карбид вольфрама 88 % и кобальта 12 %	Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG	Германия	нет

3.1.8 Функциональные и эксплуатационные характеристики

Схематичное представление технических параметров, указанных в таблицах ниже.

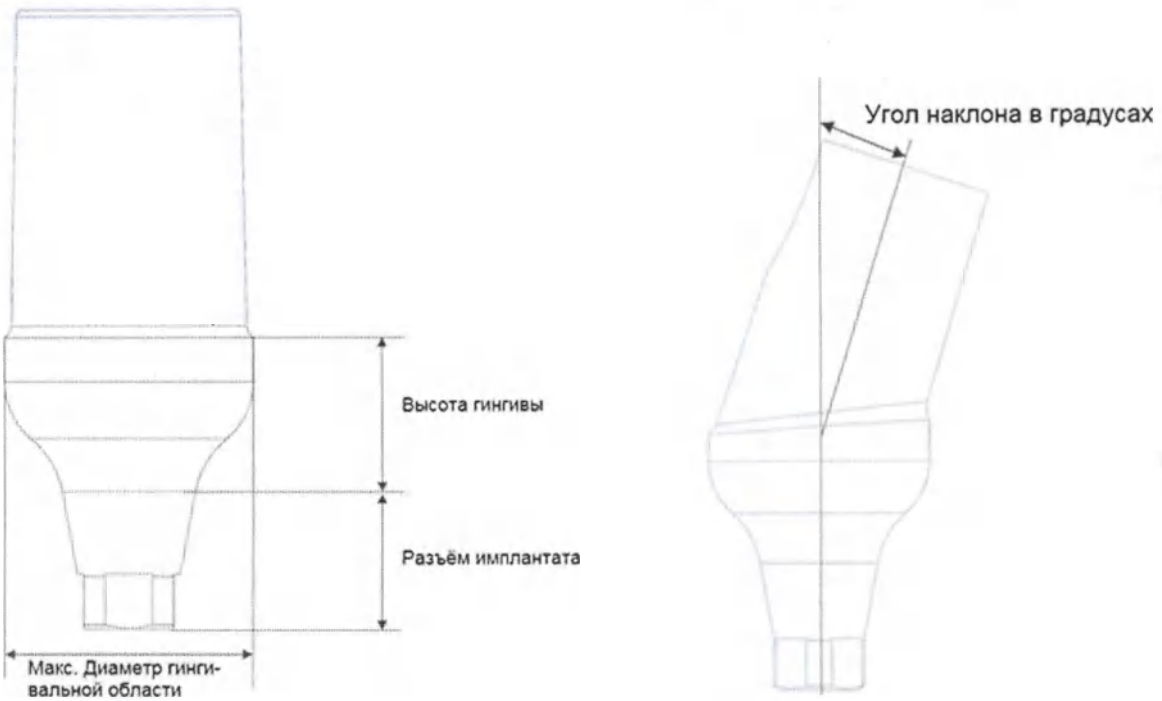

Ниже приведены все артикулы с их соответствующими техническими параметрами и характеристиками в форме таблиц.

Пояснение шапки таблиц (колонки присутствуют в случае наличия информации):

- Кат. № - каталожный номер медицинского изделия
- Название медицинского изделия – в соответствии с маркировкой МИ
- Номер в заявлении на регистрацию – номер пункта в заявлении на госрегистрацию МИ в РФ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Вес МИ нетто, г – Вес медицинского изделия, находящегося в упаковке (без тары), например, для продукта «Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC» вес изделия состоит из веса абатмента MedentiLOC + веса винта углового абатмента MedentiLOC

- Совместимость с системами – с какими системами возможно использование МИ, согласно Таблице № 1: Совместимость серий медицинского изделия с системами дентальной имплантации

- Угол наклона в градусах – см. схематичное представление выше

- Разъём имплантата – см. схематичное представление выше

- Макс. диаметр гингивальной области – см. схематичное представление выше

- Высота гингивы – см. схематичное представление выше

- Вращающий момент – с какой силой (в Ncm) необходимо вкручивать винт

- Материал – из какого материала изготовлено МИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изделия протетические для систем дентальной имплантации

I.I Состав:

1. Абатменты, в вариантах исполнения:

1.1. Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
1-07-01	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,16	Microcone®	NI	D 3,5	GH 1,5	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-02	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,20	Microcone®	NI	D 3,5	GH 3,0	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-07	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,76	Microcone®	NI	D 3,5	GH 5,0	15 Ncm	Титан класса 5
2-07-01	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,28	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-02	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,42	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-03	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,61	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-04	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,33	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента								класса 5
2-07-05	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,42	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-06	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,72	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-20	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,23	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 3,5	GH 0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-23	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,43	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-24	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,64	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-25	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,96	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
E 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,36	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 4,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 100-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 3,7	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,55	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 5,3	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 110-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,16	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 4,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 120	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,67	Nobel Biocare / NobelReplace	WP 5,0	D 5,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента			Tapered					класса 5
E 120-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,54	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 5,6	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 130	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,84	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 130-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,75	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	D 6,2	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,31	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 100-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 4,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,45	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 110-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,18	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
H 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 4,2	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 100-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,13	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 4,5	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,36	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 4,7	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 110-3	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,15	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 5,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента								класса 5
H 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,56	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 5,9	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 120-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,77	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 6,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
I 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,27	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,42	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,61	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,27	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,42	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,69	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,26	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 100-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,15	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 4,2	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 110	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,45	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента								класса 5
L 110-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,15	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,20	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	D 4,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,21	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 110L	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,23	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,27	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 4,3	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
R 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,29	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 100-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,14	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,56	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 110-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,74	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 120-1	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,79	Zimmer Dental / Tapered	D 5,7	D 6,0	GH 1,0	30 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента			Screw-Vent					класса 5
S 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 4,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 100-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,09	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,35	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 110-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,44	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,67	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 6,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 120-3	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,83	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 6,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 130	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	D 3,5	GH 1,5	15 Ncm	Титан класса 5
T 100	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 4,5	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 100-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,14	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 105	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,46	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 5,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 105-1	Абатмент стандартный	I. 1.1	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента								класса 5
Т 110	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,61	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 5,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
Т 110-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,43	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
Т 120	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,91	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	D 6,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
Т 120-1	Абатмент стандартный прямой, включая винт абатмента	I. 1.1	0,64	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	D 6,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5

1.2- 1.3. Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
Е 200-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 4,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
Е 200-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 3,7	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
Е 200-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 4,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
Е 200-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт	I. 1.3	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 3,7	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	абатмента. Тип 2									
E 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,43	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 210-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 210-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,45	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 210-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,31	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,54	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 220-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,42	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,2	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,56	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 220-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,42	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,2	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 230-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,90	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 230-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,67	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,2	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 230-2	Абатмент стандартный	I. 1.3	0,88	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 16°, включая винт абатмента Тип 2									
E 230-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,68	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,2	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
I 200-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,25	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 3,4	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 200-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,23	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 3,4	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,18	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 210-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,18	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,69	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 5,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,69	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 5,0	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 200-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,26	Nobel Biocare / Brånemark	16°	NP 3,5	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 200-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,25	Nobel Biocare / Brånemark	16°	NP 3,5	D 4,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,35	Nobel Biocare / Brånemark	16°	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 210-2	Абатмент стандартный	I. 1.3	0,18	Nobel Biocare /	16°	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2			Brånemark						класса 5
K 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,23	Nobel Biocare / Brånemark	16°	WP 5,1	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,23	Nobel Biocare / Brånemark	16°	WP 5,1	D 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 200	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,17	Straumann / Tissue Level	16°	NN 3,5	D 4,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,25	Straumann / Tissue Level	16°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 210-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,25	Straumann / Tissue Level	16°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,31	Straumann / Tissue Level	16°	WN 6,5	D 4,3	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,31	Straumann / Tissue Level	16°	WN 6,5	D 4,3	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
R 200-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,30	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 200-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,23	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 3,5	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 200-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,30	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 200-2-1	Абатмент стандартный	I. 1.3	0,23	Zimmer / MIS /	16°	D 3,5	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2.			BioHorizons / Lifecore Biomedical						класса 5
R 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,49	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 210-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,48	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 210-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,49	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 210-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,36	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,74	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 220-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,54	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,0	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,75	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 220-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,54	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,0	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 200	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,5/4,0	D 4,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 200-3	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,18	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,5/4,0	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 210	Абатмент стандартный	I. 1.2	0,32	DENTSPLY Implants /	16°	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 1,5	25 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 16°, включая винт абатмента			ASTRA TECH OsseoSpeed TX						класса 5
S 210-3	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 220	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,60	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 4,5/5,0	D 6,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 220-3	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 4,5/5,0	D 6,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 230	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента	I. 1.2	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,0	D 3,5	GH 1,5	15 Ncm	Титан класса 5
T 200-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 4,5	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 200-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 200-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,32	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 4,5	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 200-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 205-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,42	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,8	D 5,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 205-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,31	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,8	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 205-2	Абатмент стандартный	I. 1.3	0,42	DENTSPLY Implants /	16°	D 3,8	D 5,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2			XiVE S						класса 5
T 205-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,30	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,8	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 210-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,54	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 210-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 210-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,53	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 210-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 220-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,94	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 220-1-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.3	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 220-2	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,7	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 220-2-1	Абатмент стандартный угловой 16°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.3	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.4. Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
1-07-03	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,15	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 1,5	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-04	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,19	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 3,0	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-05	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,16	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 1,5	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-06	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,19	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 3,0	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-08	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,25	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 5,0	15 Ncm	Титан класса 5
1-07-09	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,24	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 5,0	15 Ncm	Титан класса 5
2-07-07	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,23	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-08	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,31	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-09	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,51	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-07-10	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,28	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-11	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,40	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-12	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,58	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-13	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,23	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-14	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,32	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-15	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,51	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-16	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,28	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-17	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,40	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-18	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,57	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-26	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,35	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-27	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,56	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-07-28	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,58	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-29	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,39	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-30	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,56	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-31	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,84	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 6,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
F 200-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 200-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 200-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 200-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 210-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,38	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 210-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 210-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 210-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
H 200-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,23	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,2	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 200-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,19	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,5	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 200-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,19	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,2	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 200-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,19	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,5	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 210-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,32	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 4,7	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 210-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,45	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 210-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,31	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 4,7	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 210-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,45	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 220-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,46	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 5,7	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 220-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,65	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

H 220-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,45	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 5,7	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 220-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,66	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,2	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
L 200-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,24	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 200-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,28	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 200-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,23	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 200-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,30	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 210-1	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,22	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 210-1-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.4	0,22	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 210-2	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,22	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 210-2-3	Абатмент стандартный угловой 18°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.4	0,22	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.5. Абатмент стандартный угловой 21°, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
N 210-1-21	Абатмент стандартный угловой 21°, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.5	0,25	Straumann / Tissue Level	21°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 210-2-21	Абатмент стандартный угловой 21°, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.5	0,24	Straumann / Tissue Level	21°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5

1.6. Абатмент модифицируемый прямой

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота абатмента	Вращающий момент	Материал
N 110-40	Абатмент модифицируемый прямой	I. 1.6	0,23	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	H 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 110-55	Абатмент модифицируемый прямой	I. 1.6	0,27	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	H 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 110-70	Абатмент модифицируемый прямой	I. 1.6	0,28	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	H 7,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 120-40	Абатмент модифицируемый прямой	I. 1.6	0,29	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 4,3	H 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 120-55	Абатмент модифицируемый прямой	I. 1.6	0,35	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 4,3	H 5,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.7. Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-07-19	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,79	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
E 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,59	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,72	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 420	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,03	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 5,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 430	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,86	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	D 6,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,66	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт	I. 1.7	0,83	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	лабораторный								
H 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,60	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 4,7	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,86	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 5,4	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 420	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,32	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 6,5	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
L 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,66	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,86	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,73	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	D 3,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,98	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 4,8	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 420	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,55	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 6,5	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,78	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 3,5	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,04	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 4,5	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 420	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,68	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	D 5,7	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
S 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,65	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 420	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	1,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 6,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 400	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,63	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 4,6	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 405	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,72	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 410	Абатмент модифицируемый прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.7	0,91	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 420	Абатмент модифицируемый	I. 1.7	1,33	DENTSPLY Implants /	D 5,5	D 6,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	прямой, включая винт абатмента и винт лабораторный			XiVE S					

1.8- 1.9. Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-07-21	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,78	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-07-22	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,78	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
E 500-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,59	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	NP 3,5	D 4,6	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 500-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,61	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	NP 3,5	D 4,6	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 510-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,69	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	RP 4,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 510-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт	I. 1.9	0,68	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	RP 4,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	абатмента и винт лабораторный. Тип 2									
E 520-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,96	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	WP 5,0	D 5,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 520-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,25	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	18°	WP 5,0	D 5,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 500-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,64	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 500-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винтр лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,64	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 510-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,76	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 510-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
H 500-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,55	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,7	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 500-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт	I. 1.9	0,54	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,7	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	лабораторный. Тип 2									
H 510-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,77	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,4	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 510-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,20	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,4	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 520-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,25	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,5	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 520-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,25	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,5	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
L 500-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,16	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 500-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,16	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 510-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,79	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 510-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,90	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 500	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.8	0,59	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	18°	D 3,5/4,0	D 5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 520	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный	I. 1.8	1,02	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	18°	D 4,5/5,0	D 6,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 500-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,53	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 3,4	D 4,6	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 500-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 3,4	D 4,6	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 505-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,68	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 3,8	D 5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 505-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,67	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 3,8	D 5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 510-1	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1	I. 1.9	0,91	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 4,5	D 5,7	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 510-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 4,5	D 5,7	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 520-1	Абатмент модифицируемый	I. 1.9	0,25	DENTSPLY Implants /	18°	D 5,5	D 6,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 1			XiVE S						класса 5
Т 520-2	Абатмент модифицируемый угловой 18°, включая винт абатмента и винт лабораторный. Тип 2	I. 1.9	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	18°	D 5,5	D 6,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5

1.10. Абатмент MedentiBASE прямой

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-28-01	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,08	Microcone®	RI	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-28-02	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,11	Microcone®	RI	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-28-03	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,14	Microcone®	RI	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-28-04	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,18	Microcone®	RI	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-28-05	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,23	Microcone®	RI	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,09	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,30	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
C 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,11	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 0,5	20 Ncm	Титан класса 5
C 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4020	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
C 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 1,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4120	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,23	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 1,5	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
C 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4220	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,29	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
C 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,29	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4320	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,34	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
C 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
C 4420	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,39	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
D 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,10	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 0,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,11	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 0,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,14	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,21	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,26	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,31	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
D 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
E 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,08	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,13	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,37	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,07	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace	NP 3,5	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

				Coni®				
F 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,11	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
H 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,10	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 0,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 0,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
I 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

I 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,18	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,26	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,09	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,10	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,23	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,26	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,26	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,31	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0	35 Ncm	Титан класса 5
N 4030	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,08	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 4130	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,13	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 4230	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,19	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 4330	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 4430	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,31	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
R 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,09	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,10	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,15	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 1,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 1,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,19	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 2,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,29	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,34	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
S 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,09	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4020	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4120	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4220	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,22	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4320	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 4420	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,37	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,08	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4005	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,13	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4010	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,12	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,14	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4105	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,17	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4110	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4205	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 4210	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4305	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4310	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4405	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,32	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 4410	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,35	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
Y 4000	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,08	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 0,5	25 Ncm	Титан класса 5
Y 4100	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,13	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
Y 4200	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,16	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
Y 4300	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,21	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
Y 4400	Абатмент MedentiBASE прямой	I. 1.10	0,27	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5

1.11. Абатмент MedentiLOC прямой

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-21-01	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,17	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-02	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-03	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,26	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-04	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-05	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 5,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,08	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,22	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

B 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,35	Bredent Medical / SKY	D 4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
C 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,19	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2030	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2040	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,33	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,23	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,30	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2130	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,39	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2140	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,45	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,30	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,35	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2230	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,47	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2240	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,59	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

								5
C 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,33	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,35	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,44	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2330	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,57	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2340	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,70	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,49	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2430	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,65	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 2440	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,83	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
D 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,16	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,17	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,22	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,23	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,35	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
E 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,78	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2030	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,79	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,35	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2130	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,46	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,89	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,40	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2230	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,56	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,56	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,42	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,47	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

								5
E 2330	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,67	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,41	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,61	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,52	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2430	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,77	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,12	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,26	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,41	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
H 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,21	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

H 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 1,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 2,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 3,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,45	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 4,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 5,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,44	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 5,5	20 Ncm	Титан класса 5
H 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,52	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 5,5	20 Ncm	Титан класса 5
I 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,14	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

								5
I 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,26	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,42	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,52	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,26	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,23	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

K 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,39	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,33	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,48	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,40	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,57	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,79	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,21	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,22	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,30	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса 5
L 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,41	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 5,5	35 Ncm	Титан класса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

								5
N 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,19	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2030	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,12	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2130	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,61	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2230	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,22	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,45	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,75	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2330	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,27	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,52	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,74	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2430	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
R 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,23	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,16	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,70	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	3,54	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,41	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,30	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,49	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,59	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 2,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

								5
S 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 4,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 5,5	25 Ncm	Титан класса 5
S 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,48	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 5,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	1,58	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2005	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2010	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2020	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	2,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2105	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2110	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2120	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,36	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	3,34	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2205	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2210	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2220	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,45	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2305	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,34	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2310	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2320	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,53	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2405	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2410	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,44	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2420	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,63	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 2000	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,20	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 2100	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,22	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 2200	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,24	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 2300	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,28	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 2400	Абатмент MedentiLOC прямой	I. 1.11	0,32	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.12- 1.13. Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-21-06	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,16	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-07	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,17	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-08	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-09	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,22	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-10	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-11	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,16	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-12	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,19	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-13	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,21	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-21-14	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,23	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-21-15	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,15	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,18	Bredent Medical / SKY	15°	D 4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Bredent Medical / SKY	15°	D 4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Bredent Medical / SKY	15°	D 4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	Bredent Medical / SKY	15°	D 4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
B 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,27	Bredent Medical / SKY	15°	D 4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
D 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,15	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2500-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,16	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2510-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,18	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2510-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,16	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 2600-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,18	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2610-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2610-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,20	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2700-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,21	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2710-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2710-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,23	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2800-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,23	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2810-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2810-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,25	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,27	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2900-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,27	Altatec / Conelog	15°	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2910-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,28	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 2910-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,28	Altatec / Conelog	15°	D 3,8/4,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
E 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,17	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2500-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,15	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2510-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2510-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,22	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2600-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2610-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 2610-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2700-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,22	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2710-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2710-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2800-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,22	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2810-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,29	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2810-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,29	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2900-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 2910-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,31	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 2910-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15°	RP 4,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2510-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2610-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2710-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2810-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 2910-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,14	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2500-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,14	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2510-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,17	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2510-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,18	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,16	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2600-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,17	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2610-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,22	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2610-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,22	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2700-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,19	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L 2710-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2710-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,24	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2800-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,21	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2810-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,26	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2810-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,26	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,24	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2900-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,25	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2910-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,28	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 2910-2	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 2	I. 1.13	0,30	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 2510	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,22	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 2610	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,22	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2710	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,27	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2810	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,28	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 2910	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,35	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
R 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,16	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 2500	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC	I. 1.12	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 2600	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC	I. 1.12	0,18	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 2700	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC	I. 1.12	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 2800	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC	I. 1.12	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 2900	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC	I. 1.12	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2500-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2505-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2510-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2600-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2605-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2610-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2700-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2705-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 2710-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2800-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2805-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,27	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2810-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2900-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2905-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 2910-1	Абатмент MedentiLOC угловой 15°, включая винт углового абатмента MedentiLOC. Тип 1	I. 1.13	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

1.14. Абатмент Novaloc прямой

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-23-01	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,17	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-02	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-03	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-04	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,32	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-23-05	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,39	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
C 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,21	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6020	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,26	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,27	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6120	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,11	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6220	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,40	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,36	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,36	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6320	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,41	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,40	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,42	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 6420	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,52	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
D 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,06	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,06	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,21	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,24	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,26	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,30	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,32	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,35	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,37	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
E 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,10	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,10	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,38	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,43	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,36	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,50	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
EV 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,04	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6020	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,04	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6030	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,04	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6120	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6130	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6220	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6230	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6320	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6330	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6420	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 6430	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
F 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,06	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,20	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,26	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,29	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,34	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,38	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
H 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,16	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

H 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,24	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,29	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,34	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,35	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,39	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,41	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
K 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,06	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,20	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,13	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,31	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,37	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,06	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,18	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,21	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,24	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,25	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,29	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,30	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,38	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,20	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6030	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,13	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,30	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6130	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,19	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,38	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6230	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,46	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 6330	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,50	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,55	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6430	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
R 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,07	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,31	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,40	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,36	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,46	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,16	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6020	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,28	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,09	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6120	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6220	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,27	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH	D 4,5/5,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

				OsseoSpeed TX				
S 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6320	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,42	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6420	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,48	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6005	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6010	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6105	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6110	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,30	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6205	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,30	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6210	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,32	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6305	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,35	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6310	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,44	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6405	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,40	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6410	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,48	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 6000	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,15	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 6100	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,20	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 6200	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,22	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 6300	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,25	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 6400	Абатмент Novaloc прямой	I. 1.14	0,34	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.15- 1.16. Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-23-06	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,16	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-07	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,18	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-08	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,20	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-09	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,21	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-10	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,24	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-11	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,15	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-12	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,17	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-13	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,20	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-23-14	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,22	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-23-15	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,23	Microcone® / Quattrocone®	15°	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
F 6500-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6510-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6600-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,03	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6610-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,03	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6700-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6710-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,20	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6800-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6810-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6900-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 6910-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15°	RP 4,3/5,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L 6500-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,14	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6500-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,12	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6510-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,16	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6510-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,17	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6600-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,16	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6600-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,16	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6610-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,20	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6610-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,20	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6700-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,18	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6700-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,18	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6710-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,27	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L 6710-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,27	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6800-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,21	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6800-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,21	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6810-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,24	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6810-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,23	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6900-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,22	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6900-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,22	Straumann / Bone Level	15°	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6910-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,26	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 6910-2	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 2	I. 1.16	0,27	Straumann / Bone Level	15°	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 6510	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,04	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 6610	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,23	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 1,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 6710	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,27	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 2,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 6810	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,28	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 6910	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,30	Straumann / Tissue Level	15°	RN 4,8	GH 4,5	35 Ncm	Титан класса 5
R 6500-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,17	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6510-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,18	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 4,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6600-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,18	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6610-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,19	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 4,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6700-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,21	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6710-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,24	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 4,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6800-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,23	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6810-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,25	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 4,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 6900-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,25	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 3,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 6910-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,27	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	15°	D 4,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 6500	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc	I. 1.15	0,14	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6600	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc	I. 1.15	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6700	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc	I. 1.15	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6800	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc	I. 1.15	0,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 6900	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc	I. 1.15	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15°	D 3,5/4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6500-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6505-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6510-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6600-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 6605-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6610-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6700-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6705-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6710-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6800-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6805-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,27	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6810-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6900-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,4	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6905-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 3,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 6910-1	Абатмент Novaloc угловой 15°, включая винт углового абатмента Novaloc. Тип 1	I. 1.16	0,30	DENTSPLY Implants / XiVE S	15°	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.17. Абатмент Optiloc прямой

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-22-01	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,15	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-22-02	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,19	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-22-03	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-22-04	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
2-22-05	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
C 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,19	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,17	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5020	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,22	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5120	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,30	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,27	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C 5220	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,31	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,33	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5320	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,44	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,37	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,39	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
C 5420	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,48	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
D 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,26	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,30	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,30	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
D 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
E 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,22	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,88	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,73	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,42	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,49	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
EV 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5020	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5030	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5120	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,24	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 5130	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,24	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5220	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5230	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,38	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5320	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5330	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,42	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5420	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 5430	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,52	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
F 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,38	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
H 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 1,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,41	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,22	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 2,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 3,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,30	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 4,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,41	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
K 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,17	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

K 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
K 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,38	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,16	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,19	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,44	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,24	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,39	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,19	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5030	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,12	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 5130	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,35	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 2,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,55	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5230	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 3,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,45	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5330	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,26	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 4,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,51	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 5430	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
R 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,15	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 1,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,21	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 2,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,26	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 3,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,31	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,40	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 4,0	30 Ncm	Титан класса 5
R 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,45	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 5,0	30 Ncm	Титан класса 5
S 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,14	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5020	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5120	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5220	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,37	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5320	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,43	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,34	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 5420	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,47	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,31	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5005	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5010	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,54	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5105	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 5110	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5205	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5210	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,31	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5305	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5310	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,40	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,36	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5405	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,39	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
T 5410	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,48	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 5000	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,13	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 5100	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,20	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 2,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 5200	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,23	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 5300	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,28	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 4,0	25 Ncm	Титан класса 5
Y 5400	Абатмент Optiloc прямой	I. 1.17	0,32	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 5,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.18. Абатмент РОС, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
2-10-01	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,53	Microcone® / Quattrocone®	RI	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,63	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,91	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 930	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	2,14	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,57	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,73	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,54	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,78	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,29	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,45	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,83	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,49	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 900	Абатмент РОС, включая винт	I. 1.18	0,52	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	абатмента						сплав (CoCr)
K 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,83	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,30	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,56	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,84	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,67	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,00	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	2,15	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,36	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,68	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,60	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,48	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 920	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 900	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,52	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 905	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	0,84	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 910	Абатмент РОС, включая винт абатмента	I. 1.18	1,14	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 920	Абатмент РОС, включая винт	I. 1.18	1,76	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	абатмента						сплав (CoCr)

1.19. Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
1-10-01	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,21	Microcone®	NI	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
2-10-02	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,31	Microcone® / Quattrocone®	RI	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,35	Altatec / Camlog	D 3,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,40	Altatec / Camlog	D 3,8	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,55	Altatec / Camlog	D 4,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 730	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,67	Altatec / Camlog	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 740	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,74	Altatec / Camlog	D 6,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
CX 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,32	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,53	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,59	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,30	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,41	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 730	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,50	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 740	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,59	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,31	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,41	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,35	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,48	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,68	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,34	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,49	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,73	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый	I. 1.19	0,37	Nobel Biocare /	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	антиротационный, включая винт абатмента			Brånemark			сплав (CoCr)
K 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,50	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,54	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,30	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,46	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,39	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,68	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,31	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,45	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,71	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,76	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 700	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 705	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,51	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 710	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,54	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 720	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный, включая винт абатмента	I. 1.19	0,72	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.20. Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
2-10-03	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,29	Microcone® / Quattrocone®	RI	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,32	Altatec / Camlog	D 3,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,36	Altatec / Camlog	D 3,8	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,42	Altatec / Camlog	D 4,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 730 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,55	Altatec / Camlog	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 740 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,58	Altatec / Camlog	D 6,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
CX 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,30	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,47	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,50	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,28	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,40	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 730 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,48	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 740 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,55	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,28	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,38	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,33	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,44	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,64	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,49	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,25	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,37	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,38	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,68	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,32	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,44	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,68	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,28	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 720 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,74	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 700 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 705 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,43	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 710 R	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый ротационный, включая винт абатмента	I. 1.20	0,48	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

1.21. Абатмент PreFace, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Диаметр абатмента	Вращающий момент	Материал
1-90-02	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,91	Microcone®	NI	D 11.5	15 Ncm	Титан класса 5
1-90-03	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,83	Microcone®	NI	D 11.5	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
2-90-02	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,81	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
2-90-03	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,90	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-90-06	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,06	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
B 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,89	Bredent Medical / SKY	D 4,0	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
B 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,81	Bredent Medical / SKY	D 3,5	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
B 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,05	Bredent Medical / SKY	D 4,0	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
BS 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,01	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25-5,5	D 16.0	30 Ncm	Титан класса 5
BS 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,88	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25-5,5	D 11.5	30 Ncm	Титан класса 5
BS 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,30	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25-5,5	D 16.0	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,91	Altatec / Camlog	D 3,3	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
C 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	9,86	Altatec / Camlog	D 3,3	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
C 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,91	Altatec / Camlog	D 3,8	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
C 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,86	Altatec / Camlog	D 3,8	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
C 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,96	Altatec / Camlog	D 4,3	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
C 9020-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,88	Altatec / Camlog	D 4,3	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
C 9030-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,89	Altatec / Camlog	D 5,0	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
C 9030-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,83	Altatec / Camlog	D 5,0	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C 9040-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,86	Altatec / Camlog	D 6,0	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
C 9040-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,81	Altatec / Camlog	D 6,0	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
C 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,65	Altatec / Camlog	D 3,3	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,74	Altatec / Camlog	D 3,8	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,87	Altatec / Camlog	D 4,3	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 9830-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,77	Altatec / Camlog	D 5,0	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 9840-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,78	Altatec / Camlog	D 6,0	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
CX 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,91	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	D 16.0	30 Ncm	Титан класса 5
CX 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,80	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	D 11.5	30 Ncm	Титан класса 5
CX 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,12	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	D 16.0	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
D 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,84	Altatec / Conelog	D 3,3	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
D 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,93	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
D 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,85	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
D 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,70	Altatec / Conelog	D 3,3	D 11.5	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
D 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,28	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,73	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
E 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,79	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
E 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,89	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
E 9020-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,80	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
E 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,42	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,96	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,98	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,83	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,02	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,86	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,00	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9020-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,82	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9030-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,04	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9030-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,88	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH	D 4,8	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

				OsseoSpeed EV				
EV 9040-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9040-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,95	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
EV 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,63	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	D 11.5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,27	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 9830-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 9840-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,95	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
F 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,82	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
F 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,91	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
F 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,80	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
F 9020-R	Абатмент PreFace, включая	I. 1.21	8,87	Nobel Biocare / NobelActive -	D 3,0	D 11.5	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	винт абатмента			NobelReplace Coni®				
F 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,20	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,02	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 9820-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,80	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	D 11.5	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,77	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
H 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
H 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,79	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 11.5	20 Ncm	Титан класса 5
H 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	15,84	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 16.0	20 Ncm	Титан класса 5
H 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,57	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 11.5	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,72	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,95	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 16.0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,70	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
I 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,70	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
I 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,77	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
I 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,35	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

I 9810-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,37	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,87	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,77	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
K 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,71	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
K 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,54	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
K 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,57	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 9810-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,38	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,45	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,92	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
L 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,83	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
L 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,97	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
L 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,86	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
L 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,08	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,20	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,88	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
N 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,74	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,82	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 16.0	35 Ncm	Титан класса 5
N 9020-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,70	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
N 9030-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,69	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	D 11.5	35 Ncm	Титан класса 5
N 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,91	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	27,90	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 16.0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 9830-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,36	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	D 11.5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 16.0	30 Ncm	Титан класса 5
R 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,79	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 11.5	30 Ncm	Титан класса 5
R 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 16.0	30 Ncm	Титан класса 5
R 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,79	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 11.5	30 Ncm	Титан класса 5
R 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,90	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	D 16.0	30 Ncm	Титан класса 5
R 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,03	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 16.0	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,05	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 16.0	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,02	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	D 16.0	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 9000-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,79	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
S 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,99	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
S 9020-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,84	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
S 9030-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,84	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	D 11.5	15 Ncm	Титан класса 5
S 9800-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 9830-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,63	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	D 11.5	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 9000-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,82	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
T 9005-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,88	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
T 9005-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,83	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
T 9010-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,90	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5
T 9010-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	8,77	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 11.5	25 Ncm	Титан класса 5
T 9020-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	14,87	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	D 16.0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 9800-R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	16,57	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 11.5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 9805-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,02	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 9810-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,11	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 9820-16R	Абатмент PreFace, включая винт абатмента	I. 1.21	28,07	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	D 16.0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

1.22. Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
1-90-01	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Microcone®	NI	15 Ncm	Титан класса 5
1-90-04	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Microcone®	NI	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
2-90-01	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Microcone® / Quattrocone®	RI	25 Ncm	Титан класса 5
2-90-04	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Microcone® / Quattrocone®	RI	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
B 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Bredent Medical / SKY	D 3,5	25 Ncm	Титан класса 5
B 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Bredent Medical / SKY	D 3,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
BS 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25/3,75	30 Ncm	Титан класса 5
BS 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25/3,75	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
BS 901001	Абатмент MedentiCAD,	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems /	D 4,1	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента			Semados S / RI / RS / RSX			
BS 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,1	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
BS 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
BS 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
BS 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 5,5	30 Ncm	Титан класса 5
BS 903004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 5,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 3,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 3,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 3,8	20 Ncm	Титан класса 5
C 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 3,8	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 4,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 4,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 903004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 904001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 6,0	20 Ncm	Титан класса 5
C 904004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Camlog	D 6,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
CX 900001	Абатмент MedentiCAD,	I. 1.22	0,05-28,33	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента						
CX 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
D 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Conelog	D 3,3	20 Ncm	Титан класса 5
D 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Conelog	D 3,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
D 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	20 Ncm	Титан класса 5
D 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
E 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
E 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
E 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	35 Ncm	Титан класса 5
EV 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	25 Ncm	Титан класса 5
EV 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 901001	Абатмент MedentiCAD,	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed	D 3,6	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента			EV			
EV 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	25 Ncm	Титан класса 5
EV 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	25 Ncm	Титан класса 5
EV 903004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 904001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	25 Ncm	Титан класса 5
EV 904004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 902001	Абатмент MedentiCAD,	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive -	D 3,0	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента			NobelReplace Coni®			
F 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Титан класса 5
H 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Титан класса 5
H 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
H 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	35 Ncm	Титан класса 5
I 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	35 Ncm	Титан класса 5
I 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
I 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
I 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

K 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	35 Ncm	Титан класса 5
K 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
K 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	35 Ncm	Титан класса 5
K 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Титан класса 5
L 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Титан класса 5
L 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Титан класса 5
N 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 903004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	35 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Титан класса 5
R 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Титан класса 5
S 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
S 903001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	15 Ncm	Титан класса 5
S 903004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 900001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	25 Ncm	Титан класса 5
T 900004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 900501	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	25 Ncm	Титан класса 5
T 900504	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 901001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 901004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
T 902001	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	25 Ncm	Титан класса 5
T 902004	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента	I. 1.22	0,05-28,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	25 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

1.23. Абатмент временный угловой, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-17-09	Абатмент временный угловой, включая винт абатмента. Тип 1	I. 1.23	0,25	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)
2-17-10	Абатмент временный угловой, включая винт абатмента. Тип 2	I. 1.23	0,26	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)

1.24. Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
E 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,20	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 3720	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,24	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	35 Ncm	Титан класса 5
F 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
F 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	35 Ncm	Титан класса 5
H 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,20	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	20 Ncm	Титан класса 5
H 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,22	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	20 Ncm	Титан класса 5
H 3720	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,23	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	20 Ncm	Титан класса 5
L 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,23	Straumann / Bone Level	NC 3,3	35 Ncm	Титан класса 5
L 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,30	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	35 Ncm	Титан класса 5
N 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,22	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	35 Ncm	Титан класса 5
N 3720	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,26	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	35 Ncm	Титан класса 5
N 3730	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,24	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	35 Ncm	Титан класса 5
R 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,16	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 3710	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,18	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 3720	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,21	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	30 Ncm	Титан класса 5
S 3700	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 3720	Абатмент временный ротационный, включая винт абатмента	I. 1.24	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	25 Ncm	Титан класса 5

1.25. Абатмент временный прямой, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
2-17-07	Абатмент временный прямой, включая винт абатмента	I. 1.25	0,19	Microcone® / Quattrocone®	н/п	RI	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5
2-17-08	Абатмент временный прямой, включая винт абатмента	I. 1.25	0,30	Microcone® / Quattrocone®	н/п	RI	D 5,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)

1.26. Абатмент временный, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
1-17-04	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,20	Microcone®	NI	н/п	н/п	15 Ncm	Титан класса 5
2-17-02	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,15	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)
2-17-03	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,12	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-17-06	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,23	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 3,5	25 Ncm	Титан класса 5 / ПВДФ (поливинилиденфторид - фторопласт 2)
D 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,24	Altatec / Conelog	D 3,3	н/п	н/п	20 Ncm	Титан класса 5
D 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,24	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	н/п	н/п	20 Ncm	Титан класса 5
E 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
E 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
E 3520	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,23	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
F 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
F 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
F 3520	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	н/п	н/п	15 Ncm	Титан класса 5
H 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,23	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	н/п	н/п	20 Ncm	Титан класса 5
H 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,24	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	н/п	н/п	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

I 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,19	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
I 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,34	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
K 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,18	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
K 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,34	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
L 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,25	Straumann / Bone Level	NC 3,3	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
L 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,28	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
N 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,21	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
N 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,23	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
N 3520	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,28	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
N 3530	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,26	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	н/п	н/п	35 Ncm	Титан класса 5
R 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,19	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	н/п	н/п	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,19	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	н/п	н/п	30 Ncm	Титан класса 5
S 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5
S 3520	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5
S 3530	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	н/п	н/п	15 Ncm	Титан класса 5
T 3500	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5
T 3505	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5
T 3510	Абатмент временный, включая винт абатмента	I. 1.26	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	н/п	н/п	25 Ncm	Титан класса 5

2. Винты, в вариантах исполнения:

2.1. Винт углового абатмента MedentiLOC

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
2-06-02	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Microcone® / Quattrocone®	25 Ncm	Титан класса 5
B 61	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Bredent Medical / SKY	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 61	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Altatec / Conelog	20 Ncm	Титан класса 5
E 64	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,06	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
E 65	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,07	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
F 64	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 65	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,06	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
L 62	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Straumann / Bone Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 64	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,07	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
R 62	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	30 Ncm	Титан класса 5
S 65	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,06	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
T 62	Винт углового абатмента MedentiLOC	I. 2.1	0,05	DENTSPLY Implants / XiVE S	25 Ncm	Титан класса 5

2.2. Винт углового абатмента Novaloc

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
2-06-05	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,05	Microcone® / Quattrocone®	25 Ncm	Титан класса 5
F 67	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,05	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 68	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,06	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
L 64	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,04	Straumann / Bone Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 66	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,06	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
R 63	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,05	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	30 Ncm	Титан класса 5
S 68	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,04	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
T 63	Винт углового абатмента Novaloc	I. 2.2	0,05	DENTSPLY Implants / XiVE S	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.3. Винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
1-06-01	Винт абатмента	I. 2.3	0,05	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
2-06-01	Винт абатмента	I. 2.3	0,05	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
2-06-03	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	Microcone® / Quattrocone®	25 Ncm	Титан класса 5
4-06-01	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	Quattrocone30®	25 Ncm	Титан класса 5
B 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Bredent Medical / SKY	25 Ncm	Титан класса 5
BS 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	30 Ncm	Титан класса 5
C 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,07	Altatec / Camlog	20 Ncm	Титан класса 5
C 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,09	Altatec / Camlog	20 Ncm	Титан класса 5
C 62	Винт абатмента	I. 2.3	0,13	Altatec / Camlog	20 Ncm	Титан класса 5
CX 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Medentis Medical / ICX	30 Ncm	Титан класса 5
D 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	Altatec / Conelog	20 Ncm	Титан класса 5
E 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
E 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,12	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
EV 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 62	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 63	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
F 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,07	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,10	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 66	Винт абатмента	I. 2.3	0,04	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,07	BIOMET 3i / Certain	20 Ncm	Титан класса 5
I 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,09	BIOMET 3i / External Hex	35 Ncm	Титан класса 5
K 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,07	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5
K 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,1	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5
K 62	Винт абатмента	I. 2.3	0,14	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Straumann / Bone Level	35 Ncm	Титан класса 5
L 63	Винт абатмента	I. 2.3	0,12	Straumann / Bone Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,04	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 62	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 65	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
R 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,08	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	30 Ncm	Титан класса 5
S 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
S 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
S 67	Винт абатмента	I. 2.3	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 60	Винт абатмента	I. 2.3	0,07	DENTSPLY Implants / XiVE S	25 Ncm	Титан класса 5
Y 61	Винт абатмента	I. 2.3	0,06	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	25 Ncm	Титан класса 5

2.4 Винт абатмента MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-06-03	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
B 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
C 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
D 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5
E 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5
F 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
I 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
K 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
L 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,01	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5
S 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,01	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5
Y 7600	Винт абатмента MedentiBASE	I. 2.4	0,03	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5

2.5 Винт абатмента Multi-unit

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-02	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 5
C 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
EV 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Титан класса 5
F 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
L 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 8501	Винт абатмента Multi-unit	I. 2.5	0,03	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5

2.6 Винт-заглушка MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-04	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
B 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
C 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
D 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5
E 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
I 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
K 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
L 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5
S 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5
Y 4610	Винт-заглушка MedentiBASE	I. 2.6	0,15	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5

2.7. Винт-заглушка Multi-unit

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-03	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 5
C 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
EV 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Титан класса 5
F 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
L 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 8502	Винт-заглушка Multi-unit	I. 2.7	0,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.8.. Винт-патрица MedentiLOC для мостовидного протеза

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
2000	Винт-патрица MedentiLOC для мостовидного протеза	I. 2.8	0,07	Совместимость со ВСЕМИ системами	35 Ncm	Титан класса 5

2.9. Винт-патрица Novaloc для мостовидного протеза

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
6000	Винт-патрица Novaloc для мостовидного протеза	I. 2.9	0,08	Совместимость со ВСЕМИ системами	35 Ncm	Титан класса 5

2.10. Винт-патрица Optiloc для мостовидного протеза

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
5000	Винт-патрица Optiloc для мостовидного протеза	I. 2.10	0,79	Совместимость со ВСЕМИ системами	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Колпачки, в вариантах исполнения:

3.1. Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-06	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
B 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
C 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
D 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5
E 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5
F 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
I 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
K 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
L 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5
Y 4700	Колпачок MedentiBASE титановый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.1	0,18	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5

3.2. Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-06	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 5
C 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
EV 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Титан класса 5
F 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
L 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 8505	Колпачок Multi-unit титановый, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.2	0,24	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.3- 3.4. Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт абатмента MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-14	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
0-28-15	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
B 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
B 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
C 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
C 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
D 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5
D 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5
E 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5
E 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5
F 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
F 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

H 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
I 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
I 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
K 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
K 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
L 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
L 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,11	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5
R 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5
S 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
S 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5
Y 4800	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.3	0,07	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5
Y 4820	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, длинный, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.4	0,09	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5

3.5. Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-08	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
C 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Altatec / Camlog	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
EV 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
F 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
H 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
L 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
N 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)
R 8507	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit	I. 3.5	0,28	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Кобальт-хром-молибденовый сплав (CoCr)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.6. Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных (в комплекте 5 шт.)

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
1-04-07	Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных	I. 3.6	0,07	Microcone®	Полиформальдегид (полиоксиметилен) - POM
2-04-19	Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных	I. 3.6	0,09	Microcone® / Quattrocone®	Полиформальдегид (полиоксиметилен) - POM
30	Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных	I. 3.6	0,07	Altatec / Camlog DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Conical® BIOMET 3i / Certain Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX DENTSPLY Implants / XiVE S	Полиформальдегид (полиоксиметилен) - POM
31	Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных	I. 3.6	0,09	Straumann / Bone Level Straumann / Tussie Level Microcone® / Quattrocone®	Полиформальдегид (полиоксиметилен) - POM

3.7. Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-08	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Microcone®	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
B 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая	I. 3.7	0,07	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	винт абатмента MedentiBASE					(поликарбонат) - Tecanat PC
C 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Altatec / Camlog	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
D 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Altatec / Conelog	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
E 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
F 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
H 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
I 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
K 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
L 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
N 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
NNC 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая	I. 3.7	0,07	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	винт абатмента MedentiBASE					
R 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
S 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
T 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
Y 4710	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 3.7	0,07	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

3.8- 3.9. Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт для моделирования

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-16	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Microcone®	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
0-28-17	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Microcone®	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
B 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Bredent Medical / SKY	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
B 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Bredent Medical / SKY	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
C 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Altatec / Camlog	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Altatec / Camlog	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
D 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Altatec / Conelog	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
D 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Altatec / Conelog	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
E 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
E 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
F 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
F 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
H 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	BIOMET 3i / Certain	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
H 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	BIOMET 3i / Certain	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
I 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	BIOMET 3i / External Hex	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
I 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	BIOMET 3i / External Hex	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
K 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Nobel Biocare / Brånemark	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
K 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Nobel Biocare / Brånemark	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
L 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Straumann / Bone Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
L 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Straumann / Bone Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
N 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Straumann / Tissue Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Straumann / Tissue Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
NNC 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Straumann / Tissue Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
NNC 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Straumann / Tissue Level	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
R 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
R 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
S 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
S 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
T 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	DENTSPLY Implants / XiVE S	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
T 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	DENTSPLY Implants / XiVE S	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
Y 4810	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий, включая винт для моделирования	I. 3.8	0,08	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
Y 4830	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, длинный, включая винт для моделирования	I. 3.9	0,09	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

3.10. Колпачок Multi-unit пластиковый

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-31-11	Колпачок Multi-unit пластиковый	I. 3.10	0,07	Microcone® / Quattrocone®	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC
8510	Колпачок Multi-unit пластиковый	I. 3.10	0,07	Совместимость со ВСЕМИ системами	Аморфный монолитный полимер (поликарбонат) - Tecanat PC

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.11. Колпачок трансфера слепочного индивидуального

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота/Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы/ Длина имплантата	Материал
2-04-09	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,06	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 1-2	Полиэфирэфиркетон - PEEK
2-04-10	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,10	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 1-2	Полиэфирэфиркетон - PEEK
2-04-11	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,15	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 1-2	Полиэфирэфиркетон - PEEK
2-04-12	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,04	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 3-6	Полиэфирэфиркетон - PEEK
2-04-13	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,08	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 5,5	GH 3-6	Полиэфирэфиркетон - PEEK
2-04-14	Колпачок трансфера слепочного индивидуального	I. 3.11	0,14	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 6,5	GH 3-6	Полиэфирэфиркетон - PEEK

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Основания, в вариантах исполнения:

4.1. Основание титановое, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы/ Длина имплантата	Вращающий момент	Материал
1-09-01	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,11	Microcone®	NI	GH 0,7	15 Ncm	Титан класса 5
1-09-02	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,12	Microcone®	NI	GH 1,2	15 Ncm	Титан класса 5
2-09-11	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
2-09-12	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
2-09-13	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5
2-09-14	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5
B 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	Bredent Medical / SKY	D 3,5	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
B 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Bredent Medical / SKY	D 3,5	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
BS 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,1	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5
BS 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5
BS 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,11	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 5,5	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5
BS 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,1	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

BS 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5
BS 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 5,5	GH 0,1	30 Ncm	Титан класса 5
C 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,29	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1040	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,30	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,36	Altatec / Camlog	D 5,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1140	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,33	Altatec / Camlog	D 6,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
CX 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	GH 0,65	30 Ncm	Титан класса 5
CX 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	GH 0,65	30 Ncm	Титан класса 5
CX 1200	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	GH 1,15	30 Ncm	Титан класса 5
CX 1300	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	GH 1,15	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

D 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
D 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
D 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,15	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
D 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
D 1200	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,15	20 Ncm	Титан класса 5
D 1210	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,15	20 Ncm	Титан класса 5
D 1300	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 1,15	20 Ncm	Титан класса 5
D 1310	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,20	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 1,15	20 Ncm	Титан класса 5
E 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,36	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,34	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,26	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,38	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 0,4	35 Ncm	Титан класса 5
E 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 0,4	35 Ncm	Титан класса 5
E 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 0,4	35 Ncm	Титан класса 5
E 830	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,37	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	GH 0,4	35 Ncm	Титан класса 5
EV 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,14	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1040	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,30	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,28	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1140	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1200	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1210	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 1220	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1230	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1240	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1300	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1310	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1320	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1330	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1340	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,45	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
F 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,10	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	GH 0,65	15 Ncm	Титан класса 5
F 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,45	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,12	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	GH 0,65	15 Ncm	Титан класса 5
F 1200	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,15	35 Ncm	Титан класса 5
F 1210	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,15	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 1300	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 1,15	35 Ncm	Титан класса 5
F 1310	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 1,15	35 Ncm	Титан класса 5
F 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 0,8	35 Ncm	Титан класса 5
F 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,28	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 0,8	35 Ncm	Титан класса 5
H 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,36	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
H 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,27	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
I 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

I 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
I 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,11	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,30	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 0,5	35 Ncm	Титан класса 5
K 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,28	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
L 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,15	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

L 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 0,8	35 Ncm	Титан класса 5
L 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,45	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 0,8	35 Ncm	Титан класса 5
L 801	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,2	35 Ncm	Титан класса 5
L 811	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,26	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
N 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,20	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
N 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,28	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,15	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
N 1530	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 0,35	35 Ncm	Титан класса 5
N 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,19	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0,15	35 Ncm	Титан класса 5
N 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,29	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
R 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,29	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0.24	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,20	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
R 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,24	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 0,5	30 Ncm	Титан класса 5
S 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
S 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
S 1030	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	GH 0,6	15 Ncm	Титан класса 5
S 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,35	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
S 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,31	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
S 1130	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	GH 0,6	15 Ncm	Титан класса 5
S 1200	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,67	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5
S 1220	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,30	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

S 1300	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5
S 1320	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 1,1	25 Ncm	Титан класса 5
S 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 0,8	25 Ncm	Титан класса 5
S 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,29	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 0,85	25 Ncm	Титан класса 5
T 1000	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,37	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1005	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1010	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 1020	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 1100	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,61	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1105	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,21	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1110	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,27	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 1120	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,28	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 805	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,18	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 810	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,25	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 820	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,48	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Y 1500	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,13	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
Y 1600	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,16	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
Y 1700	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,12	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5
Y 1800	Основание титановое, включая винт абатмента	I. 4.1	0,17	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	GH 1,15	25 Ncm	Титан класса 5

4.2. Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота гингивы	Вращающий момент	Материал
1-09-04	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,10	Microcone®	NI	GH 0,7	15 Ncm	Титан класса 5
2-09-15	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,14	Microcone® / Quattrocone®	RI	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
B 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Bredent Medical / SKY	D 3,5	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
BS 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,15	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,1	GH 0,15	30 Ncm	Титан класса 5
BS 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	GH 0,15	30 Ncm	Титан класса 5
C 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Altatec / Camlog	D 3,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

C 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	Altatec / Camlog	D 3,8	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
C 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,15	Altatec / Camlog	D 4,3	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
CX 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,14	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	GH 0,65	30 Ncm	Титан класса 5
D 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Altatec / Conelog	D 3,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
D 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,14	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	GH 0,65	20 Ncm	Титан класса 5
E 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
E 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,20	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	GH 0,3	35 Ncm	Титан класса 5
EV 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
EV 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,19	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 1530	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,22	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	GH 0,65	25 Ncm	Титан класса 5
F 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	GH 0,65	35 Ncm	Титан класса 5
F 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,09	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	GH 0,65	15 Ncm	Титан класса 5
H 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,11	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
H 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	GH 0,3	20 Ncm	Титан класса 5
I 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
I 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,17	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

K 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
K 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,26	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	GH 0,6	35 Ncm	Титан класса 5
L 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Straumann / Bone Level	NC 3,3	GH 1,0	35 Ncm	Титан класса 5
L 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,14	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	GH 0,8	35 Ncm	Титан класса 5
N 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,19	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
N 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,22	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	GH 0,1	35 Ncm	Титан класса 5
R 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,16	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
R 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,19	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	GH 0,3	30 Ncm	Титан класса 5
S 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
S 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 1500	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,12	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1505	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,13	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	GH 0,3	25 Ncm	Титан класса 5
T 1510	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5
T 1520	Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента	I. 4.2	0,19	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	GH 0,6	25 Ncm	Титан класса 5

4.3. Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-05	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,1	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
B 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I.4.3	0,10	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
C 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
D 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,1	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 5
F 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,1	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
I 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 5
K 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 5
L 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
NNC 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 5
N 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5
S 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,1	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая	I. 4.3	0,1	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	винт абатмента MedentiBASE					
Y 4840	Основание MedentiBASE титановое, включая винт абатмента MedentiBASE	I. 4.3	0,10	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 5

4.4. Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-09	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 5
C 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 5
EV 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Титан класса 5
F 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 5
L 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 5
N 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 5
R 8508	Основание Multi-unit титановое, включая винт абатмента Multi-unit	I. 4.4	0,15	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.5. Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-91-01	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,32	Microcone®	NI	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
2-91-01	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,07	Microcone® / Quattrocone®	RI	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
B 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Bredent Medical / SKY	D 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
D 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,23	Altatec / Conelog	D 3,3	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
D 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,25	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
E 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
E 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,25	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
E 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
E 9130	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,45	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
F 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,26	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
F 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,24	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
F 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
H 9100	Основание MedentiCAD для моделирования,	I. 4.5	0,26	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	Медицинская

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента					нержавеющая сталь 1.4305
H 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
H 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,30	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
I 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
I 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,32	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
I 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,38	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
K 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
K 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,33	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
K 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,38	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
L 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,24	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
L 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
N 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
N 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,28	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
N 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,38	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
N 9130	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
R 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,22	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
R 9110	Основание MedentiCAD для моделирования,	I. 4.5	0,26	Zimmer Dental /	D 4,5	Медицинская

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента			Tapered Screw-Vent		нержавеющая сталь 1.4305
R 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,31	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
S 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
S 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,33	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
S 9130	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,27	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
T 9100	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
T 9105	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,30	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
T 9110	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,33	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
T 9120	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента	I. 4.5	0,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

II. Принадлежности.

1. Абатменты для планирования:

1.1. Абатмент для планирования прямой – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Высота/ Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы/ Длина имплантата	Материал
1-15-01	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,10	Microcone®	NI	D 3,5	GH 1,5	Алюминий
1-15-02	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,09	Microcone®	NI	D 3,5	GH 3,0	Алюминий
2-15-01	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,12	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 1,5	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-15-02	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,20	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 3,0	Алюминий
2-15-03	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,25	Microcone® / Quattrocone®	RI	D 4,5	GH 5,0	Алюминий
EP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,11	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	D 4,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	D 4,8	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,30	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	D 5,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 130	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,50	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	D 6,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
FP 100-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,17	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
FP 110-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 100-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,17	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 110-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,27	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	D 5,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 120-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,42	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	D 6,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
IP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,11	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
IP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,18	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
IP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,28	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
KP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,11	Nobel Biocare / Brånemark	RP 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
KP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,18	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
KP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,28	Nobel Biocare / Brånemark	RP 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
LP 100-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,15	Straumann / Bone Level	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
LP 110-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,27	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5/3,0	Алюминий
NP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,10	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	D 4,0	GH 1,5	Алюминий
NP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,07	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	D 3,5	GH 0	Алюминий
NP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,10	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	D 4,3	GH 0	Алюминий
RP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,12	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	Алюминий
RP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,27	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
RP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,43	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	Алюминий
SP 100-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
SP 110-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,23	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 1,5/3,0	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SP 120-3	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,42	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	D 6,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
TP 100	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,17	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	D 4,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 105	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	D 5,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 110	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,32	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	D 5,7	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 120	Абатмент для планирования прямой	II. 1.1	0,50	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	D 6,7	GH 1,0/2,5	Алюминий

1.2. Абатмент для планирования угловой - не более 20 шт. каждого.

1.3. Абатмент для планирования угловой, тип 1, тип 2 – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами и производителями	Угол наклона в градусах	Разъём имплантата	Высота/ Макс. диаметр гингивальной области	Высота гингивы/ Длина имплантата	Материал
1-15-03	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,06	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 1,5	Алюминий
1-15-04	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,09	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 3,0	Алюминий
1-15-05	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,07	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 1,5	Алюминий
1-15-06	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,09	Microcone®	18°	NI	D 3,5	GH 3,0	Алюминий
2-15-04	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,13	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 1,5	Алюминий
2-15-05	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,17	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 3,0	Алюминий
2-15-06	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,22	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 5,0	Алюминий
2-15-07	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,13	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 1,5	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-15-08	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,15	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 3,0	Алюминий
2-15-09	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,22	Microcone® / Quattrocone®	18°	RI	D 4,5	GH 5,0	Алюминий
EP 200-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,13	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 4,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 200-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,10	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	NP 3,5	D 4,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,8	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	RP 4,3	D 4,8	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,26	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,28	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	WP 5,0	D 5,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 230-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,47	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
EP 230-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,48	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	16°	D 6,0	D 6,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
FP 200-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
FP 200-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	NP 3,5	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
FP 210-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,22	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
FP 210-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,23	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	18°	RP 4,3/5,0	D 5,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 200-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,14	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 200-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,15	BIOMET 3i / Certain	18°	D 3,4	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

HP 210-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,22	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 210-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,22	BIOMET 3i / Certain	18°	D 4,1	D 5,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 220-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,34	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
HP 220-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,35	BIOMET 3i / Certain	18°	D 5,0	D 6,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
IP 200-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
IP 200-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
IP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
IP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	BIOMET 3i / External Hex	16°	D 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
IP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	D 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
IP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	D 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
KP 200-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	RP 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
KP 200-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	RP 3,4	D 4,1	GH 2,5	Алюминий
KP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
KP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	RP 4,1	D 4,8	GH 2,5	Алюминий
KP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	D 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
KP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,16	Nobel Biocare / Brånemark	16°	D 5,0	D 5,5	GH 2,5	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

LP 200-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,12	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
LP 200-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,12	Straumann / Bone Level	18°	NC 3,3	D 4,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
LP 210-1-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,22	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5/3,0	Алюминий
LP 210-2-3	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,21	Straumann / Bone Level	18°	RC 4,1/4,8	D 5,0	GH 1,5/3,0	Алюминий
NP 200	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,06	Straumann / Tissue Level	16°	NN 3,5	D 4,0	GH 1,5	Алюминий
NP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,09	Straumann / Tissue Level	16°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	Алюминий
NP 210-1-21	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,08	Straumann / Tissue Level	21°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	Алюминий
NP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,07	Straumann / Tissue Level	16°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	Алюминий
NP 210-2-21	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,07	Straumann / Tissue Level	21°	RN 4,8	D 3,5	GH 0	Алюминий
NP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,13	Straumann / Tissue Level	16°	WN 6,5	D 4,3	GH 0	Алюминий
NP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,13	Straumann / Tissue Level	16°	WN 6,5	D 4,3	GH 0	Алюминий
RP 200-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,13	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	Алюминий
RP 200-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,12	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 3,5	D 4,5	GH 2,5	Алюминий
RP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,26	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
RP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,24	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 4,5	D 5,5	GH 2,5	Алюминий
RP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,39	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

RP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,40	Zimmer / MIS / BioHorizons / Lifecore Biomedical	16°	D 5,7	D 6,5	GH 2,5	Алюминий
SP 200-3	Абатмент для планирования угловой	II. 1.2	0,14	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,5/4,0	D 4,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
SP 210-3	Абатмент для планирования угловой	II. 1.2	0,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 3,5/4,0	D 5,2	GH 1,5/3,0	Алюминий
SP 220-3	Абатмент для планирования угловой	II. 1.2	0,46	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	16°	D 4,5/5,0	D 6,5	GH 1,5/3,0	Алюминий
TP 200-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,15	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 4,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 200-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,15	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,4	D 4,5	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 205-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,22	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,8	D 5,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 205-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,23	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 3,8	D 5,0	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 210-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,7	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 210-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,29	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 4,5	D 5,7	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 220-1	Абатмент для планирования угловой. Тип 1	II. 1.3	0,47	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,7	GH 1,0/2,5	Алюминий
TP 220-2	Абатмент для планирования угловой. Тип 2	II. 1.3	0,48	DENTSPLY Implants / XiVE S	16°	D 5,5	D 6,7	GH 1,0/2,5	Алюминий

1.4 – 1.15. Набор абатментов для планирования – не более 20 наборов каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
1-15-07	Набор абатментов для планирования	II. 1.4	0,50	Microcone®	Алюминий
2-15-10	Набор абатментов для планирования	II. 1.5	1,59	Microcone® / Quattrocone®	Алюминий

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.6	3,18	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	Алюминий
FPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.7	1,16	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	Алюминий
HPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.8	0,14	BIOMET 3i / Certain	Алюминий
IPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.9	0,48	BIOMET 3i / External Hex	Алюминий
KPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.10	0,48	Nobel Biocare / Brånemark	Алюминий
LPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.11	1,09	Straumann / Bone Level	Алюминий
NPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.12	0,90	Straumann / Tissue Level	Алюминий
RPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.13	2,36	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	Алюминий
SPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.14	1,60	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	Алюминий
TPS	Набор абатментов для планирования	II. 1.15	3,51	DENTSPLY Implants / XiVE S	Алюминий

2. Абатменты для сканирования:

2.1. Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации – не более 300 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Вращающий момент	Материал
1-09-03	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,47	Microcone®	NI	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
2-09-10	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,51	Microcone® / Quattrocone®	RI	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
4-09-01	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,60	Quattrocone30®	AI	н/п	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

B 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,46	Bredent Medical / SKY	D 3,5/4,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
BS 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,42	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25-5,5	30 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,48	Altatec / Camlog	D 3,3	20 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,49	Altatec / Camlog	D 3,8	20 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,65	Altatec / Camlog	D 4,3	20 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 1430	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,84	Altatec / Camlog	D 5,0/6,0	20 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
CX 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,44	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	30 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
D 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,42	Altatec / Conelog	D 3,3	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
D 1410	Абатмент для сканирования,	II. 2.1	0,42	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт для фиксации						в серый цвет
E 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,43	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
E 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,63	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
E 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,87	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
E 1430	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	1,32	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
EV 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,38	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	25 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
EV 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,41	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	25 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
EV 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,53	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	25 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
EV 1430	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,74	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	25 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 1440	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,77	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	25 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
F 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,44	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
F 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,69	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
F 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,41	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
H 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,45	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
H 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,74	BIOMET 3i / Certain	D 4,1/5,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
I 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,53	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
I 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,53	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1/5,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
K 1400	Абатмент для сканирования,	II. 2.1	0,46	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт для фиксации						в серый цвет
K 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,57	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
K 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,93	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
L 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,42	Straumann / Bone Level	NC 3,3	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
L 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,60	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
N 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,80	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
N 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	1,38	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
N 1430	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,43	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
R 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,39	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

R 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,59	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
R 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	1,05	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
S 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,42	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
S 1420	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,73	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
S 1430	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,39	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
T 1400	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,47	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
T 1405	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,61	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
T 1410	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации	II. 2.1	0,79	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5/5,5	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
Y 1400	Абатмент для сканирования,	II. 2.1	0,50	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	10 Ncm	Титан класса 4 анодирование

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт для фиксации						в серый цвет

2.2. Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-28-13	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 4 / анодирование в серый цвет
B 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Bredent Medical / SKY	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II.2.2	0,41	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
D 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Altatec / Conelog	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
E 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
F 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
H 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
I 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	BIOMET 3i / External Hex	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
K 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования,	II. 2.2	0,41	Nobel Biocare / Brånemark	15 Ncm	Титан класса 4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента MedentiBASE					анодирование в серый цвет
L 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
N 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,53	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
NNC 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
R 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
S 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
T 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	DENTSPLY Implants / XiVE S	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
Y 4900	Абатмент MedentiBASE для сканирования, включая винт абатмента MedentiBASE	II. 2.2	0,41	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

2.3. Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-01	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования,	II. 2.3	0,62	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	включая винт абатмента Multi-unit					серый цвет
EV 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
F 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
H 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
L 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
N 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	Straumann / Tissue Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
R 8500	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.3	0,62	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

2.4. Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
0-31-16	Абатмент Multi-unit для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,07	Microcone® / Quattrocone®	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
C 8513	Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,15	Altatec / Camlog	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
EV 8513	Абатмент Multi-unit угловой для	II. 2.4	0,15	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	сканирования, включая винт абатмента Multi-unit			OsseoSpeed EV		серый цвет
F 8513	Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,15	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
H 8513	Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,15	BIOMET 3i / Certain	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
L 8513	Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,15	Straumann / Bone Level	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет
R 8513	Абатмент Multi-unit угловой для сканирования, включая винт абатмента Multi-unit	II. 2.4	0,15	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	15 Ncm	Титан класса 4 анодирование в серый цвет

3. Трансферы:

3.1. Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-04-06	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,29	Microcone®	NI	Титан класса 5
2-04-17	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,44	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
E 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,45	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,37	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,54	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,37	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni	NP 3,5	Титан класса 5
F 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
F 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni	D 3,0	Титан класса 5
H 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,48	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	Титан класса 5
H 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,59	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	Титан класса 5
H 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,79	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	Титан класса 5
L 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,40	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,43	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
N 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,71	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5
N 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	1,07	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
N 33	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,35	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	Титан класса 5
R 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,48	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,61	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,92	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
S 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,62	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,83	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
T 30	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,42	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5
T 31	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,68	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 32	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,90	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 35	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.1	0,56	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5

3.2. Трансфер слепочный индивидуальный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
2-04-18	Трансфер слепочный индивидуальный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий	II. 3.2	0,28	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5

3.3-3.4. Трансфер слепочный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации – не более 200 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-04-01	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	0,56	Microcone®	NI	Титан класса 5
2-04-01	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,82	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
2-04-02	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,21	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
2-04-07	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	0,82	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
2-04-08	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,21	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
4-04-01	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,62	Quattrocone30®	AI	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

E 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,36	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 12	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,44	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5
E 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,78	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,79	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 22	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,89	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5
F 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,96	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Титан класса 5
F 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,39	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
F 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,12	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Титан класса 5
F 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
L 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,78	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,93	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
L 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	0,79	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,00	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
N 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,98	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	Титан класса 5
N 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,06	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

N 12	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	2,18	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
N 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,39	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	Титан класса 5
N 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,44	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5
N 22	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	2,01	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
R 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,02	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,80	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 12	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	2,64	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
R 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,23	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,70	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 22	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	3,54	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
S 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,93	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,58	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
S 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,47	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	2,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
T 10	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,93	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5
T 11	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	0,96	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 12	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	2,16	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 15	Трансфер слепочный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.3	1,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5
T 20	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,58	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5
T 21	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	2,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5
T 22	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	3,34	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 25	Трансфер слепочный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.4	1,93	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5

3.5- 3.6. Трансфер слепочный индивидуальный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации – не более 50 шт.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
2-04-07	Трансфер слепочный индивидуальный короткий для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.5	0,68	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
2-04-08	Трансфер слепочный индивидуальный длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации	II. 3.6	1,26	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.7. Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-12	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Microcone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
B 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Bredent Medical / SKY	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
C 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Altatec / Camlog	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
D 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Altatec / Conelog	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
E 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
F 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
H 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	BIOMET 3i / Certain	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
I 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	BIOMET 3i / External Hex	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
K 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Nobel Biocare / Brånemark	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
L 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Straumann / Bone Level	Медицинская нержавеющая сталь

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

					1.4305
N 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Straumann / Tissue Level	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
NNC 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Straumann / Tissue Level	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
R 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
S 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
T 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	DENTSPLY Implants / XiVE S	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
Y 4620	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации	II. 3.7	0,71	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

3.8. Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-31-04	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Microcone® / Quattrocone®	Титан класса 5
C 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Altatec / Camlog	Титан класса 5
EV 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	Титан класса 5
F 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	Титан класса 5
H 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	BIOMET 3i / Certain	Титан класса 5
L 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Straumann / Bone Level	Титан класса 5
N 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Straumann / Tissue Level	Титан класса 5
R 8503	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации	II. 3.8	0,78	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Аналоги:

4.1. Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiLOC – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-21-01	Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiLOC	II. 4.1	0,46	Microcone® / Quattrocone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
56	Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiLOC	II. 4.1	0,71	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

4.2. Аналог лабораторный углового абатмента MedentiLOC – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-21-02	Аналог лабораторный углового абатмента MedentiLOC	II. 4.2	0,65	Microcone® / Quattrocone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
57	Аналог лабораторный углового абатмента MedentiLOC	II. 4.2	0,74	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

4.3. Аналог лабораторный прямого абатмента Novaloc – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-23-01	Аналог лабораторный прямого абатмента Novaloc	II. 4.3	0,71	Microcone® / Quattrocone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
58	Аналог лабораторный прямого абатмента Novaloc	II. 4.3	0,46	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

					сталь 1.4305

4.4. Аналог лабораторный углового абатмента Novaloc – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-23-02	Аналог лабораторный углового абатмента Novaloc	II. 4.4	0,74	Microcone® / Quattrocone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
59	Аналог лабораторный углового абатмента Novaloc	II. 4.4	0,65	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

4.5. Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-20	Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE	II. 4.5	0,79	Microcone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
4630	Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE	II. 4.5	0,79	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

4.6. Аналог лабораторный абатмента Multi-unit – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-31-05	Аналог лабораторный прямого абатмента Multi-unit	II. 4.6	0,78	Microcone® / Quattrocone®	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8504	Аналог лабораторный прямого абатмента Multi-unit	II. 4.6	0,78	Совместимость со ВСЕМИ системами	Титан класса 5

4.7. Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Материал
0-31-12	Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit	II. 4.7	0,07	Microcone® / Quattrocone®	17°	Титан класса 5
8514-17	Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit	II. 4.7	0,78	Совместимость со ВСЕМИ системами	17°	Титан класса 5

4.8. Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Материал
0-31-13	Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit	II. 4.8	0,07	Microcone® / Quattrocone®	30°	Титан класса 5
8514-30	Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit	II. 4.8	0,78	Совместимость со ВСЕМИ системами	30°	Титан класса 5

4.9. Аналог лабораторный абатмента MedentiBASE CADCAM – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-21	Аналог лабораторный абатмента MedentiBASE CADCAM	II. 4.9	0,52	Microcone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
80	Аналог лабораторный абатмента MedentiBASE	II. 4.9	0,52	Совместимость со ВСЕМИ	Медицинская нержавеющая сталь

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

	CADCAM			системами	1.4305

4.10. Аналог лабораторный абатмента Multi-unit CADCAM – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-31-10	Аналог лабораторный абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.10	0,51	Microcone® / Quattrocone®	Титан класса 5
8509	Аналог лабораторный абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.10	0,51	Совместимость со ВСЕМИ системами	Титан класса 5

4.11. Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit CADCAM – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Материал
0-31-14	Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.11	0,07	Microcone® / Quattrocone®	17°	Титан класса 5
8515-17	Аналог лабораторный углового 17° абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.11	0,51	Совместимость со ВСЕМИ системами	17°	Титан класса 5

4.12. Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit CADCAM – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Угол наклона в градусах	Материал
0-31-15	Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.12	0,07	Совместимость со ВСЕМИ системами	30°	Титан класса 5
8515-30	Аналог лабораторный углового 30° абатмента Multi-unit CADCAM	II. 4.12	0,51	Совместимость со ВСЕМИ системами	30°	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.13. Аналог лабораторный CADCAM – не более 200 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-05-02	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,12	Microcone®	NI	Титан класса 5
2-05-02	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,14	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
B 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,17	Bredent Medical / SKY	D 3,5/4,0	Титан класса 5
BS 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,19	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 3,25/3,75	Титан класса 5
BS 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,22	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,1	Титан класса 5
BS 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,28	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 4,5	Титан класса 5
BS 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,35	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	D 5,5	Титан класса 5
C 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,18	Altatec / Camlog	D 3,3	Титан класса 5
C 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,21	Altatec / Camlog	D 3,8	Титан класса 5
C 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,23	Altatec / Camlog	D 4,3	Титан класса 5
C 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,27	Altatec / Camlog	D 5,0	Титан класса 5
C 84	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,42	Altatec / Camlog	D 6,0	Титан класса 5
CX 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,21	Medentis Medical / ICX	D 3,75-4,8	Титан класса 5
D 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,10	Altatec / Conelog	D 3,3	Титан класса 5
D 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	Титан класса 5
E 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,21	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5
E 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,45	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	Титан класса 5
EV 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,10	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	Титан класса 5
EV 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,14	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	Титан класса 5
EV 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	Титан класса 5
EV 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	Титан класса 5
EV 84	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	Титан класса 5
F 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,26	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
F 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,25	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	Титан класса 5
H 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,14	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	Титан класса 5
H 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,22	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	Титан класса 5
H 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,55	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	Титан класса 5
I 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,20	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	Титан класса 5
I 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,46	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	Титан класса 5
I 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,71	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	Титан класса 5
K 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,21	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	Титан класса 5
K 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,27	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	Титан класса 5
K 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,65	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	Титан класса 5
L 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,10	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
N 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,24	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5
N 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,98	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
N 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,16	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	Титан класса 5
R 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,12	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,30	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,87	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
S 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
S 83	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,13	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	Титан класса 5
T 80	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,24	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5
T 81	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,54	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5
T 82	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,89	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 85	Аналог лабораторный CADCAM	II. 4.13	0,31	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.14. Аналог лабораторный абатмента модифицируемого – не более 20 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
N 51-40	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого	II. 4.14	0,40	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Алюминий
N 51-55	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого	II. 4.14	0,42	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Алюминий
N 51-70	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого	II. 4.14	0,17	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Алюминий
N 52-40	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого	II. 4.14	0,23	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Алюминий
N 52-55	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого	II. 4.14	0,23	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Алюминий

4.15. Аналог лабораторный имплантата – не более 300 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-05-01	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,22	Microcone®	NI	Титан класса 5
2-05-01	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,33	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
4-05-01	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,49	Quattrocone30®	AI	Титан класса 5
B 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,44	Bredent Medical / SKY	D 3,5/4,0	Титан класса 5
C 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,29	Altatec / Camlog	D 3,3	Титан класса 5
C 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,36	Altatec / Camlog	D 3,8	Титан класса 5
C 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,51	Altatec / Camlog	D 4,3	Титан класса 5
C 53	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,68	Altatec / Camlog	D 5,0	Титан класса 5
D 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,54	Altatec / Conelog	D 3,3	Титан класса 5
D 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,36	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	Титан класса 5
E 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,33	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,88	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,73	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5
E 53	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,99	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

EV 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,25	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	Титан класса 5
EV 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,36	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	Титан класса 5
EV 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,50	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	Титан класса 5
EV 53	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,68	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	Титан класса 5
EV 54	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,84	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	Титан класса 5
F 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,34	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Титан класса 5
F 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,40	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
F 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,27	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	Титан класса 5
H 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,28	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	Титан класса 5
H 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,41	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	Титан класса 5
H 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,63	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	Титан класса 5
I 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,35	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	Титан класса 5
I 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,47	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	Титан класса 5
I 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	1,27	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	Титан класса 5
K 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,37	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	Титан класса 5
K 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,47	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	Титан класса 5
K 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	1,35	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	Титан класса 5
L 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,29	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,44	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
N 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,50	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	Титан класса 5
N 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,35	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5
N 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,55	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
N 53	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,24	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	Титан класса 5
R 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,33	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,57	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,87	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
S 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,35	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,56	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
S 53	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,26	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	Титан класса 5
T 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,31	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

T 51	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,54	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5
T 52	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,85	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 55	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,38	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5
Y 50	Аналог лабораторный имплантата	II. 4.15	0,71	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	D 3,5-7,0	Титан класса 5

5. Винт лабораторный – не более 300 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Вращающий момент	Материал
1-06-02	Винт лабораторный	II. 5.	0,04	Microcone®	15 Ncm	Титан класса 5
2-06-04	Винт лабораторный	II. 5.	0,07	Microcone® / Quattrocone®	25 Ncm	Титан класса 5
B 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Bredent Medical / SKY	25 Ncm	Титан класса 5
BS 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	BEGO Implant Systems / Semados S / RI / RS / RSX	30 Ncm	Титан класса 5
C 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,09	Altatec / Camlog	20 Ncm	Титан класса 5
C 62 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,13	Altatec / Camlog	20 Ncm	Титан класса 5
CX 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Medentis Medical / ICX	30 Ncm	Титан класса 5
D 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,06	Altatec / Conelog	20 Ncm	Титан класса 5
E 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
E 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,12	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	35 Ncm	Титан класса 5
EV 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,06	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 62 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
EV 63 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	25 Ncm	Титан класса 5
F 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,07	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,10	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	35 Ncm	Титан класса 5
F 66 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,04	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	15 Ncm	Титан класса 5
H 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,07	BIOMET 3i / Certain	20 Ncm	Титан класса 5
I 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,09	BIOMET 3i / External Hex	35 Ncm	Титан класса 5
K 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,07	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

K 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,1	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5
K 62 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,14	Nobel Biocare / Brånemark	35 Ncm	Титан класса 5
L 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Straumann / Bone Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,04	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 62 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
N 65 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,06	Straumann / Tissue Level	35 Ncm	Титан класса 5
R 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,08	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	30 Ncm	Титан класса 5
S 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,06	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
S 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	25 Ncm	Титан класса 5
S 67 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,05	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	15 Ncm	Титан класса 5
T 60 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,07	DENTSPLY Implants / XiVE S	25 Ncm	Титан класса 5
Y 61 L	Винт лабораторный	II. 5.	0,06	DENTSPLY Implants / ANKYLOS	25 Ncm	Титан класса 5

6. Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
1-04-02	Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки	II. 6.	0,24	Microcone®	Титан класса 5
2-04-04	Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки	II. 6.	0,27	Microcone® / Quattrocone®	Титан класса 5
2-04-05	Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки	II. 6.	0,65	Microcone® / Quattrocone®	Титан класса 5

7. Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный – не более 50 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

0-13-13	Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный	II. 7.	143,50	Microcone® / Quattrocone®	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305
M 04	Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный	II. 7.	143,50	Совместимость со ВСЕМИ системами	Медицинская нержавеющая сталь 1.4305

8. Насадка для держателей протезных конструкций – не более 100 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Разъём имплантата	Материал
1-13-03	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,24	Microcone®	NI	Титан класса 5
2-13-04	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,23	Microcone® / Quattrocone®	RI	Титан класса 5
B 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,16	Bredent Medical / SKY	D 3,5/4,0	Титан класса 5
C 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,16	Altatec / Camlog	D 3,3	Титан класса 5
C 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,18	Altatec / Camlog	D 3,8	Титан класса 5
C 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,18	Altatec / Camlog	D 4,3	Титан класса 5
C 43	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,19	Altatec / Camlog	D 5,0	Титан класса 5
C 44	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,33	Altatec / Camlog	D 6,0	Титан класса 5
D 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,09	Altatec / Conelog	D 3,3	Титан класса 5
D 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,15	Altatec / Conelog	D 3,8/4,3	Титан класса 5
E 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,19	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	NP 3,5	Титан класса 5
E 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,13	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	RP 4,3	Титан класса 5
E 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,25	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	WP 5,0	Титан класса 5
E 43	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,27	Nobel Biocare / NobelReplace Tapered	D 6,0	Титан класса 5
EV 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,22	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,0	Титан класса 5
EV 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,21	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 3,6	Титан класса 5
EV 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,24	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,2	Титан класса 5
EV 43	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,27	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 4,8	Титан класса 5
EV 44	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,27	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed EV	D 5,4	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

F 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,14	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	NP 3,5	Титан класса 5
F 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,19	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	RP 4,3/5,0	Титан класса 5
F 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,21	Nobel Biocare / NobelActive - NobelReplace Coni®	D 3,0	Титан класса 5
H 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,12	BIOMET 3i / Certain	D 3,4	Титан класса 5
H 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,22	BIOMET 3i / Certain	D 4,1	Титан класса 5
H 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,33	BIOMET 3i / Certain	D 5,0	Титан класса 5
I 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,17	BIOMET 3i / External Hex	D 3,4	Титан класса 5
I 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,25	BIOMET 3i / External Hex	D 4,1	Титан класса 5
I 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,37	BIOMET 3i / External Hex	D 5,0	Титан класса 5
K 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,21	Nobel Biocare / Brånemark	NP 3,5	Титан класса 5
K 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,21	Nobel Biocare / Brånemark	RP 4,1	Титан класса 5
K 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,34	Nobel Biocare / Brånemark	WP 5,1	Титан класса 5
L 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,18	Straumann / Bone Level	NC 3,3	Титан класса 5
L 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,20	Straumann / Bone Level	RC 4,1/4,8	Титан класса 5
N 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,29	Straumann / Tissue Level	NN 3,5	Титан класса 5
N 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,22	Straumann / Tissue Level	RN 4,8	Титан класса 5
N 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,42	Straumann / Tissue Level	WN 6,5	Титан класса 5
N 43	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,20	Straumann / Tissue Level	NNC 3,5	Титан класса 5
R 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,13	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 3,5	Титан класса 5
R 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,27	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 4,5	Титан класса 5
R 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,25	Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent	D 5,7	Титан класса 5
S 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,20	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,5/4,0	Титан класса 5
S 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,11	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 4,5/5,0	Титан класса 5
S 43	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,12	DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed TX	D 3,0	Титан класса 5
T 40	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,20	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,4	Титан класса 5
T 41	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	1,26	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 4,5	Титан класса 5
T 42	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,42	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 5,5	Титан класса 5
T 45	Насадка для держателей протезных конструкций	II. 8.	2,10	DENTSPLY Implants / XiVE S	D 3,8	Титан класса 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма – не более 20 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-18	Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма	II.9.	4,34	Microcone®	Твёрдый сплав из карбида вольфрама 88 % + кобальта 12 %
M 17	Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма	II. 9.	4,34	Со ВСЕМИ системами	Твёрдый сплав из карбида вольфрама 88 % + кобальта 12 %
M 19	Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма	II. 9.	4,21	Со ВСЕМИ системами	Твёрдый сплав из карбида вольфрама 88 % + кобальта 12 %

10. Развёртка MedentiBASE для шляпки винта – не более 20 шт. каждого.

Кат. №	Название медицинского изделия	Номер в заявлении на регистрацию	Вес МИ нетто, г	Совместимость с системами	Материал
0-28-19	Развёртка MedentiBASE для шляпки винта	II. 10.	4,38	Microcone®	Твёрдый сплав из карбида вольфрама 88 % + кобальта 12 %
M 18	Развёртка MedentiBASE для шляпки винта	II. 10.	4,38	Со ВСЕМИ системами	Твёрдый сплав из карбида вольфрама 88 % + кобальта 12 %

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.2 Габаритные размеры медицинских изделий

Группа изделий	Длина		Ширина (диаметр)	
	Наименьшая	Наибольшая	Наименьшая	Наибольшая
Абатменты	3,45 ± 0,5 мм	25,3 ± 0,5 мм	4 ± 0,5 мм	15,8 ± 0,5 мм
Винты	3,4 ± 0,5 мм	8,3 ± 0,5 мм	2,15 ± 0,5 мм	4,5 ± 0,5 мм
Колпачки	3,4 ± 0,5 мм	11 ± 0,5 мм	2,15 ± 0,5 мм	10 ± 0,5 мм
Основания	3,9 ± 0,2 мм	14,2 ± 0,5 мм	3,3 ± 0,2 мм	6,2 ± 0,5 мм
Принадлежности				
Абатменты для планирования и сканирования	10,03 ± 0,5 мм	16,33 ± 0,5 мм	4,06 ± 0,5 мм	6,67 ± 0,5 мм
Трансферы слепочные	10 ± 0,5 мм	20,73 ± 0,5	4,2 ± 0,2 мм	6,9 ± 0,5 мм
Аналоги имплантатов и абатментов	6,5 ± 0,5 мм	19,8 ± 0,5 мм	3 ± 0,2 мм	5,4 ± 0,5 мм
Винты лабораторные	4,5 ± 0,5 мм	10,5 ± 0,5 мм	1,85 ± 0,1 мм	3,2 ± 0,2 мм
Винты для фиксации	19 ± 0,5 мм	24 ± 0,5 мм	2,4 ± 0,5 мм	2,4 ± 0,5 мм
Держатели	100 ± 0,5 мм		15,8 ± 0,5 мм	
Насадки для держателей	17 ± 0,5 мм		4,97 ± 0,5 мм	
Развёртки MedentiBASE	20 ± 0,5 мм	26 ± 0,5 мм	5 ± 0,5 мм	5 ± 0,5 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Медицинское изделие представляет собой различные варианты исполнения абатментов, винтов, колпачков, оснований, а также принадлежностей к ним, которые в совокупности предоставляют возможность лечащему врачу и стоматологу восстановить эстетику и функциональность зубов у частично или полностью беззубого пациента, который уже прошёл лечение зубными имплантатами, и их приживление полностью завершено.

Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями, произведённые компанией МЕДЕНТиКА, предназначены для размещения исключительно на остеоинтегрированных (заживлённых) имплантатах. После имплантации должно пройти не менее 4-6 месяцев, прежде чем реставрация может быть возобновлена. Таким образом, будет обеспечена не только первичная (механическая), но и вторичная (прочность соединения имплантата с костью) стабильность имплантата.

4.1 Способ применения

4.1.1 Абатмент стандартный прямой/угловой

4.1.1.1 Материал

Абатменты стандартные прямые/угловые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.1.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.
- Цементная фиксация протеза.

4.1.1.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексац ¨ положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.1.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают прямой или угловой стандартный абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.1.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

4.1.1.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту абатмента блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

4.1.2 Абатмент модифицируемый прямой/угловой

4.1.2.1 Материал

Абатменты модифицируемые прямые/угловые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.2.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.
- Цементная фиксация протеза.

4.1.2.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.2.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают абатмент обтачиваемый и модифицируют в соответствии с потребностями пациента. Для модификации помещают абатмент в защитный аналог и подготавливают его с помощью карборундового диска и твердосплавного бора.

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда изменяйте имплантатный разъём абатмента и не уменьшайте толщину стенки менее 0,4 мм.

- Располагают абатмент на лабораторном аналоге, проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов

4.1.2.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат, вкручивая его или закрепляя винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента (при использовании «абатмента модифицируемого прямого» - используют оригинальный инструмент фирмы Straumann для фиксации абатмента) согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

4.1.2.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту абатмента блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента (не относится к «Абатменту модифицируемому прямому»).
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1.3 Абатмент MedentiBASE прямой, винт и колпачок

4.1.3.1 Материал

Абатменты MedentiBASE прямые, винты, колпачки и основания произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.3.2 Показания к применению

- Установка многокомпонентного винтового протеза.
- Используют в случае повышенной посадочной платформы зубного протеза, когда установка протеза на уровне имплантата не представляется возможной, или является единственным возможным способом в связи с глубиной или углом наклона имплантата.

4.1.3.3 Соединение абатмента (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата и убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Выбирают подходящую высоту абатмента MedentiBASE: измеряют высоту воротника абатмента.
- Вкручивают абатмент MedentiBASE в имплантат, после чего с помощью ключа-трещотки и отвертки MedentiBASE затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.

4.1.3.4 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Устанавливают соответствующий слепочный трансфер на абатмент MedentiBASE и затягивают винт вручную.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём MedentiBASE, после чего высушивают его.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности абатмента MedentiBASE.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.
- Используя винт-заглушку MedentiBASE в верхней части абатмента MedentiBASE, закрывают канал доступа к винту абатмента MedentiBASE.

4.1.3.5 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Производят протезирование, используя компоненты протетические:
- Для временного протезирования используют колпачок титановый MedentiBASE (см. процедуру установки абатмента временного);

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для пассивного и постоянного соединения протезов используют колпачок титановый вклеиваемый MedentiBASE либо основание титановое MedentiBASE.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.3.6 Соединение окончательного протеза (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Удаляют винт-заглушку MedentiBASE.
- Проверяют фиксацию абатмента MedentiBASE.
- Аккуратно устанавливают протез на абатменты и соединяют его с абатментами с помощью винтов абатмента MedentiBASE. Начинают со среднего заднего сегмента и затягивают все остальные винты попеременно с левой и правой стороны.
- Проверяют окклюзионный и межзубной контакты. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винты до 15 Нсм.
- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента MedentiBASE с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом.

4.1.4 Абатмент MedentiLOC

4.1.4.1 Материал

Абатменты MedentiLOC прямые/угловые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5), верхняя часть абатментов покрыта нитридом титана (TiN).

4.1.4.2 Показания к применению

- Съемные, состоящие из нескольких частей, зубные протезы с опорой на имплантаты.

4.1.4.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.4.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают прямой или угловой абатмент MedentiLOC и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.4.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают MedentiLOC абатмент на имплантат и закрепляют его напрямую (прямой абатмент) или с помощью винта углового абатмента MedentiLOC (угловой абатмент), используя для этого ключ-трещотку и MedentiLOC отвертку согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- Заполняют разъём для инструмента (прямой абатмент) или канал доступа к винту абатмента (угловой абатмент) блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.

4.1.4.6 Соединение окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатменты и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.

4.1.5 Абатмент Novaloc/Optiloc

4.1.5.1 Материал

Абатменты Novaloc прямые/угловые и Optiloc произведены из титана класса 5 (titanium grade 5), верхняя часть абатментов покрыта плазменно-химическим осаждением из газовой фазы.

4.1.5.2 Показания к применению

- Съемные, состоящие из нескольких частей, зубные протезы с опорой на имплантаты.

4.1.5.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Подбирают слепочный трансфер и помещает его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.5.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают прямой или угловой Novaloc абатмент или прямой Optiloc абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.5.5 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают Novaloc или Optiloc абатмент на имплантат и закрепляют его напрямую (прямой абатмент) или с помощью винта углового абатмента Novaloc (угловой абатмент) с помощью ключа-трещотки и соответствующей отвертки согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- Заполняют разъём для инструмента (прямой абатмент) или канал доступа к винту углового абатмента Novaloc (угловой абатмент) блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к нему доступ.

4.1.5.6 Соединение окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатменты и проверяет окклюзионный контакт и контакт между мягкими тканями. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.

4.1.6 Абатмент POC

4.1.6.1 Материал

Абатменты POC произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1.6.2 Показания к применению

- Изготовление гибрид-абатмента или абатмента с напрессованной керамической коронкой.
- Протезирование одного зуба.

4.1.6.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.6.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают подходящий абатмент РОС и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают гибрид-абатмент в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов согласно технологии напрессовывания керамики.
- Проверяют правильность бесшовной посадки керамики на РОС абатмент.

4.1.6.5 Фиксация гибрид-абатмента/абатмента с напрессованной керамической коронкой (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают гибрид-абатмент или абатмент с напрессованной керамической коронкой на имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента с напрессованной керамической коронкой с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.

4.1.6.6 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают керамическую коронку на гибрид-абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют герметично канал доступа к винту абатмента с использованием соответствующего материала, такого как гуттаперча или силикон, после чего закрывают канал светоотверждаемым материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

4.1.7 Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный/ротационный

4.1.7.1 Материал

Абатменты кобальт-хромовые приливаемые антиротационные/ротационные произведены из кобальт-хром-молибденового сплава (CoCr).

4.1.7.2 Показания к применению

- Моделирование реставрационной конструкции (коронки) из воска на абатменте и изготовление цельной реставрационной конструкции (коронки на абатменте) из кобальт-хромового сплава методом приливания к абатменту.
- Протезирование одного зуба.

4.1.7.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций (в зависимости от типа абатмента) положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.7.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепочный трансфер и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают индексированный или неиндексированный приливаемый абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Моделируют коронку из воска на приливаемом абатменте на мастер-модели.
- Изготавливают муфель с расположенной в нём восковой коронкой на приливаемом абатменте.
- Приливают коронку в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации паковочной массы, используя технику литья кобальт-хромовых сплавов.
- Дообрабатывают и полируют изготовленную реставрационную конструкцию, а также проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.7.5 Установка реставрационной конструкции (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают реставрационную конструкцию в имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.

4.1.8 Абатмент PreFace

4.1.8.1 Материал

Абатменты PreFace произведены из титана класса 5 (titanium grade 5) либо из кобальт-хром-молибденового сплава (CoCr).

4.1.8.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.

4.1.8.3 Сканирование челюстей пациента (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают абатмент для сканирования, помещают в одну из возможных индексаций положения имплантата и фиксируют его винтом для фиксации к имплантату.
- Сканирование остеоинтегрированного имплантата с и без абатмента для сканирования, соседних и противоположных, а также и окклюзии челюстей.
- Для определения данных, необходимых для приготовления на 3D-принтере напечатанной мастер-модели, сканируют всю полость рта с и без абатмента для сканирования.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- На основании полученных данных виртуально конструируется индивидуальный абатмент при помощи соответствующего программного обеспечения, а также данных из библиотеки PreFace, полученных в распоряжение от компании MEDENTiKA.
- Сохраняют полученные данные для передачи их зуботехнической лаборатории.
- В случае, если у врача-стоматолога нет соответствующего оборудования для сканирования, необходимо перейти к традиционному и общепринятому методу снятия слепка поверхности имплантата (см. 4.1.8.4).

4.1.8.4 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.8.5 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса с помощью десневой маски, которая может быть сканирована и удалена.
- Вставляют абатмент для сканирования в лабораторный аналог имплантата и вкручивают его внутрь с помощью соответствующего лабораторного винта.
- Выбирают подходящий имплантат и абатмент PreFace из архива MEDENTiKA и сканируют модель с помощью вставленного абатмента для сканирования.
- Сканируют десневую маску.
- Изготавливают по заказу профиль выступания и часть абатмента, обращенную к ротовой полости, в соответствии с конкретными анатомическими характеристиками.
- Убедитесь, что минимальная толщина стенки абатмента PreFace составляет не менее 0,5 мм, а угол наклона не превышает 30°.
- Сохраняют данные для передачи их на зуботехнический фрезерный станок.

4.1.8.6 Обработка на фрезерном станке абатмента PreFace (Зуботехническая лаборатория)

- Загружают переданный файл данных и проверяют рекомендации конструкции относительно толщины стенок и угла наклона.
- Выбирают надлежащий абатмент PreFace и устанавливают его в держатель PreFace абатмента.
- Обрабатывают на фрезерном станке абатмент PreFace в соответствии с переданным файлом данных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём PreFace абатмента.

- Дообрабатывают и проверяют изготовленный индивидуальный абатмент.

4.1.8.7 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

4.1.8.8 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.,

4.1.9 Абатмент MedentiCAD

4.1.9.1 Материал

Абатменты MedentiCAD произведены из абатмента PreFace из титана класса 5 (titanium grade 5) либо из кобальт-хром-молибденового сплава (CoCr).

4.1.9.2 Показания к применению

- Установка протеза для одного или нескольких зубов.

4.1.9.3 Сканирование челюстей пациента (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают абатмент для сканирования, помещают в одну из возможных индексаций положения имплантата и фиксируют его винтом для фиксации к имплантату.
- Сканирование остеоинтегрированного имплантата с и без абатмента для сканирования, соседних и противоположных, а также и окклюзии челюстей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для определения данных, необходимых для приготовления на 3D-принтере напечатанной мастер-модели, сканируют всю полость рта с и без абатмента для сканирования.
- На основании полученных данных виртуально конструируется индивидуальный абатмент MedentiCAD при помощи соответствующего программного обеспечения, а также данных из библиотеки MedentiCAD, полученных в распоряжение от компании MEDENTiKA.
- Сохраняют полученные данные для передачи их компании MEDENTiKA.
- В случае, если у врача-стоматолога нет соответствующего оборудования для сканирования, необходимо перейти к традиционному и общепринятому методу снятия слепка поверхности имплантата (см. 4.1.9.4).

4.1.9.4 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.9.5 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса с помощью десневой маски, которая может быть сканирована и удалена.
- Вставляют абатмент для сканирования в лабораторный аналог имплантата и вкручивают его внутрь с помощью соответствующего лабораторного винта.
- Выбирают подходящий имплантат и абатмент PreFace из библиотеки MedentiCAD и сканируют модель с помощью вставленного абатмента для сканирования.
- Сканируют десневую маску.
- Изготавливают по заказу профиль выступания и часть абатмента, обращенную к ротовой полости, в соответствии с конкретными анатомическими характеристиками.
- Убедитесь, что минимальная толщина стенки абатмента PreFace составляет не менее 0,5 мм, а угол наклона не превышает 30°.
- Сохраняют данные для передачи их компании MEDENTiKA (4.1.9.6) или зуботехнической лаборатории (4.1.9.7) для изготовления абатмента MedentiCAD.

4.1.9.6 Размещение заказа в компании MEDENTiKA

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- На основании данных, полученных в ходе процедур, описанных в пунктах 4.1.9.3 и 4.1.9.4, размещается заказ на изготовление абатмента MedentiCAD и пересылаются полученные данные.
- Компания MEDENTiKA изготавливает абатмент MedentiCAD на основании полученных данных и пересылает его заказчику.

4.1.9.7 Обработка на фрезерном станке (Зуботехническая лаборатория)

- Загружают переданный файл данных и проверяют рекомендации конструкции относительно толщины стенок и угла наклона.
- Выбирают надлежащий абатмент PreFace и устанавливают его в держатель PreFace абатмента.
- Обрабатывают на фрезерном станке абатмент PreFace в соответствии с переданным файлом данных.

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём PreFace абатмента.

- Дообрабатывают и проверяют изготовленный индивидуальный абатмент.

4.1.9.8 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт абатмента с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

4.1.9.9 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

4.1.10 Абатмент временный

4.1.10.1 Материал

Абатменты временные произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

Верхняя часть абатментов временных прямых/угловых с каталожными номерами:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2-17-07; 2-17-08; 2-17-09; 2-17-10 произведена из поливинилиденфторида.

4.1.10.2 Показания к применению

- Временный протез с винтовой фиксацией для одного или нескольких зубов

4.1.10.3 Слепок (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер имплантата и помещают его в один из возможных указателей положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.10.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса.
- Выбирают временный абатмент и помещают его в лабораторный аналог имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Изготавливают временную конструкцию в соответствии с инструкцией изготовителя по эксплуатации материалов.
- Проверяют правильность посадки и состояние контактных точек конструкции.

4.1.10.5 Абатмент / Соединение временной конструкции (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём временного абатмента.

- Убеждаются, что платформа имплантата лишена каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту фиксации абатмента.

4.1.11 Винт углового абатмента MedentiLOC и Novaloc

4.1.11.1 Материал

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Винты угловых абатментов MedentiLOC и Novaloc произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.11.2 Назначение

- Фиксация угловых абатментов MedentiLOC и Novaloc к имплантату.

4.1.12 Винт абатмента

4.1.12.1 Материал

Винты абатментов произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.12.2 Назначение

- Фиксация абатментов и оснований к имплантату.

4.1.13 Винт абатмента MedentiBASE

См. пункт 4.1.3.

4.1.14 Винт абатмента Multi-unit

4.1.14.1 Материал

Винты абатментов Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.14.2 Назначение

- Фиксация многокомпонентной конструкции на протяжении планирования, моделирования, производства, а также финальная фиксация многокомпонентной конструкции к абатменту Multi-unit.

4.1.15 Винт-заглушка MedentiBASE

См. пункт 4.1.3.

4.1.16 Винт-заглушка Multi-unit

4.1.16.1 Материал

Винты-заглушки Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.16.2 Назначение

- Защита абатмента Multi-unit и его винтового канала от повреждений и загрязнений.
- Предотвращение роста десны (гингивы) над абатментом Multi-unit.

4.1.17 Винт-патрица MedentiLOC для мостовидных протезов

4.1.17.1 Материал

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Винты-заглушки Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5). Верхняя часть изделия покрыта нитридом титана (TiN).

4.1.17.2 Назначение

- Фиксация к мостовидной конструкции, на которой в последствии будет держаться съёмный протез.

4.1.18 Винт-патрица Novaloc и Optiloc для мостовидных протезов

4.1.18.1 Материал

Винты-заглушки Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5). Верхняя часть изделий покрыта ADLC (ПХГФО – Плазменно-химическое осаждение из газовой фазы).

4.1.18.2 Назначение

- Фиксация к мостовидной конструкции, на которой впоследствии будет держаться съёмный протез.

4.1.19 Колпачок титановый MedentiBASE

См. пункт 4.1.3.

4.1.20 Колпачок титановый Multi-unit

4.1.20.1 Материал

Колпачки титановые Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.20.2 Назначение

- Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту Multi-unit в клинических и лабораторных условиях.

4.1.21 Колпачок титановый вклеиваемый MedentiBASE

См. пункт 4.1.3.

4.1.22 Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit

4.1.22.1 Материал

Колпачки кобальт-хромовые Multi-unit произведены из кобальт-хромового сплава (CoCr).

4.1.22.2 Назначение

- Моделирование временной или постоянной мостовидной конструкции, а также фиксация к абатменту Multi-unit в клинических и лабораторных условиях.

4.1.23 Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных

4.1.23.1 Материал

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Колпачки позиционирующие для трансферов слепочных произведены из полиформальдегида (полиоксиметилен – POM).

4.1.23.2 Назначение

- Для снятия слепка методом закрытой ложки.
- Используется в комбинации с трансфером слепочным для закрытой ложки и винтом абатмента.

4.1.24 Колпачок пластиковый MedentiBASE

4.1.24.1 Материал

Колпачки пластиковые MedentiBASE произведены из аморфного монолитного полимера (поликарбоната) –Tecanat PC.

4.1.24.2 Назначение

- Для моделирования и изготовления многокомпонентной конструкции с опорой на абатменты MedentiBASE в лабораторных условиях.

4.1.25 Колпачок пластиковый вклеиваемый MedentiBASE

4.1.25.1 Материал

Колпачки пластиковые вклеиваемые MedentiBASE произведены из аморфного монолитного полимера (поликарбоната) –Tecanat PC.

4.1.25.2 Назначение

- Для моделирования, изготовления и размещения многокомпонентной конструкции с опорой на абатменты MedentiBASE в лабораторных условиях.

4.1.26 Колпачок пластиковый Multi-unit

4.1.26.1 Материал

Колпачки пластиковые Multi-unit произведены из аморфного монолитного полимера (поликарбоната) –Tecanat PC.

4.1.26.2 Назначение

- Для моделирования и изготовления многокомпонентной конструкции с опорой на абатменты Multi-unit в лабораторных условиях.

4.1.27 Колпачок трансфера слепочного индивидуального

4.1.27.1 Материал

Колпачки трансферов слепочных индивидуальных произведены из медицинского полиэфирэфиркетона (PEEK).

4.1.27.2 Назначение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для определения точного месторасположения формирователя десны и остеоинтегрированного имплантата при снятии слепка трансфером слепочным индивидуальным для закрытой ложки в клинических условиях.

4.1.28 Основание титановое

4.1.28.1 Материал

Основания титановые произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.28.2 Показания к применению

- Изготовление гибрид-абатмента
- Установка протеза для одного зуба.
- Цементная фиксация протеза.

4.1.28.3 Слепок поверхности имплантата (Врач-стоматолог)

- Снимают формирователь десны или временную конструкцию с имплантата.
- С помощью пульверизатора распыляют воздух / воду на разъём имплантата, после чего высушивают его.
- Подбирают слепочный трансфер и помещают его в одну из возможных индексаций положения имплантата.
- Проверяют правильность посадки и фиксируют его вручную.
- Имея необходимый материал, снимают слепок поверхности имплантата.
- Направляют в зуботехническую лабораторию, помимо слепочного трансфера и слепка имплантата, информацию о челюсти-антагонисте и оттенке.

4.1.28.4 Лабораторные процедуры (Зубной техник)

- Убеждаются, что слепочный материал лишен трещин и пузырей.
- Устанавливают соответствующий лабораторный аналог имплантата на слепок имплантата и подготавливают мастер-модель жесткого гипса с помощью десневой маски, которая может быть сканирована и удалена.
- Вставляют абатмент для сканирования в лабораторный аналог имплантата и вкручивают его внутрь с помощью соответствующего лабораторного винта.
- Выбирают подходящий имплантат и основание титановое из архива MEDENTiKA и сканируют модель с помощью вставленного абатмента для сканирования.
- Сканируют десневую маску.
- Изготавливают по заказу профиль выступания и часть абатмента, обращенную к ротовой полости, в соответствии с конкретными анатомическими характеристиками пациента.
- Убедитесь, что минимальная толщина стенки циркониевого абатмента составляет не менее 0,4 мм, а угол наклона не превышает 30°.
- Сохраняют данные для передачи их на зуботехнический фрезерный станок.
- Загружают переданный файл данных и проверяют толщину стенок и угол наклона.
- Выбирают материал (цирконий, кобальт-хромовый сплав и т. д.) и обрабатывают на фрезерном станке в соответствии с переданным файлом данных.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1.28.5 Склеивание основания титанового (Зубной техник)

- Вставляют основание титановое в лабораторный аналог имплантата и заполняют винтовой канал воском.
- Проводят пескоструйную обработку оксидом алюминия (110 мкм, 2 бар) соединяемых поверхностей основания титанового и циркониевого абатмента или мостовидного протеза, после чего очищают поверхности.
- Наносят адгезивный клей на склеиваемую поверхность основания титанового в соответствии с рекомендациями производителя.
- Помещают циркониевый абатмент или мостовидный протез на основание титановое и обеспечивают корректное соединение.
- Удаляют излишки адгезивного клея и воска.

4.1.28.6 Фиксация абатмента (Врач-стоматолог)

Примечание: Для соблюдения надлежащей прочности и соответствующих размеров, никогда не изменяйте имплантатный разъём основания титанового.

- Убеждаются, что разъём имплантата лишён каких-либо остатков мягкой или костной ткани.
- Устанавливают абатмент или многокомпонентную конструкцию на имплантат и закрепляют винт в имплантате с помощью подходящей отвертки.
- Снятие рентгеновского снимка зубов может быть полезным для подтверждения точной посадки абатмента.
- С помощью ключа-трещотки затягивают винт абатмента согласно рекомендованному вращающему моменту, указанному в инструкции по эксплуатации абатмента.

4.1.28.7 Цементирование окончательного протеза (Врач-стоматолог)

- Аккуратно устанавливают протез на абатмент и проверяют окклюзионный и межзубной контакт. Протез должен находиться в состоянии легкой окклюзии. Жевательная поверхность должна быть минимальной.
- Заполняют канал доступа к винту блокирующим материалом, чтобы сохранить доступ к винту абатмента.
- Цементируют протез с использованием постоянного цемента в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя цемента.

4.1.29 Основание титановое MedentiBASE

См. пункт 4.1.3.

4.1.30 Основание титановое Multi-unit

4.1.30.1 Материал

Основания титановые Multi-unit произведены из титана класса 5 (titanium grade 5).

4.1.30.2 Назначение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для изготовления и размещения одно- или многокомпонентной конструкции (циркониевого абатмента/циркониевой коронки/мостовидной конструкции из диоксида циркония) на абатменте Multi-unit на титановом основании при помощи фиксации циркониевого компонента цементом к основанию и винтом абатмента Multi-unit к абатменту Multi-unit.

4.1.31 Основание для моделирования MedentiCAD

4.1.31.1 Материал

Основания для моделирования MedentiCAD произведены из медицинской нержавеющей стали 1.4305.

4.1.31.2 Назначение

- Для воскового моделирования одно- или многокомпонентной конструкции в лабораторных условиях.

4.1.32 Абатмент для планирования прямой/угловой

4.1.32.1 Материал

Абатменты для планирования произведены из элоксированного алюминия.

4.1.32.2 Назначение

- Для планирования одно- или многокомпонентной конструкции на модели в лабораторных условиях.
- Имитирует соответствующий абатмент с определённым разъёмом.

4.1.33 Абатменты для планирования, в наборах

4.1.33.1 Материал

См. пункт 4.1.24.1.

4.1.33.2 Назначение

См. пункт 4.1.24.2.

4.1.34 Абатмент для сканирования

4.1.34.1 Материал

Абатменты для сканирования произведены из нелегированного титана класса 4 (titanium grade 4) и анодированы в серый цвет. Этот вариант доработки абатмента для сканирования улучшает распознавание сканером.

4.1.34.2 Назначение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения абатмента и остеоинтегрированного имплантата, а также направления.

4.1.35 Абатмент для сканирования MedentiBASE

4.1.35.1 Материал

Абатменты для сканирования MedentiBASE произведены из нелегированного титана класса 4 (titanium grade 4) и анодированы в серый цвет. Этот вариант доработки абатмента для сканирования улучшает распознавание сканером.

4.1.35.2 Назначение

- Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения и направления абатмента MedentiBASE.

4.1.36 Абатмент для сканирования Multi-unit (угловой)

4.1.36.1 Материал

Абатменты для сканирования Multi-unit (угловые) произведены из нелегированного титана класса 4 (titanium grade 4) и анодированы в серый цвет. Этот вариант доработки абатмента для сканирования улучшает распознавание сканером.

4.1.36.2 Назначение

- Для сканирования ротовой полости в клинических условиях и модели в лабораторных условиях с целью определения точного месторасположения (/угла) и направления абатмента Multi-unit.

4.1.37 Трансфер слепочный

4.1.37.1 Материал

Трансферы слепочные произведены из титана класса 5 и анодированы (titanium grade 5), за исключением Трансфера слепочного прямого MedentiBASE, включая винт для фиксации, который произведён из медицинской нержавеющей стали 1.4305.

4.1.37.2 Назначение

- Для снятия слепка с целью определения точного месторасположения имплантата в челюстной кости (/для индивидуального/ а также прилегающей к имплантату сформированной десны) методом закрытой (/для индивидуального/ при помощи колпачка трансфера слепочного индивидуального) /открытой ложки в клинических условиях, фиксируя трансферы на остеоинтегрированные имплантаты. Трансферы MedentiBASE и Multi-unit предназначены для точного месторасположения соответствующих абатментов и, соответственно, размещаются и фиксируются для снятия слепка на них, а не на остеоинтегрированных имплантатах.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.1.38 Аналоги лабораторные имплантатов и абатментов

4.1.38.1 Материал

Аналоги лабораторные произведены из титана класса 5 и анодированы (titanium grade 5), за исключением Аналогов лабораторных MedentiLOC, Novaloc, MedentiBASE и MedentiBASE CADCAM, которые произведены из медицинской нержавеющей стали 1.4305.

4.1.38.2 Назначение

- Для планирования и изготовления съёмной многокомпонентной конструкции на гипсовой или на напечатанной на 3D-принтере модели в лабораторных условиях.
- Имитирует соответствующий абатмент (MedentiLOC, Novaloc, MedentiBASE, Multi-unit и т. д.) или имплантат соответствующей серии.

4.1.39 Аналоги имплантатов лабораторные абатментов модифицируемых

4.1.39.1 Материал

Аналоги имплантатов лабораторные абатментов модифицируемых произведены из алюминия и дополнительно элоксируются в соответствующий цвет имплантата.

4.1.39.2 Назначение

- Для планирования и изготовления одно- или многокомпонентной фиксированной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях.
- Имитирует имплантат с вкрученным в него цельным абатментом модифицируемым серии N следующих каталожных номеров: N 110-40, N 110-55, N 110-70, N 120-40, N 120-55.

4.1.40 Винт лабораторный

4.1.40.1 Материал

Винты лабораторные произведены из алюминия и дополнительно элоксируются.

4.1.40.2 Назначение

- Для фиксации абатментов для планирования и других компонентов при планировании и изготовлении одно- или многокомпонентной фиксированной конструкции на гипсовой модели в лабораторных условиях.

4.1.41 Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки

4.1.41.1 Материал

Винты для фиксации трансферов слепочных произведены из титана класса 5 (titanium grade 5) и могут быть дополнительно анодированы.

4.1.41.2 Назначение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Для фиксации трансфера слепочного во время снятия слепка методом открытой ложки в клинических условиях.

4.1.42 Держатель протезных конструкций

4.1.42.1 Материал

Держатели протезных конструкций произведены из медицинской нержавеющей стали 1.4305.

4.1.42.2 Назначение

- Для моделирования и работы над протезными конструкциями в лабораторных условиях при помощи насадок.

4.1.43 Насадка для держателей протезных конструкций

4.1.43.1 Материал

Насадки для держателей протезных конструкций произведены из титана класса 5 (titanium grade 5) и могут быть дополнительно анодированы.

4.1.43.2 Назначение

- Для имитации соответствующего разъёма имплантата при моделировании и работе над протезными конструкциями в лабораторных условиях при помощи держателя.

4.1.44 Развёртки MedentiBASE

4.1.44.1 Материал

Развёртки MedentiBASE произведены из твёрдого сплава.

4.1.44.2 Назначение

- Для финальной обработки протезных конструкций перед позиционированием на абатмент MedentiBASE.

4.2 Условия применения

- Медицинское изделие должно быть использовано только профессиональными стоматологами и зубными техниками.
- Перед использованием медицинское изделие должно быть проверено.
- Упаковка должна быть закрытой и без видимых повреждений.
- При эксплуатации «Изделия протетические для систем дентальной имплантации с принадлежностями» устойчивы к воздействию температуры от 32 до 42°C, относительной влажности 20-100 % и воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. МАРКИРОВКА.

Вся продукция компании MEDENTiKA маркируется в соответствии с описанием маркировки ниже.

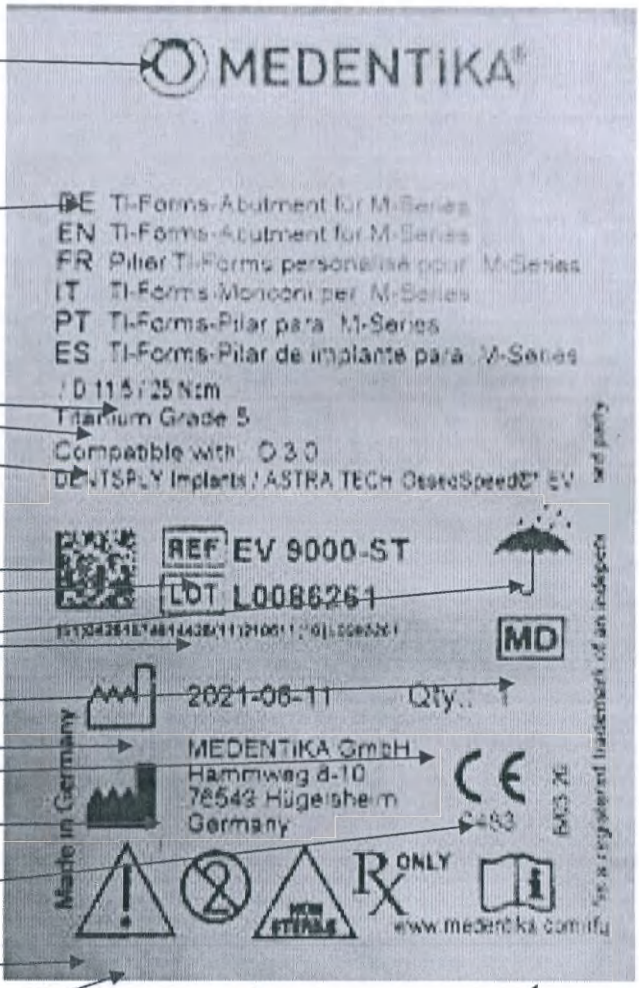

Товарный знак производителя

Наименование МИ на европейских языках

Технические параметры

Использованный материал при производстве МИ

Совместимость с имплантационными системами

QR-код

Номер по каталогу

Номер партии

Беречь от влаги

Медицинское изделие

Дата изготовления

Количество

Производитель

Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Евросоюза

Страна происхождения

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

Запрет на повторное применение

Не стерильно

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ с указанием электронного адреса, где можно ознакомиться с инструкцией

Изделия, предназначенные для поставки на территорию Российской Федерации, снабжены дополнительной этикеткой с маркировкой на русском языке.

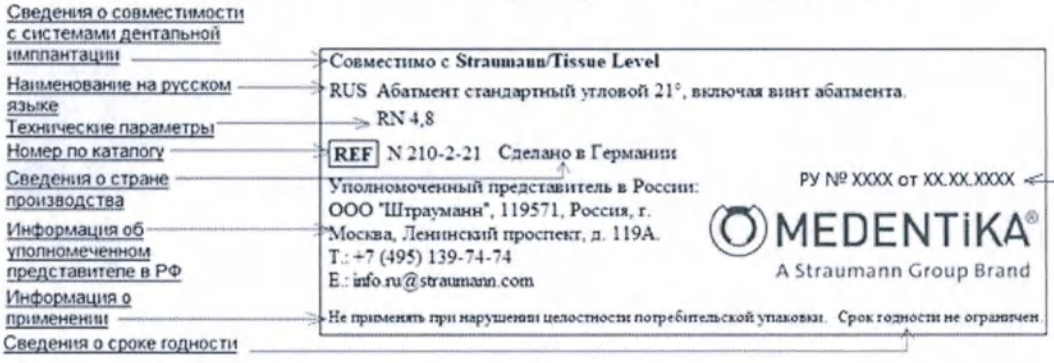

Сведения о совместимости с системами дентальной имплантации

Наименование на русском языке

Технические параметры

Номер по каталогу

Сведения о стране производства

Информация об уполномоченном представителе в РФ

Информация о применении

Сведения о сроке годности

Номер и дата регистрационного удостоверения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. УПАКОВКА.

Для всех компонентов медицинского изделия существует десять вариантов упаковки, которые представлены ниже.

6.1 Вариант (I)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковая коробка (первичная упаковка)	57 x 41 x 13 мм	Полистирол (ПС)	9003-53-6	Красный / прозрачный
Вкладыш пластиковый блистерный (первичная упаковка)	54 x 38 x 10 мм	Твёрдый поливинилхлорид (ПВХ)	9002-86-2	Прозрачный
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	100 x 70 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

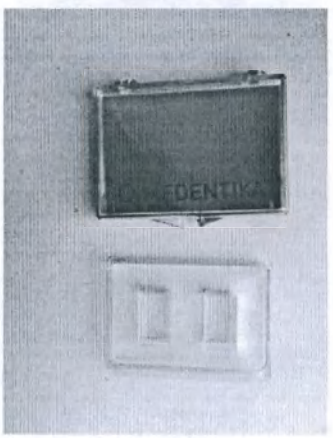

Пластиковая коробка + вкладыш пластиковый блистерный с двумя отделениями

Пластиковая коробка с вложенным в неё вкладышем пластиковым блистерным

Первичная упаковка с этикеткой (лицевая сторона)

Первичная упаковка с этикеткой (функция герметизации)

Первичная упаковка с этикеткой (тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

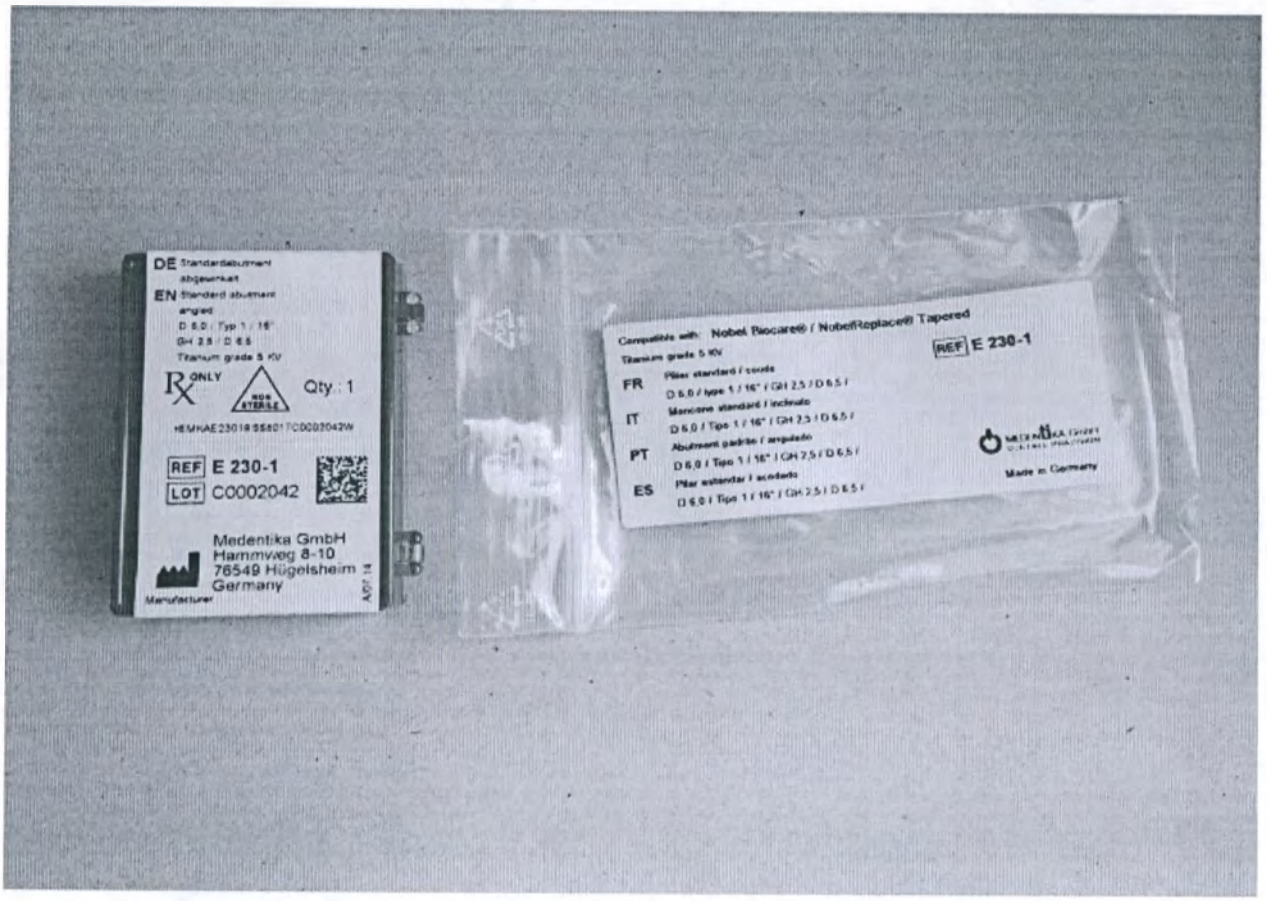

Первичная упаковка (пластиковая коробка) и вторичная упаковка (пластиковый пакет)

Финальная упаковка продукта (лицевая сторона)

Финальная упаковка продукта (тыльная сторона)

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки: указан в Таблице 6.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.2 Вариант (II)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковая коробка (первичная упаковка)	57 x 41 x 13 мм	Полистирол (ПС)	9003-53-6	Красный / прозрачный
Вкладыш поролоновый для размещения продукции (первичная упаковка)	54 x 38 x 10 мм	Пенополиуретан (ППУ)	9009-54-5	Чёрный
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	100 x 70 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

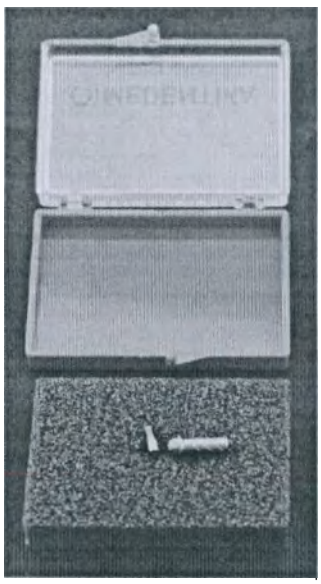

Пластиковая коробка + вкладыш поролоновый

Пластиковая коробка с вложенным в неё вкладышем поролоновым

Первичная упаковка с этикеткой (лицевая сторона)

Первичная упаковка с этикеткой (функция герметизации)

Первичная упаковка с этикеткой (тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

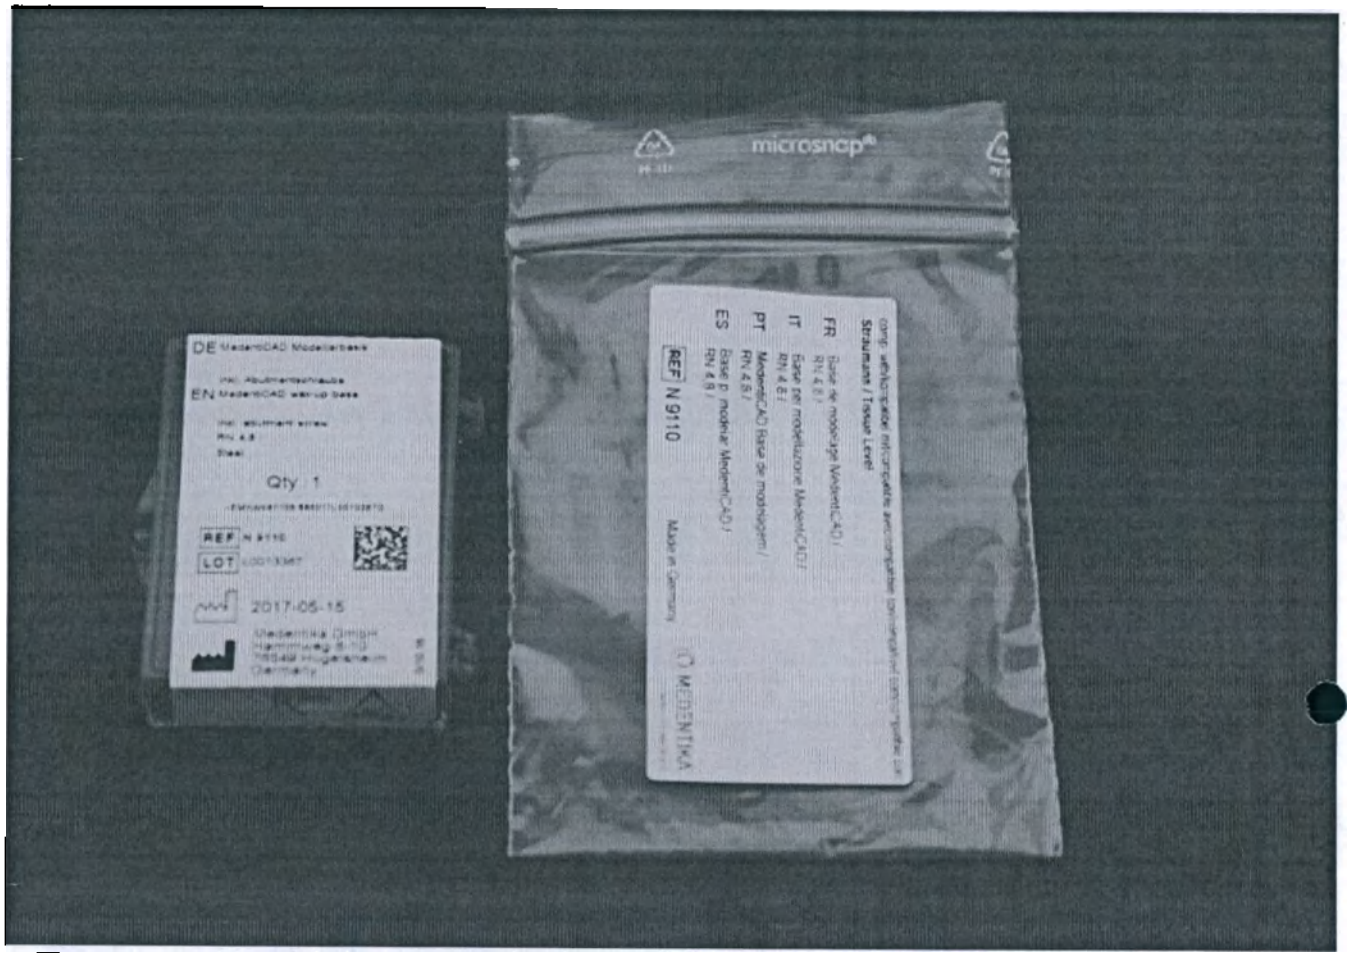

Первичная упаковка (пластиковая коробка) и вторичная упаковка (пластиковый пакет)

Финальная упаковка продукта (лицевая сторона)

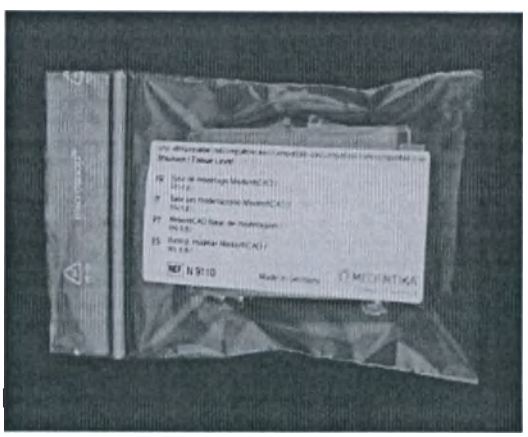

Финальная упаковка продукта (тыльная сторона)

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6.3 Вариант (III)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковая трубка (первичная упаковка)	D 9 мм x L 45 мм	Поливинилхлорид (ПВХ)	9002-86-2	Прозрачный
Пластиковая крышка (первичная упаковка)	D 9 мм	Полипропилен натуральный (ПП натуральный)	9003-07-0	Светло-белый
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	100 x 70 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

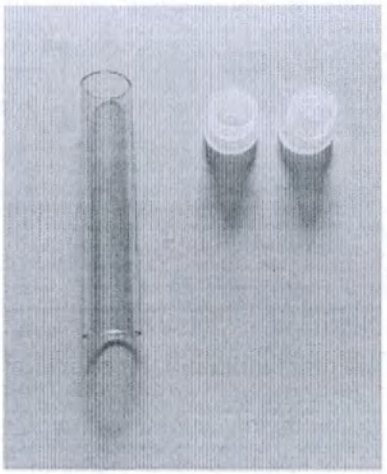

Пластиковая трубка (D 9 мм x L 45 мм) + две пластиковых крышки (D 9 мм)

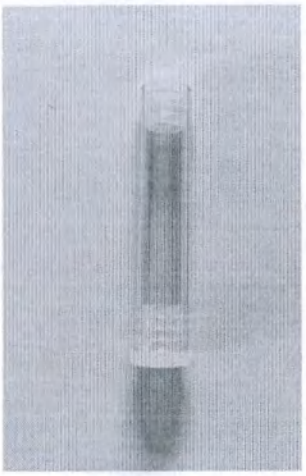

Пластиковая трубка (D 9 мм x L 45 мм) с монтированными крышками (D 9 мм)

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; лицевая сторона)

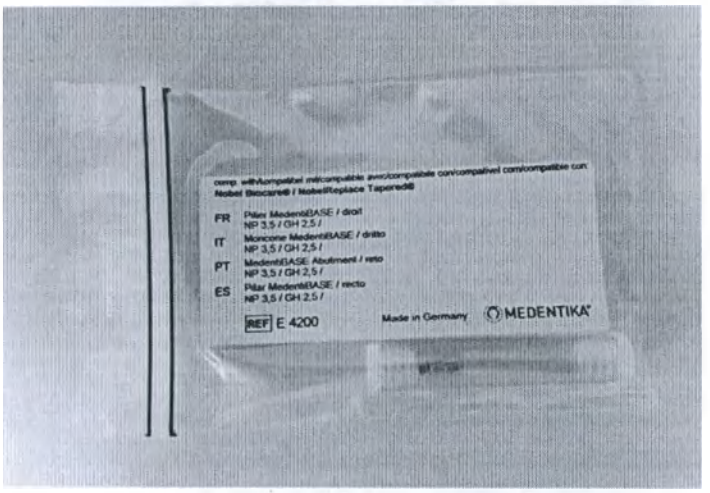

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Перечень указан в Таблицах 6 и 7.

6.4 Вариант (IV)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковая трубка (первичная упаковка)	D 18 мм x L 35 мм	Поливинилхлорид (ПВХ)	9002-86-2	Прозрачный
Пластиковая крышка (первичная упаковка)	D 18 мм	Полипропилен натуральный (ПП натуральный)	9003-07-0	Светло-белый
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	100 x 70 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

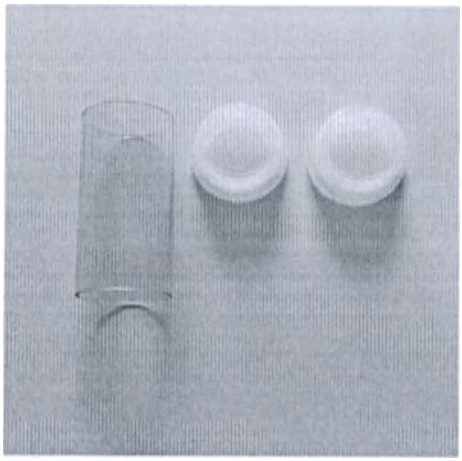

Пластиковая трубка (D 18 мм x L 35 мм) + две пластиковых крышки (D 18 мм)

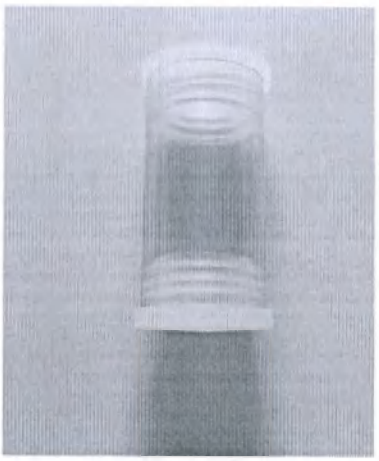

Пластиковая трубка (D 18 мм x L 35 мм) с монтированными крышками (D 18 мм)

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; лицевая сторона)

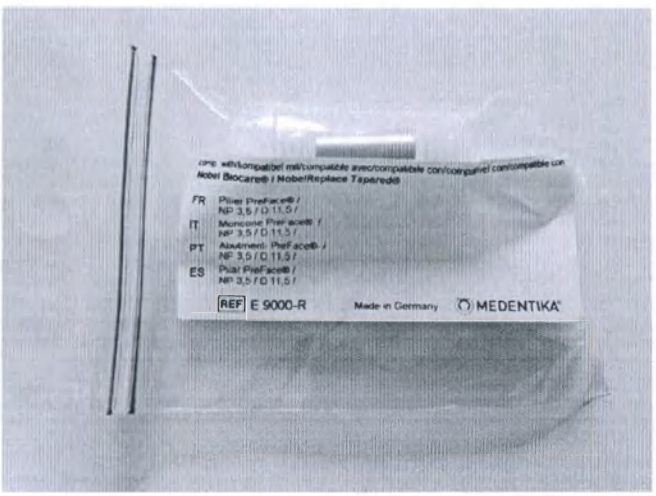

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Абатмент PreFace, включая винт абатмента.

6.5 Вариант (V)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковый чемоданчик (первичная упаковка)	L 123 мм x B 115 мм x H 25 мм	Поливинилхлорид (ПВХ)	9002-86-2	Белый
Вкладыш поролоновый для размещения продукции (первичная упаковка)	L 117 мм x B 34 мм x H 10 мм	Пенополиуретан (ППУ)	9009-54-5	Чёрный
Вкладыш поролоновый для уплотнения продукции (первичная упаковка)	L 117 мм x B 89 мм x H 10 мм	Пенополиуретан (ППУ)	9009-54-5	Чёрный
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	150 мм x 220 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

Пластиковый чемоданчик (вид сверху)

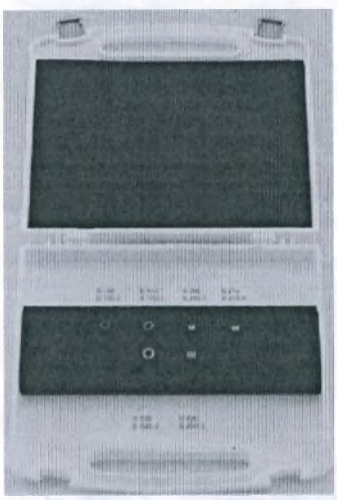

Пластиковый чемоданчик с вкладышами (в открытом виде)

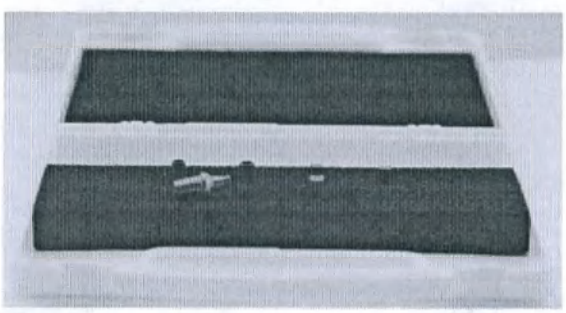

Вкладыш поролоновый для размещения изделий

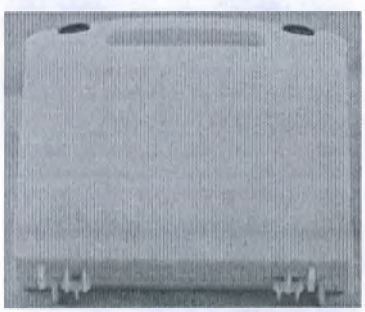

Пластиковый чемоданчик (вид снизу)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; лицевая сторона)

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; тыльная сторона)

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Набор абатментов для планирования.

6.6 Вариант (VI)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковый пакет	70 мм x 100 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный
Пластиковый пакет	100 мм x 150 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

Пластиковый пакет с ключом шестигранным

Финальная упаковка (лицевая сторона)

Финальная упаковка (тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный.

6.7 Вариант (VII)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковый пакет	70 мм x 100 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный

Спецификация упаковки

Упаковка продукта лицевая сторона

Упаковка продукта тыльная сторона

или

Пластиковый пакет пустой

Финальная упаковка (лицевая сторона)

Финальная упаковка (тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Перечень указан в Таблицах 6 и 7.

6.8 Вариант (VIII)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	Цвет
Блистер	86 мм x 60 мм x 9,4 мм	Полиэтилентерефталатгликоль марки MEDPETG 6763 Medical Standard производства «MEDIPACK AG», Швейцария; тайвек 1073B производства «Dupont», США	Красный или бесцветный

Спецификация упаковки

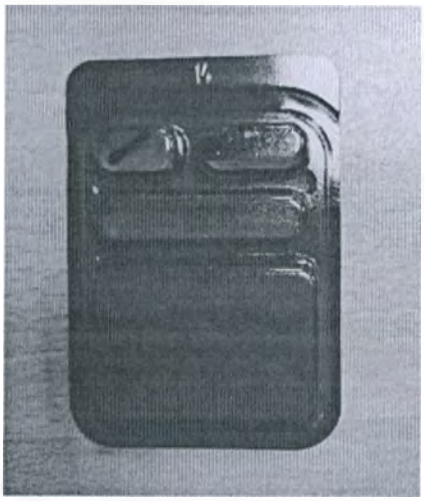

Вид сзади

Вид спереди

Или

Вид сзади

Вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Перечень указан в Таблицах 6 и 7.

6.9 Вариант (IX)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	Цвет
Блистер	86 мм х 60 мм х 17,4 мм	Полиэтилентерефталатгликоль марки MEDPETG 6763 Medical Standard производства «MEDIPACK AG», Швейцария; тайвек 1073B производства «Dupont», США	Красный или бесцветный

Спецификация упаковки

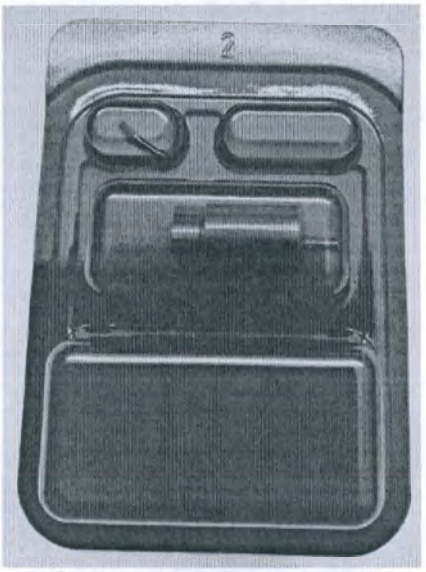

Вид сзади

Вид спереди

Или

Вид сзади

Вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Перечень указан в Таблице 6.

6.10 Вариант (X)

Спецификация упаковочного материала

	Размер	Материал	CAS-№	Цвет
Пластиковая туба (первичная упаковка)	42 x 13 мм	Поливинилхлорид (ПВХ)	9002-86-2	Прозрачный
Пластиковая крышка (первичная упаковка)	8 x 13 мм	Полипропилен натуральный (ПП натуральный)	9003-07-0	Светло-белый
Пластиковый пакет (вторичная упаковка)	146 x 75 мм	Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)	9002-88-4	Прозрачный и белый

Спецификация упаковки

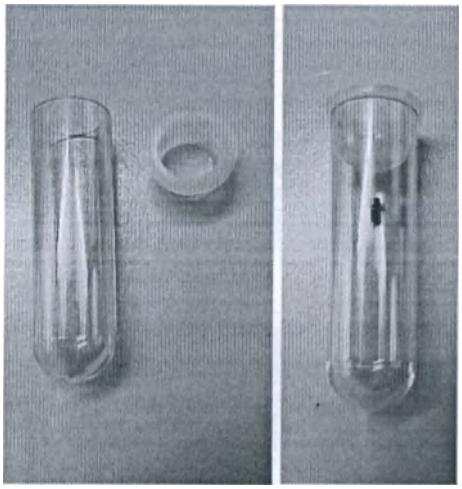
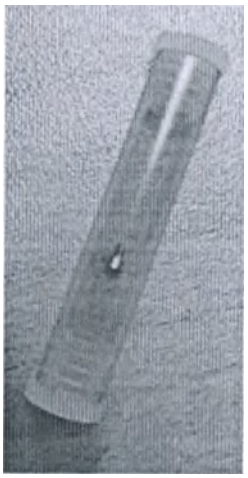

или

Пластиковая туба с пластиковой крышкой

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; лицевая сторона)

Финальная упаковка продукта (первичная + вторичная упаковка; тыльная сторона)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перечень артикулов, относящихся к этому варианту упаковки:
Перечень указан в Таблицах 6 и 7.

Перечень продукции с соответствующим вариантом упаковки

Таблица 6. Упаковка абатментов, колпачков и оснований

№ согласно перечню	Наименование продукции	Изображение	Вариант упаковки
1.1-1.5	Абатмент стандартный прямой/угловой, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
1.6-1.9	Абатмент модифицируемый прямой/угловой, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
1.10	Абатмент MedentiBASE прямой		Вариант (III) или (VIII)
1.11-1.13	Абатмент MedentiLOC прямой/угловой, включая винт углового абатмента MedentiLOC		Вариант (I) или (VIII)
1.14-1.17	Абатмент Novaloc/Optiloc прямой/угловой, включая винт углового абатмента Novaloc		Вариант (I) или (VIII)
1.18	Абатмент POC, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
1.19-1.20	Абатмент кобальт-хромовый приливаемый антиротационный/ротационный, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
1.21	Абатмент PreFace, включая винт абатмента		Вариант (IV) или (IX)
1.22	Абатмент MedentiCAD, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
1.23-1.26	Абатмент временный угловой/прямой/ротационный, включая винт абатмента		Вариант (III) или (VIII)
2.1-2.2	Винт углового абатмента MedentiLOC/ Novaloc		Вариант (VII)
2.3	Винт абатмента		Вариант (VII)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.4-2.5	Винт абатмента MedentiBASE/Multi-unit		Вариант (III) или (X)
2.6-2.7	Винт-заглушка MedentiBASE/Multi-unit		Вариант (III) или (VIII)
2.8-2.10	Винт-патрица MedentiLOC/Novaloc/Optiloc		Вариант (III) или (VIII)
3.1-3.2	Колпачок MedentiBASE/Multi-unit титановый, включая винт абатмента MedentiBASE/Multi-unit		Вариант (III) или (VIII)
3.3-3.4	Колпачок MedentiBASE титановый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт абатмента MedentiBASE		Вариант (III) или (VIII)
3.5	Колпачок кобальт-хромовый Multi-unit, включая винт абатмента Multi-unit		Вариант (III) или (VIII)
3.6	Колпачок позиционирующий для трансферов слепочных		Вариант (III) или (VIII)
3.7	Колпачок MedentiBASE пластиковый, включая винт для моделирования		Вариант (III) или (VIII)
3.8-3.9	Колпачок MedentiBASE пластиковый вклеиваемый, короткий/длинный, включая винт для моделирования		Вариант (III) или (VIII)
3.10	Колпачок Multi-unit пластиковый		Вариант (III) или (VIII)
3.11	Колпачок трансфера слепочного индивидуального		Вариант (III) или (VIII)
4.1-4.2	Основание титановое/Основание титановое для мостовидных протезов, включая винт абатмента		Вариант (I) или (VIII)
4.3-4.4	Основание MedentiBASE/Multi-unit титановое, включая винт абатмента MedentiBASE/Multi-unit		Вариант (III) или (VIII)
4.5	Основание MedentiCAD для моделирования, включая винт абатмента		Вариант (II) или (IX)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 7. Упаковка принадлежностей

№ согласно перечню	Наименование продукции	Изображение	Вариант упаковки (согласно п. 15.1)
1.1-1.3	Абатмент для планирования прямой/угловой		Вариант (III) или (X)
1.4-1.15	Набор абатментов для планирования		Вариант (V)
2.1	Абатмент для сканирования, включая винт для фиксации		Вариант (III) или (VIII)
2.2-2.4	Абатмент для сканирования MedentiBASE/Multi-unit (угловой), включая винт абатмента MedentiBASE/Multi-unit		Вариант (III) или (VIII)
3.1	Трансфер слепочный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий		Вариант (III) или (VIII)
3.2	Трансфер слепочный индивидуальный для закрытой ложки, включая винт абатмента и колпачок позиционирующий		Вариант (III) или (VIII)
3.3-3.4	Трансфер слепочный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации		Вариант (III) или (VIII)
3.5-3.6	Трансфер слепочный индивидуальный короткий/длинный для открытой ложки, включая винт для фиксации		Вариант (III) или (VIII)
3.7	Трансфер MedentiBASE слепочный прямой, включая винт для фиксации		Вариант (III) или (VIII)
3.8	Трансфер Multi-unit слепочный, включая винт для фиксации		Вариант (III) или (VIII)
4.1-4.4	Аналог лабораторный прямого/углового абатмента MedentiLOC/Novaloc		Вариант (VII)
4.5	Аналог лабораторный прямого абатмента MedentiBASE		Вариант (VII)
4.6-4.8	Аналог лабораторный /углового 17°/30°/ абатмента Multi-unit		Вариант (VII)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.9	Аналог лабораторный абатмента MedentiBASE CADCAM		Вариант (VII)
4.10-4.12	Аналог лабораторный /углового 17°/30°/ абатмента Multi-unit CADCAM		Вариант (VII)
4.13	Аналог лабораторный CADCAM		Вариант (VII)
4.14	Аналог лабораторный абатмента модифицируемого		Вариант (VII)
4.15	Аналог лабораторный имплантата		Вариант (VII)
5.	Винт лабораторный		Вариант (VII)
6.	Винт для фиксации трансфера слепочного для открытой ложки		Вариант (III) или (VII)
7.	Держатель протезных конструкций, включая ключ шестигранный		Вариант (VI)
8.	Насадка для держателей протезных конструкций		Вариант (VII)
9.-10.	Развёртка MedentiBASE для геометрии разъёма/для шляпки винта		Вариант (III) или (VII)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Изделия хранятся на складе готовой продукции в первичной упаковке. Для осуществления пересылки они забираются оттуда и складываются транспортные короба. Размер коробки со съёмной крышкой выбирается в соответствии с количеством отсылающихся продуктов. Коробка выкладывается поролоновыми вкладышами сверху и снизу, а также свободное пространство между продуктами заполняется упаковочными чипсами. В заключение всё накрывается воздушно-пузырчатой упаковочной плёнкой, упаковка закрывается и заклеивается упаковочным скотчем. Коробки транспортируют автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом.

Упакованное медицинское изделие (абатмент, винт, колпачок, основание и принадлежности) может быть размещено на складе при температуре от +5 до +40˚С, относительной влажности не более 89 % (при t = +25˚С) в течение неограниченного времени, так как оно является устойчивым к ожидаемым температурам и влажности воздуха.

Срок годности не ограничен.

8. СТЕРИЛЬНОСТЬ.

Все медицинские изделия, указанные в данной инструкции, являются **СТЕРИЛИЗУЕМЫМИ** и поставляются **НЕСТЕРИЛЬНЫМИ**.

После проведения действий предстерилизационной очистки рекомендуется стерилизация подлежащих стерилизации медицинских изделий методом автоклавирования:

1. Следует герметично упаковать в подходящую фольгу для стерилизации в автоклаве.
2. Паровая стерилизация:

   А) Предвакуумное разделение на 3 фракции

   Б) Температура: 132 °С (270 °F)

   В) Длительность: 4 минуты

   Г) Время высыхания: 20 минут

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ.

По окончанию срока службы изделия должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. По классу опасности отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания изделия относятся к классу А (ТБО). Специальных требований к утилизации изделия не имеют.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Настоящая гарантия предоставляется только в пользу лечащего врача/стоматолога (далее по тексту «Потребитель»). Программа предусматривает бесплатную замену продукции, однако не предполагает возмещения сопутствующих расходов, в том числе, но не исключительно расходов на проведение необходимого лечения.

Подробные условия гарантии опубликованы на сайте https://www.straumann.com/ в разделе бренда «МЕДЕНТиКА»

11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия не применимы, так как медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

11.1 Сервисное обслуживание.

Медицинское изделие также не подлежит и сервисному обслуживанию.

12 РЕКЛАМАЦИЯ.

Свои рекламации просим Вас присылать нашему уполномоченному представителю в Российской Федерации:

ООО «Штрауманн»
119571, Россия
Москва
Ленинский проспект, 119А
Тел.: +7 495 139-74-74
reginfo@straumann.com

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод с немецкого языка на русский язык.

Нотариальный реестр UVZ 3074 / 2022

Настоящим я официально удостоверяю вышестоящую подпись,

поставленную в моем присутствии

г-ном Георгом Крэлингом (Georg Krahling),

03.03.1960 года рождения,

со служебным адресом: 76549 Хюгельсхайм, Хаммвег, 8-10 (Hammweg 8-10 in 76549 Hügelsheim), личность которого установлена нотариусом.

Вышестоящий текст составлен на иностранном языке. Удостоверяющий нотариус не владеет данным языком и вследствие этого не может дать правовую оценку содержанию документа.

г. Гернсбах, 22.12.2022 г.

<подписано>

Нотариус д-р Кевин Коше (Kevin Kosche)

<Печать: Д-Р КЕВИН КОШЕ * НОТАРИУС В Г. ГЕРНСБАХЕ *>

<Рельефная печать: Д-Р КЕВИН КОШЕ * НОТАРИУС В Г. ГЕРНСБАХЕ *>

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Перевод данного текста выполнен переводчиком Котляровым Антоном Игоревичем.

_____

Российская Федерация

Город Москва
Десятого февраля две тысячи двадцать третьего года
Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика, Котлярова Антона Игоревича.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2023-9-2780
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

В. К. Корсик

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 19 лист(а)(ов)

Нотариус

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU