



Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 1, Комплектация 1

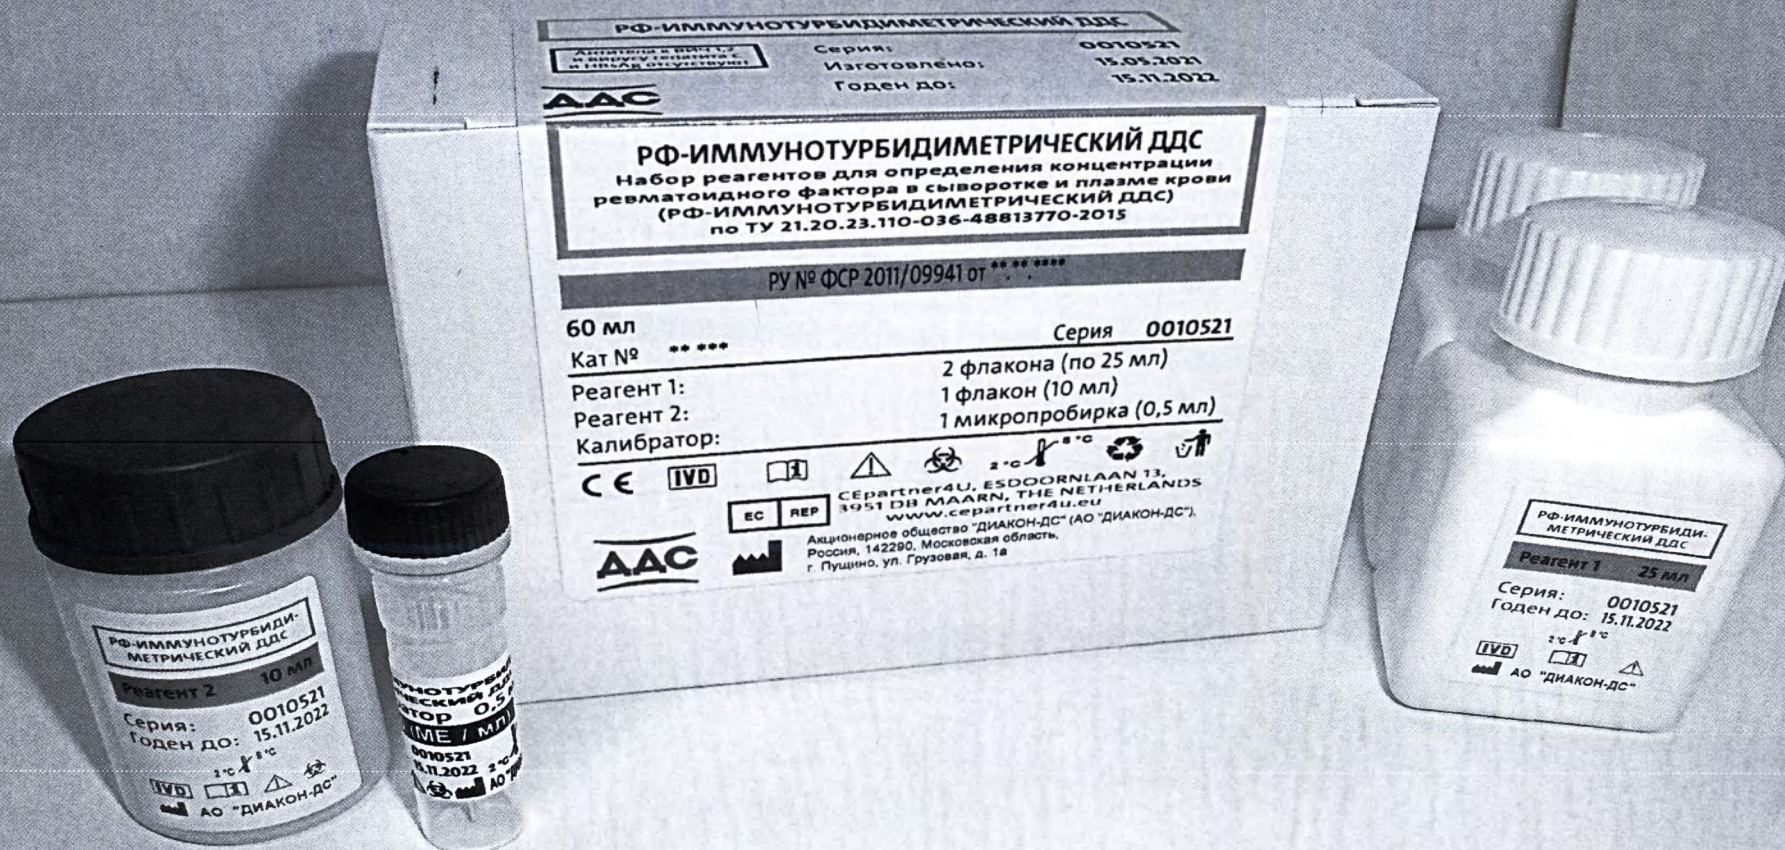


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 1, Комплектация 2

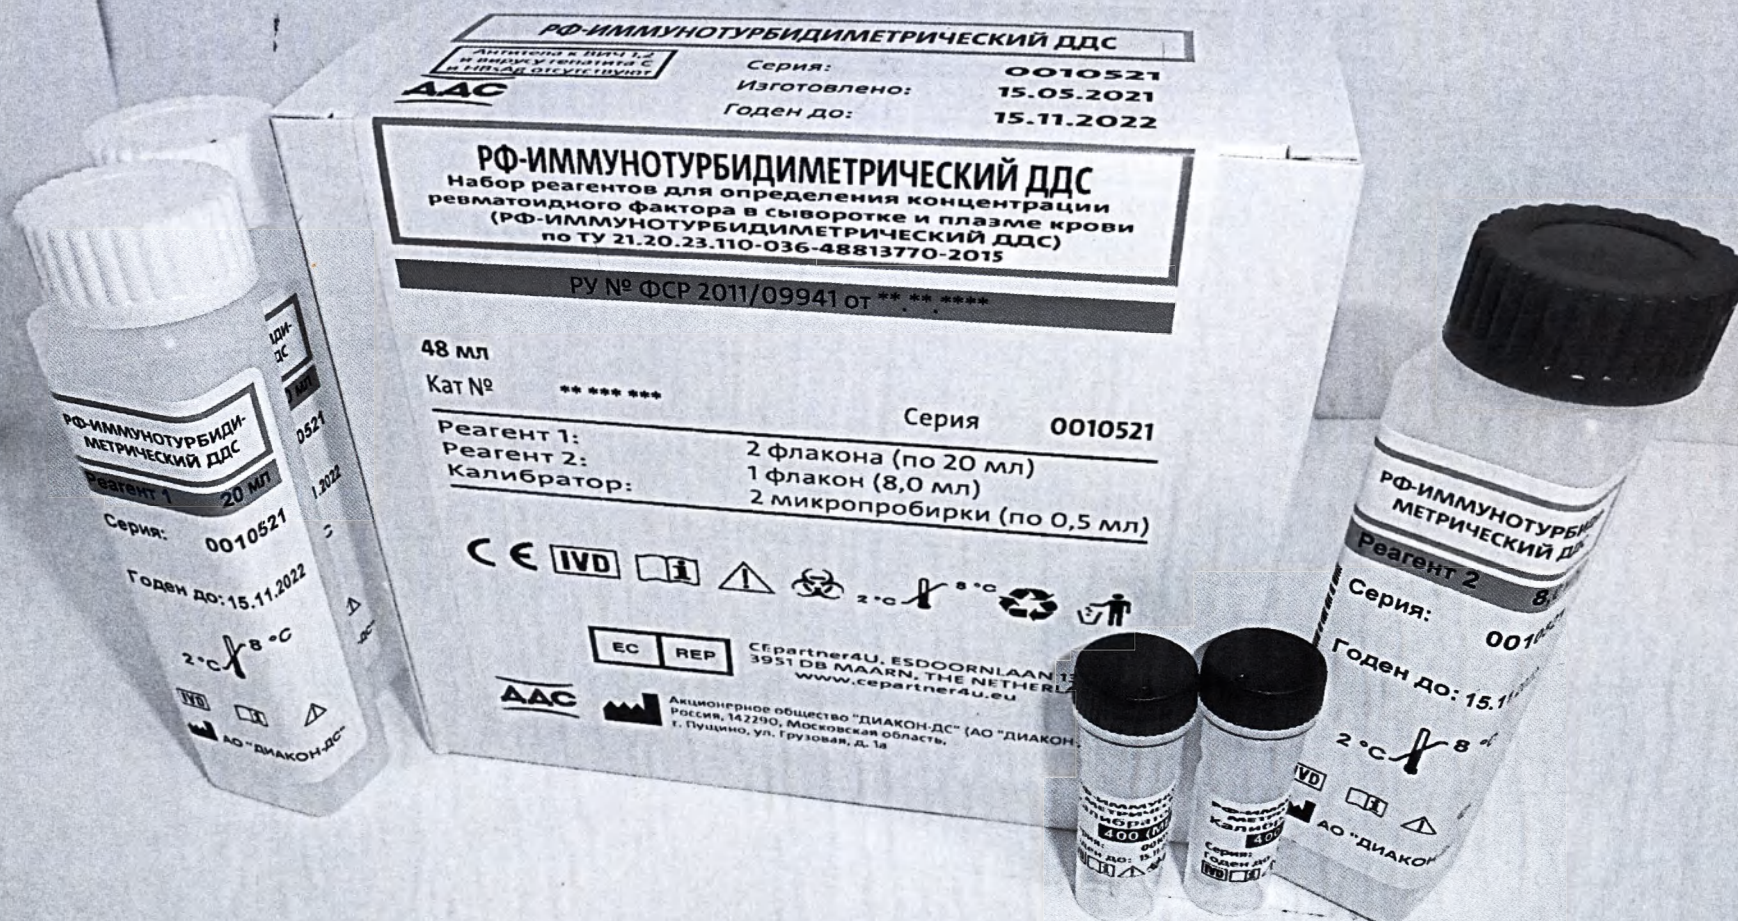


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 1, Комплектация 3

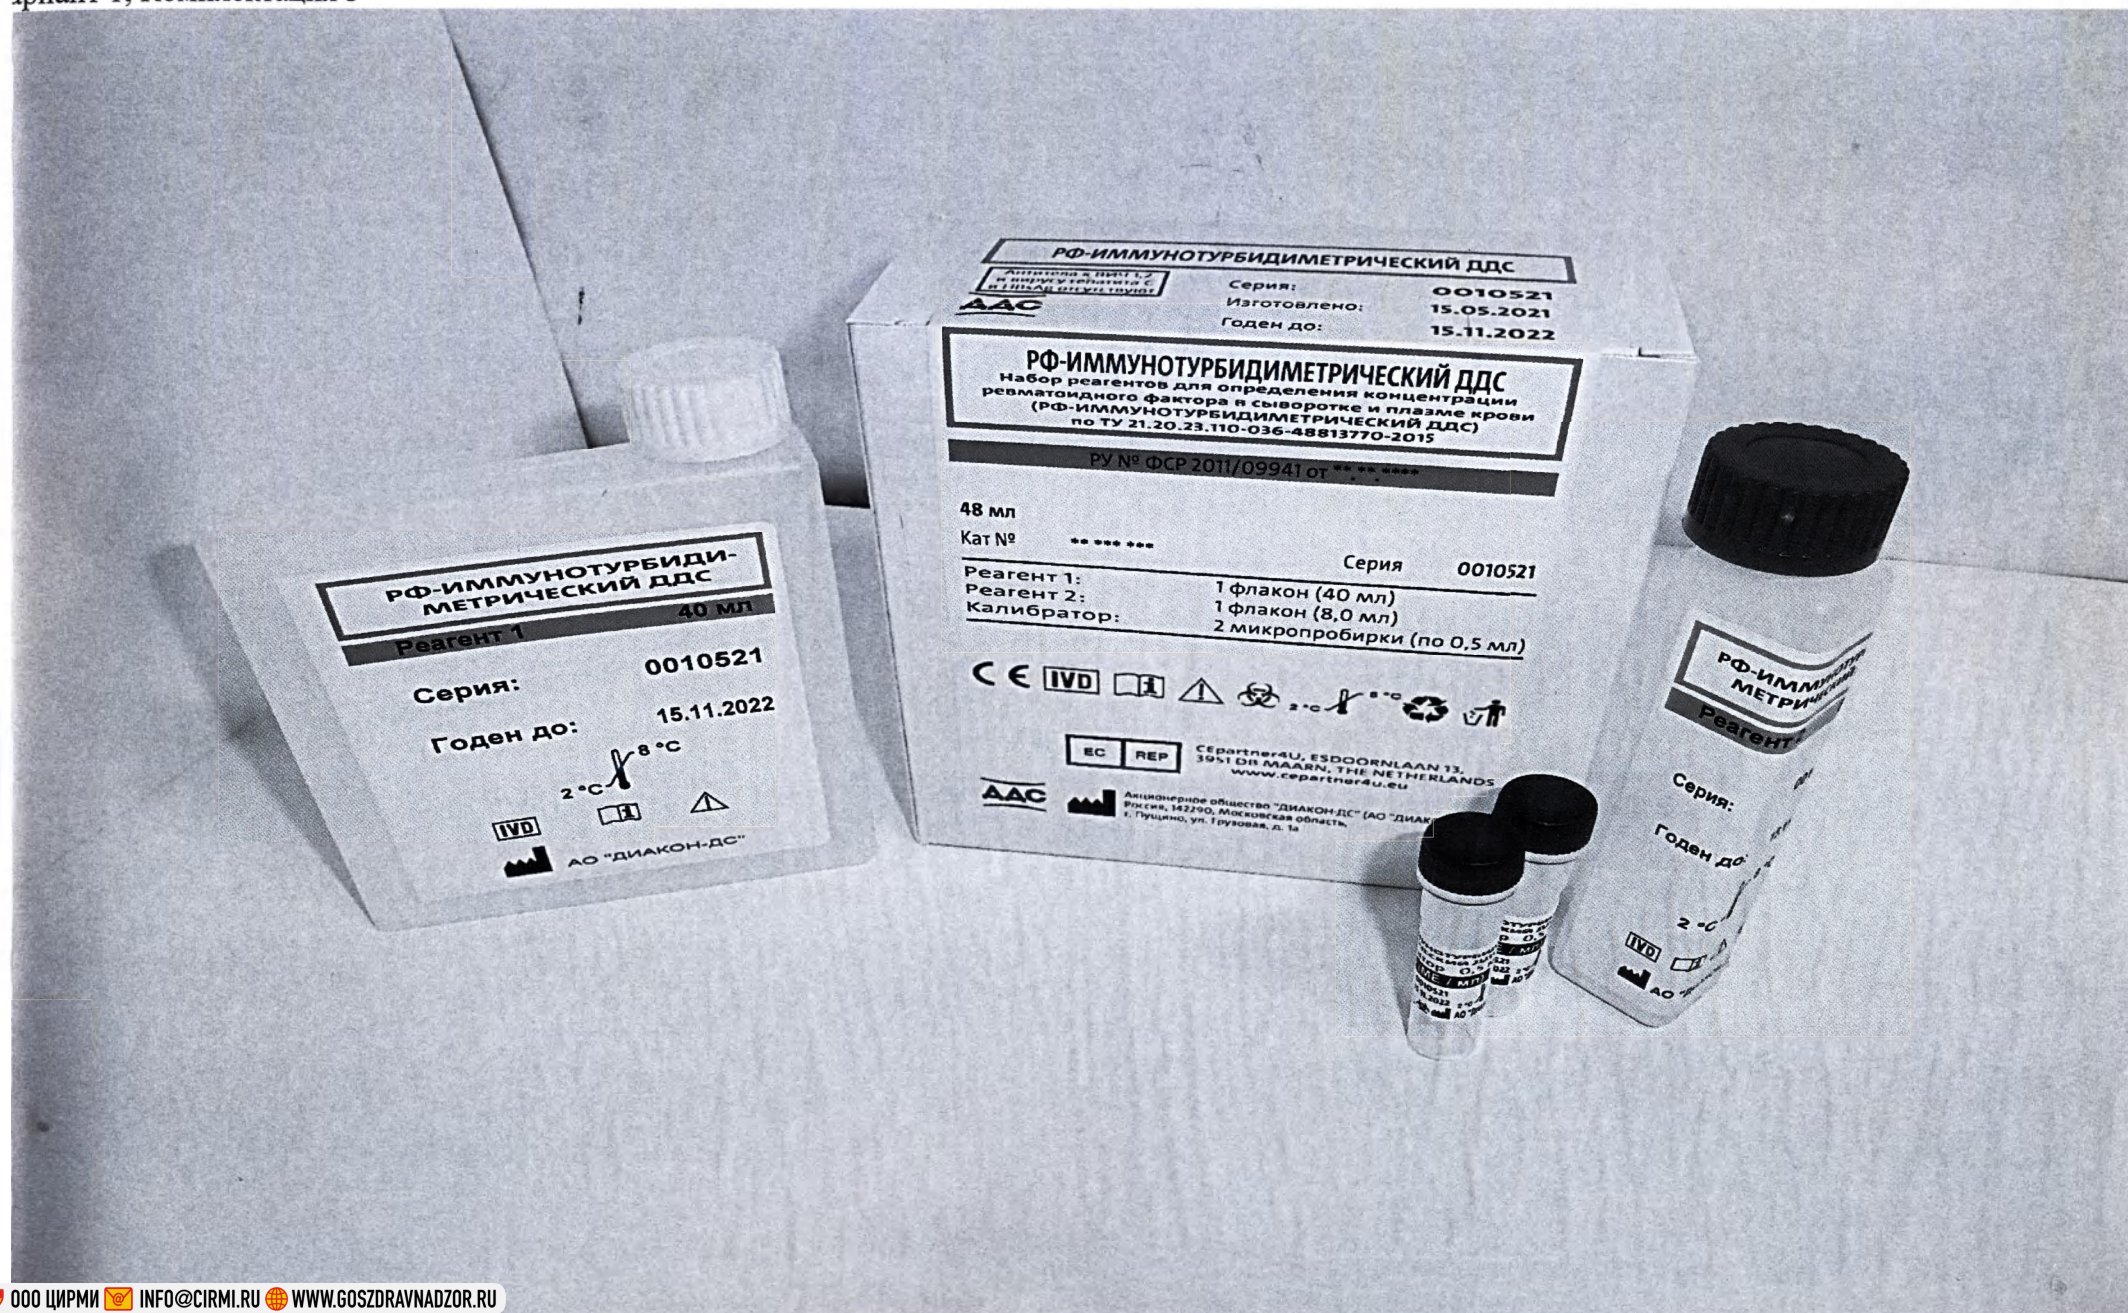


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 1, Комплектация 4

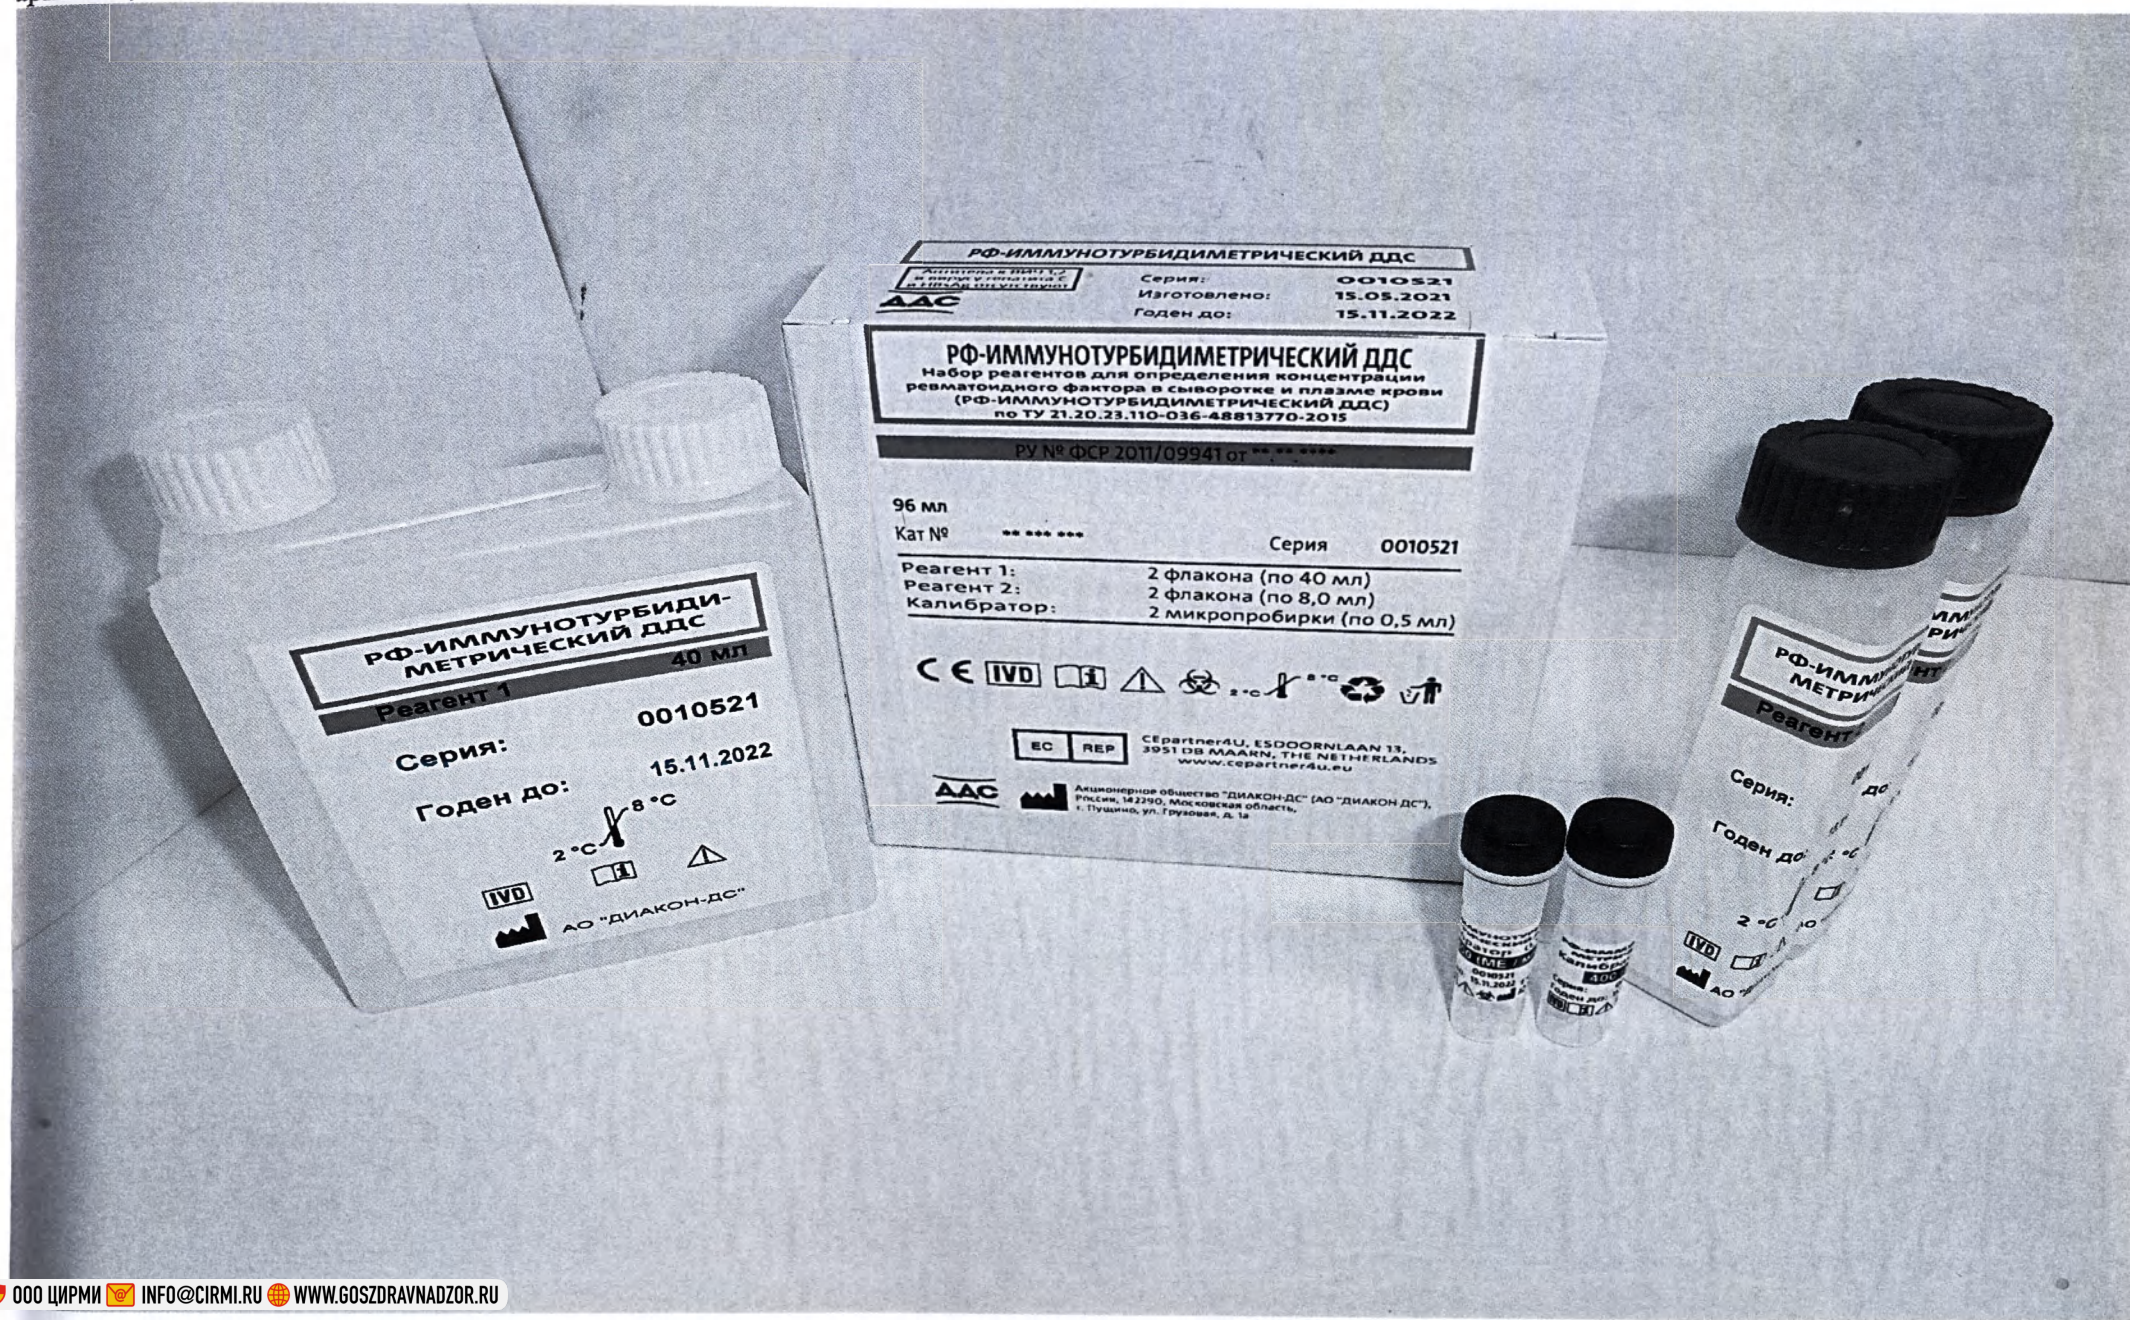

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 1, Комплектация 5

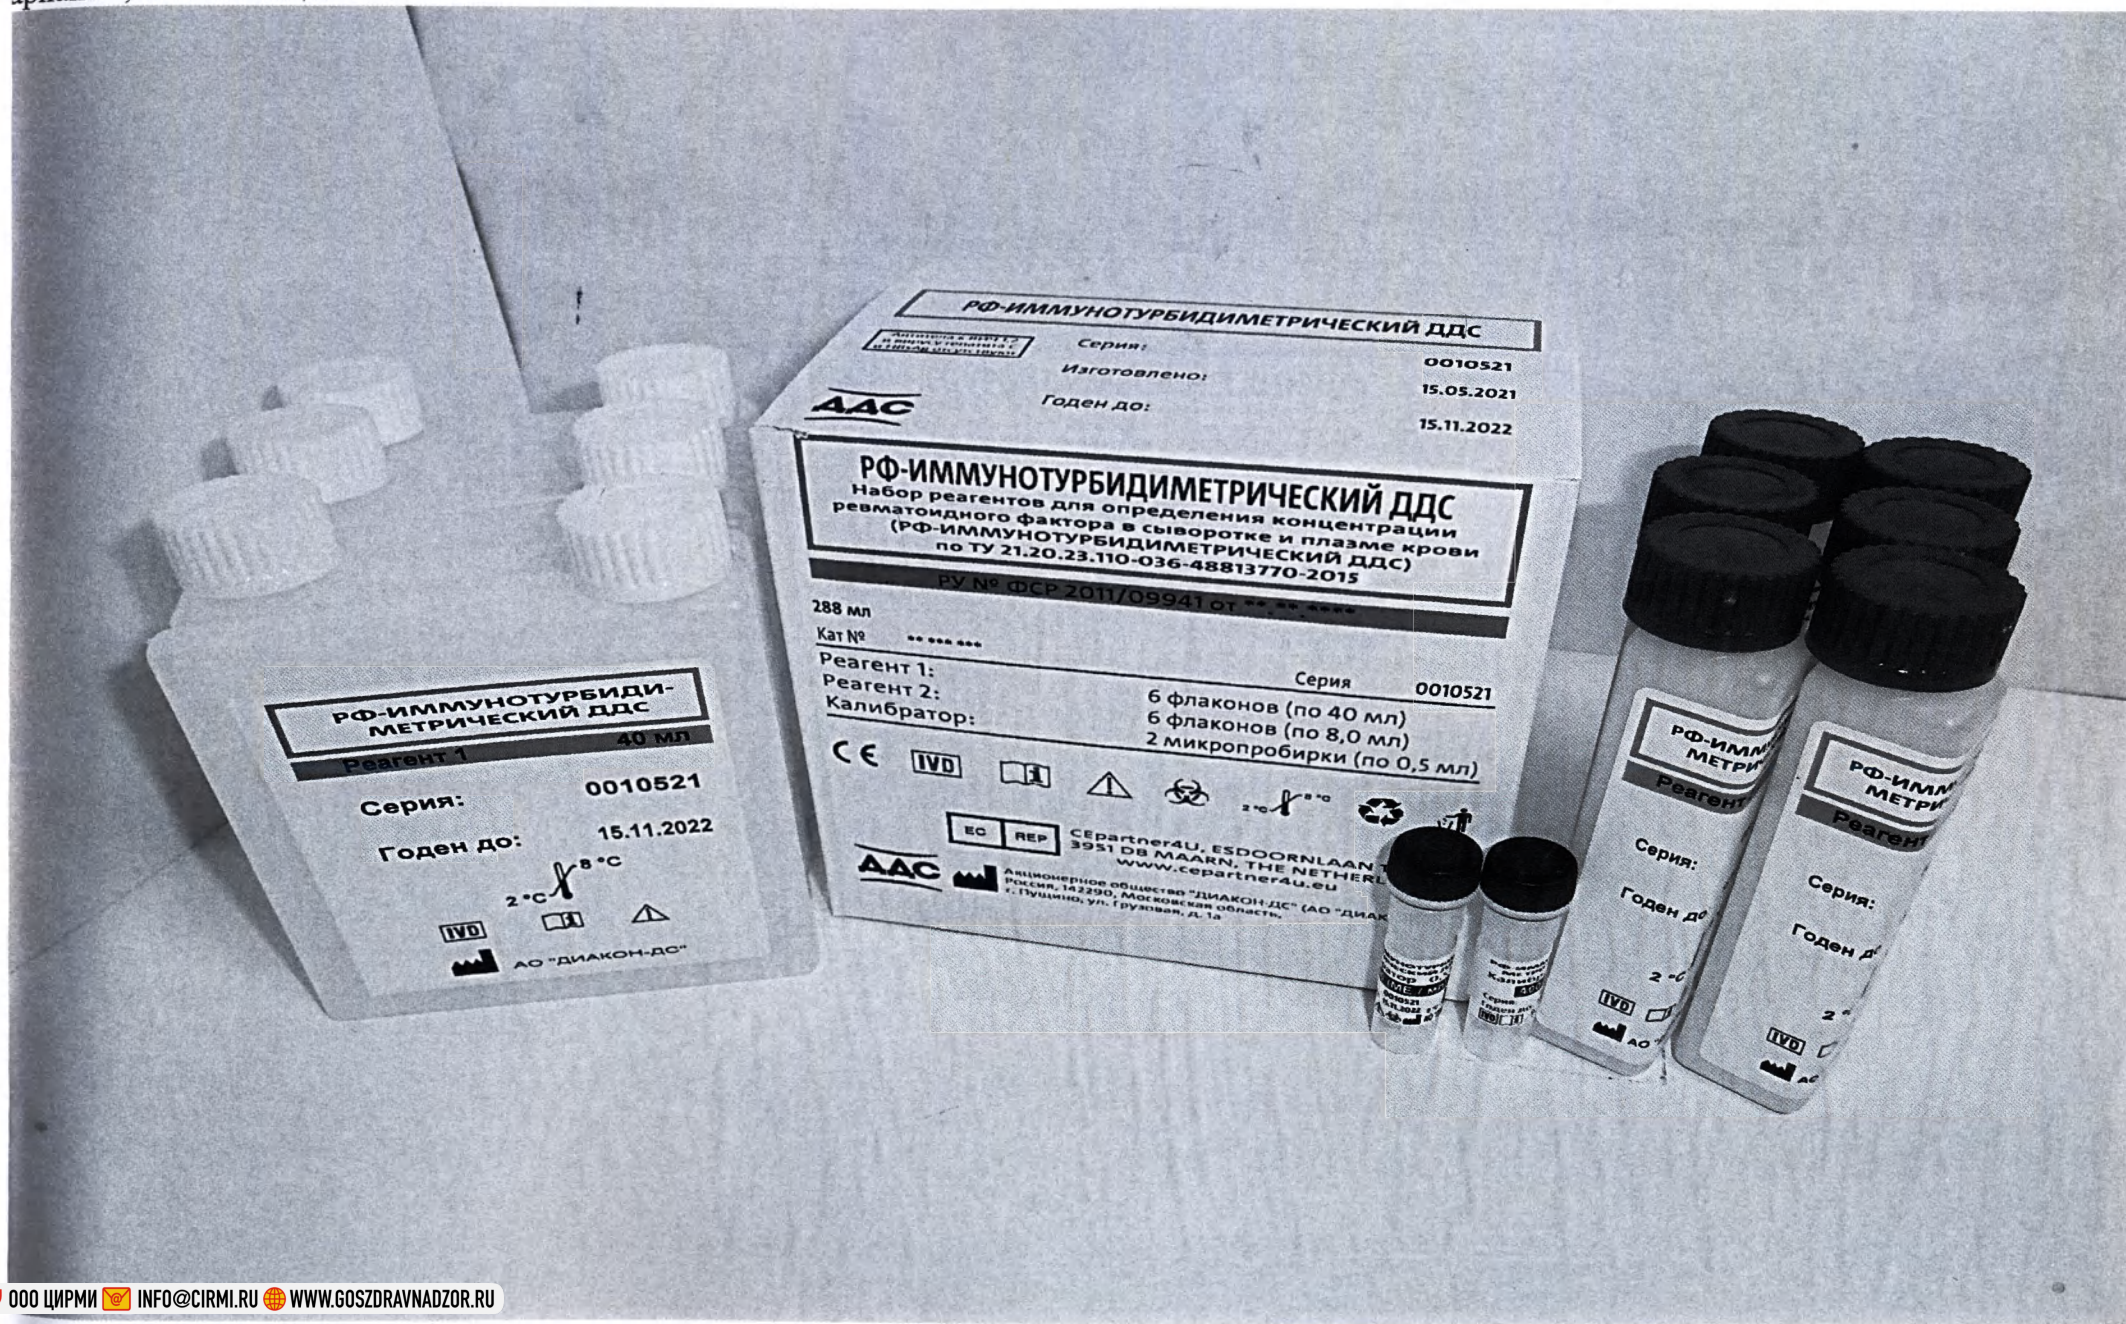

**Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015**

РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HbS-Ag отсутствуют
 AAC
 Серия: 0010521
 Изготовлено: 15.05.2021
 Годен до: 15.11.2022

РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови (РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС) по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/09941 от ** ** *

103 мл
 Кат № ** ** *
 Серия 0010521

Реагент 1:	5 флаконов (по 17 мл)
Реагент 2:	1 флакон (18 мл)
Калибратор:	2 микропробирки (по 0,5 мл)

CE IVD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EC REP
 CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 3951 DB MAARN, THE NETHERLANDS
 www.cepartner4u.eu

AAC
 Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"), Россия, 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а


РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Реагент 1
 Серия: 0010521
 Годен до: 15.11.2022
 2°C
 IVD
 АО "ДИАКОН-ДС"

РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
 Реагент 2
 Серия: 0010521
 Годен до: 15.11.2022
 2°C
 IVD
 АО "ДИАКОН-ДС"

Калибратор
 Серия: 0010521
 Годен до: 15.11.2022
 2°C
 IVD
 АО "ДИАКОН-ДС"


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 1, Комплектация 7

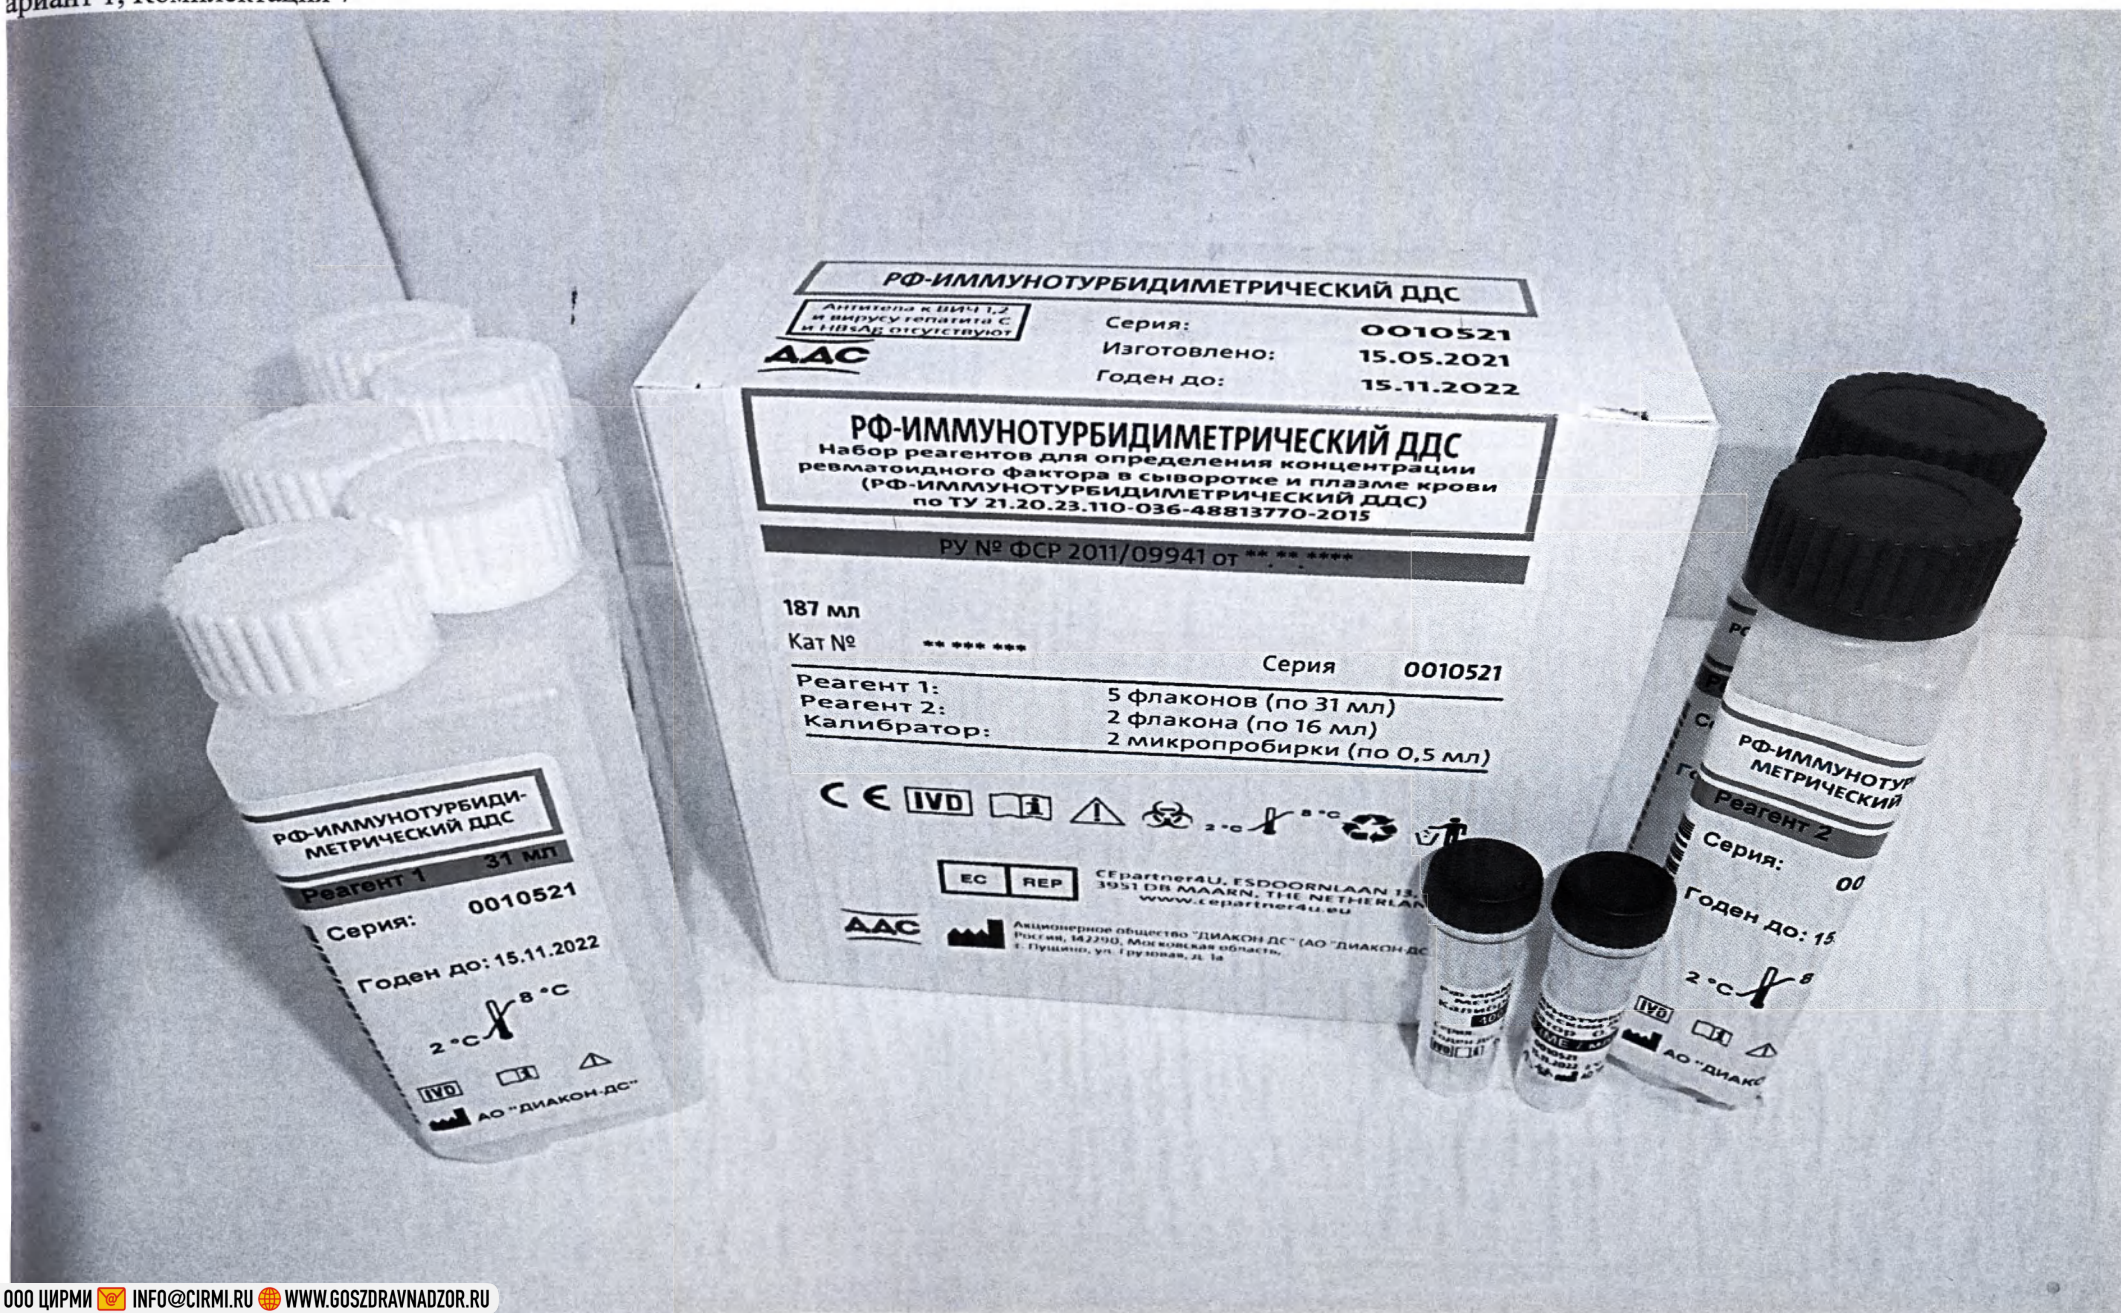


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 2, Комплектация 1

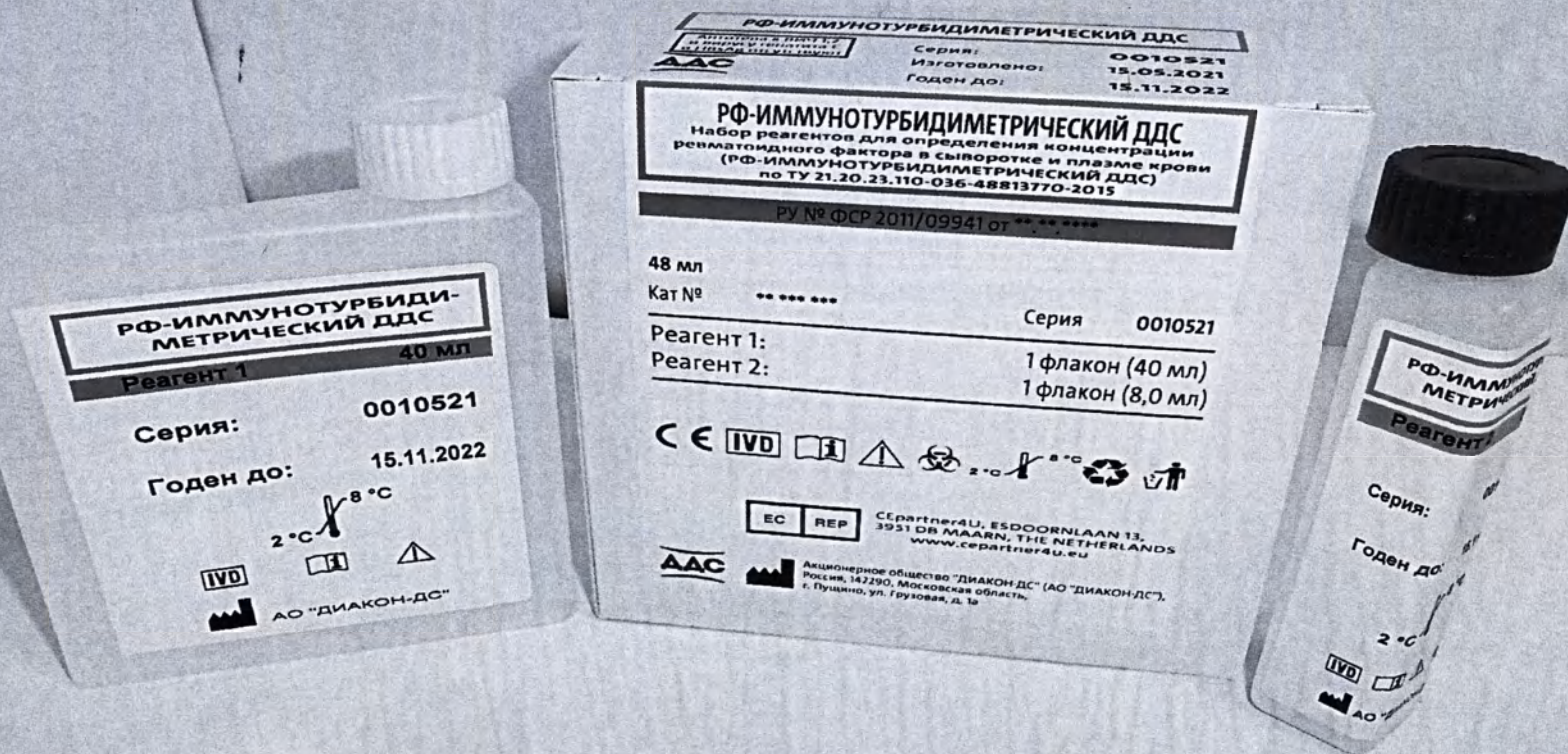


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 2, Комплектация 2

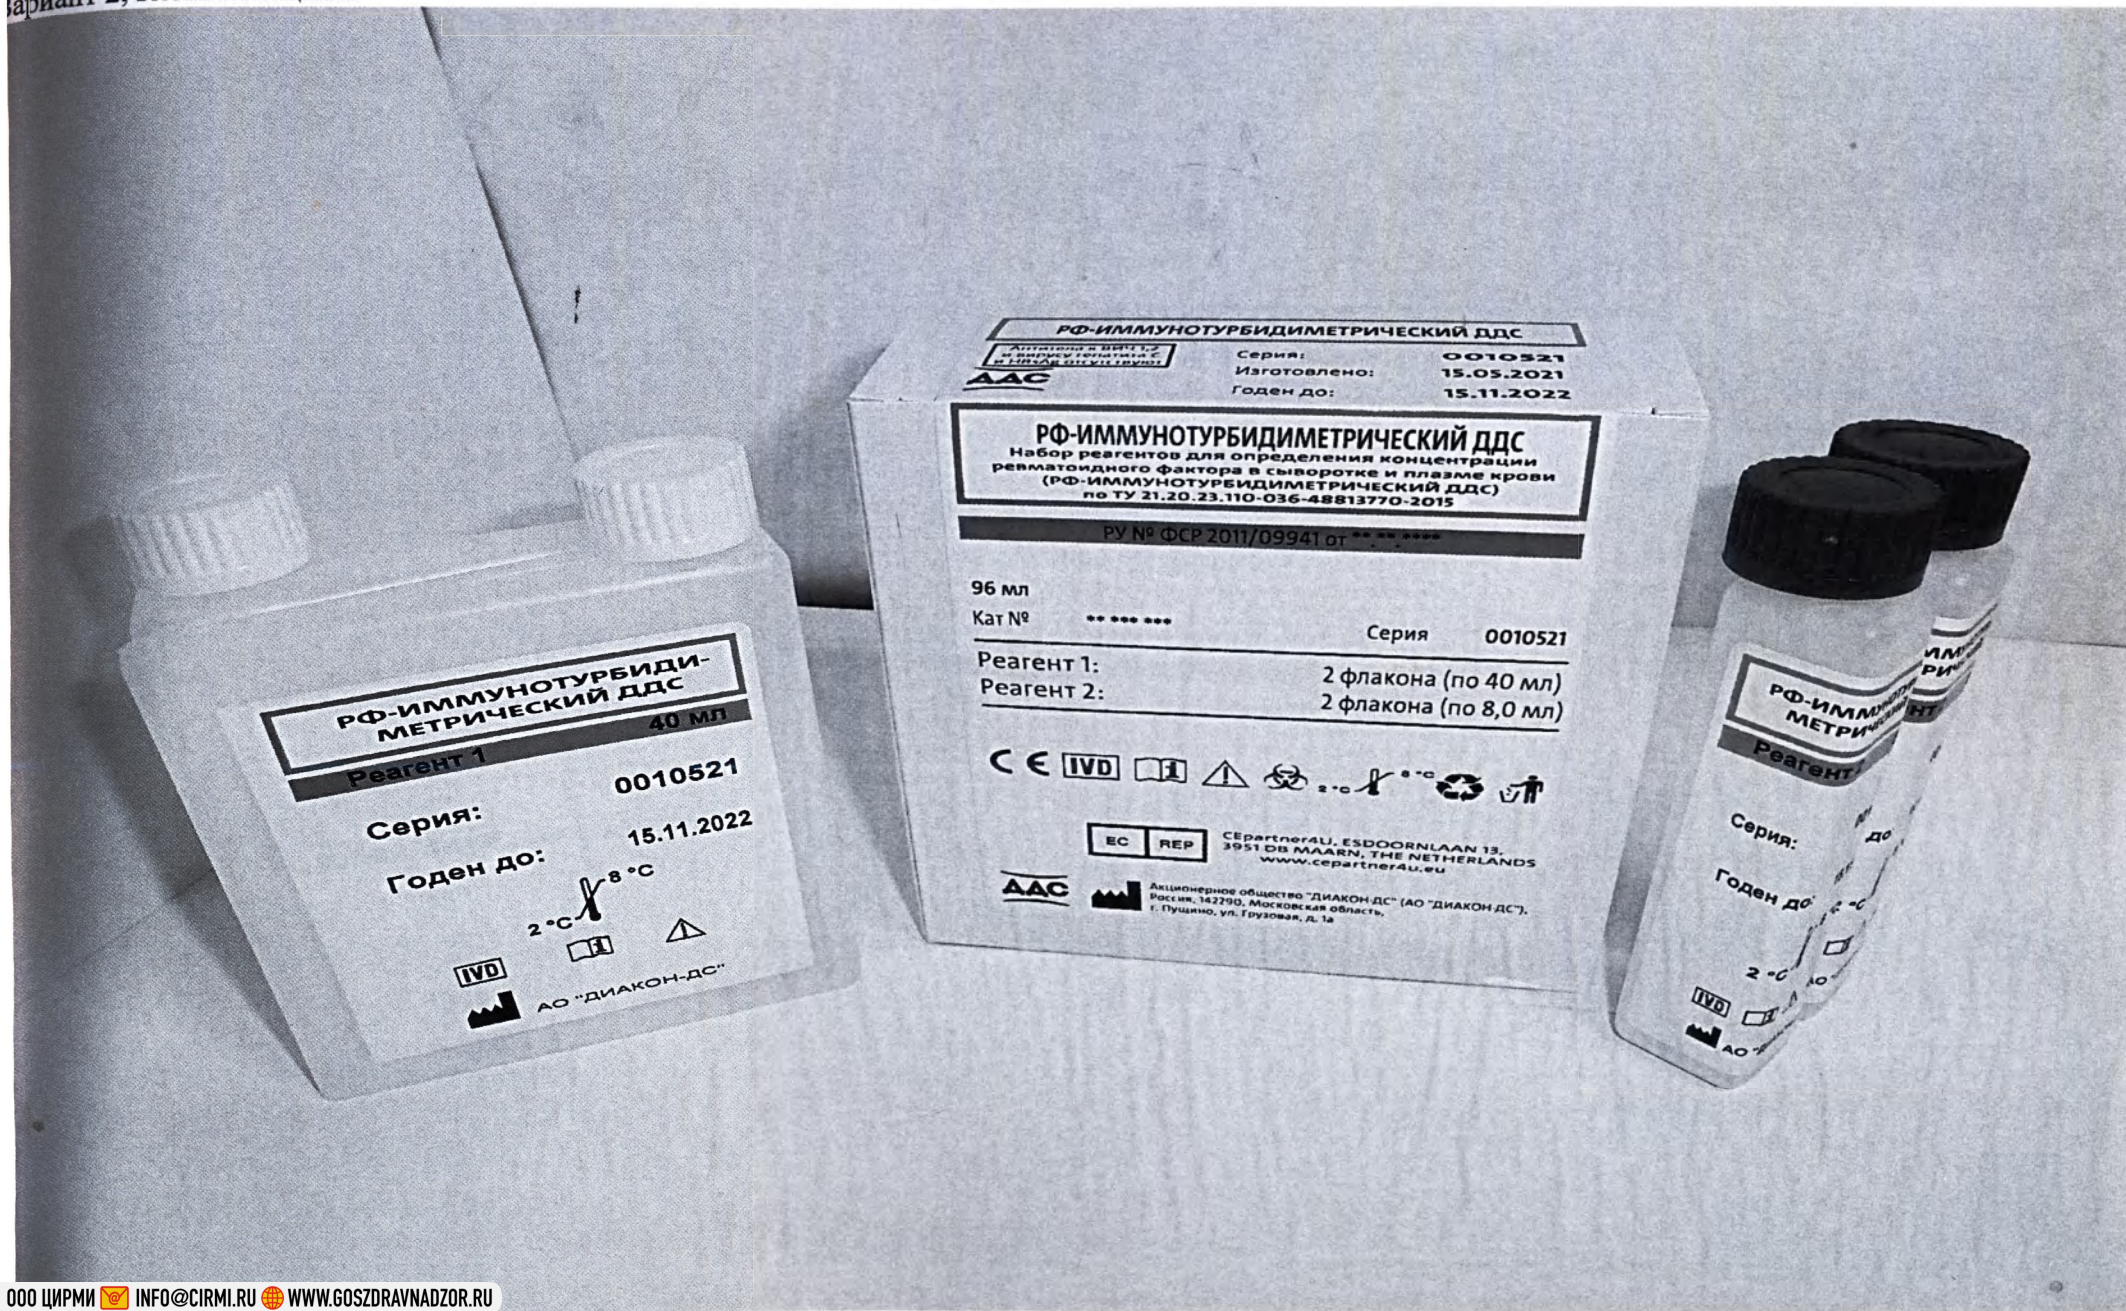


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 3

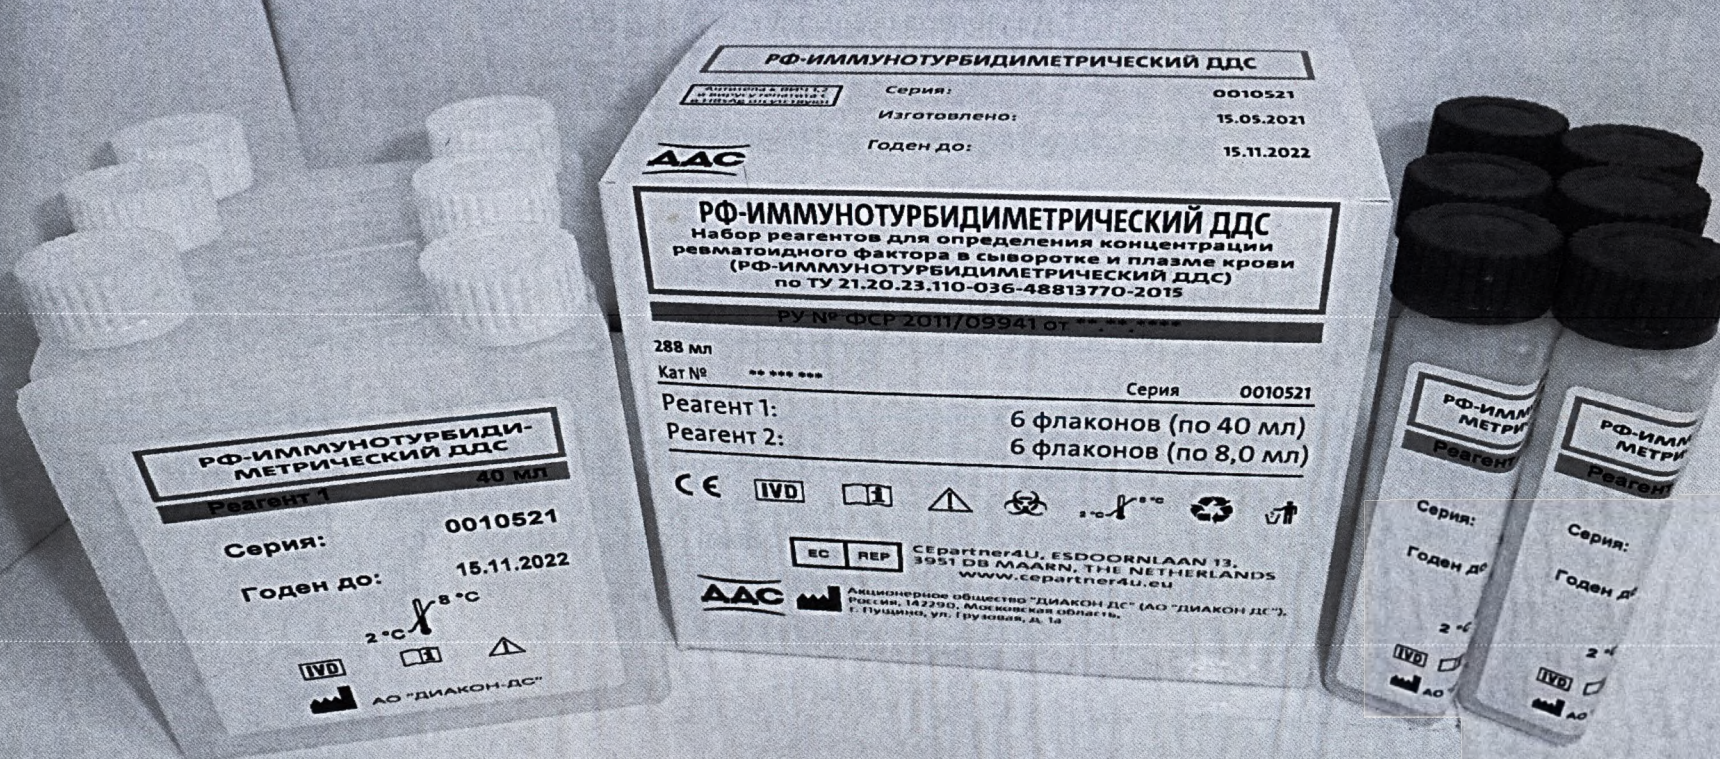


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 4

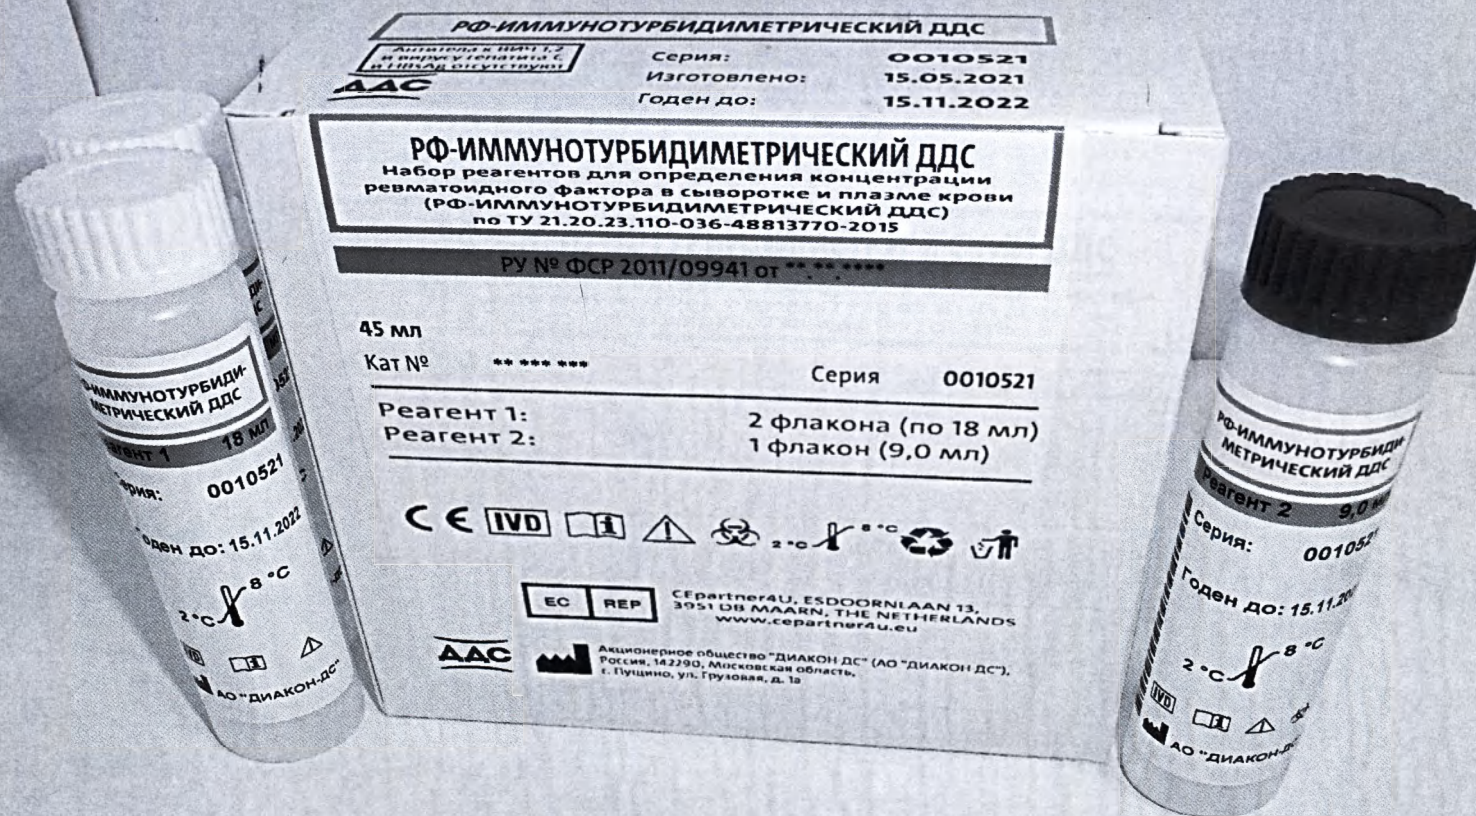


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 5

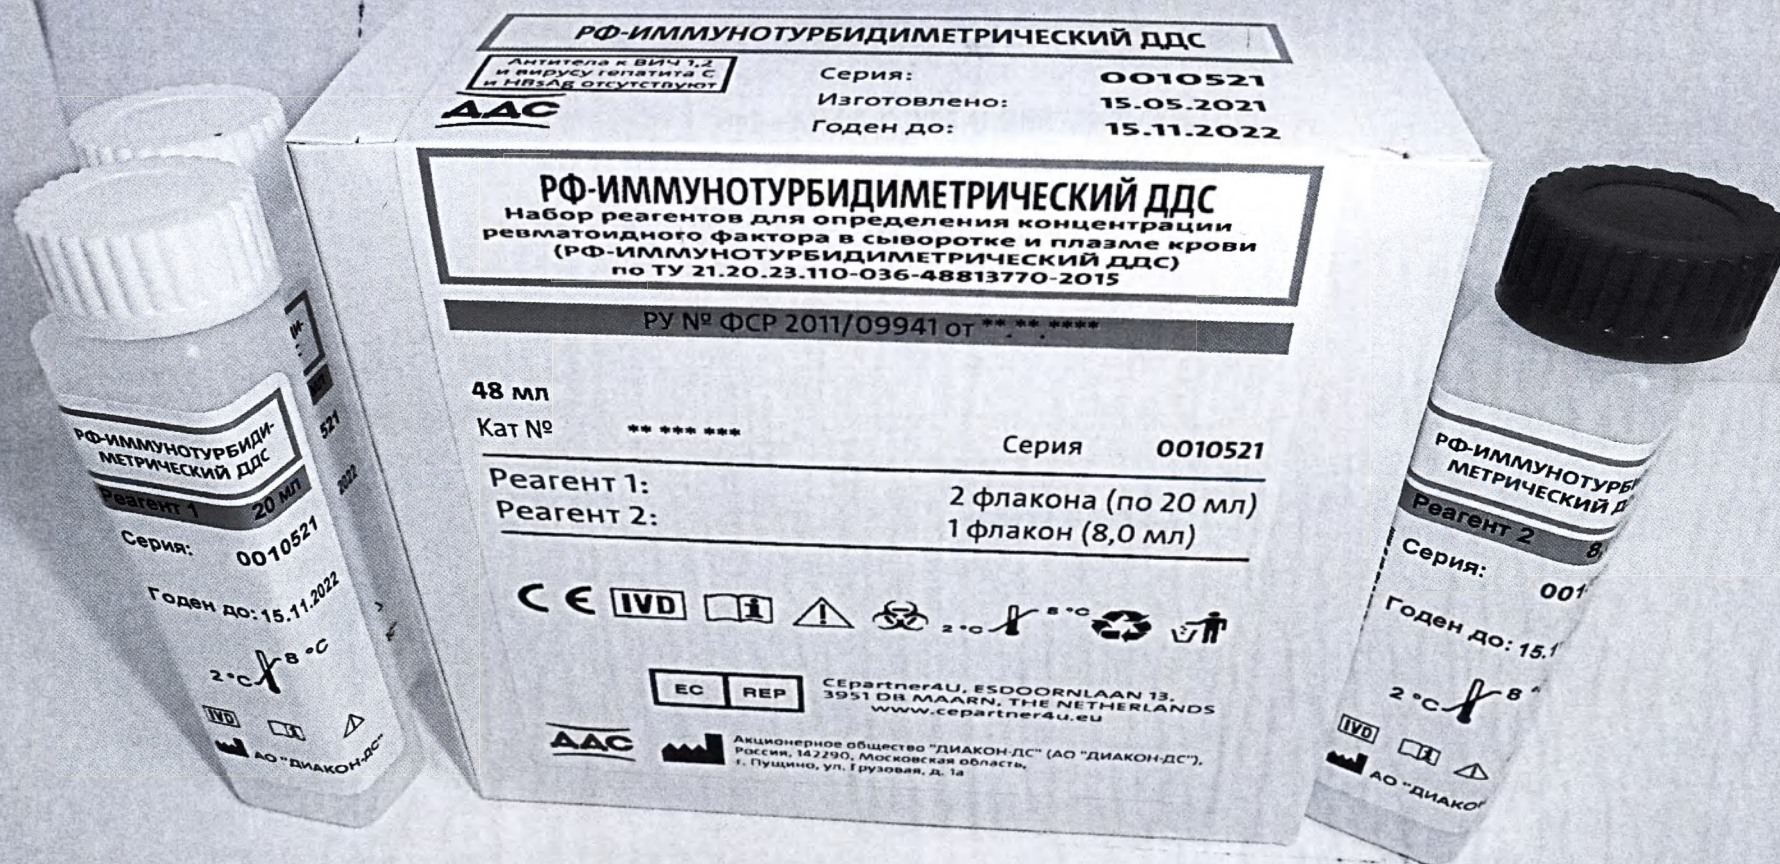

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 6

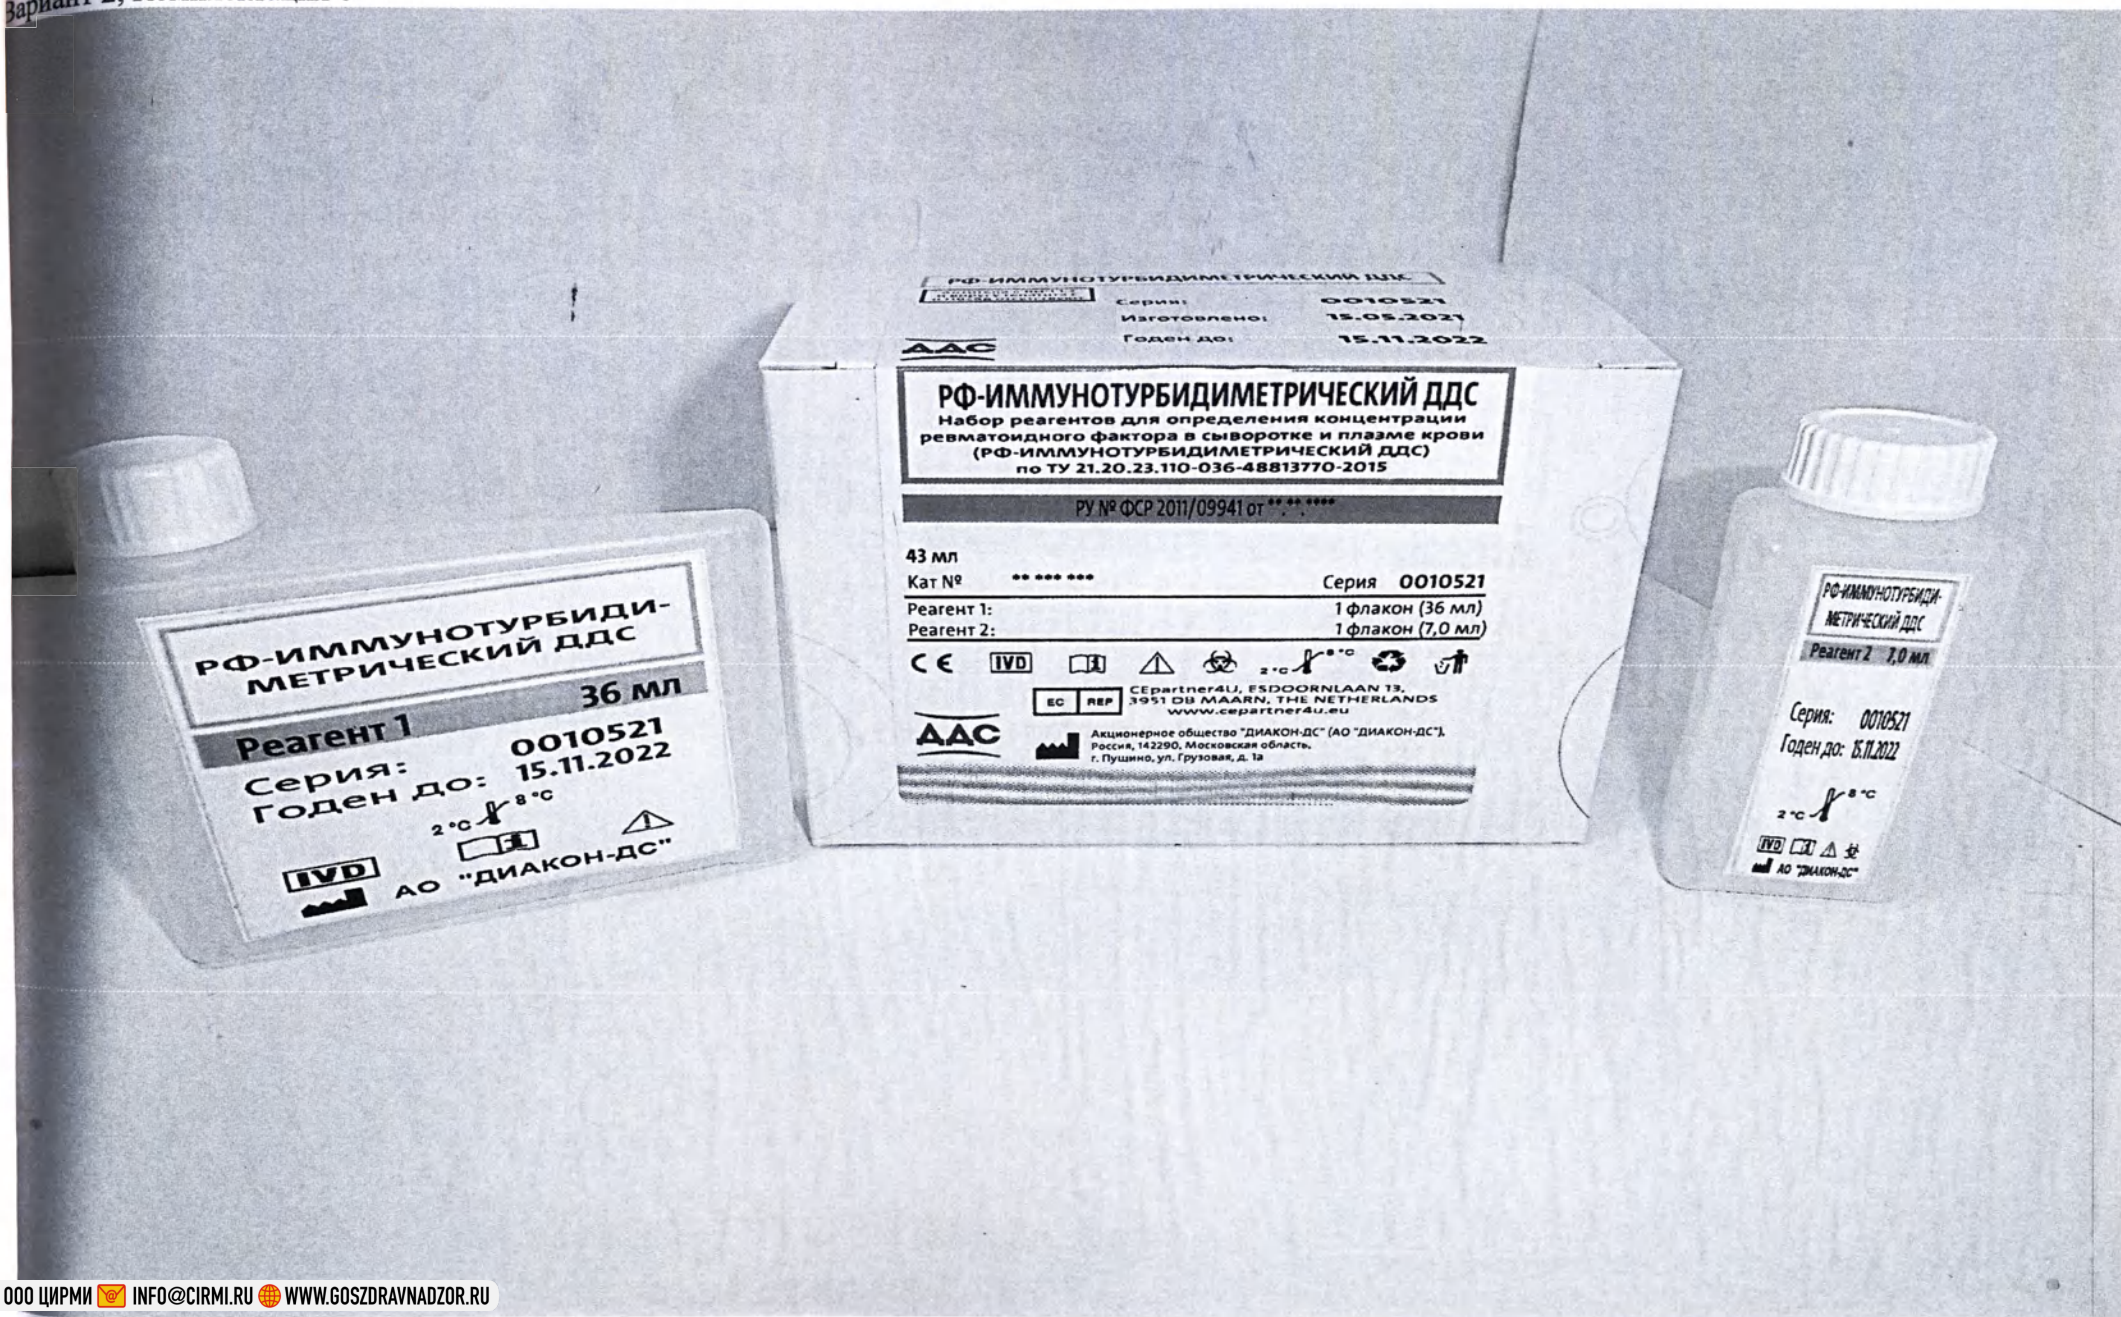

Вариант 2, Комплектация 7



Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 8



**Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015**

The image shows the packaging for the RF-ImmunoTurbidimetric Assay (РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС). The box is white with black and red text. The top section contains the product name in Russian and English, followed by the manufacturer's name (AAC) and a small logo. Below this, the box specifies the reagents and their concentrations: 42 ml of Reagent 1 and 2, and 2 vials (18 ml each) of Reagent 3. The box also displays the lot number (0010521) and the expiration date (15.11.2021). The bottom section of the box features the AAC logo, a barcode, and contact information for the manufacturer (AAC) in Moscow. To the left of the box, two vials are visible, labeled 'РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС' and 'ДИАКОН-ДС'.

РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
AAC

Серия: 0010521
Изготовлено: 15.05.2021
Годен до: 15.11.2022

РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
Набор реагентов для определения концентрации
ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/09941 ОТ *** **

42 мл
Кат № *** **

Серия 0010521

Реагент 1: 2 флакона (по 18 мл)
Реагент 2: 1 флакон (6,0 мл)

CE IVD 1 2-0 1 8-0 1 1 1


EC REP

Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а

ДИАКОН-ДС

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 10

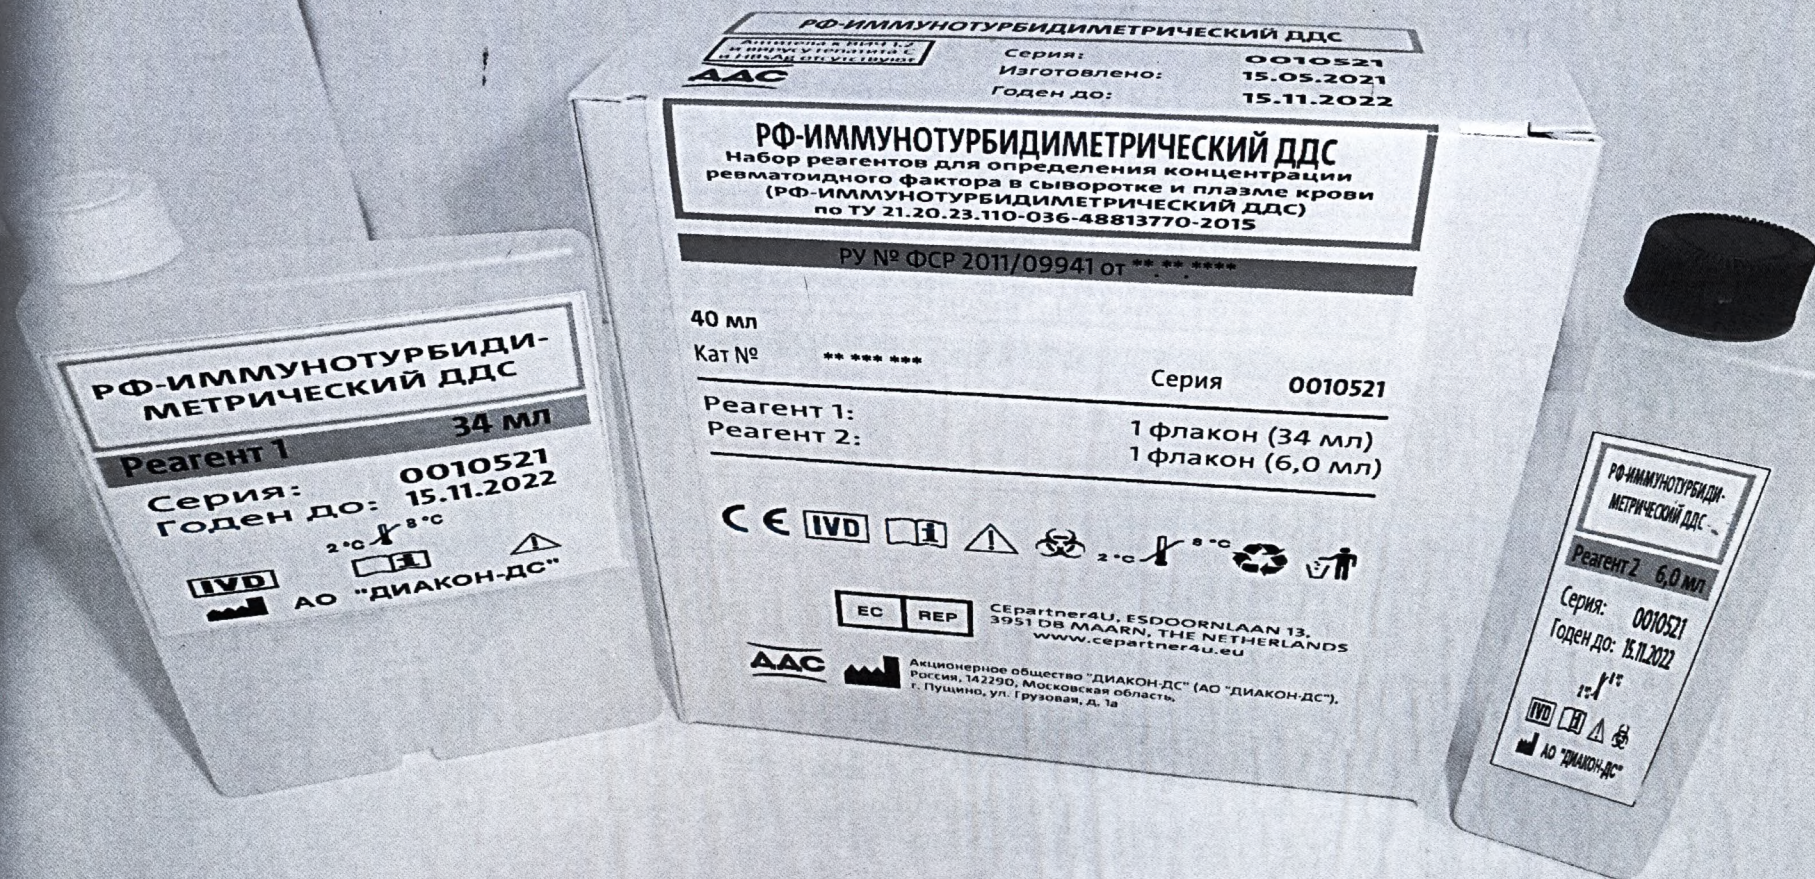

**Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015**

Вариант 2, Комплектация 11



Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 12



Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 13




Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 14




Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 15

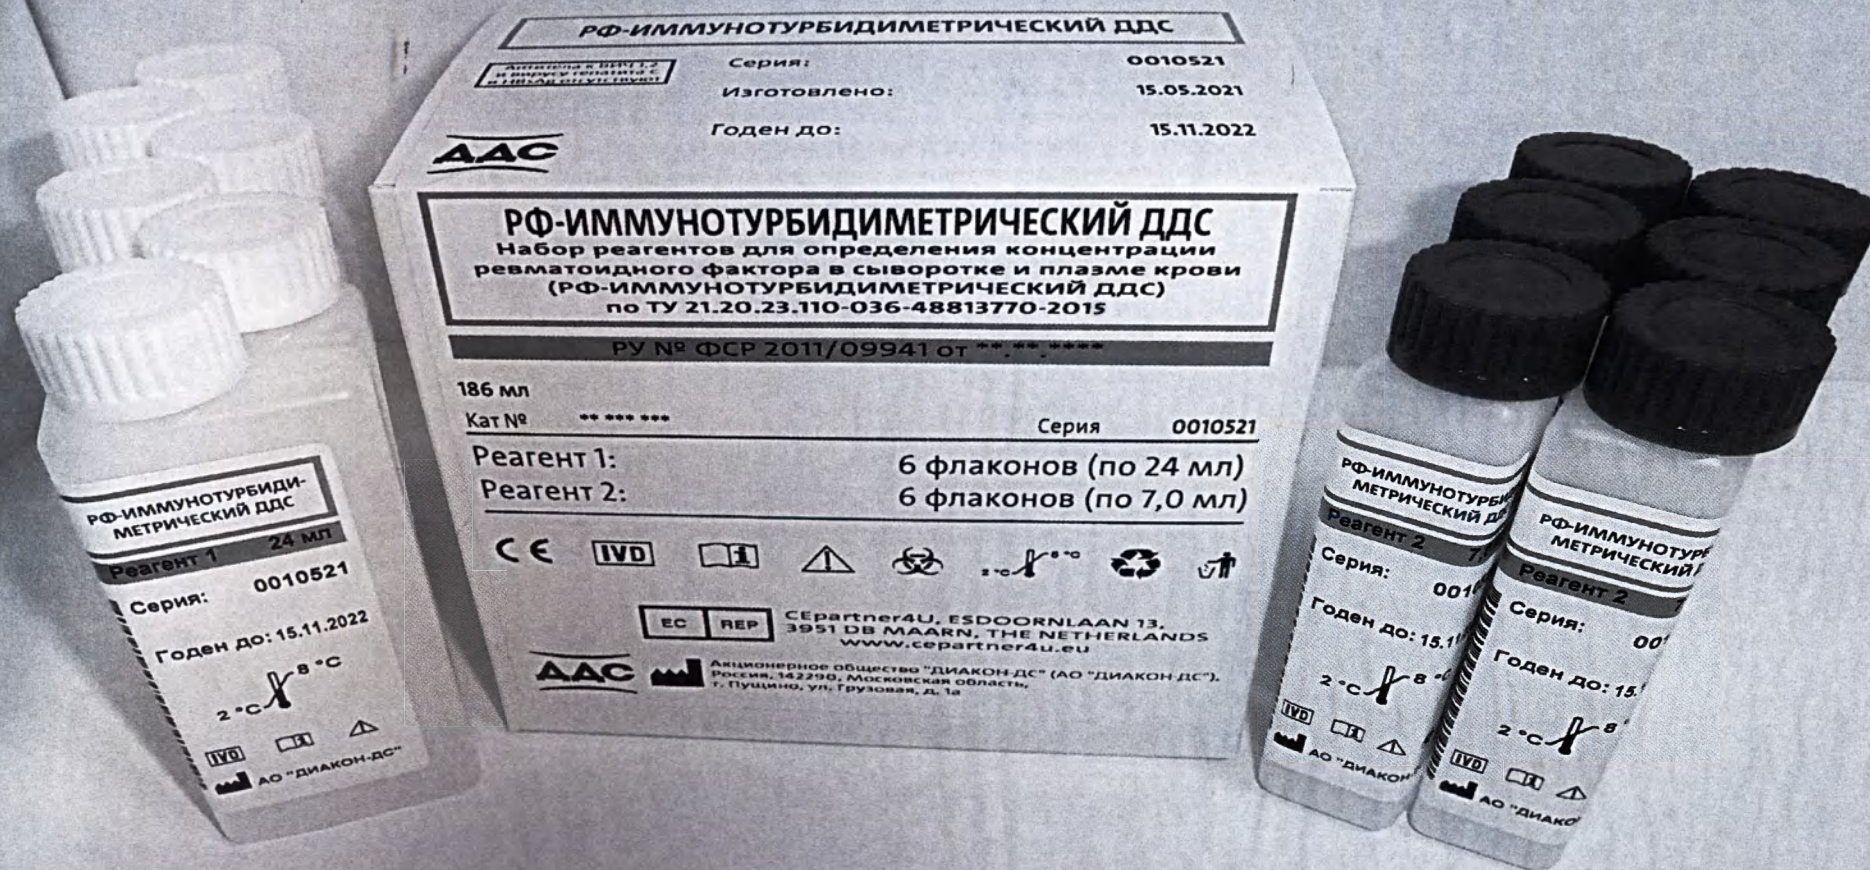


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 16

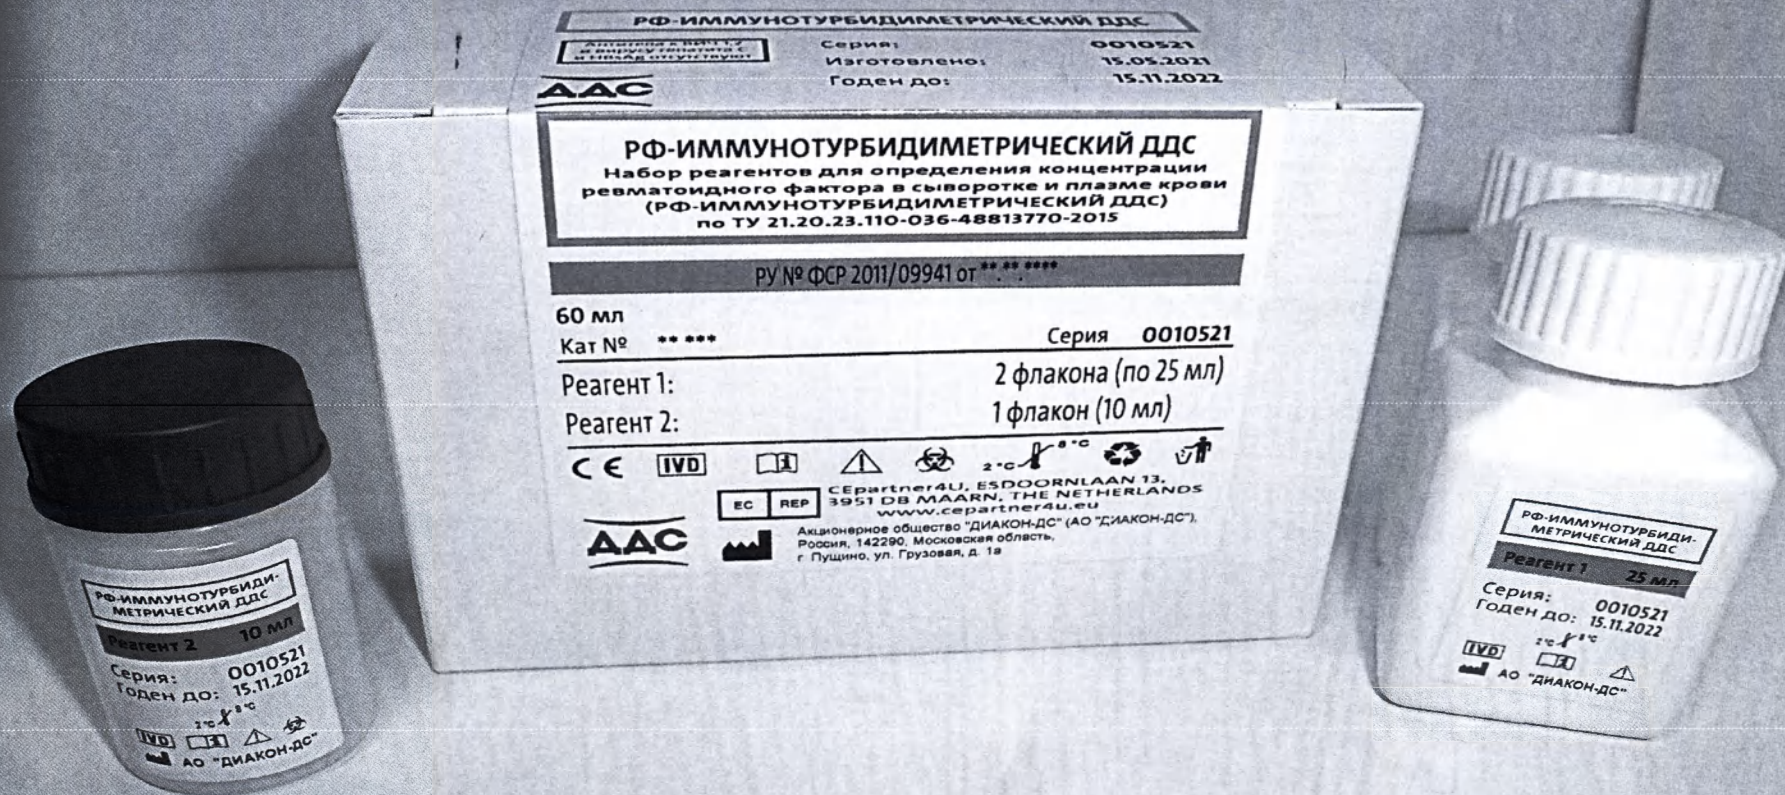


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 2, Комплектация 18

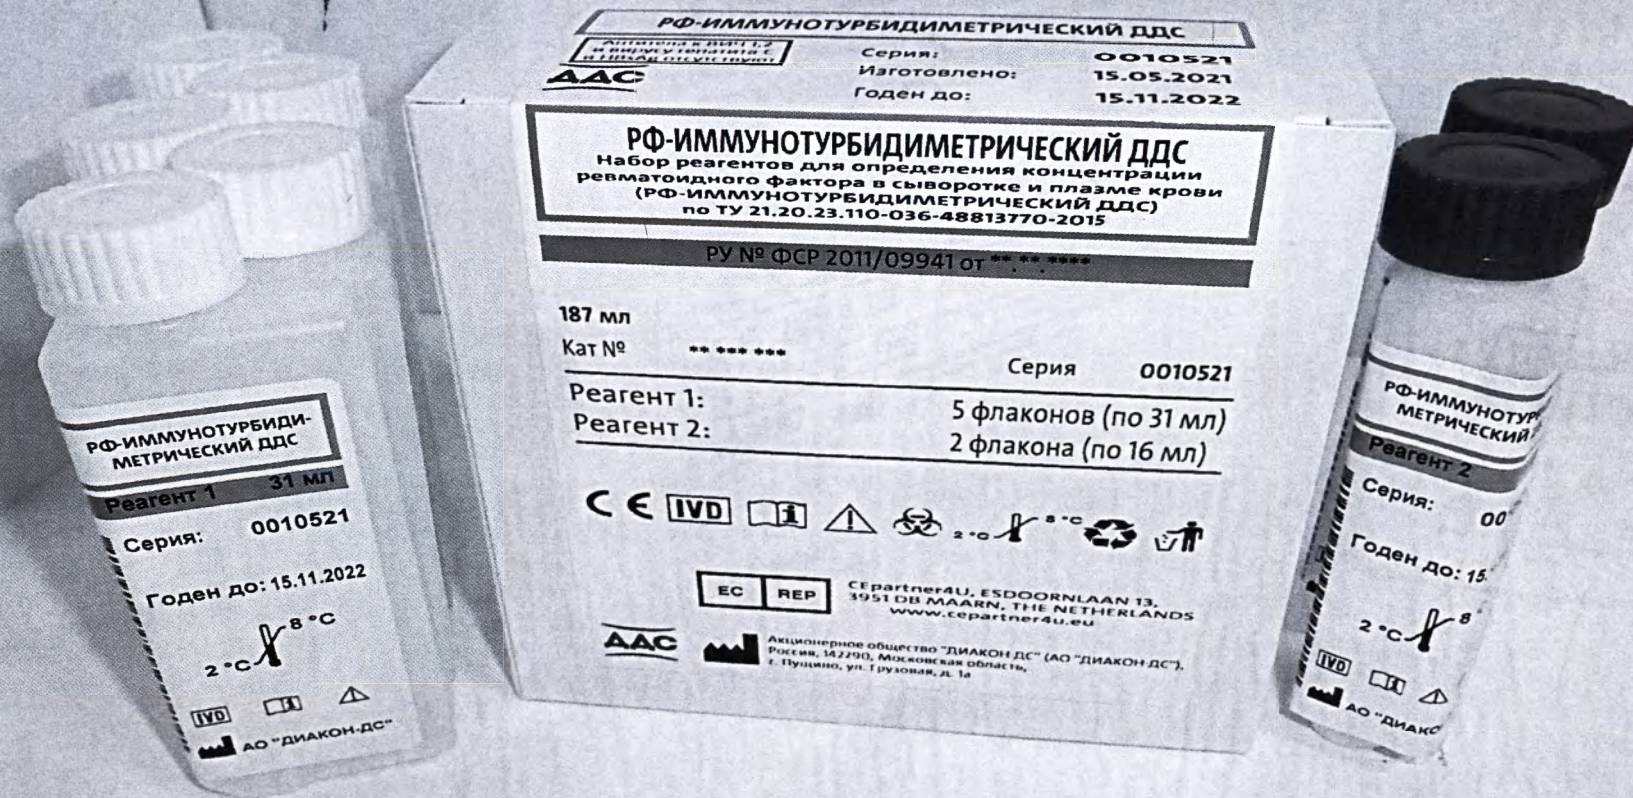

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

вариант 3, Комплектация 1

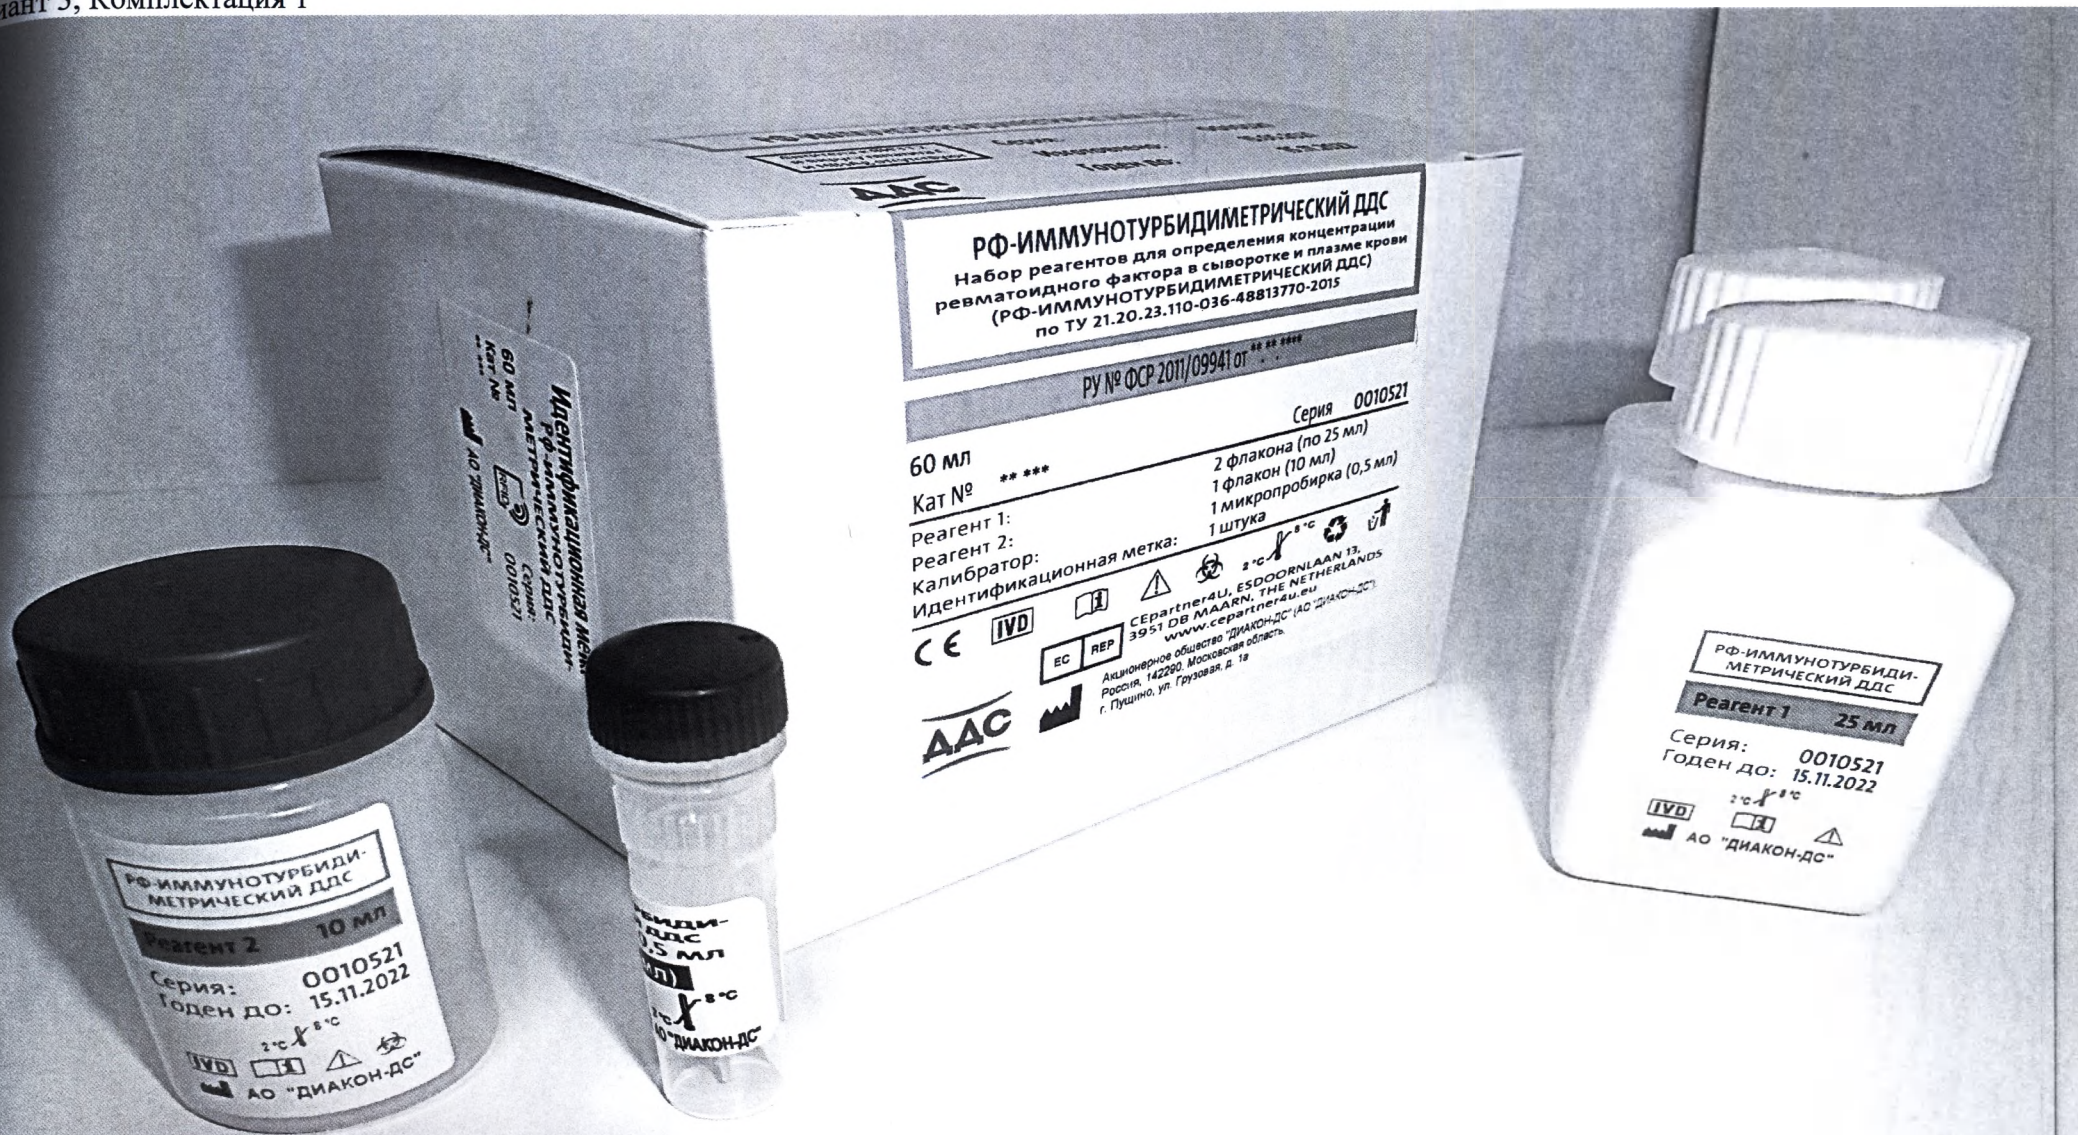

Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови
(РФ-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-036-48813770-2015

Вариант 4, Комплектация 1



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 27
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»



Т.Ю. Корзун