

varian

ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»
109147, Россия, Москва
ул. Таганская, д.17-23
Бизнес-центр Мосэнка
тел. +7 495 604 44 24/23
факс +7 495 660 11 37
www.varian.com



Генеральный директор

ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»

Фельдманн Маркус

«18» сентября 2018г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями».

«Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями», в составе:

Базовый блок 1 (версия для установки на кушетку):
















2. ЖК – монитор, 23-дюйма.




3. Клавиатура.

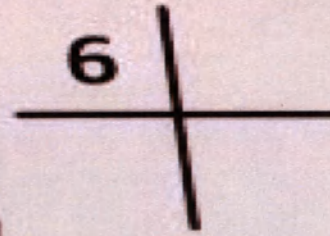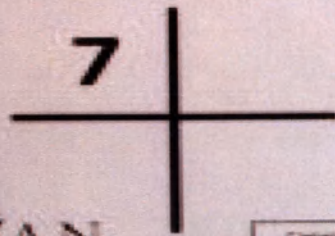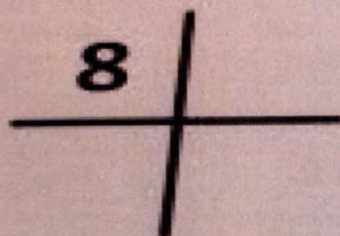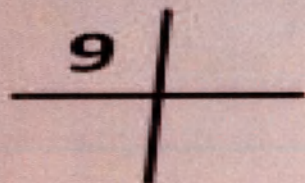

VARIAN
MEDICAL SYSTEMS

Camera Calibration Report
P5000-2009A

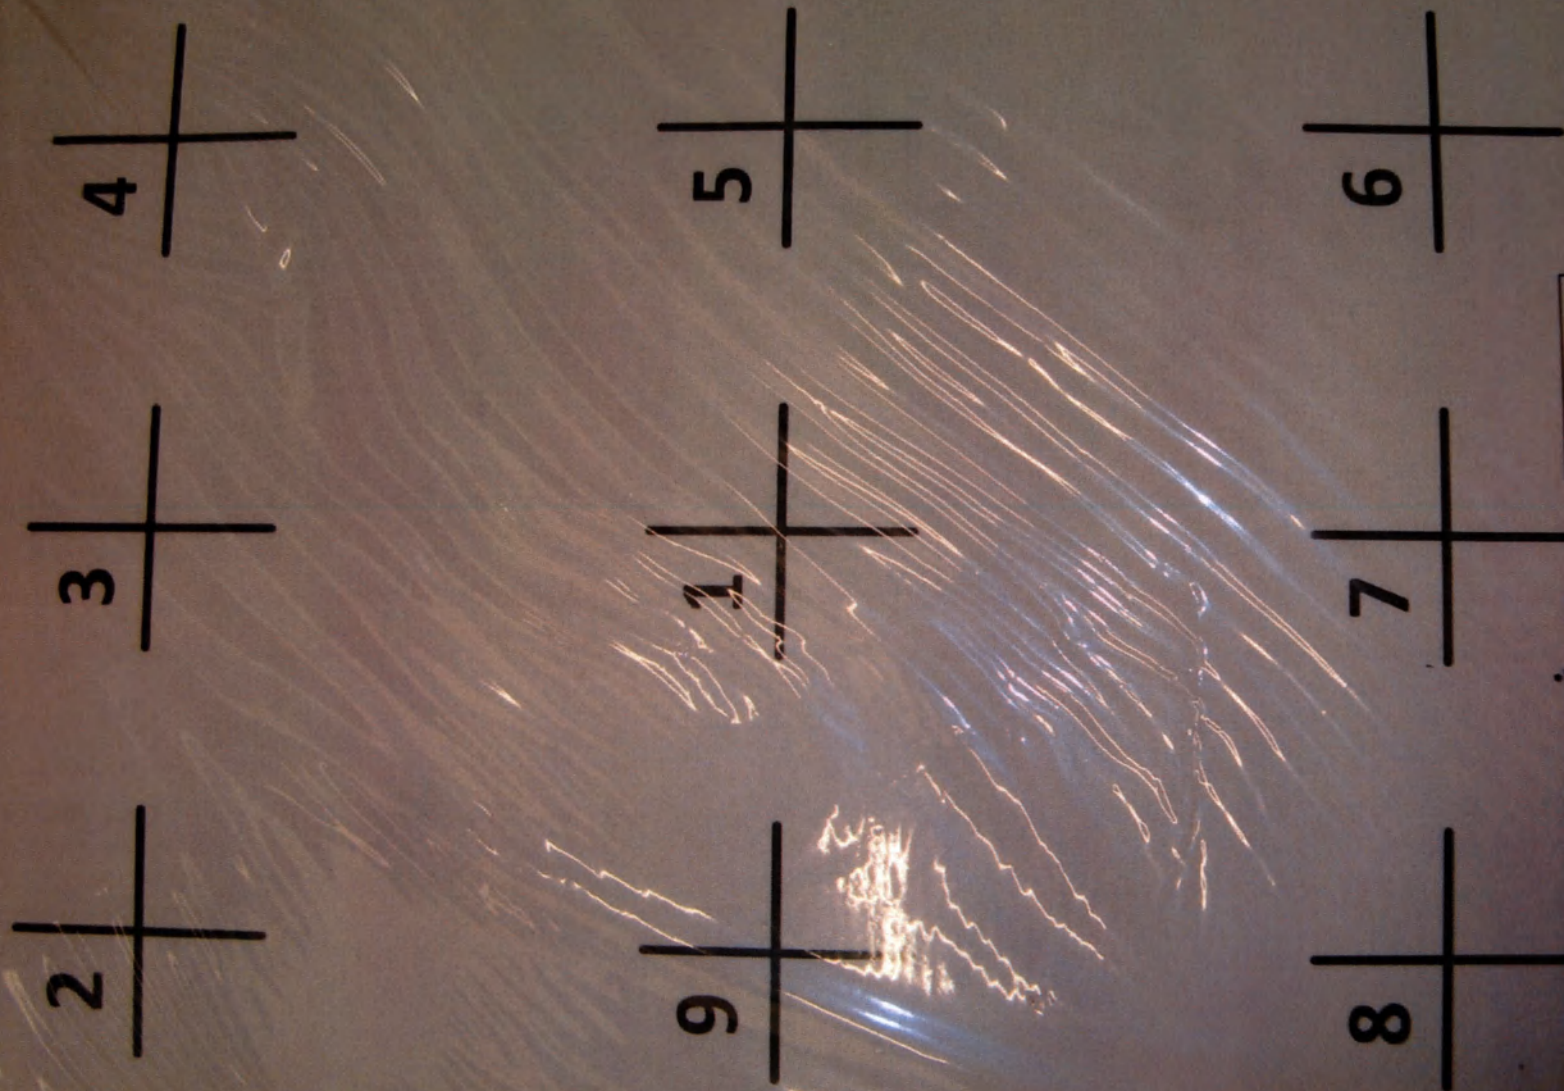

Camera Calibration Board
P1002522001A


VARIAN
medical systems

VARIAN
medical systems

46. Пластина для калибровки камеры.




5. Блок отражателей.

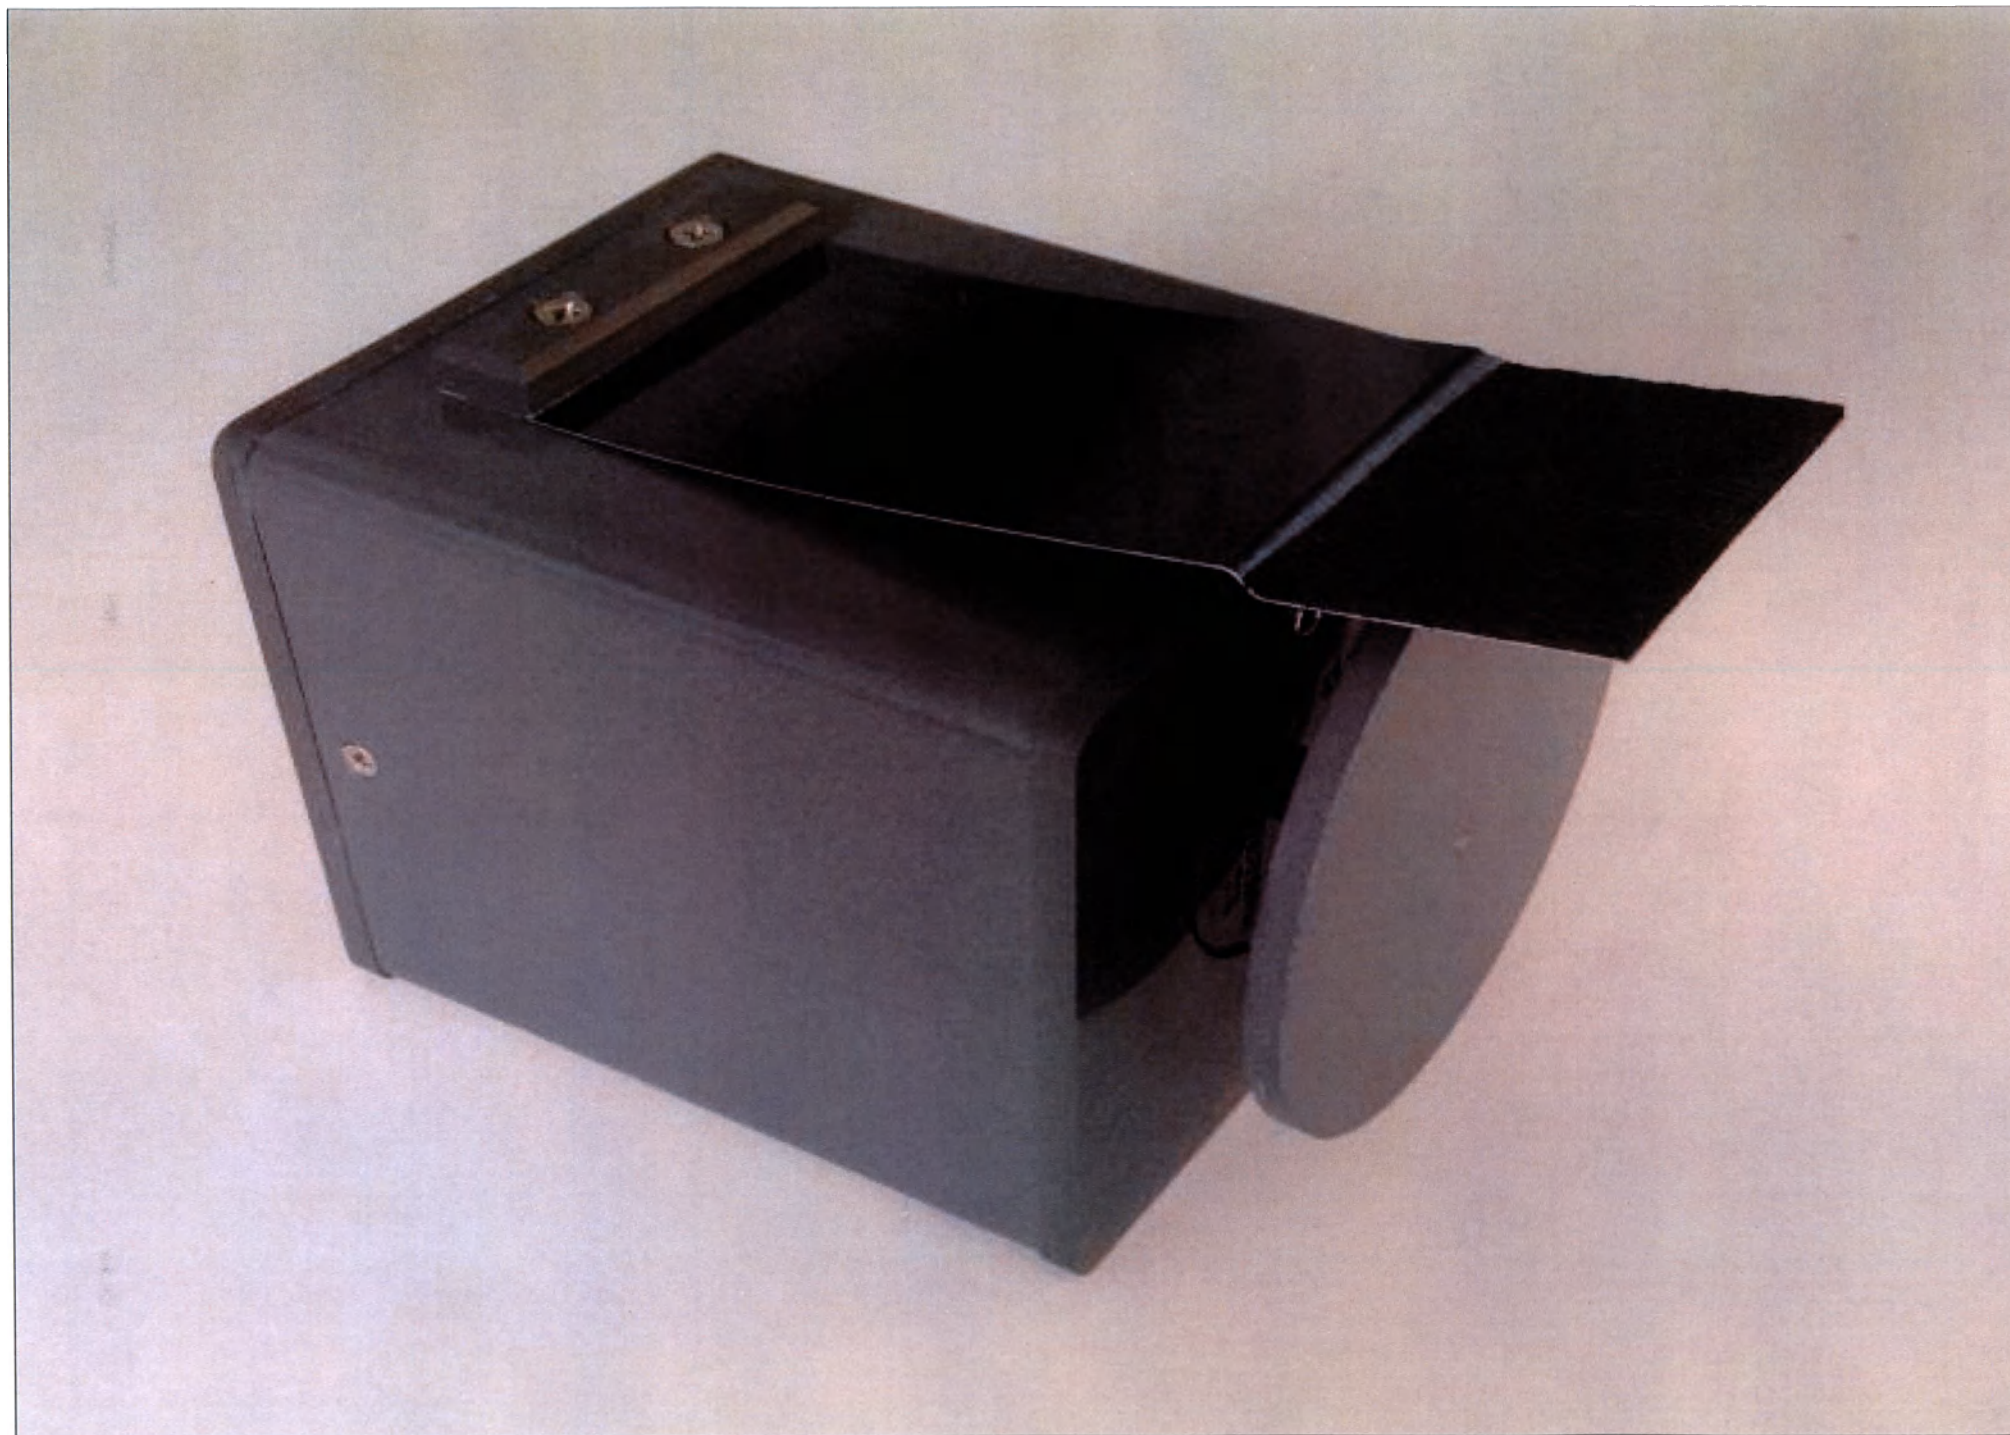


ба. Фантом респираторный.




66. Фантом респираторный.

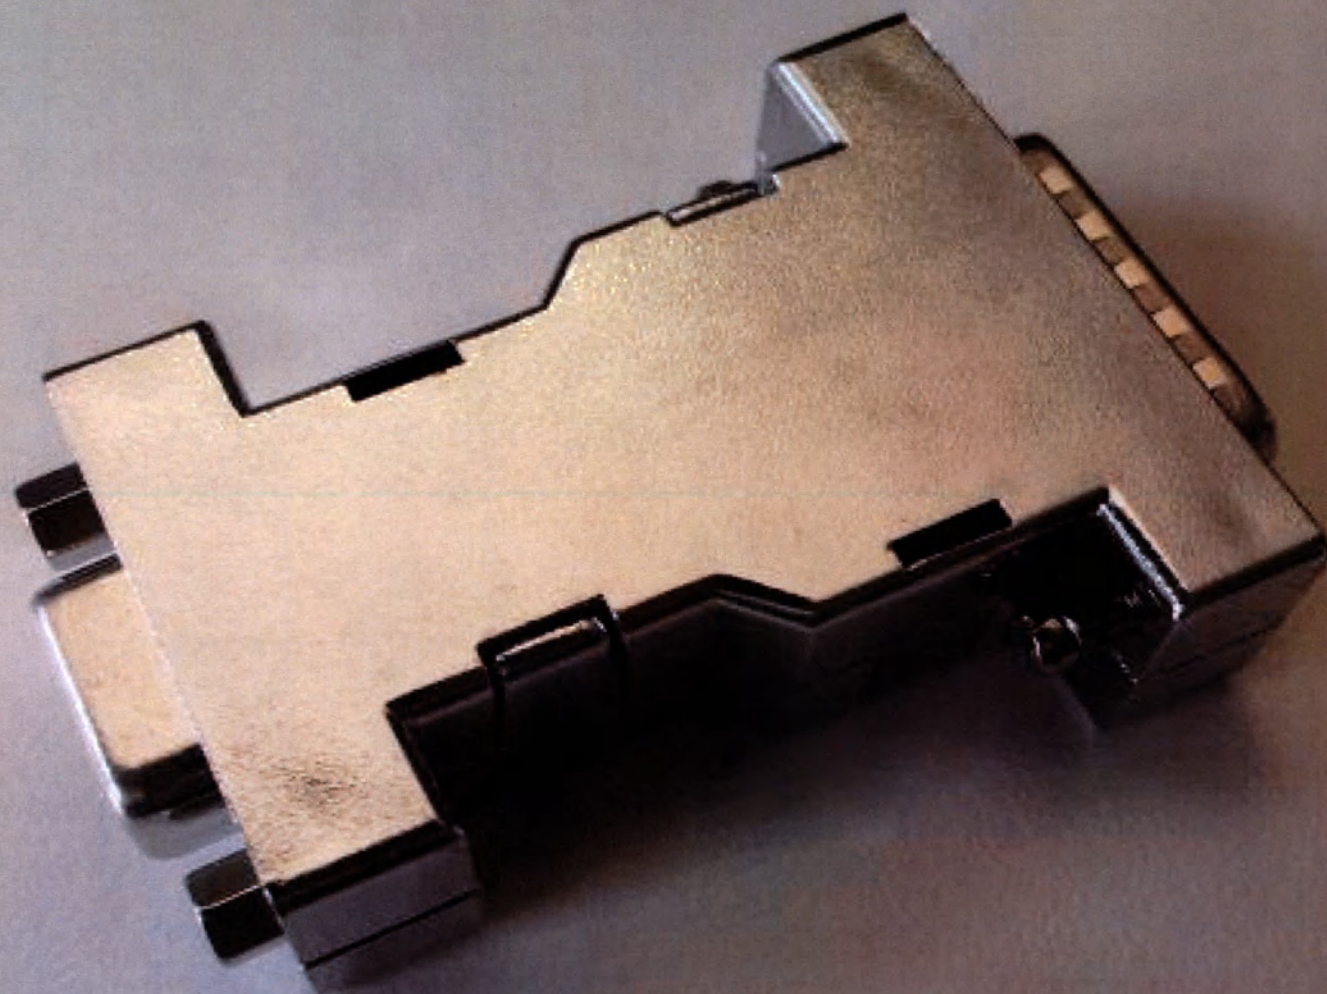

7. *Адаптер RGSC-RPM Adapter неизолированный.*

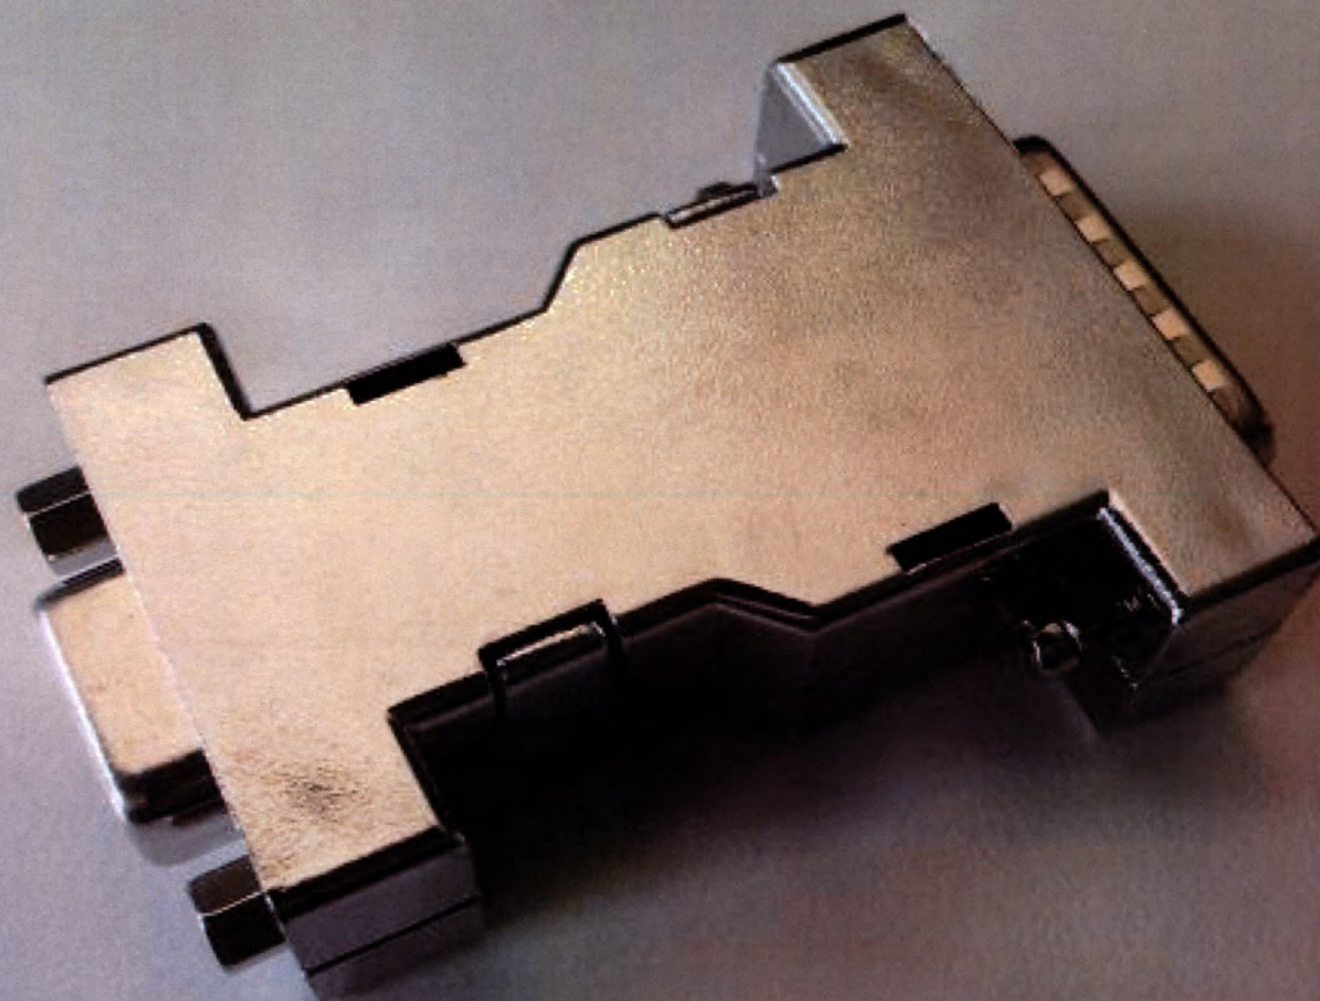


8. *Адаптер RGSC-RPM неизолированный XD.*

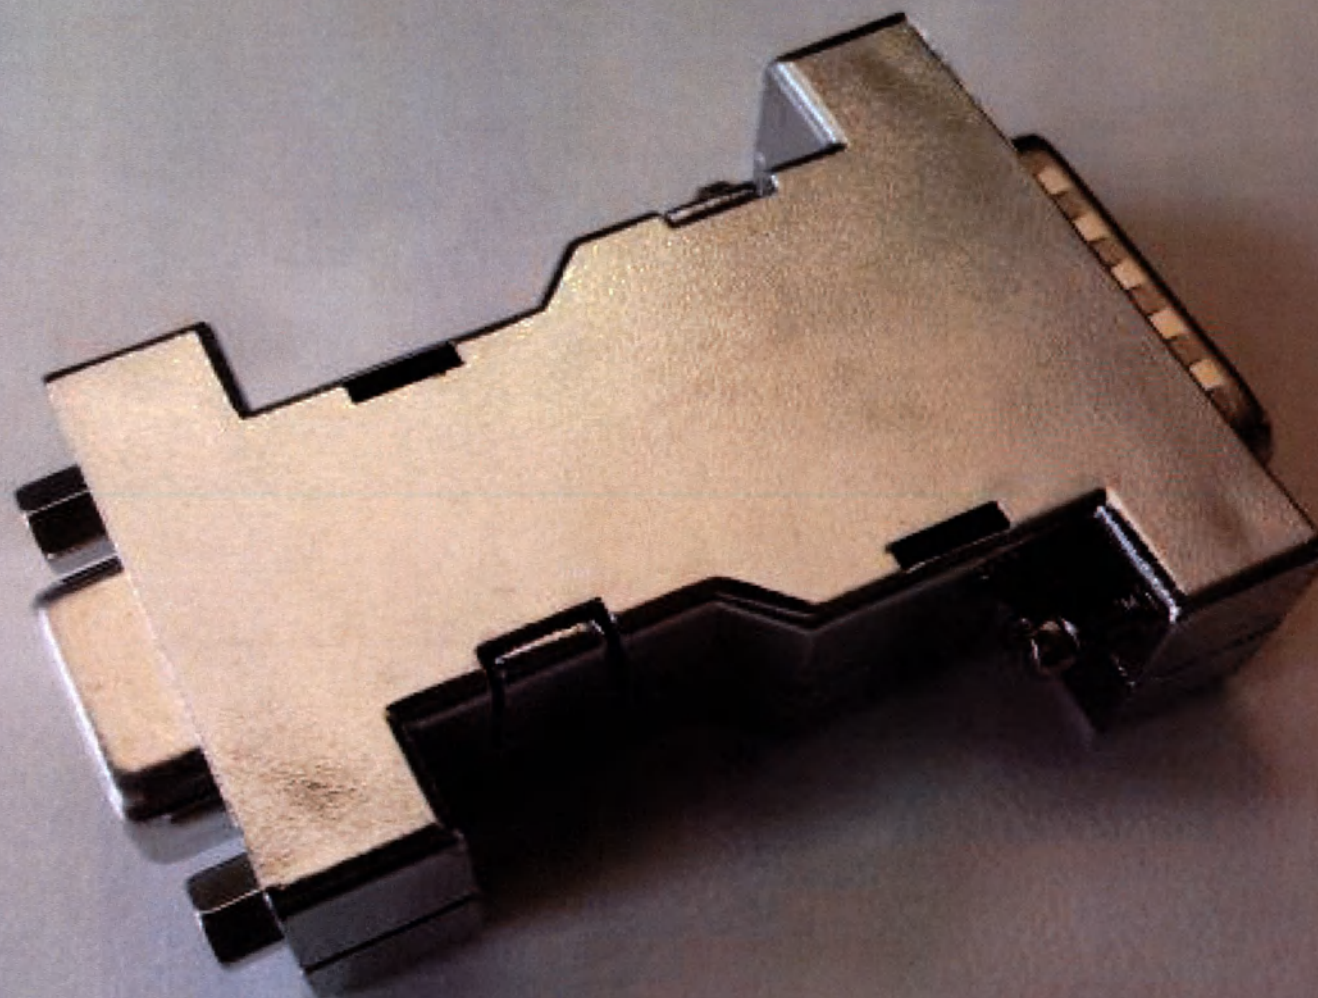


9. Адаптер RGSC-RPM изолированный.




10. Мышь оптическая, USB.

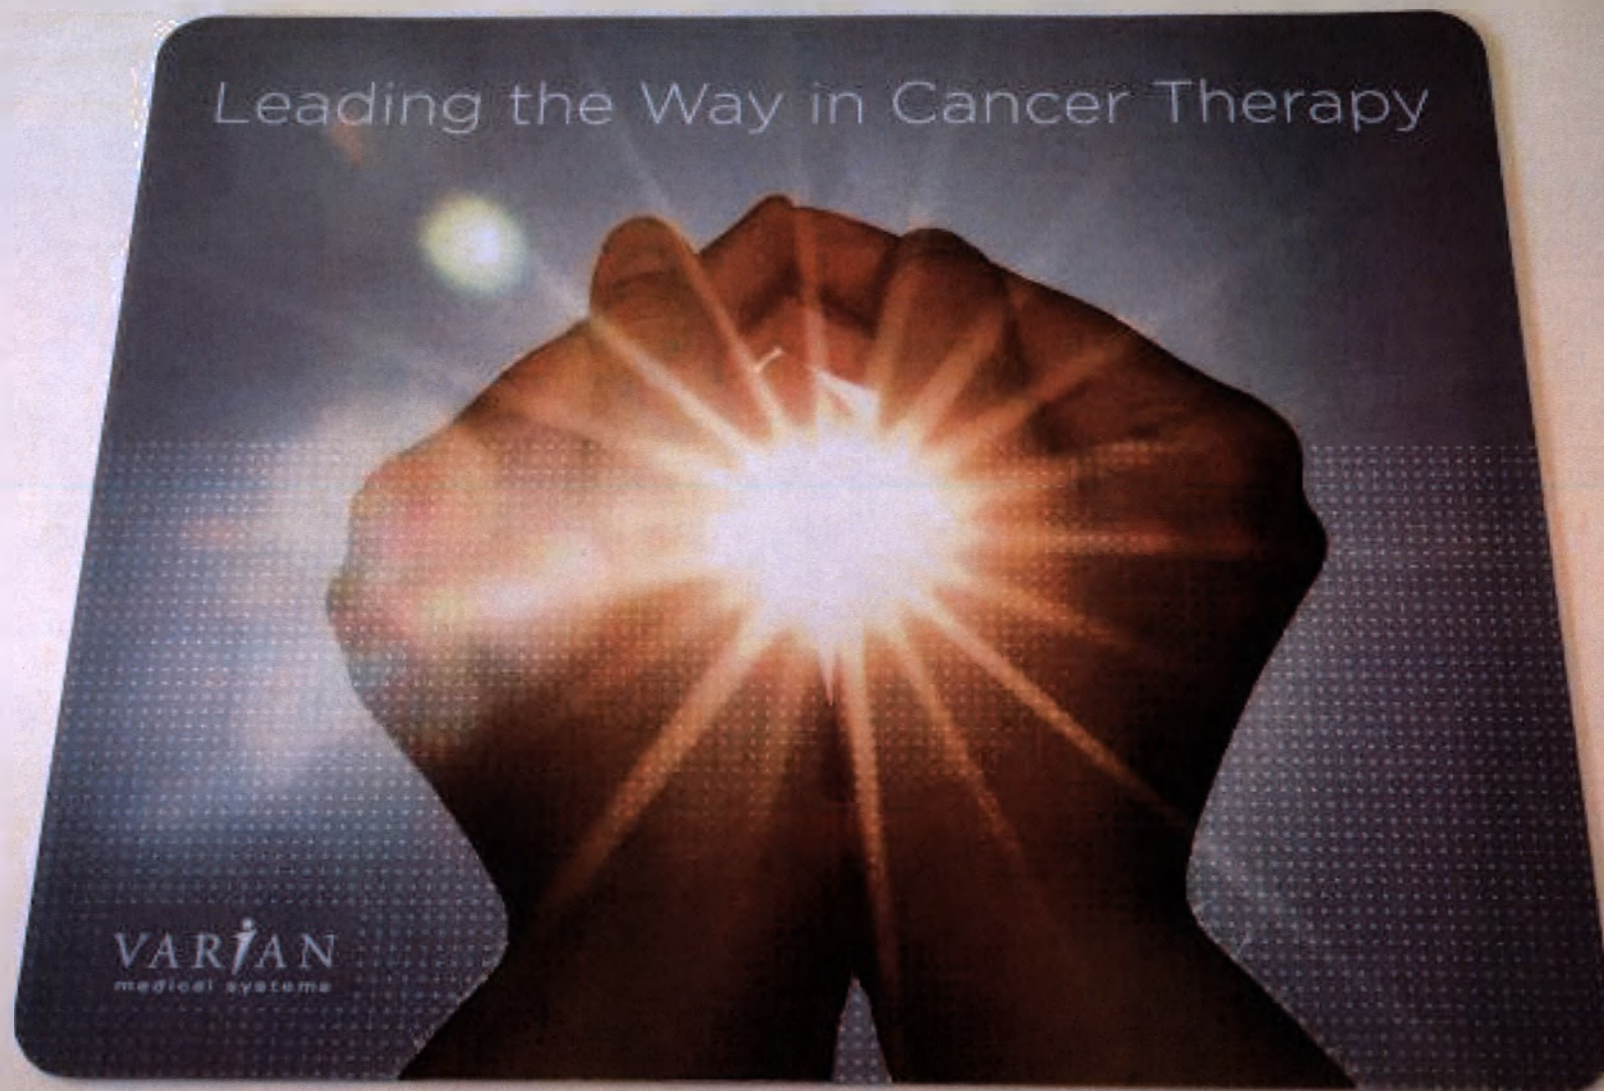



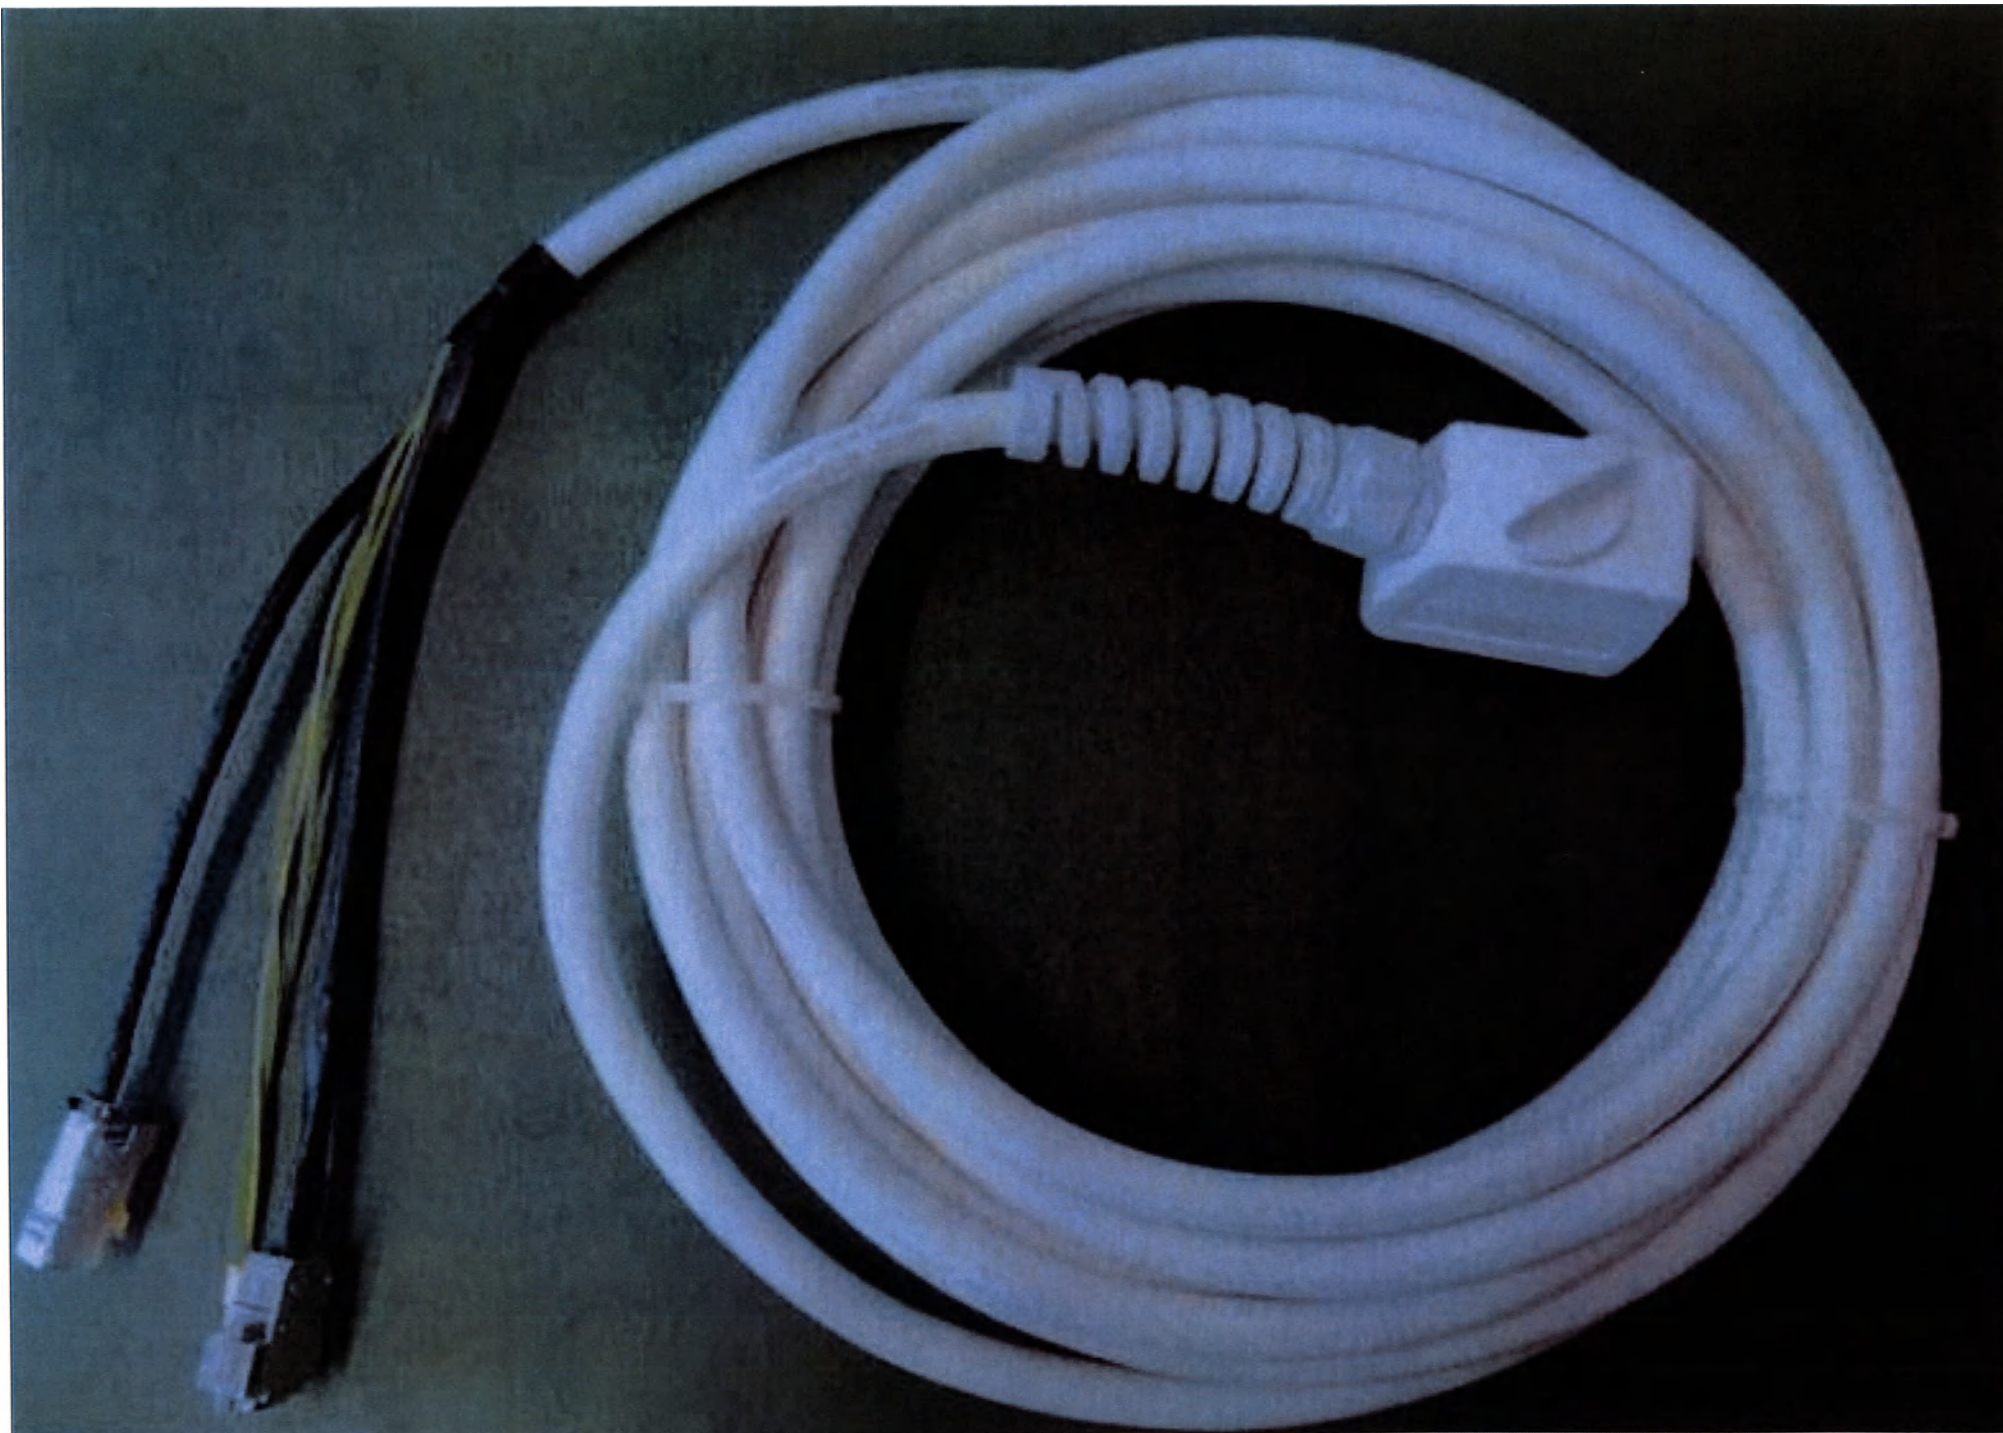

13. Кабель, длиной 10 м.

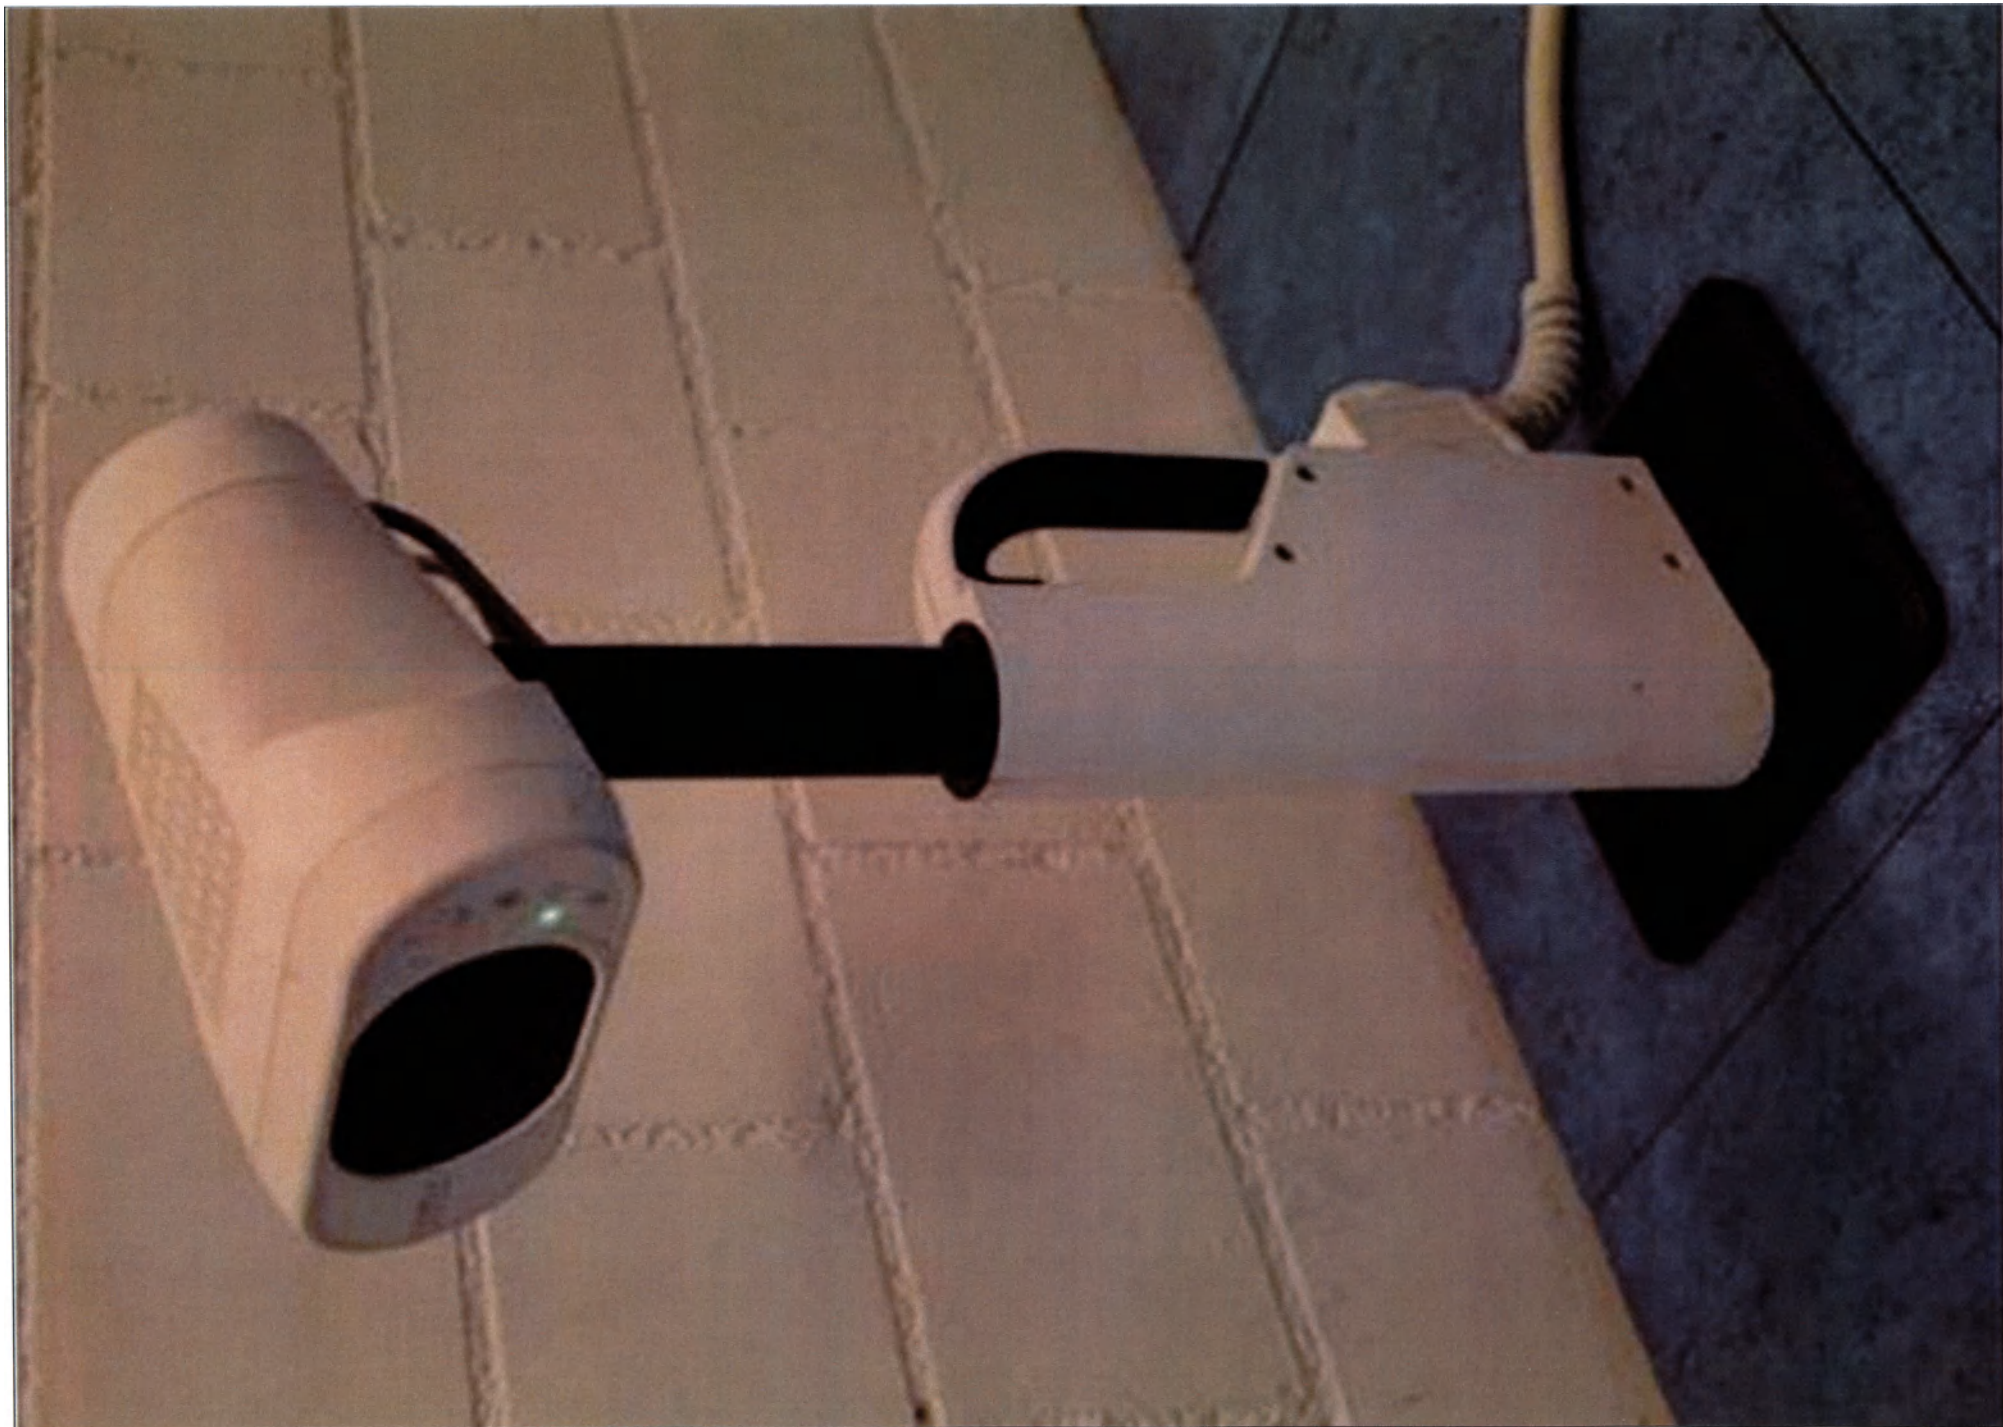


14. Камера с объективом 12 мм.




15а. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



156. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.

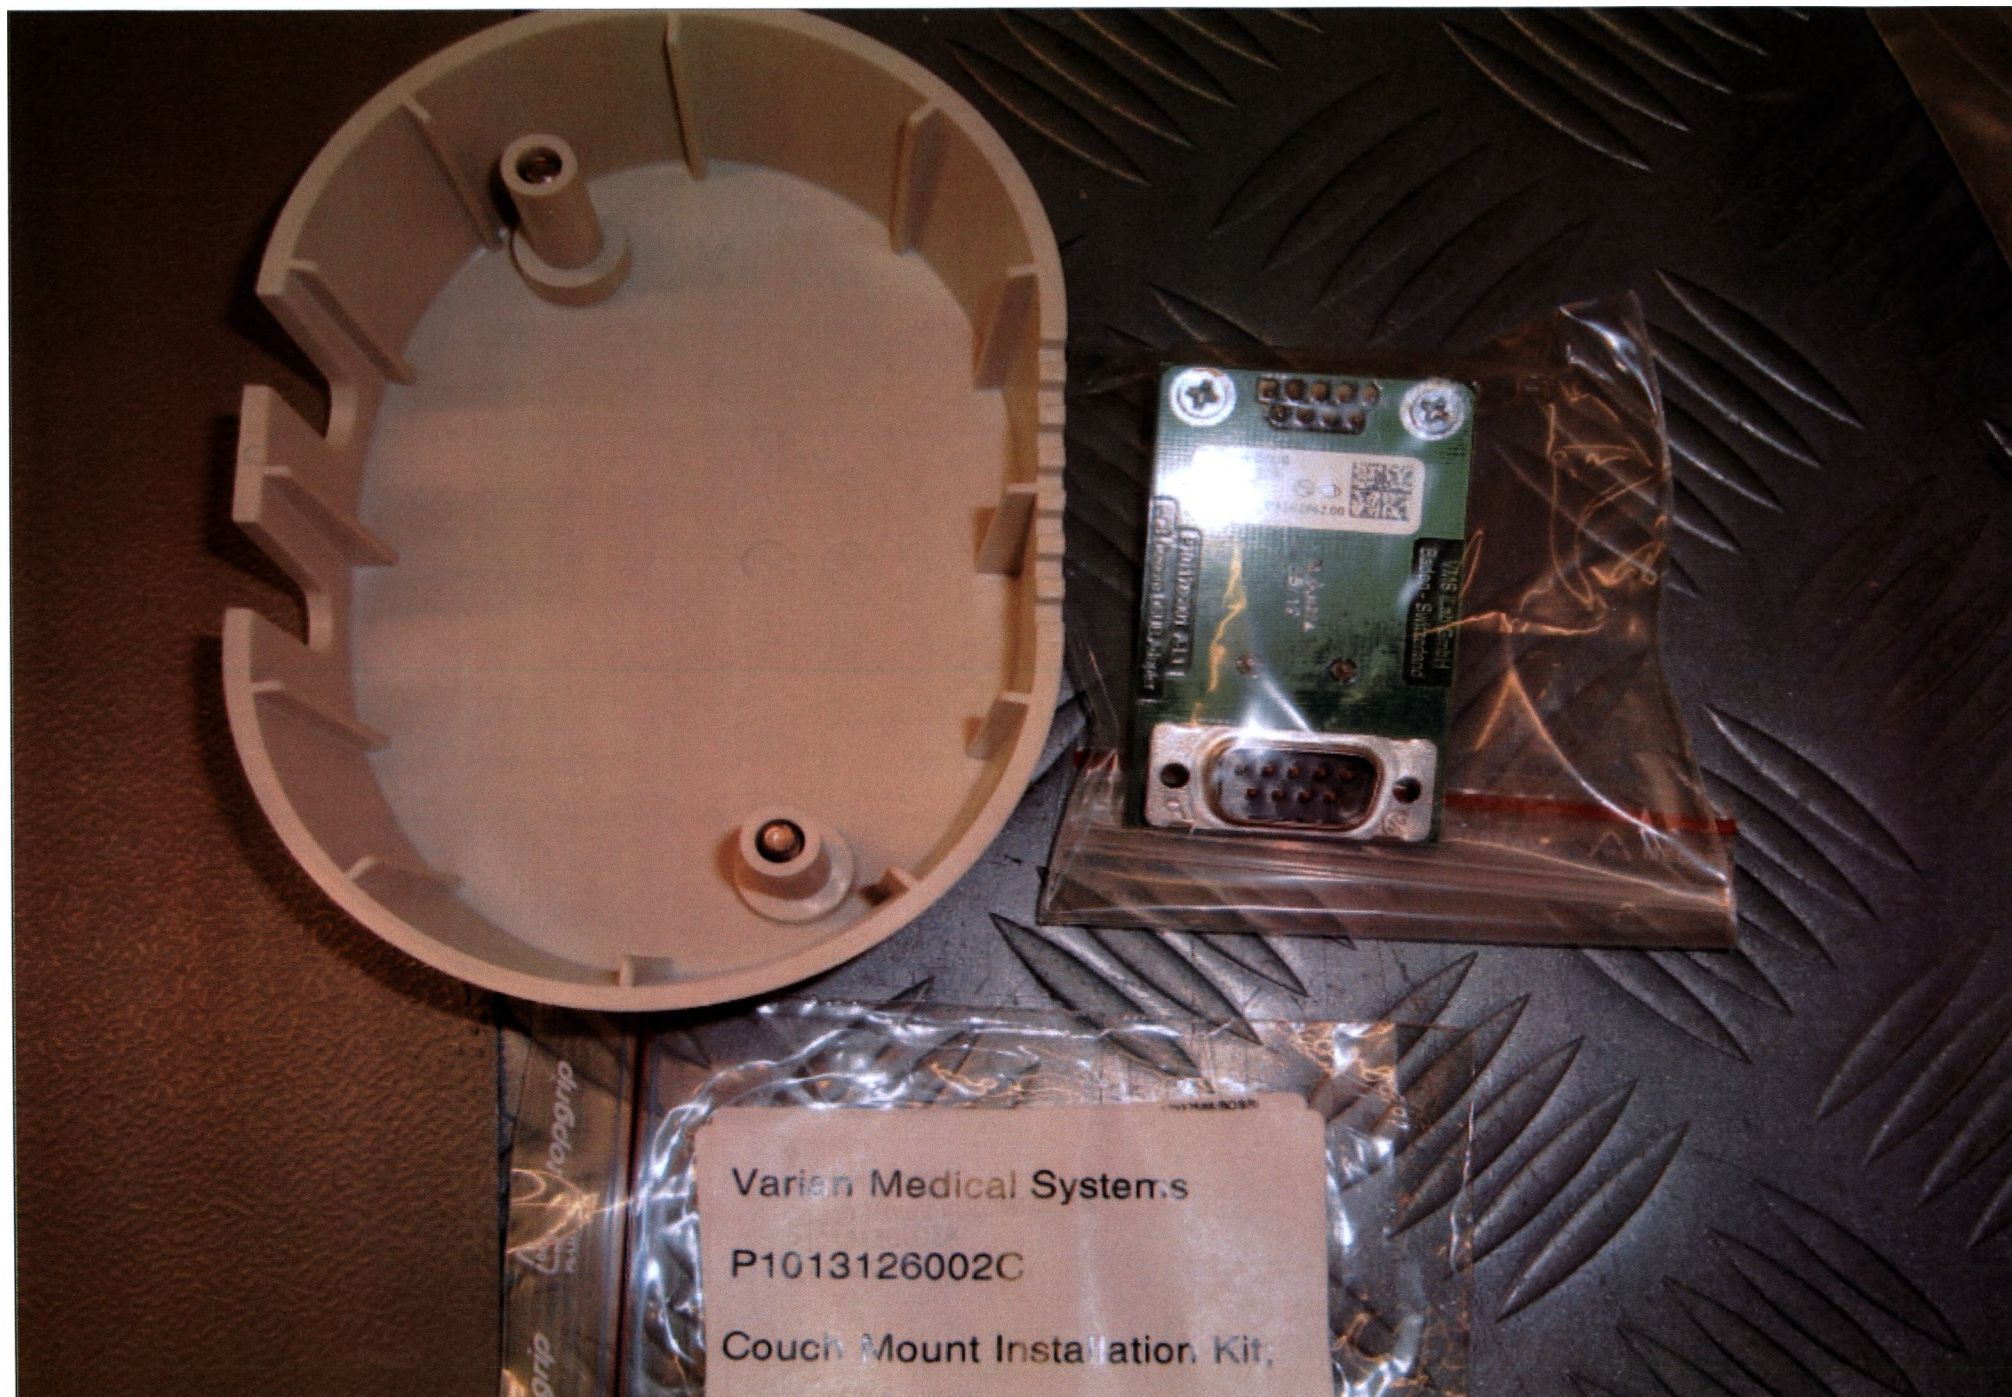

15в. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.

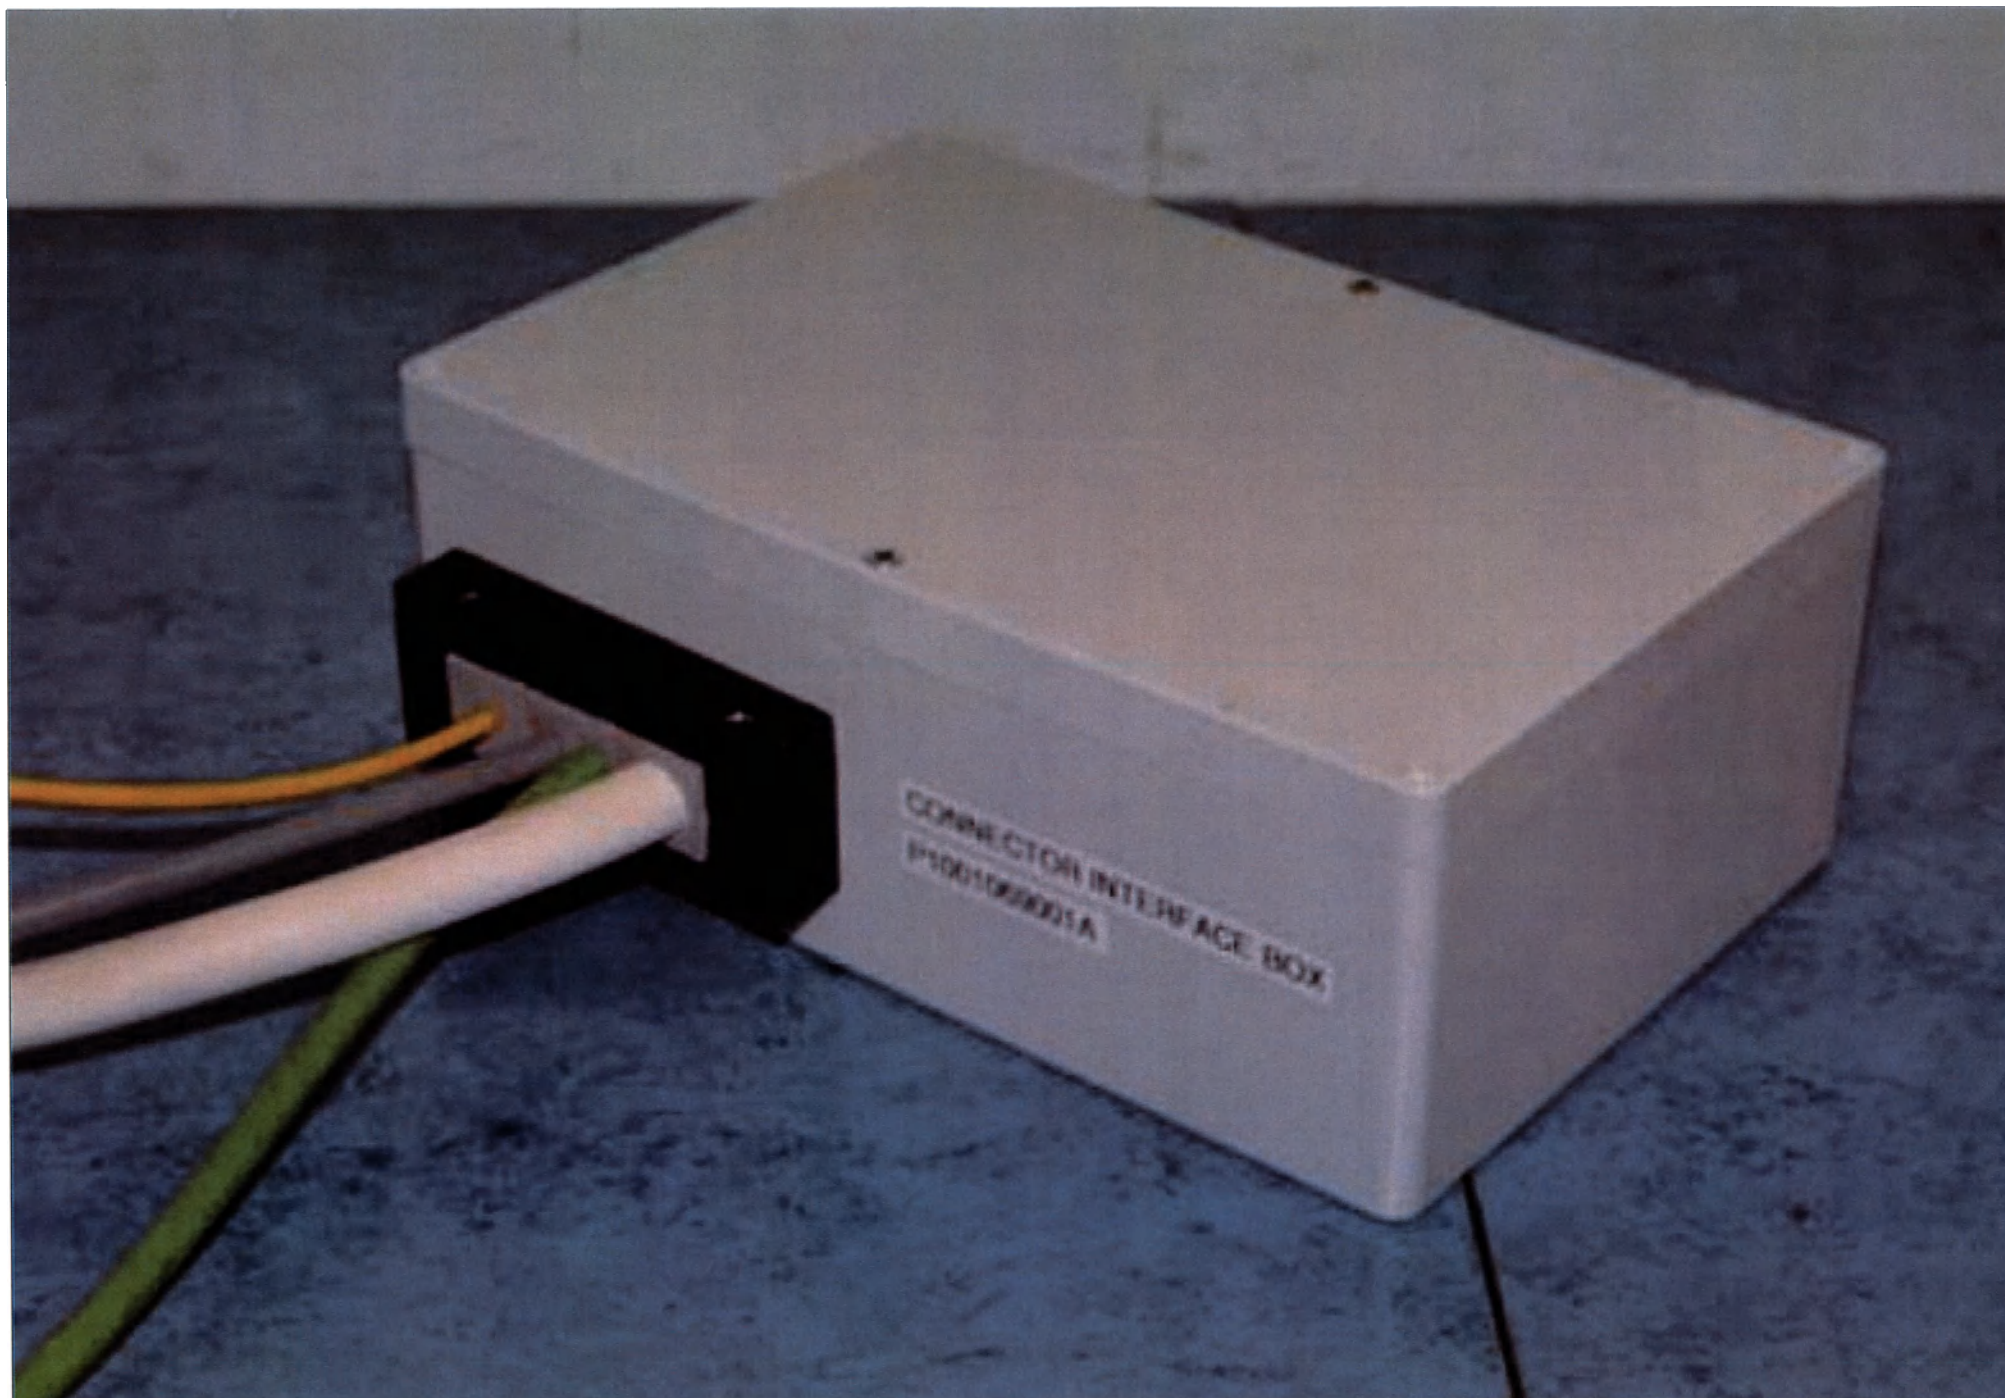

15г. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



15д. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



15e. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



15ж. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



153. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.



15и. Комплект для установки камеры на кушетке с кабелем длиной 10 м: Комплект для установки камеры на кушетке; Распределительная панель; Стыковочный узел; Штатив; Кабель камеры, длиной 10 м.

Базовый блок 2 (версия для настенной / потолочной установки):









2. ЖК – монитор, 23-дюйма.



3. Клавиатура

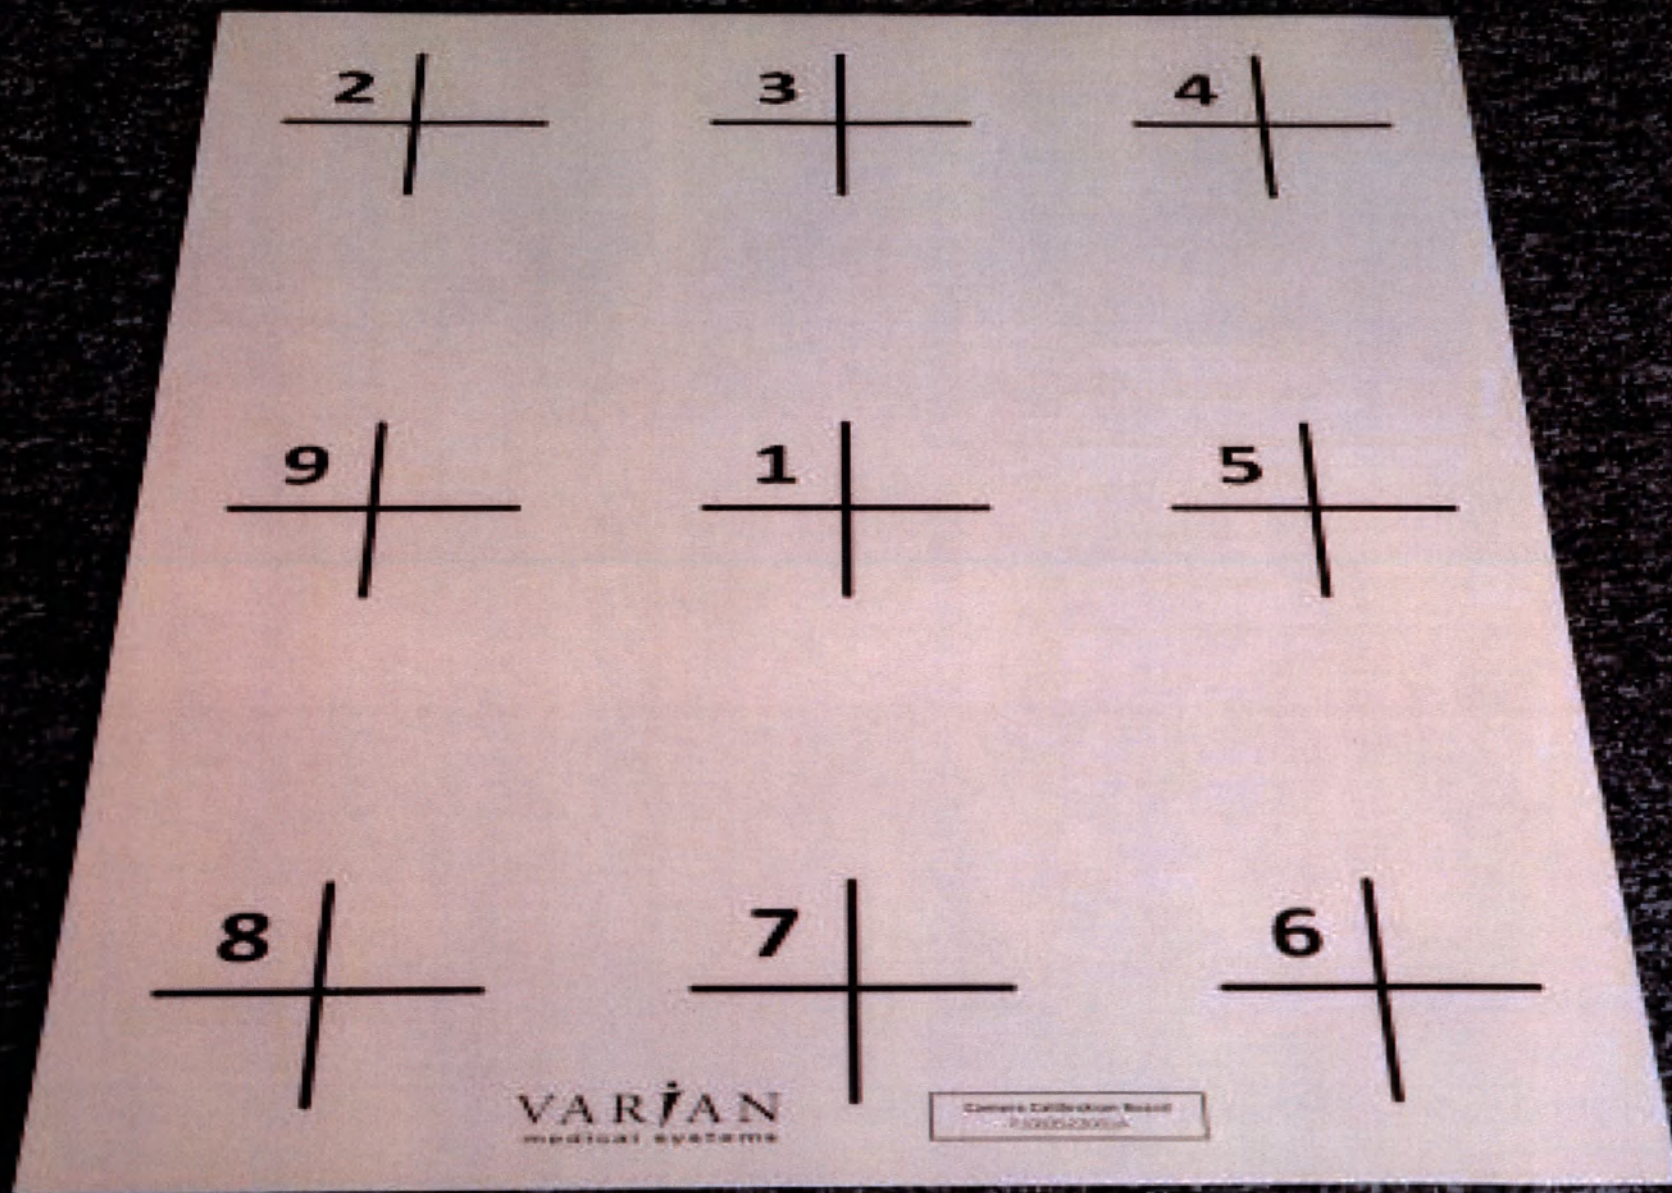


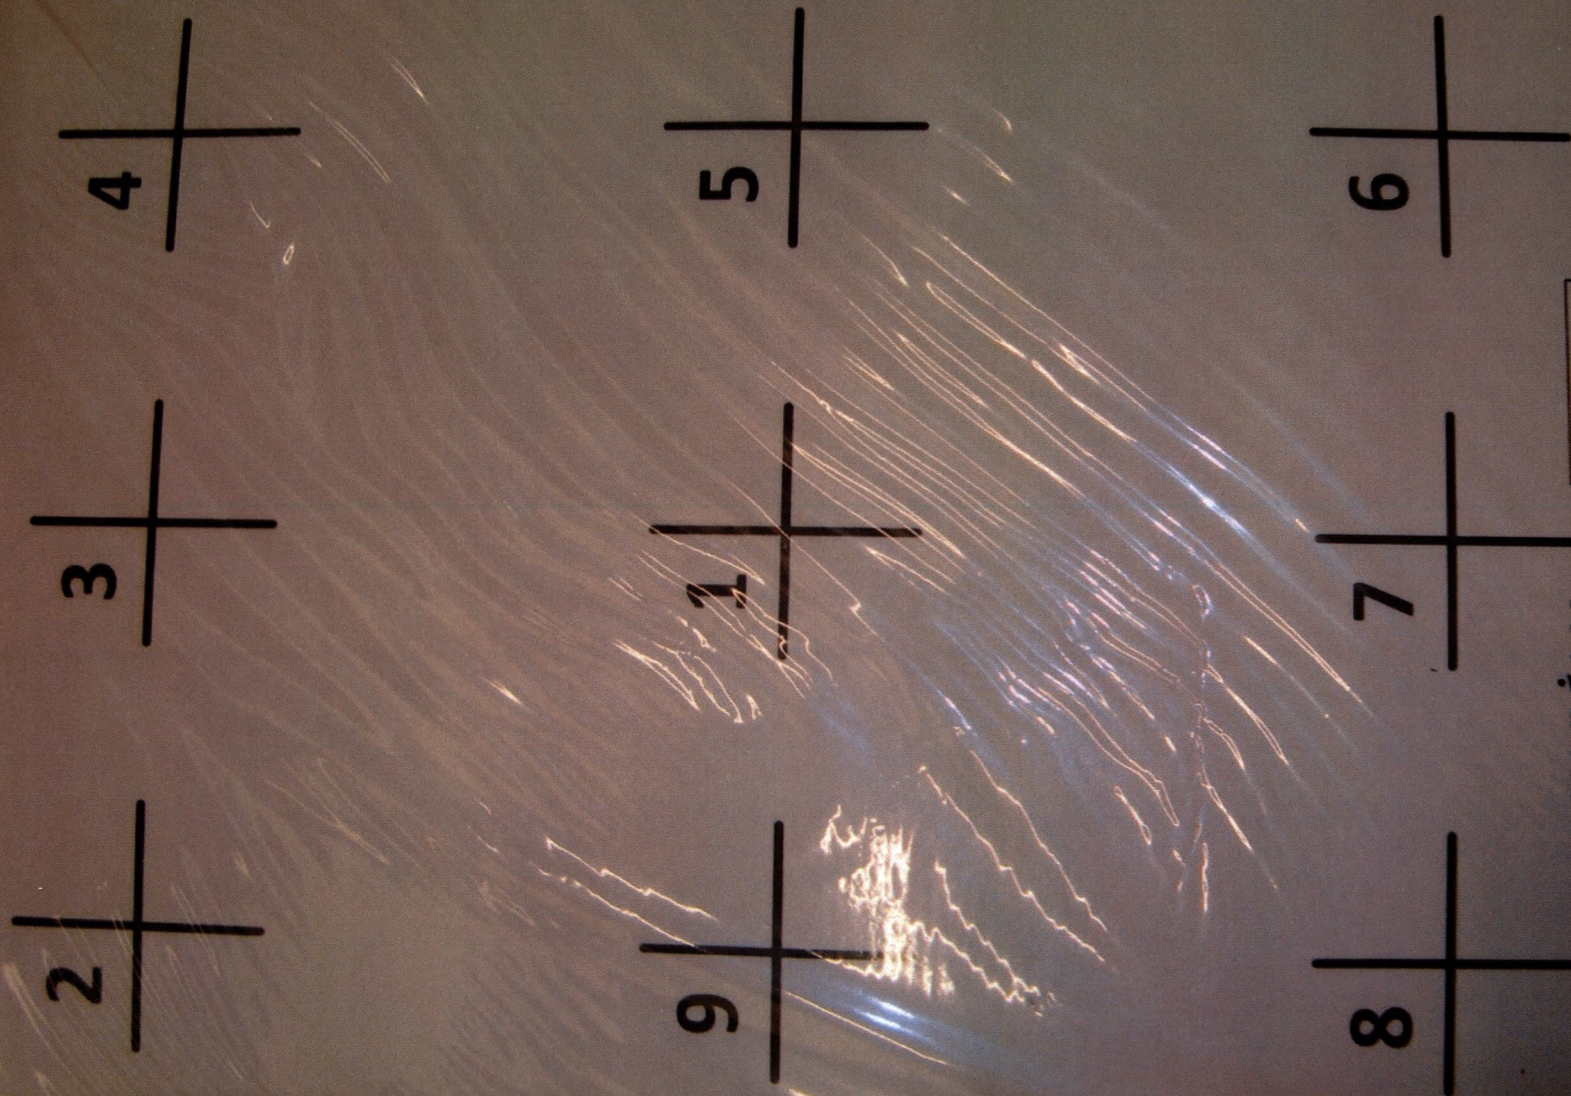

46. Пластина для калибровки камеры.




5. Блок отражателей

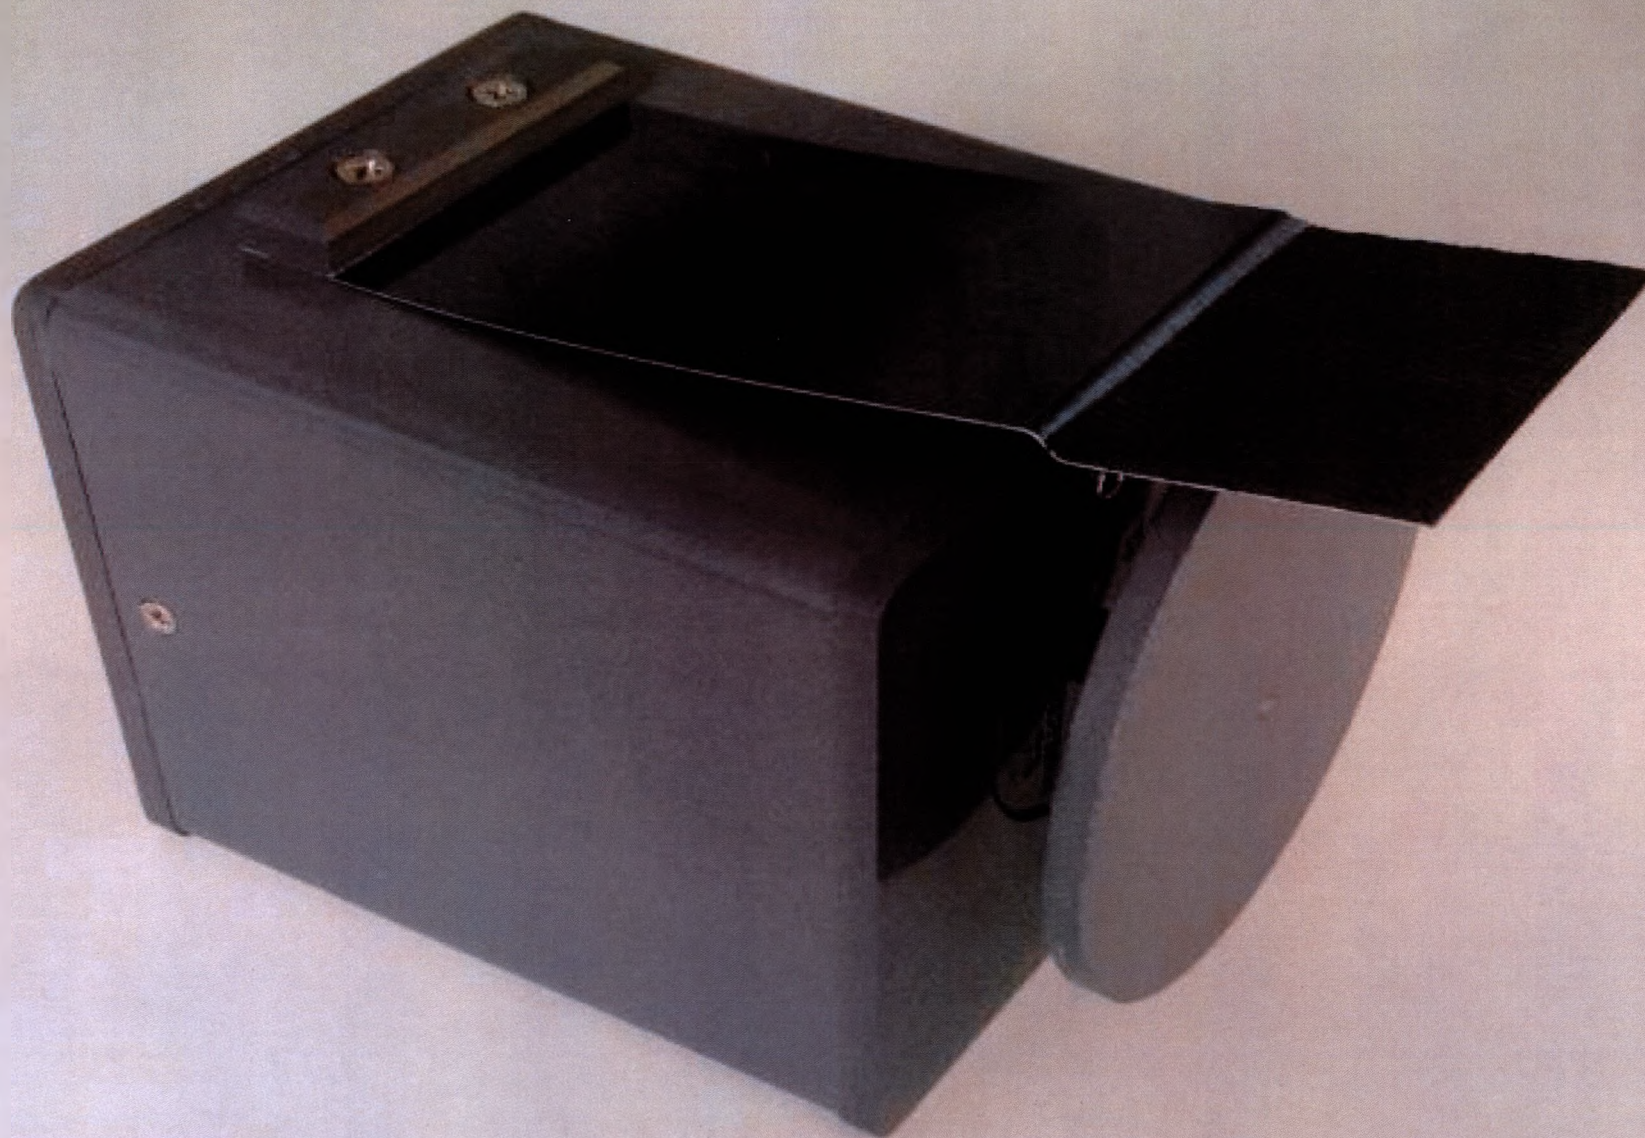


6. Фантом респираторный.




66. *Фантом респираторный.*

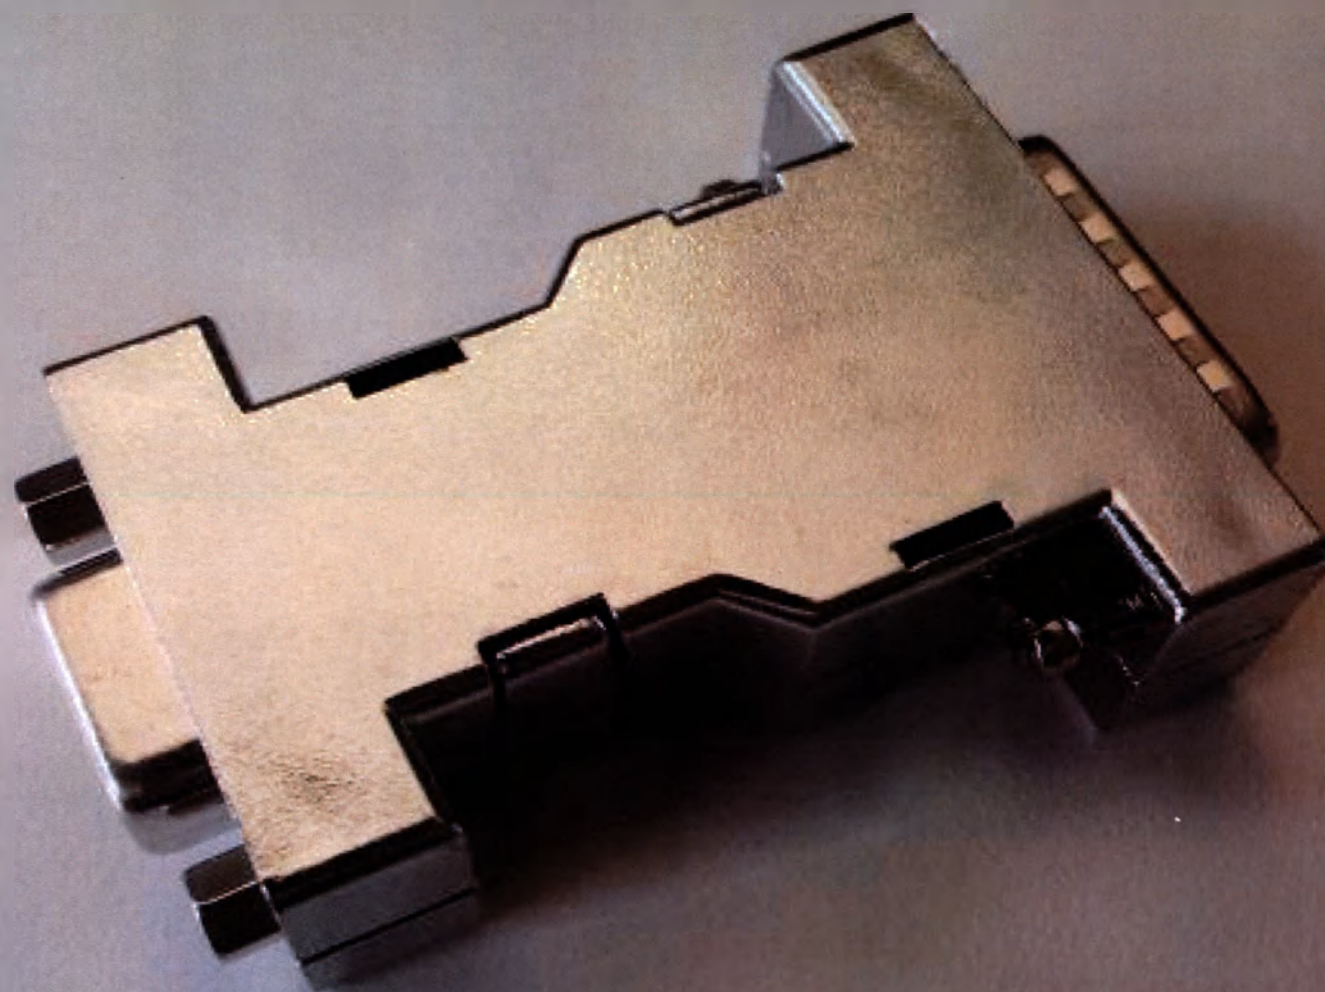

7. Адаптер RGSC-RPM Adapter неизолированный.

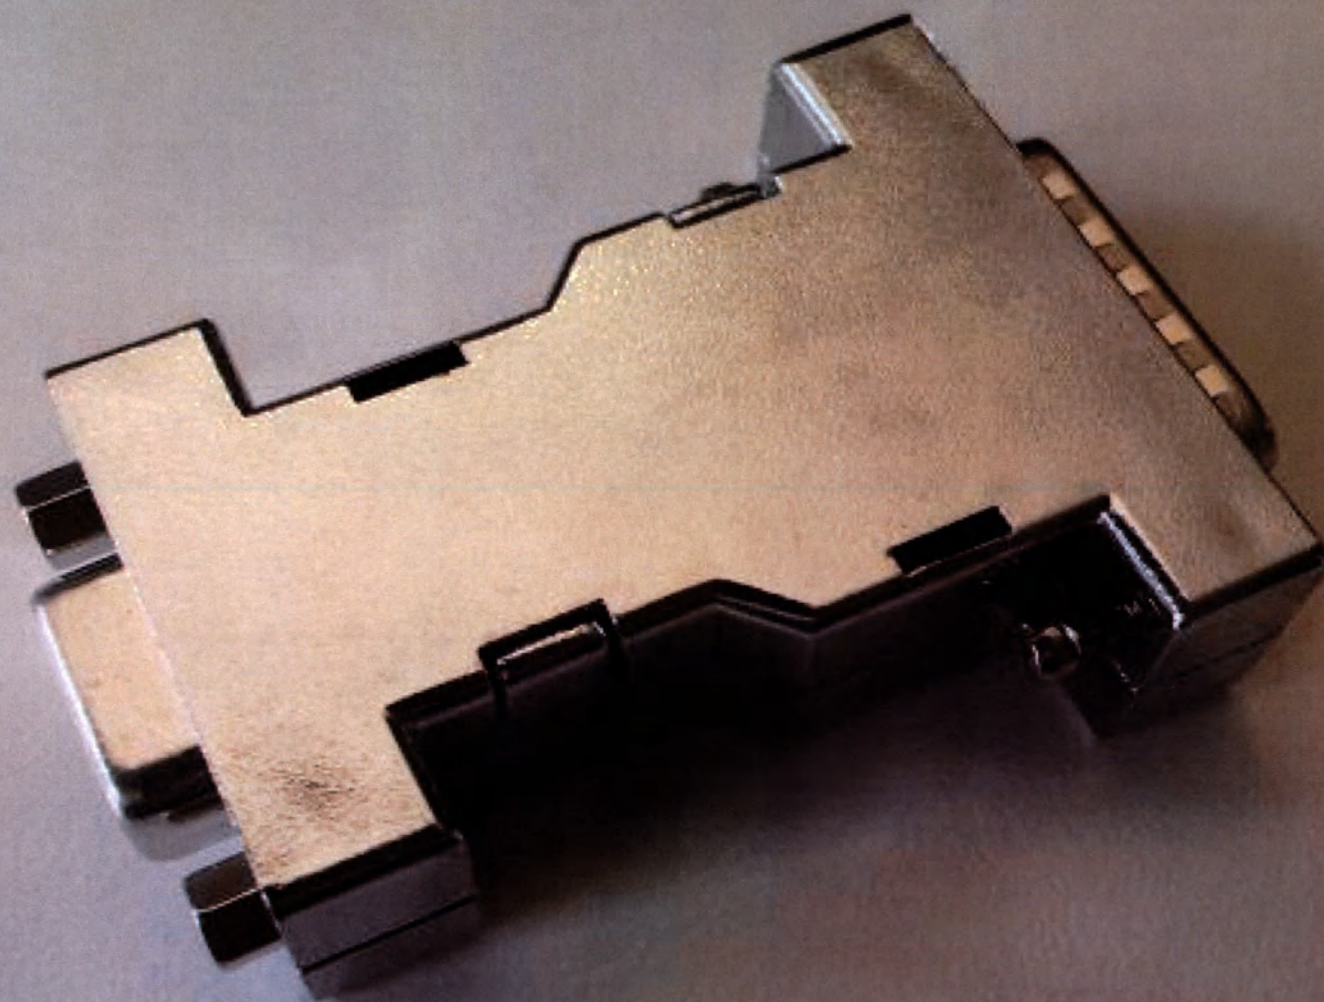

8. Адаптер RGSC-RPM неизолированный XD.

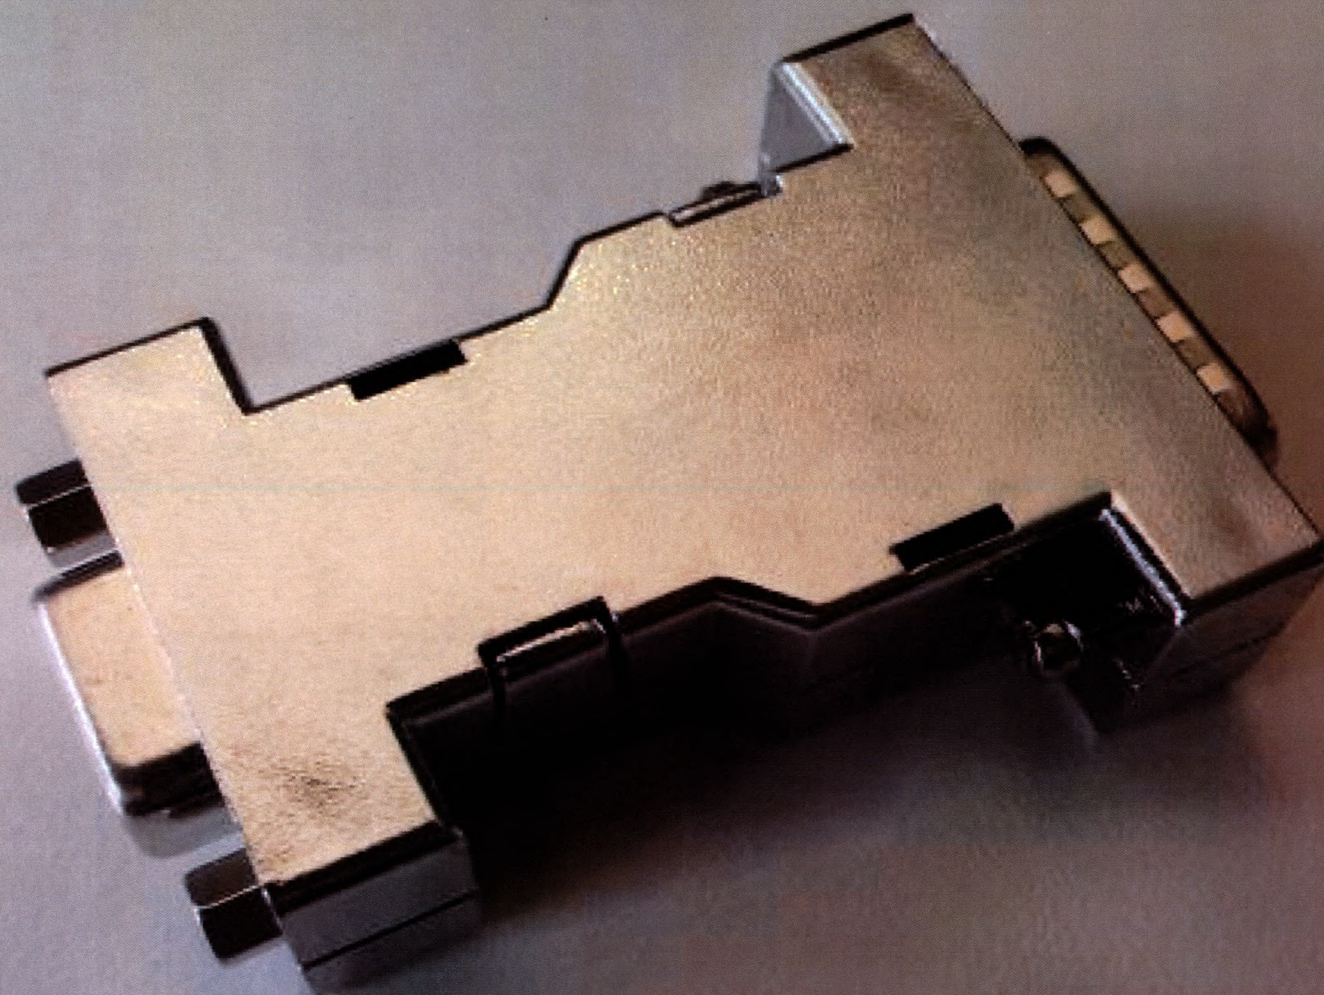


9. Адаптер RGSC-RPM изолированный.




10. Мышь оптическая. USB.

Leading the Way in Cancer Therapy

VARIAN
medical systems

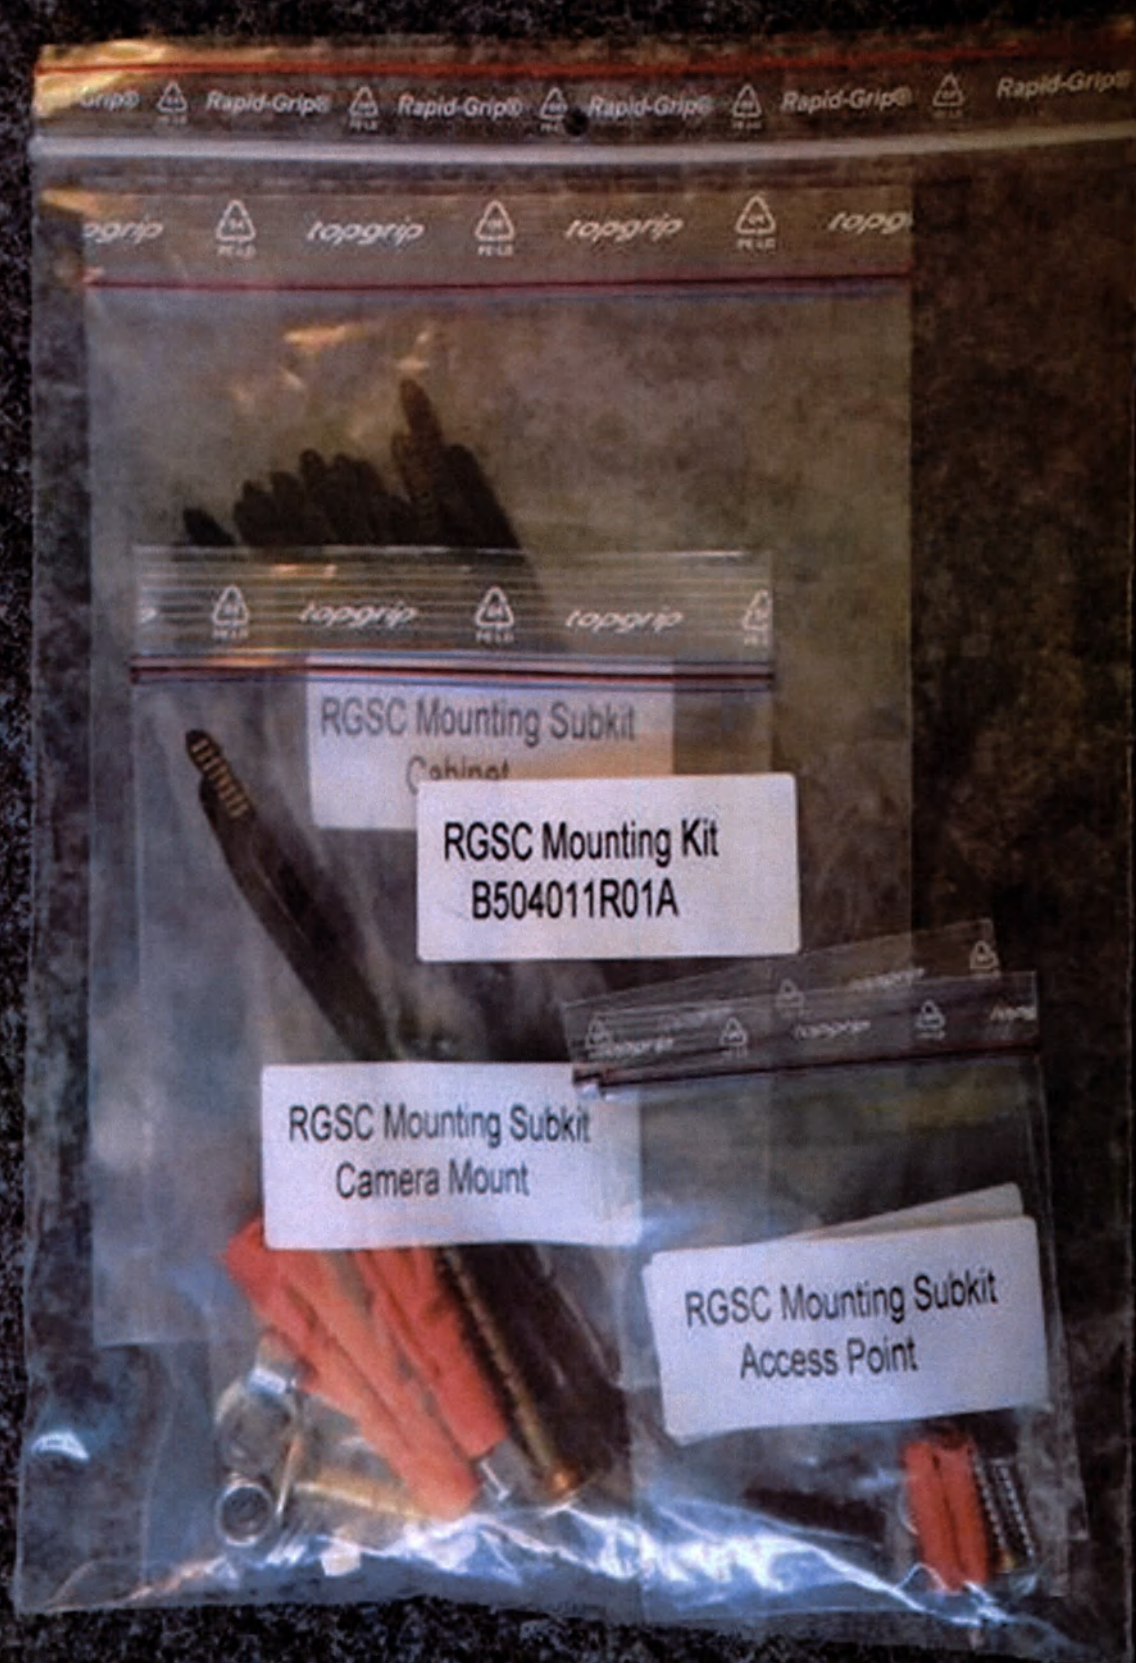

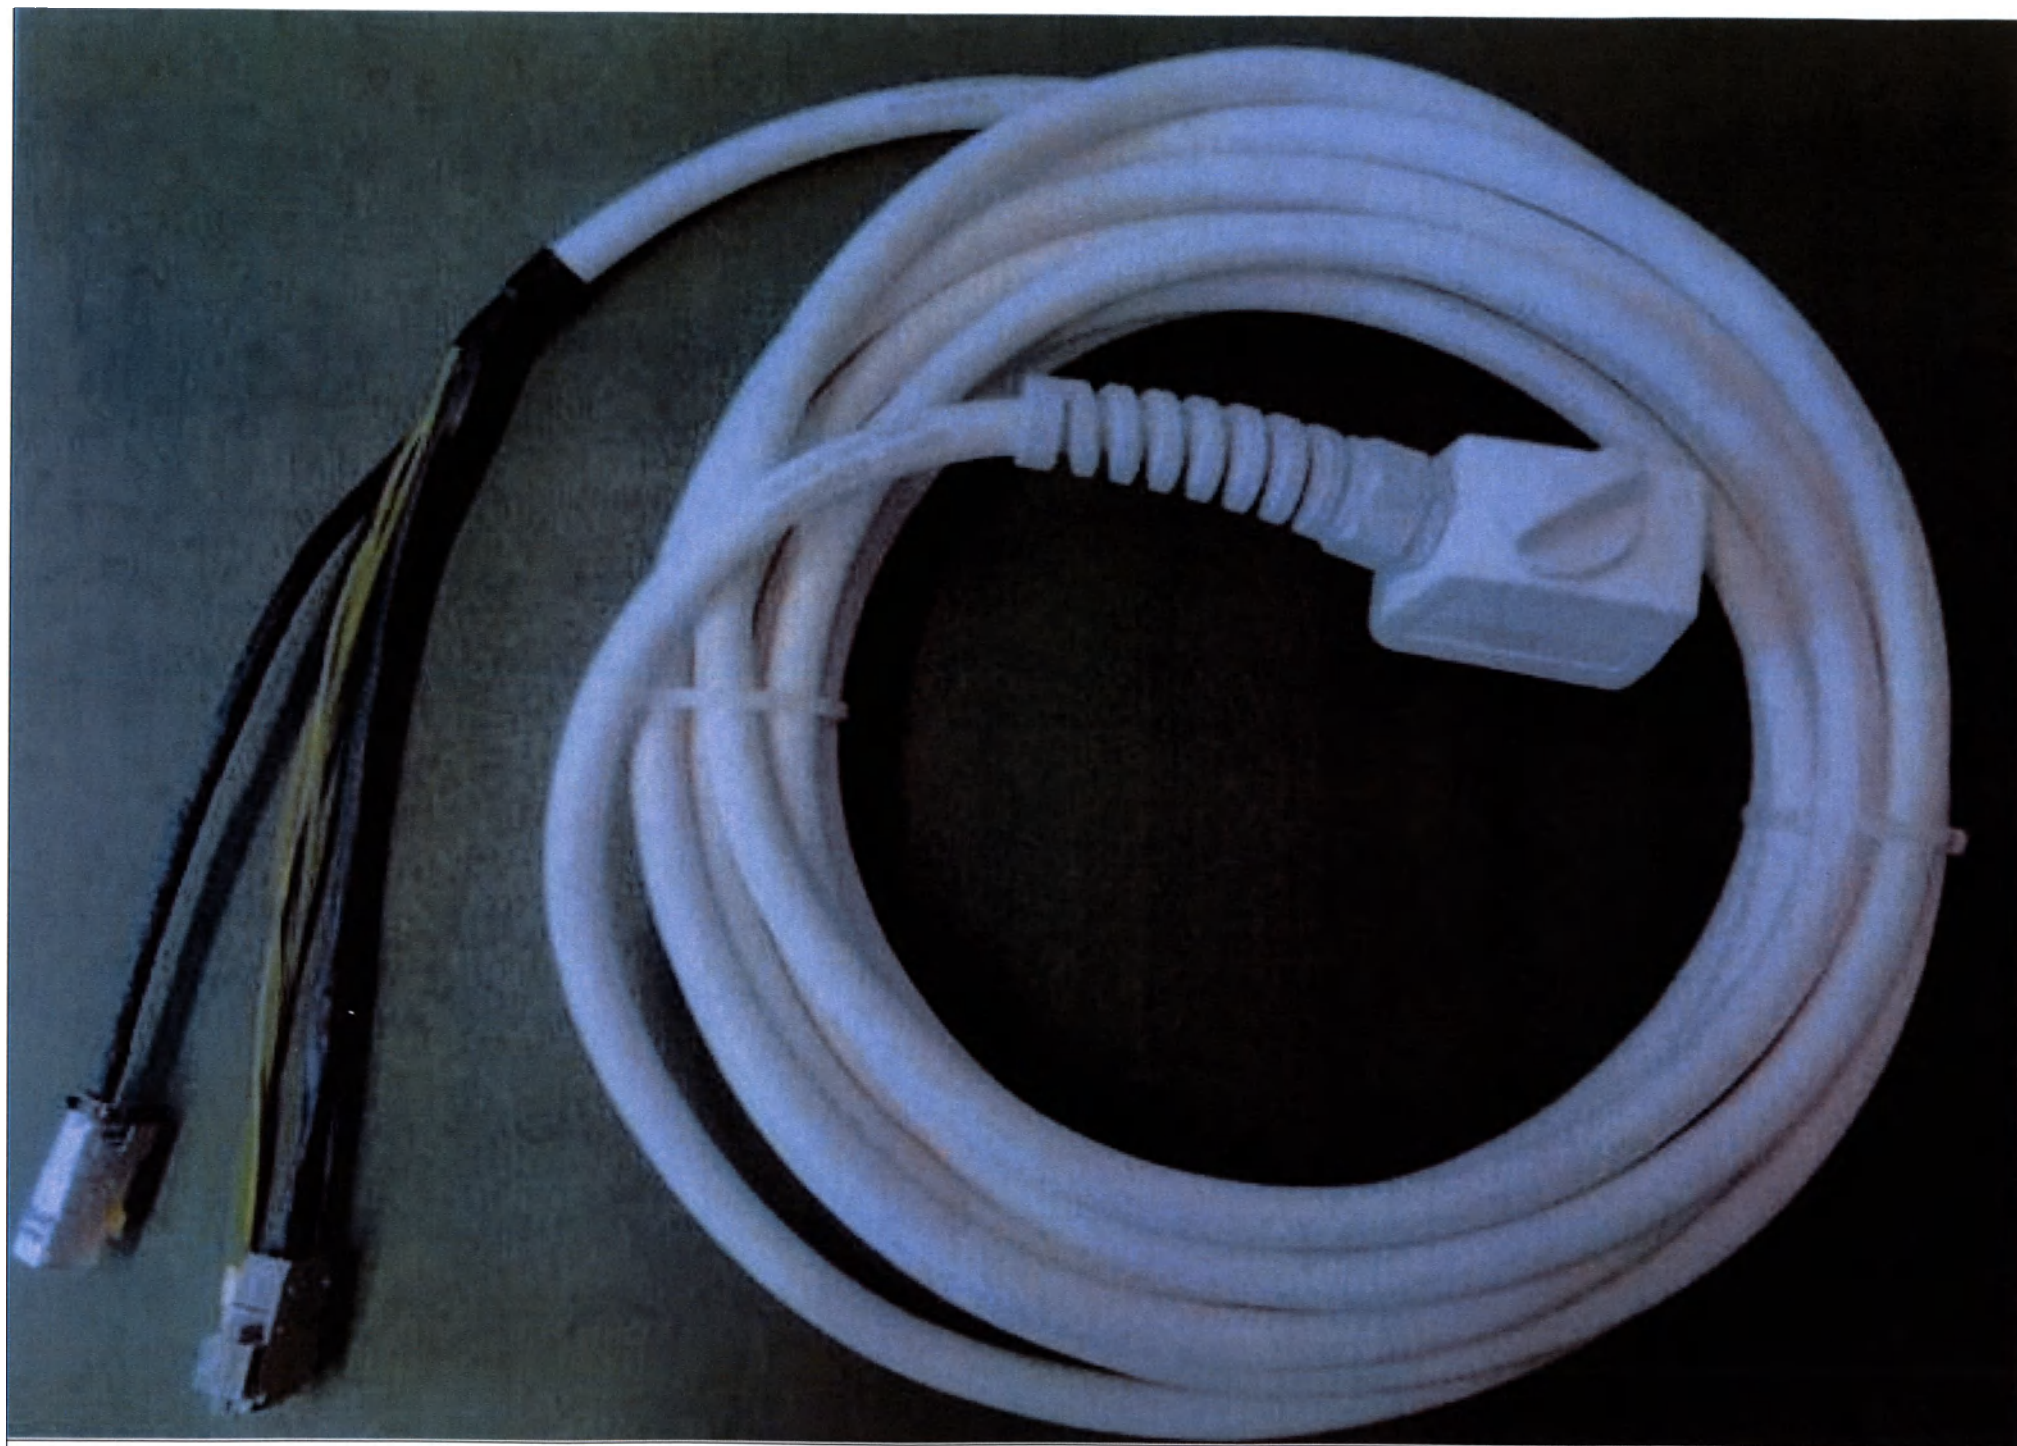


13. Кабель, длиной 10 м.



14а. Камера с объективом 25 мм.



146. Камера с объективом 25 мм.

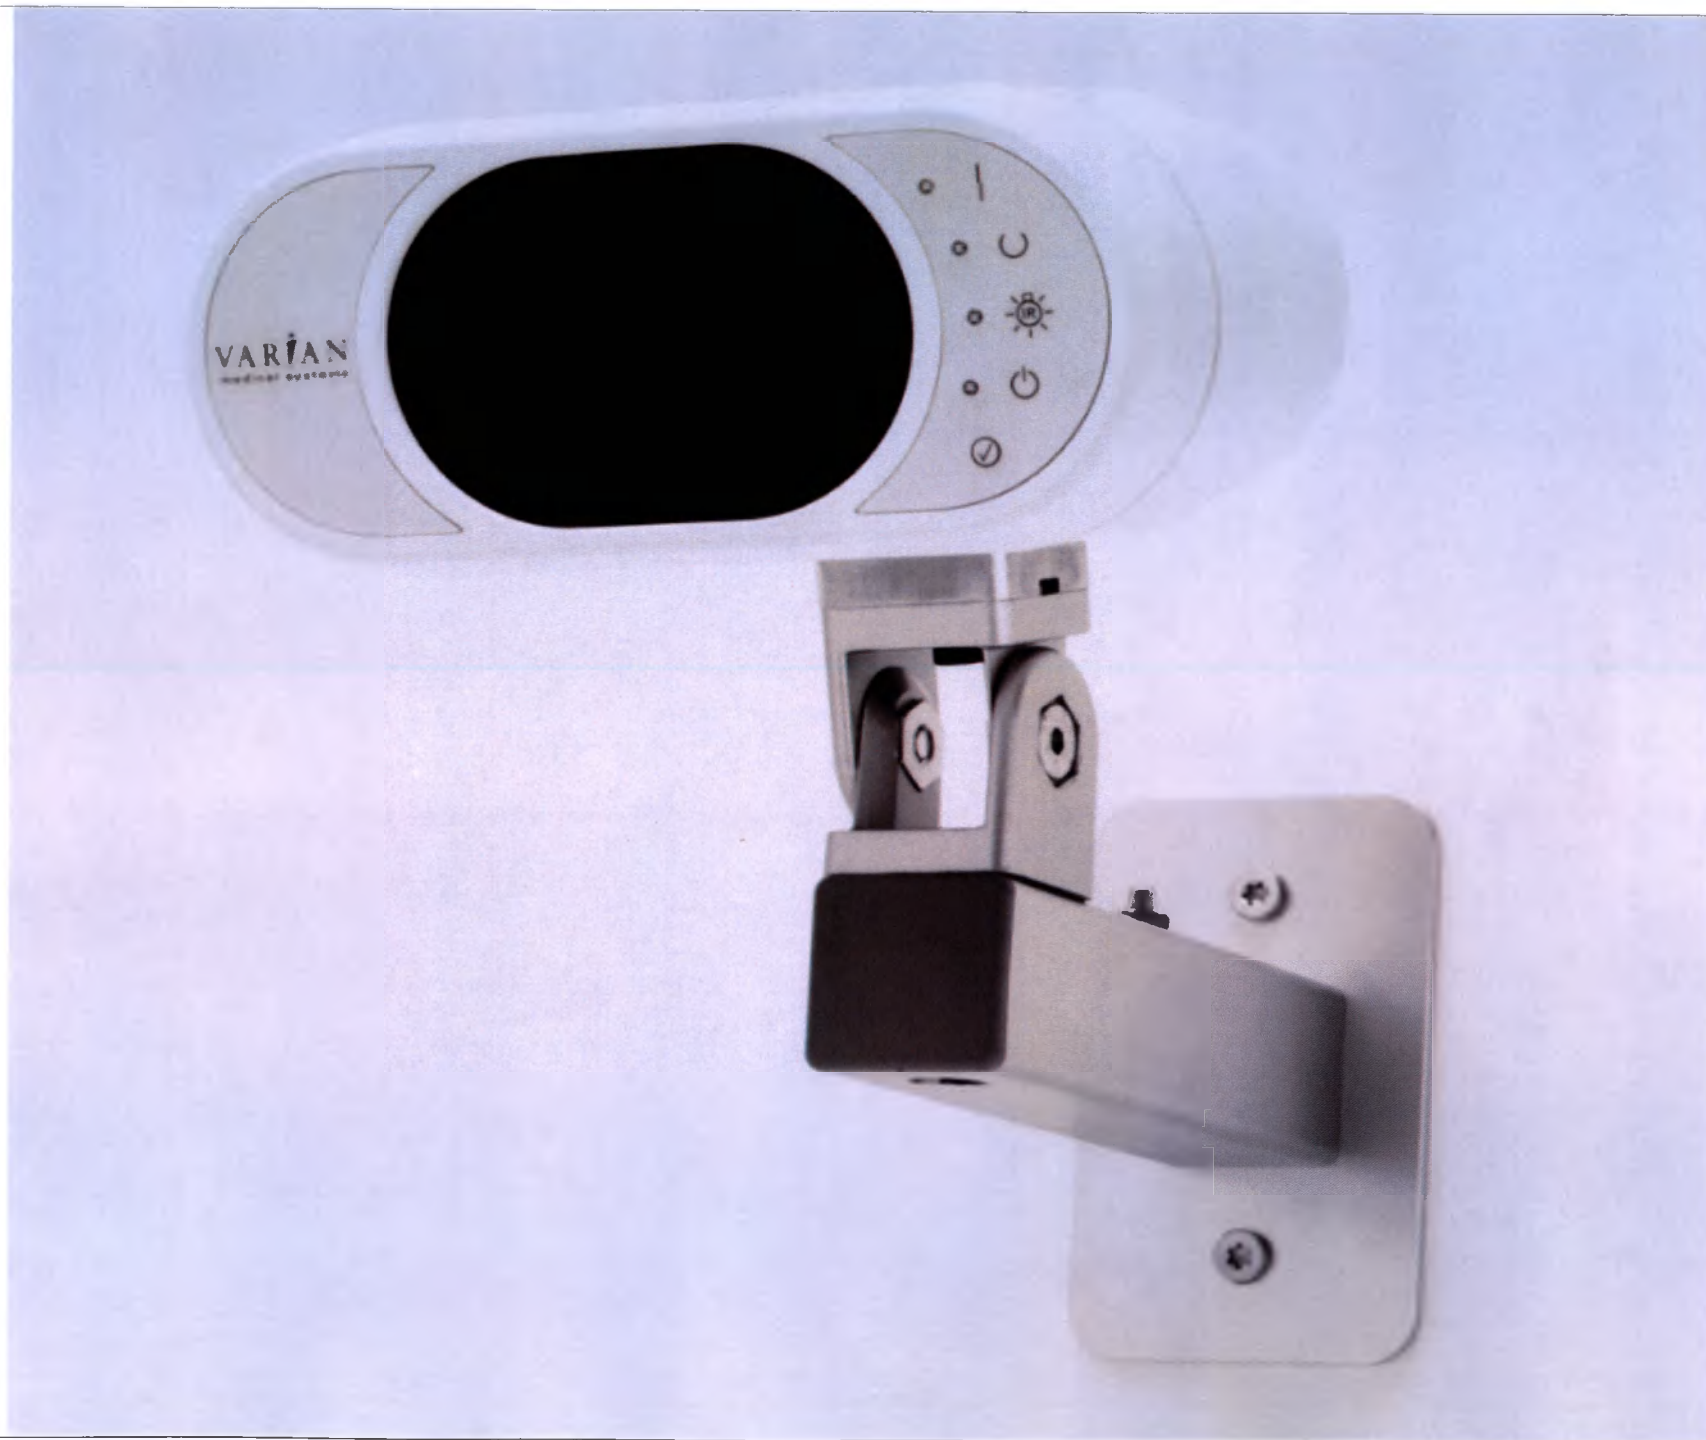

14в. Камера с объективом 25 мм.



14.1a Крепление для камеры настенное.



14.16 Крепление для камеры настенное.



14.2a Крепление для камеры потолочное.

VARIAN
medical systems

Camera Ceiling Mount

Part No.: P1011904001B


14 26 Кронштейн для камеры потолочное.

Varian Medical Systems
P1013126002C
Couch Mount Installation Kit;
for Stand


Varian Medical Systems
P1013126001C
Couch Mount Installations Kit;
for Dockong Plate



156. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.

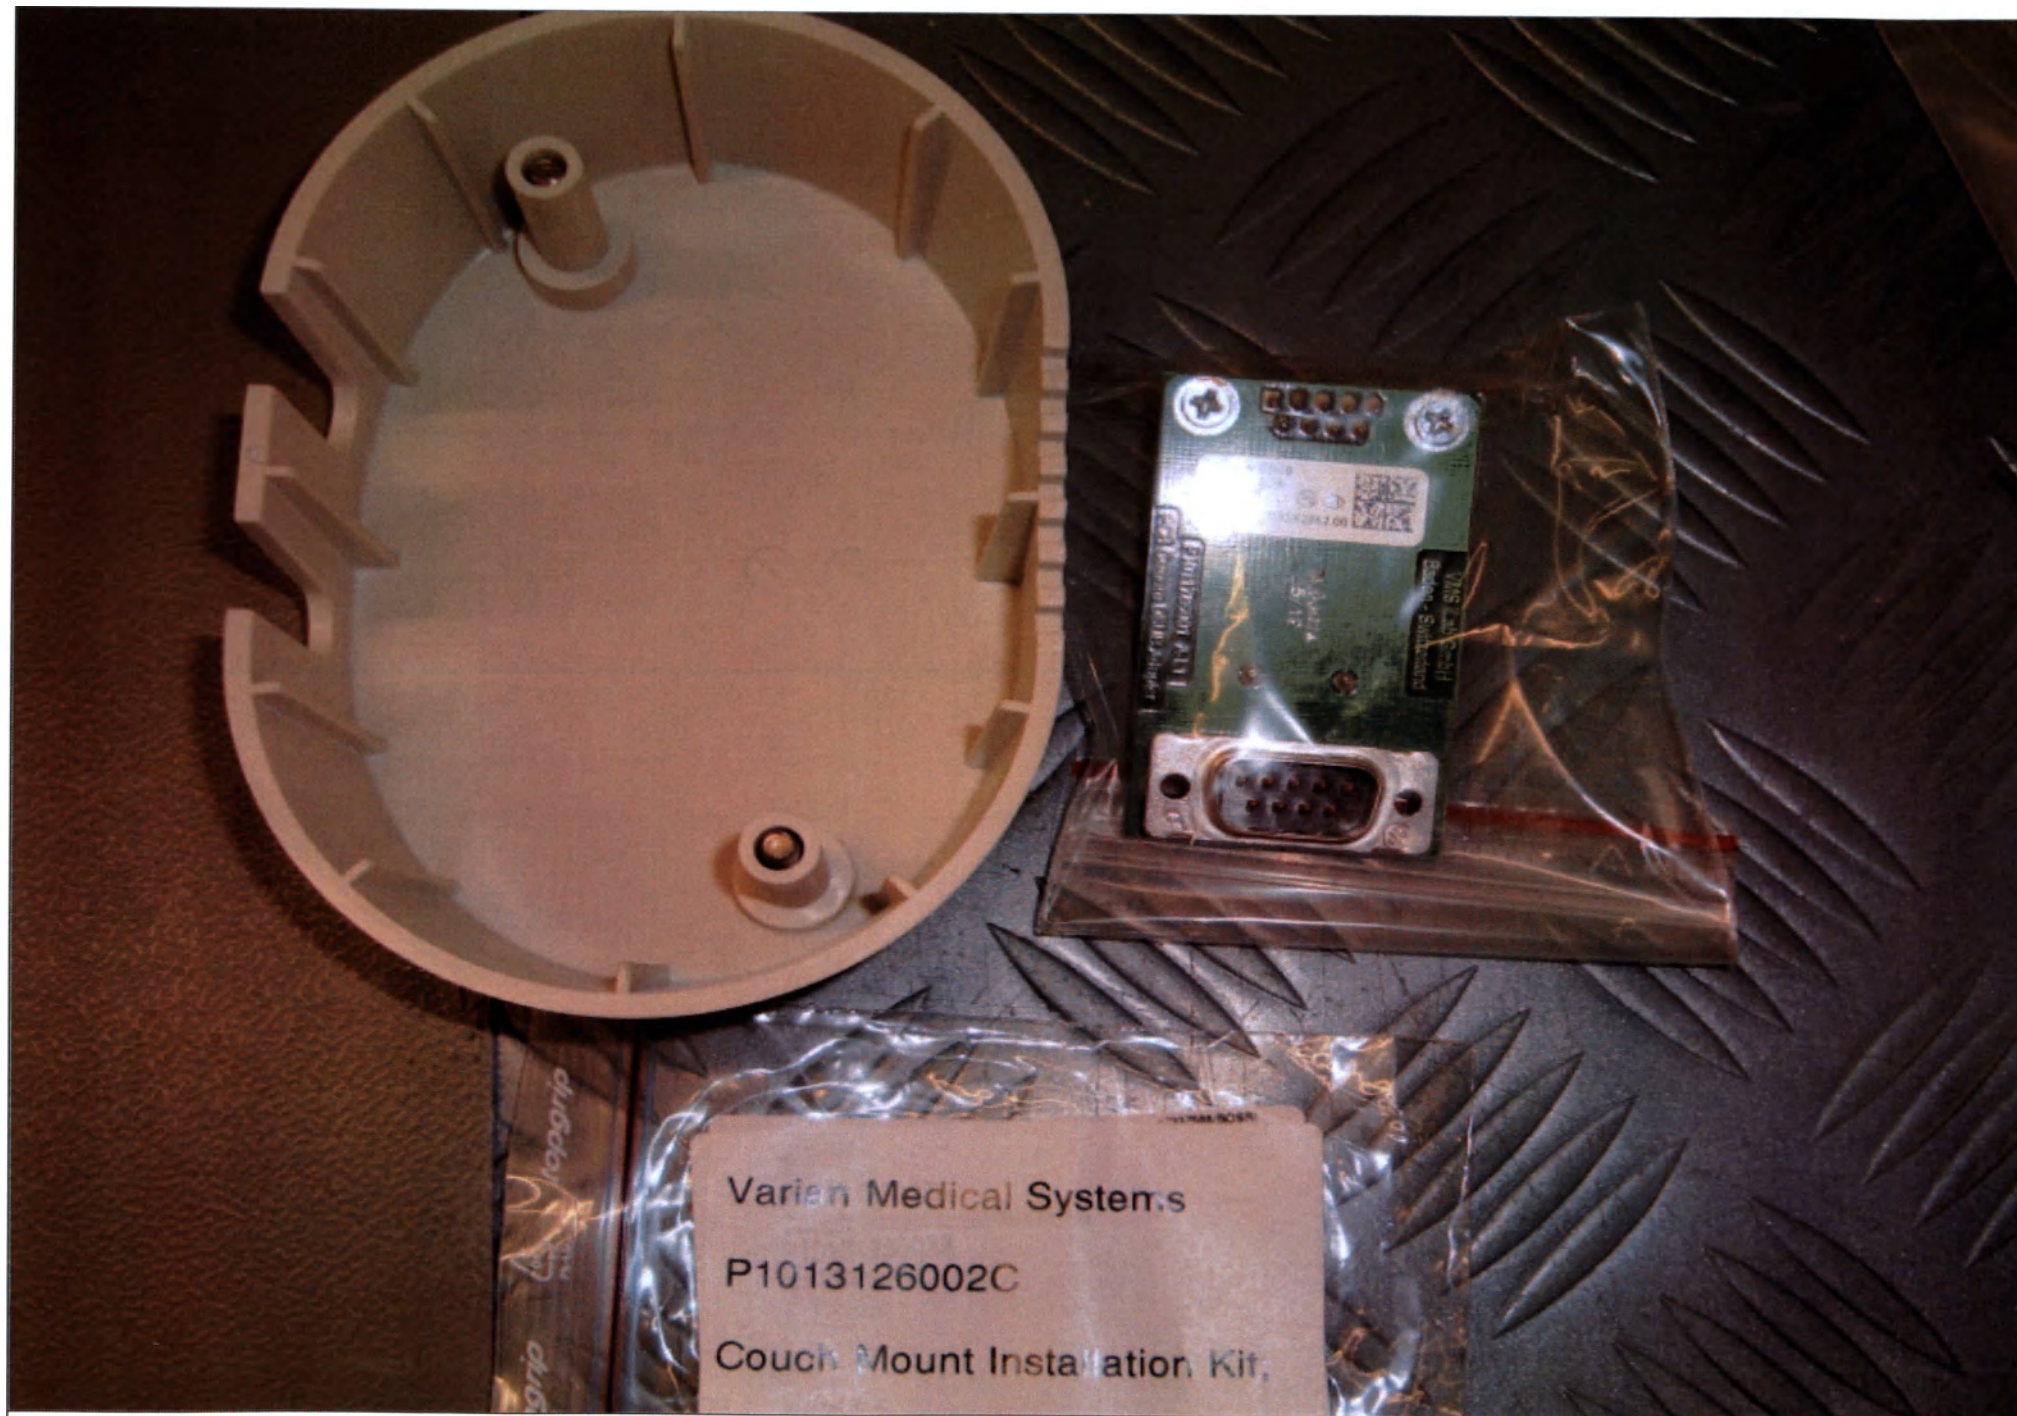

15в. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.

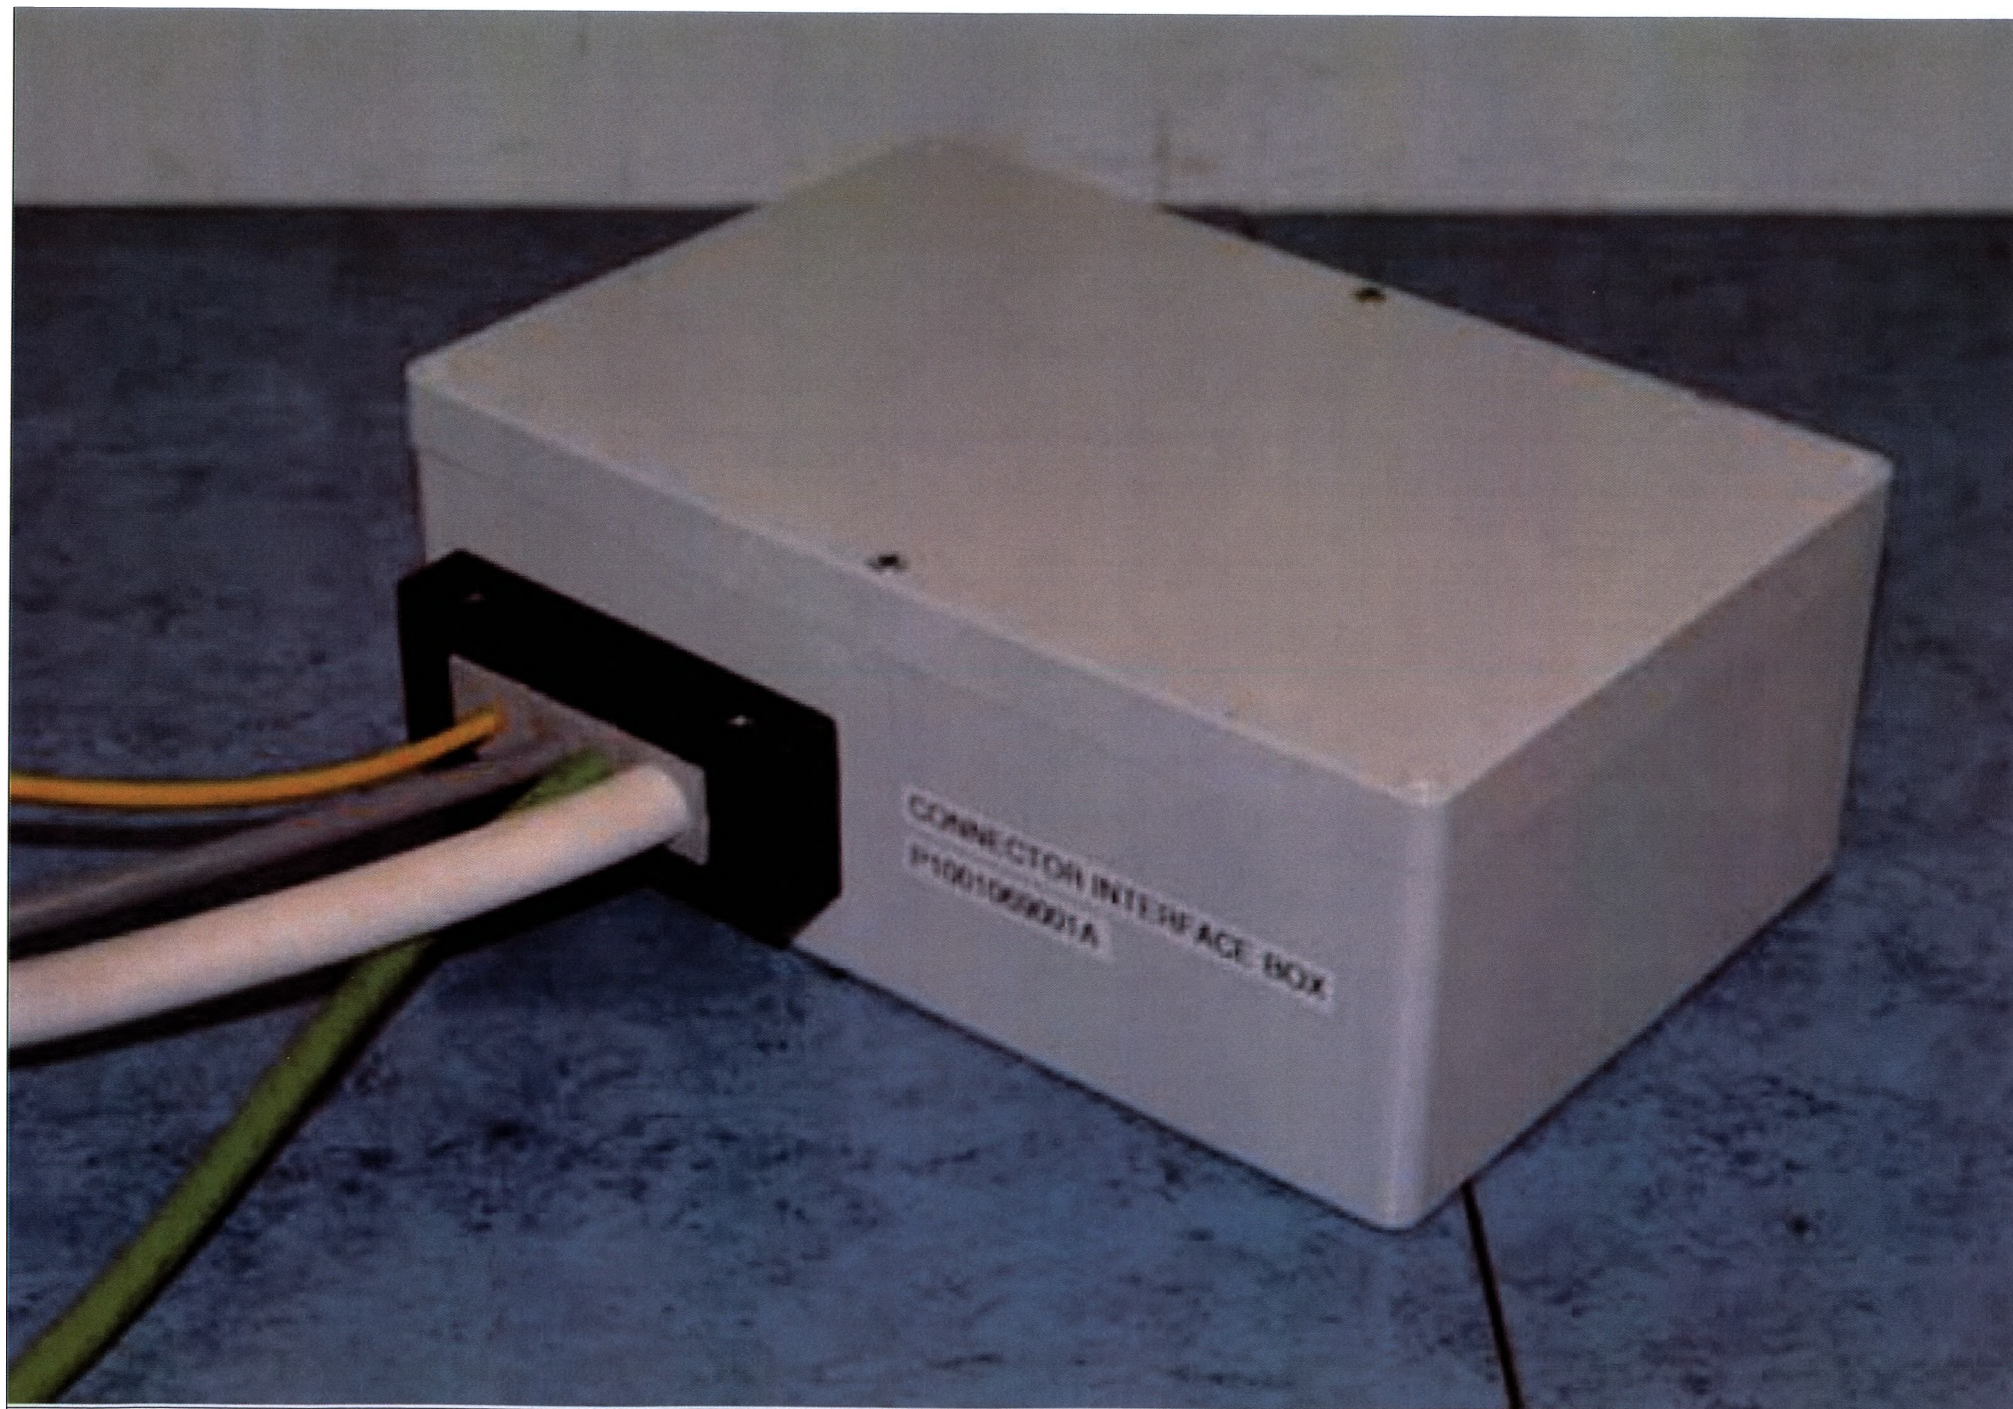

15г. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



15д. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



15е. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



15ж. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



15з. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



15и. Комплект для установки камеры на стене/потолке с кабелем длиной 10 м.



Varian Medical Systems

Camera Cable, L = 10 m
P1012814002A

1 Stück



VARIAN

medical systems


Rechargeable Li-Ion Battery

1S2P ICR18650B4

Nominal / Charge voltage: 3.6 V / 4.2 V

Energy / Capacity: 18.72 Wh / 5.2 Ah

1ICR19/65-2 Made in Germany



Don't short-circuit, disassemble or
expose the battery to fire or water.
Ne court-circuitiez pas, ne démontez
pas et n'exposez pas la batterie au
feu ou à l'eau.

Nicht kurzschliessen, nicht auseinandernehmen und nicht in Berührung
mit Feuer oder Wasser bringen.

VCD Battery Pack
B503323R01A
1336024




3128216

CONFORMS TO
IEC STD 62133






16. Набор устройства *Visual Coaching Device (VCD)* без крепления на кушетку: Батарея аккумулятора; Устройство *Visual Coaching Device (VCD)*; Зарядная станция; Точка беспроводного доступа.

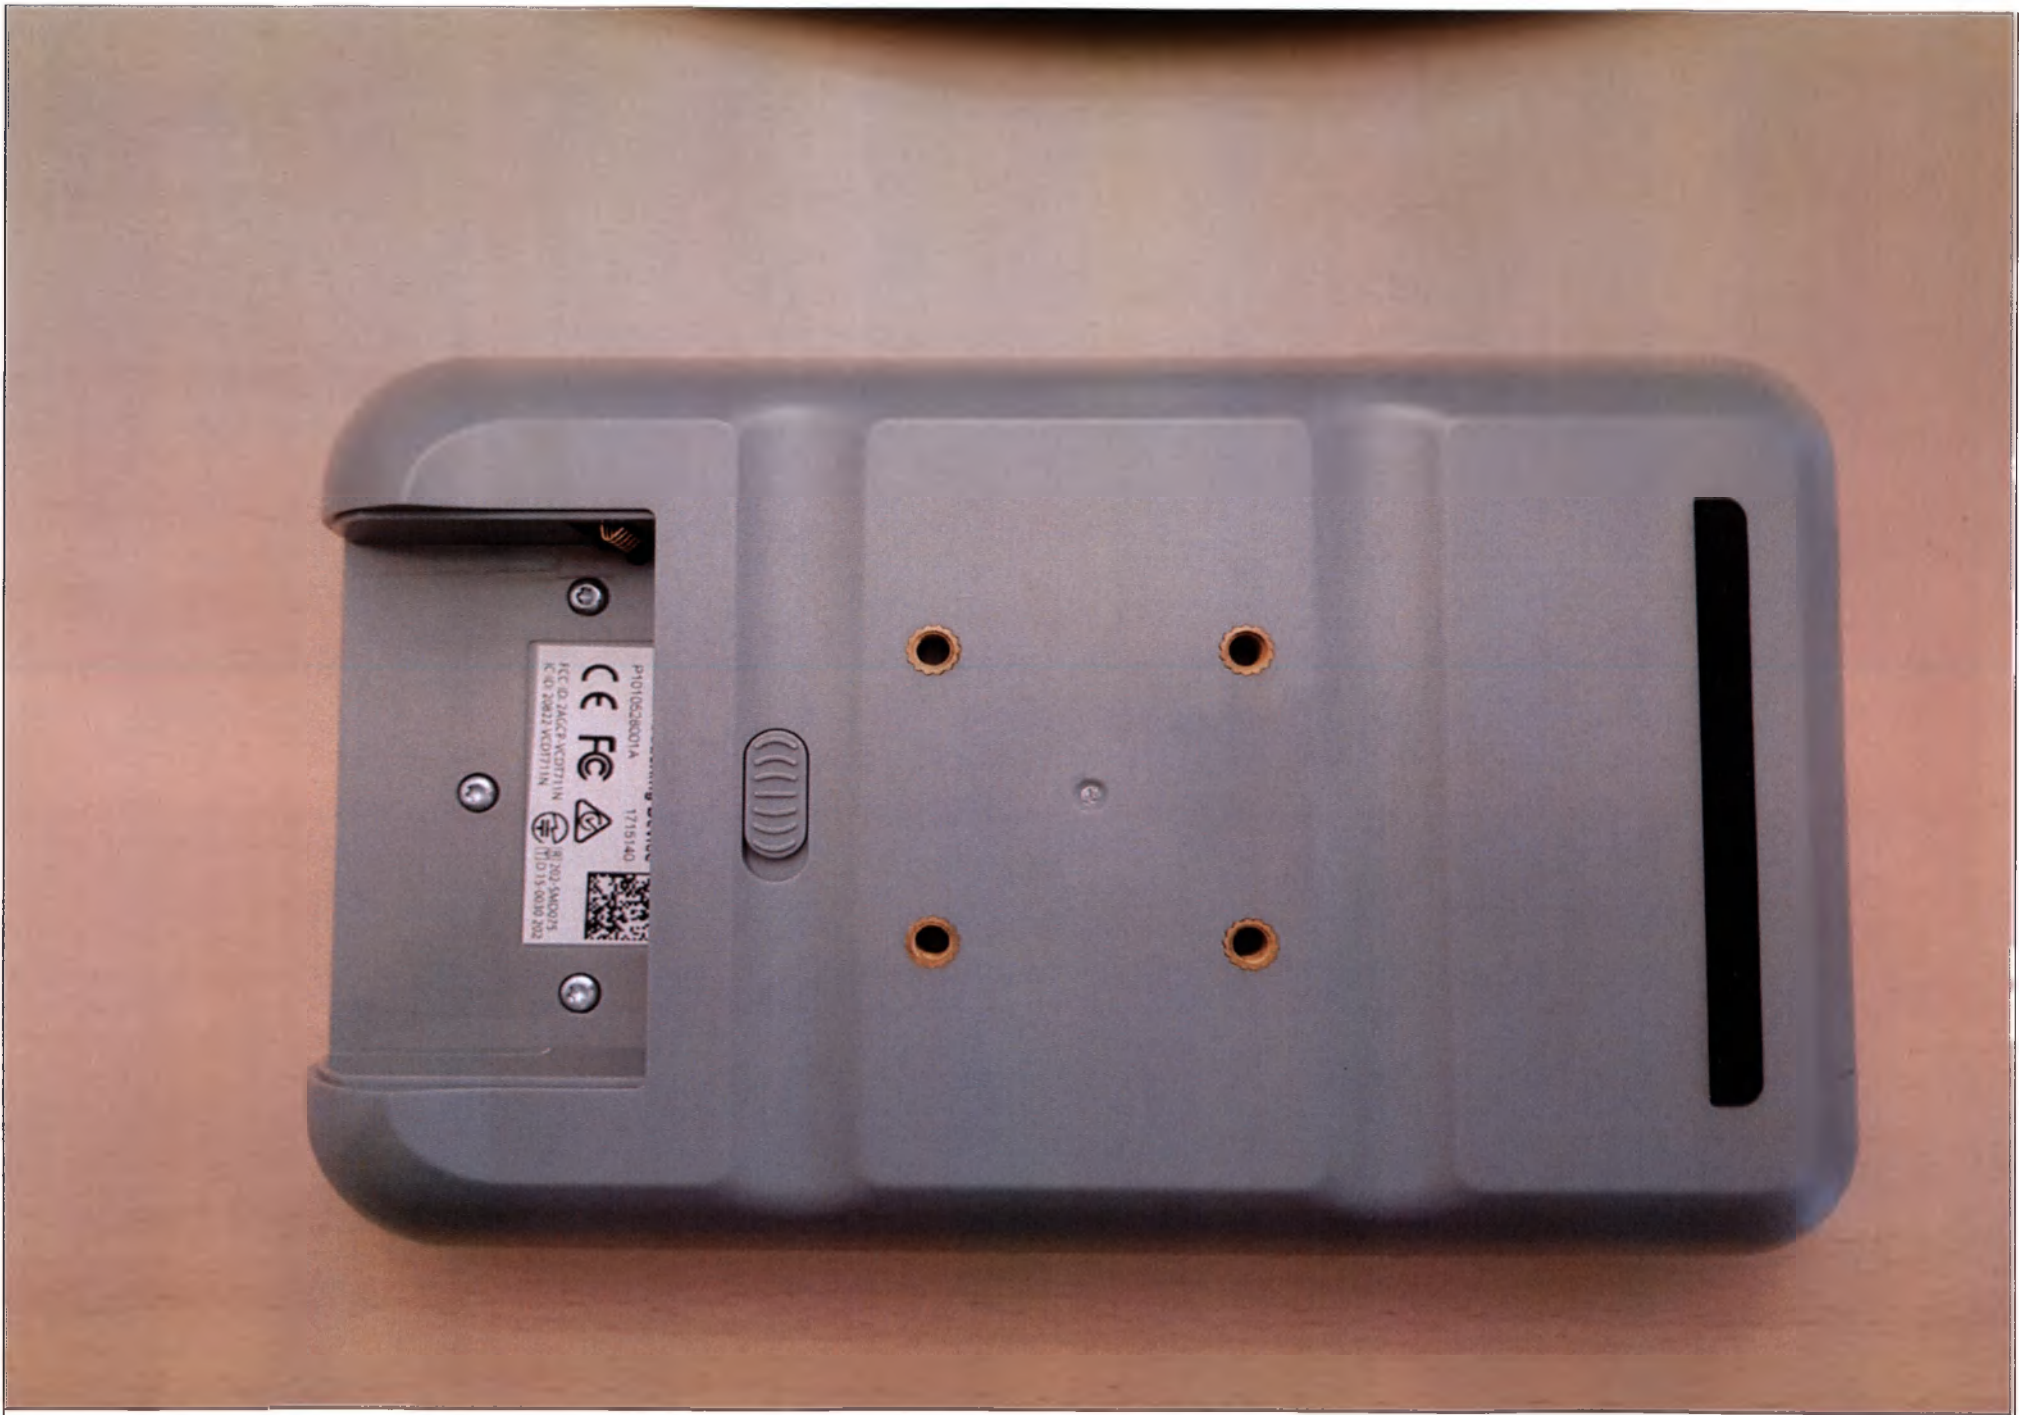

16. Набор устройства Visual Coaching Device (VCD) без крепления на кушетку: Батарея аккумулятора; Устройство Visual Coaching Device (VCD); Запядная станция; Точка беспроводного доступа.




12. Набор устройства Visual Coaching Device (VCD) без крепления на кушетку: Батарея аккумулятора; Устройство Visual Coaching Device (VCD); Западная станция; Точка беспроводного доступа.

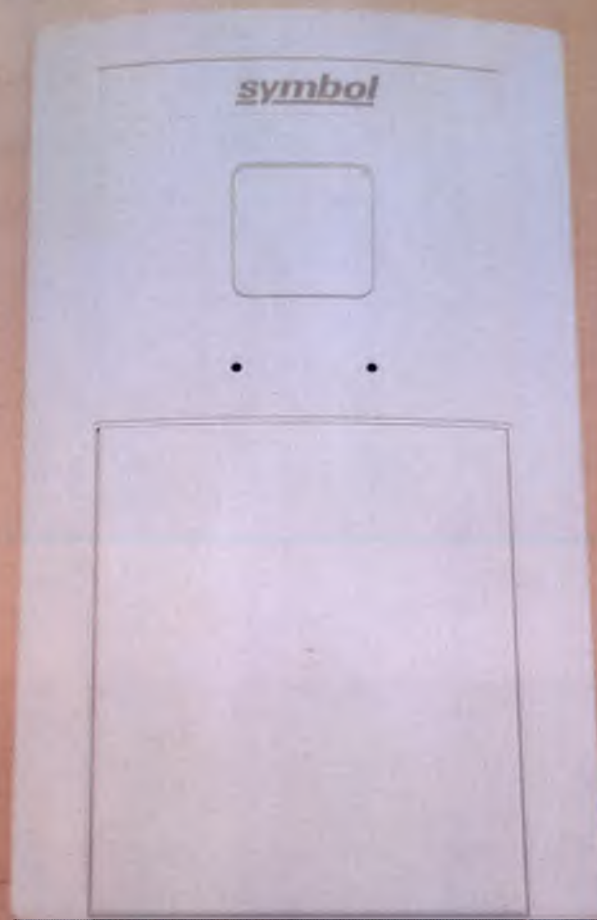


1д. Набор устройства Visual Coaching Device (VCD) без крепления на кушетку: Батарея аккумулятора; Устройство Visual Coaching Device (VCD); Зарядная станция; Точка беспроводного доступа.




2а. Штатив универсальный для установки на кушетку.

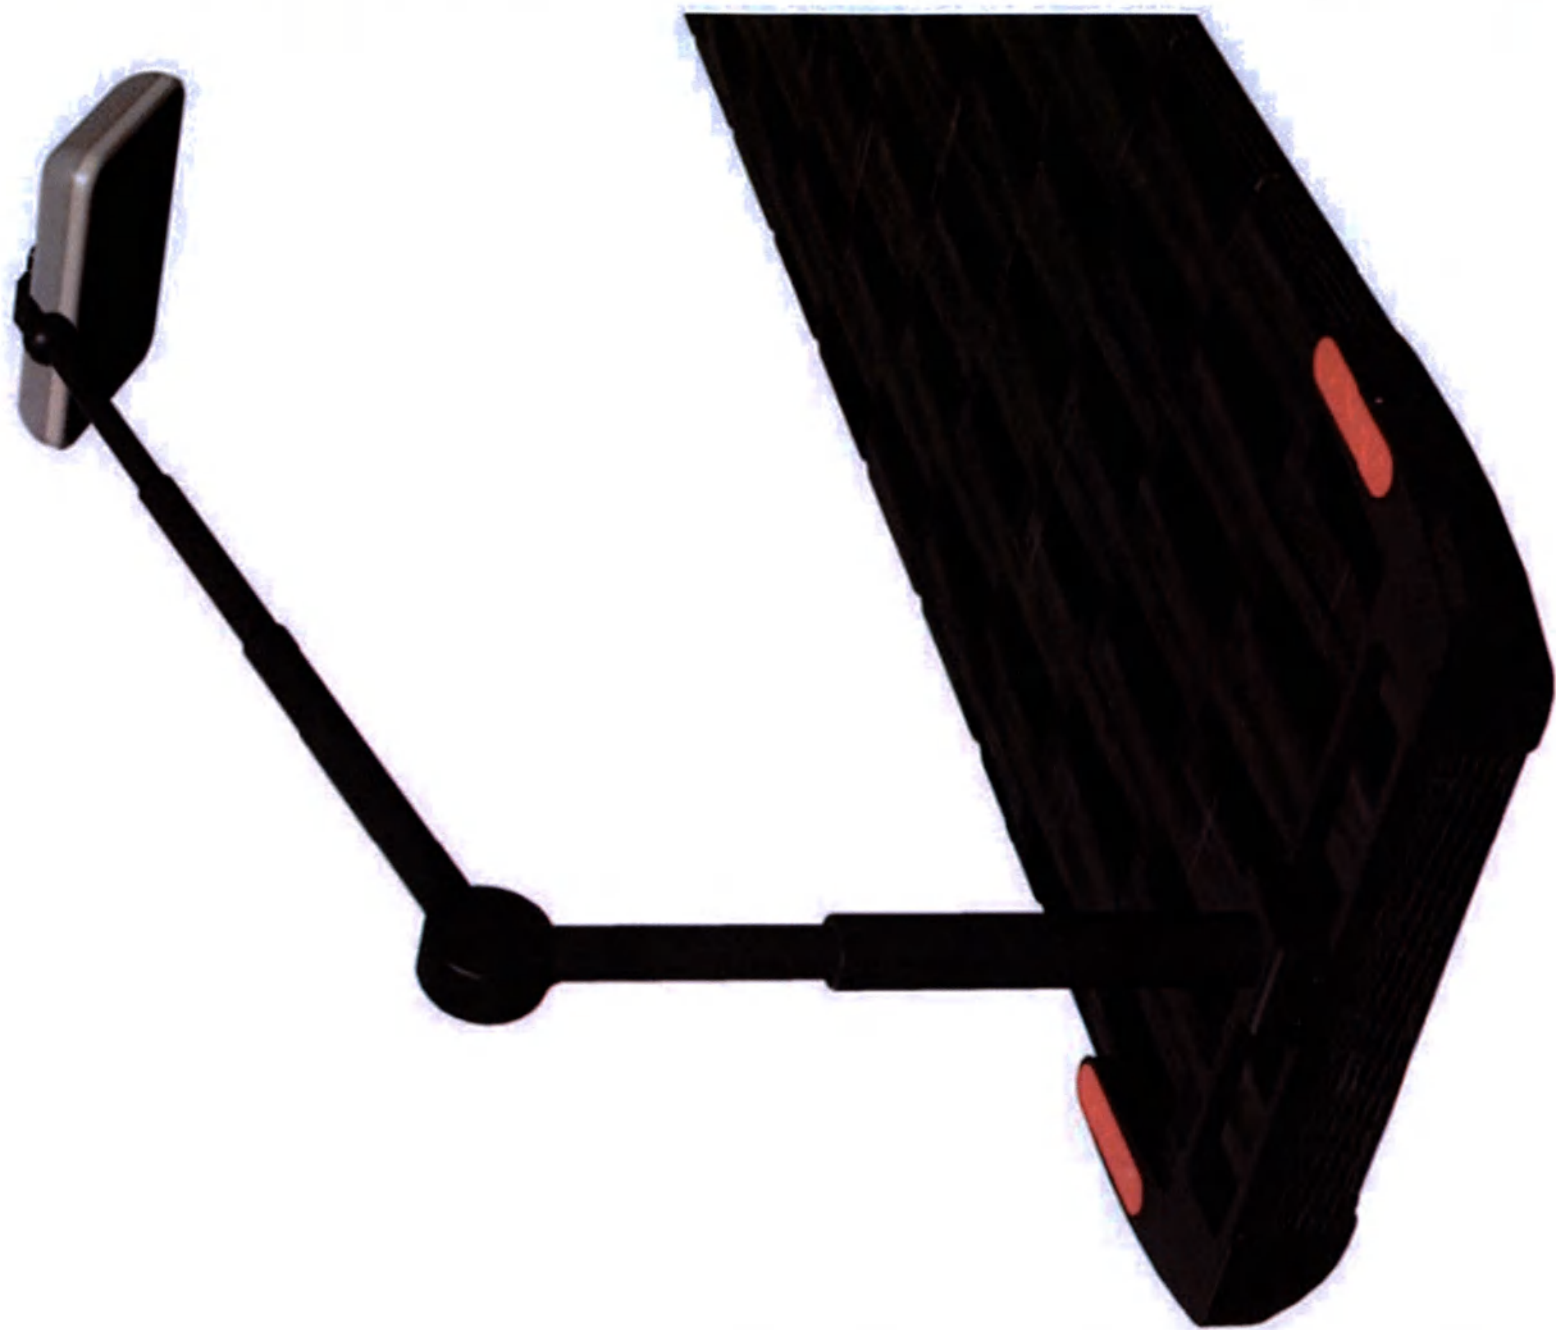


26. Штатив универсальный для установки на кушетку.

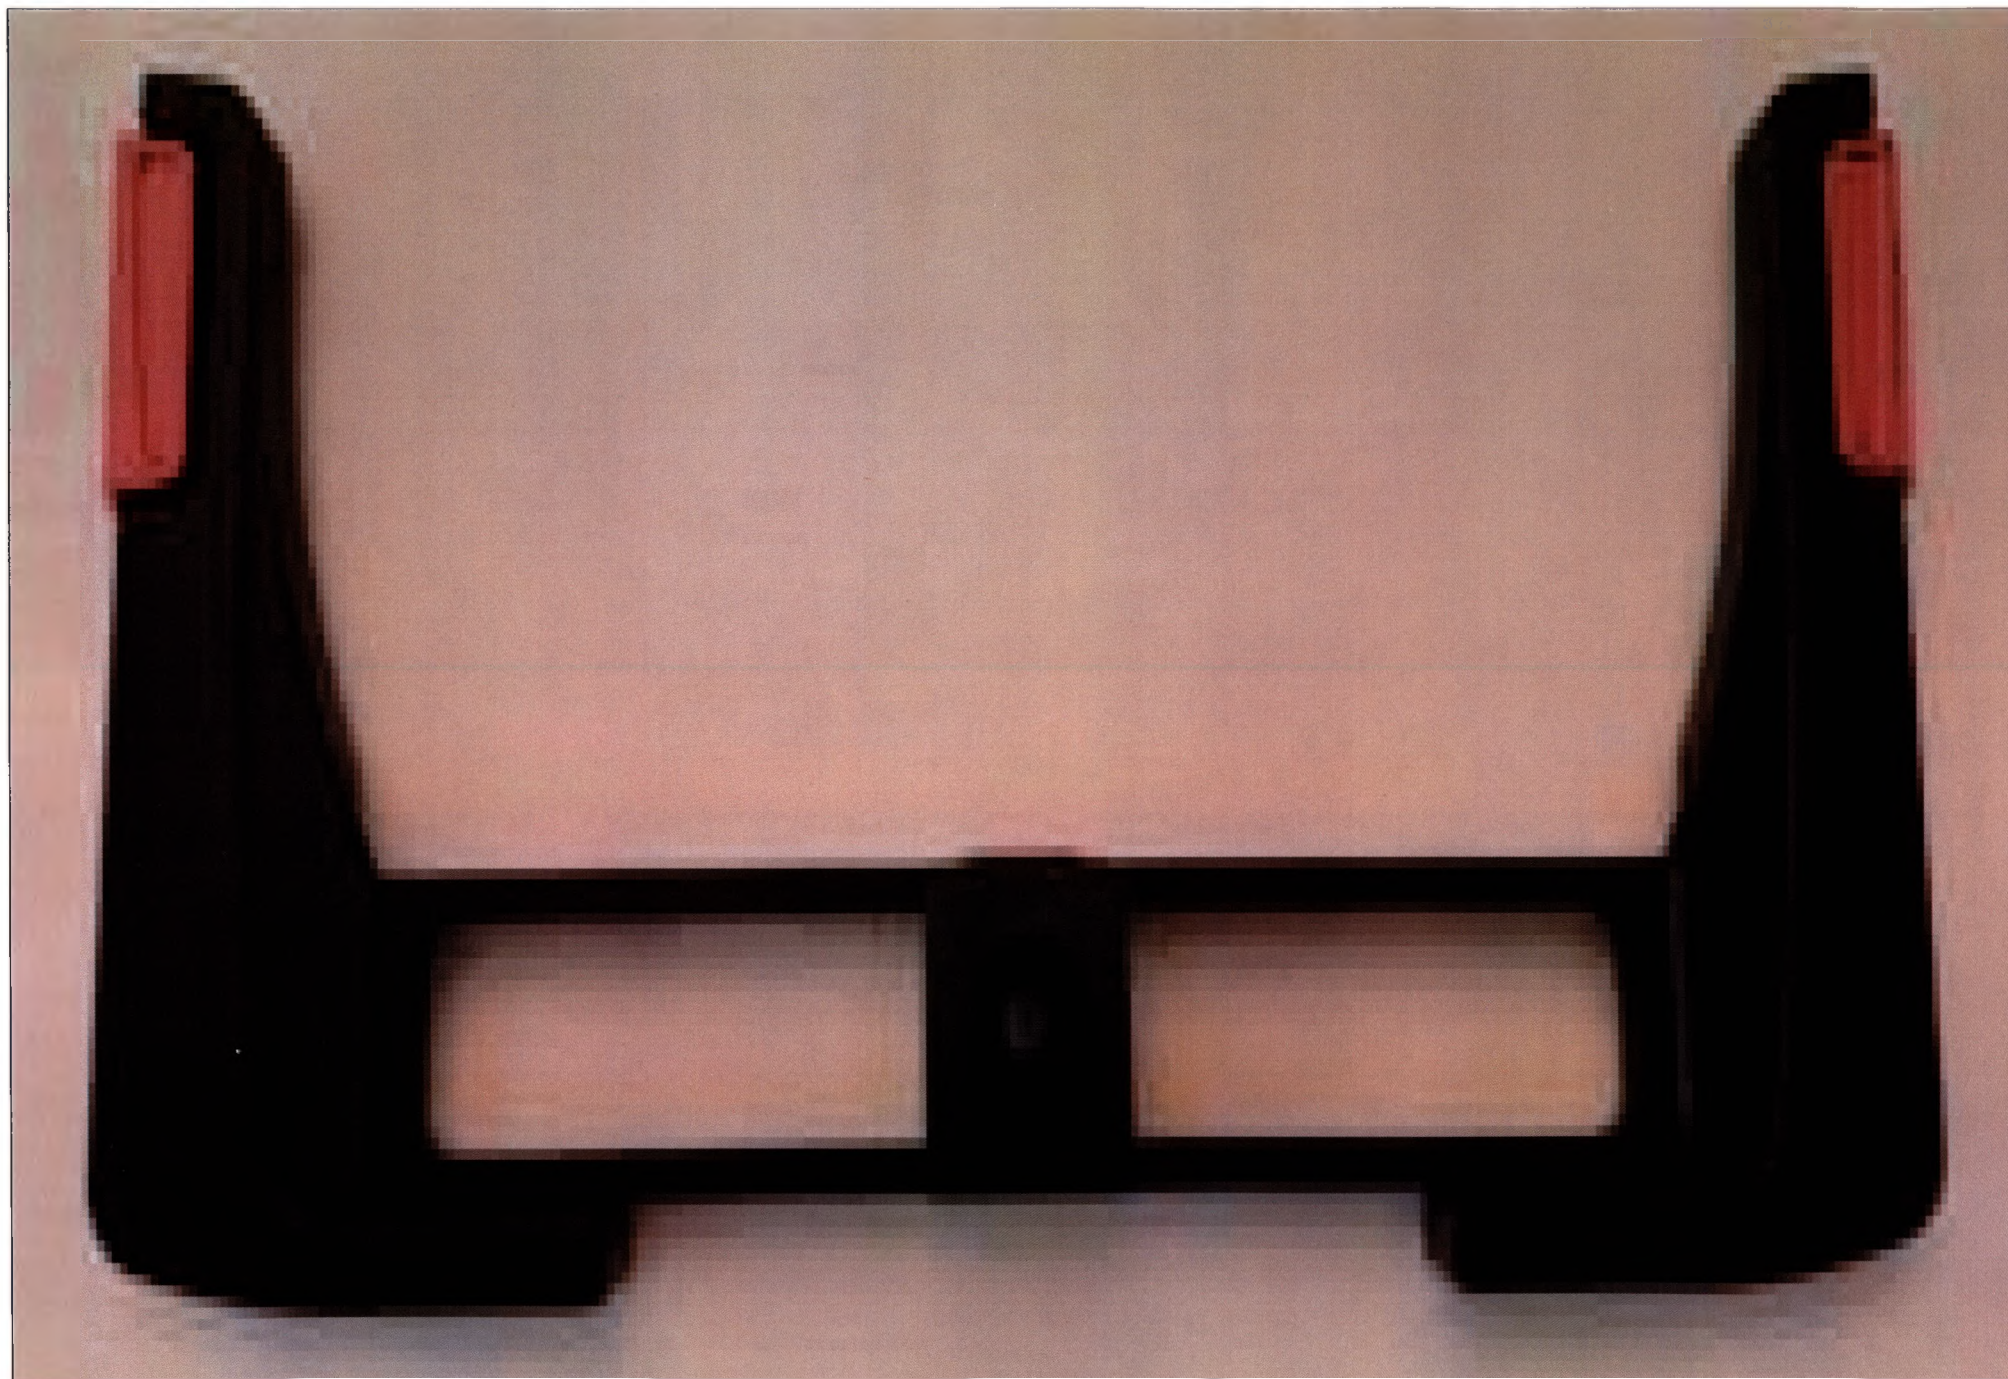


За. Штатив для крепления на кушетку Qfix kVue w.

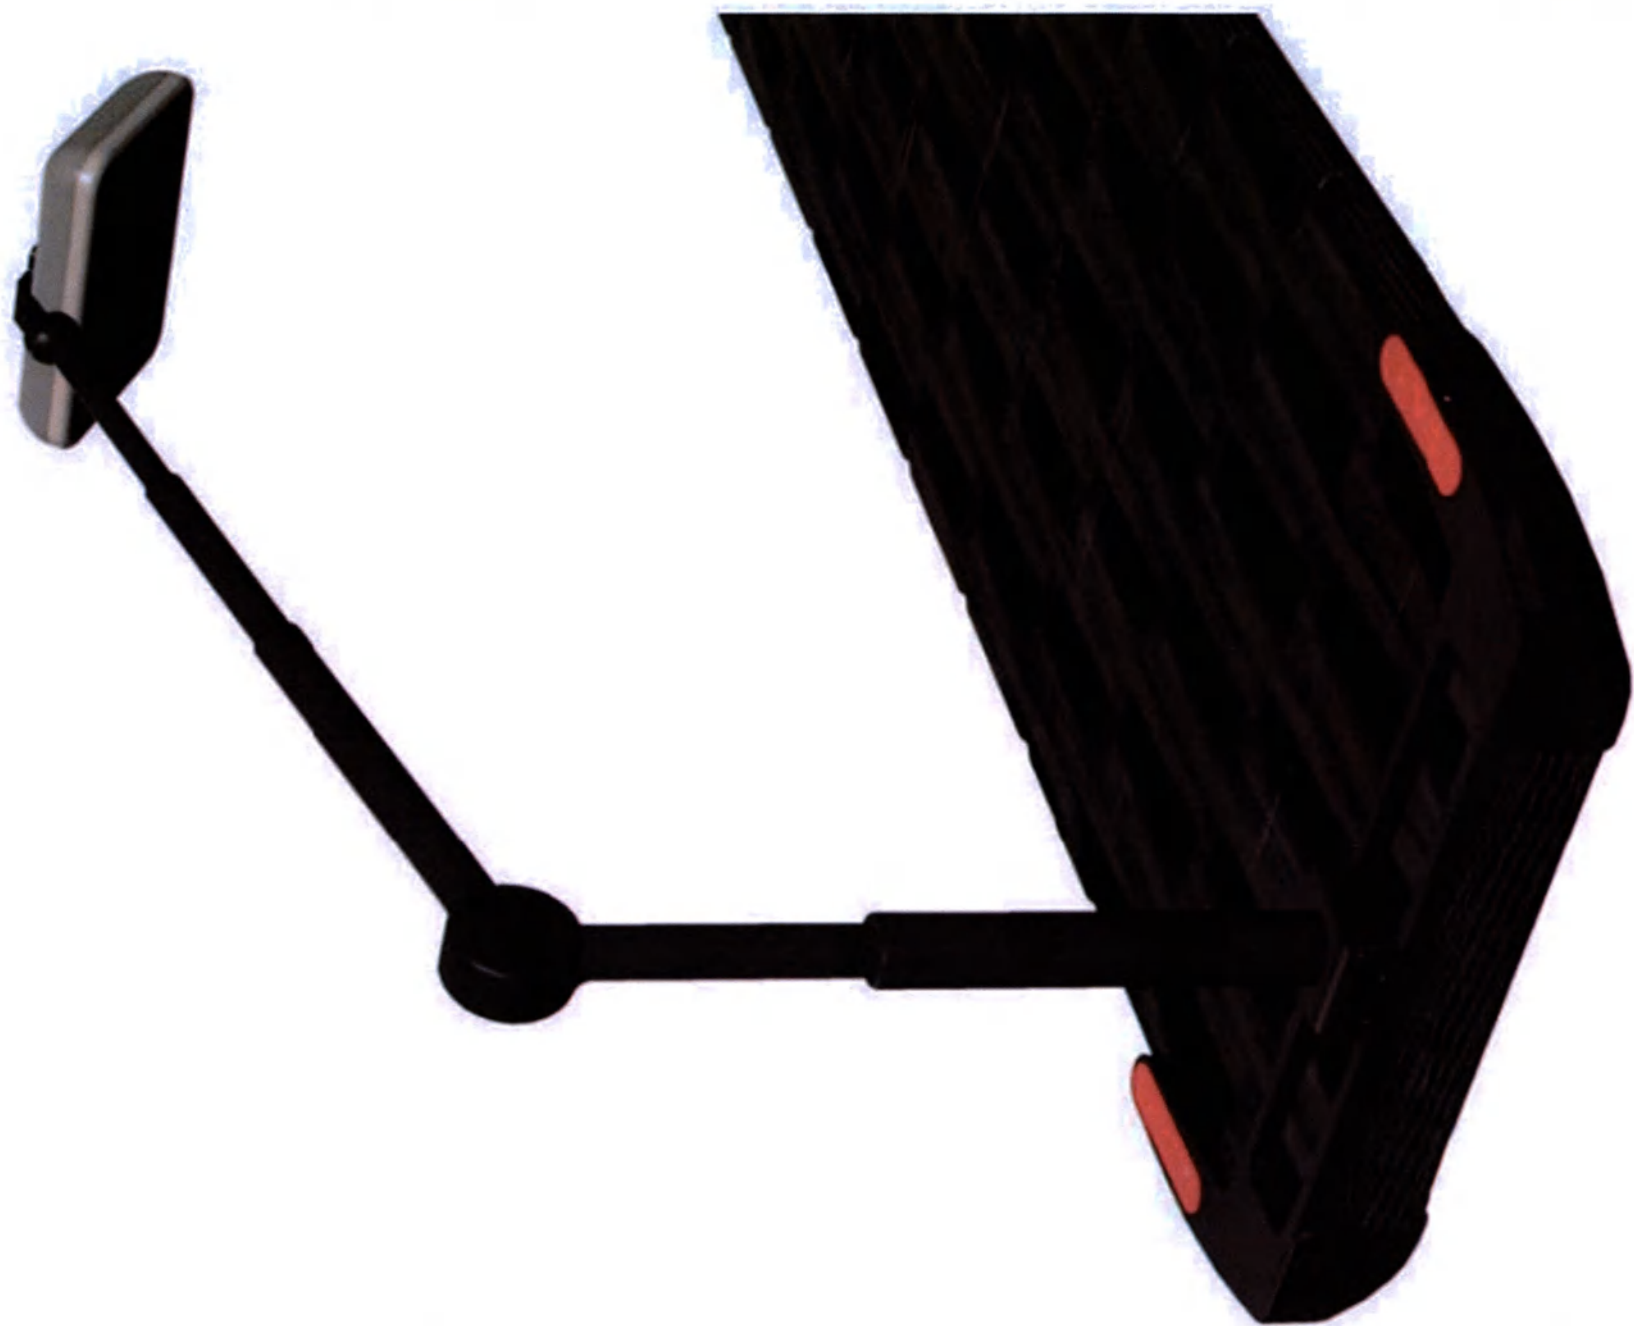


36. Штатив для крепления на кушетку Qfix kVue w.

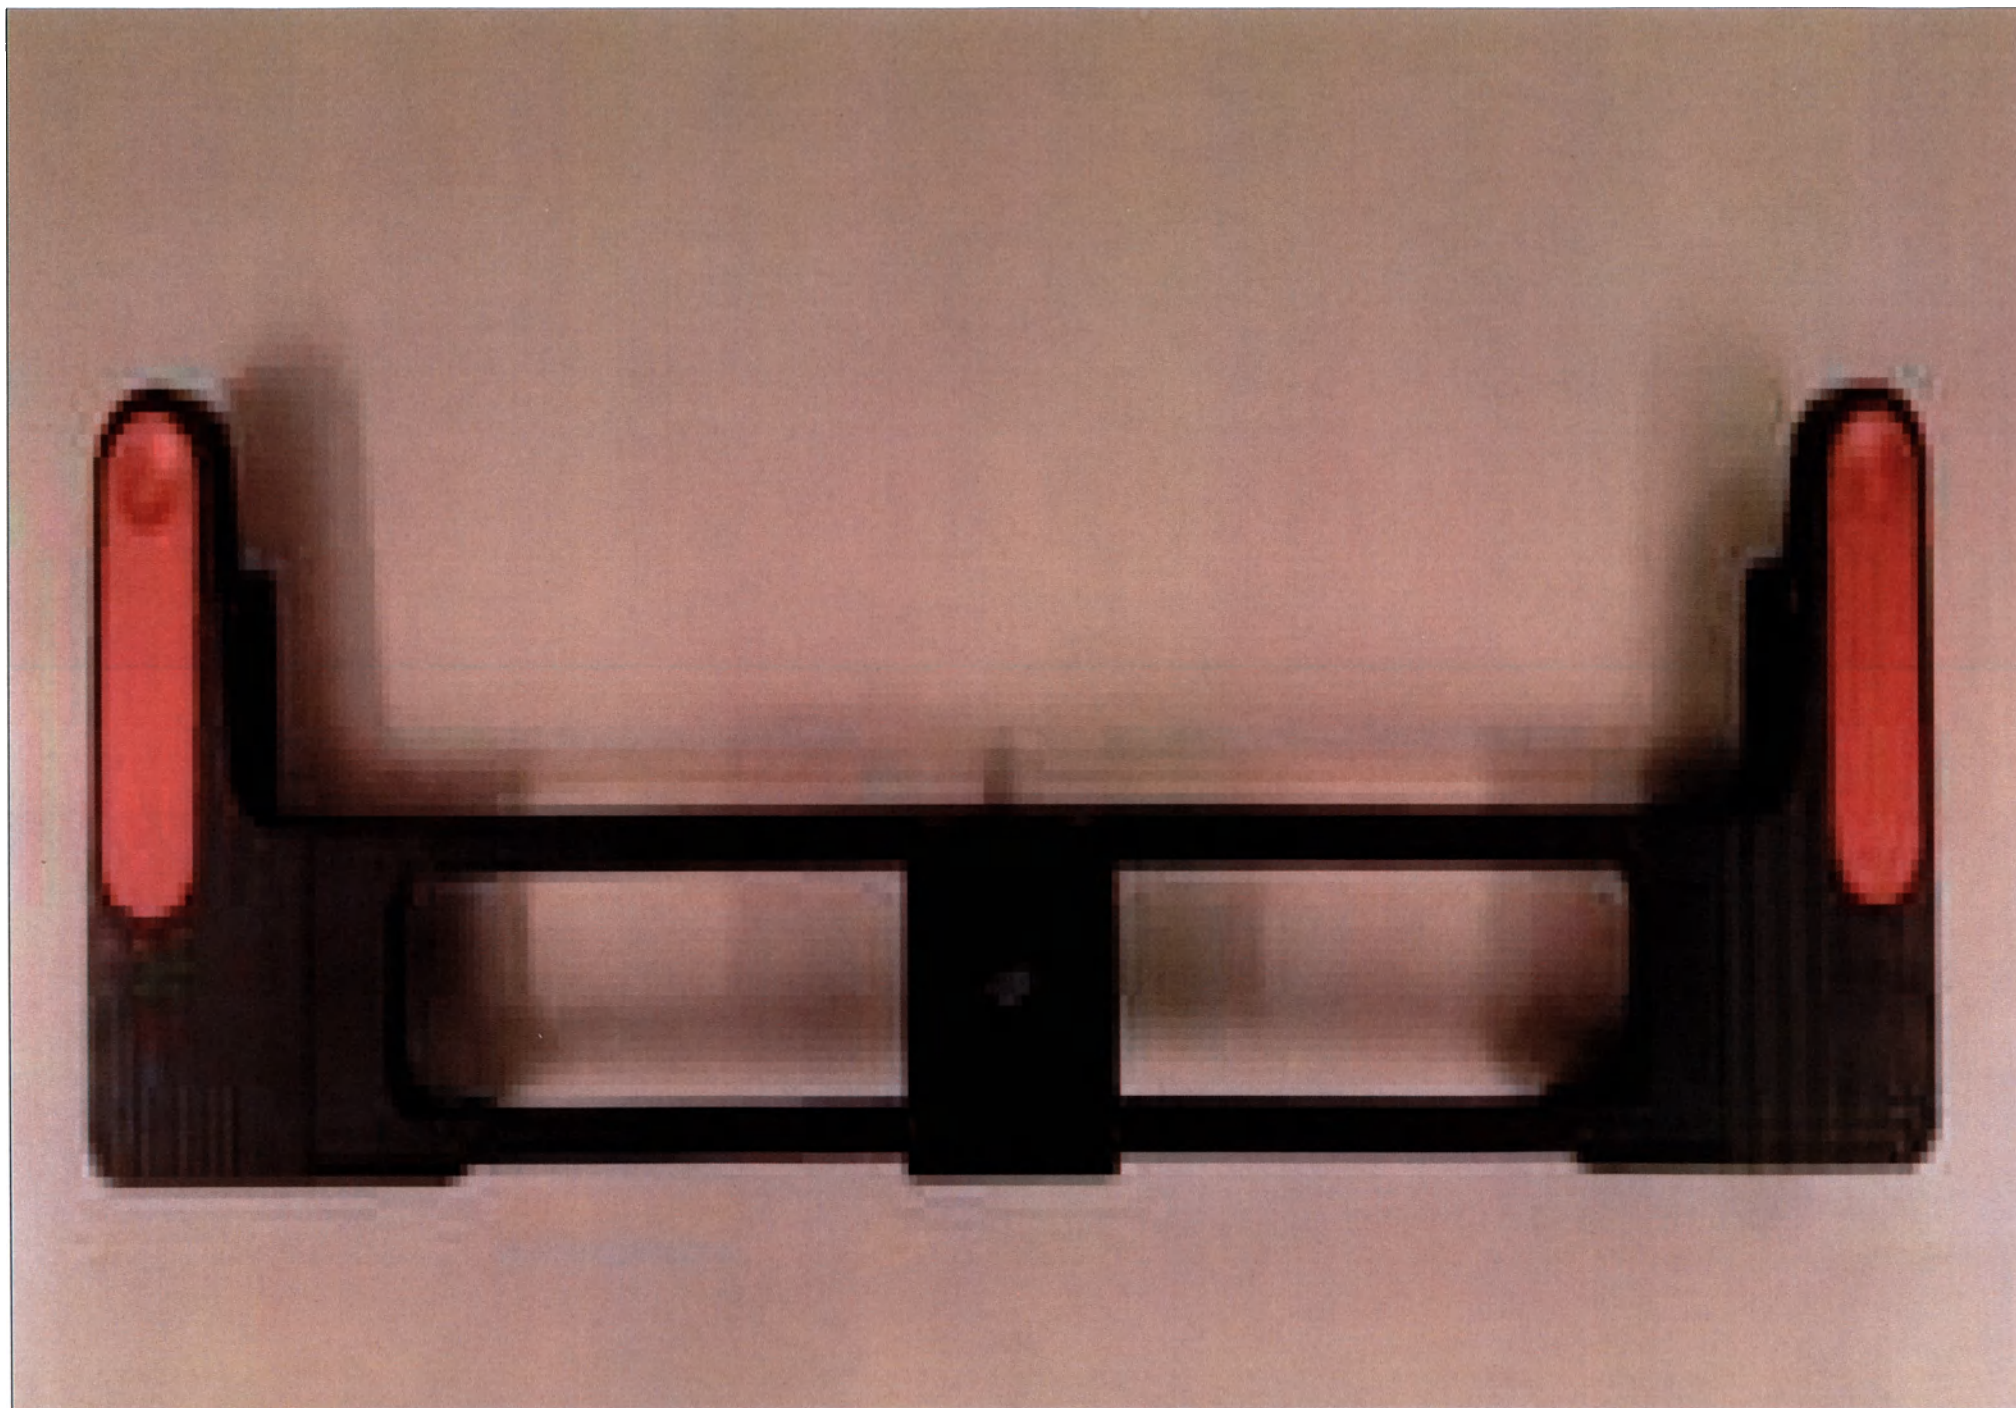


4а. Штатив для крепления VCD на кушетку Siemens RTP w.

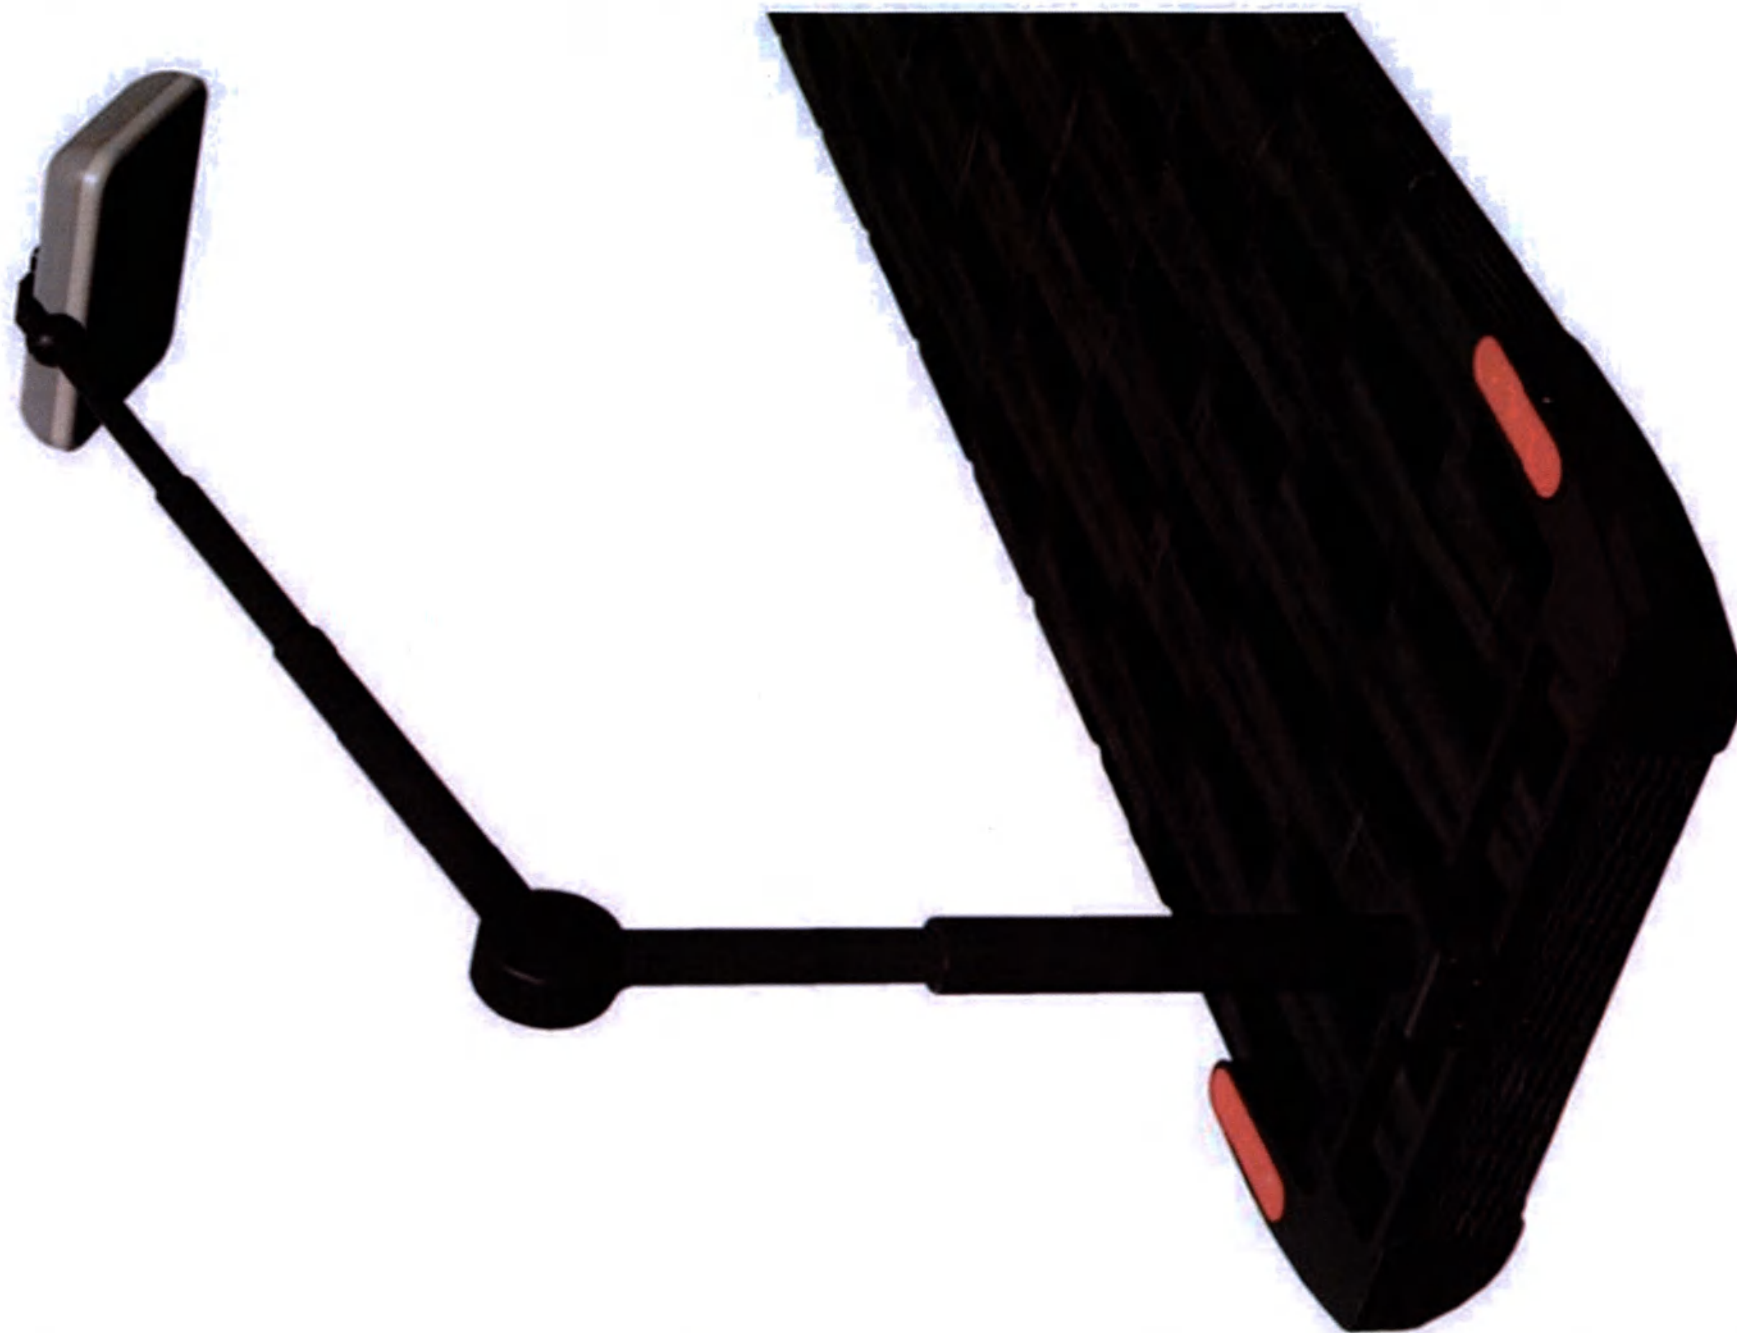


46. Штатив для крепления VCD на кушетку Siemens RTP w.

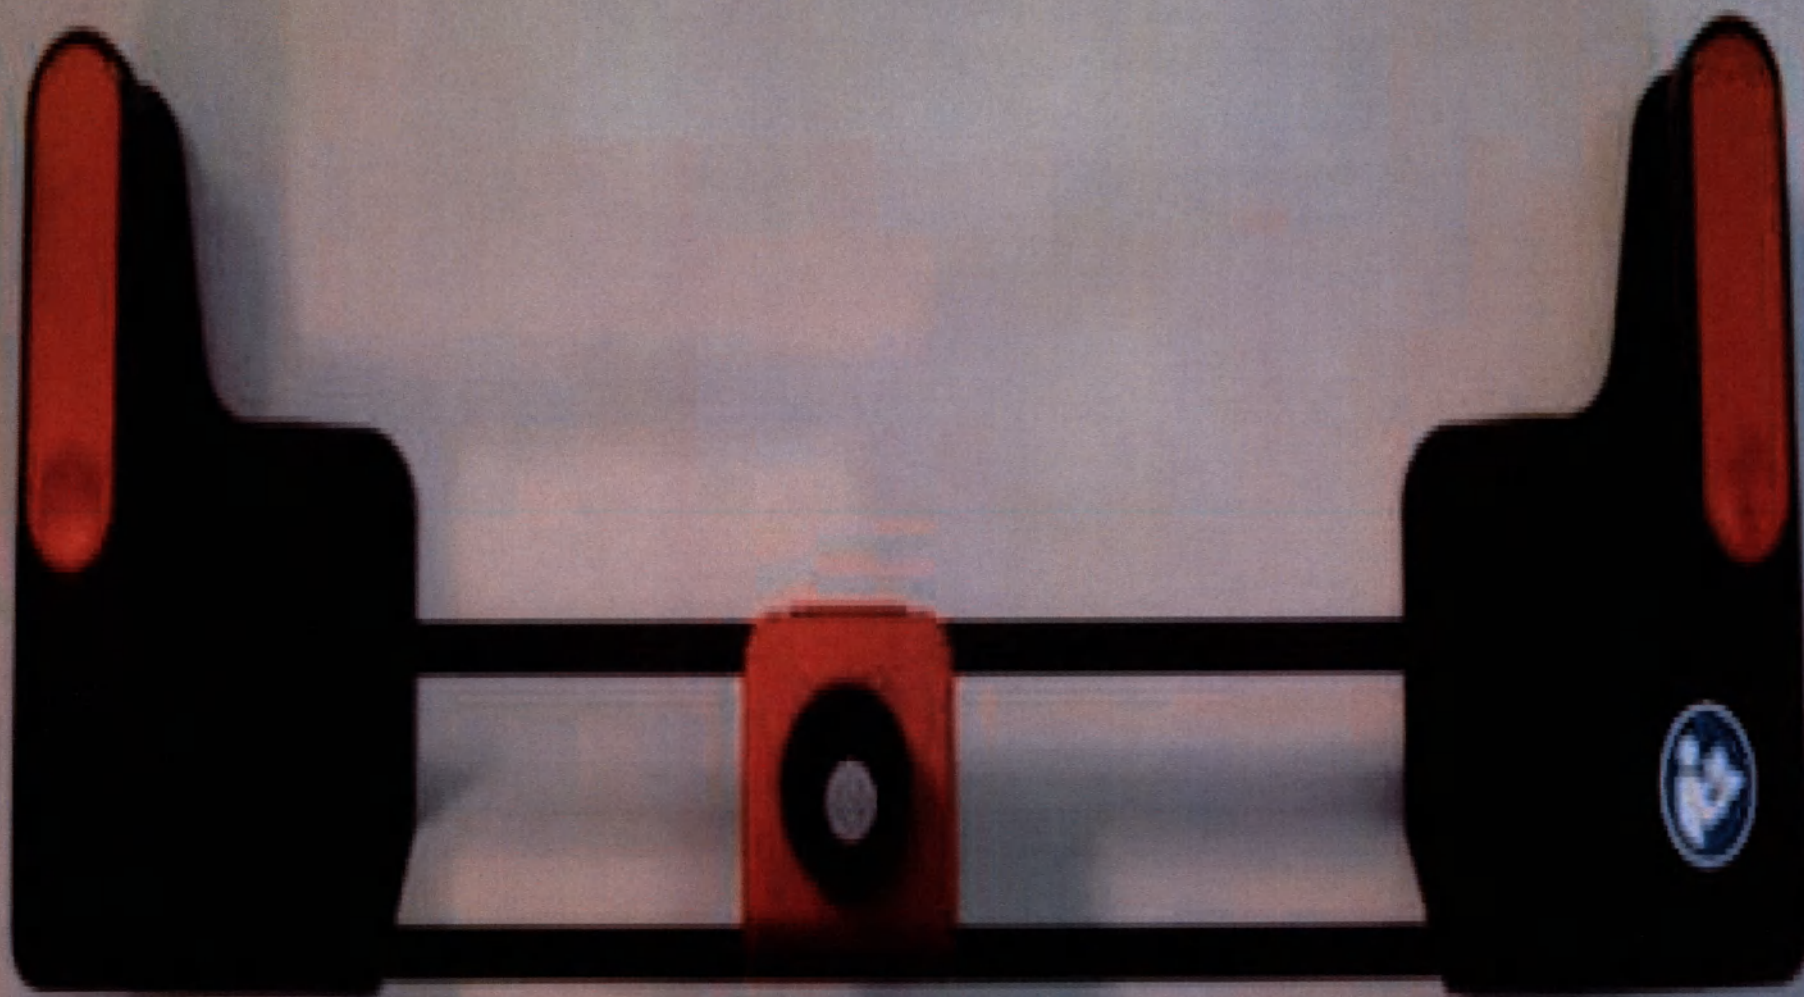


5a. Набон Visual Coaching Device (VCD) Standard CT Overlay.

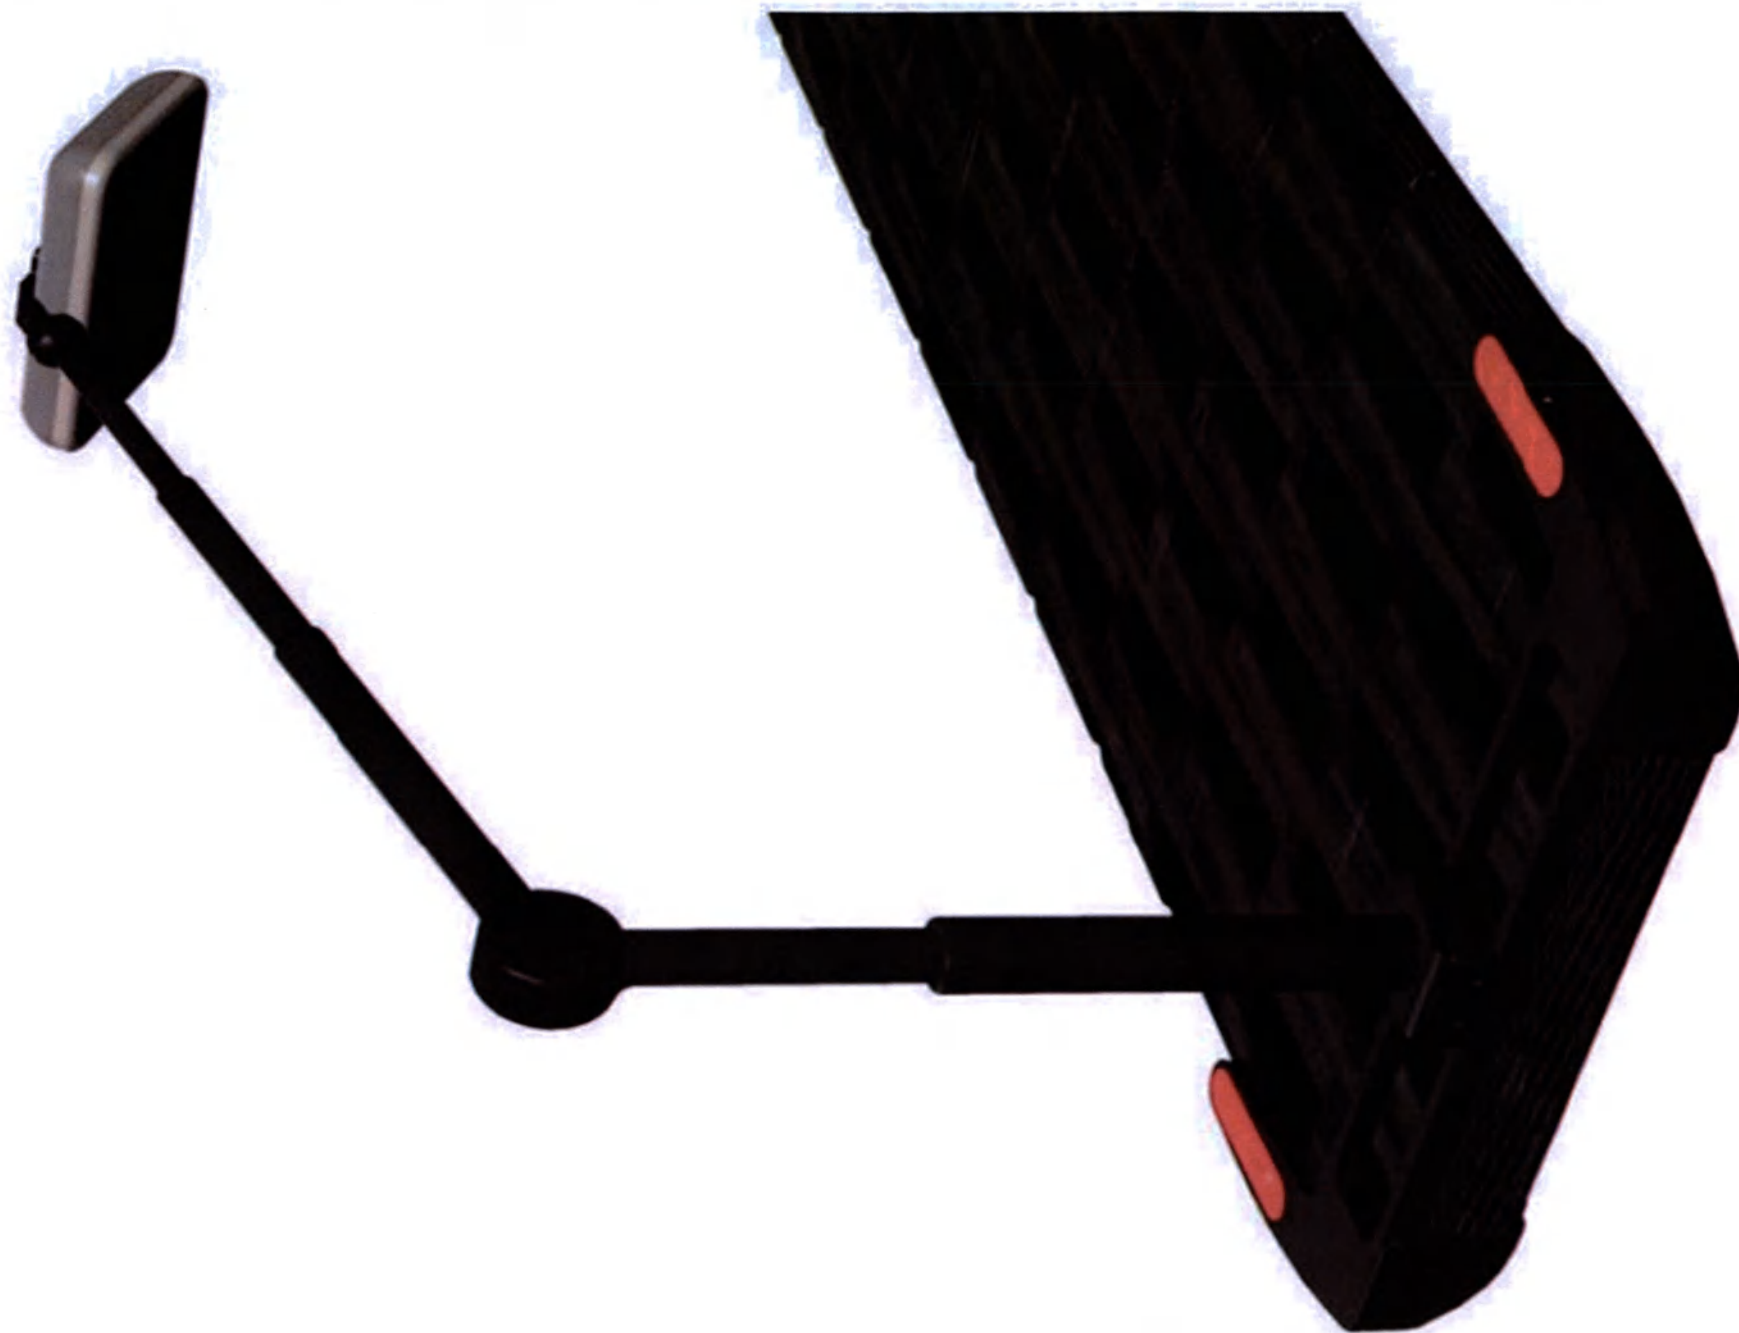

56. *Набор Visual Coaching Device (VCD) Standard CT Overlay.*

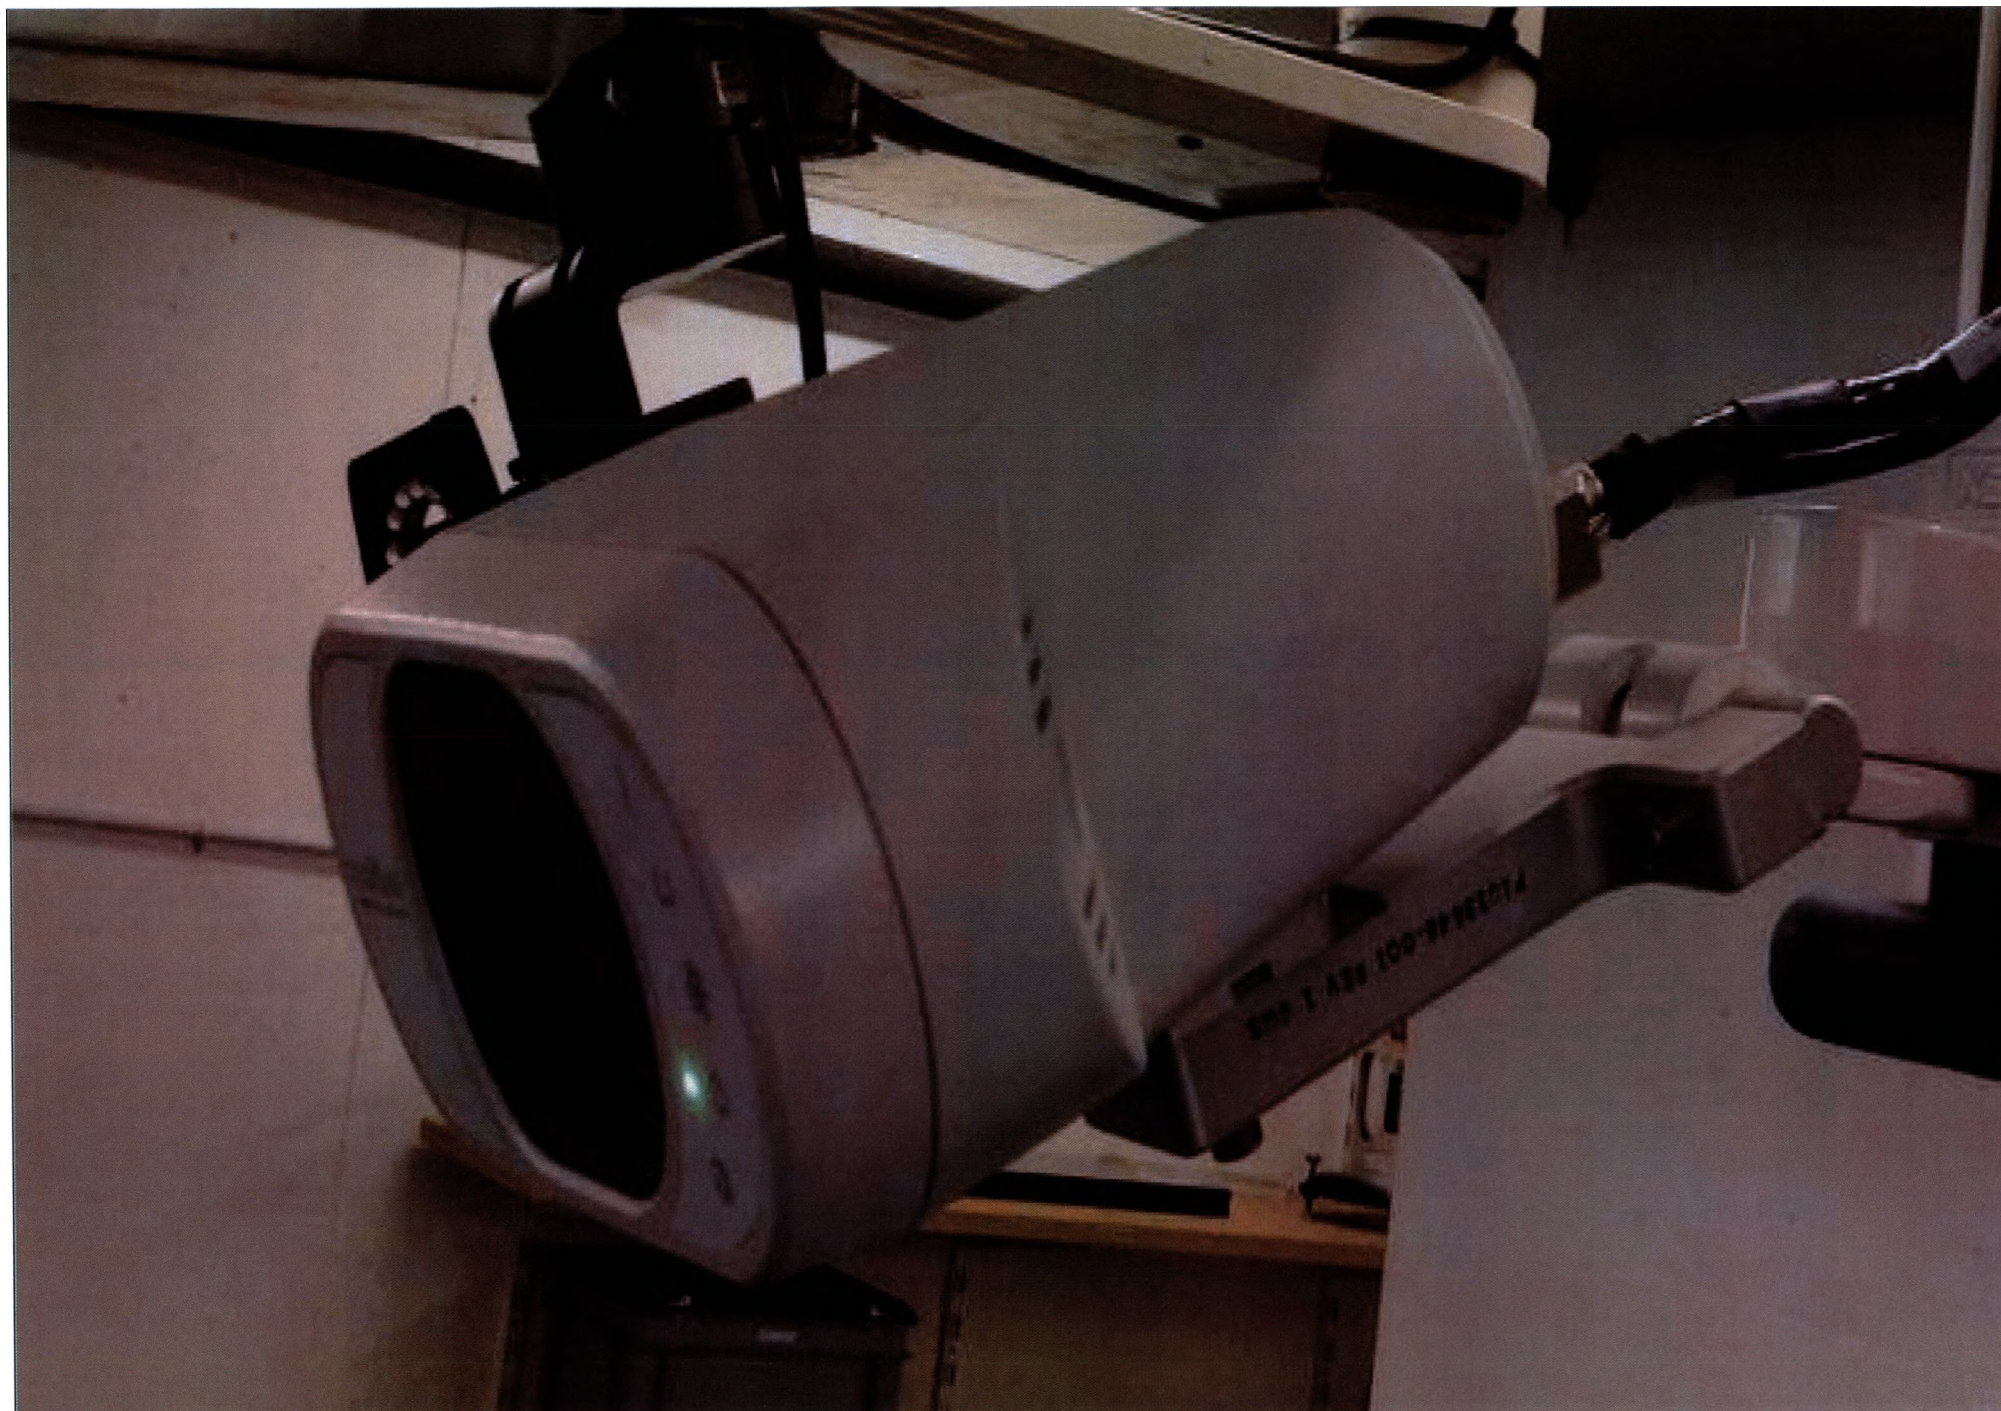

7. Отдельная камера для системы лучевой терапии TrueBeam.

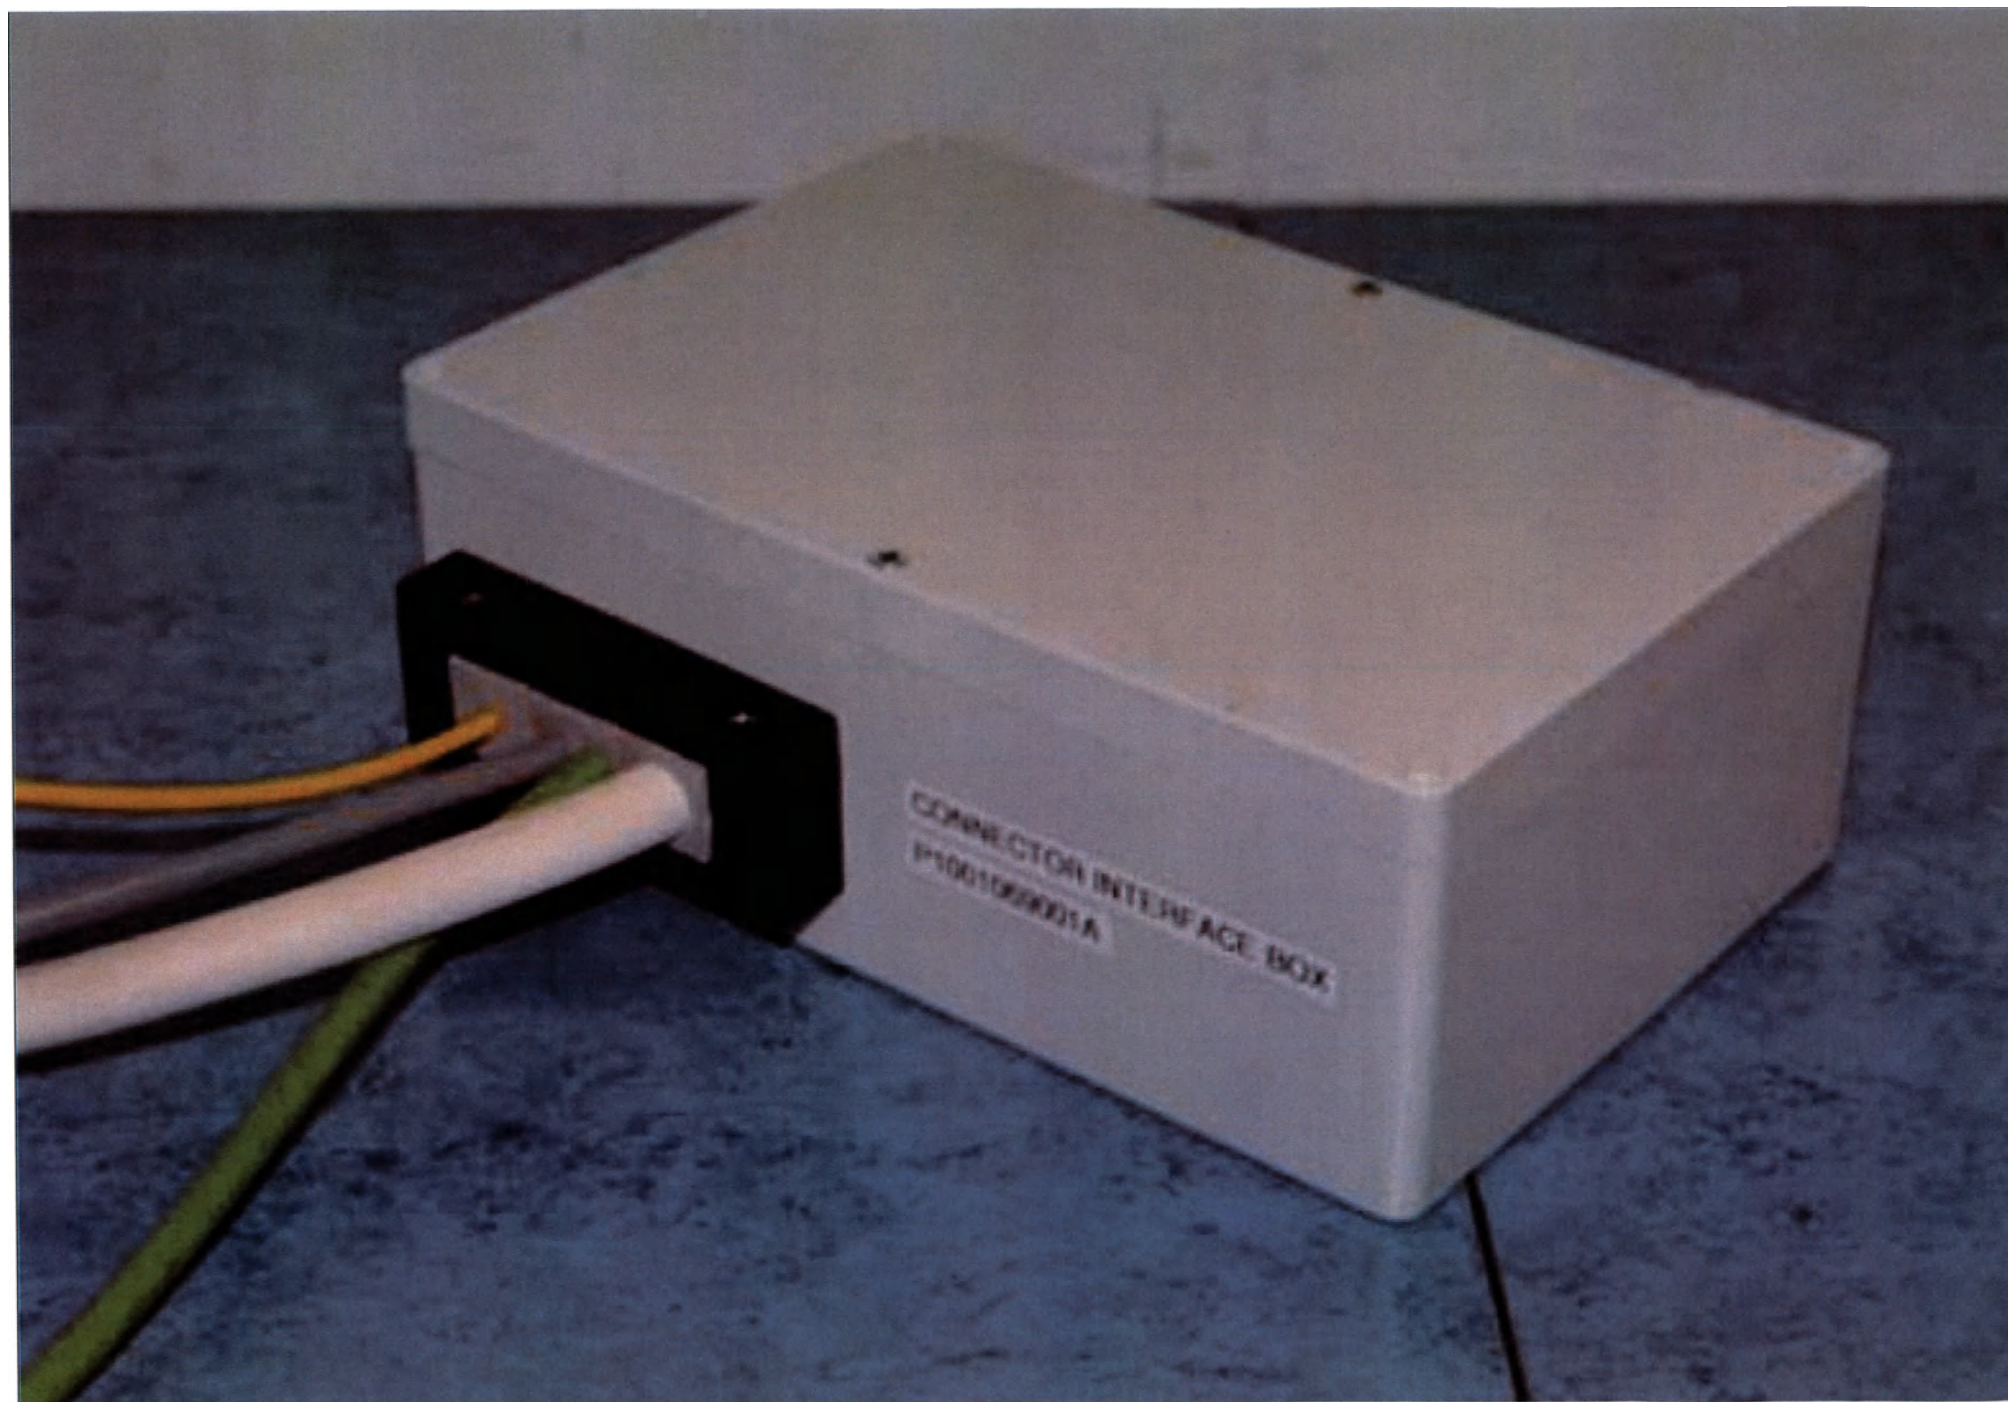

8а. Комплект монтажный для кушетки с кабелем длиной 10 м.



86. Комплект монтажный для кушетки с кабелем длиной 10 м.



86. Комплект монтажный для кушетки с кабелем длиной 10 м.



8г. Комплект монтажный для кушетки с кабелем длиной 10 м..



8д. Комплект монтажный для кушетки с кабелем длиной 10 м.

Всего пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
листа (ов)

