



127422 г. Москва, Тимирязевская ул., д. 1,
Помещение I, комната 2Б
+7(495) 780-0793
www.dixon.ru
info@dixon.ru

Фотографические изображения медицинского изделия

Авторефкератометр с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»


Яковлев А.А.

2019 г.






Аutoreфкератометр варианта исполнения HRK-7000A.
1. Основной блок.

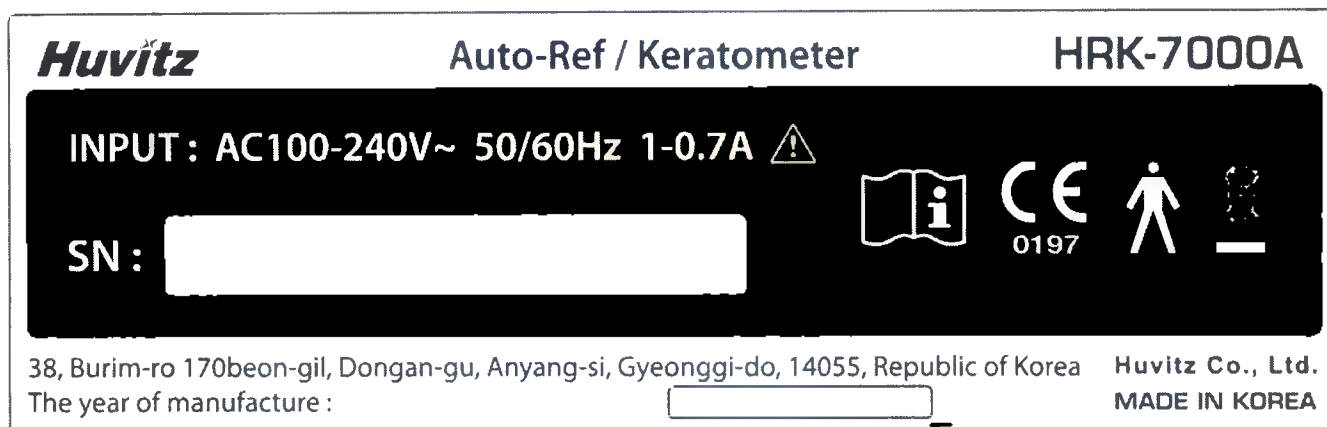

Место для нанесения
стикера с указанием номера
регистрационного
удостоверения

Макет маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-7000A.

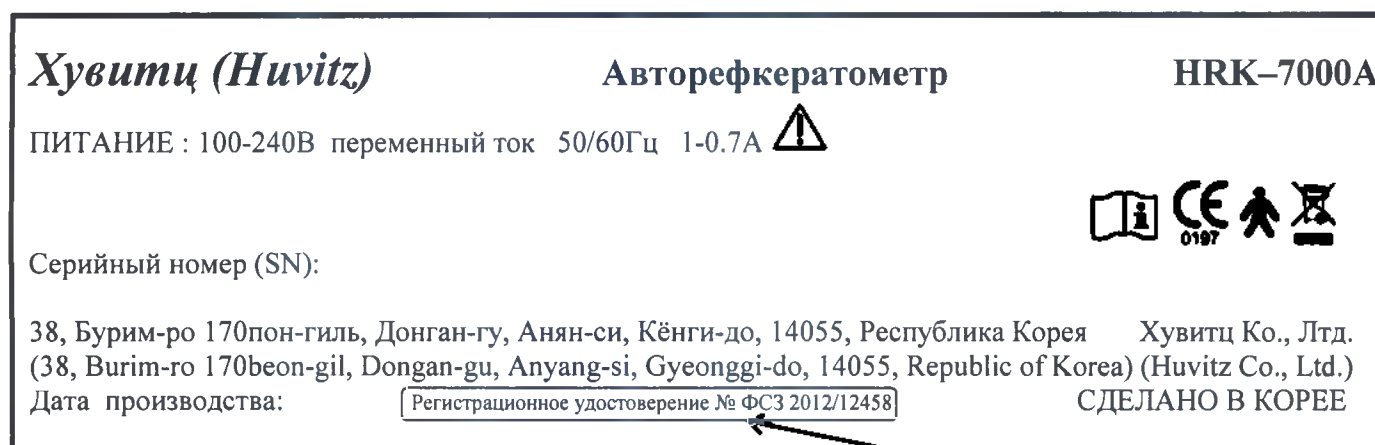

Макет стикера с указанием номера
регистрационного удостоверения

Перевод макета маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-7000A на русский язык.



Авторефрактометр варианта исполнения HRK-8000A.
1. Основной блок.

Huvitz	Auto-Ref / Keratometer	HRK-8000A
INPUT : 100-240V~ 50/60Hz 1-0.8A 		
SN :	   	
38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea The year of manufacture :		Huvitz Co., Ltd. MADE IN KOREA

Место для нанесения
стикера с указанием номера
регистрационного
удостоверения

Макет маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-8000A.

Хувитц (Huvitz)	Авторефкератометр	HRK-8000A
ПИТАНИЕ : 100-240В переменный ток 50/60Гц 1-0.8А 		
Серийный номер (SN):	   	
38, Бурим-ро 170пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея (38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea) (Huvitz Co., Ltd.) Дата производства:		Хувитц Ко., Лтд. СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Макет стикера с указанием номера
регистрационного удостоверения

Перевод макета маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-8000A на русский язык.



Авторефрактометр варианта исполнения HRK-9000A.

1. Основной блок.

Huvitz	Auto-Ref / Keratometer	HRK-9000A
INPUT : 100-240 Vac 1.0-0.6A 50/60Hz ⚠		  
SN :	CE 0984 0197	
38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea The year of manufacture :		Huvitz Co., Ltd. MADE IN KOREA

Место для нанесения
стикера с указанием номера
регистрационного
удостоверения

Макет маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-9000A.

Хувитц (Huvitz)	Авторефкератометр	HRK-9000A
ПИТАНИЕ : 100-240В переменный ток 1.0-0.6А 50/60Гц ⚠		  
Серийный номер (SN):	CE 0984 0197	
38, Бурим-ро 170пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея (38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea) (Huvitz Co., Ltd.)		Хувитц Ко., Лтд.
Дата производства:	Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12458	СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Макет стикера с указанием номера
регистрационного удостоверения

Перевод макета маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-9000A на русский язык.



Авторефрактометр варианта исполнения HRK-1.
1. Основной блок.

Huvitz	Auto-Ref / Keratometer	HRK-1
INPUT : 100-240 Vac 1.0-0.6A 50/60Hz ⚠		
SN :	   	
38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea The year of manufacture :		Huvitz Co., Ltd. MADE IN KOREA

Место для нанесения
стикера с указанием номера
регистрационного
удостоверения

Макет маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-1.


Хувитц (Huvitz)	Авторефкератометр	HRK-1
ПИТАНИЕ : 100-240В переменный ток 1.0-0.6А 50/60Гц ⚠		
Серийный номер (SN):	   	
38, Бурим-ро 170пон-гиль, Донган-гу, Анян-си, Кёнги-до, 14055, Республика Корея (38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14055, Republic of Korea) (Huvitz Co., Ltd.) Дата производства:		Хувитц Ко., Лтд. СДЕЛАНО В КОРЕЕ

Макет стикера с указанием номера
регистрационного удостоверения

Перевод макета маркировки Авторефкератометра, вариант исполнения HRK-1 на русский язык.



2. Глаз тестовый стандартный.

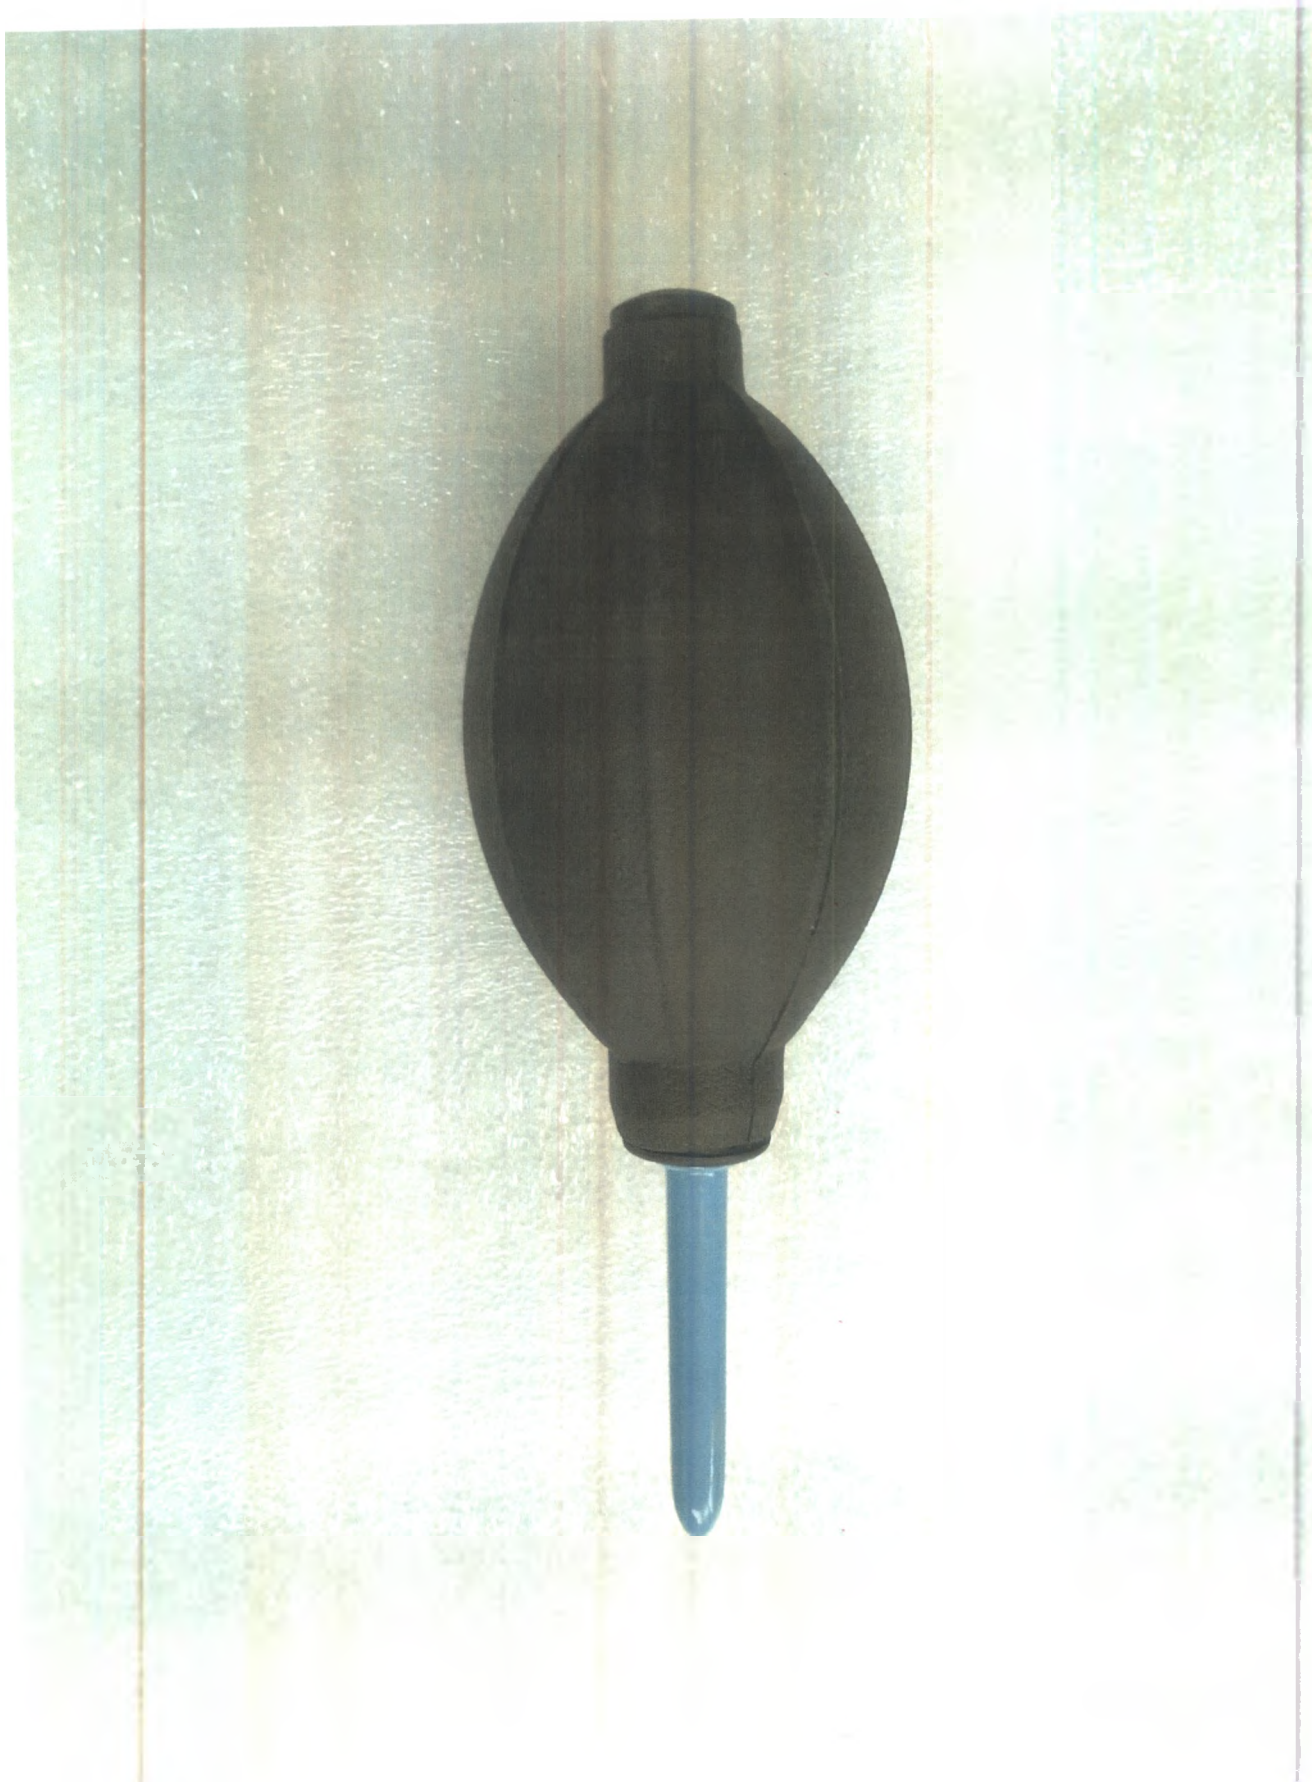


3. Груша резиновая.



4. Кабель питания.


User Manual

Auto Ref/Keratometer HRK-9000A

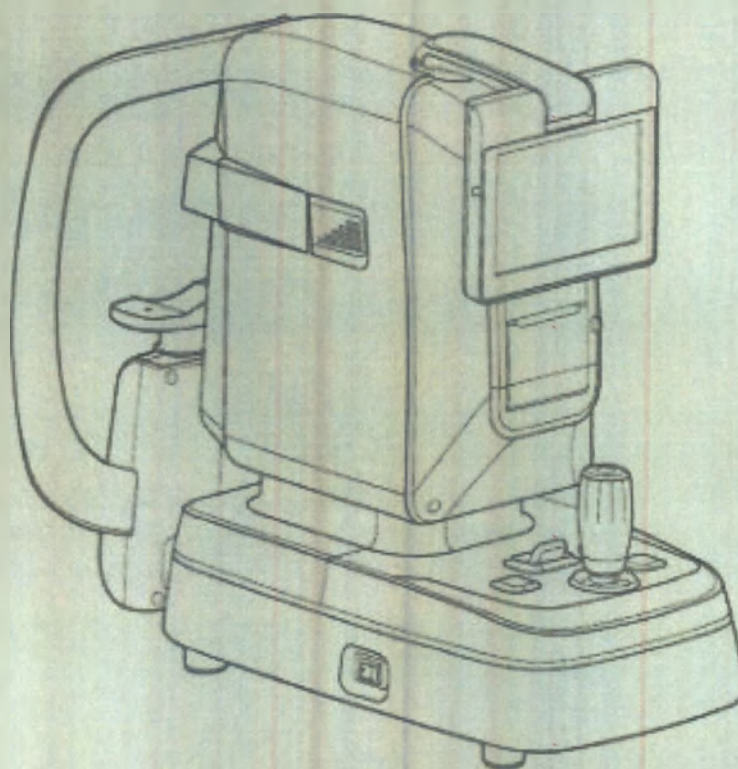

Huvitz
Facing Progress toward People

5. Руководство по эксплуатации.

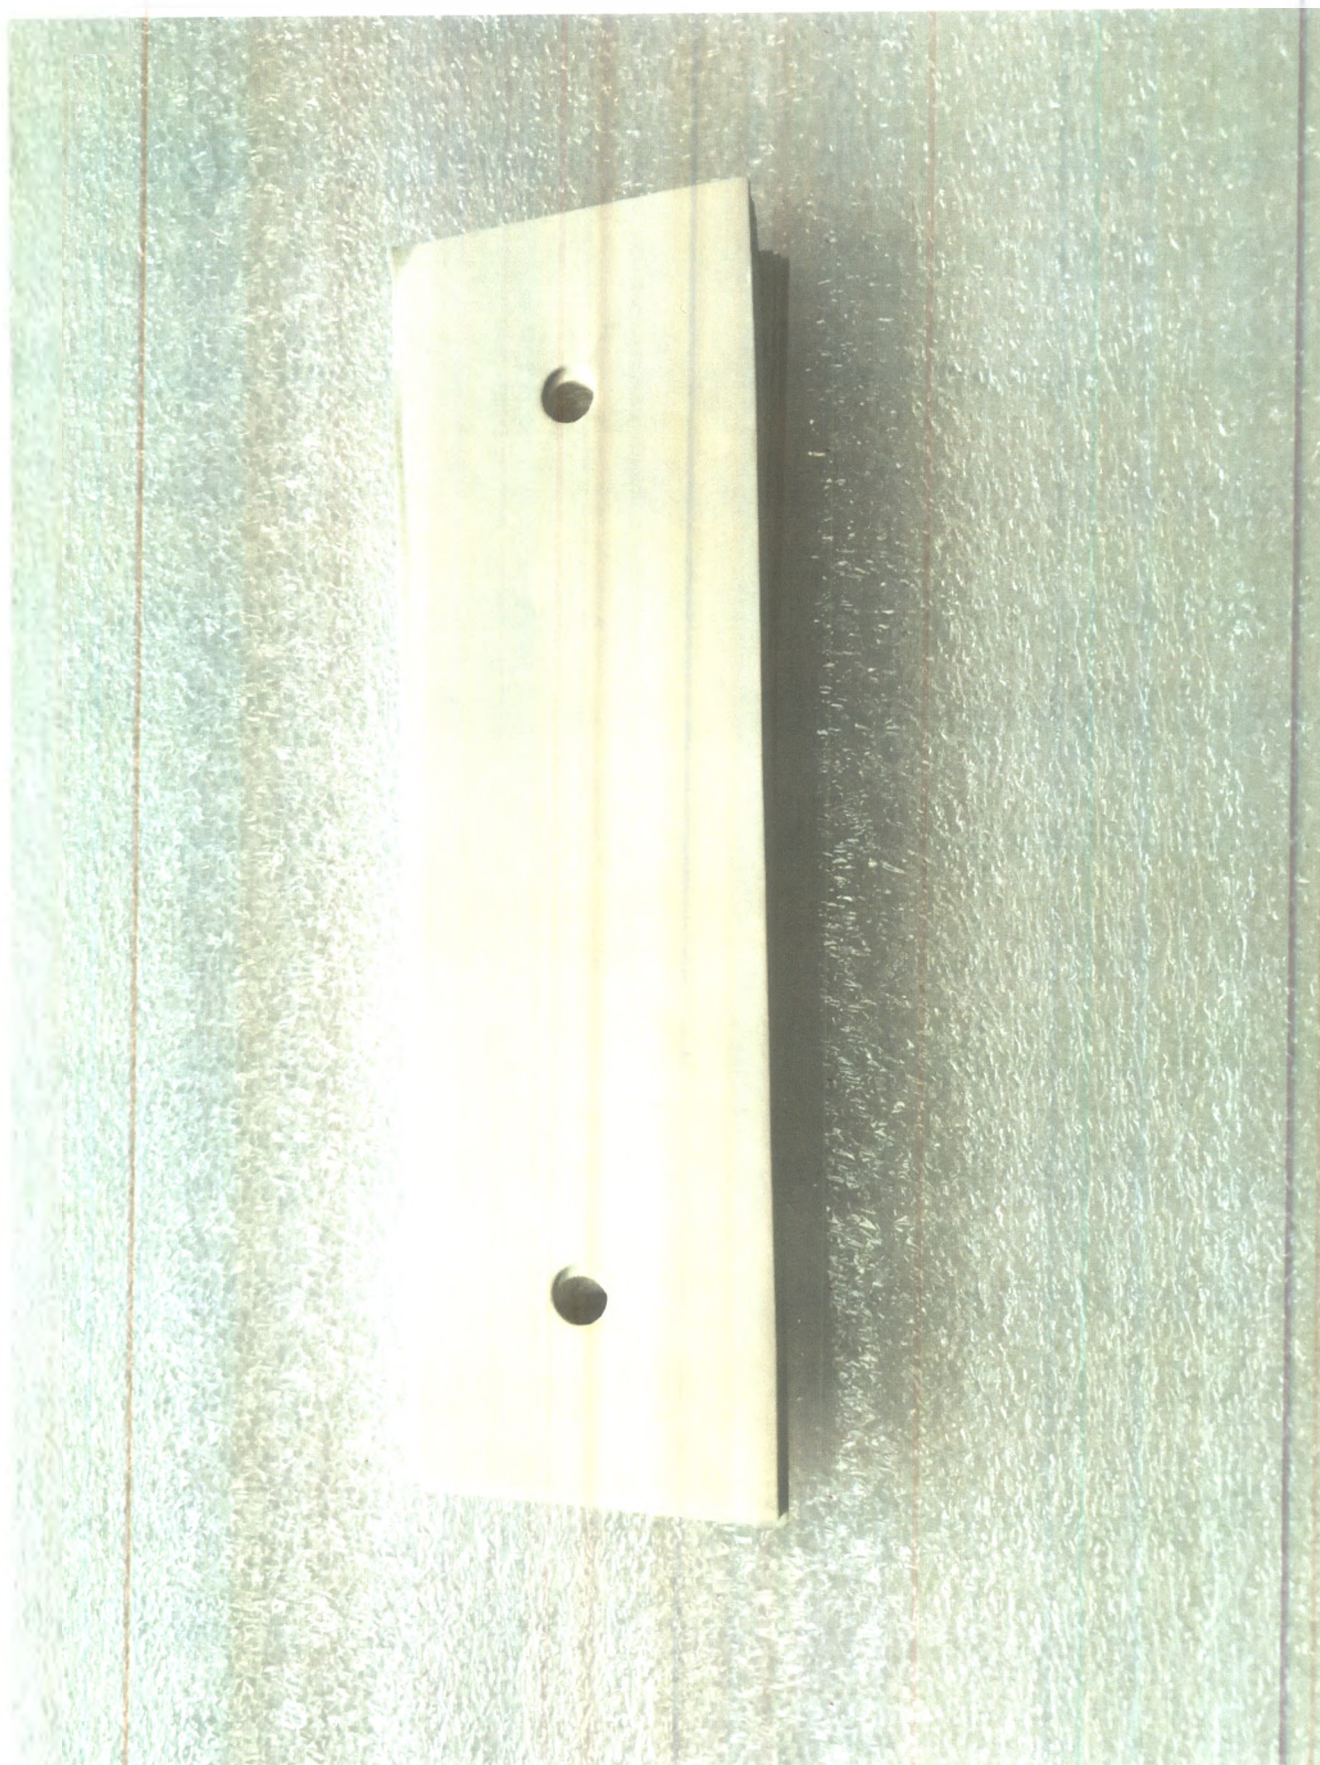


Принадлежности.

1. Салфетки для подбородка – 100 шт./уп.



2. Пылезащитный чехол.

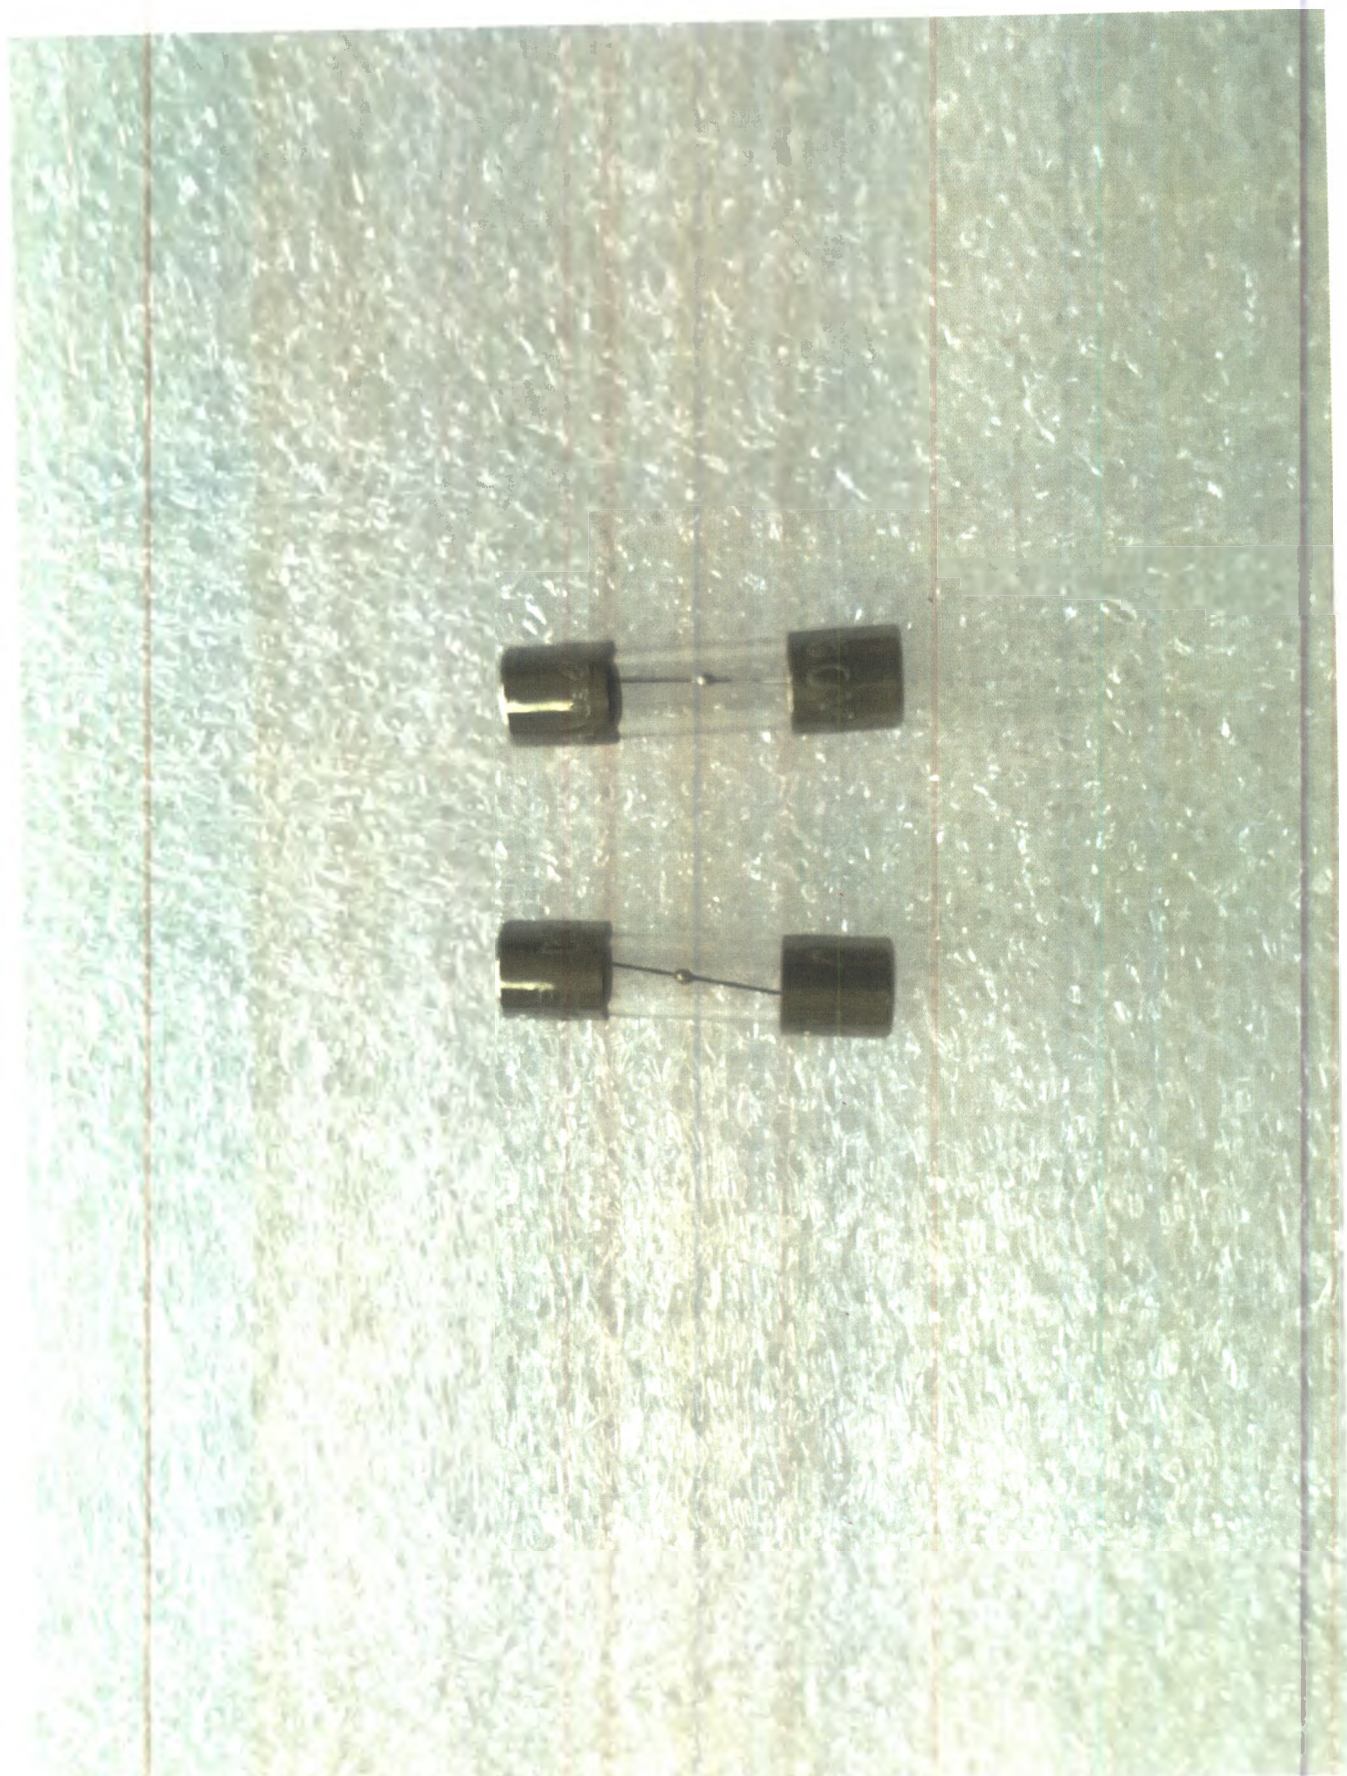


3. Предохранитель (250 В/3.15А) – не более 2 шт.



4. Заглушка резиновая.




5. Бумага для печати – 2 рулона.

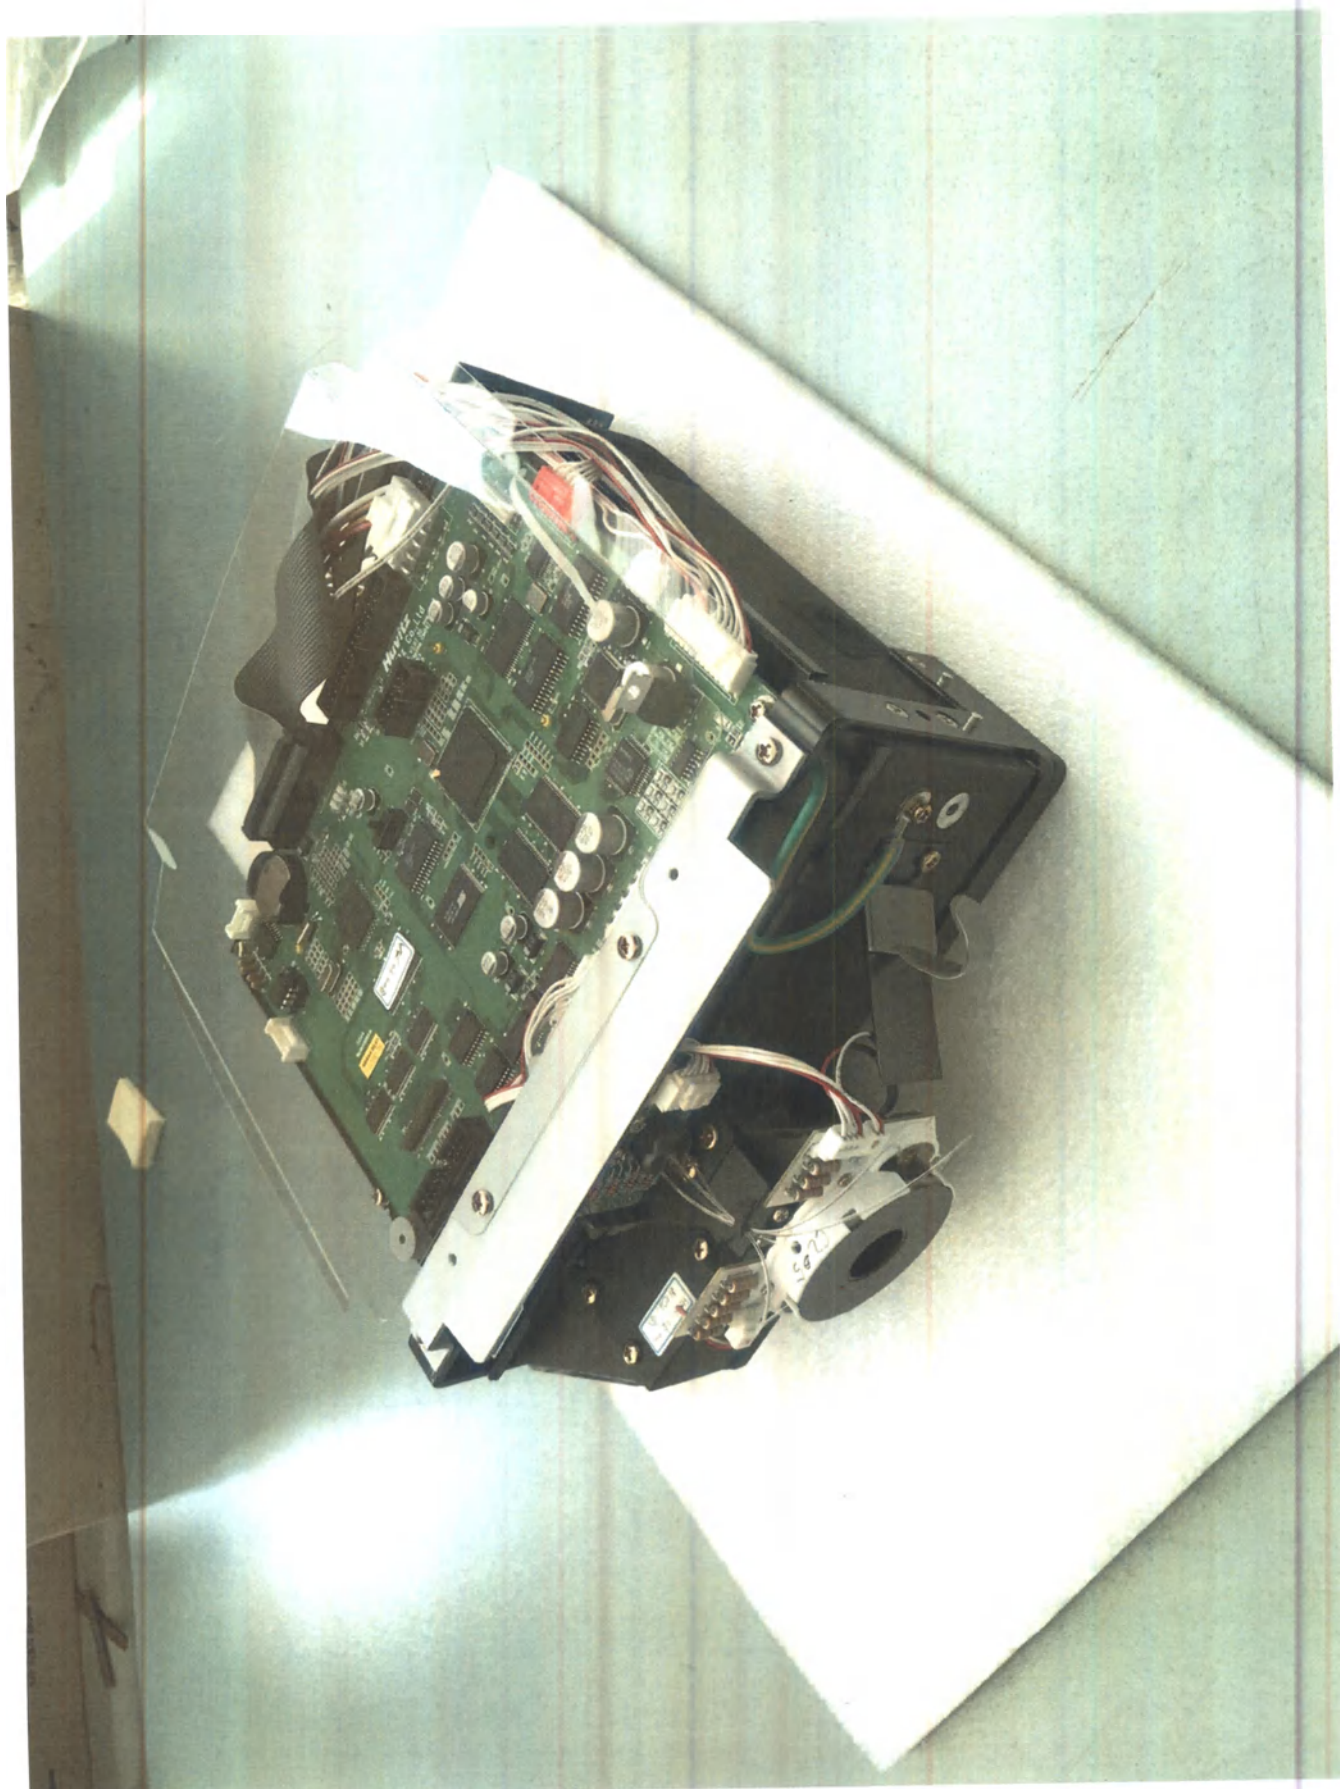

6. Блок управления центральный.



7. Блок управления моторами.

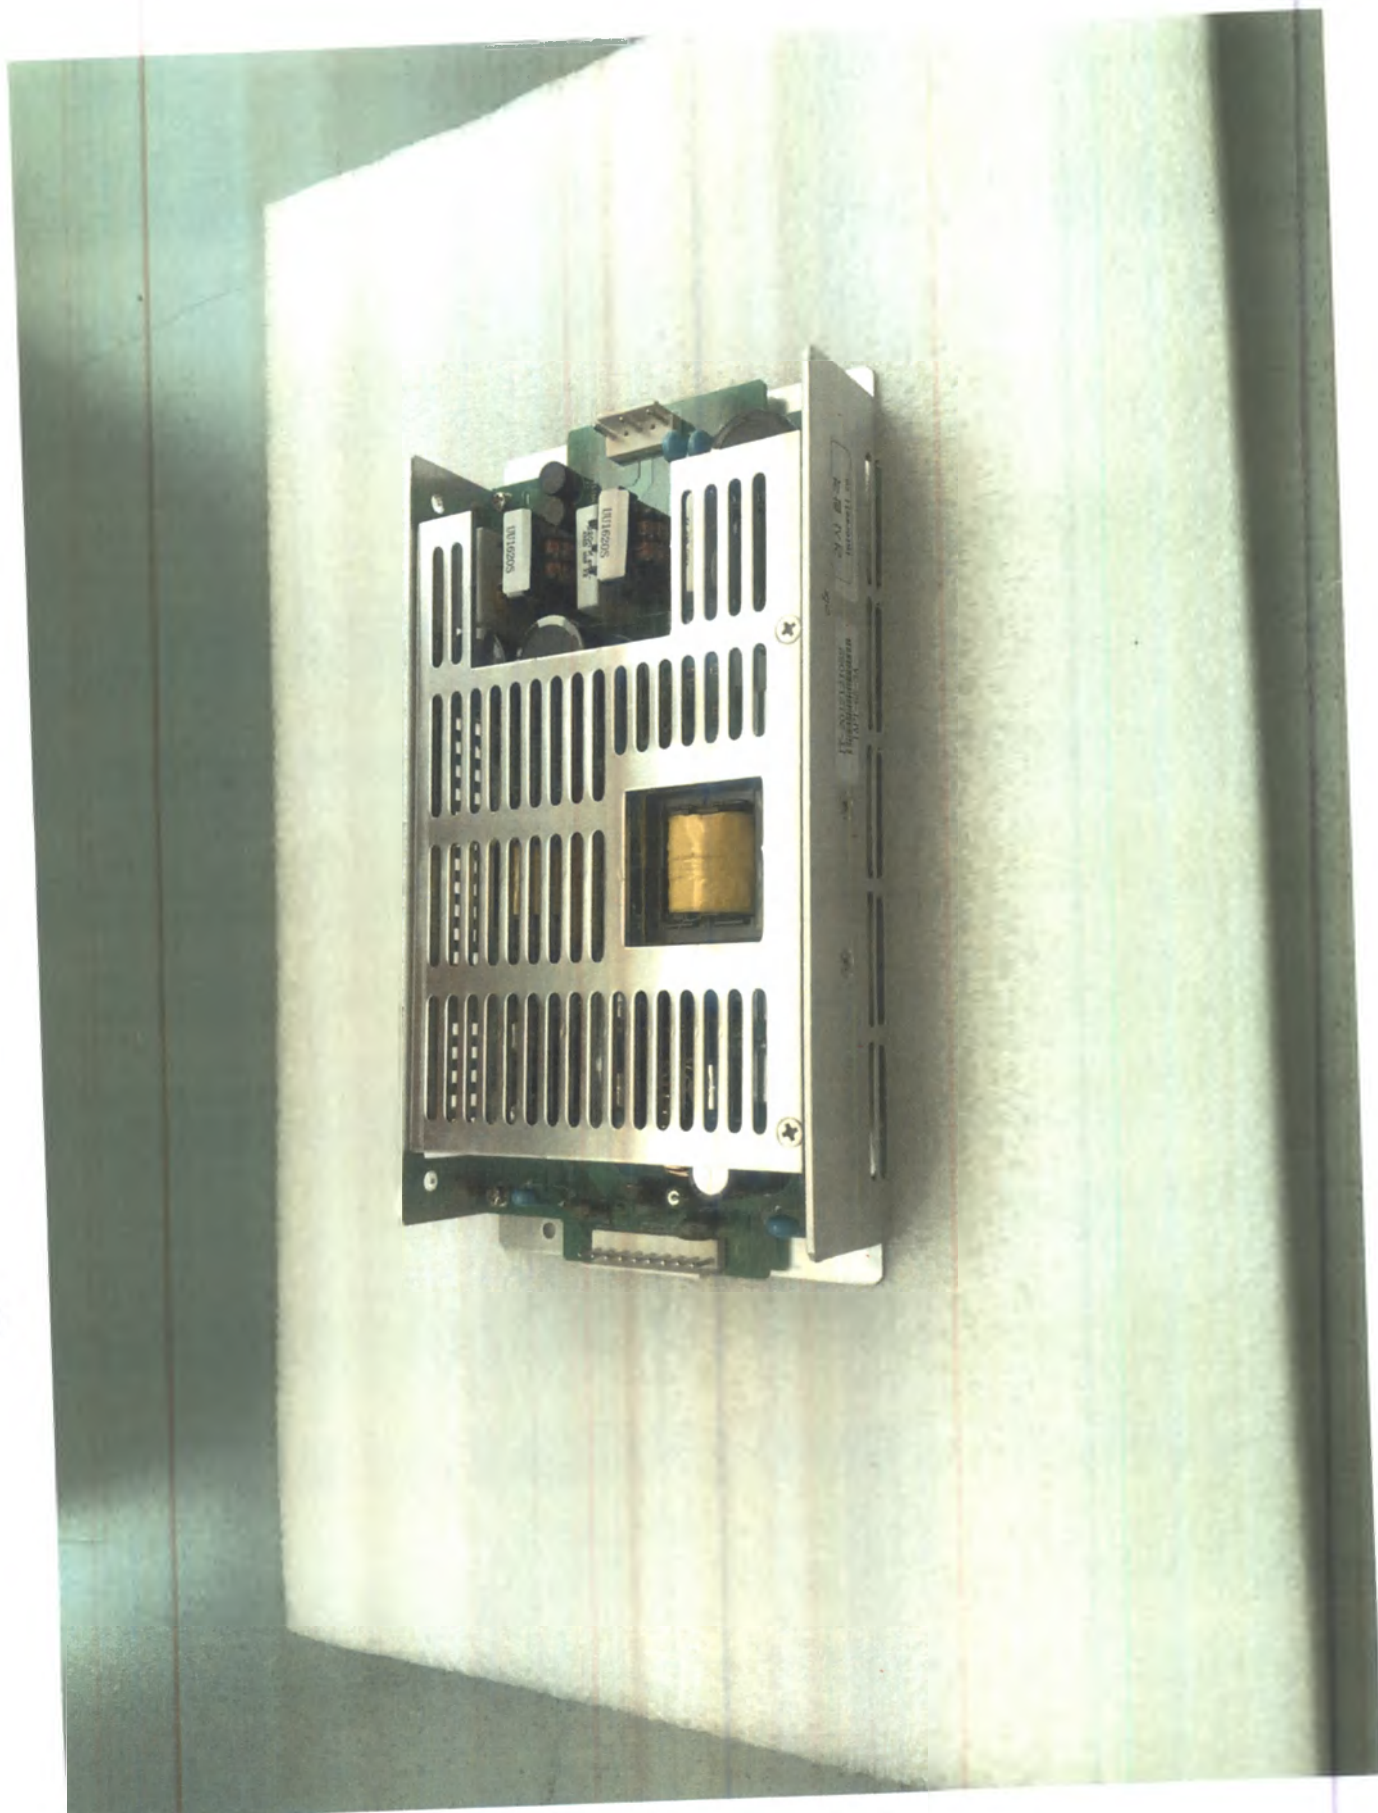


8. Блок питания.



9. Блок упора для подбородка.



10. Блок управления типа джойстик.

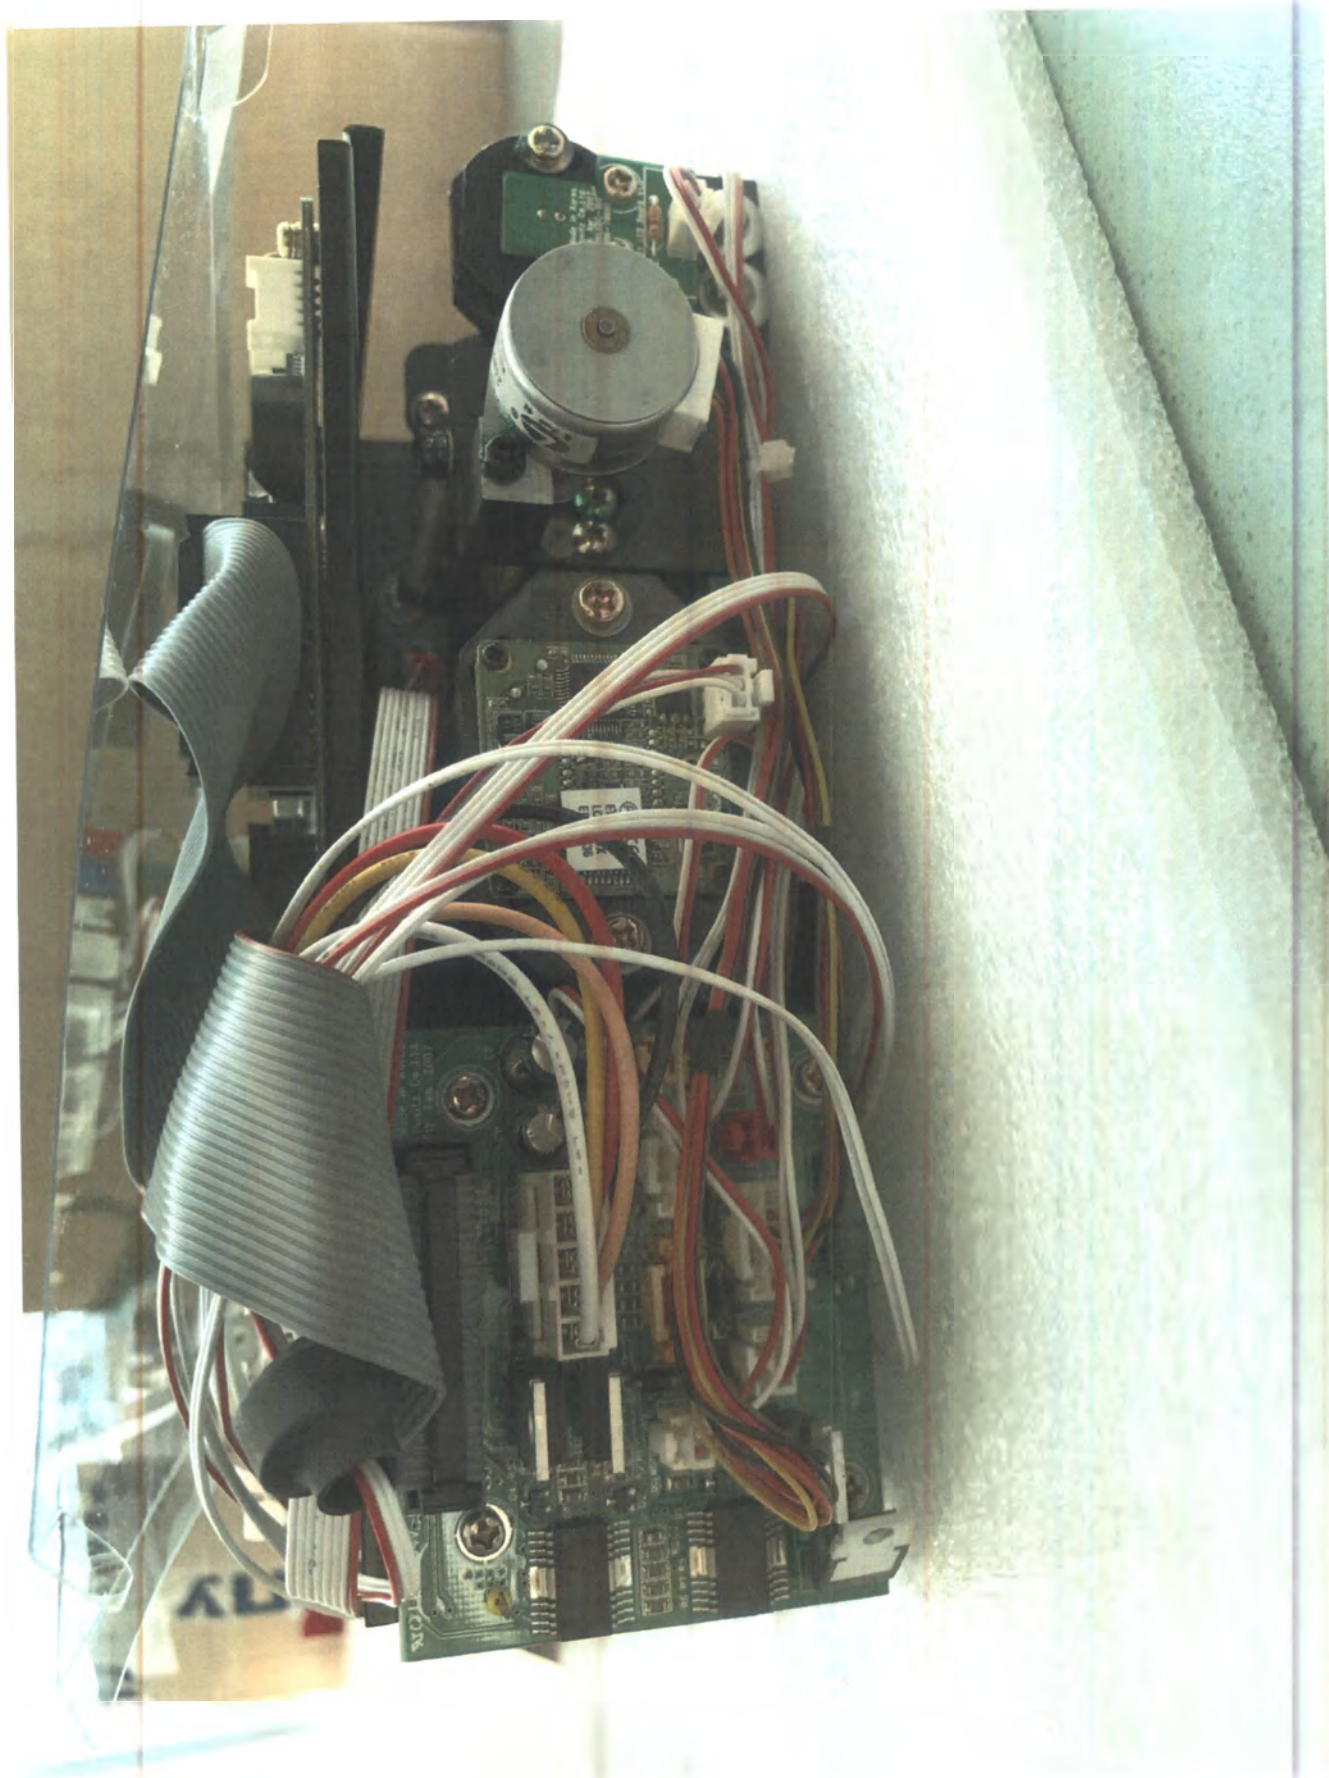


11. Блок интерфейсный передачи данных измерения.




12. Термопринтер специальный встраиваемый.




13. Светодиод подсветки специальный.

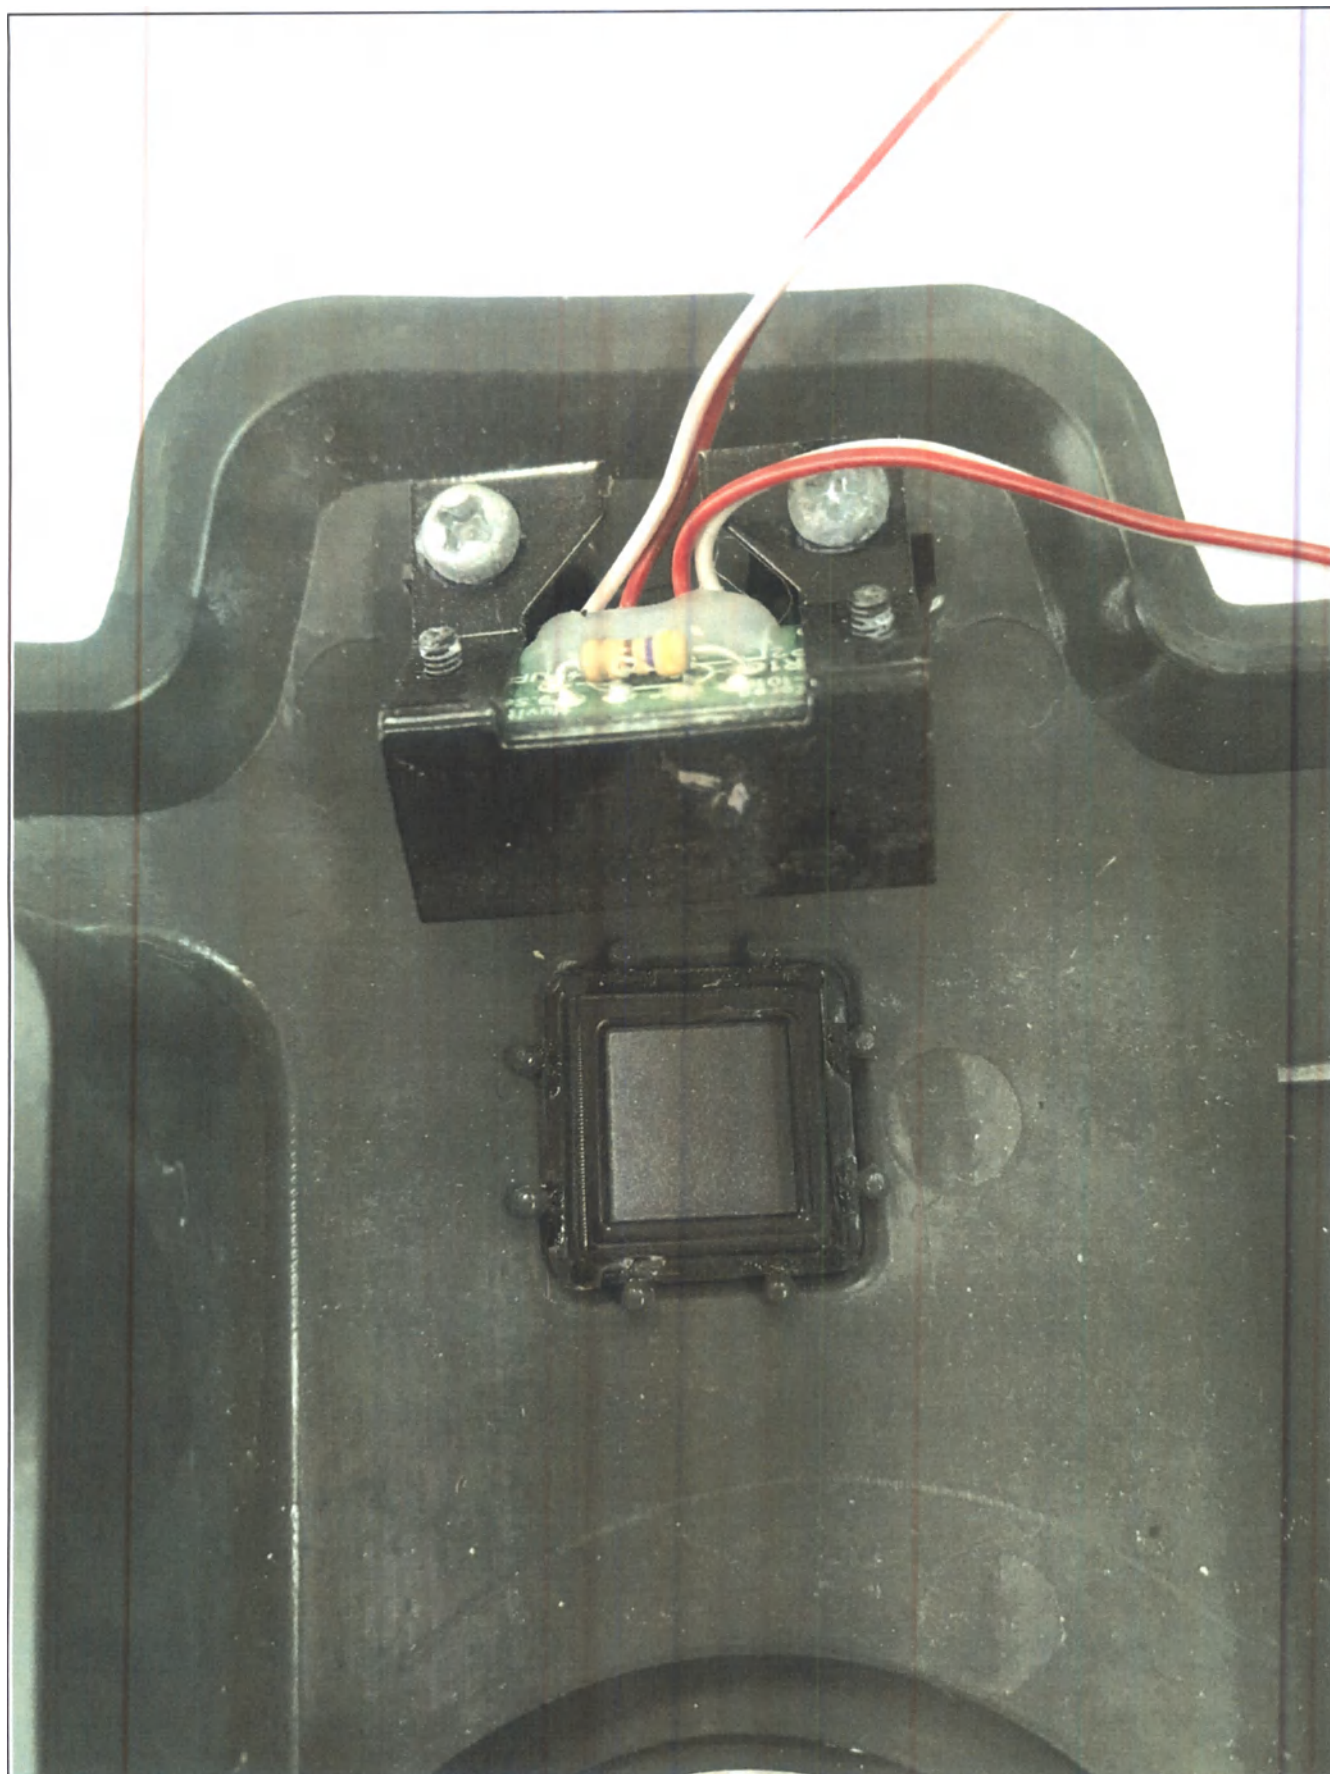


14. Светодиод подсветки с рассеивателем специальный.

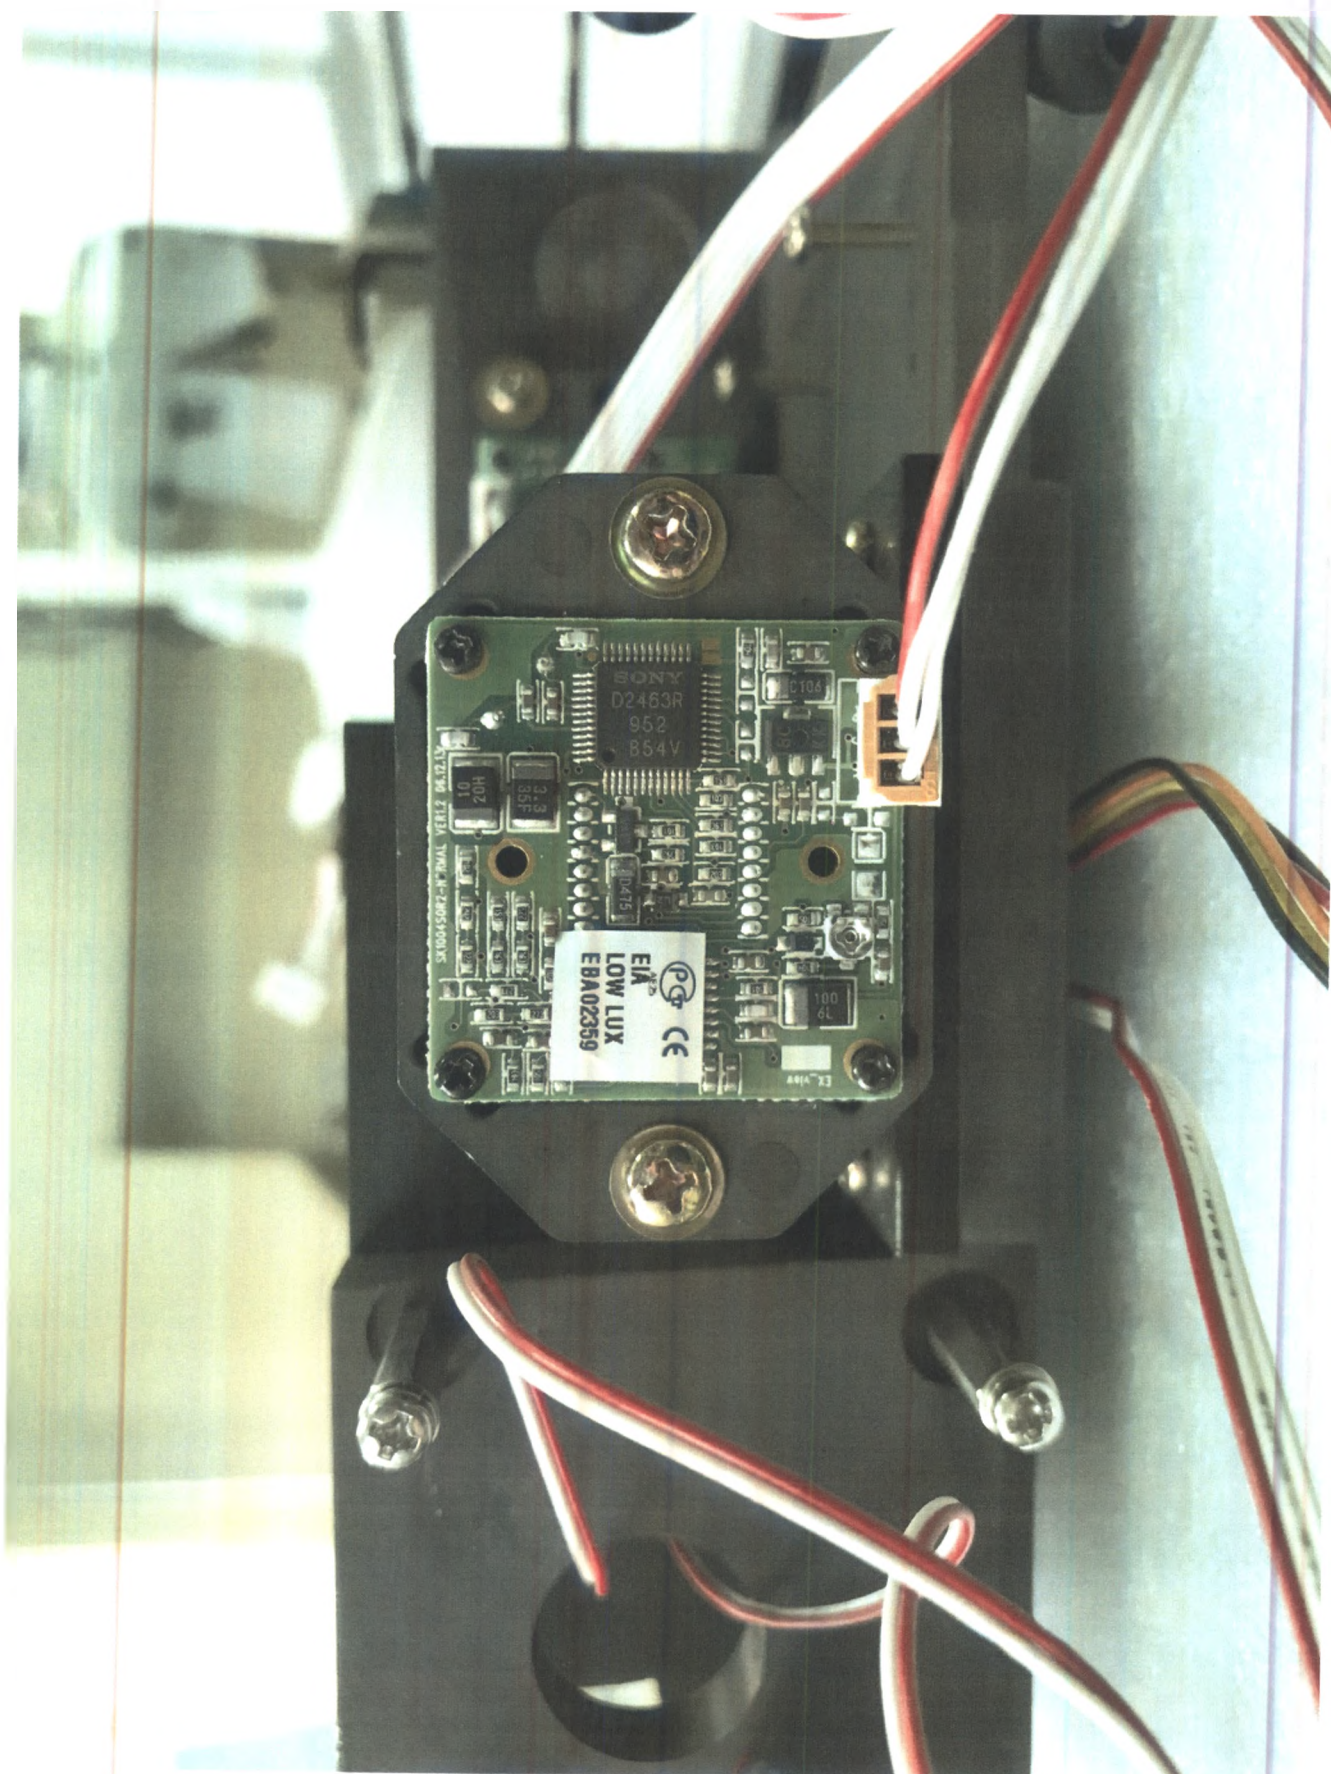


15. Камера-регистратор CCD специальная.

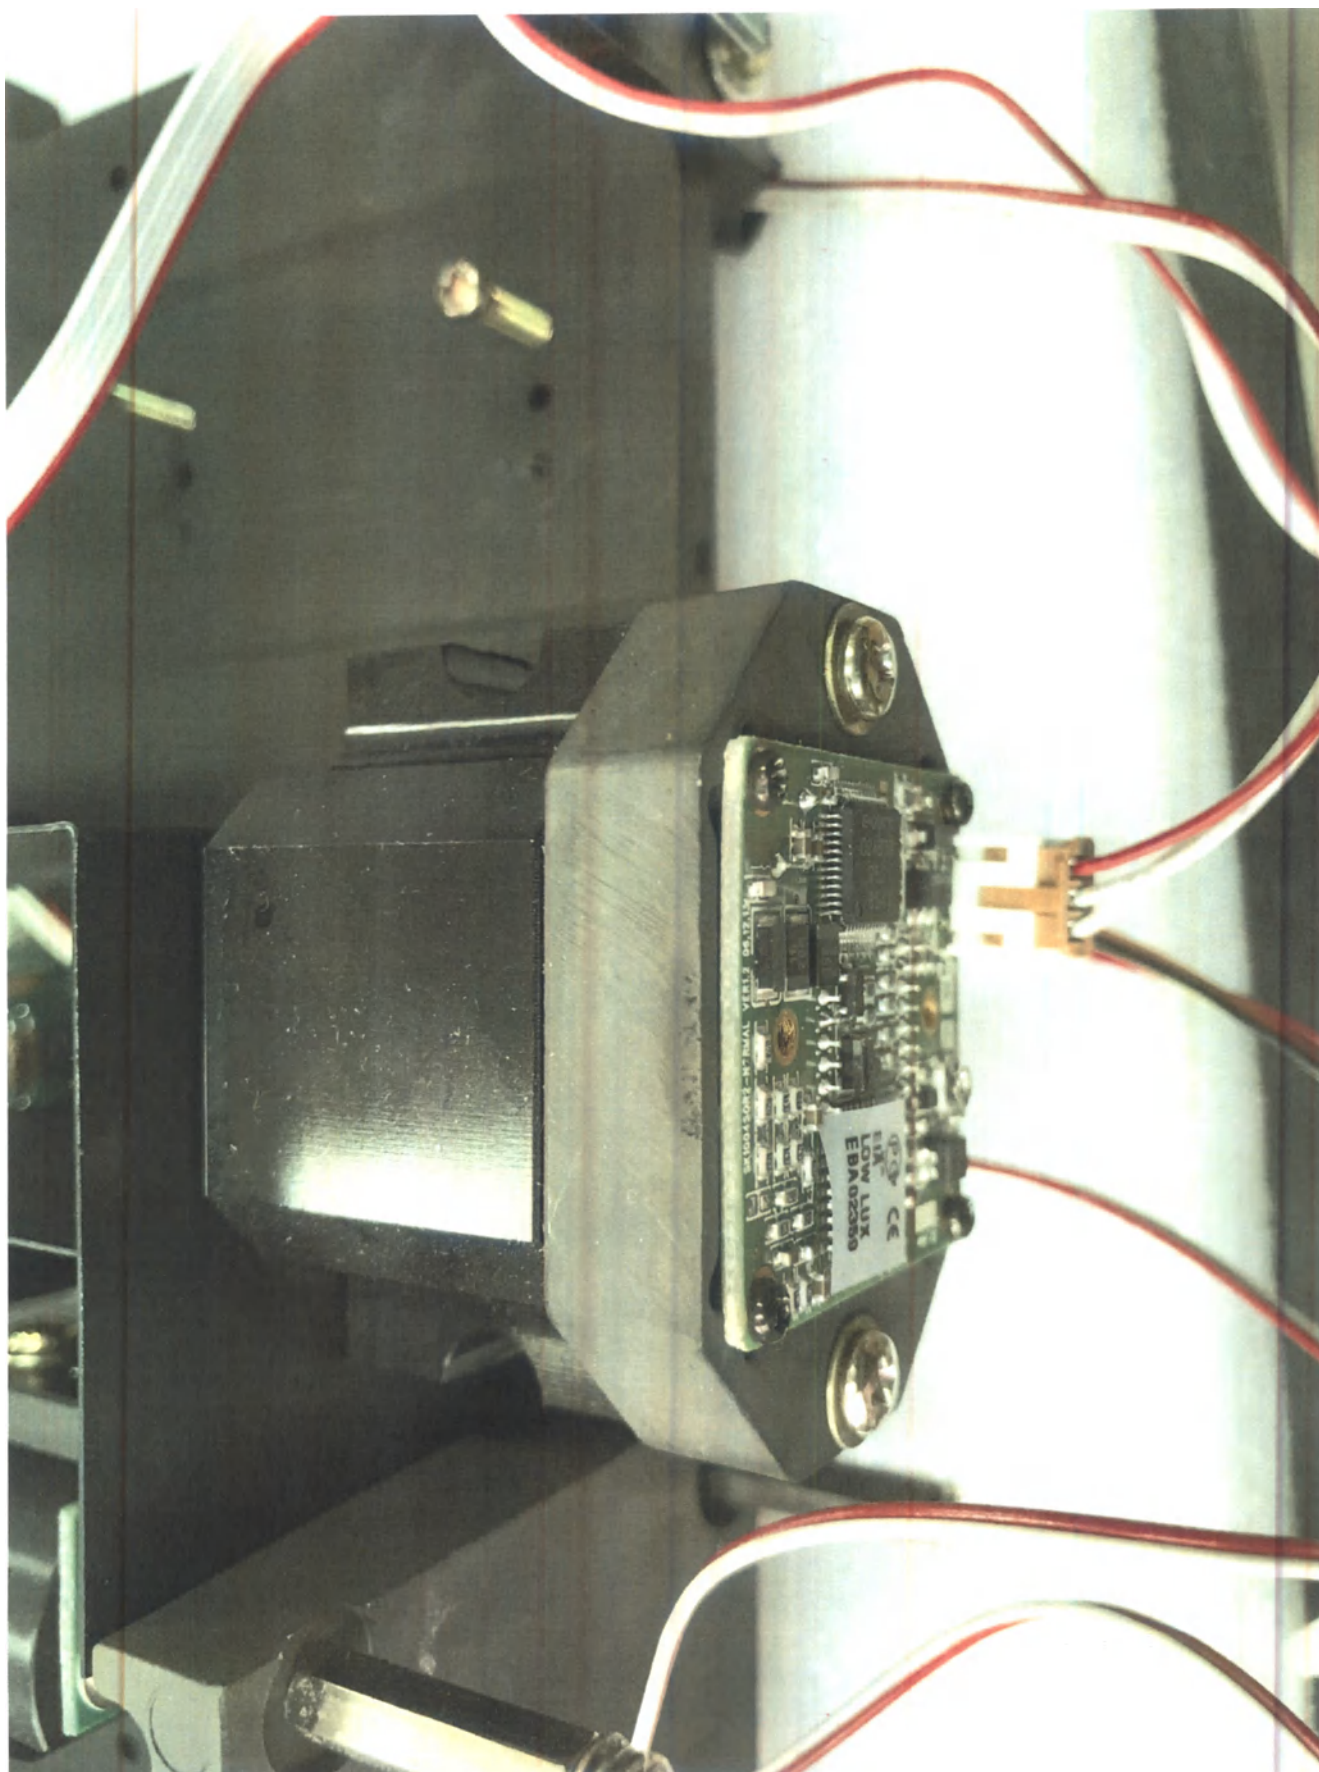

16. Устройство визуализации специальное.

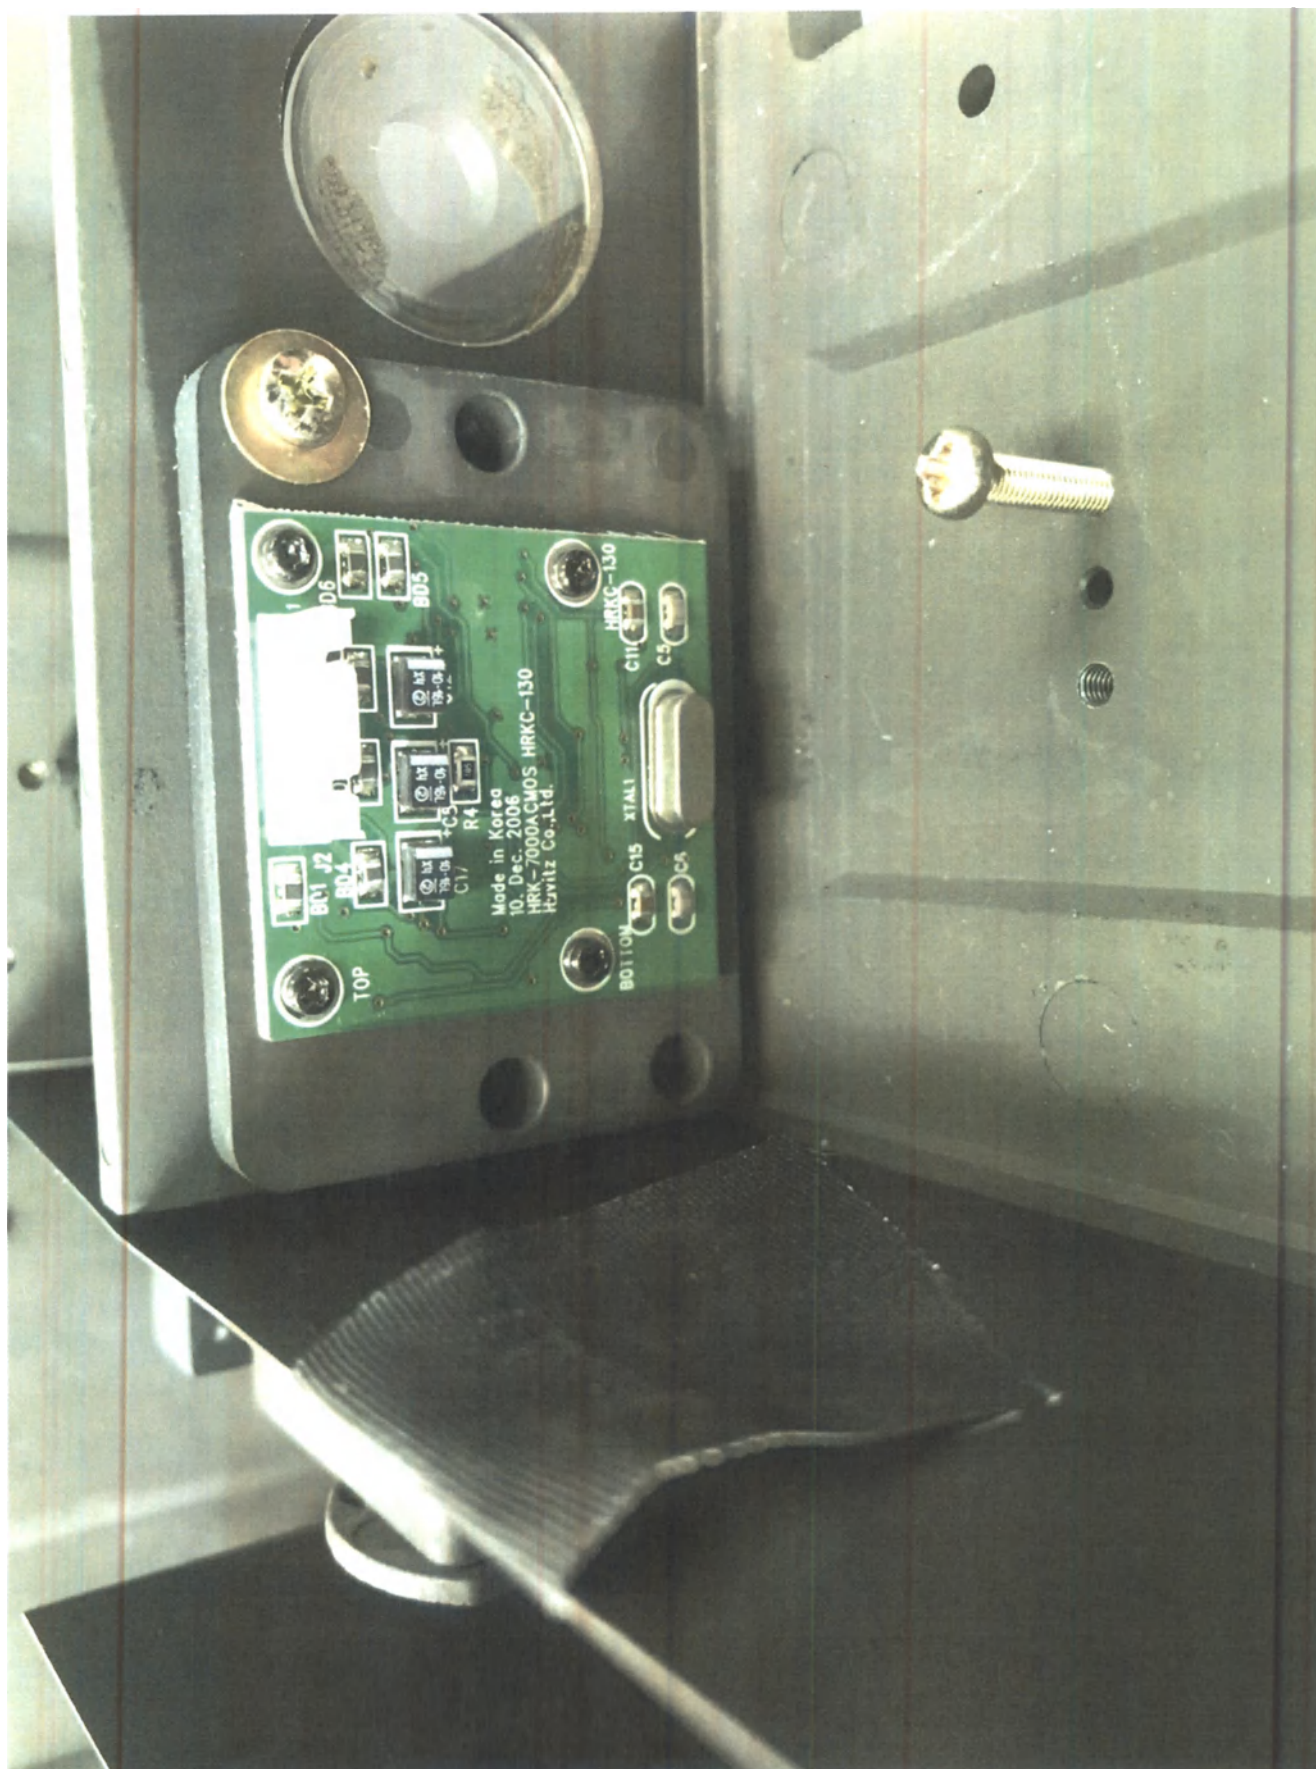


17. Камера-регистратор CMOS специальная.

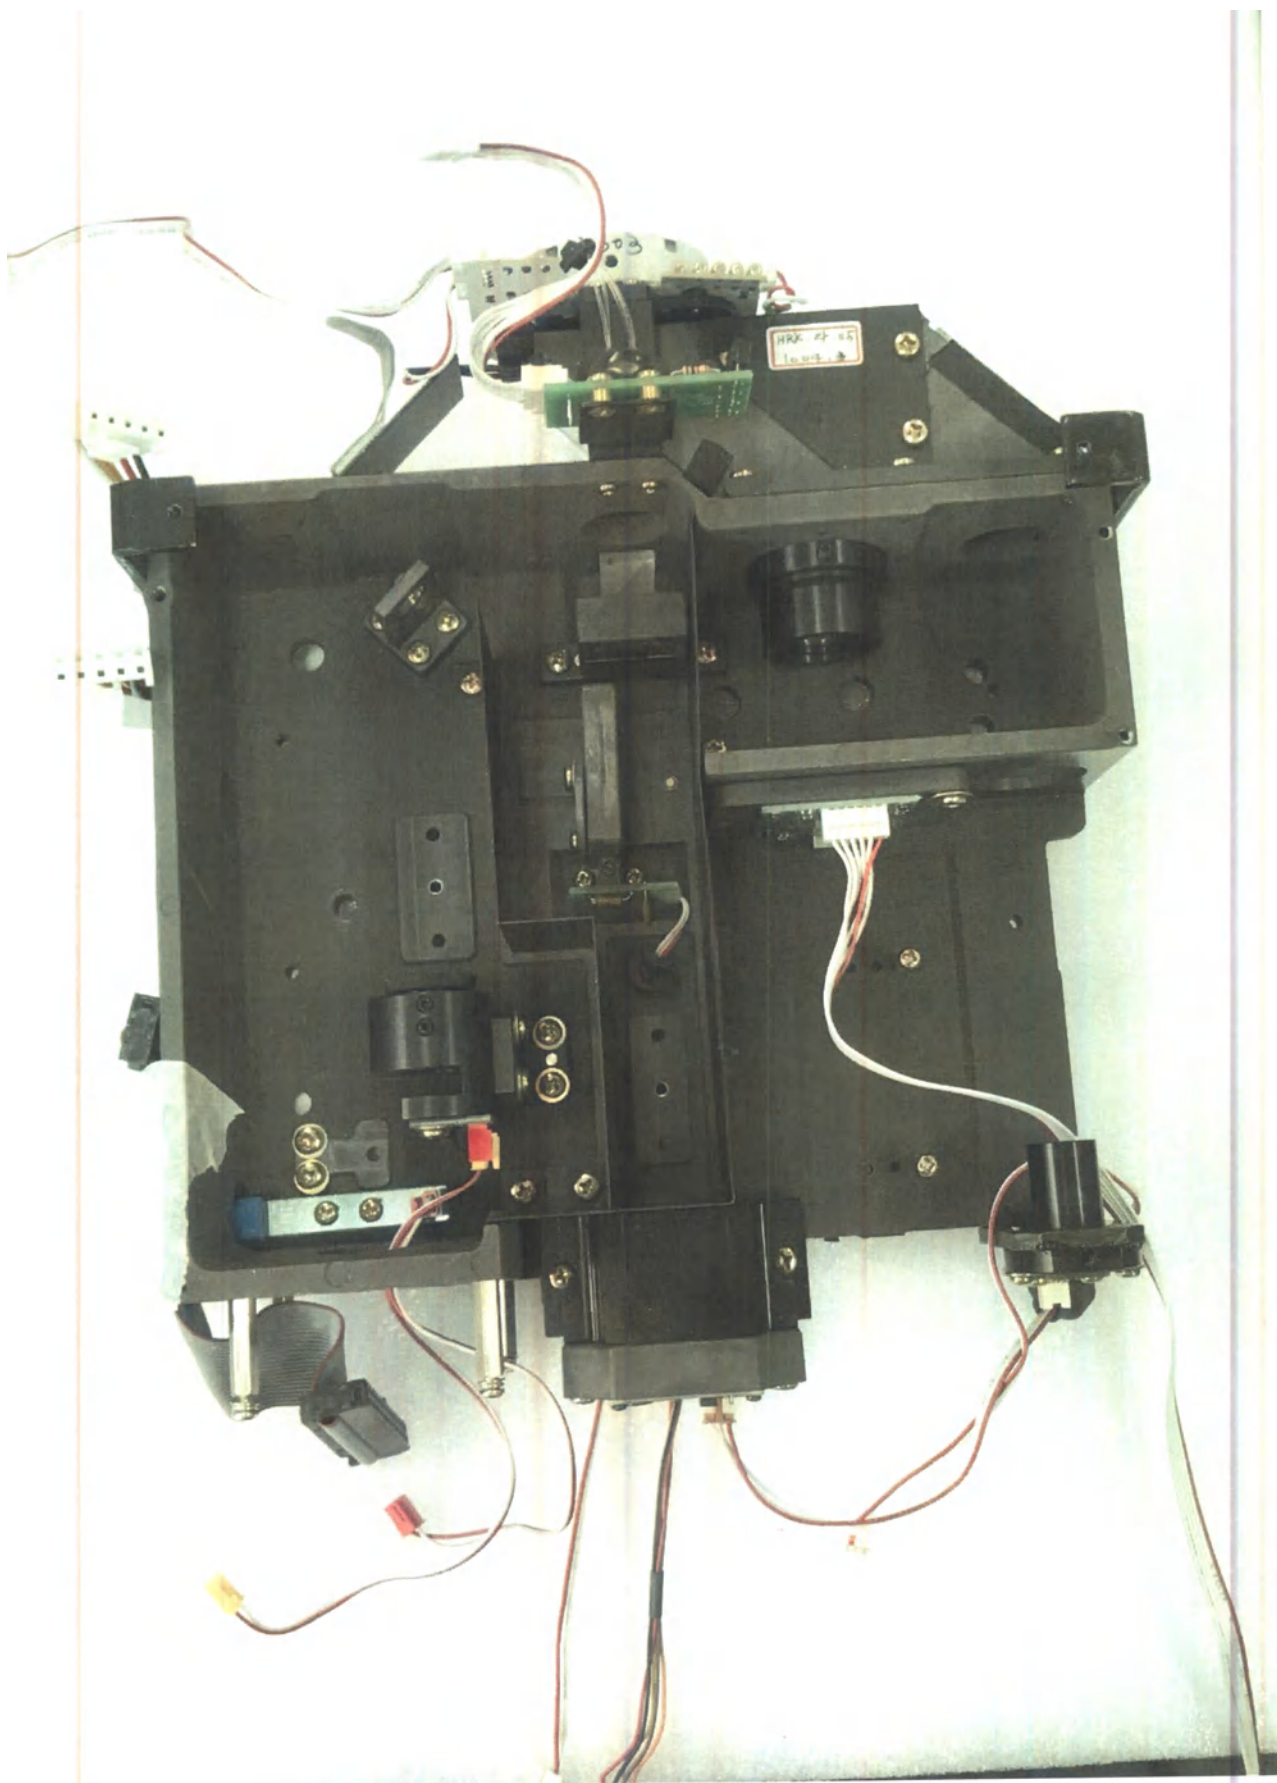

18. Массив микролинз.




19. Зеркало.

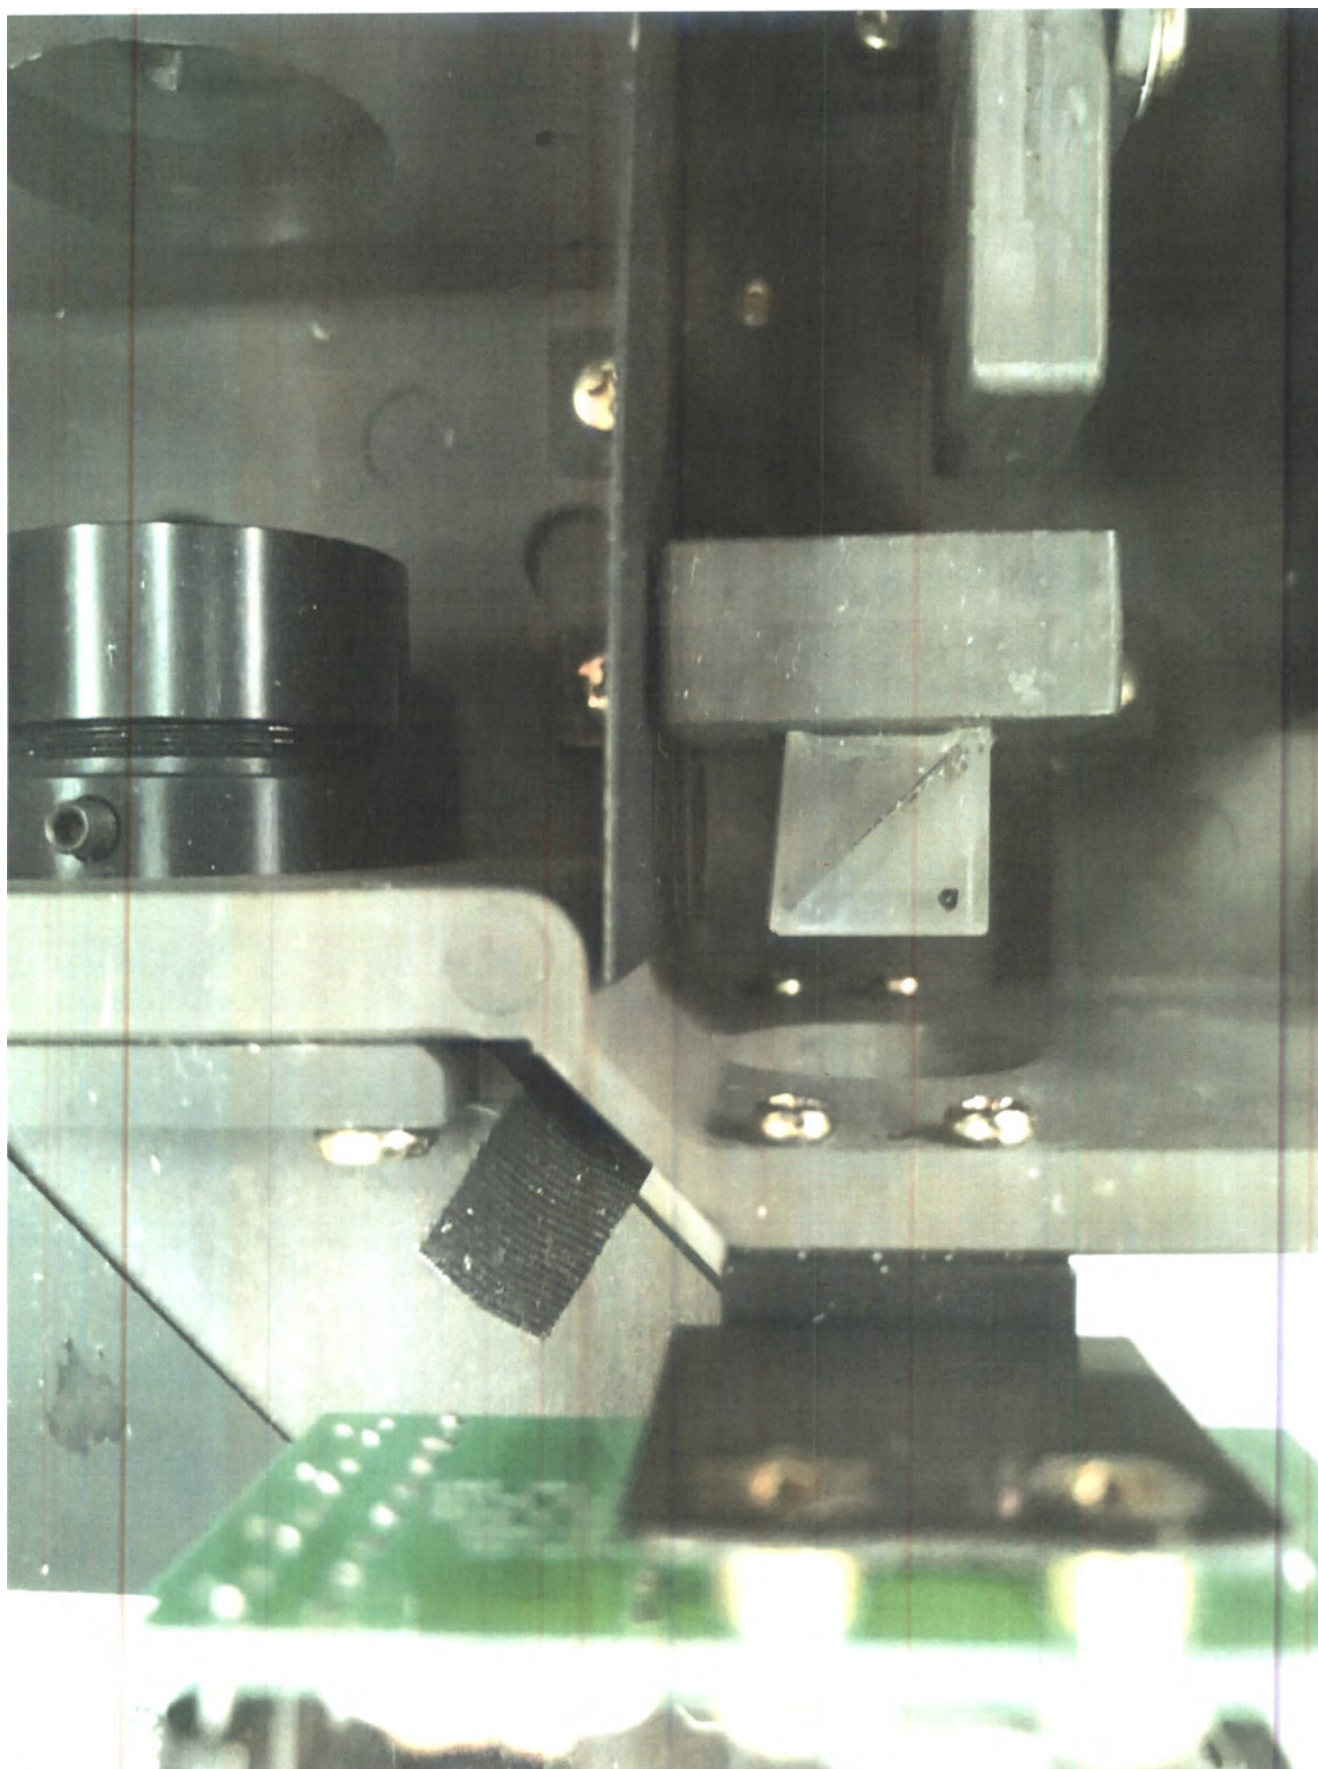

20. Призма.



21. Линза.

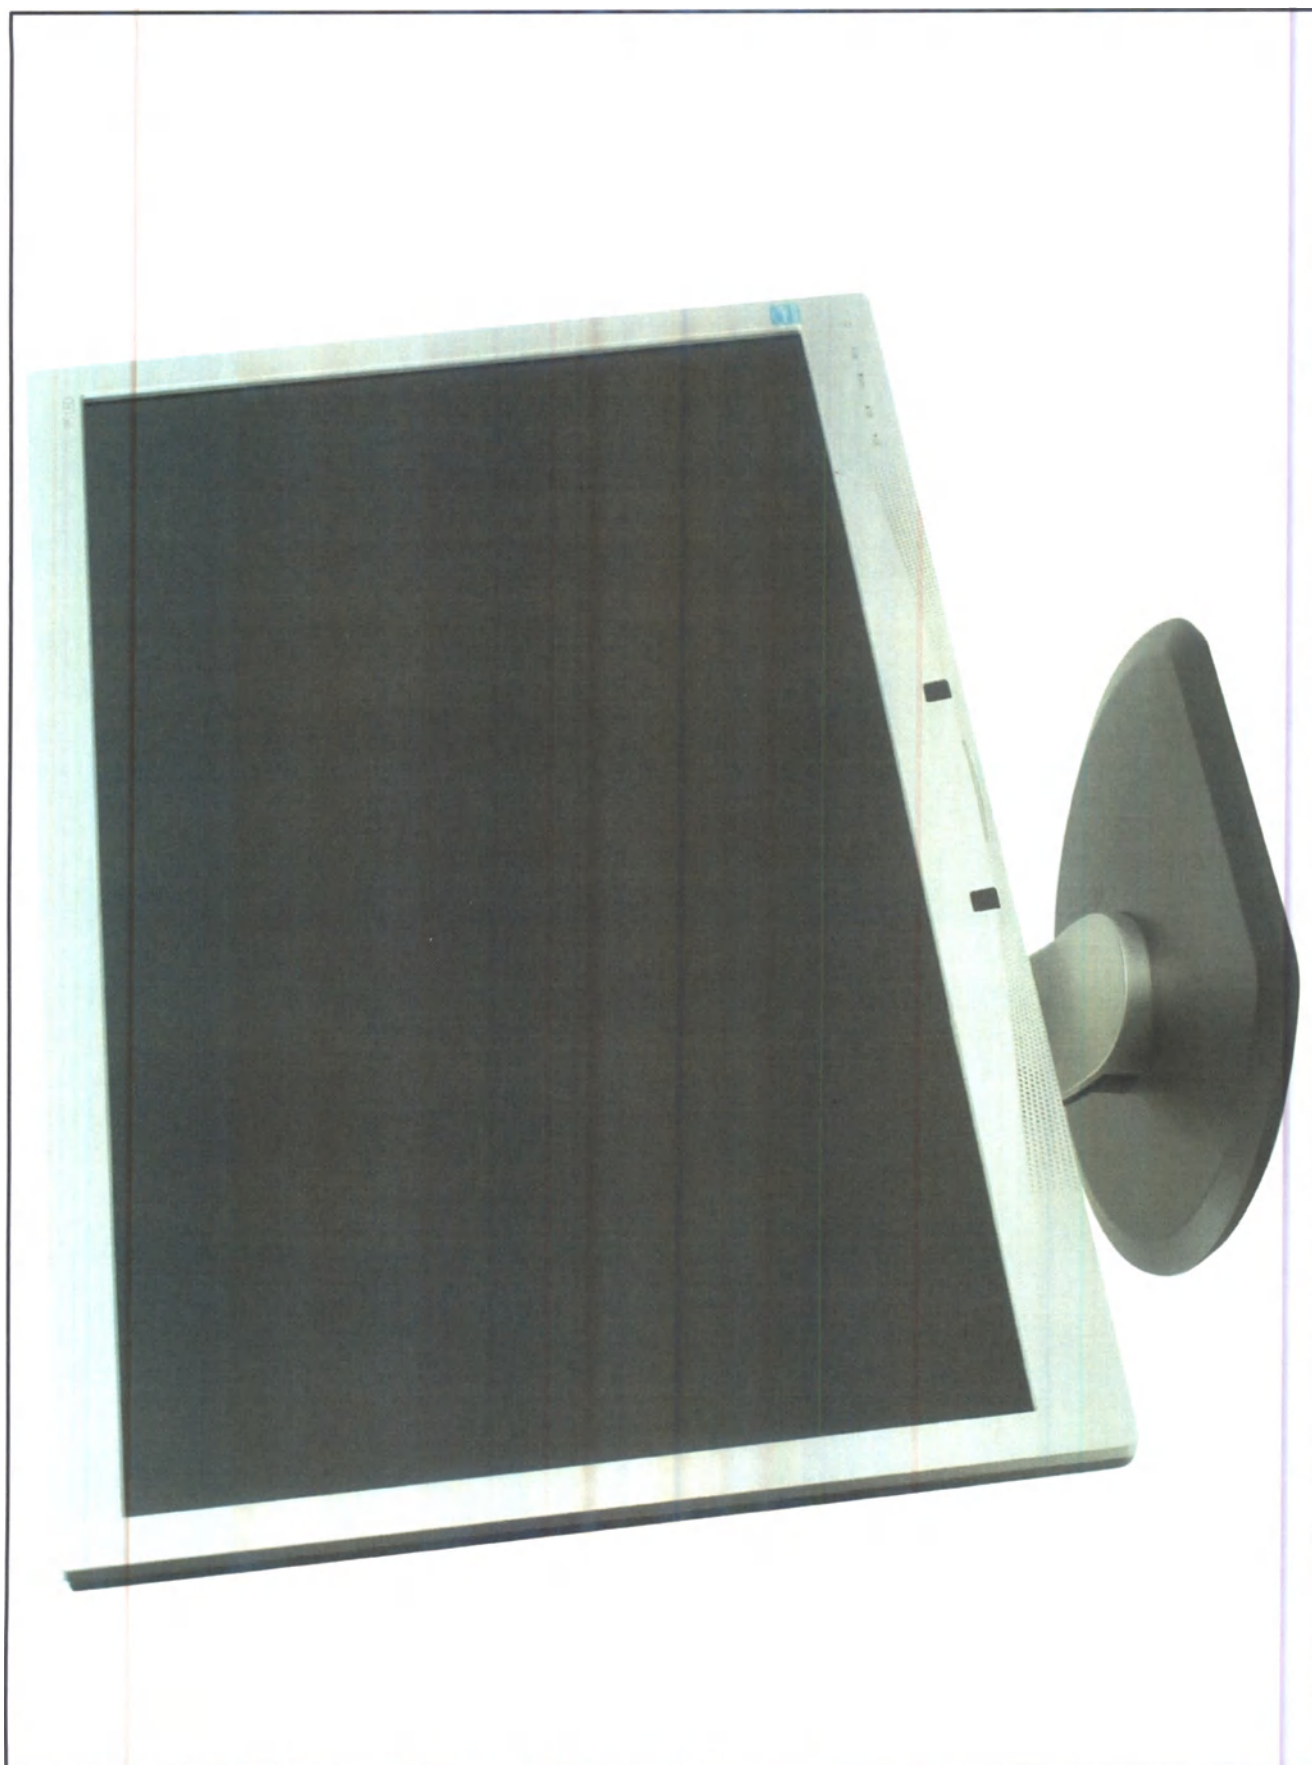


22. Монитор LCD внешний специальный.



23. Дисплей встраиваемый для HRK-7000A.




23. Дисплей встраиваемый для HRK-8000A.

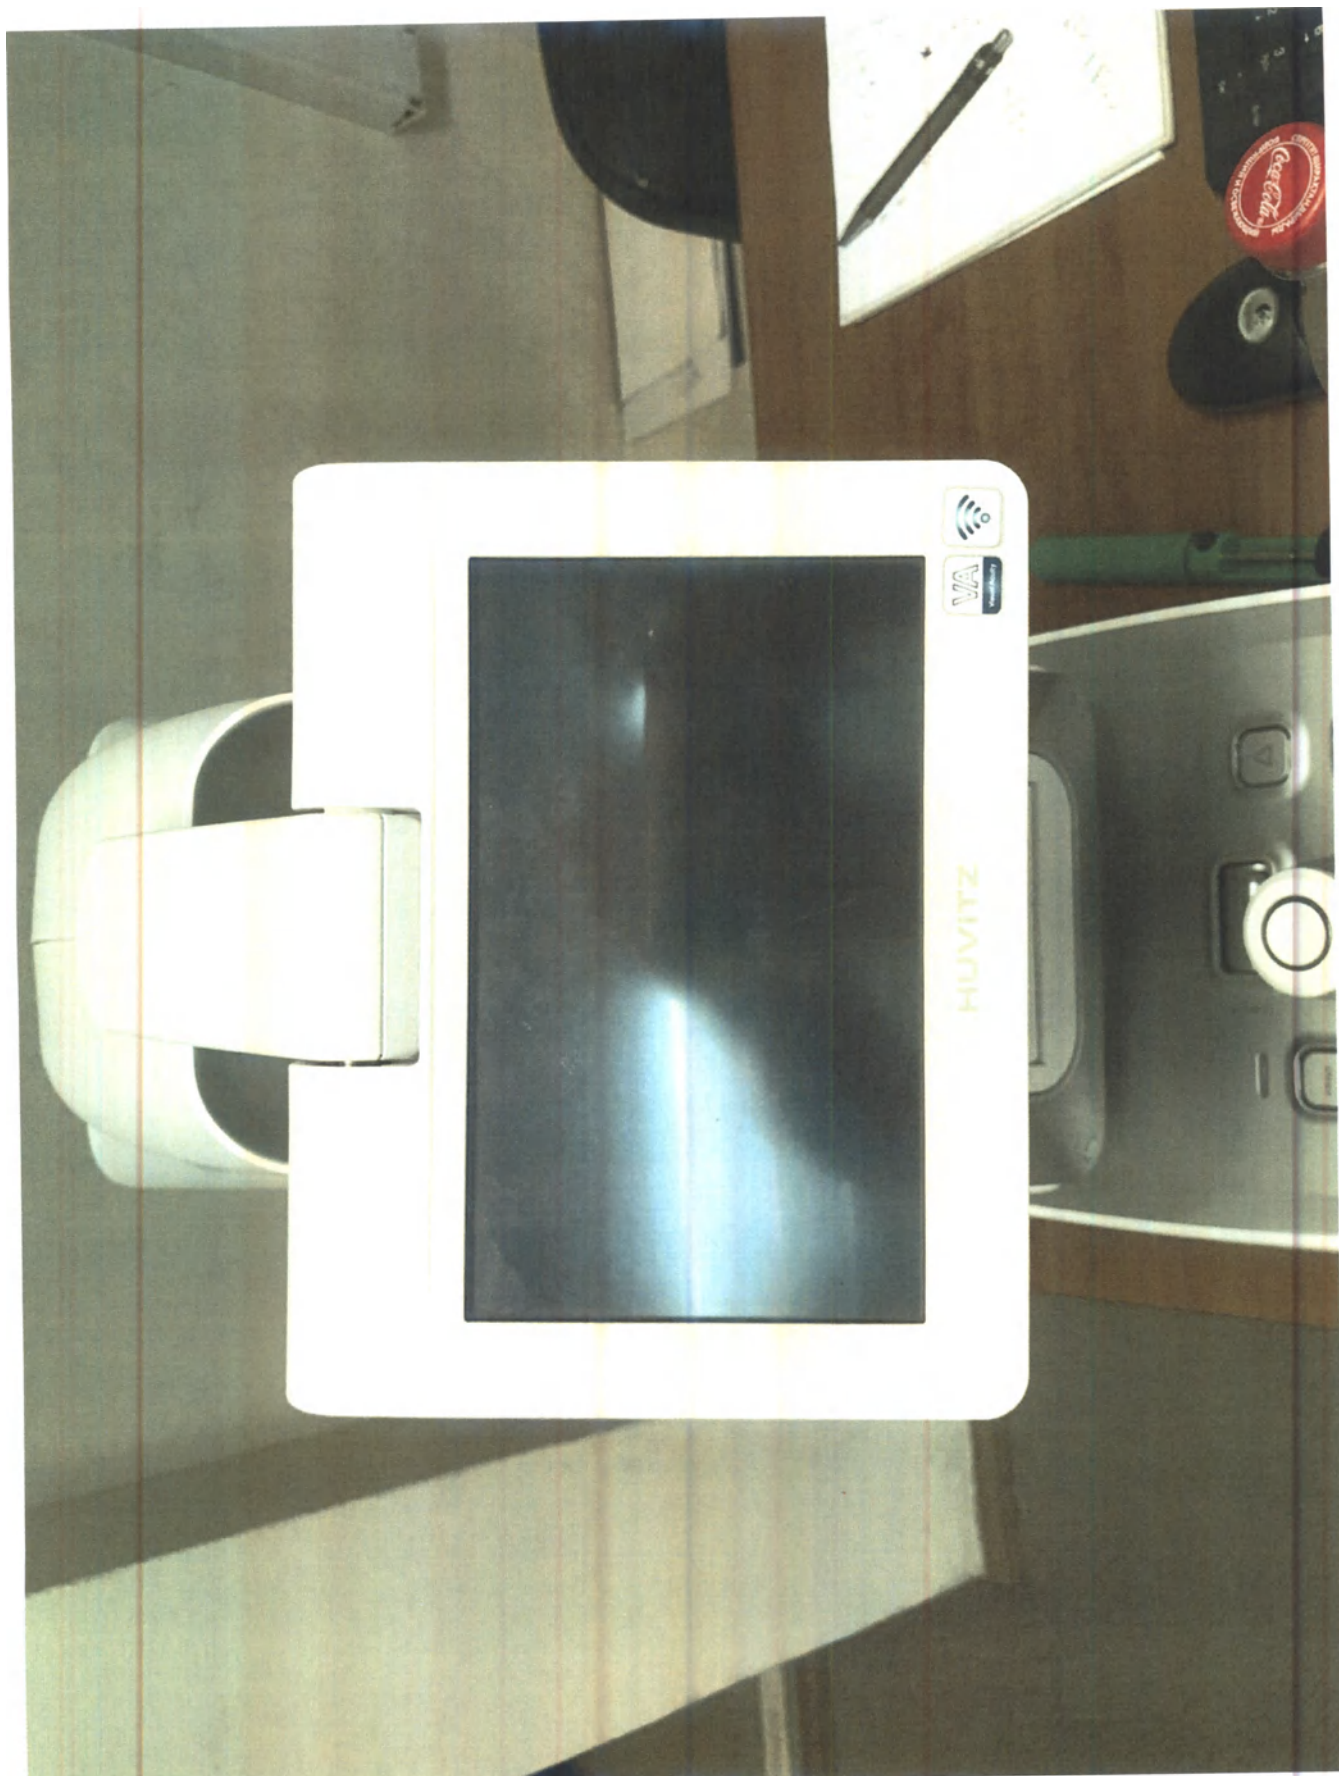


23. Дисплей встраиваемый для HRK-9000A.




23. Дисплей встраиваемый для HRK-1.

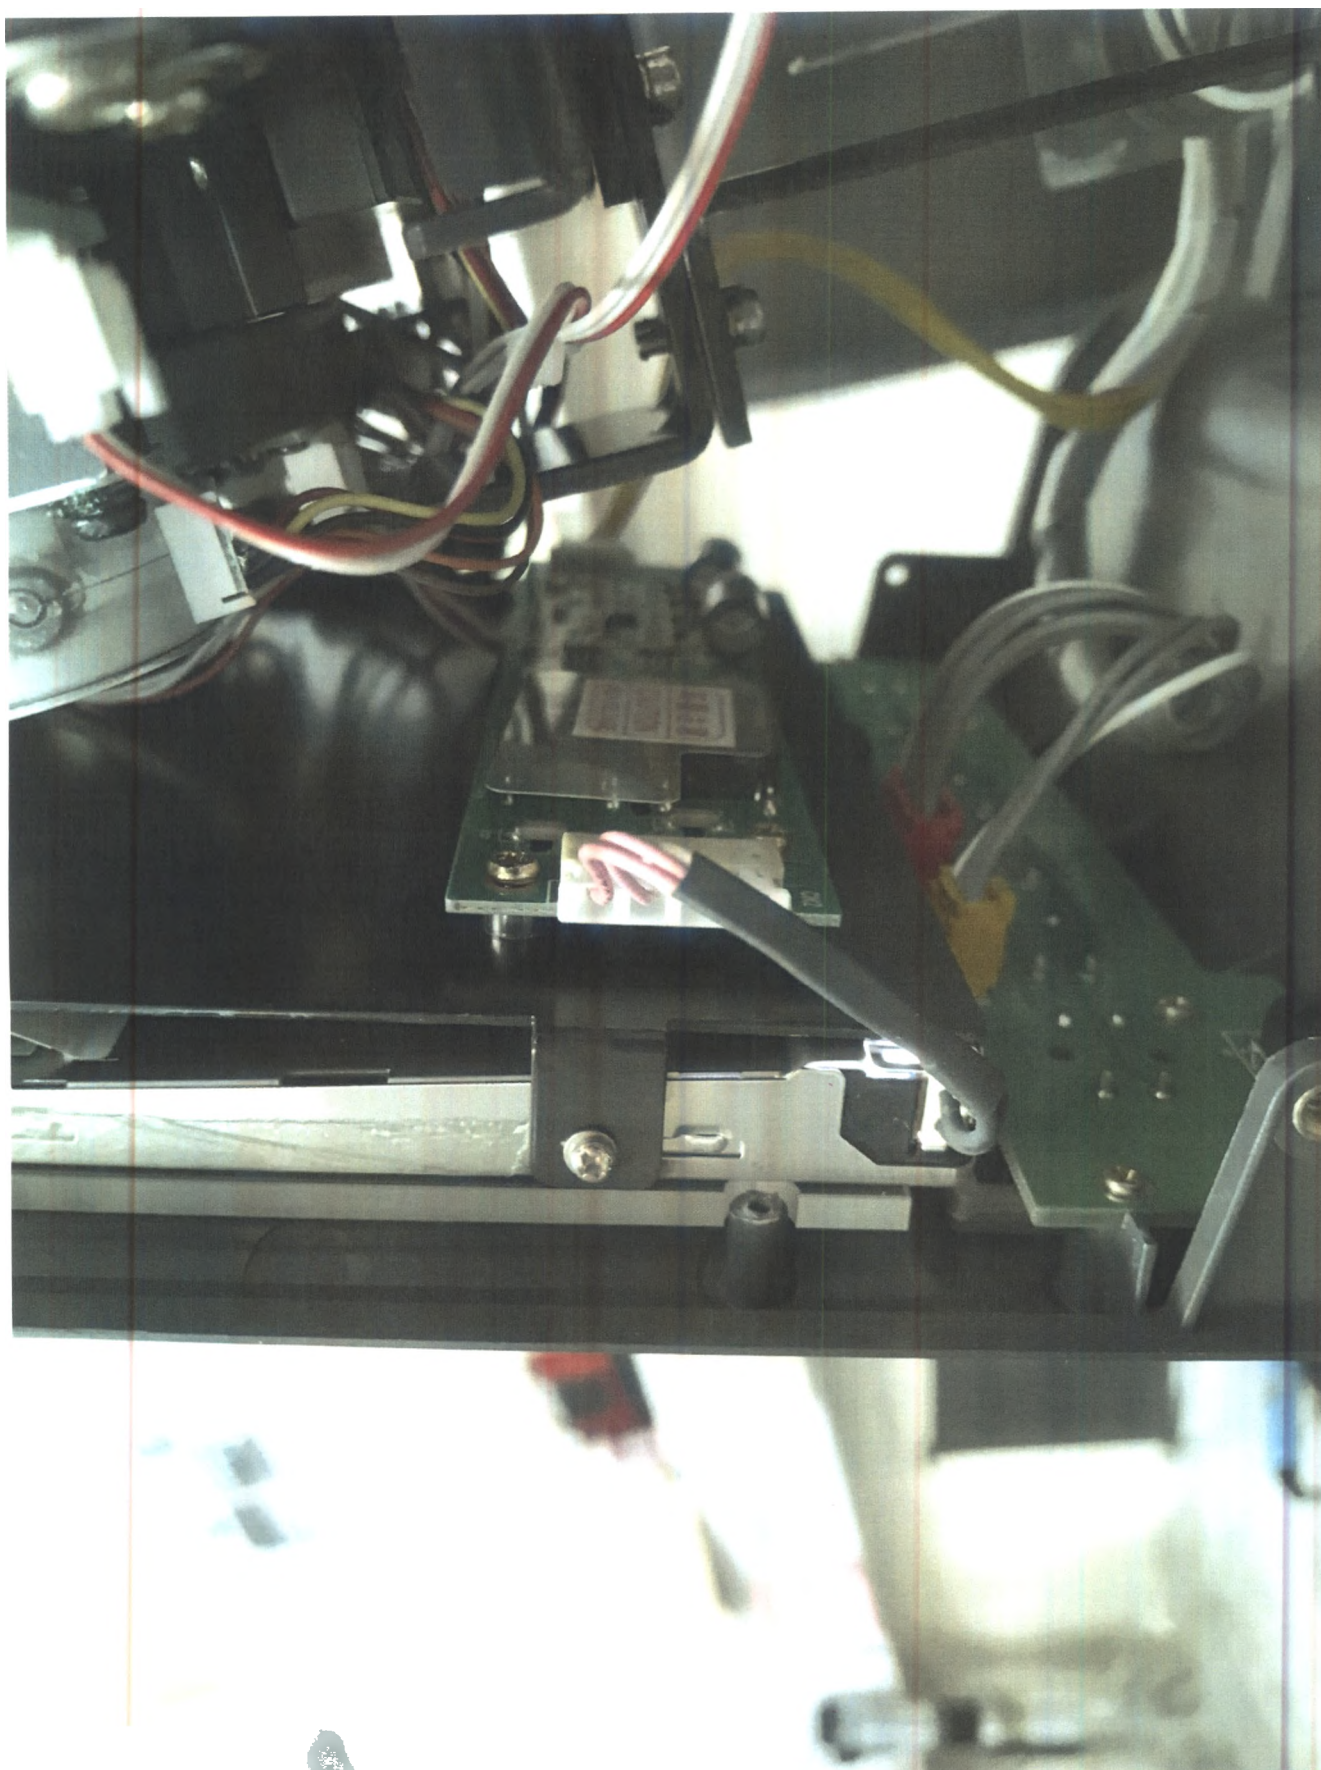


24. Блок подсветки монитора.

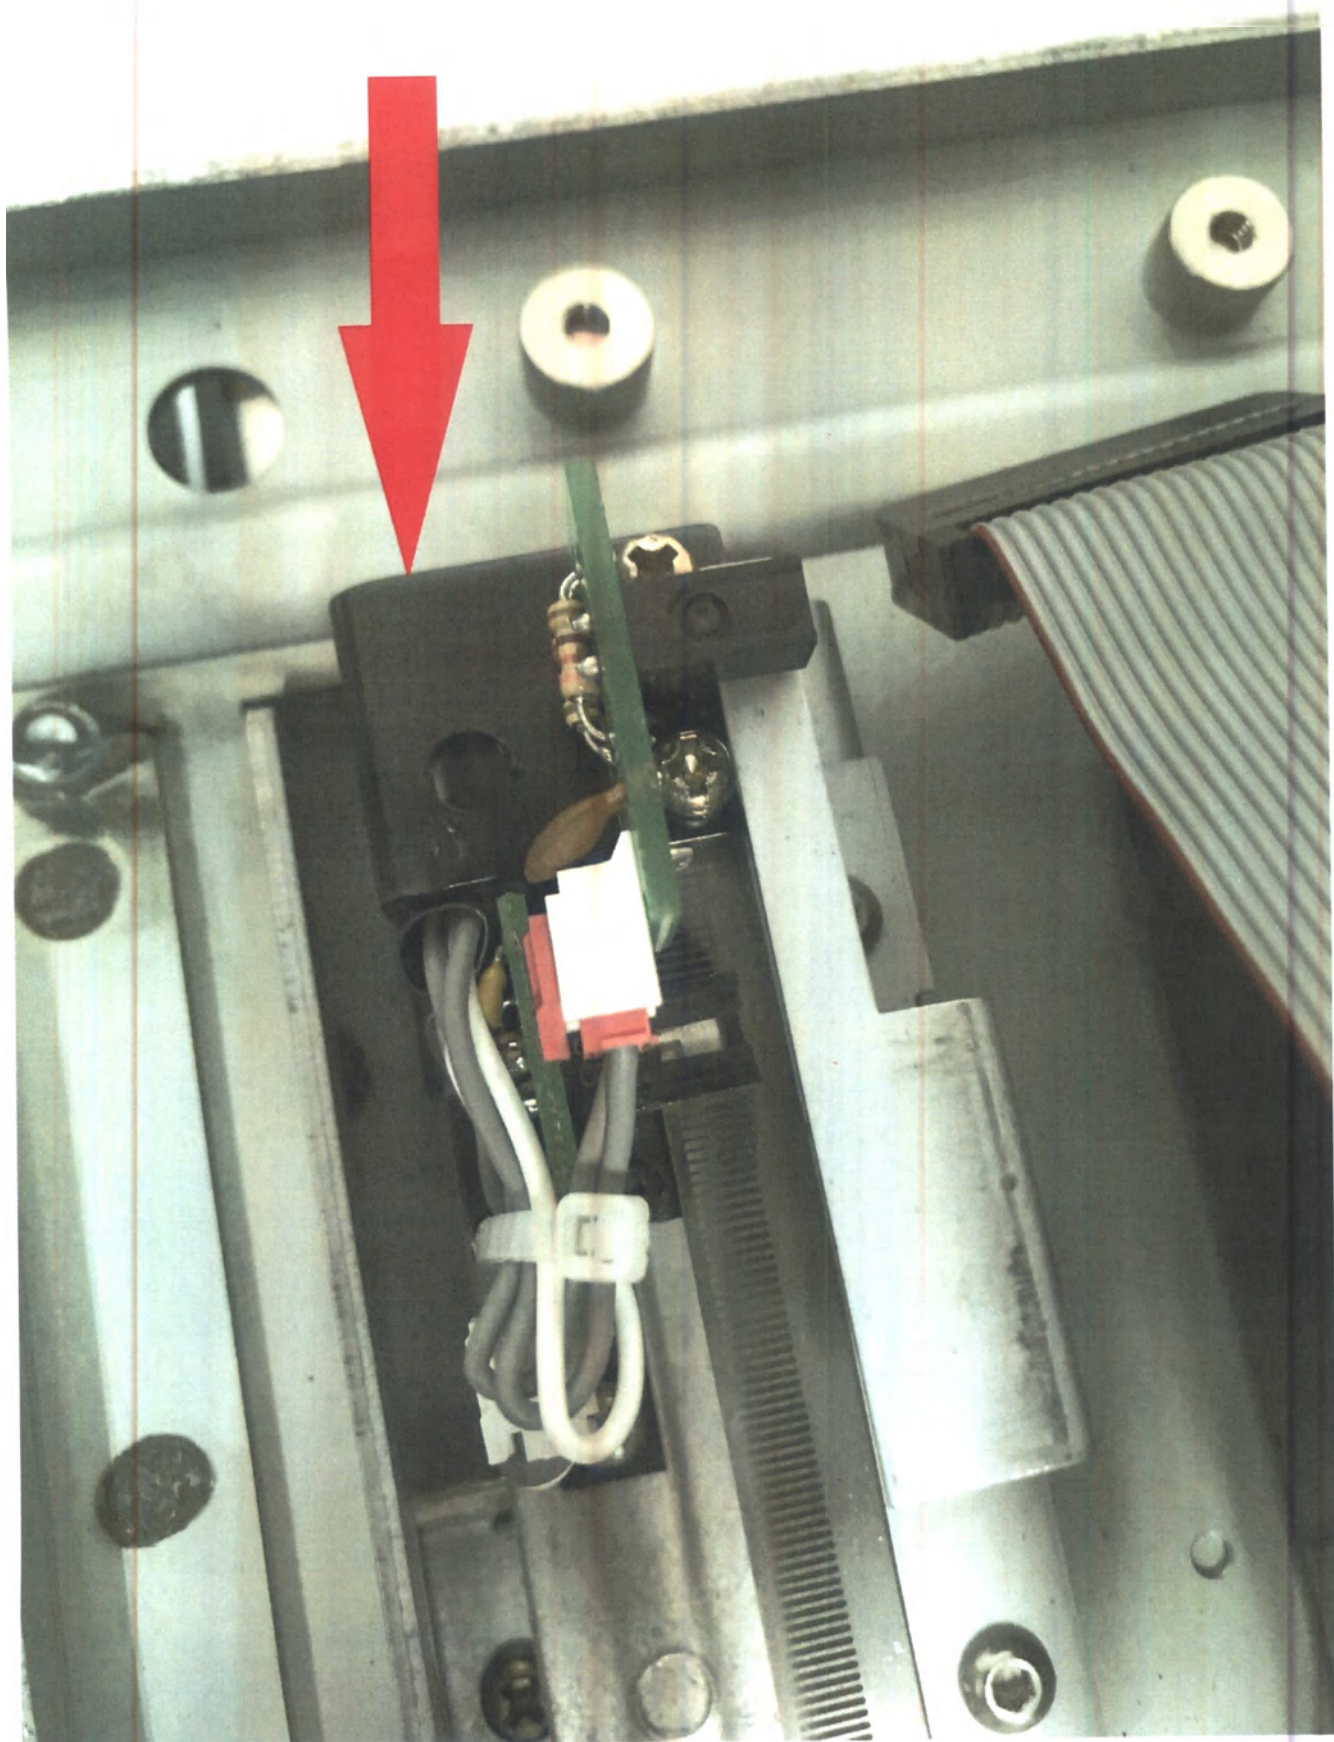


25. Датчик перемещения.

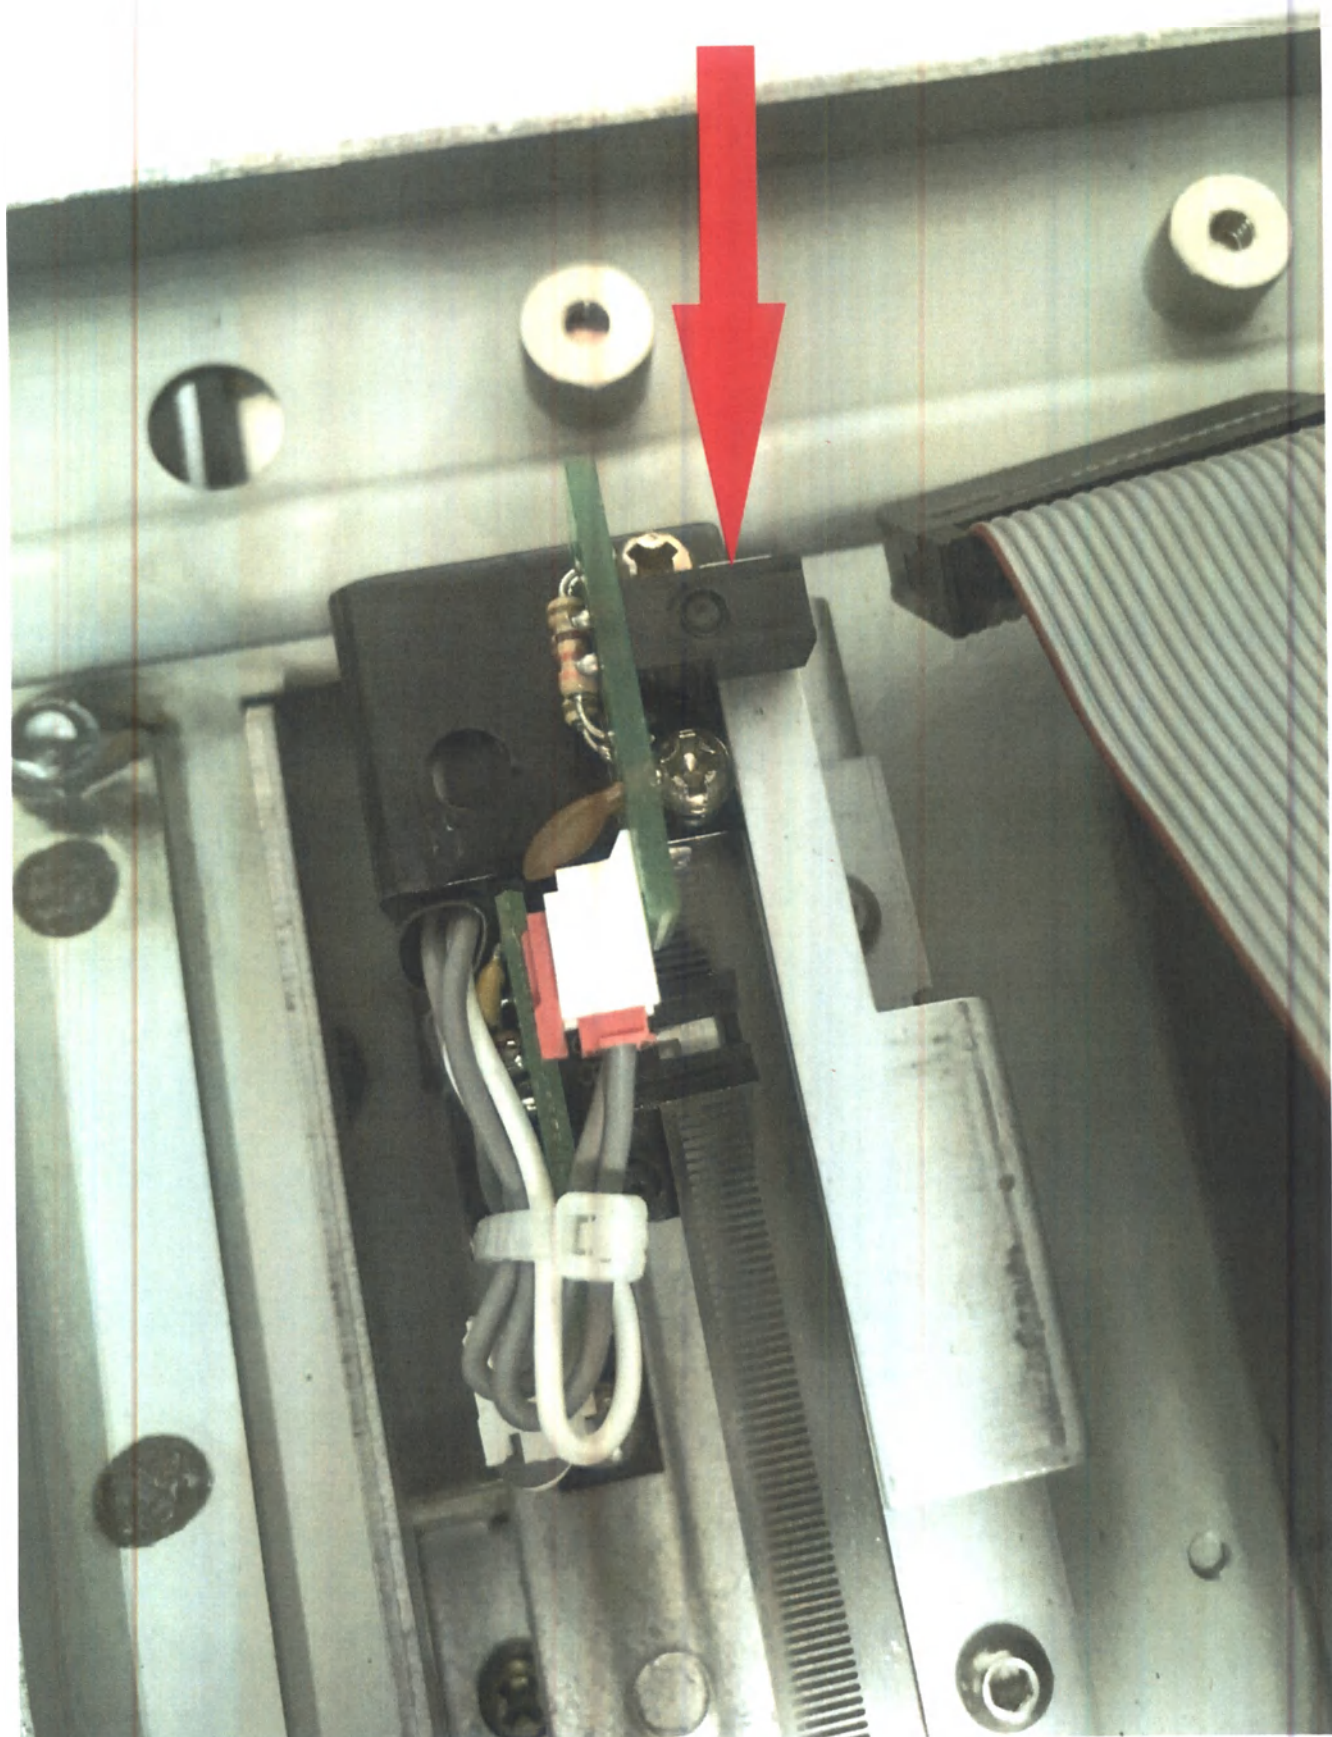


26. Датчик концевой оптический специальный.

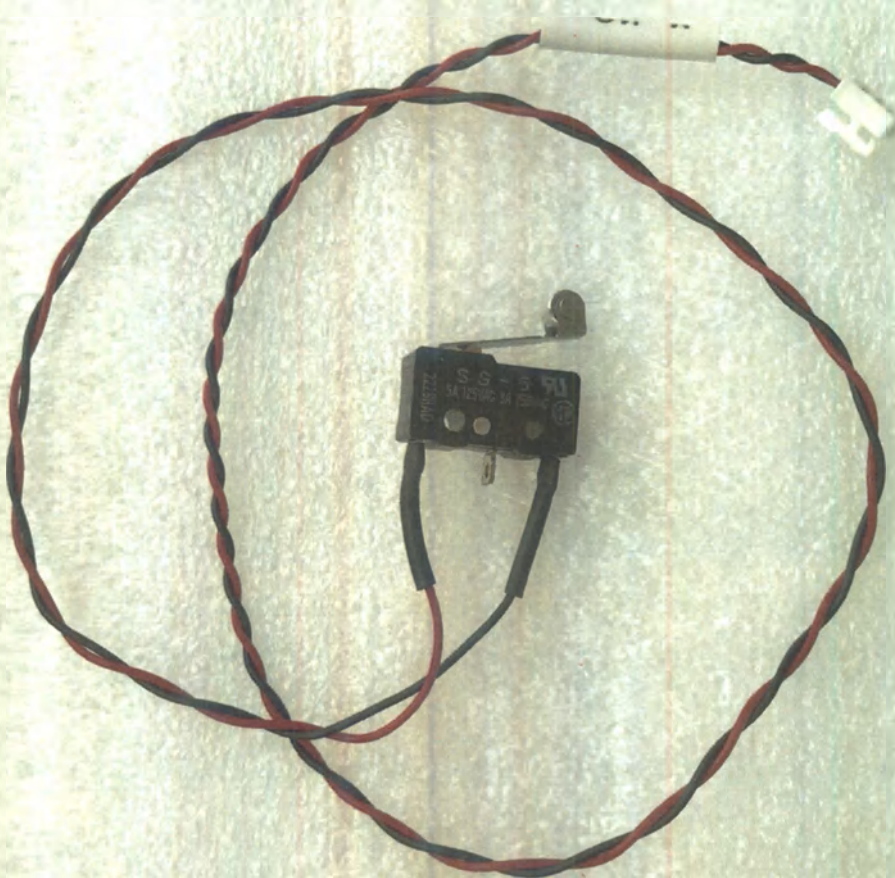


27. Датчик концевой механический специальный.

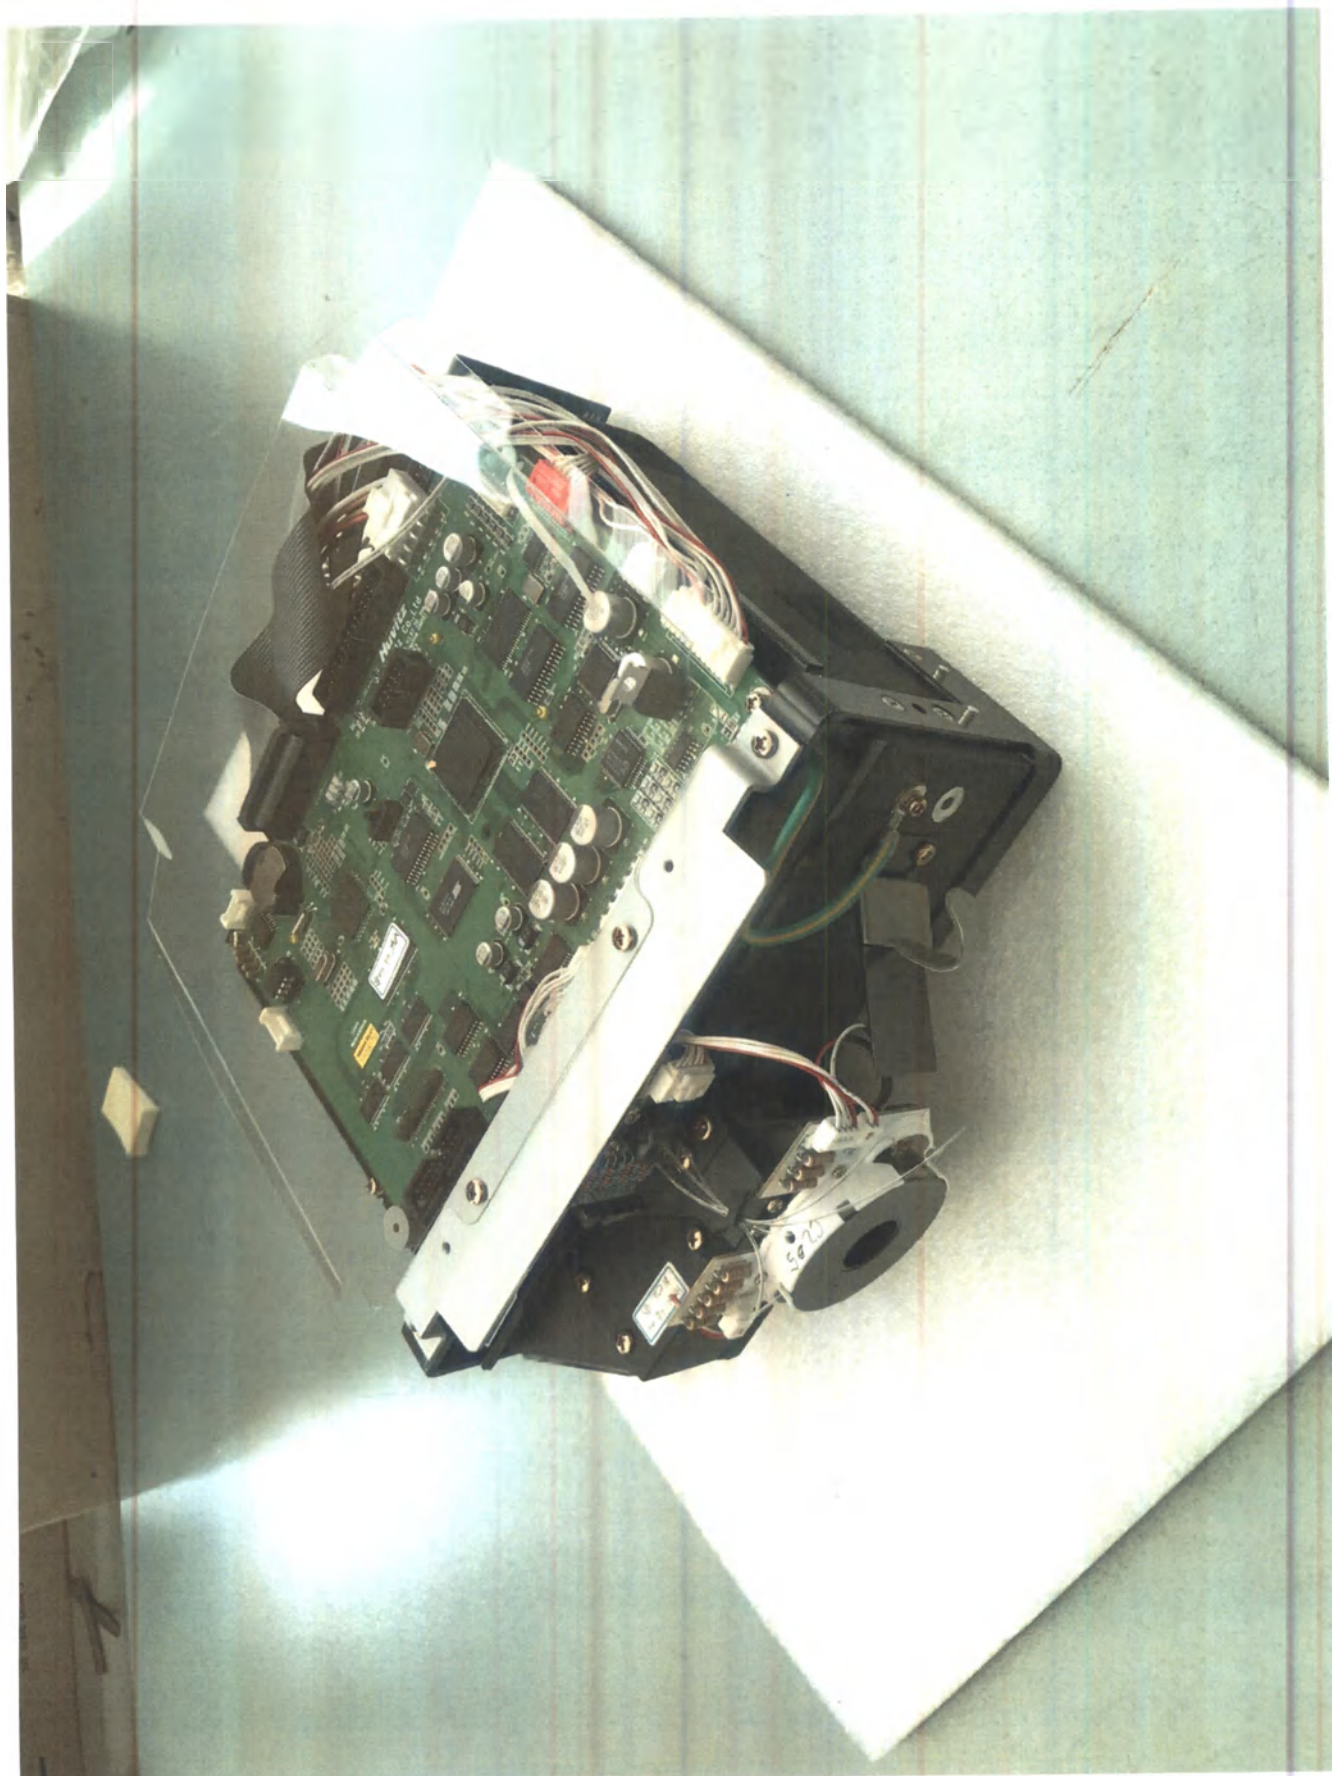

28. Блок оптический в сборе встраиваемый.

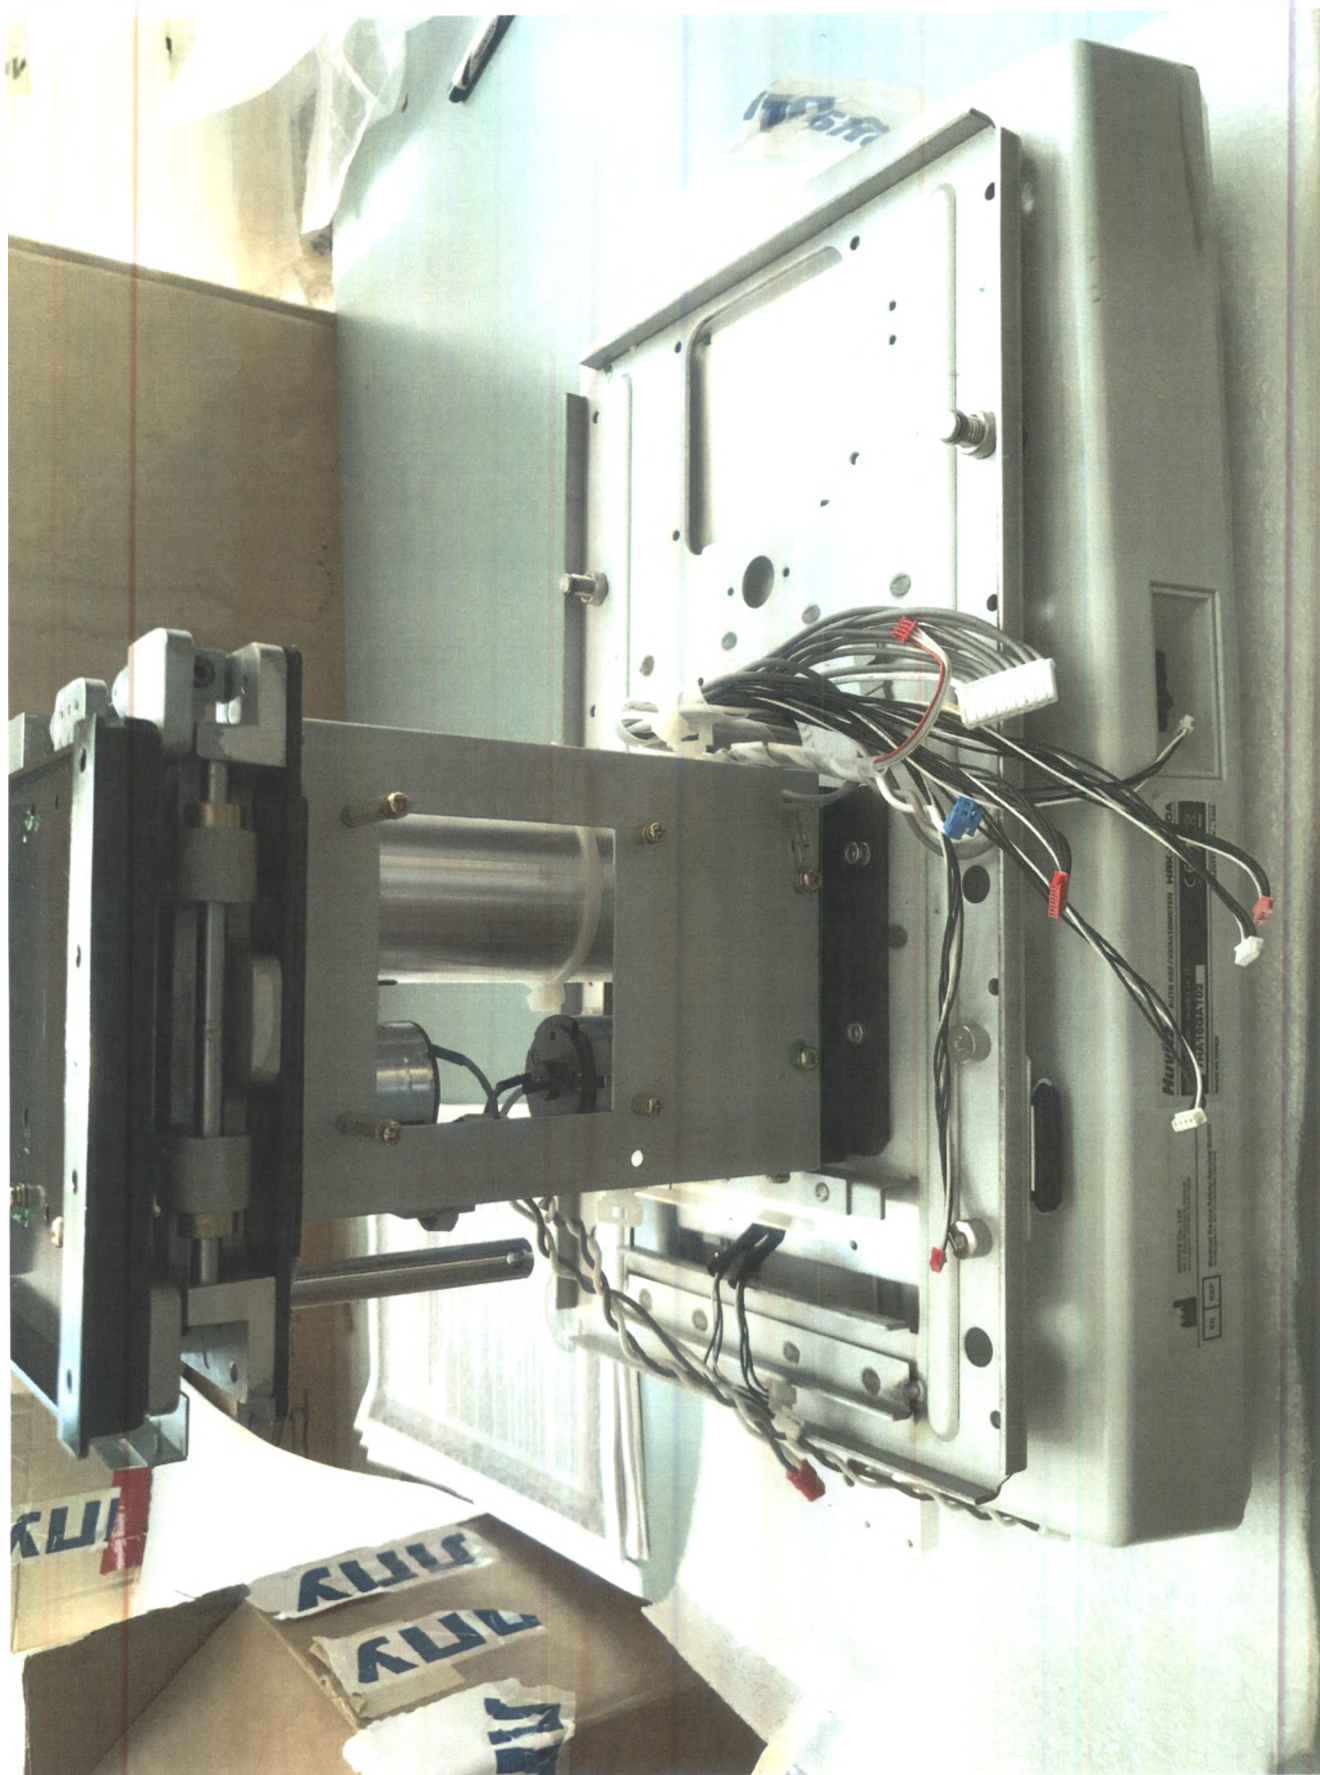

29. Блок электропривода специальный.

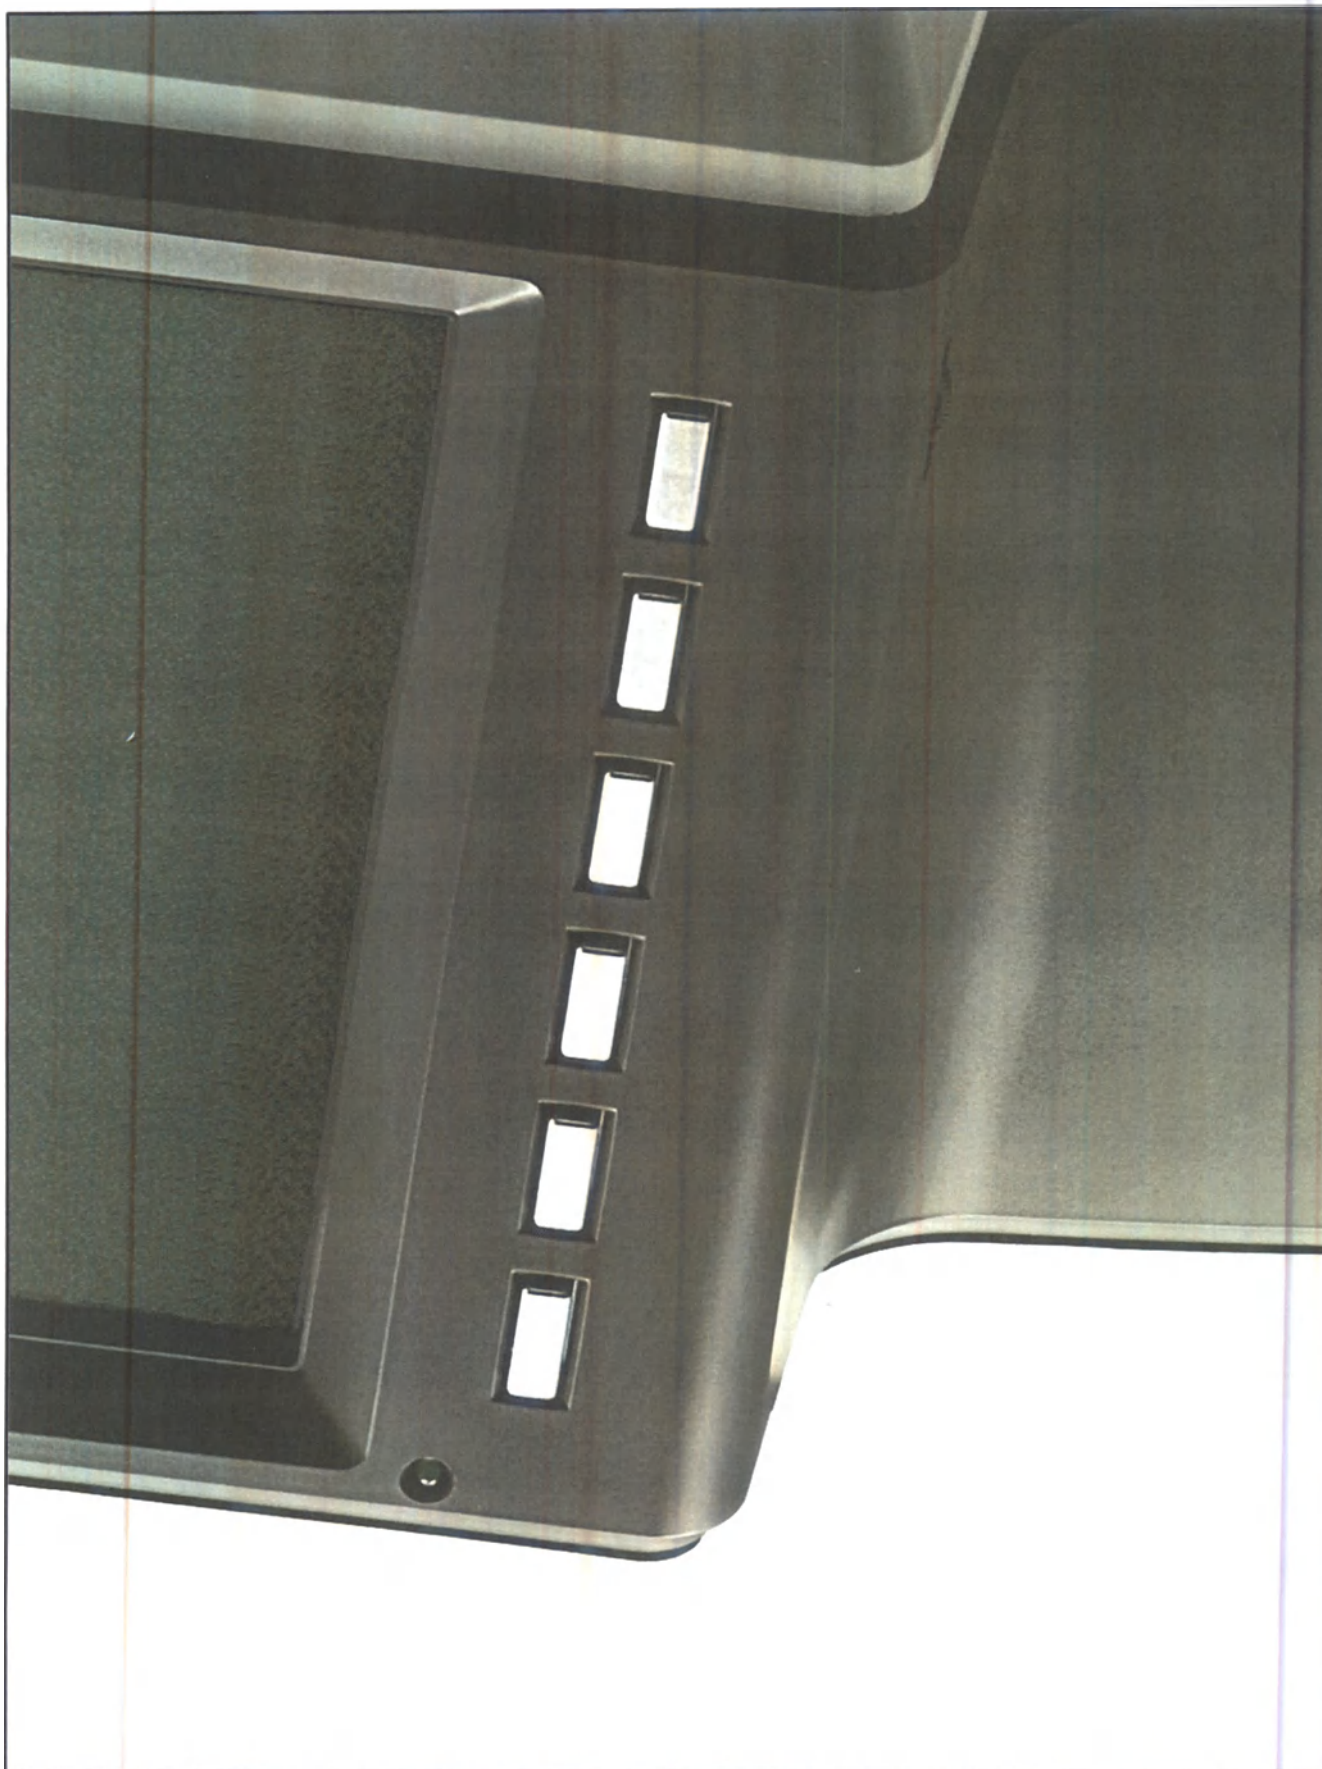

30. Кнопочная панель.




31. Кнопочная наклейка.



32. Втулка.




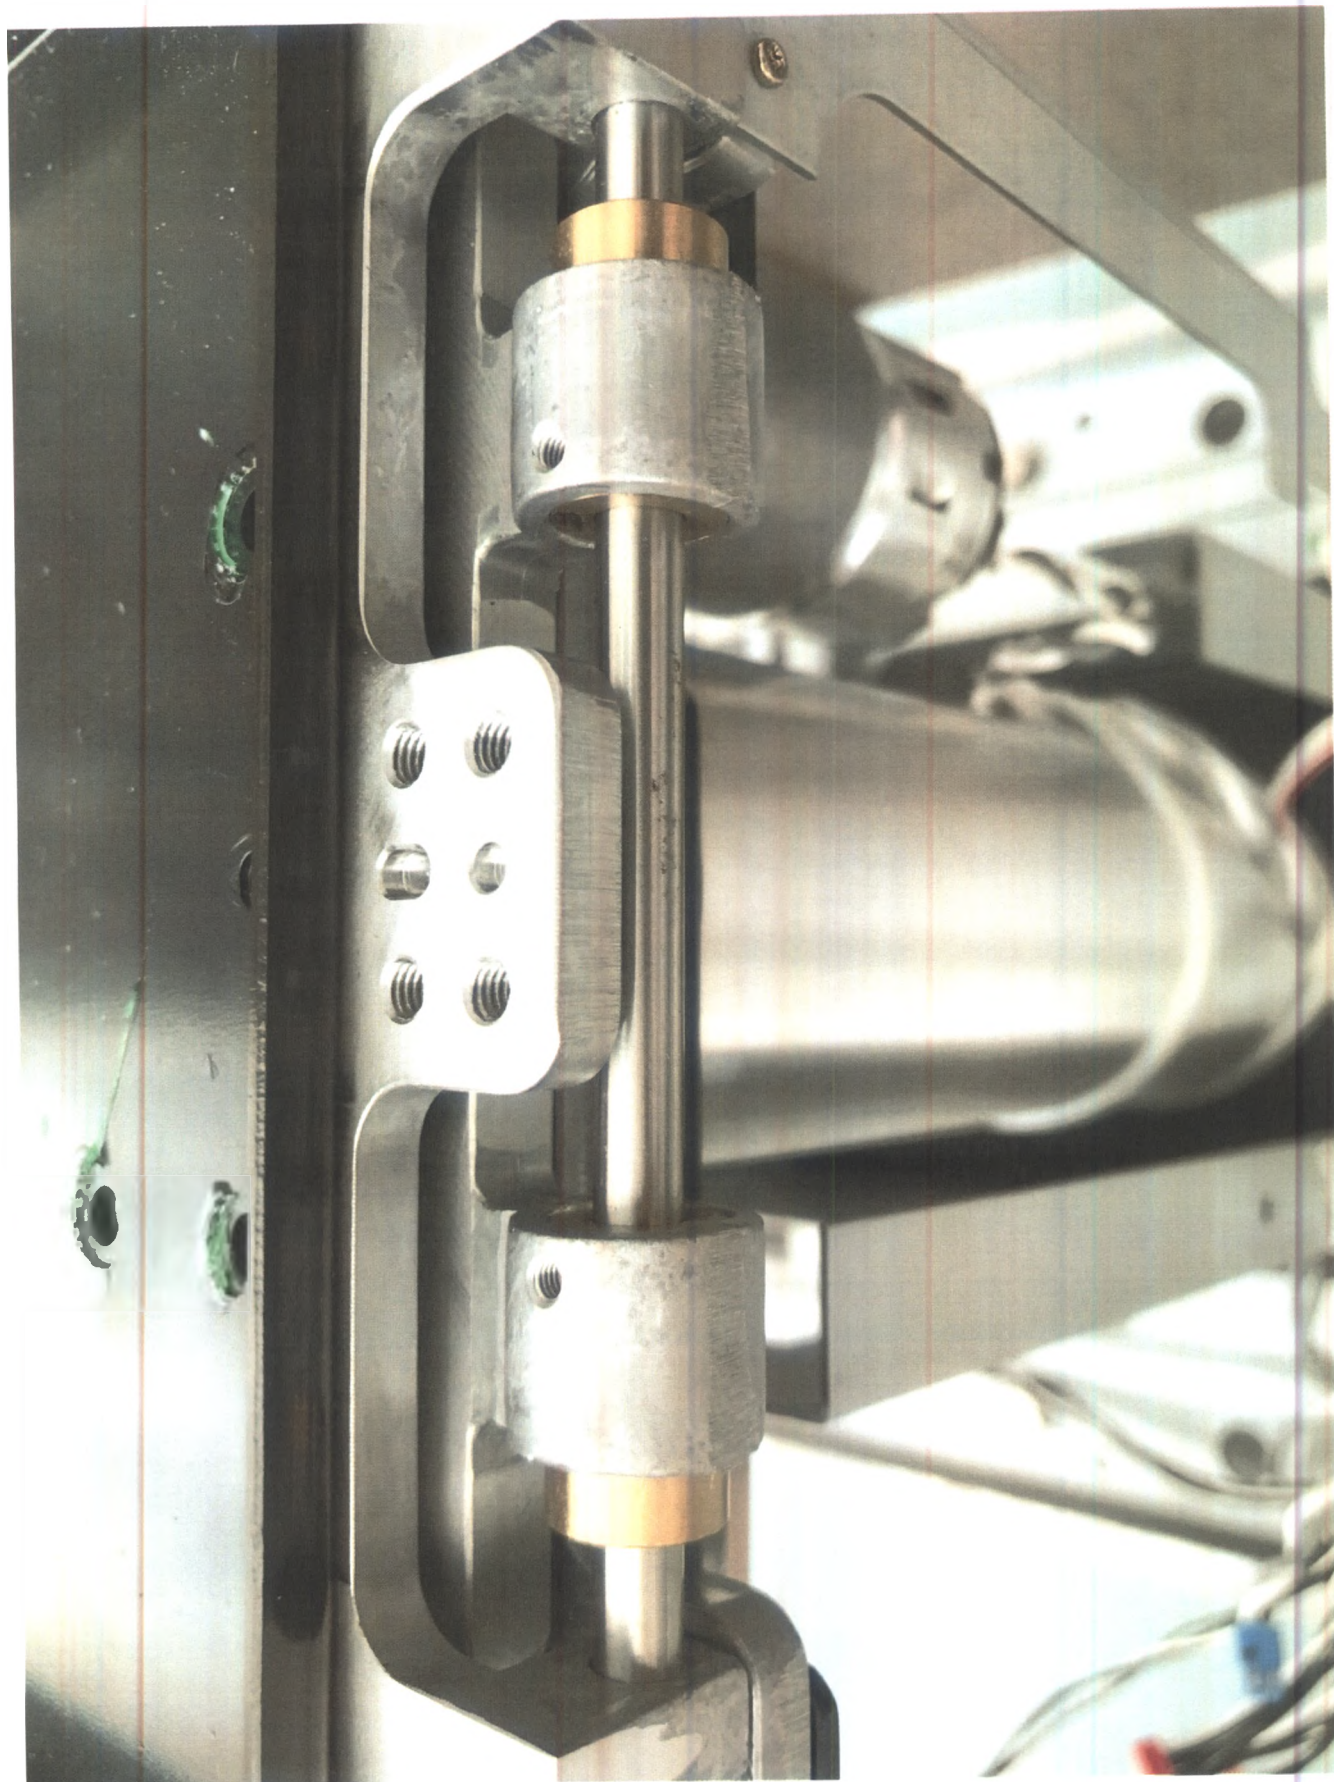

34. Вал.




35. Шпилька.

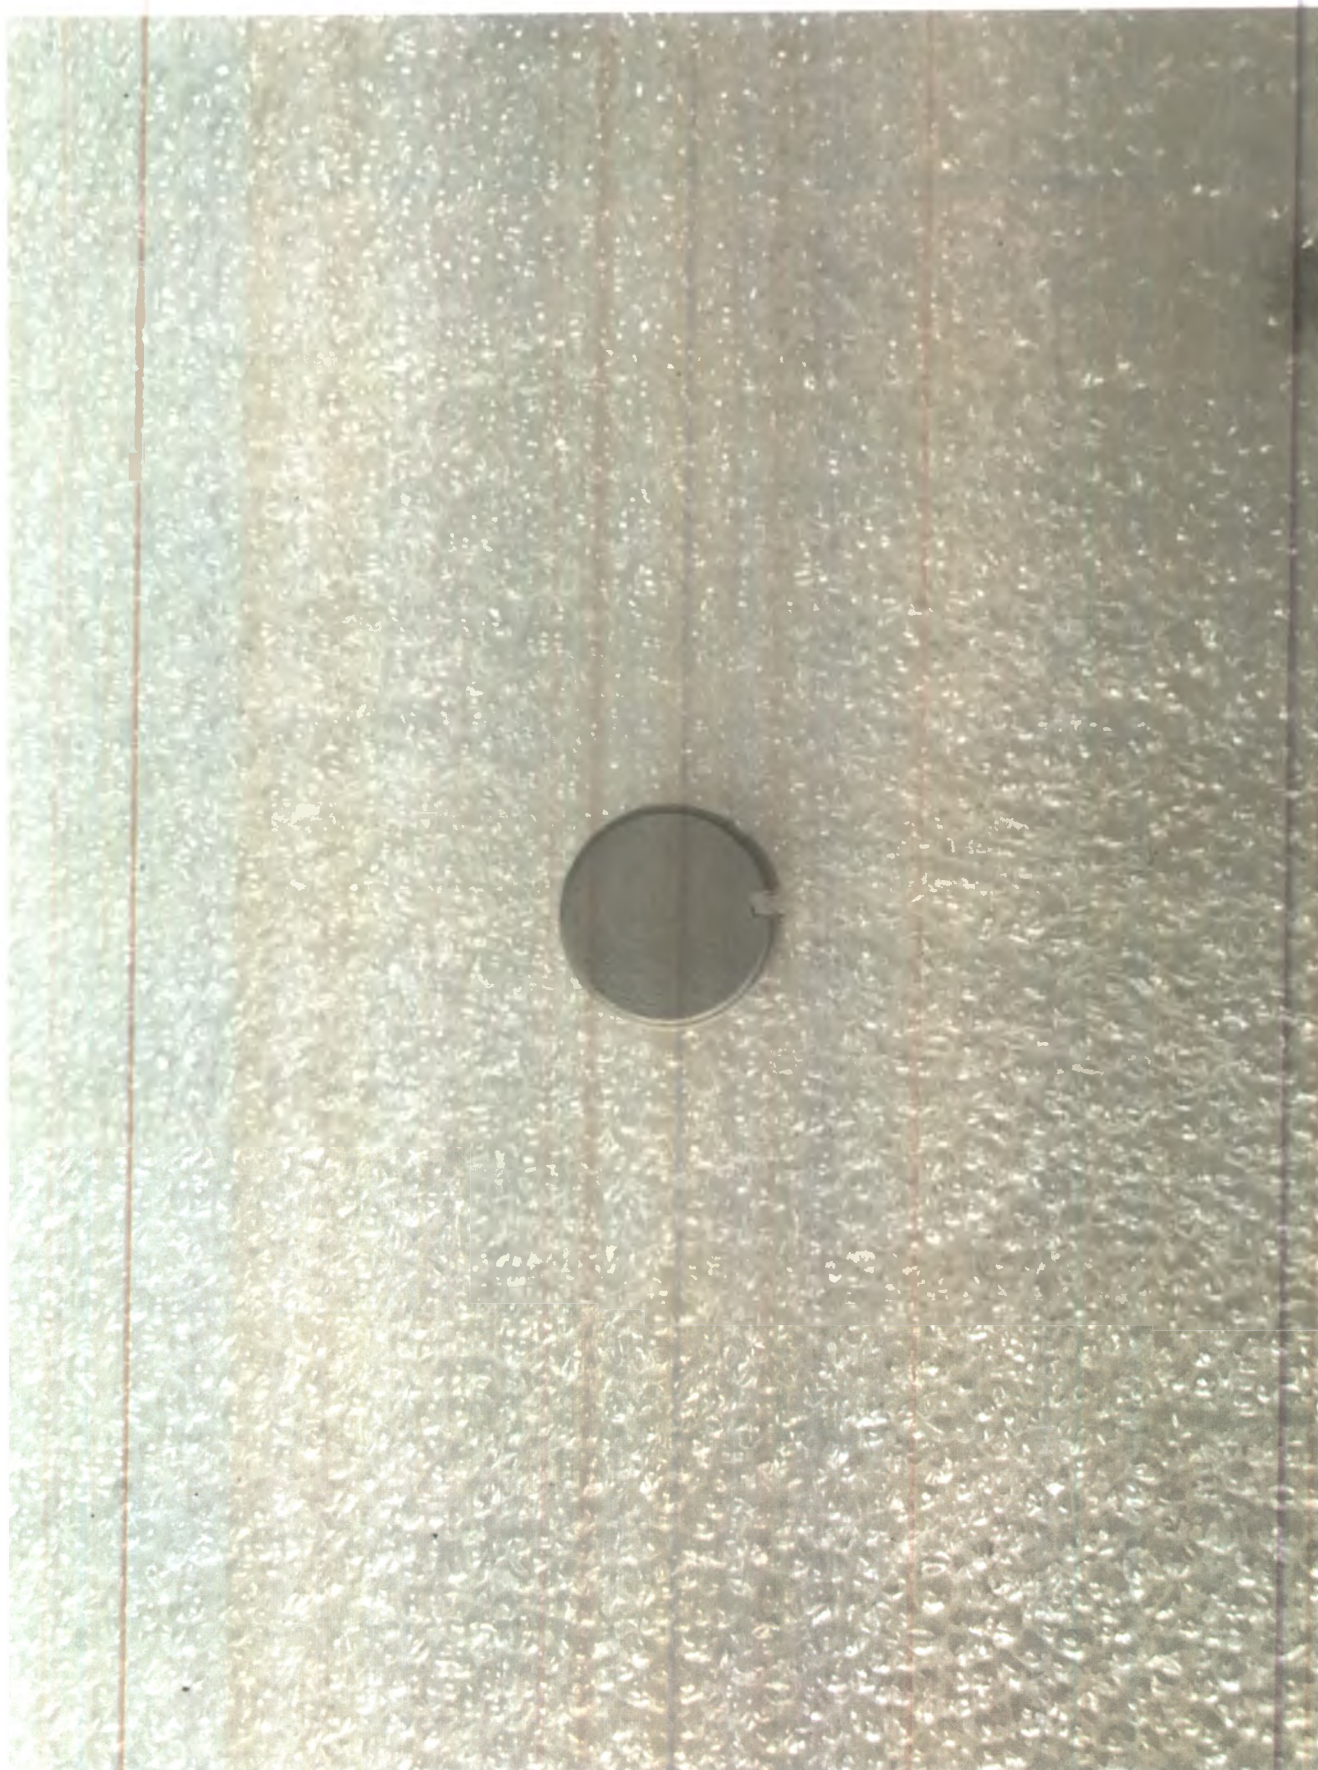


36. Заглушка.




37. Наклейка резиновая.

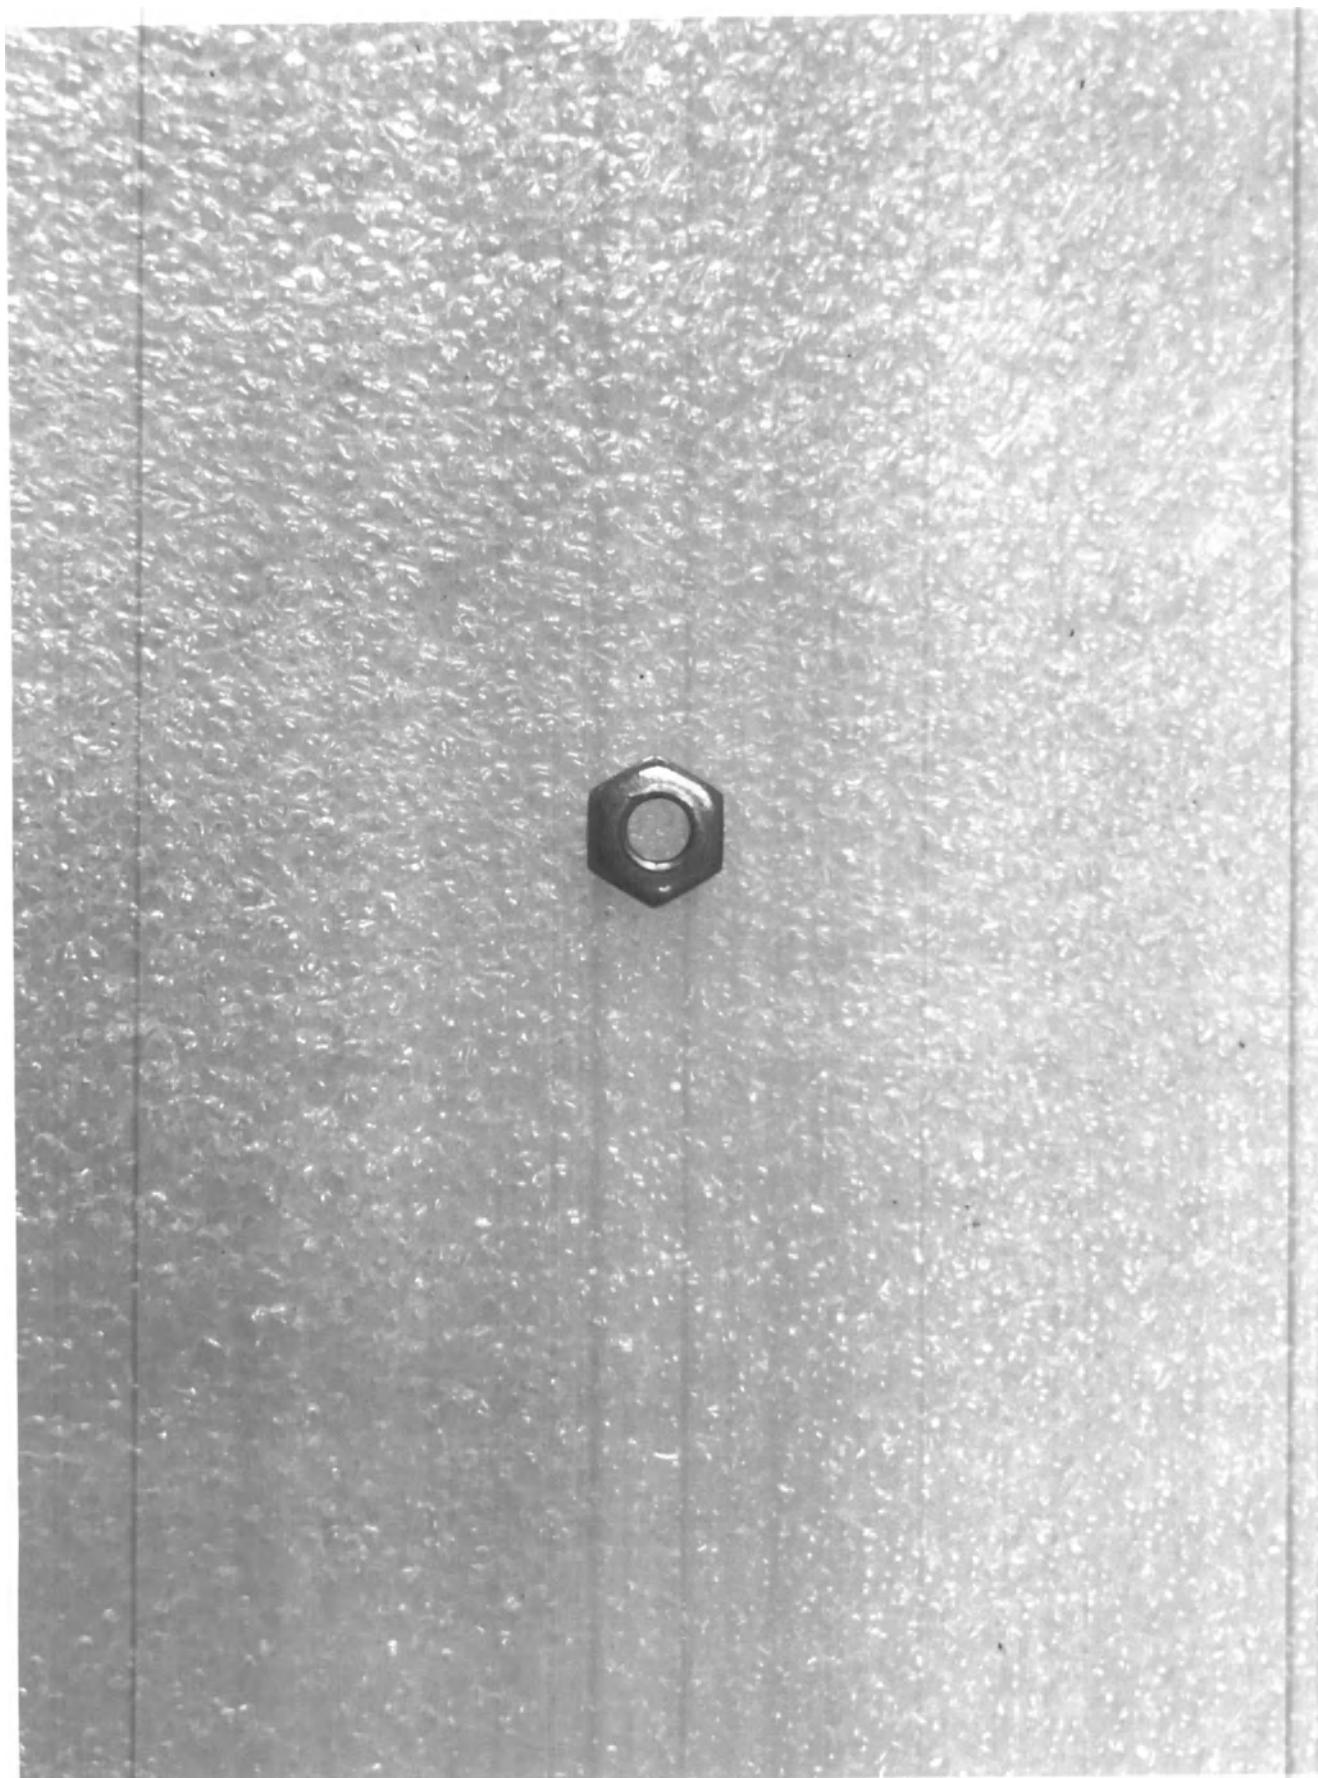


38. Гайка.

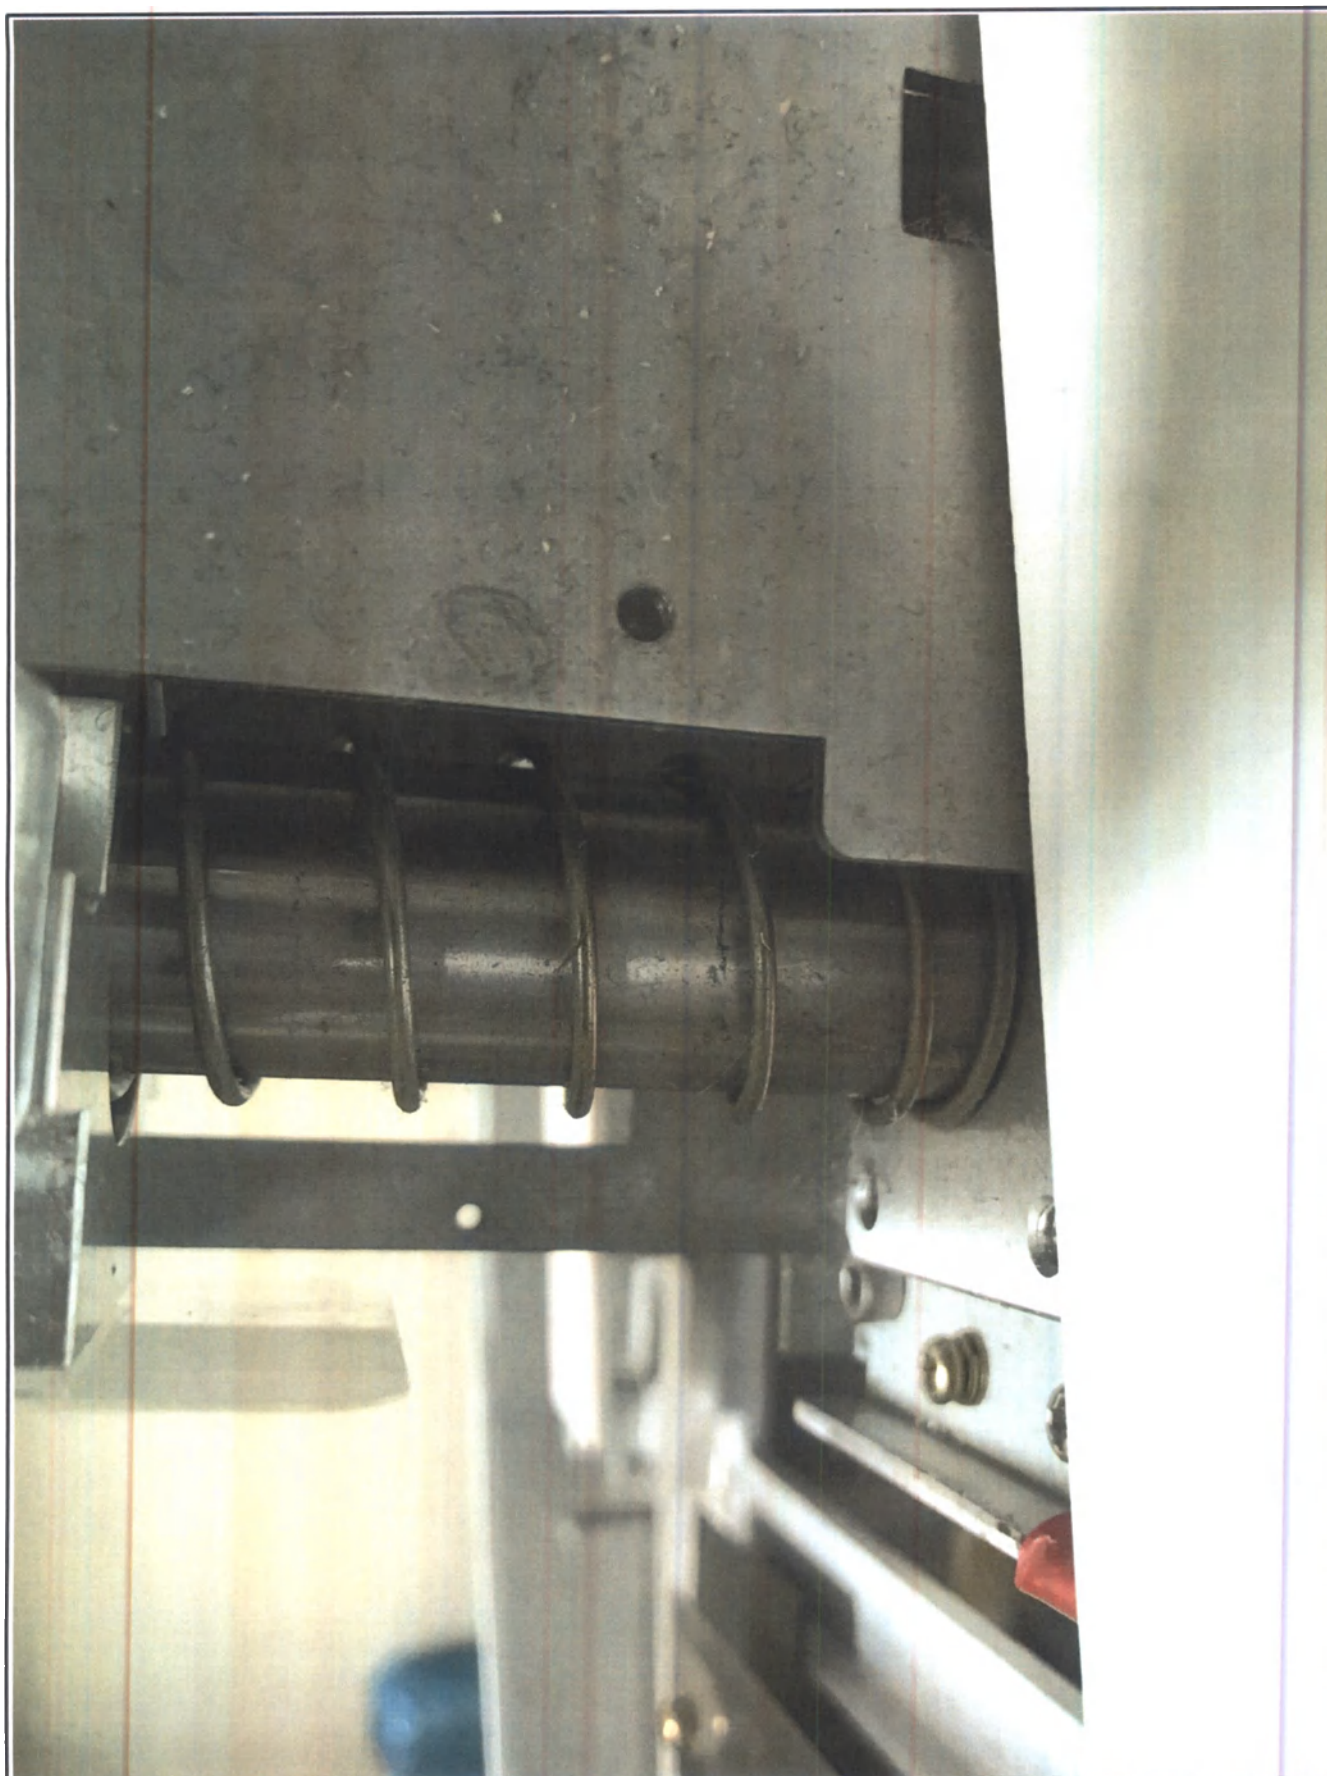

39. Пружина специальная.

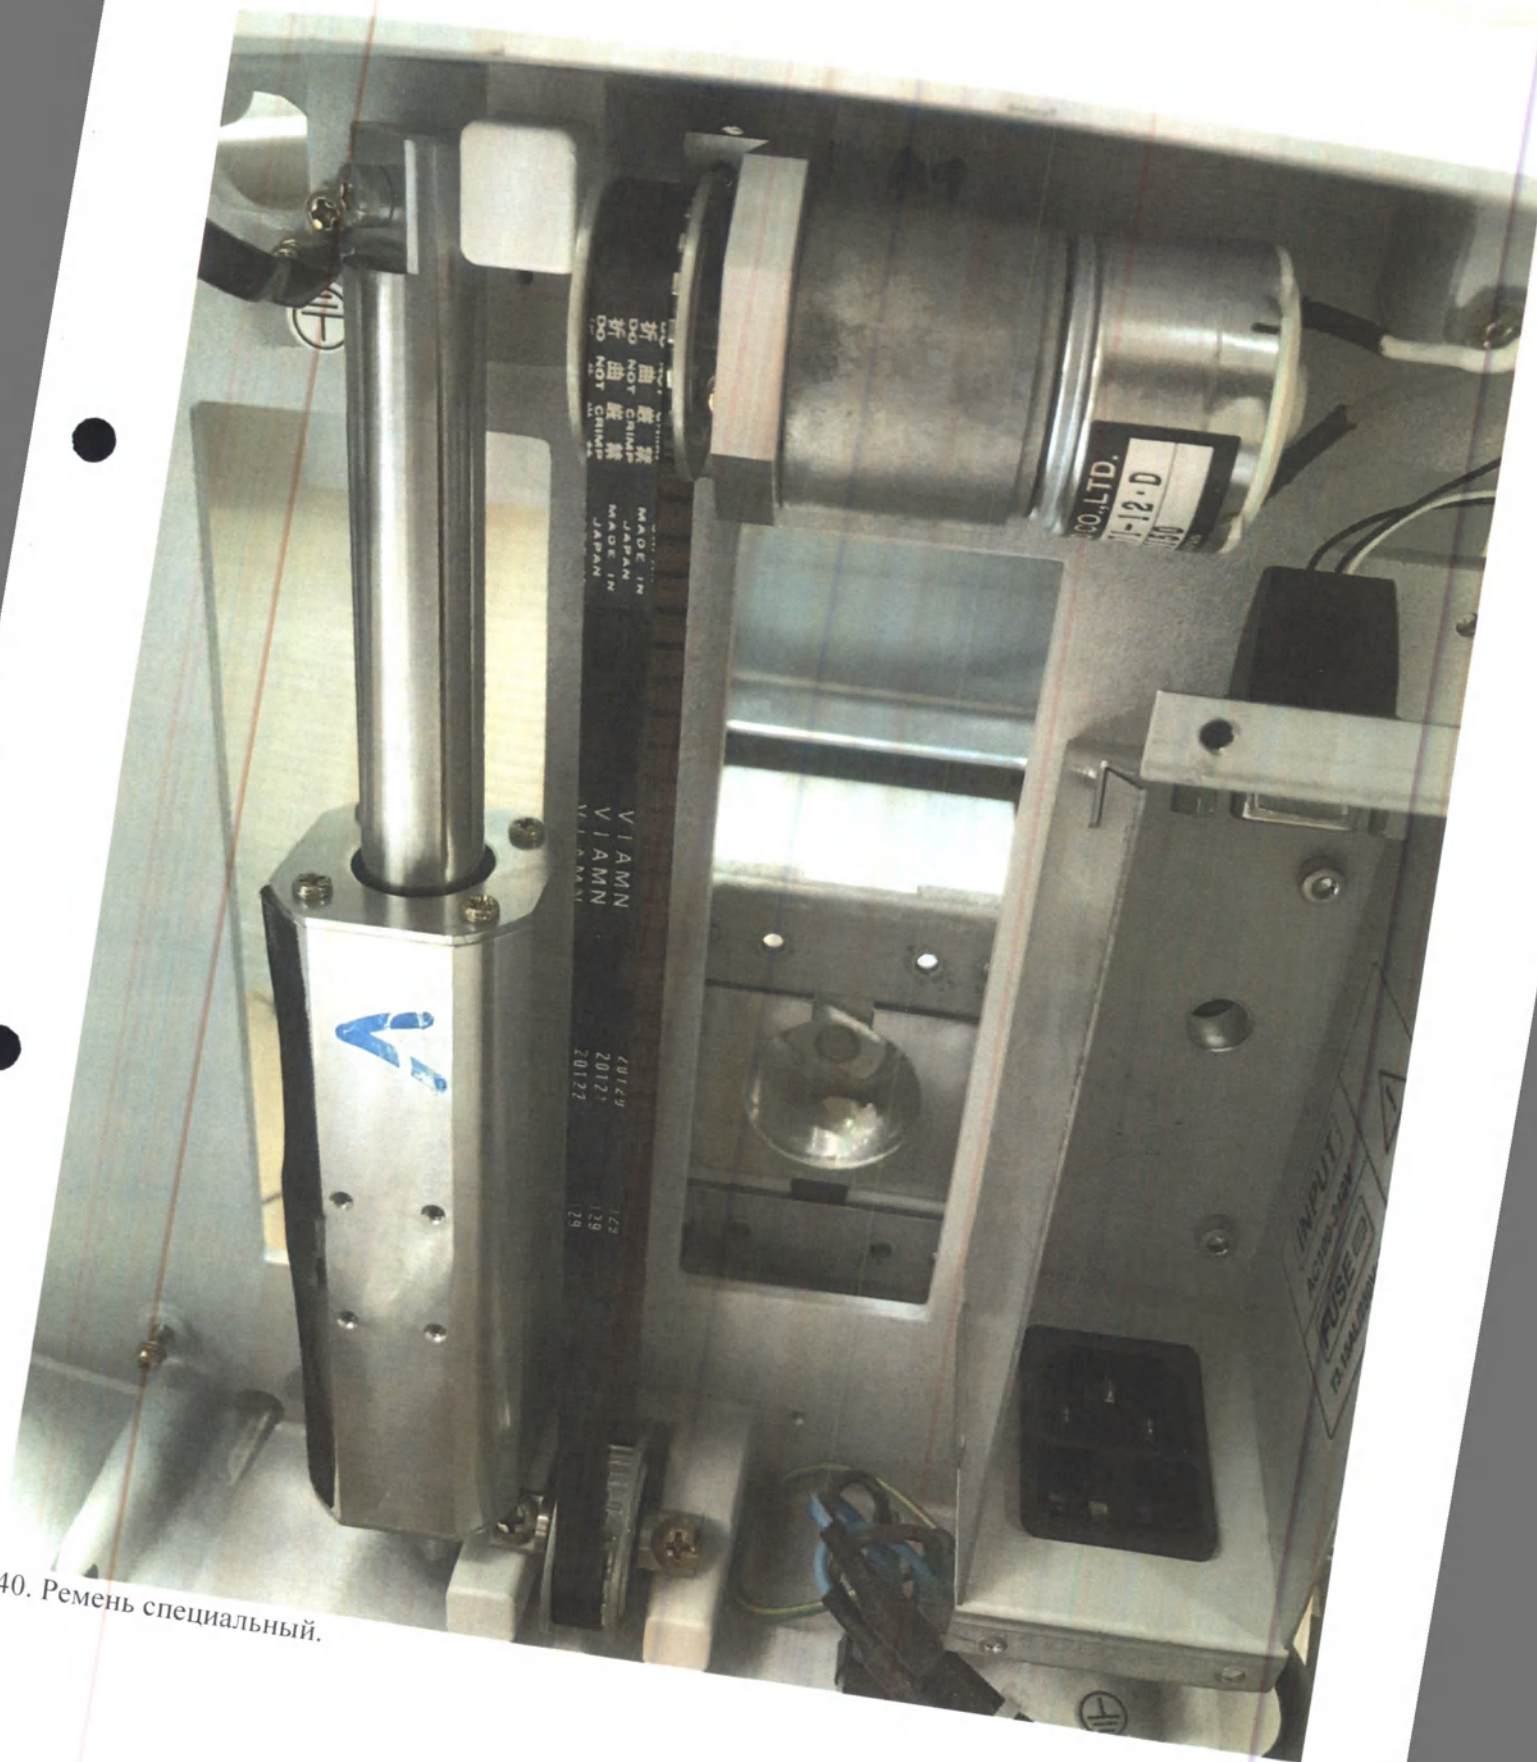


40. Ремень специальный.

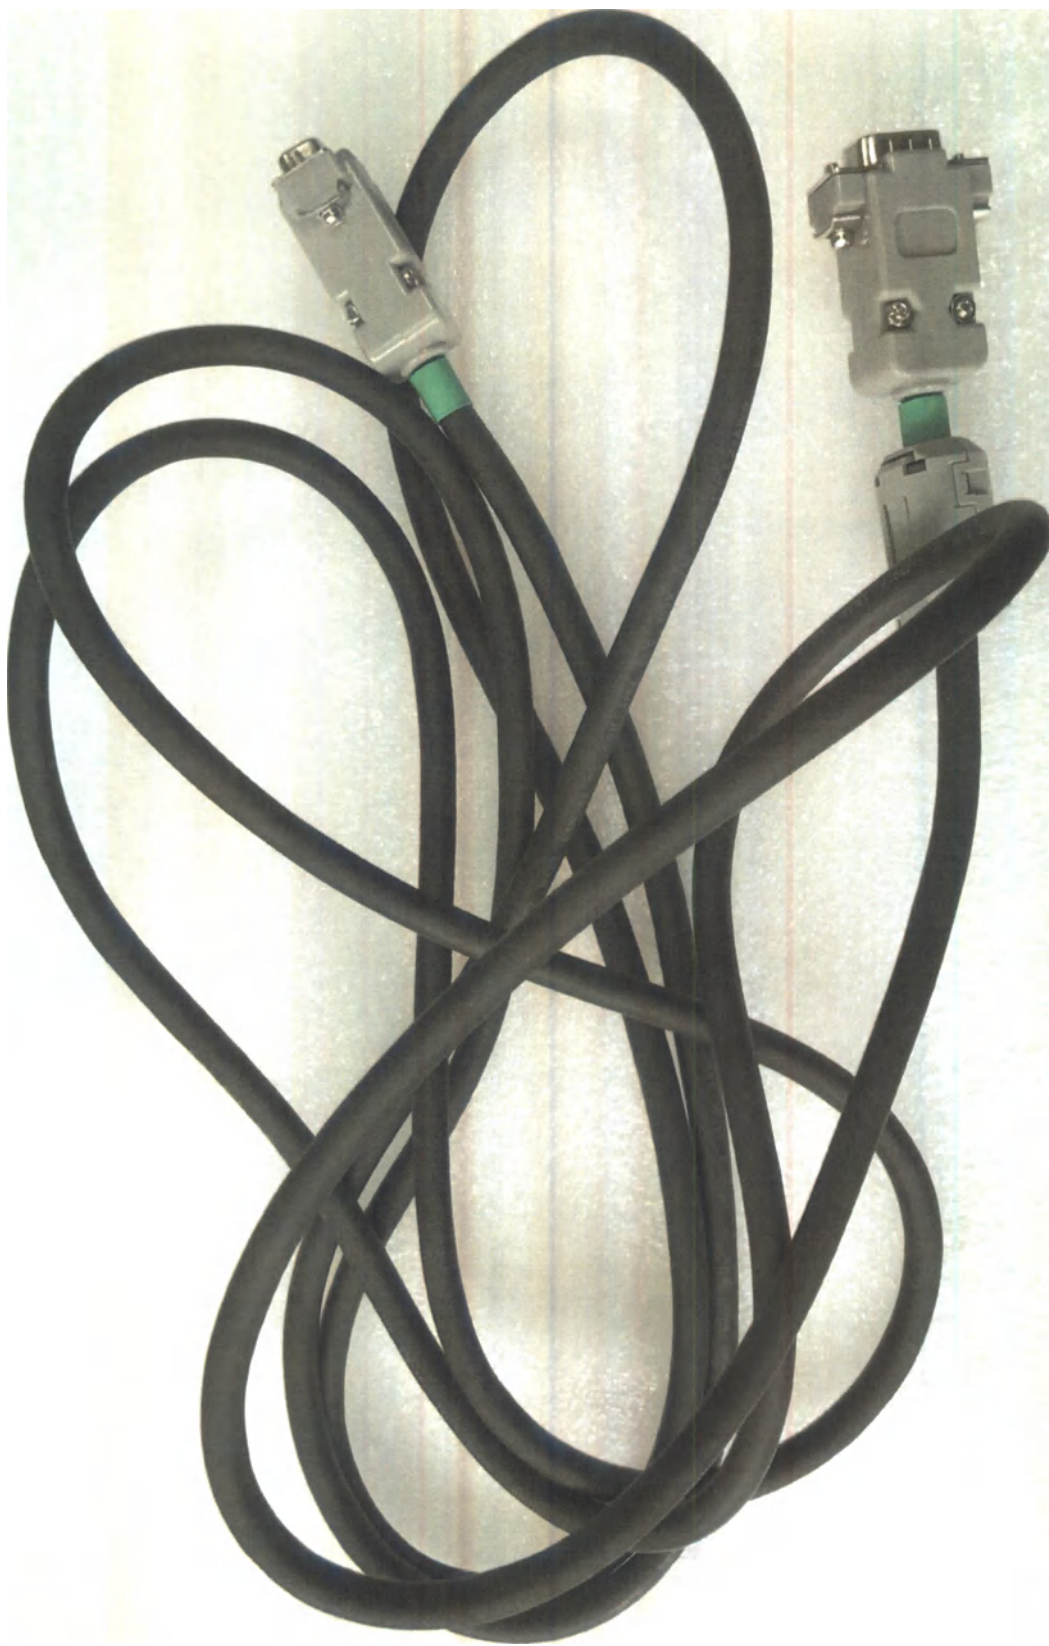

41. Кабель интерфейсный (стандарт VGA) специальный.




41. Кабель интерфейсный (стандарт HDMI) специальный.

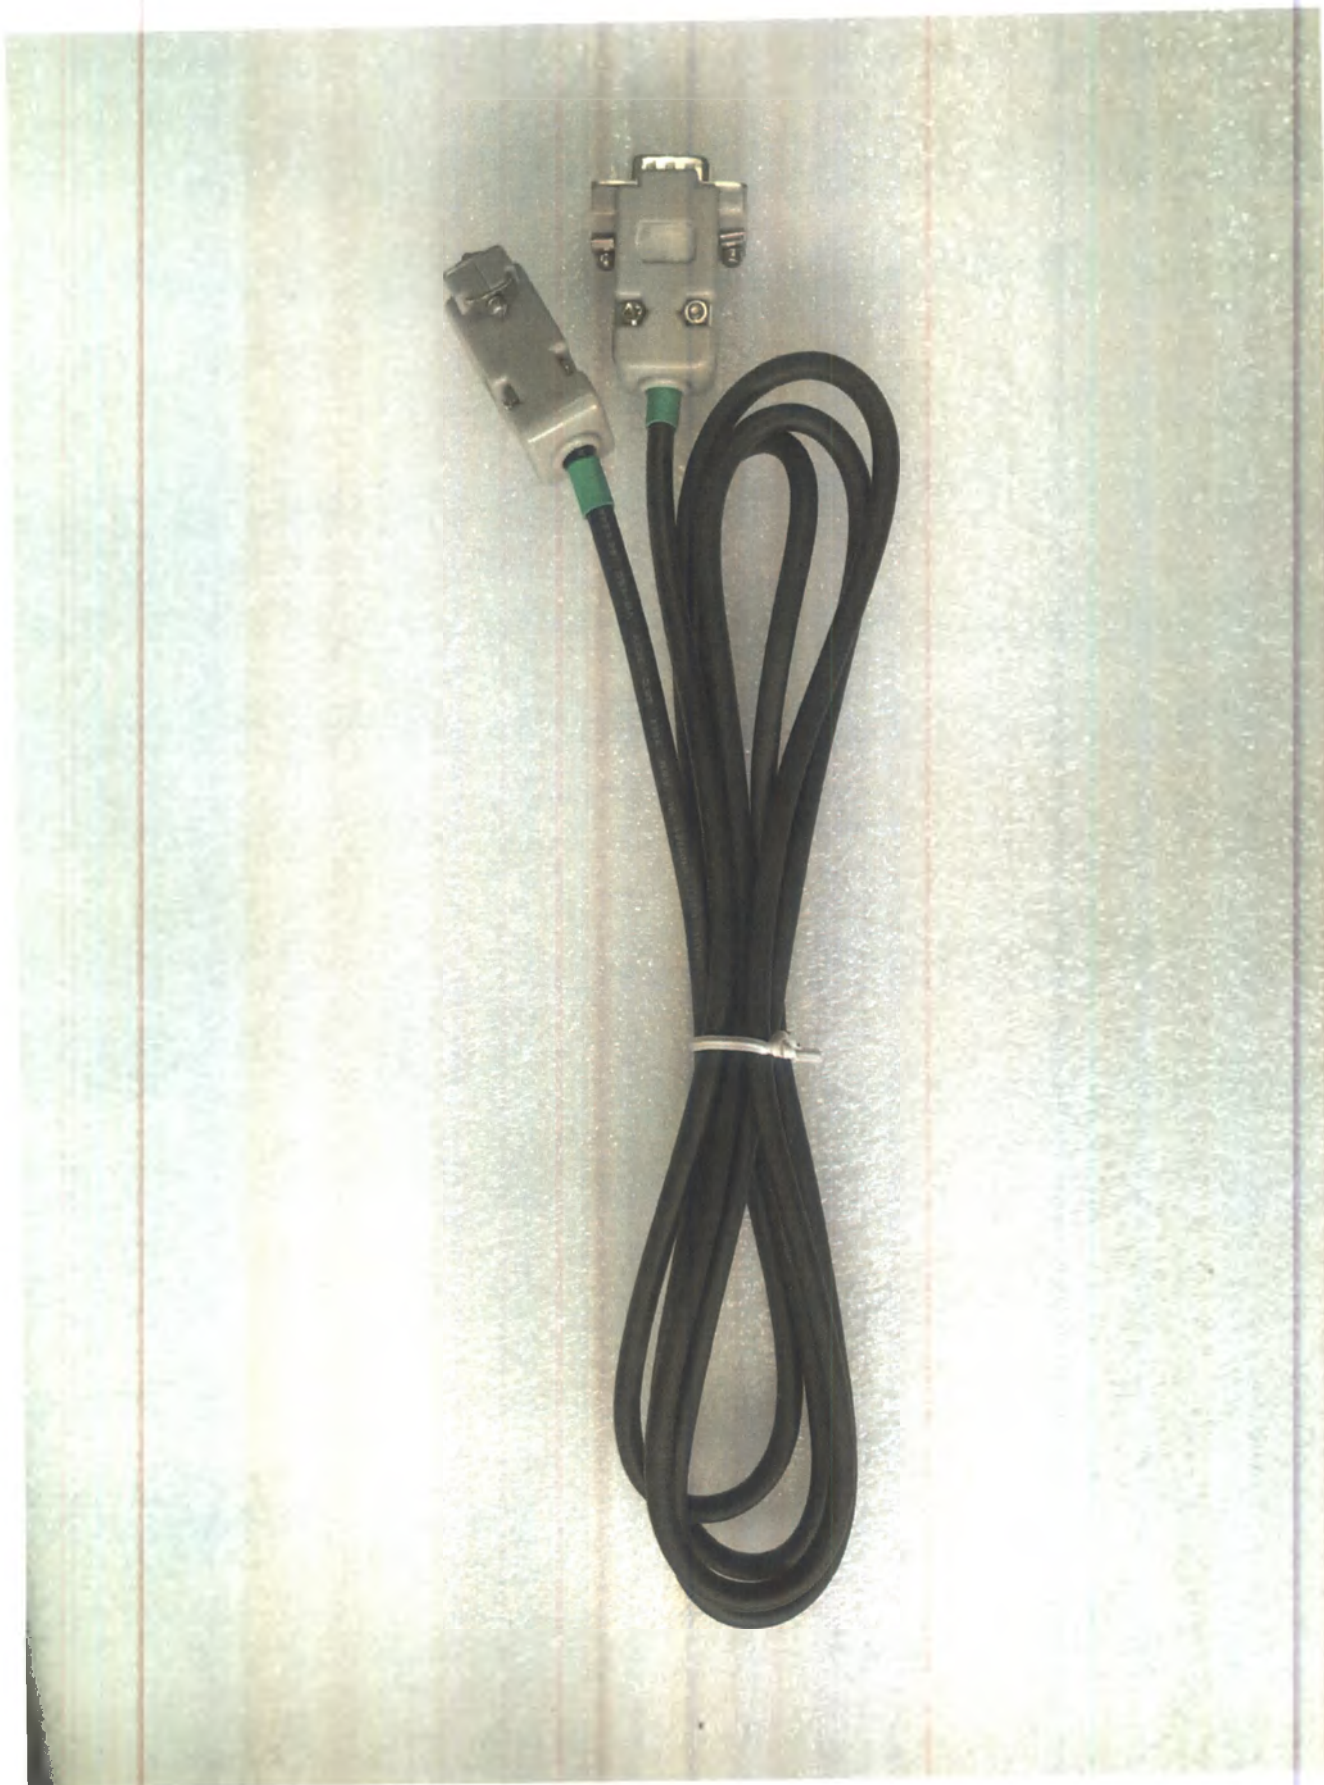

41. Кабель интерфейсный (стандарт RS-232) специальный.




42. Рычаг блокировки.

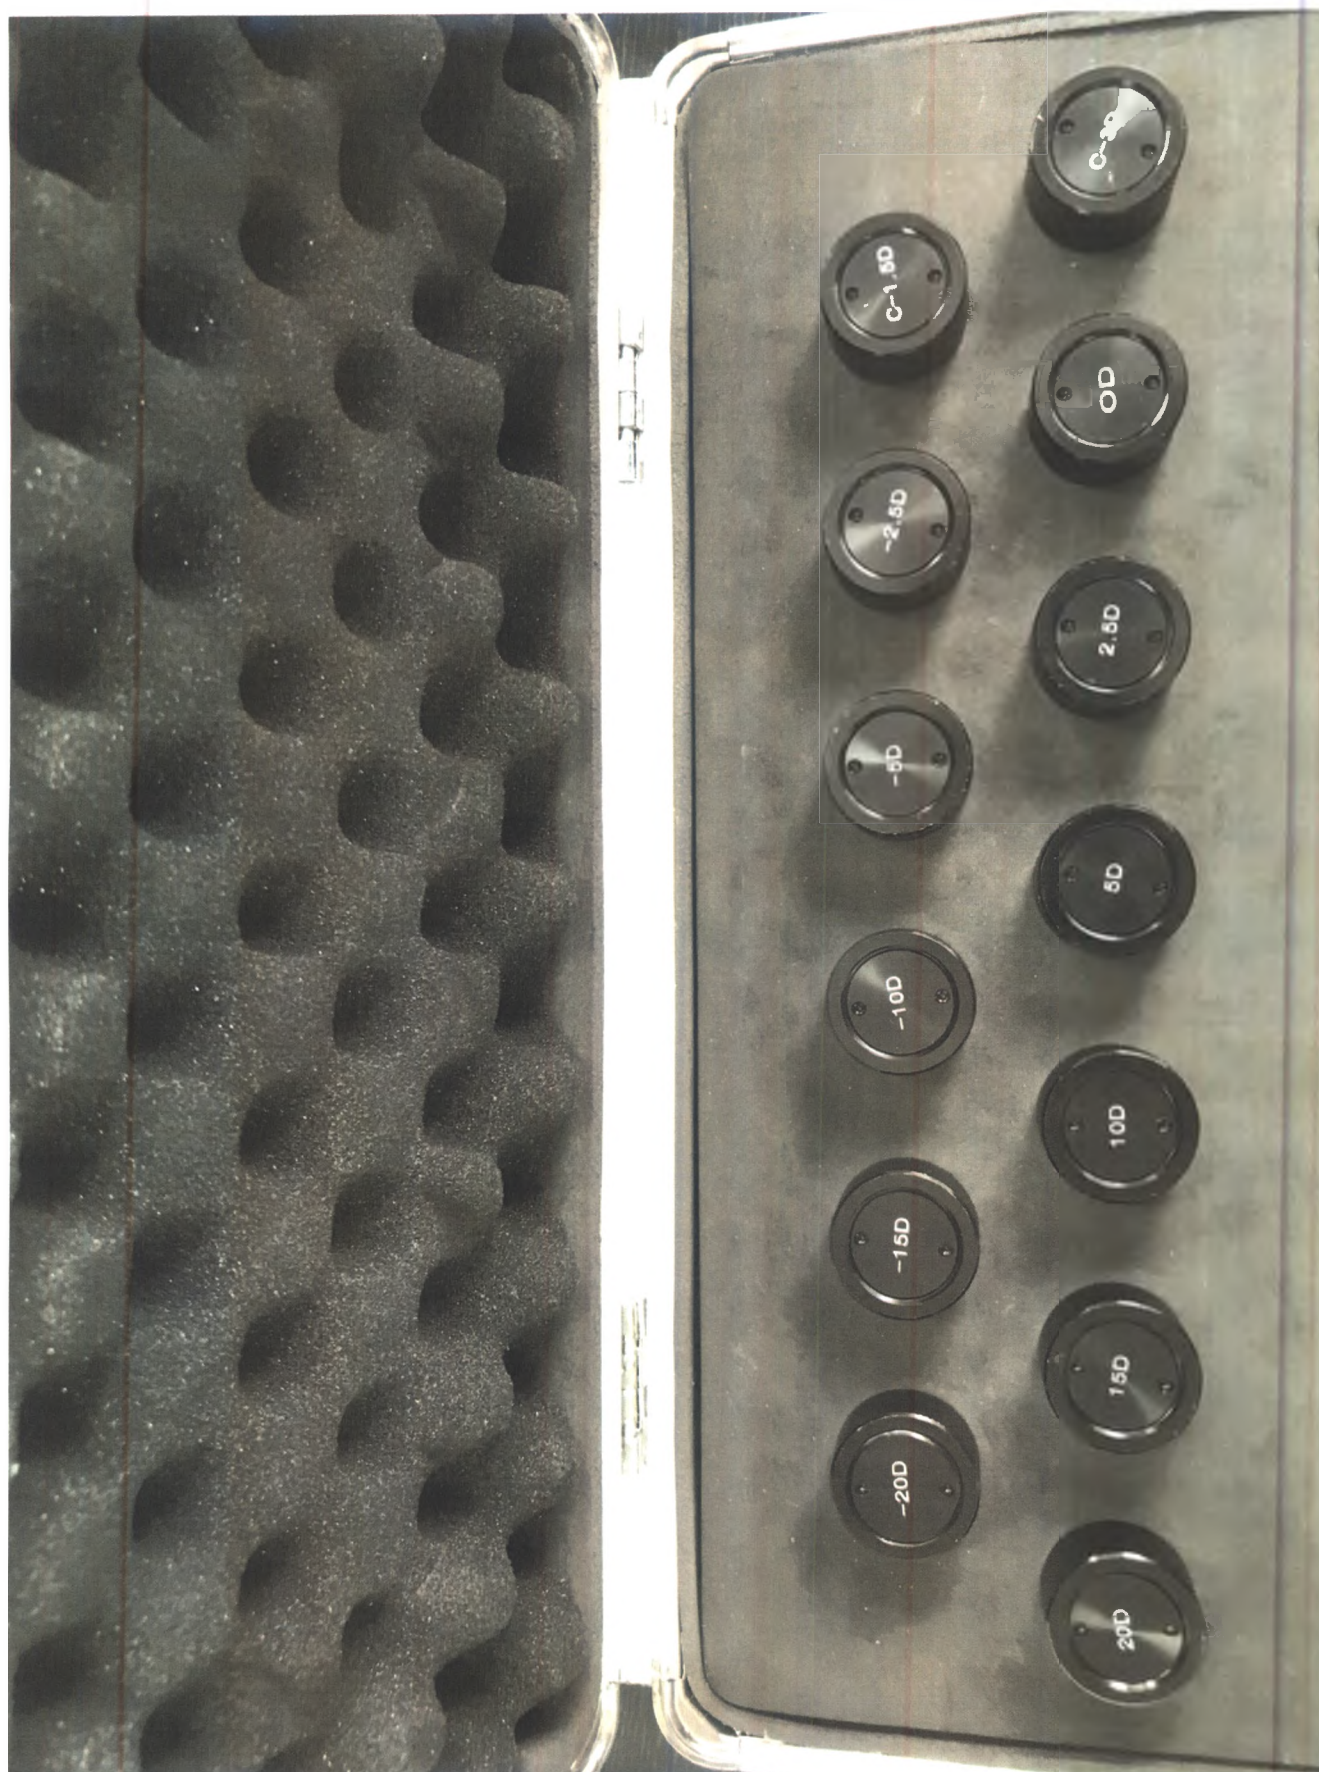


43. Набор тестовых глаз для калибровки:

43.1. Тестовые глаза для калибровки рефракции – 13 шт.

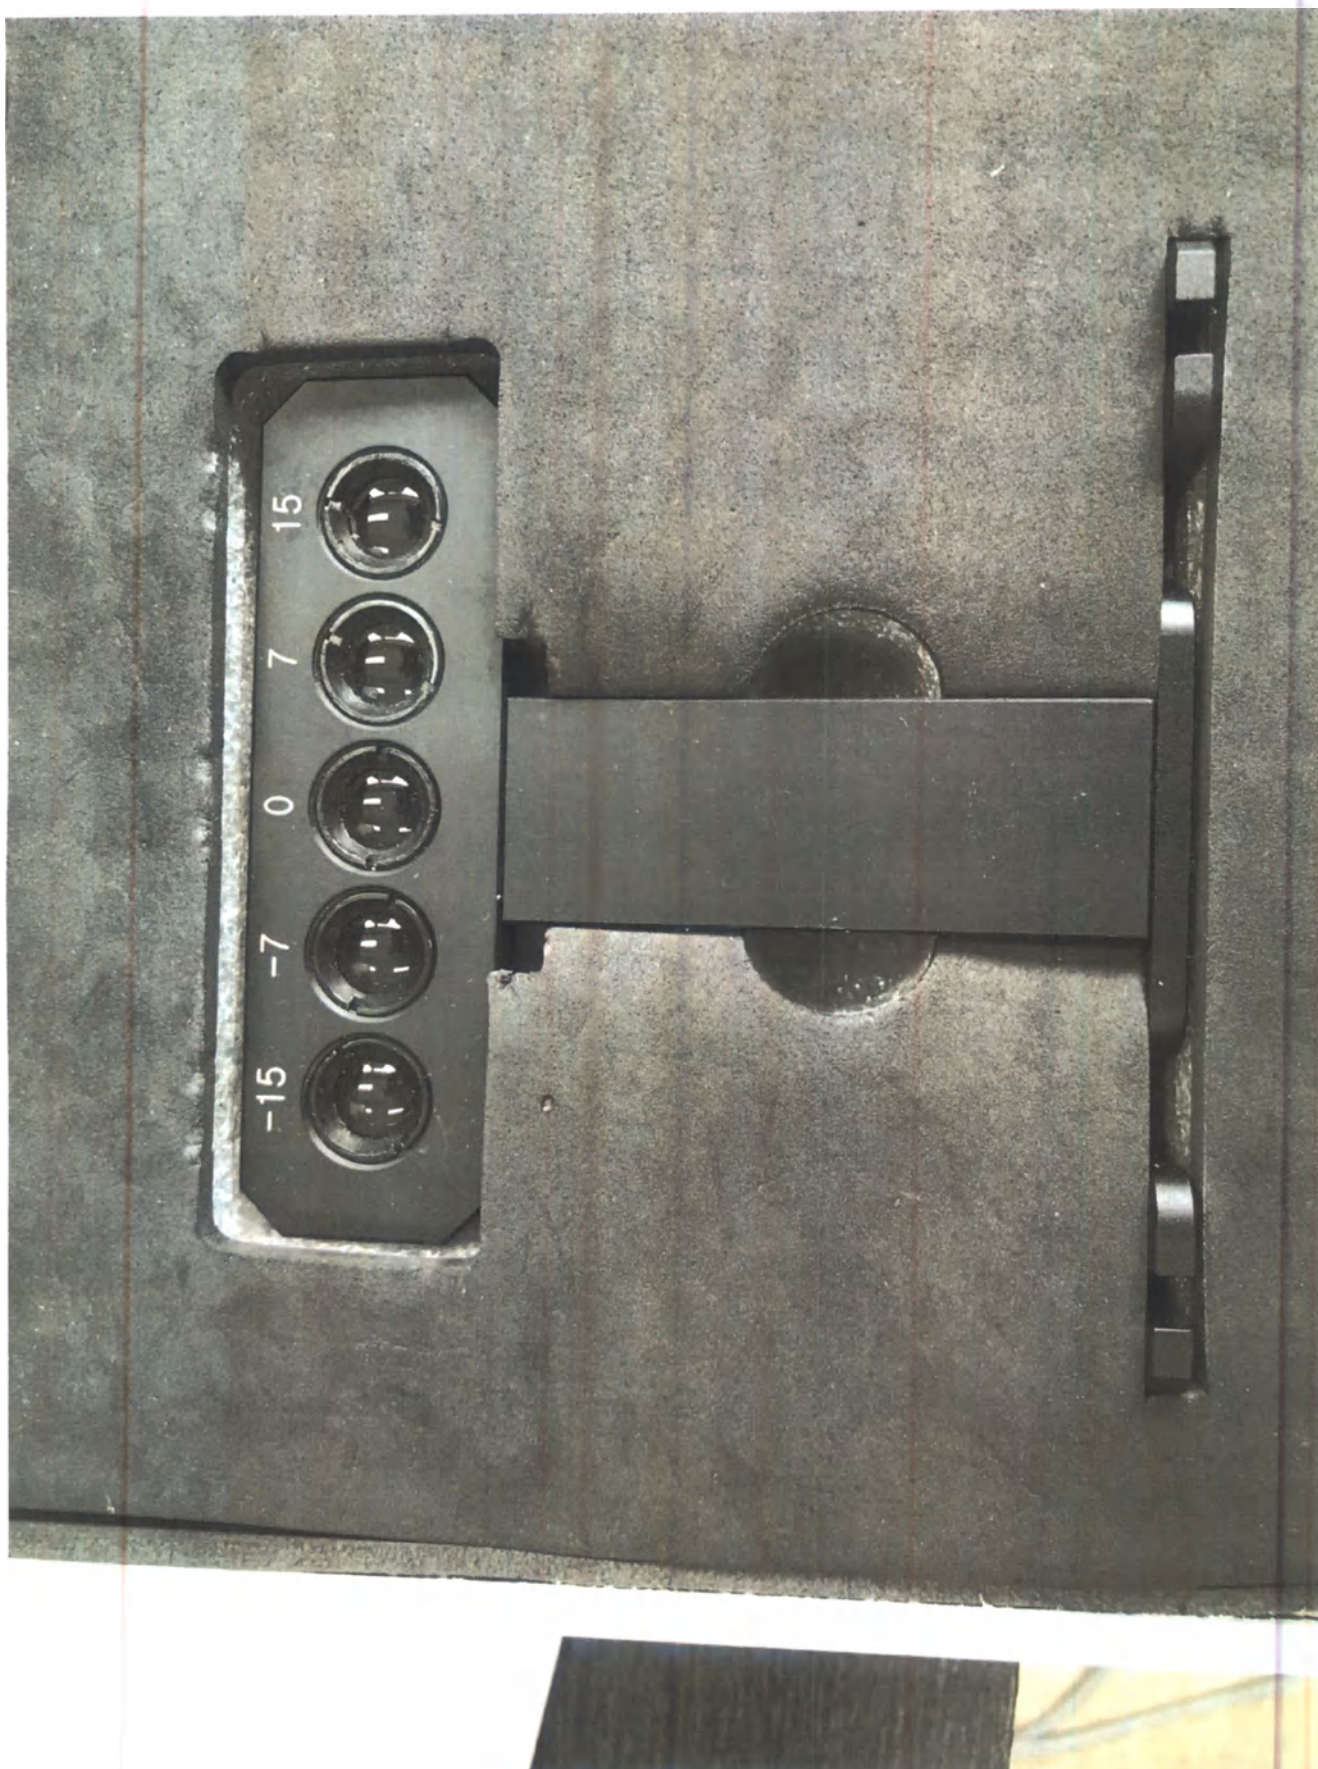

43. Набор тестовых глаз для калибровки:

43.2. Тестовые глаза для калибровки кератометрии – 5 шт.

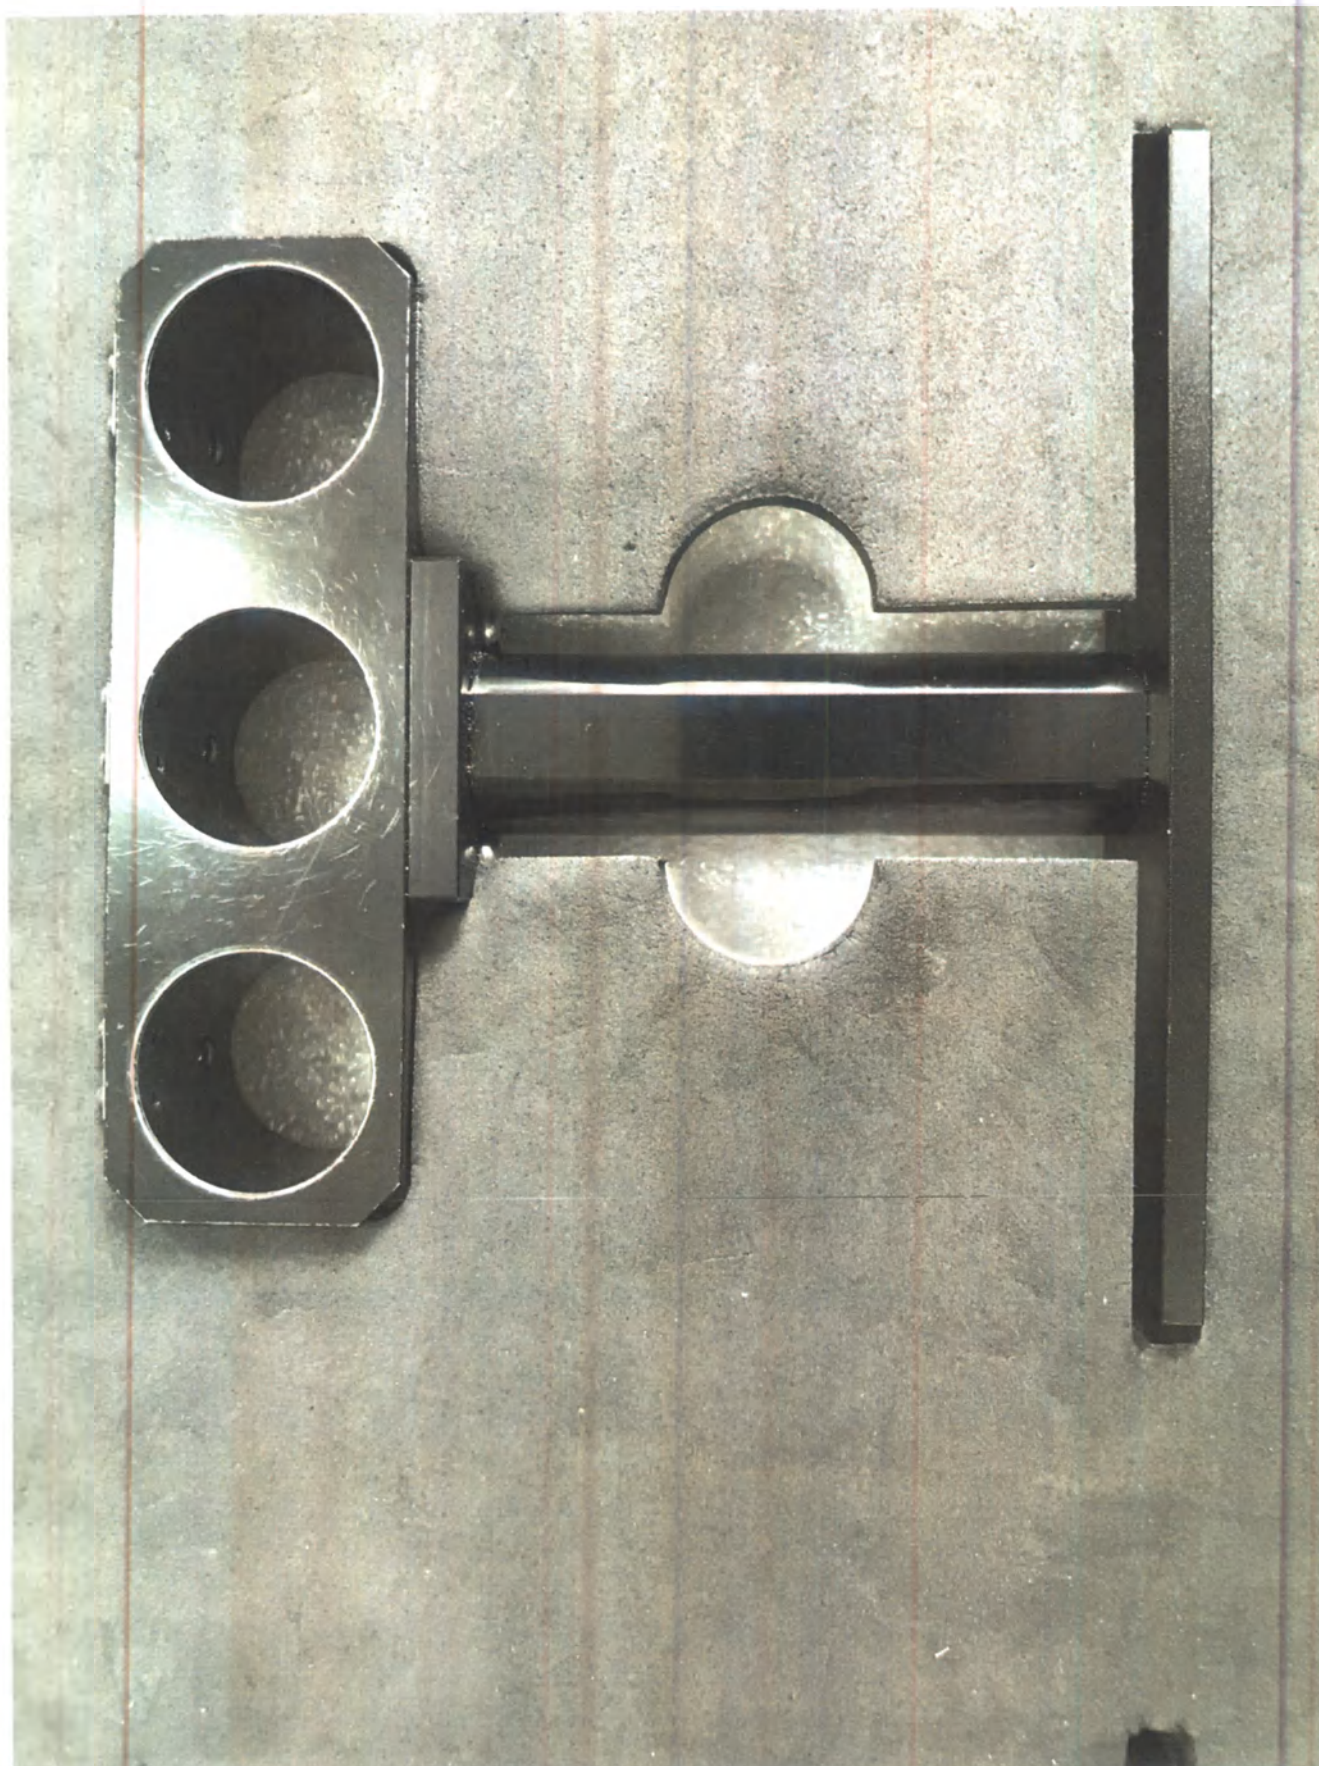


43. Набор тестовых глаз для калибровки:


43.3. Подставка для тестовых глаз – 1 шт.



44. Стол инструментальный СИТ – 4000.

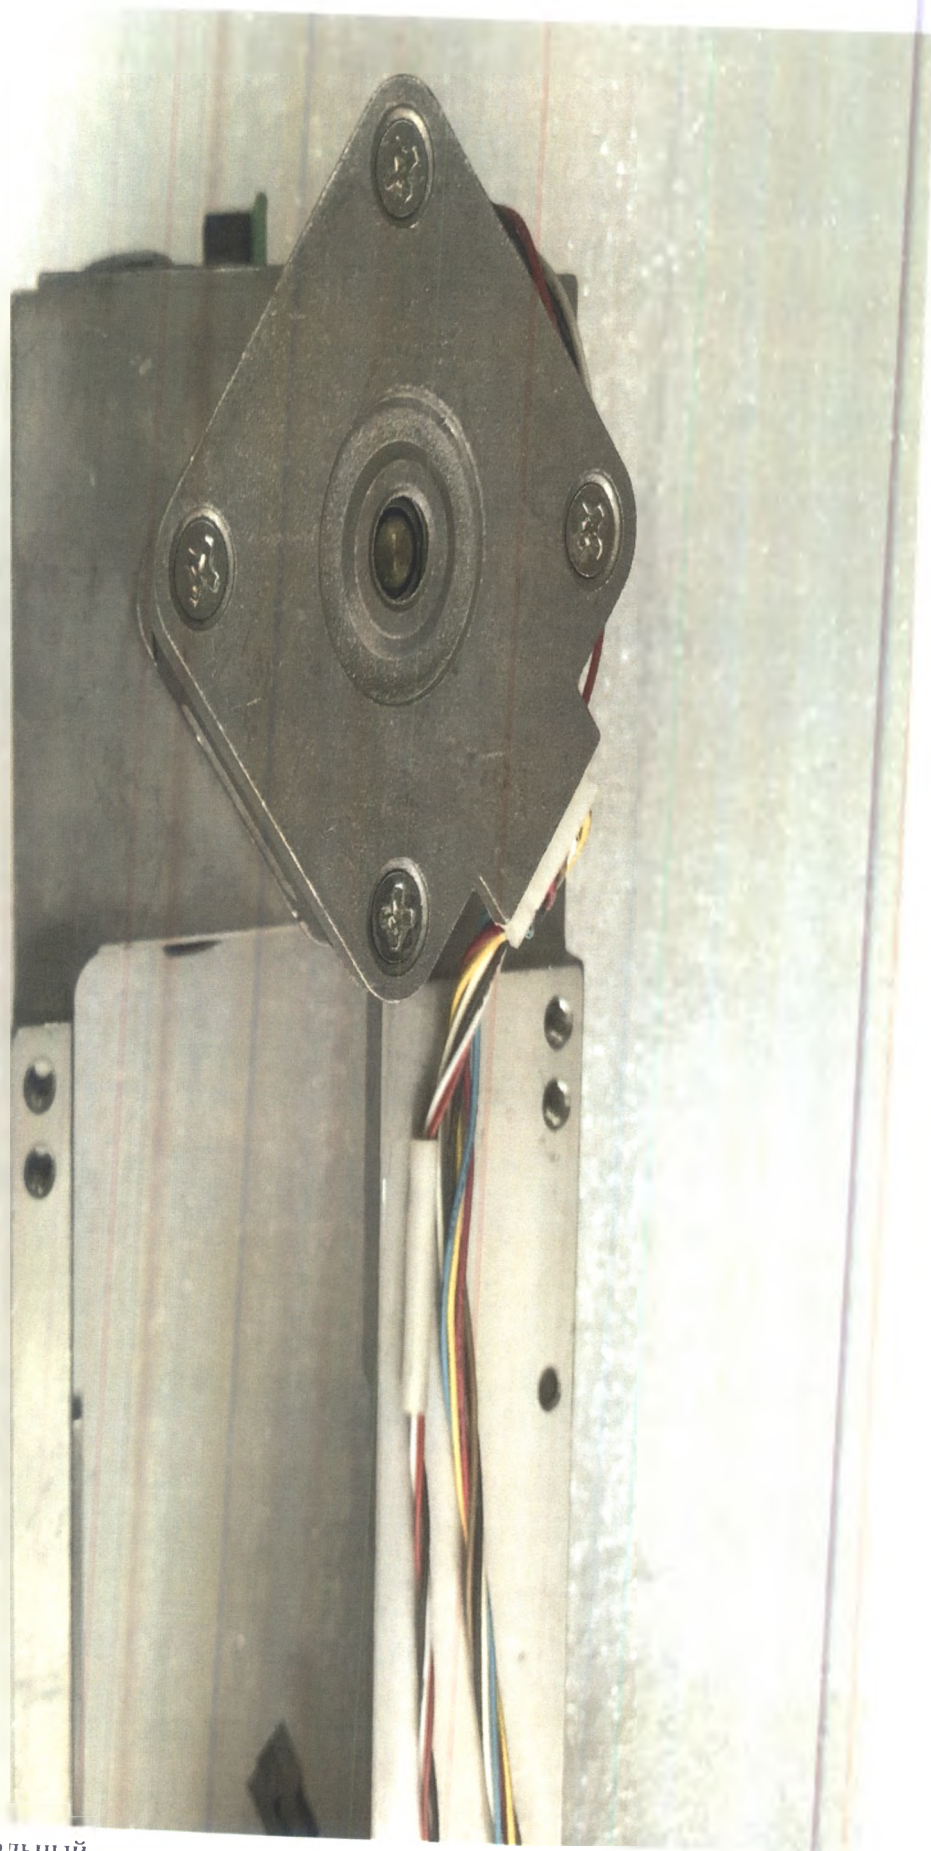

45. Блок шагового привода специальный.

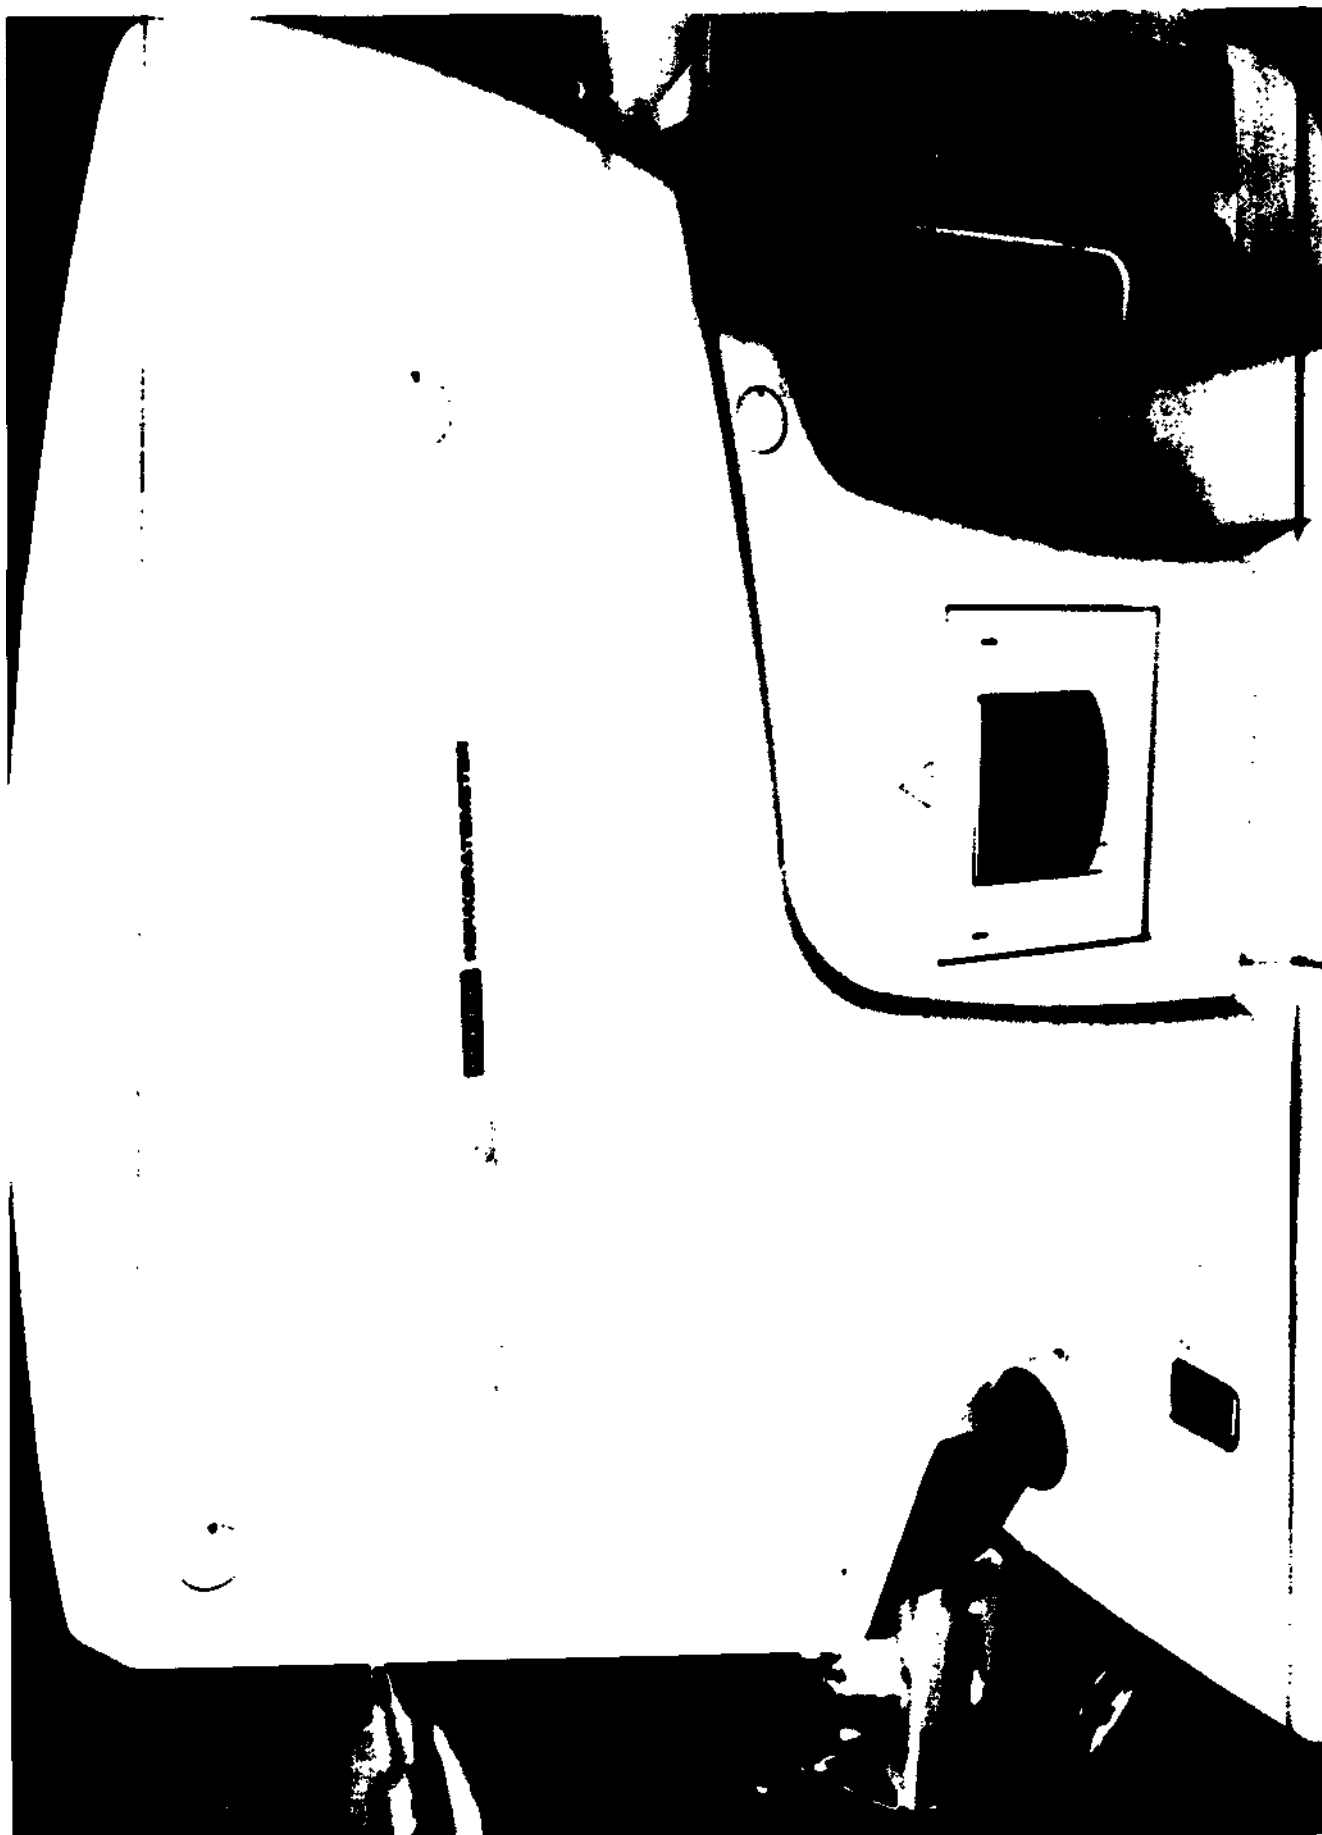

46. Панель корпуса защитная.

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО
66 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.

