

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти
(Vasofix® Safety) с инъекционным портом**

Оглавление

I. Индивидуальная упаковка.	6
1. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	6
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	6
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	7
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	8
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	9
2. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	10
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269330S-20)	10
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269330S-20)	11
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269330S-20)	12
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269330S-20)	13
3. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	14
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269136S-20)	14
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269136S-20)	15
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269136S-20)	16
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269136S-20)	17
4. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	18
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	18
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	19
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	20
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	21
5. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	22
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269071S-01)	22
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269071S-01)	23


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269071S-01).....	24
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269071S-01).....	25
6. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	25
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	25
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	27
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	29
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	29
7. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	33
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	33
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	35
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	37
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	39
8. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	34
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)	34
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269179S-20).....	35
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269179S-20).....	36
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269179S-20).....	37
9. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом	38
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)	38
2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера по каталогу 4269217S-20).....	39
3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269217S-20).....	40
4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269217S-20).....	41
II. Групповая упаковка.....	42
1. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.....	42

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269330S-20).....	42
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269330S-20).....	44
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269330S-20).....	45
2. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.....	46
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269136S-20).....	46
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269136S-20).....	48
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269136S-20).....	49
3. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	50
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269071S-01).....	50
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269071S-01).....	52
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269071S-01).....	53
4. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.....	54
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	54
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	56
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269110S-01).....	57
5) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	58
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	58
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	60
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269152S-20).....	61
6) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	62
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269179S-20).....	62
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269179S-20).....	64

3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)	65
7) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	66
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)	66
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)	68
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)	69
8) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	70
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	70
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	72
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сверху</i>) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)	73
9) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.	74
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид спереди</i>) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	74
2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	76
3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (<i>вид сзади и сбоку</i>) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)	77


I. Индивидуальная упаковка.

1. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)

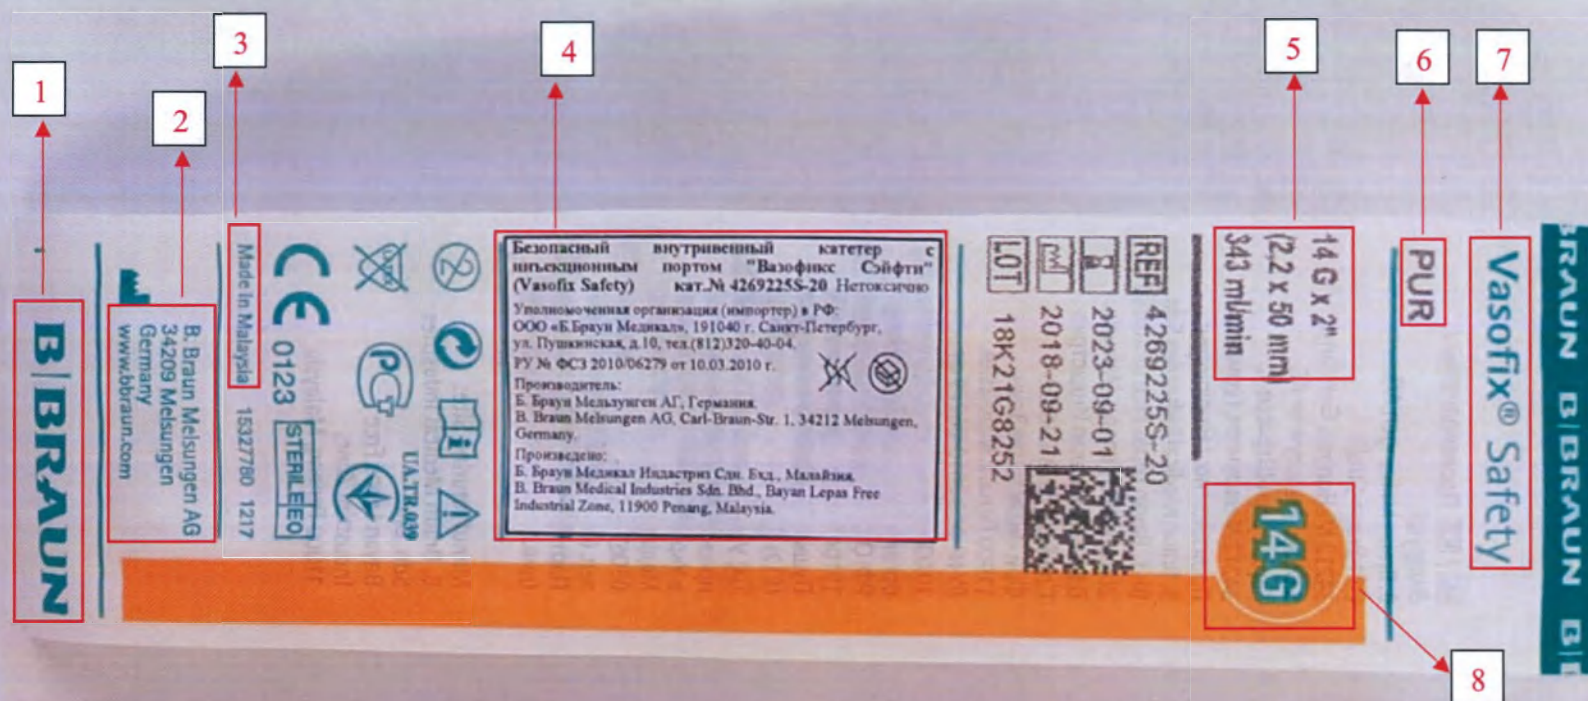


1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера


После завершения процесса внесения изменений регистрационную документацию на этикетку/сти медицинского изделия будет нанесена обновленная дата и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

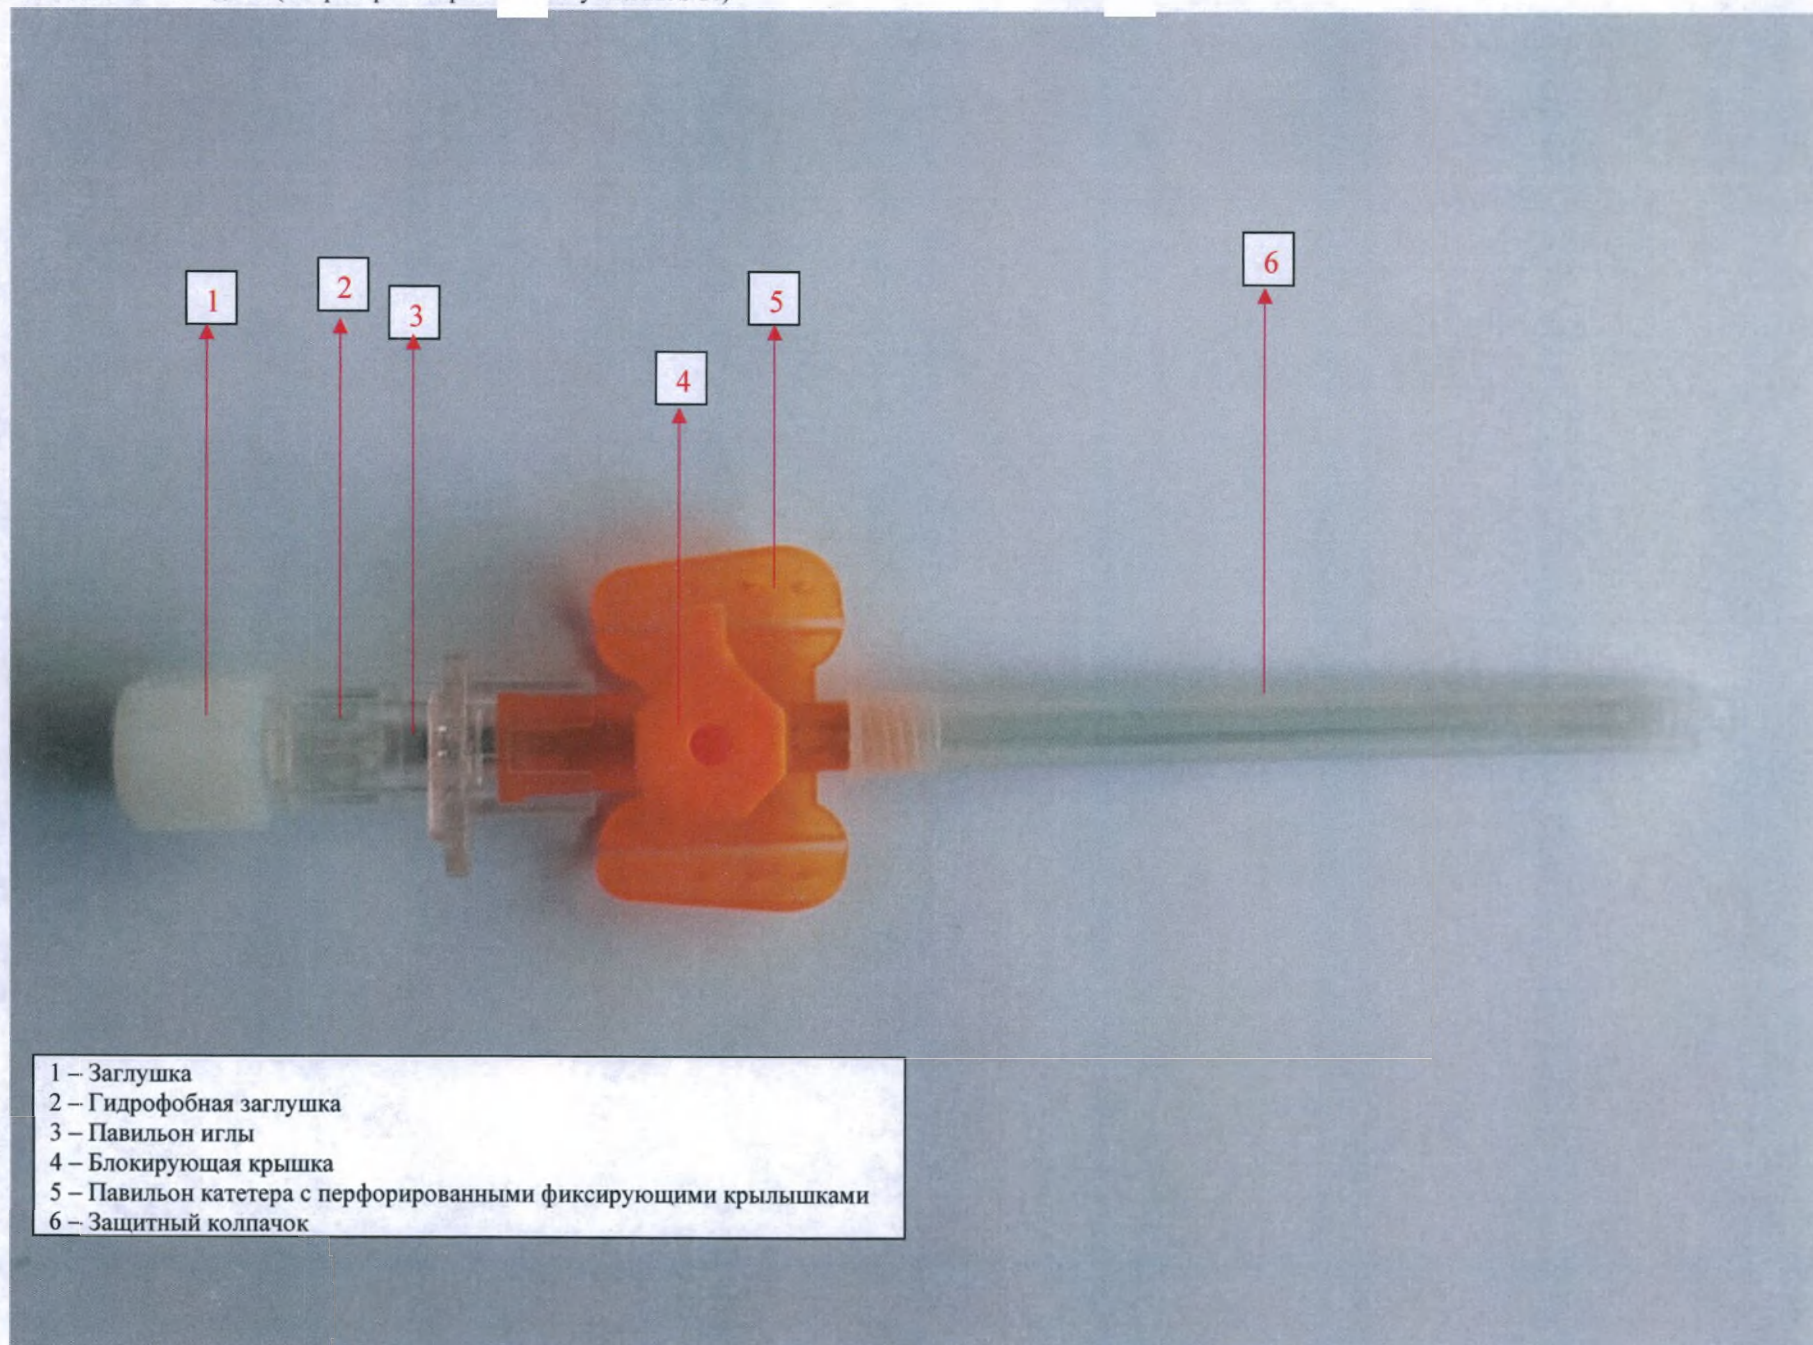


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269225S-20)

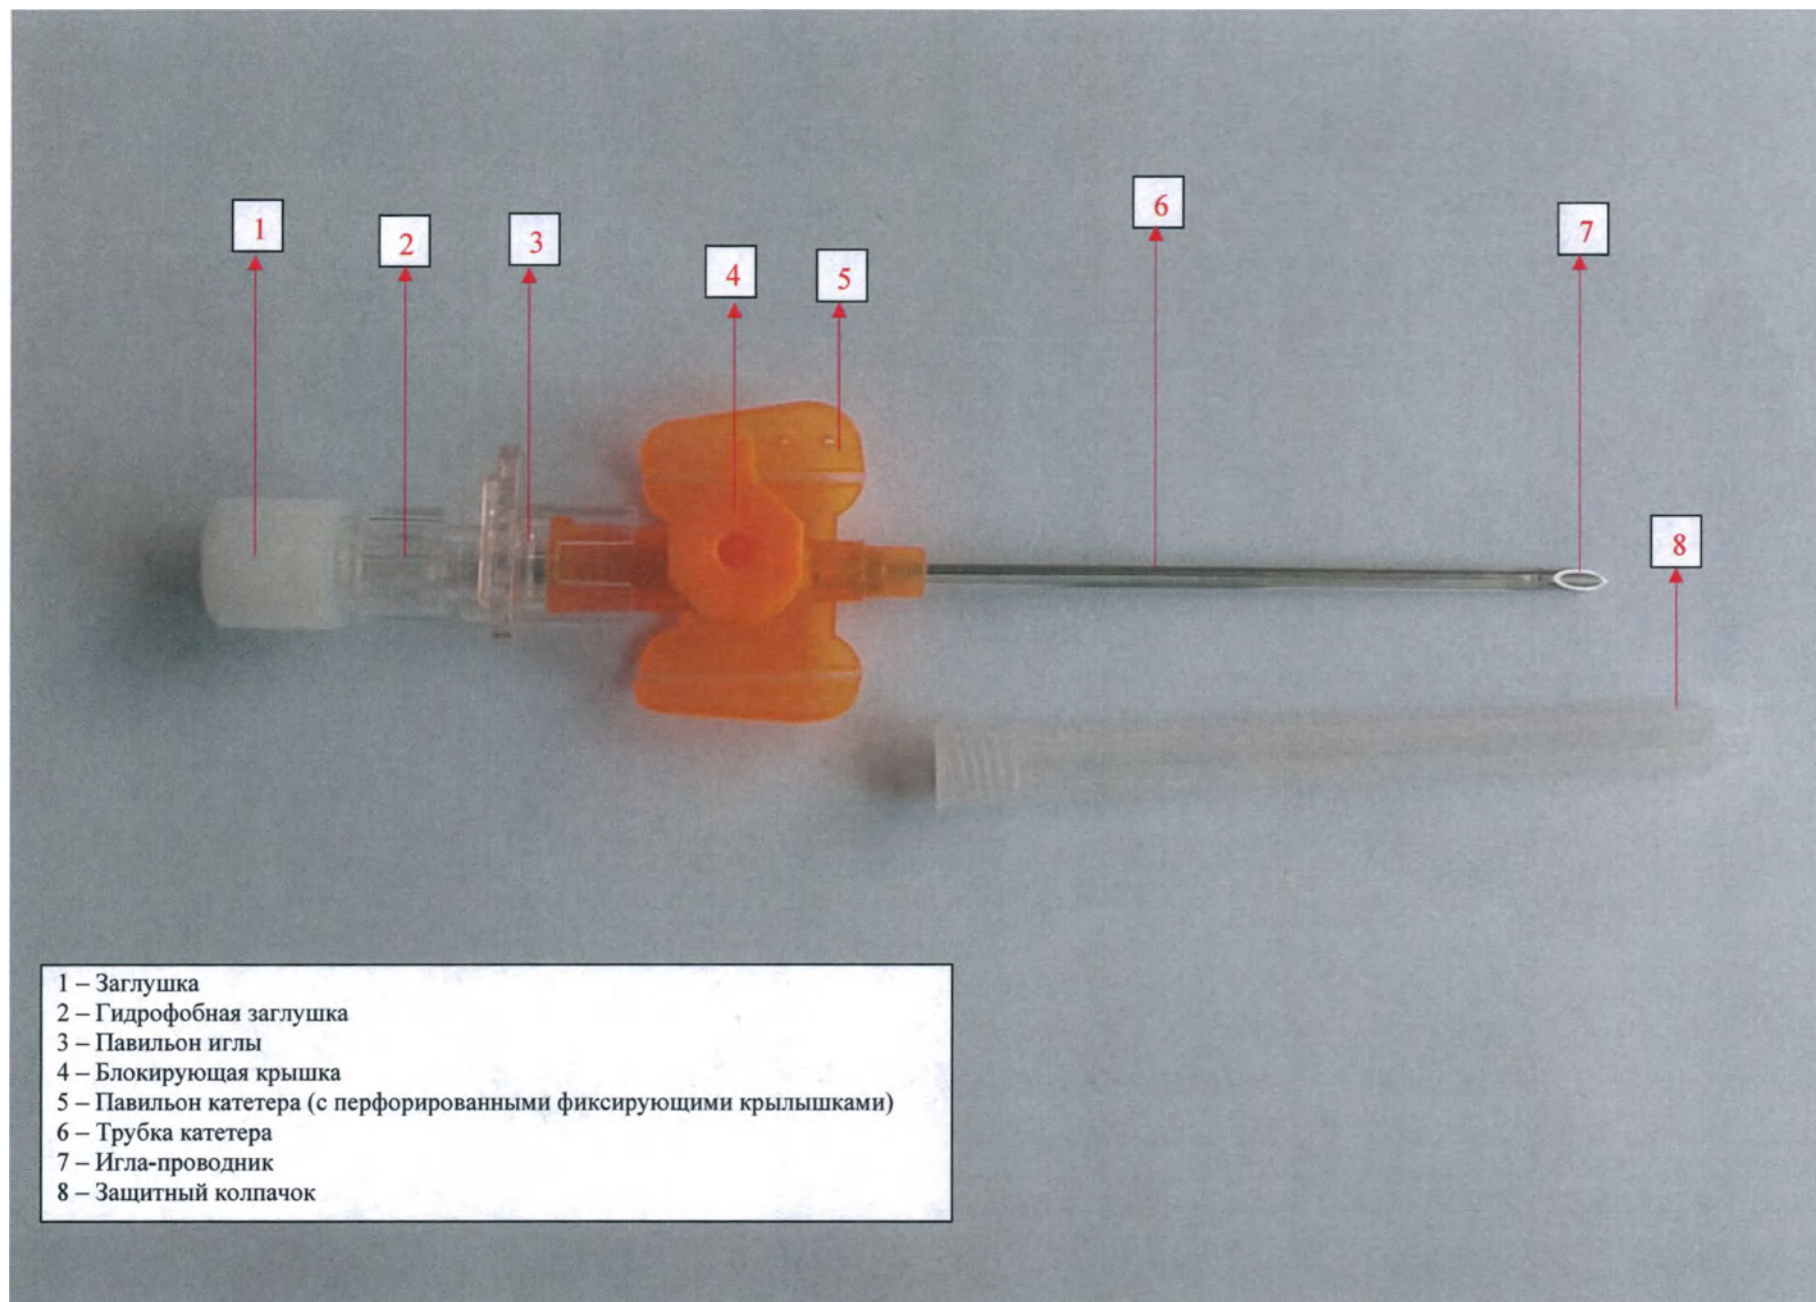


4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269225S-20)

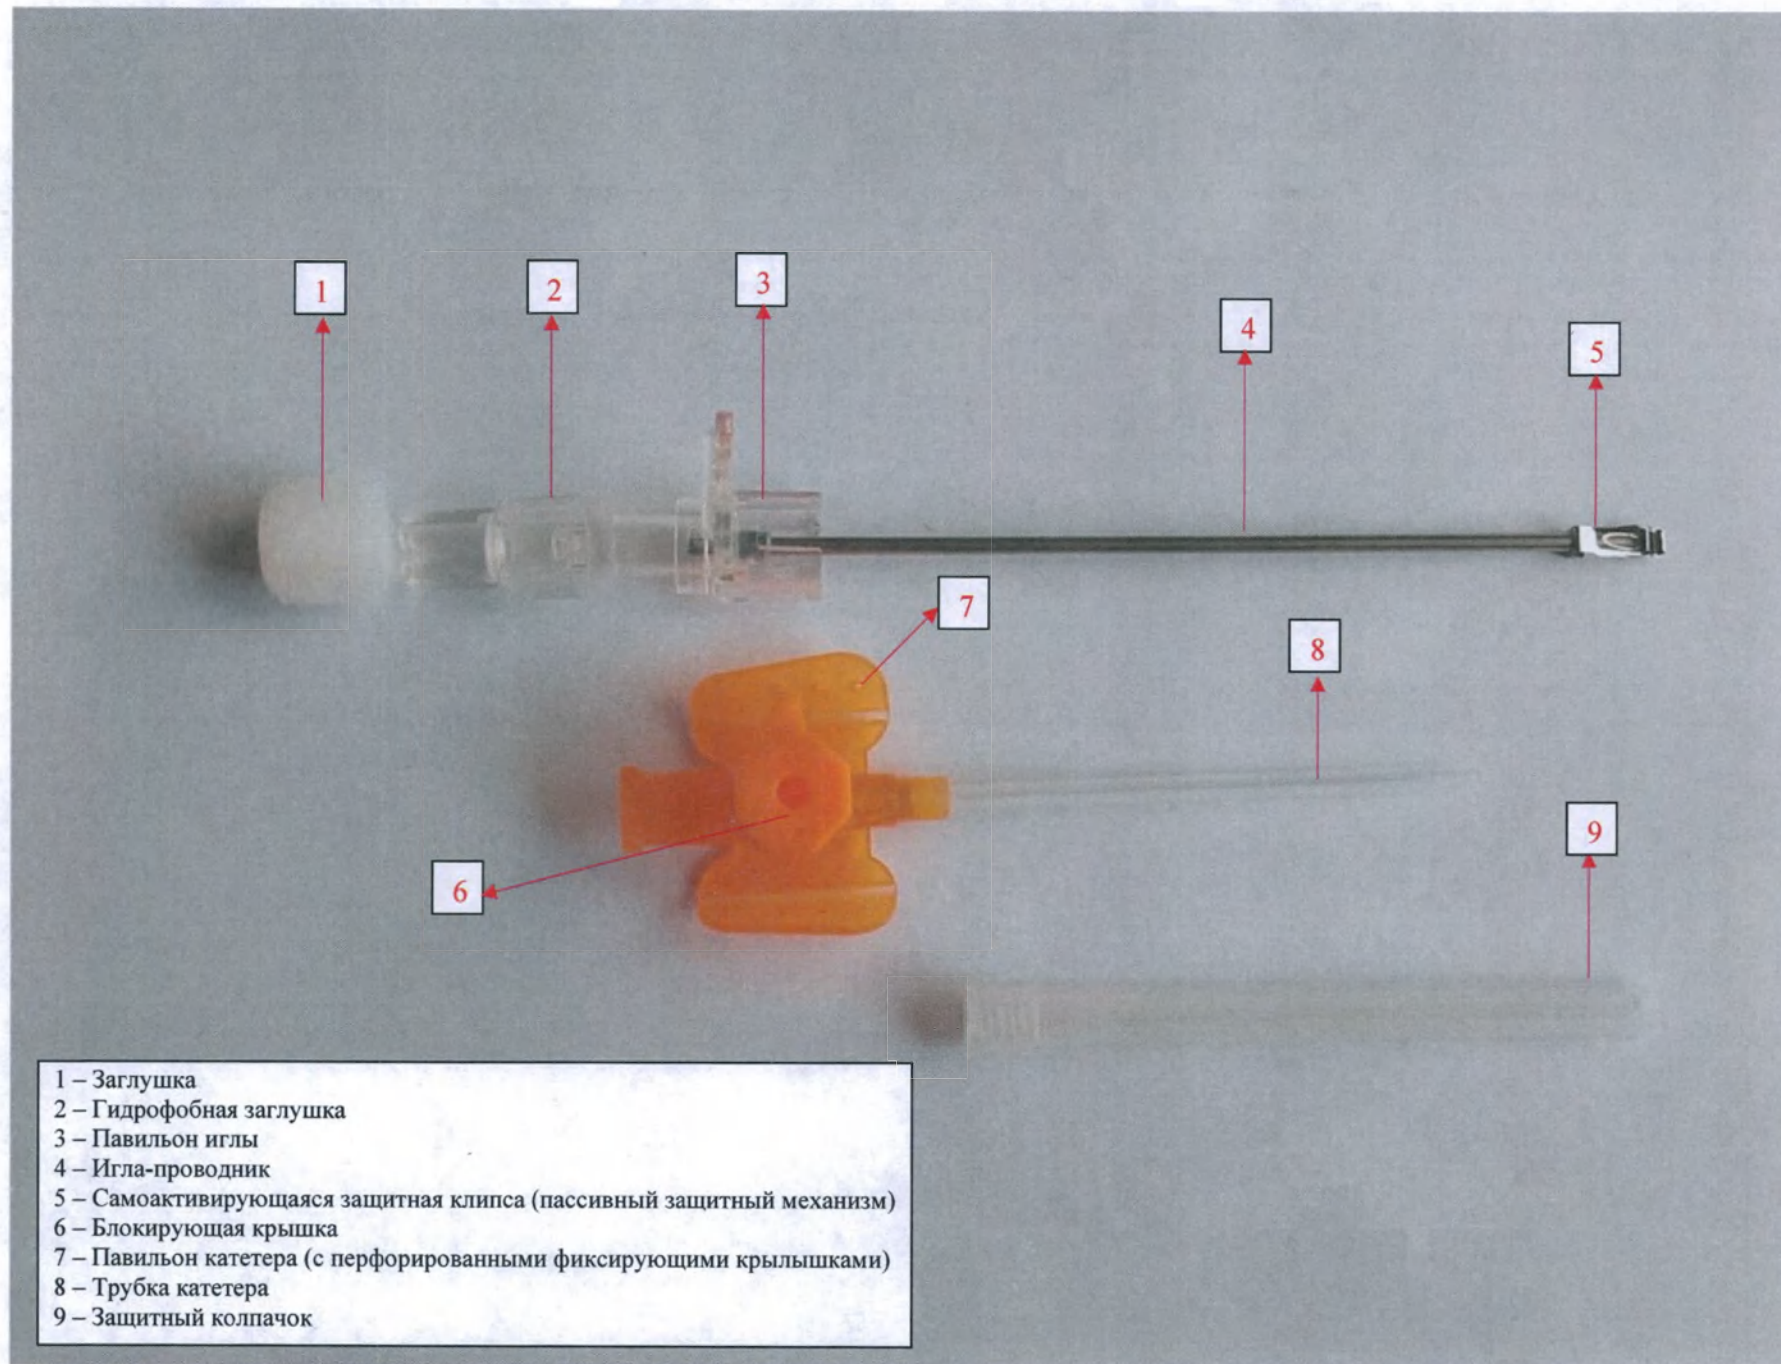


2. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269330S-20)

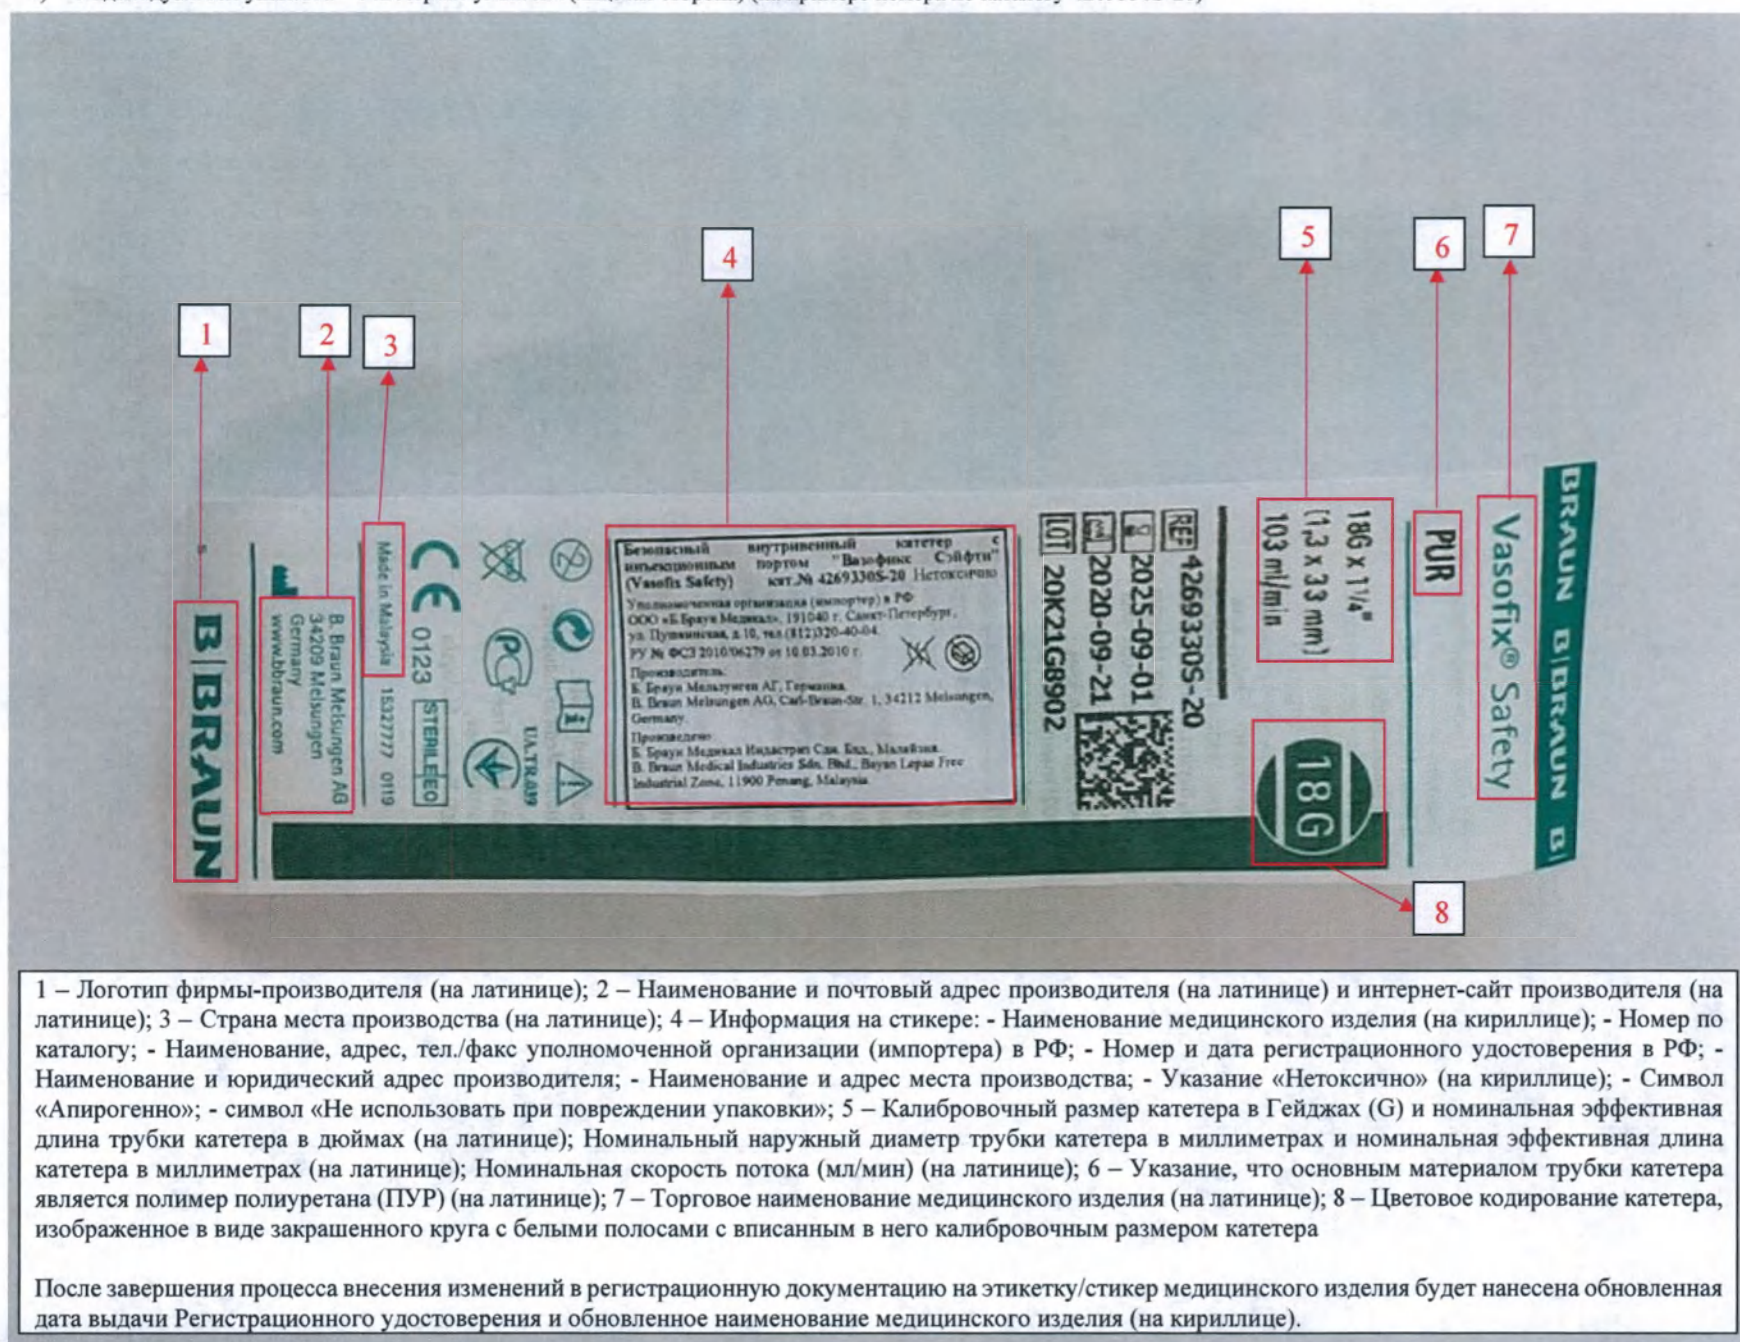

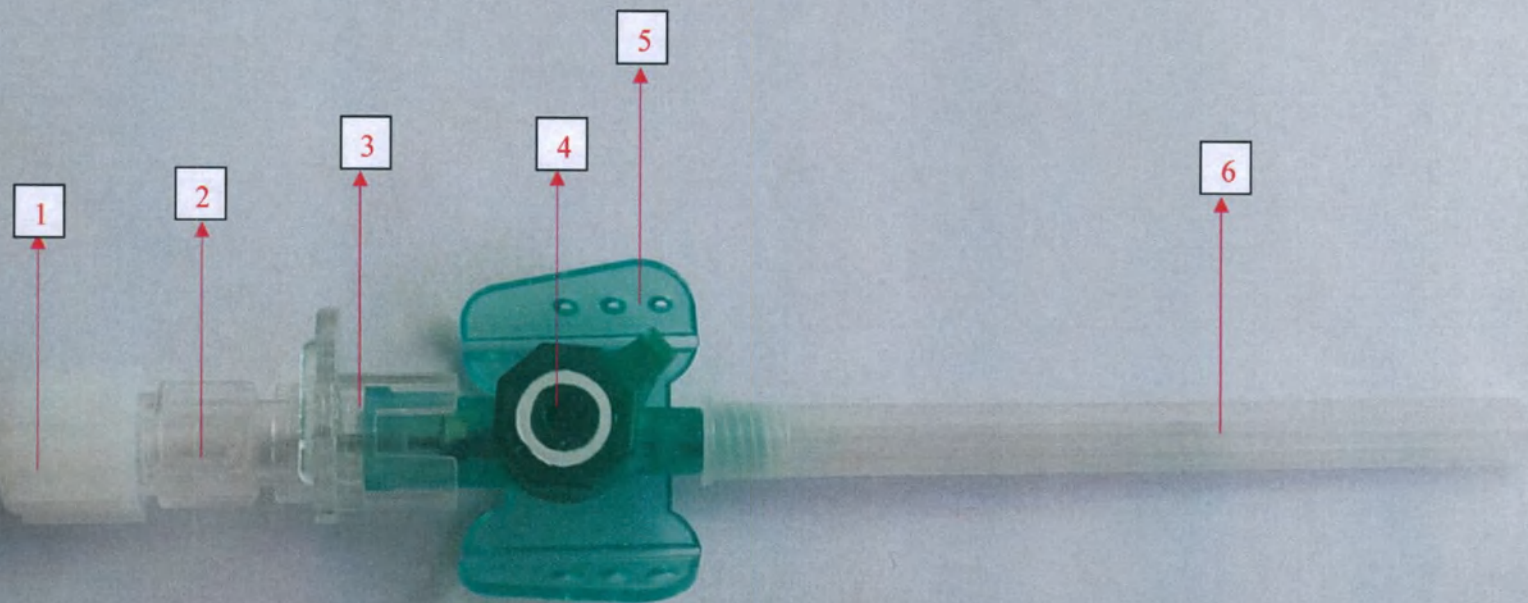


- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Блокирующая крышка (с нанесенным кругом белого цвета)
- 5 – Павильон катетера с перфорированными фиксирующими крылышками
- 6 – Защитный колпачок


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269330S-20)

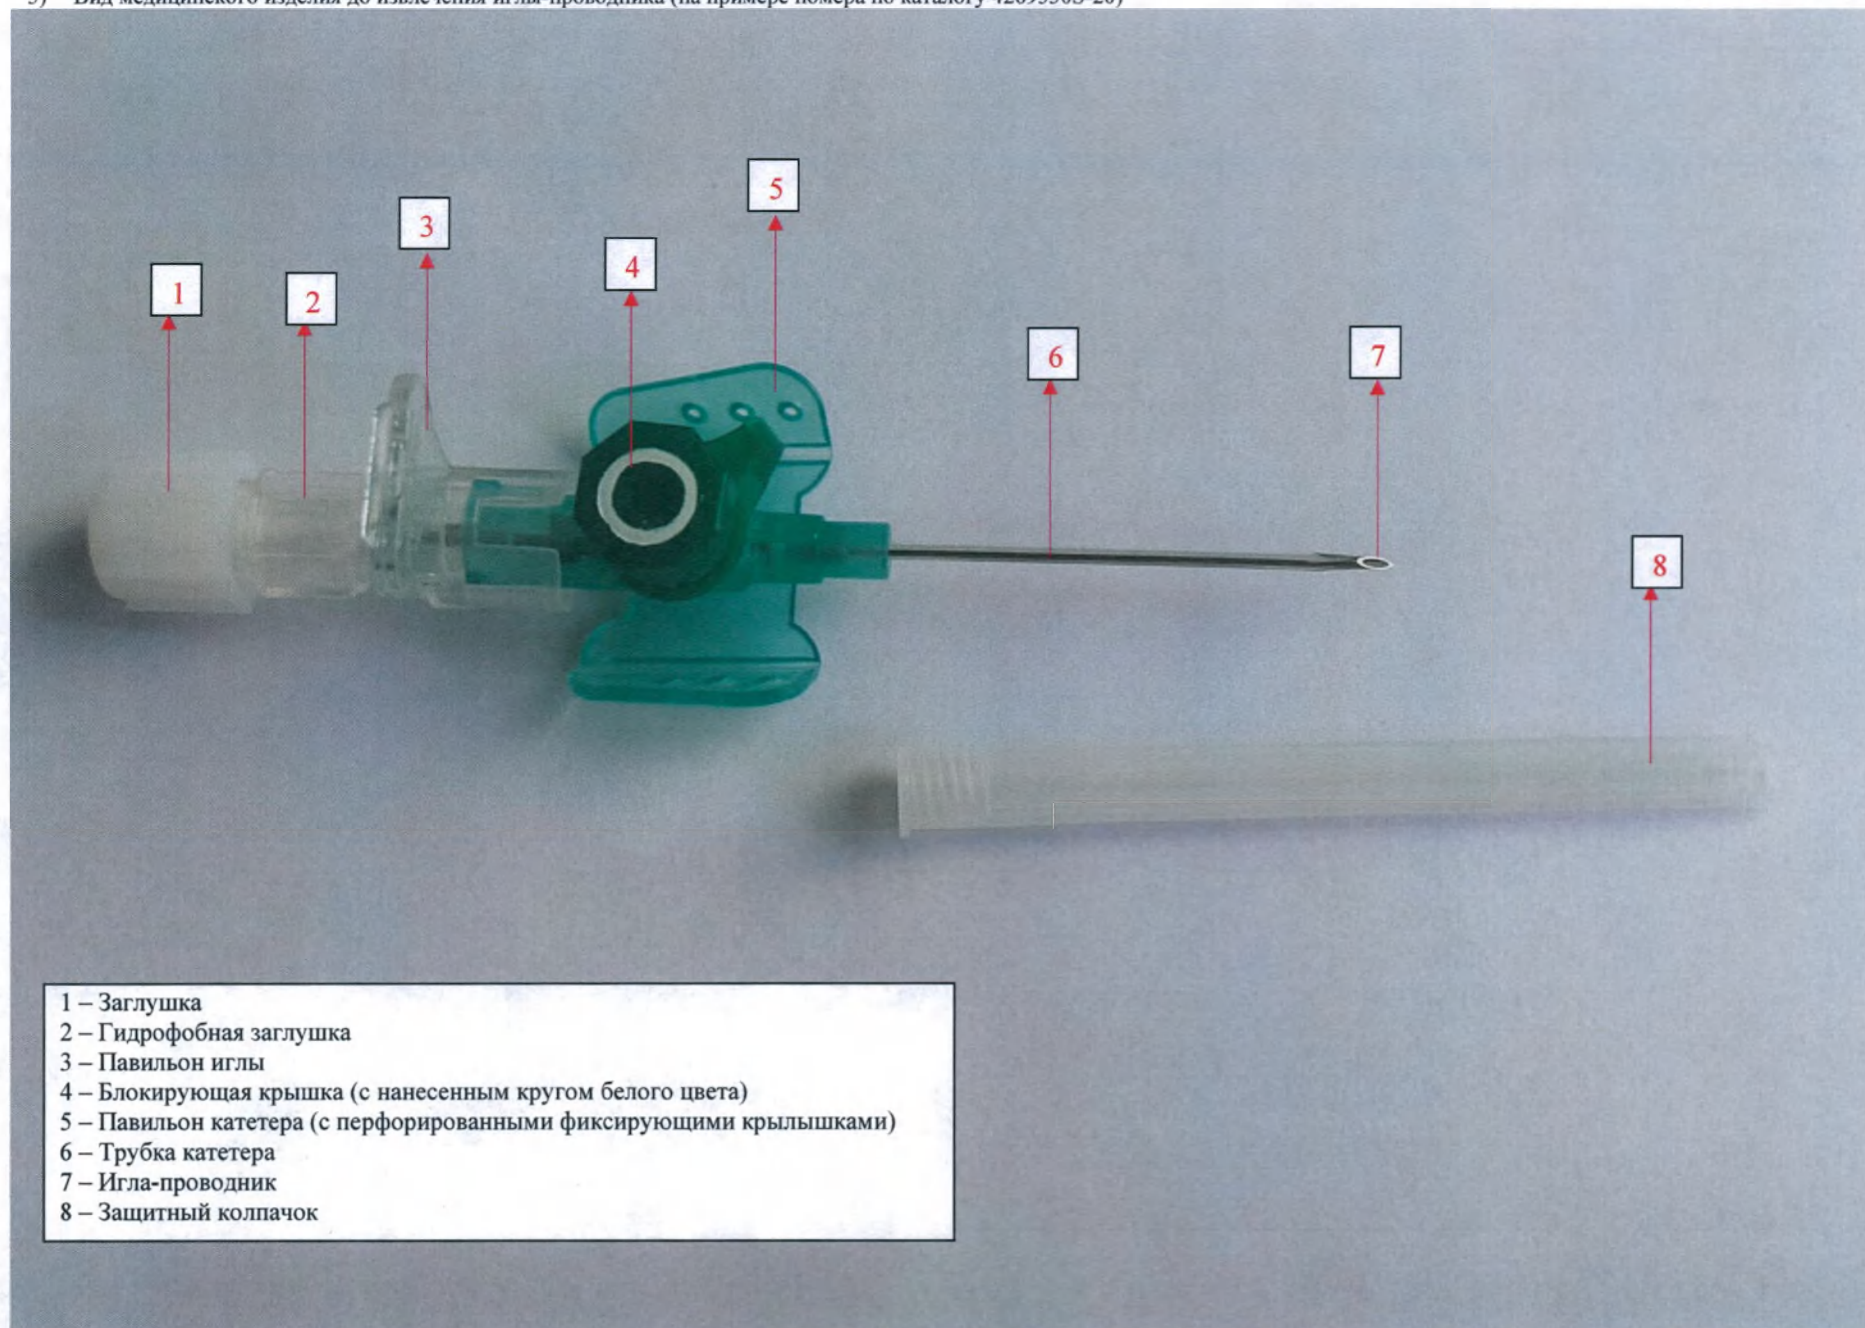

4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269330S-20)

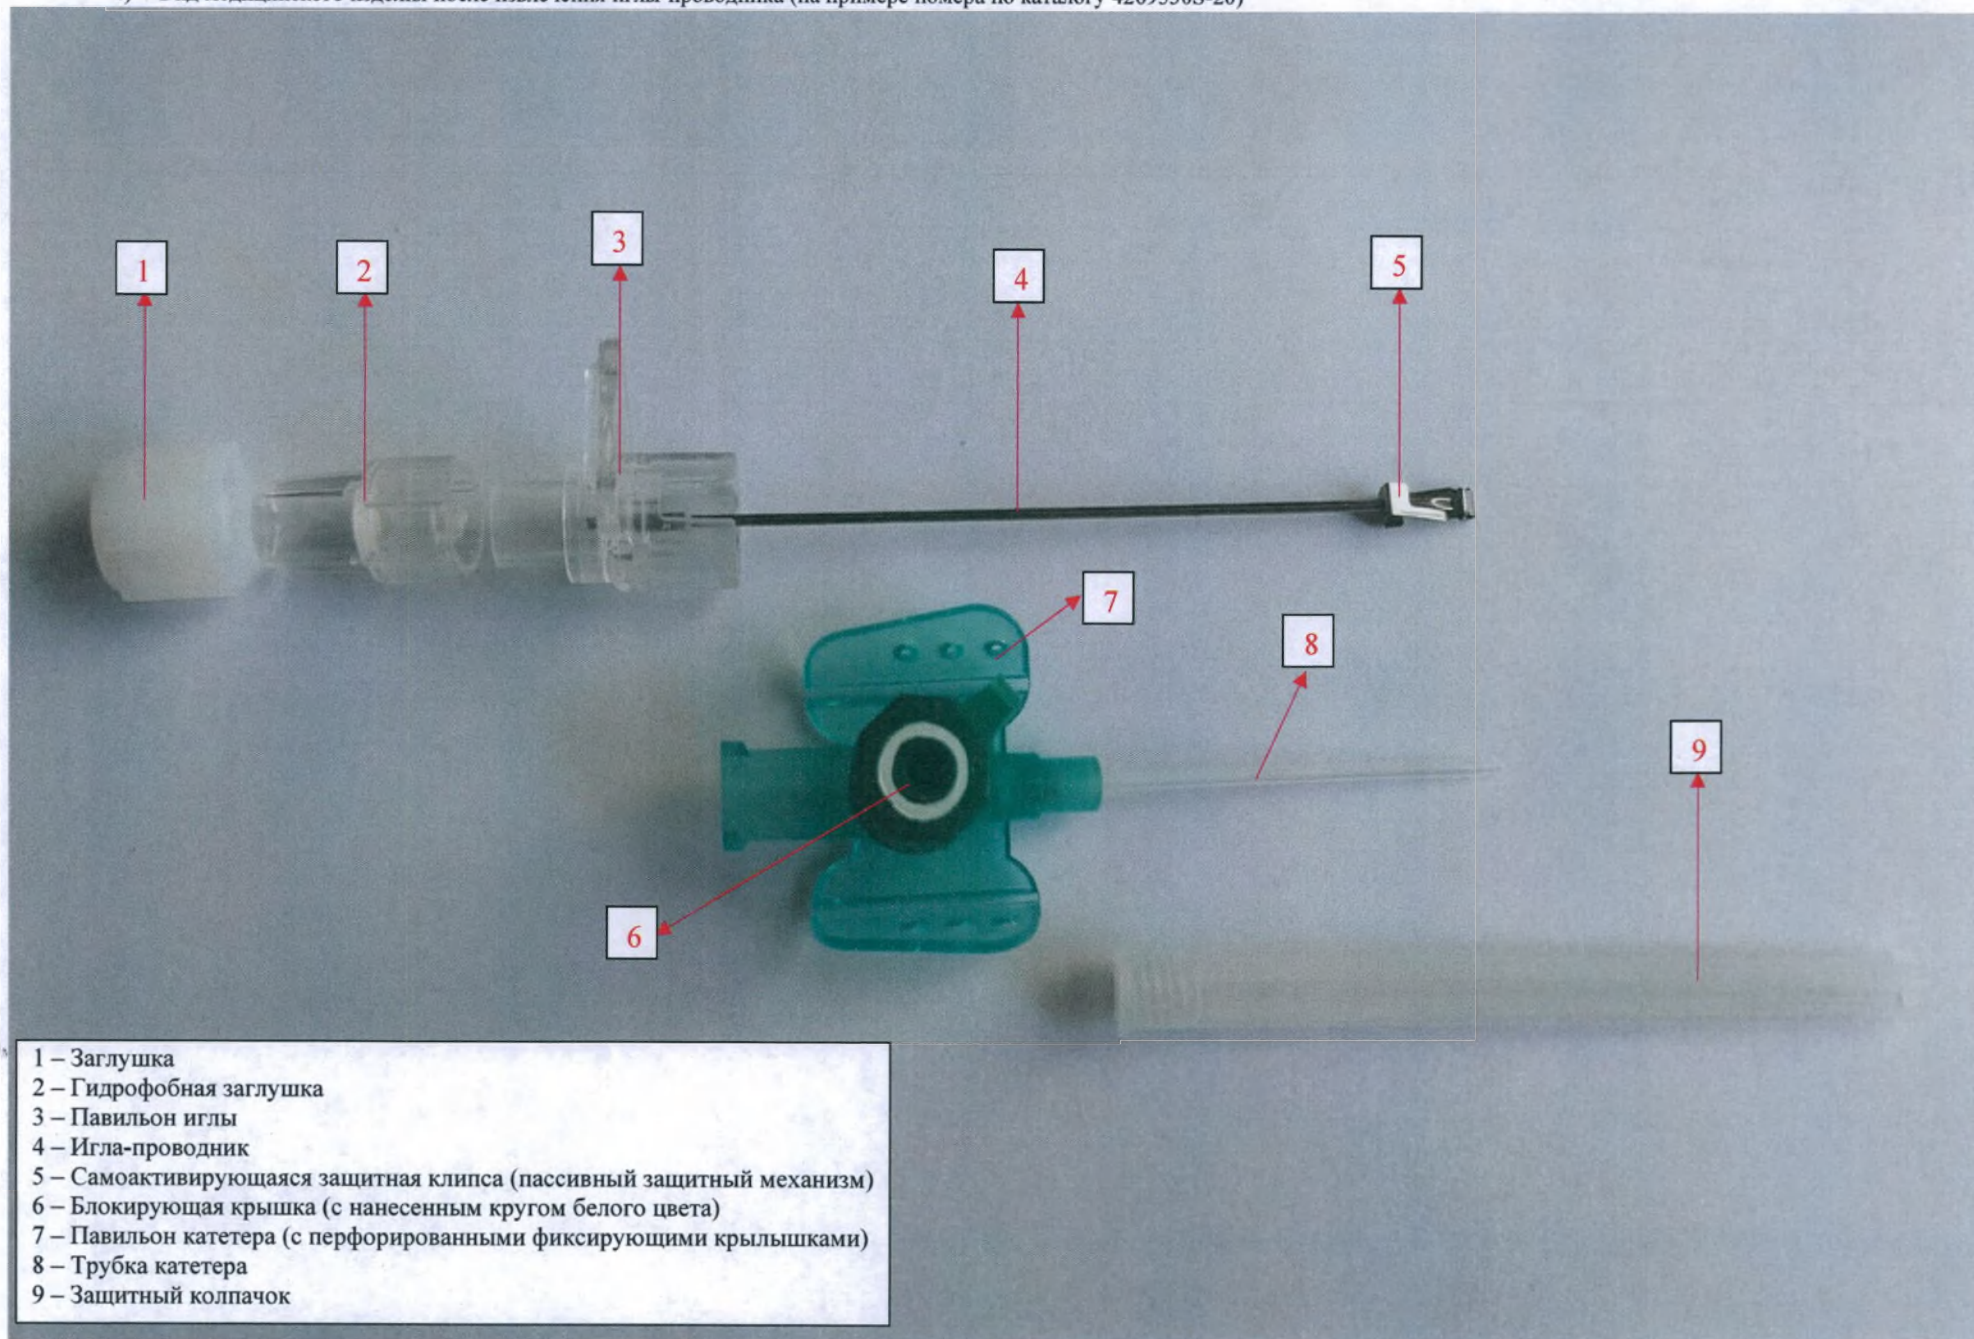


3. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269136S-20)

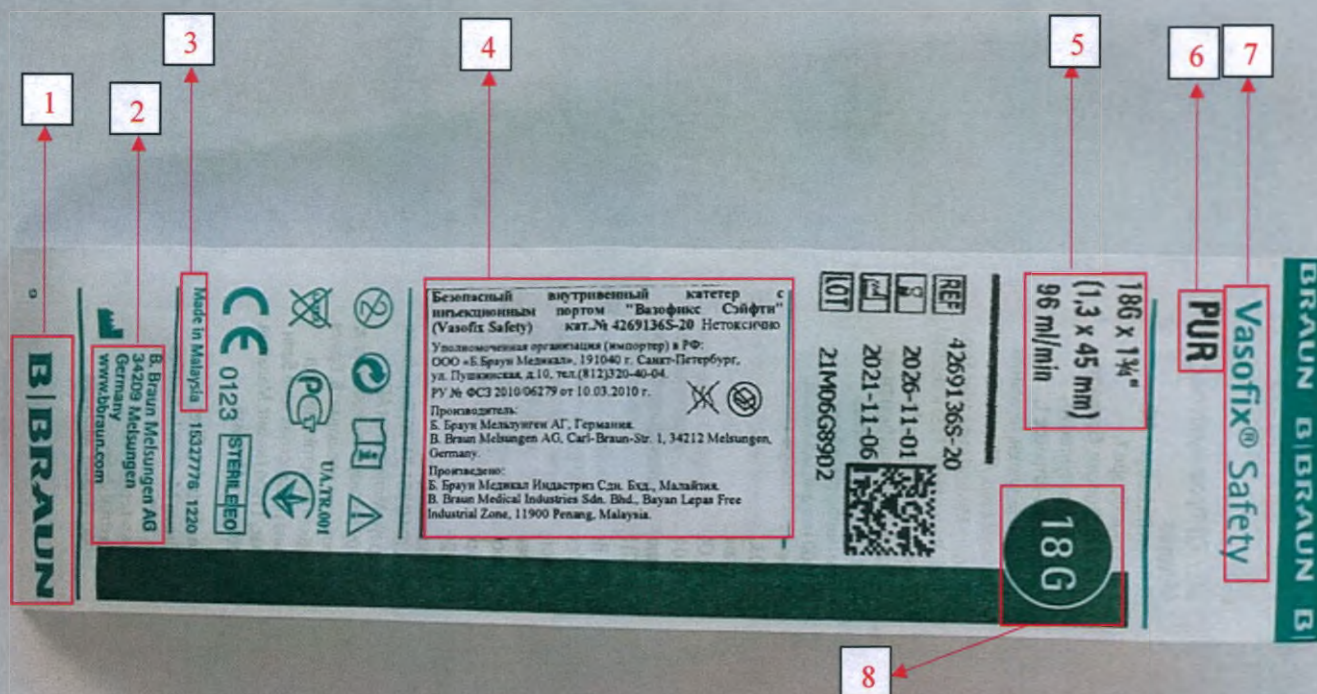



1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

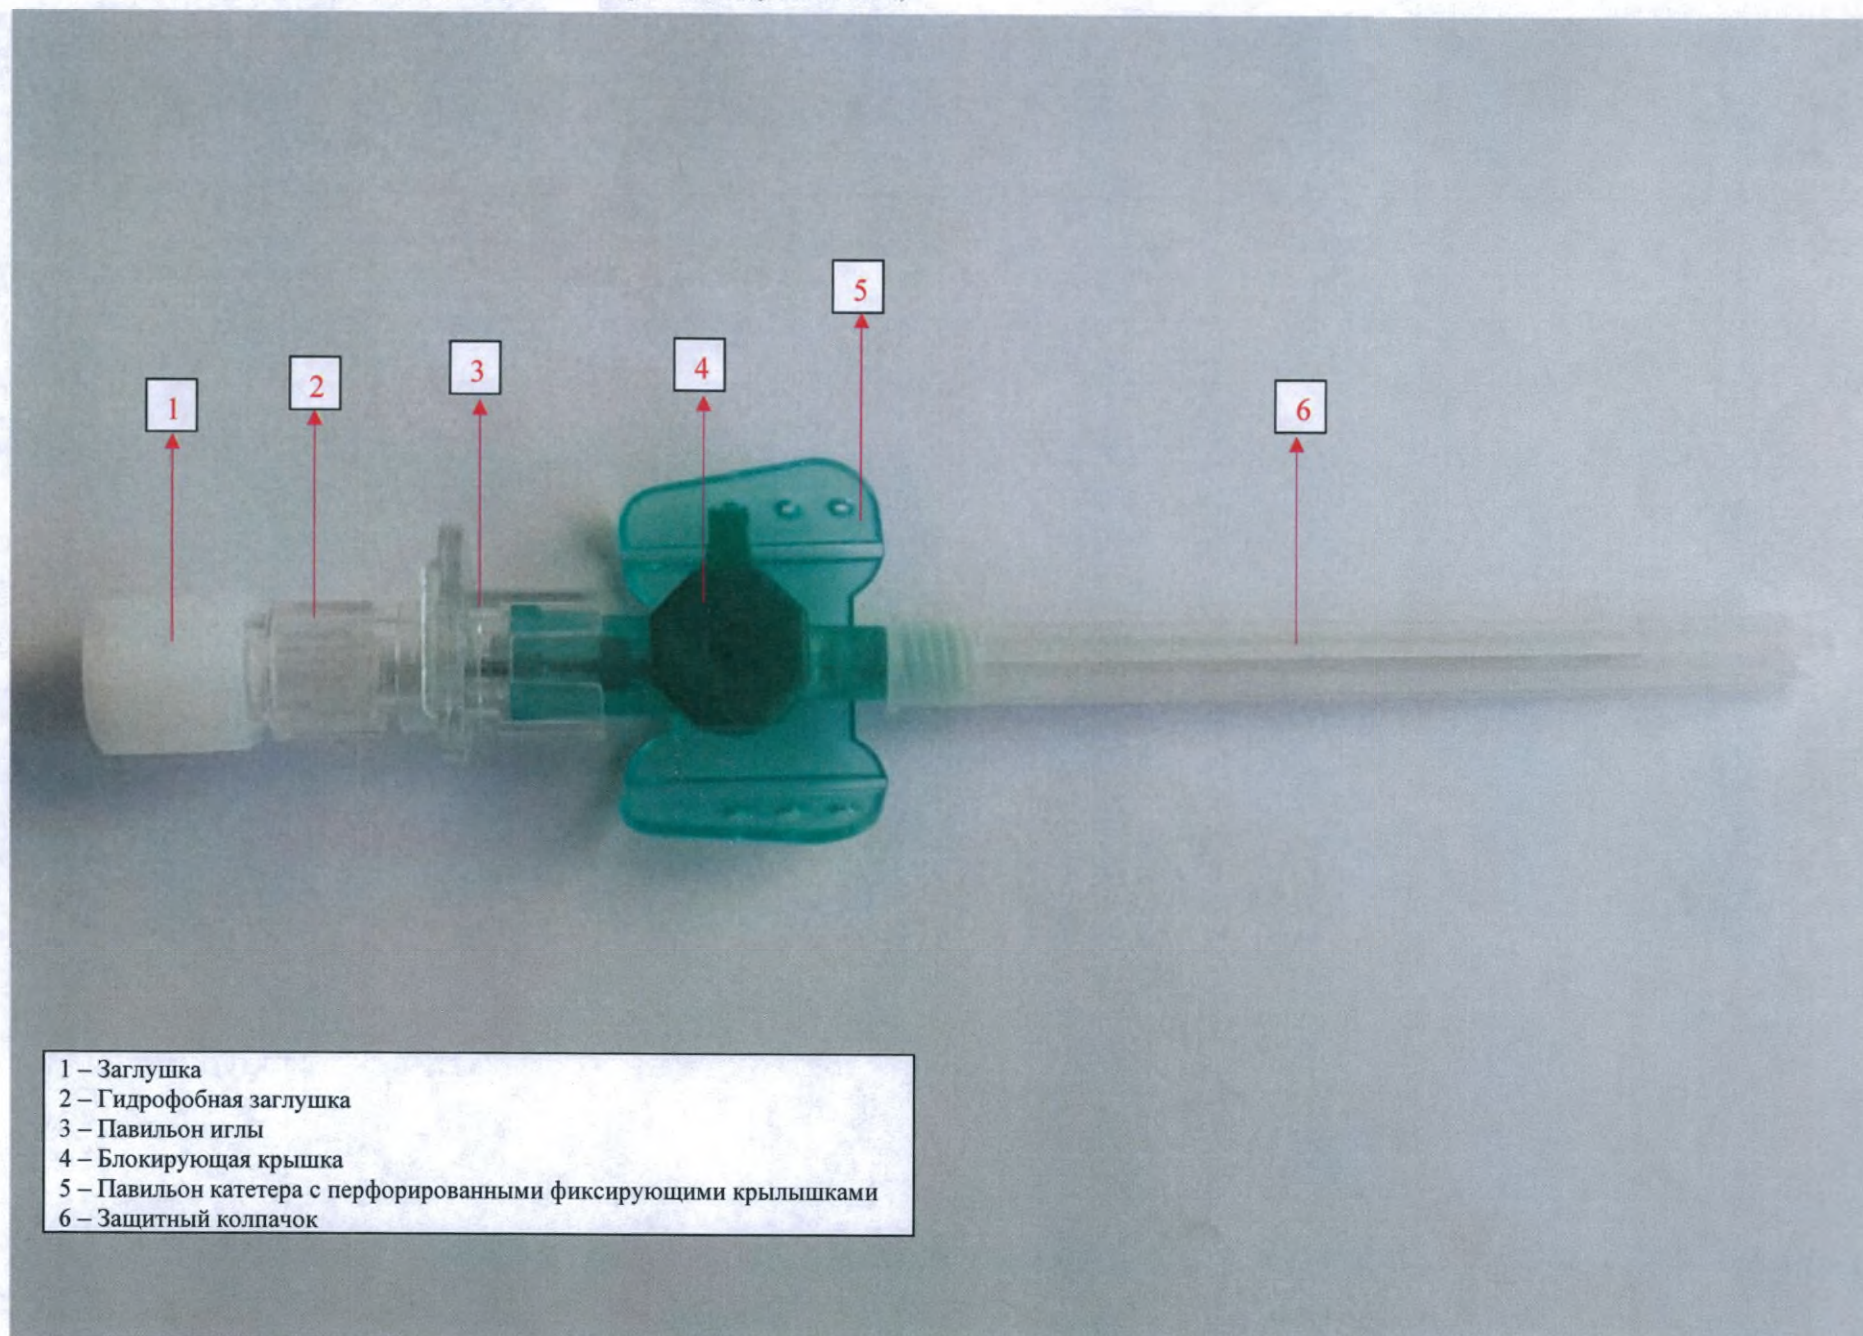


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269136S-20)

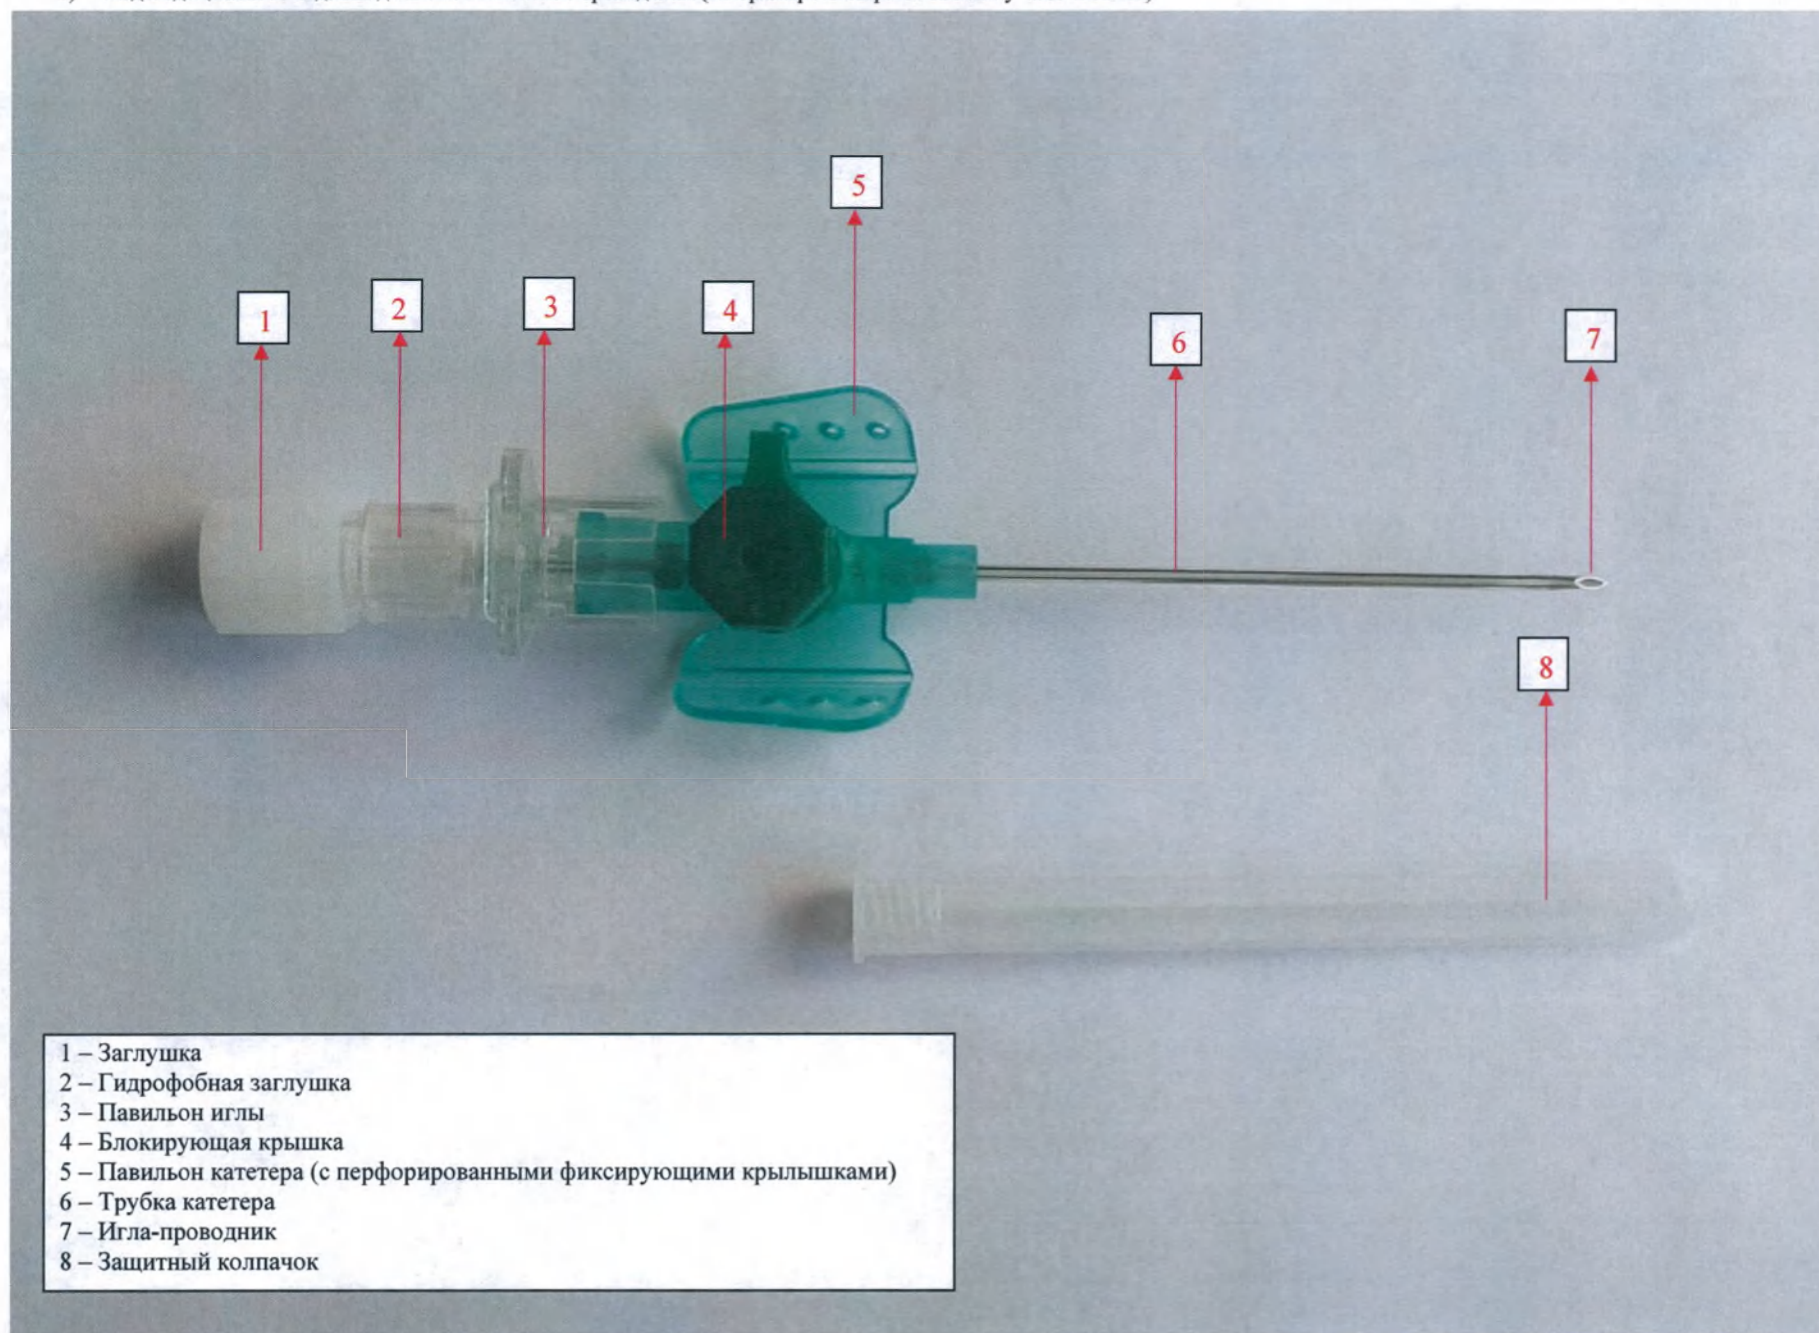

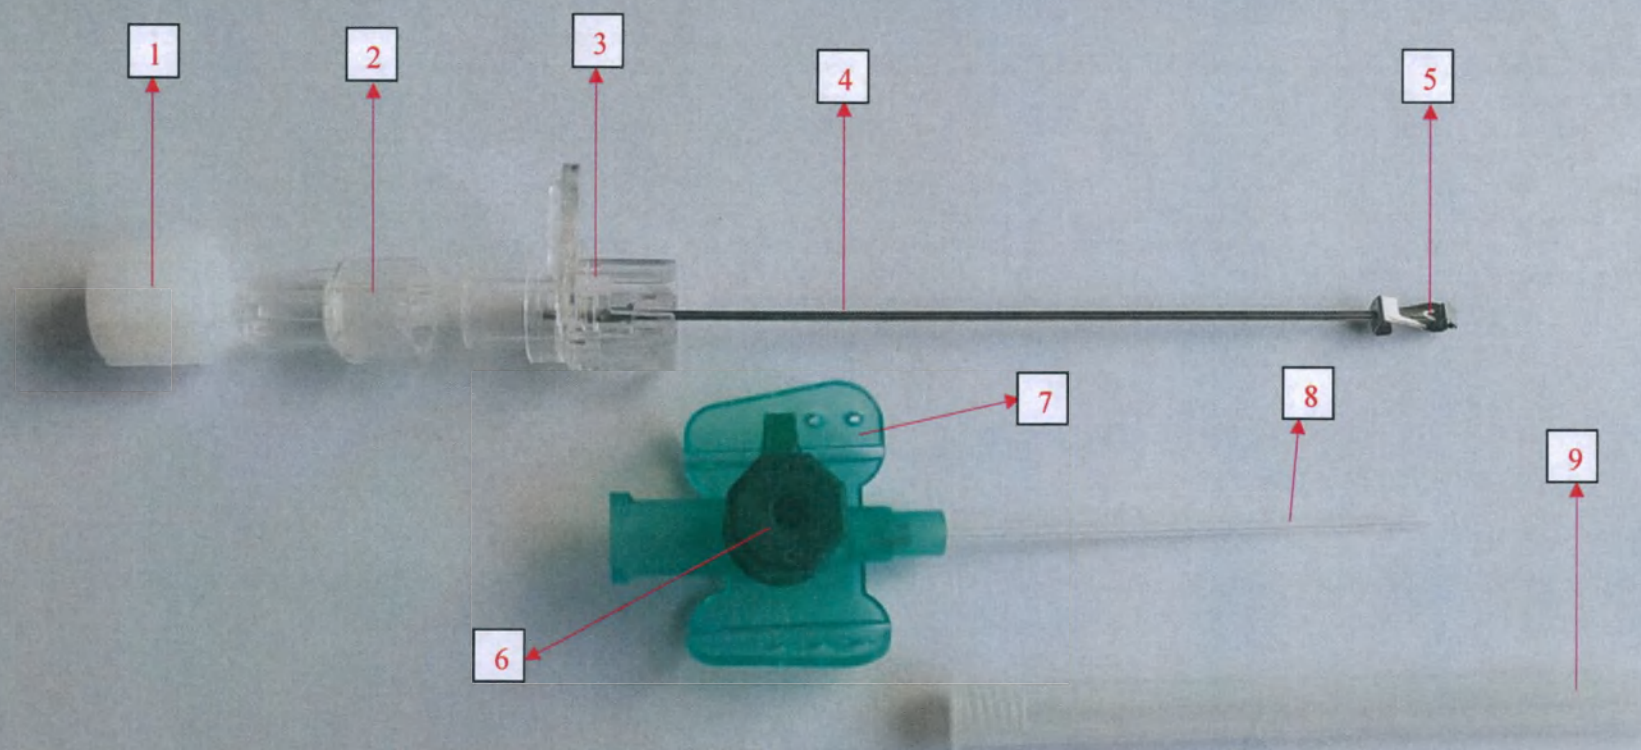

- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Игла-проводник
- 5 – Самоактивирующаяся защитная клипса (пассивный защитный механизм)
- 6 – Блокирующая крышка
- 7 – Павильон катетера (с перфорированными фиксирующими крылышками)
- 8 – Трубка катетера
- 9 – Защитный колпачок


4. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)

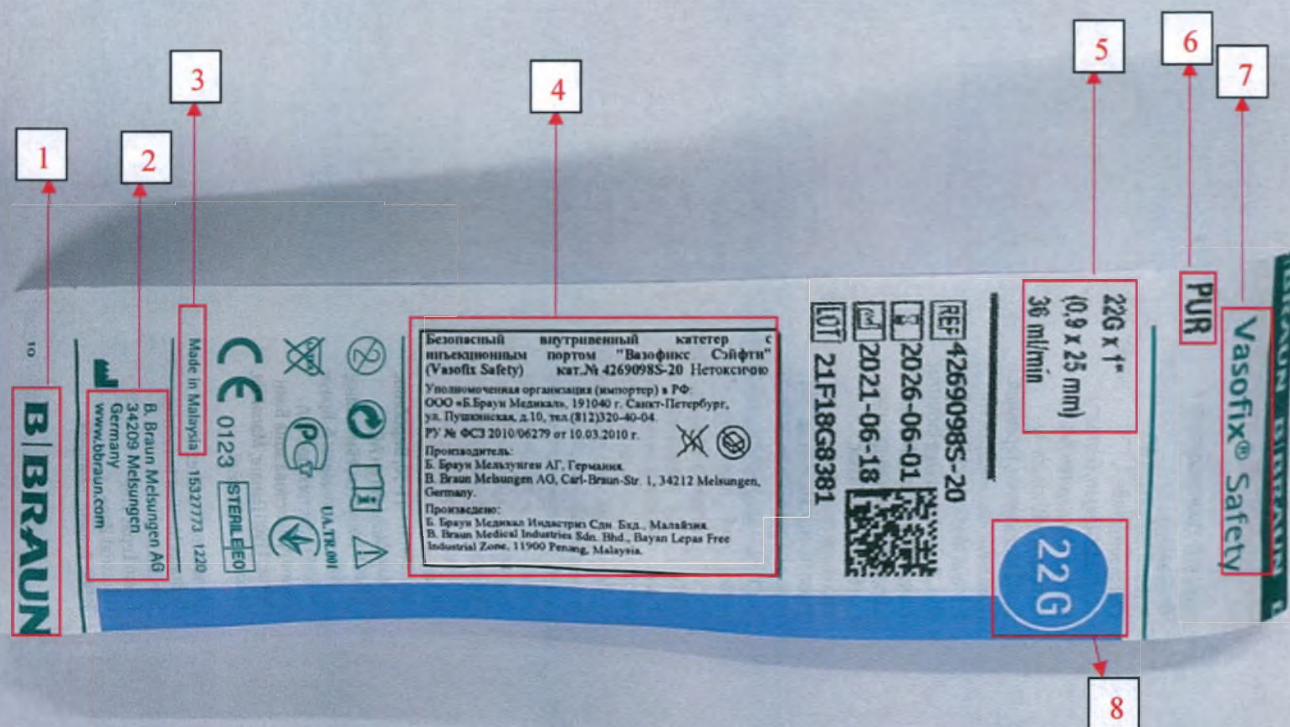


1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - Символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).


2) Общий вид медицинского изделия (на примере катетера по каталогу 4269098S-20)

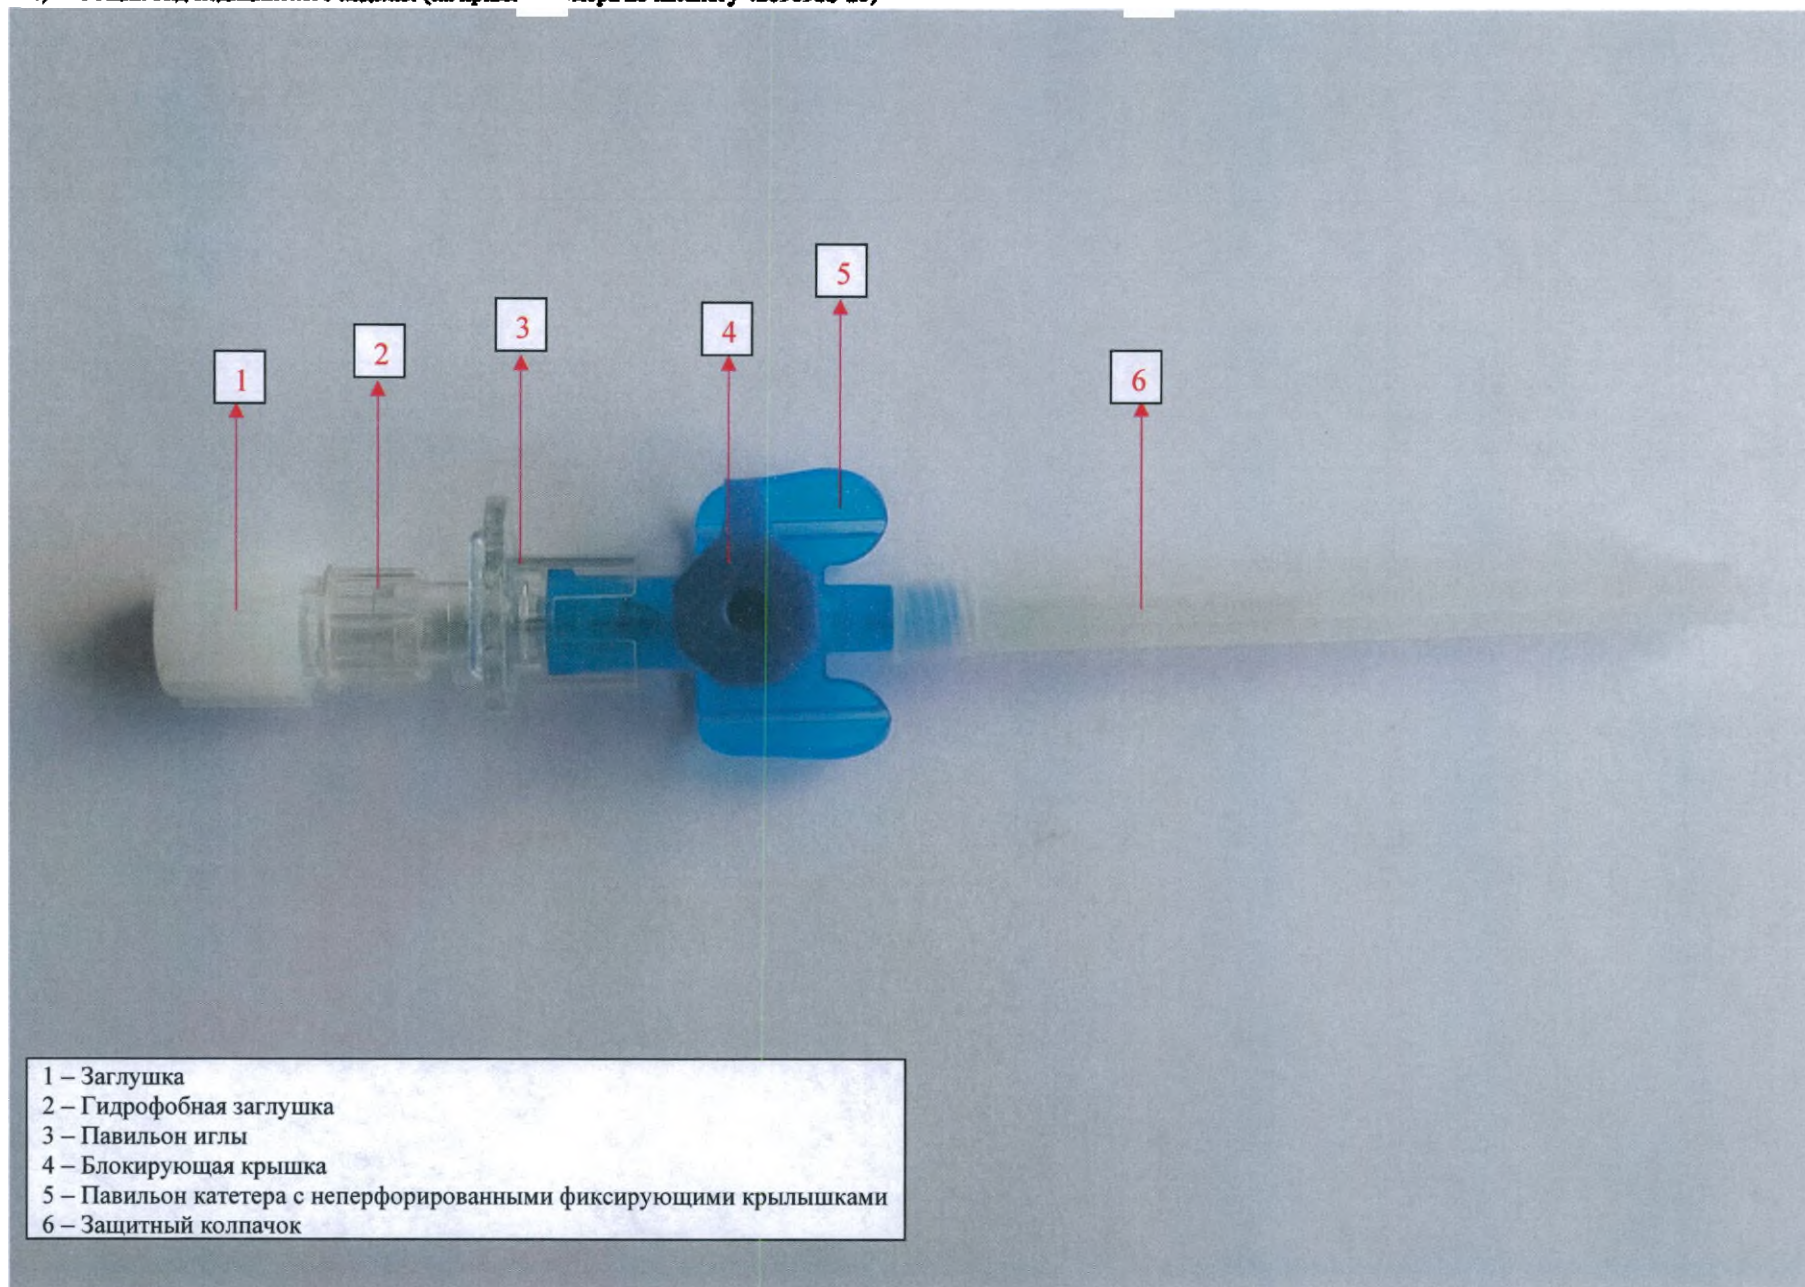


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269098S-20)

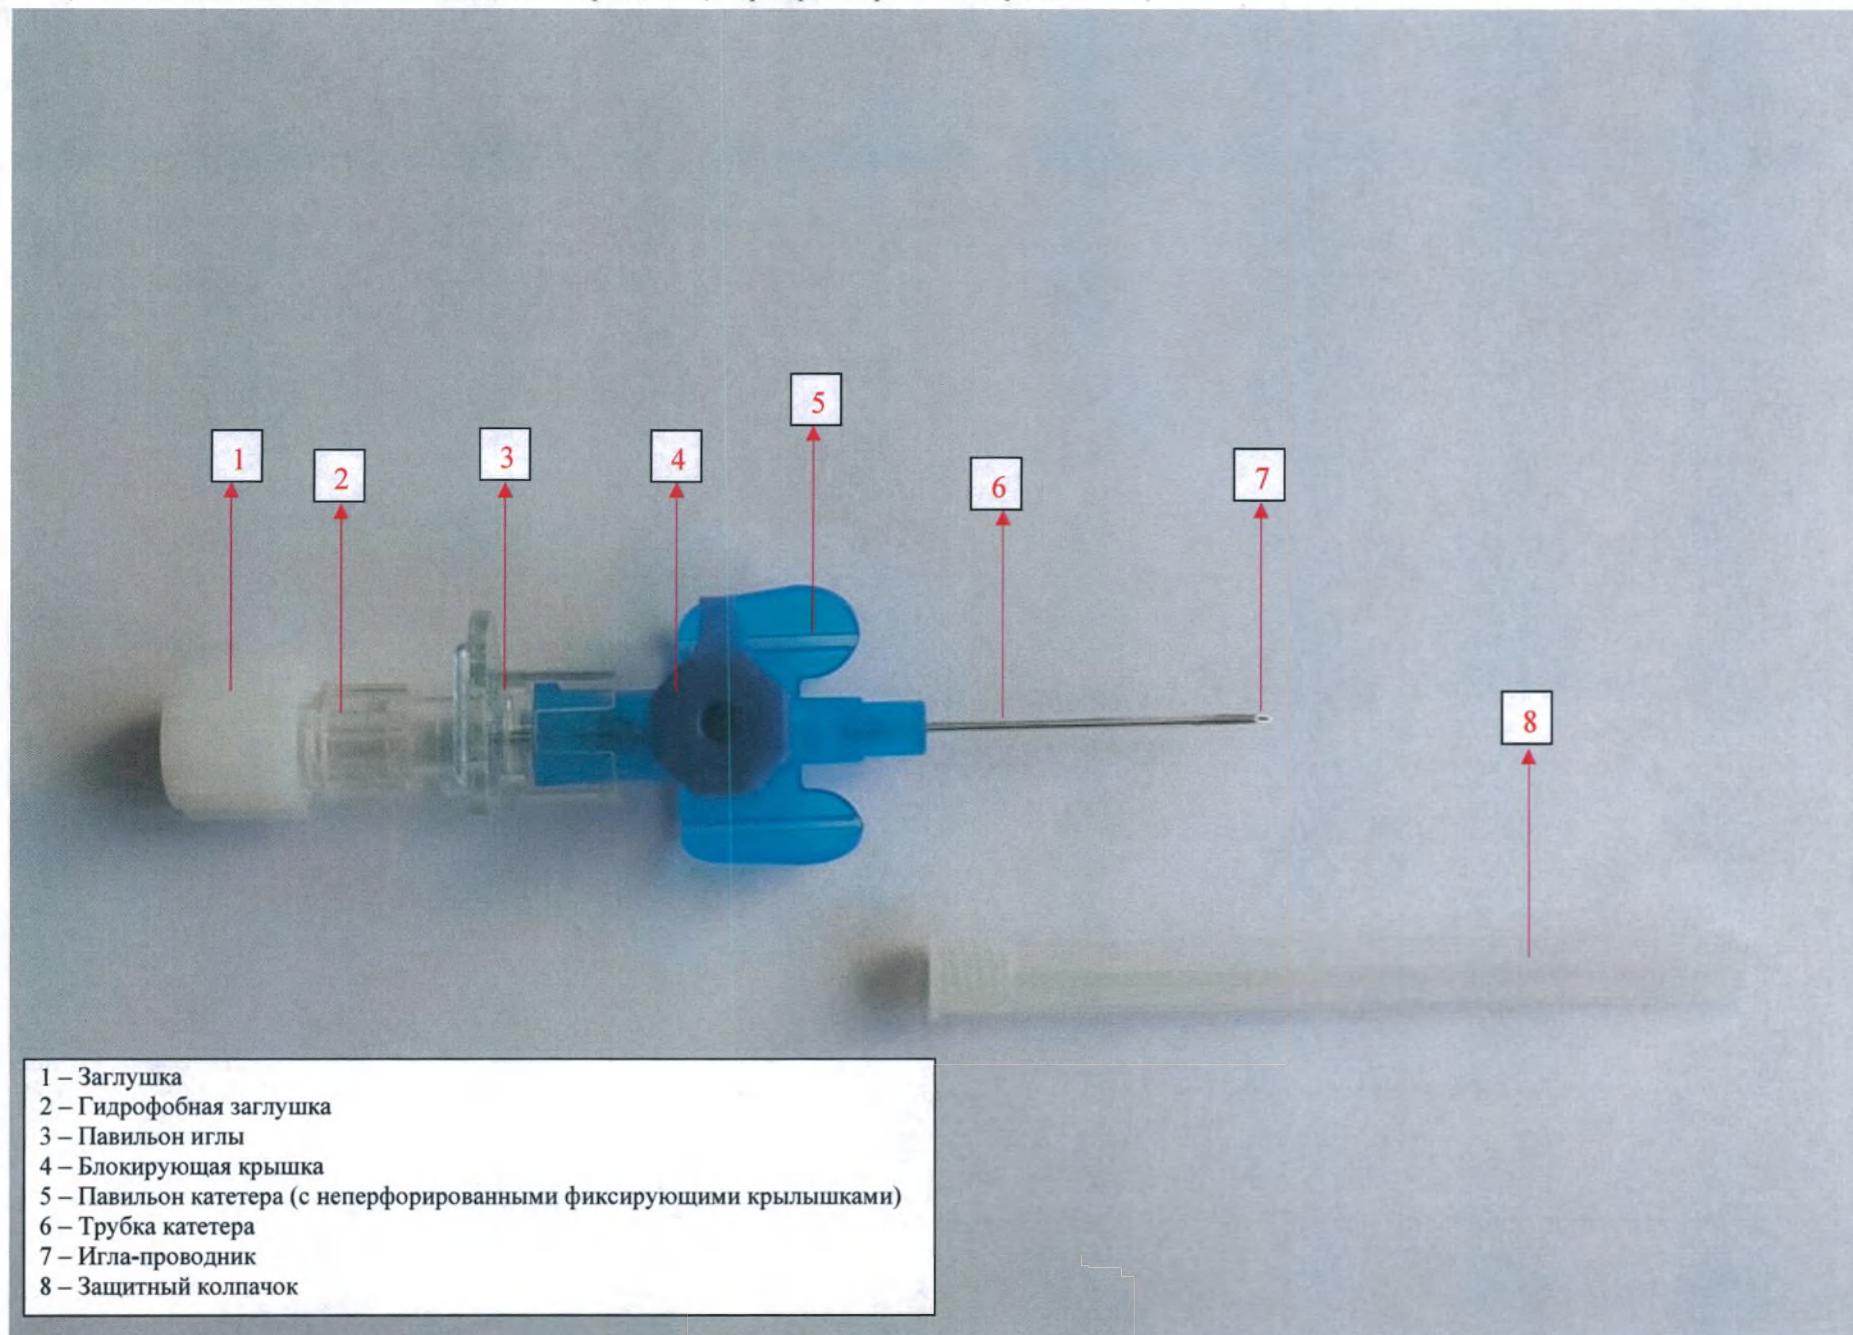

4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269098S-20)

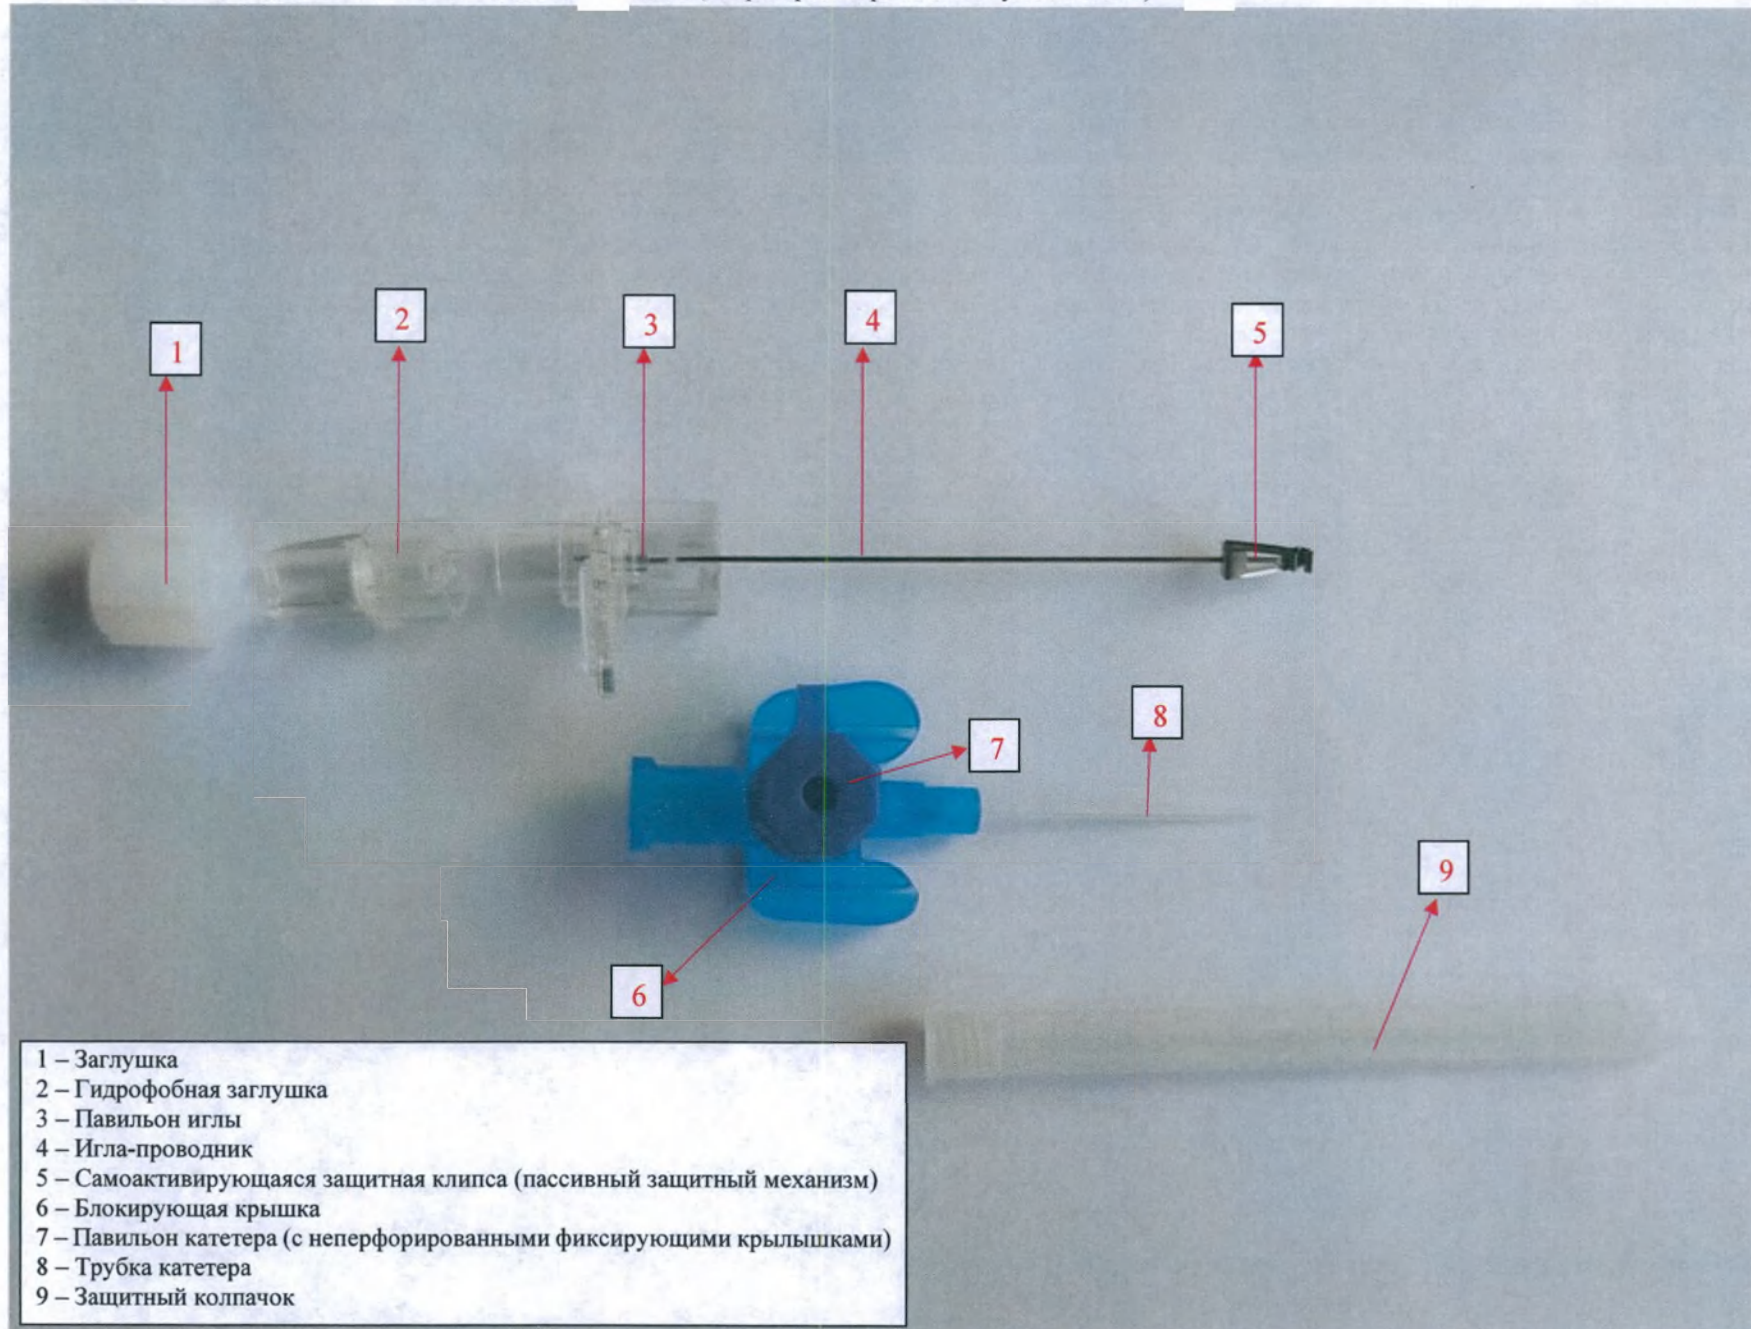


5. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269071S-01)

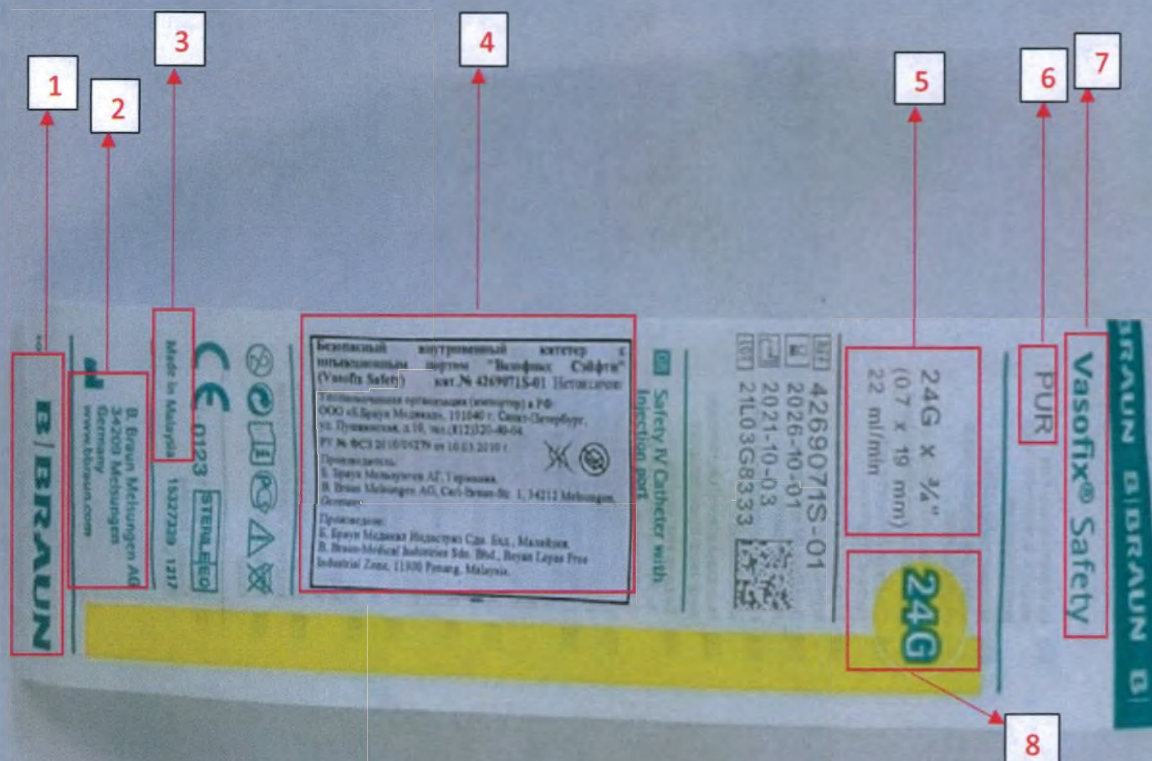

1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере номера поorg 4269071S-01)

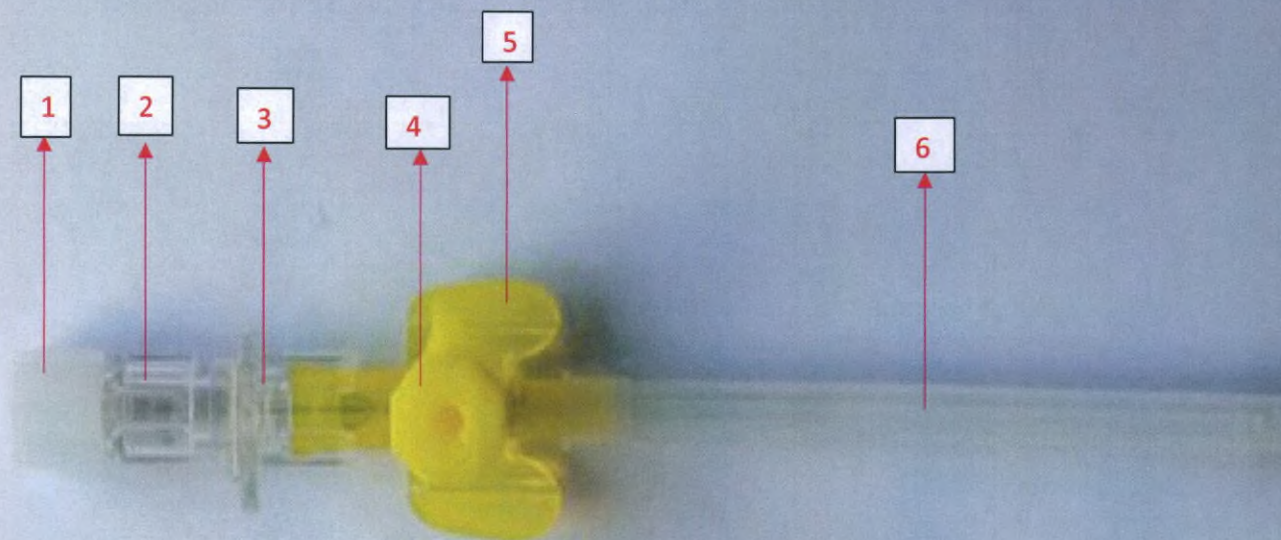


- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Блокирующая крышка
- 5 – Павильон катетера с неперфорированными фиксирующими крылышками
- 6 – Защитный колпачок


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269071S-01)

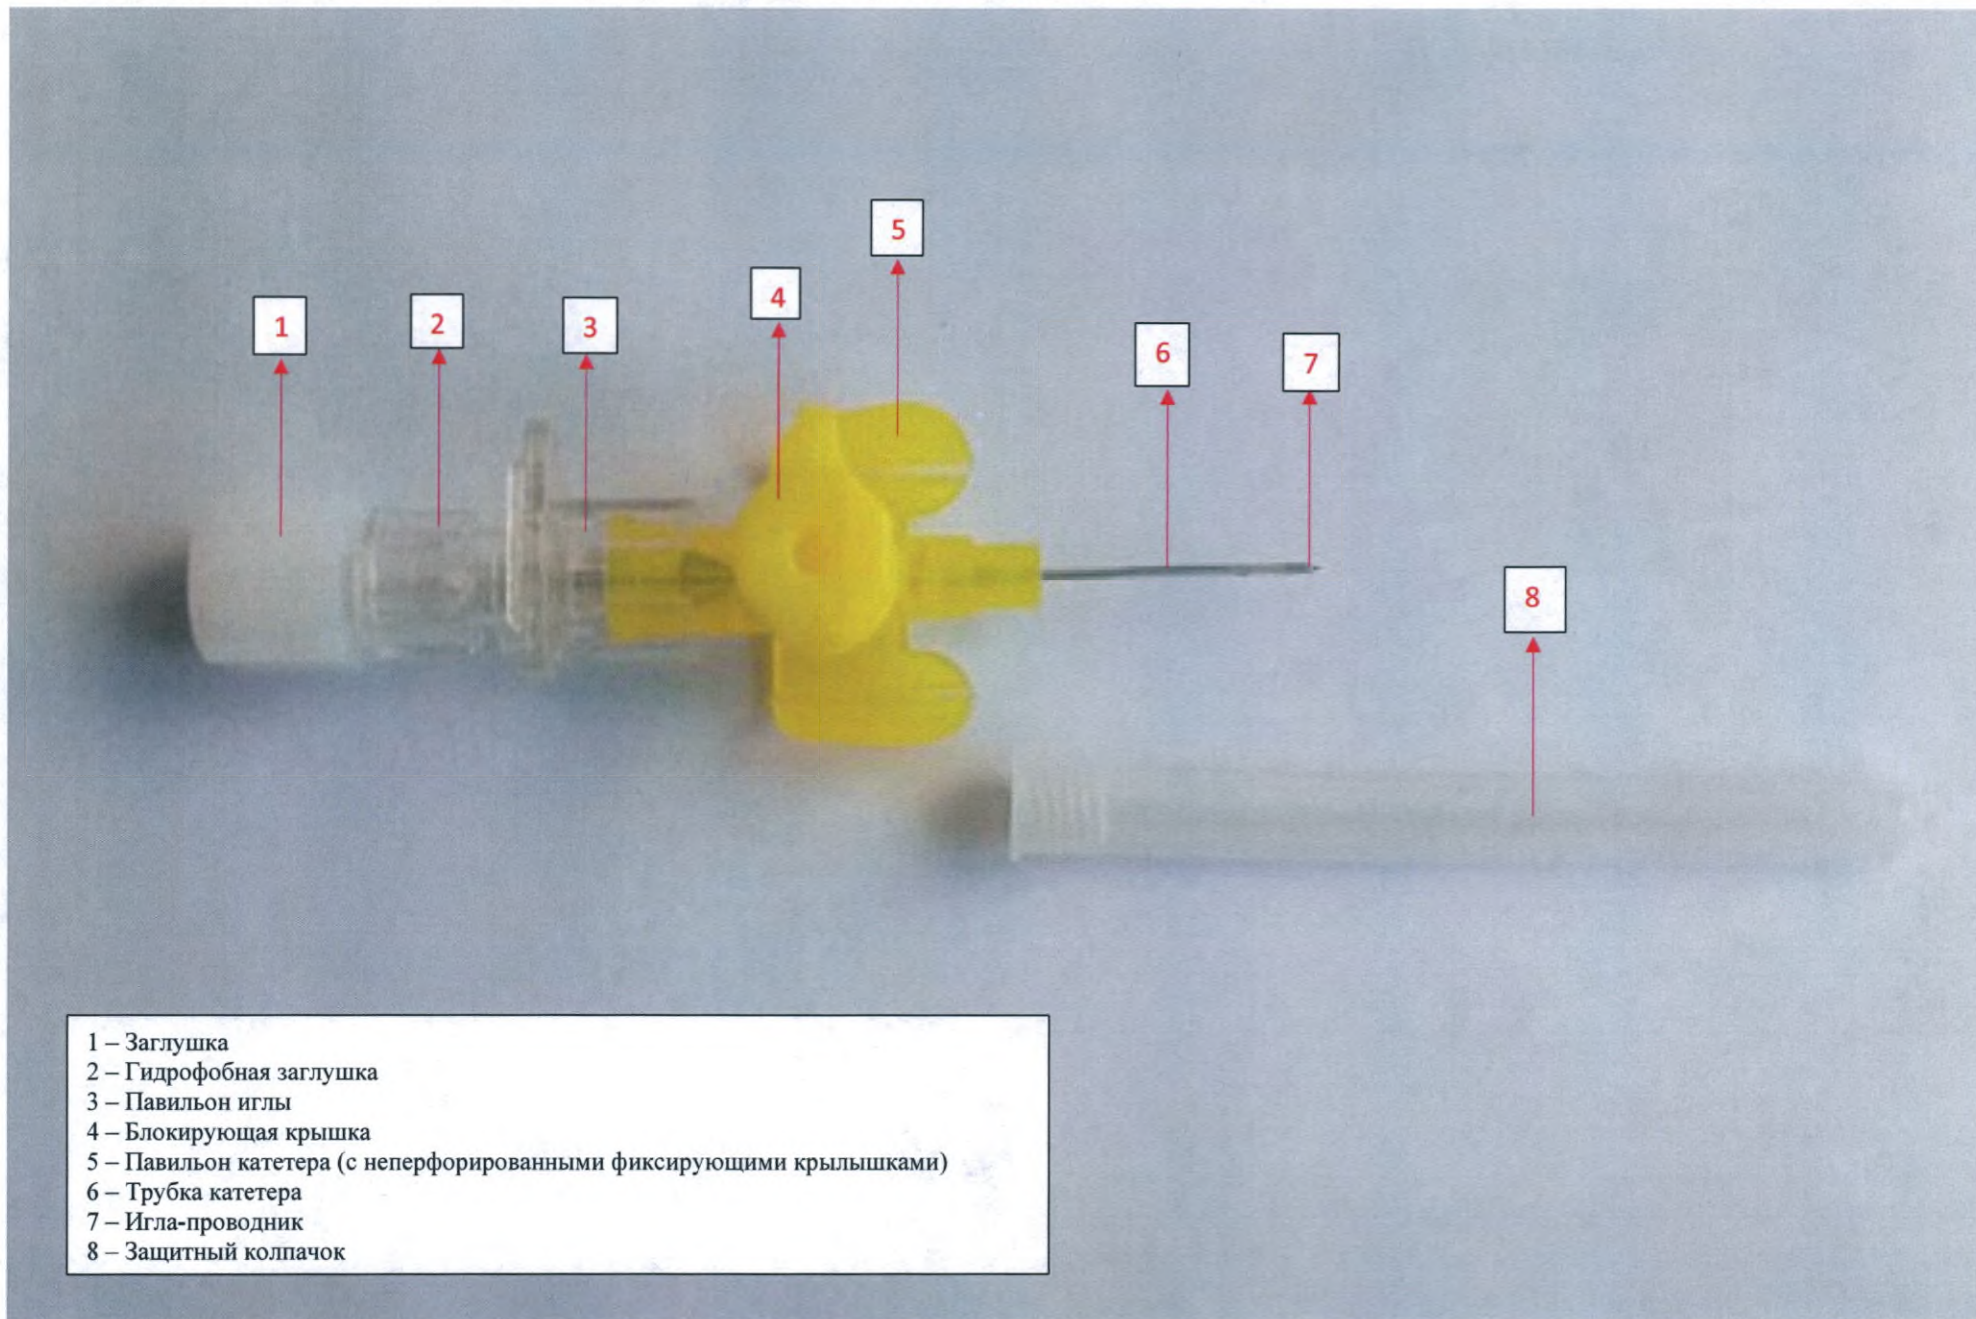

4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269071S-01)

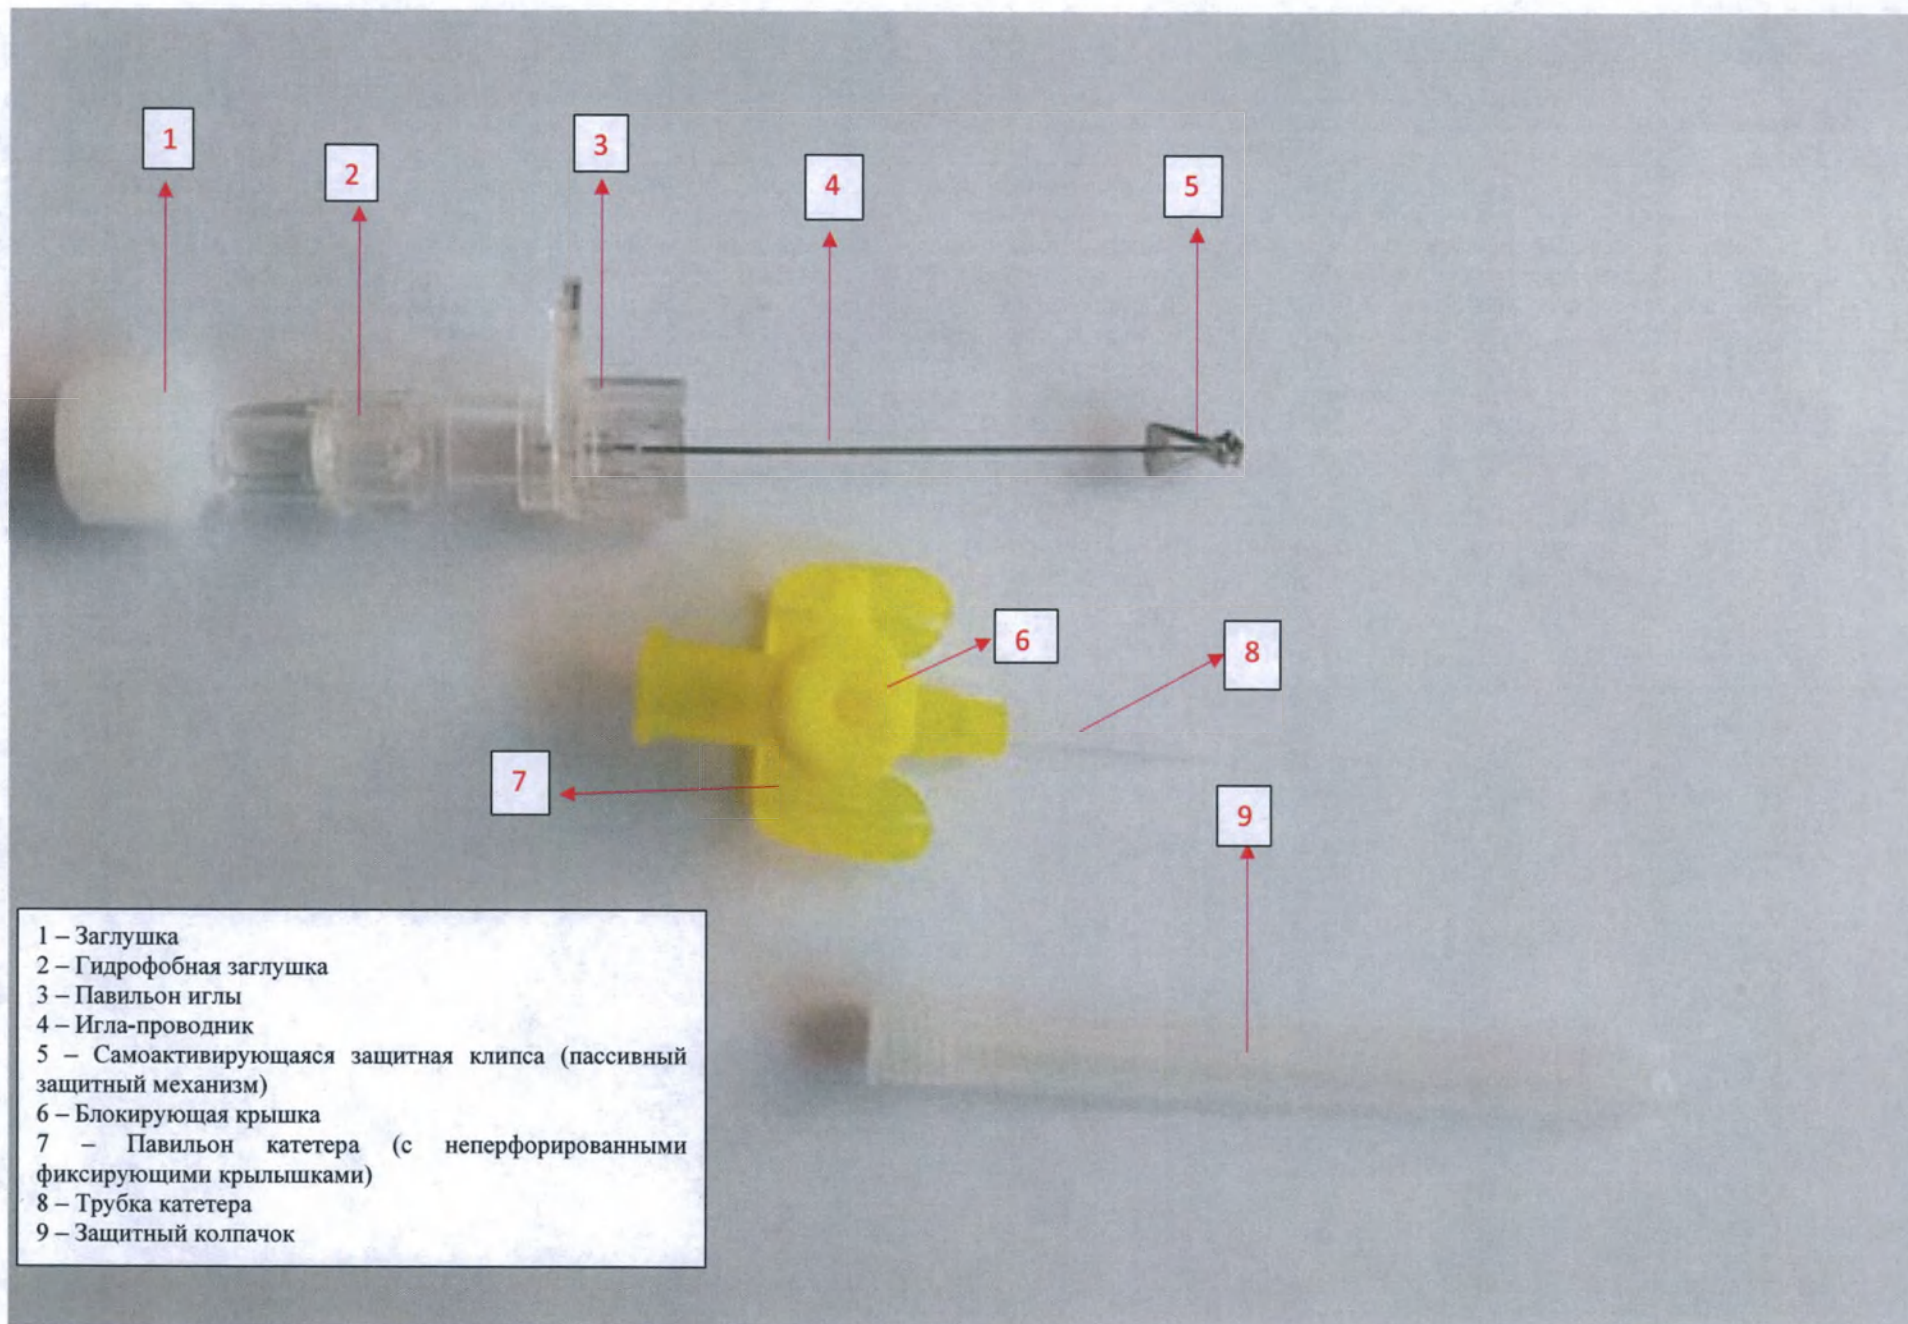


6. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269110S-01)

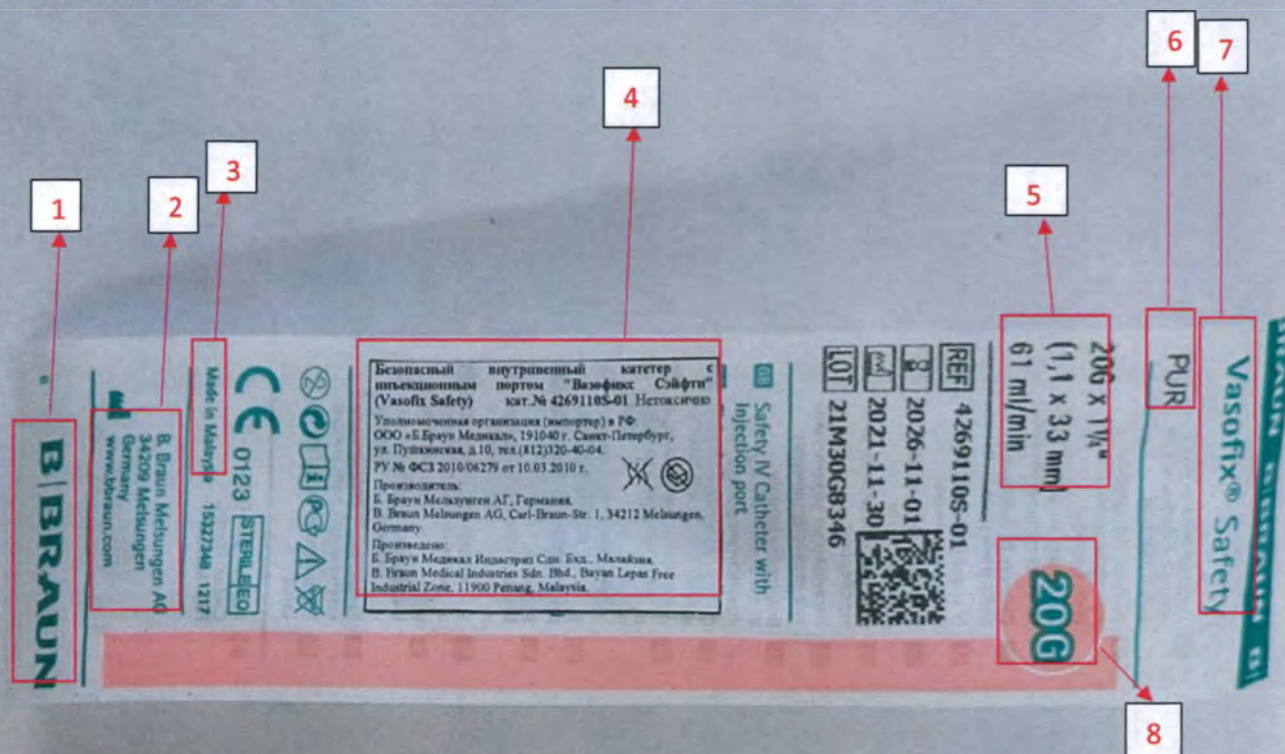


1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с белыми полосами с вписанным в него калибровочным размером катетера

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).


2) Общий вид медицинского изделия (на примере ном... о каталогу 4269110S-01)

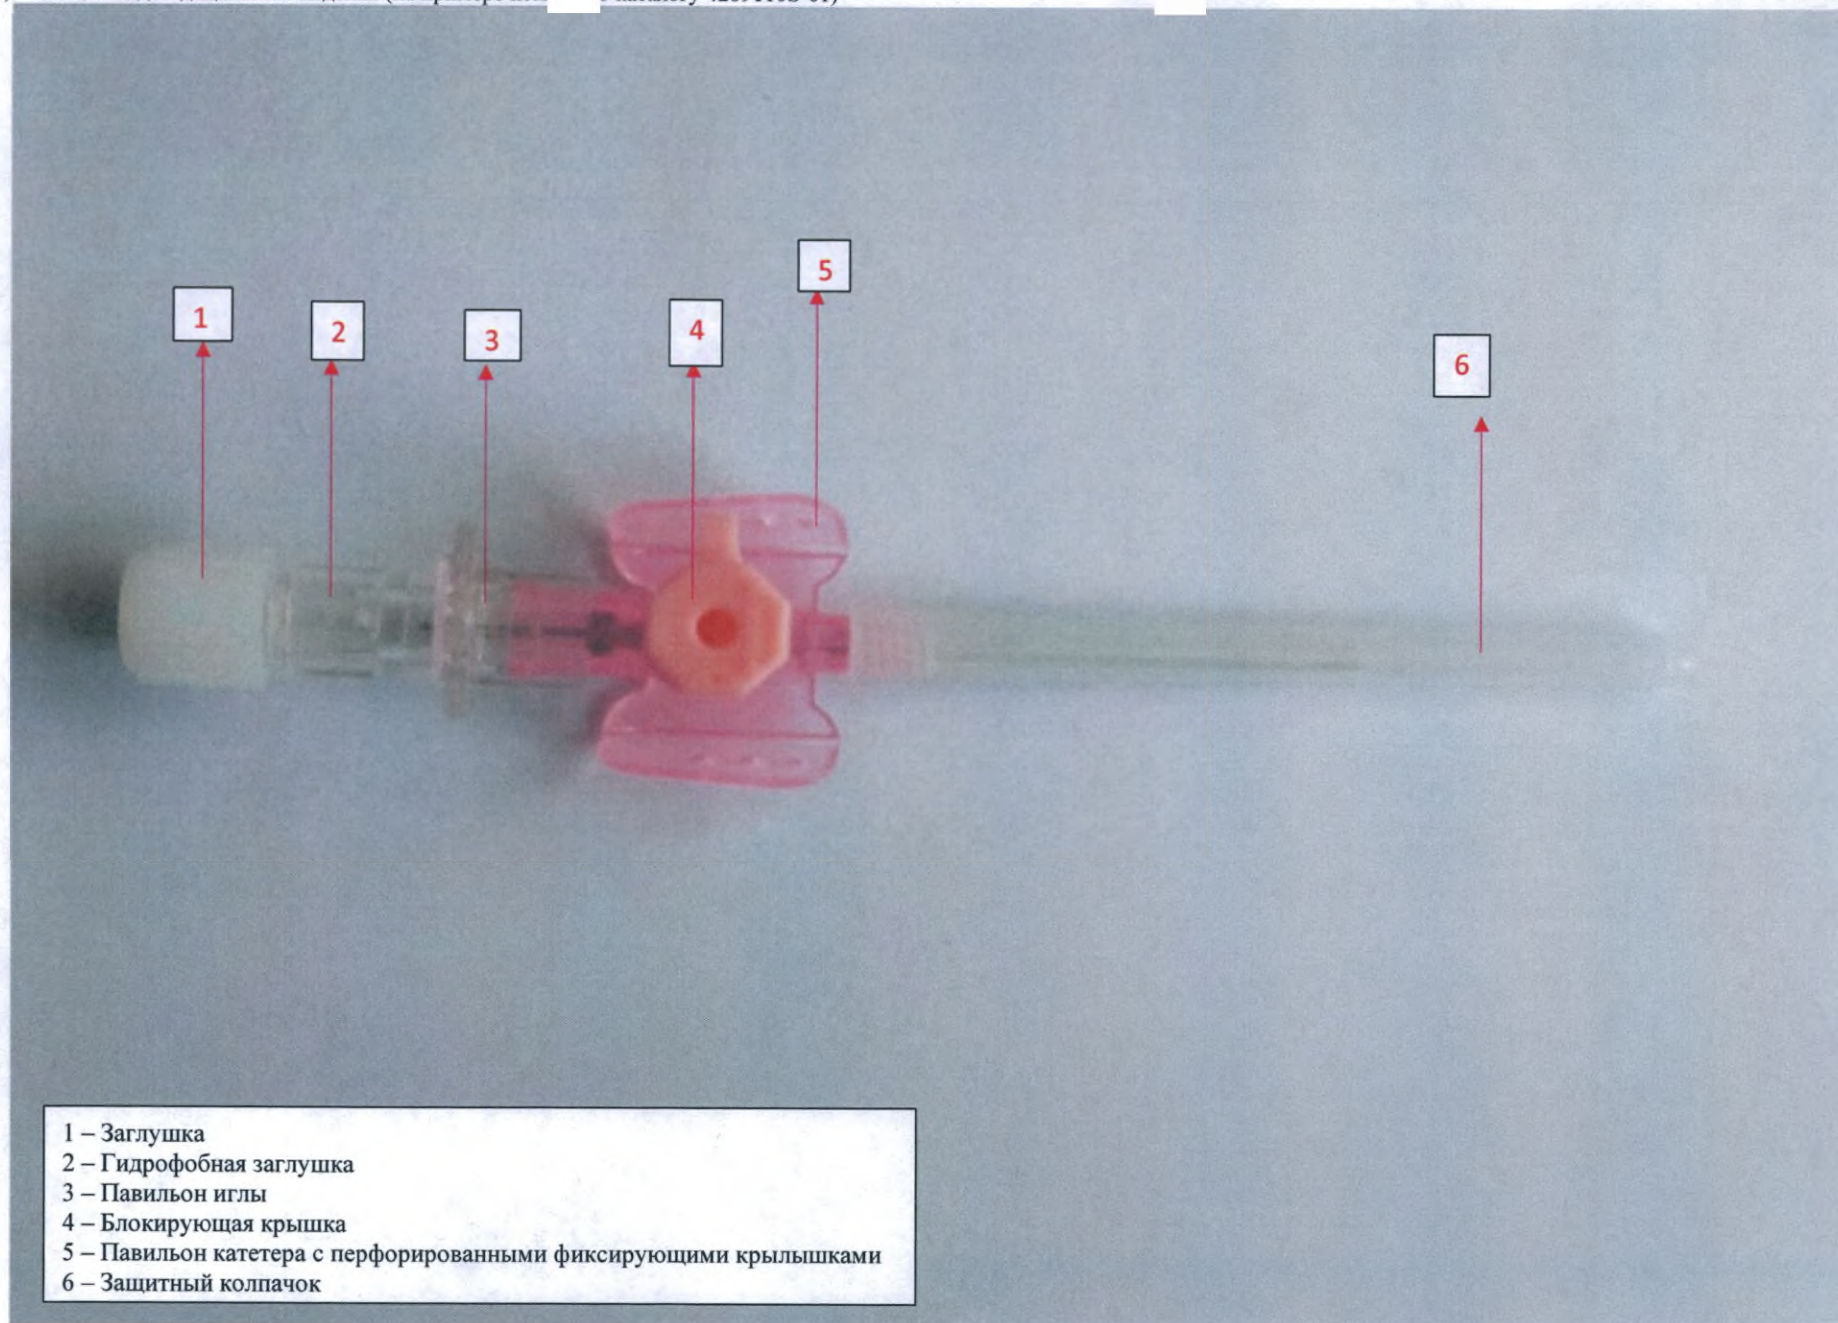


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269110S-01)

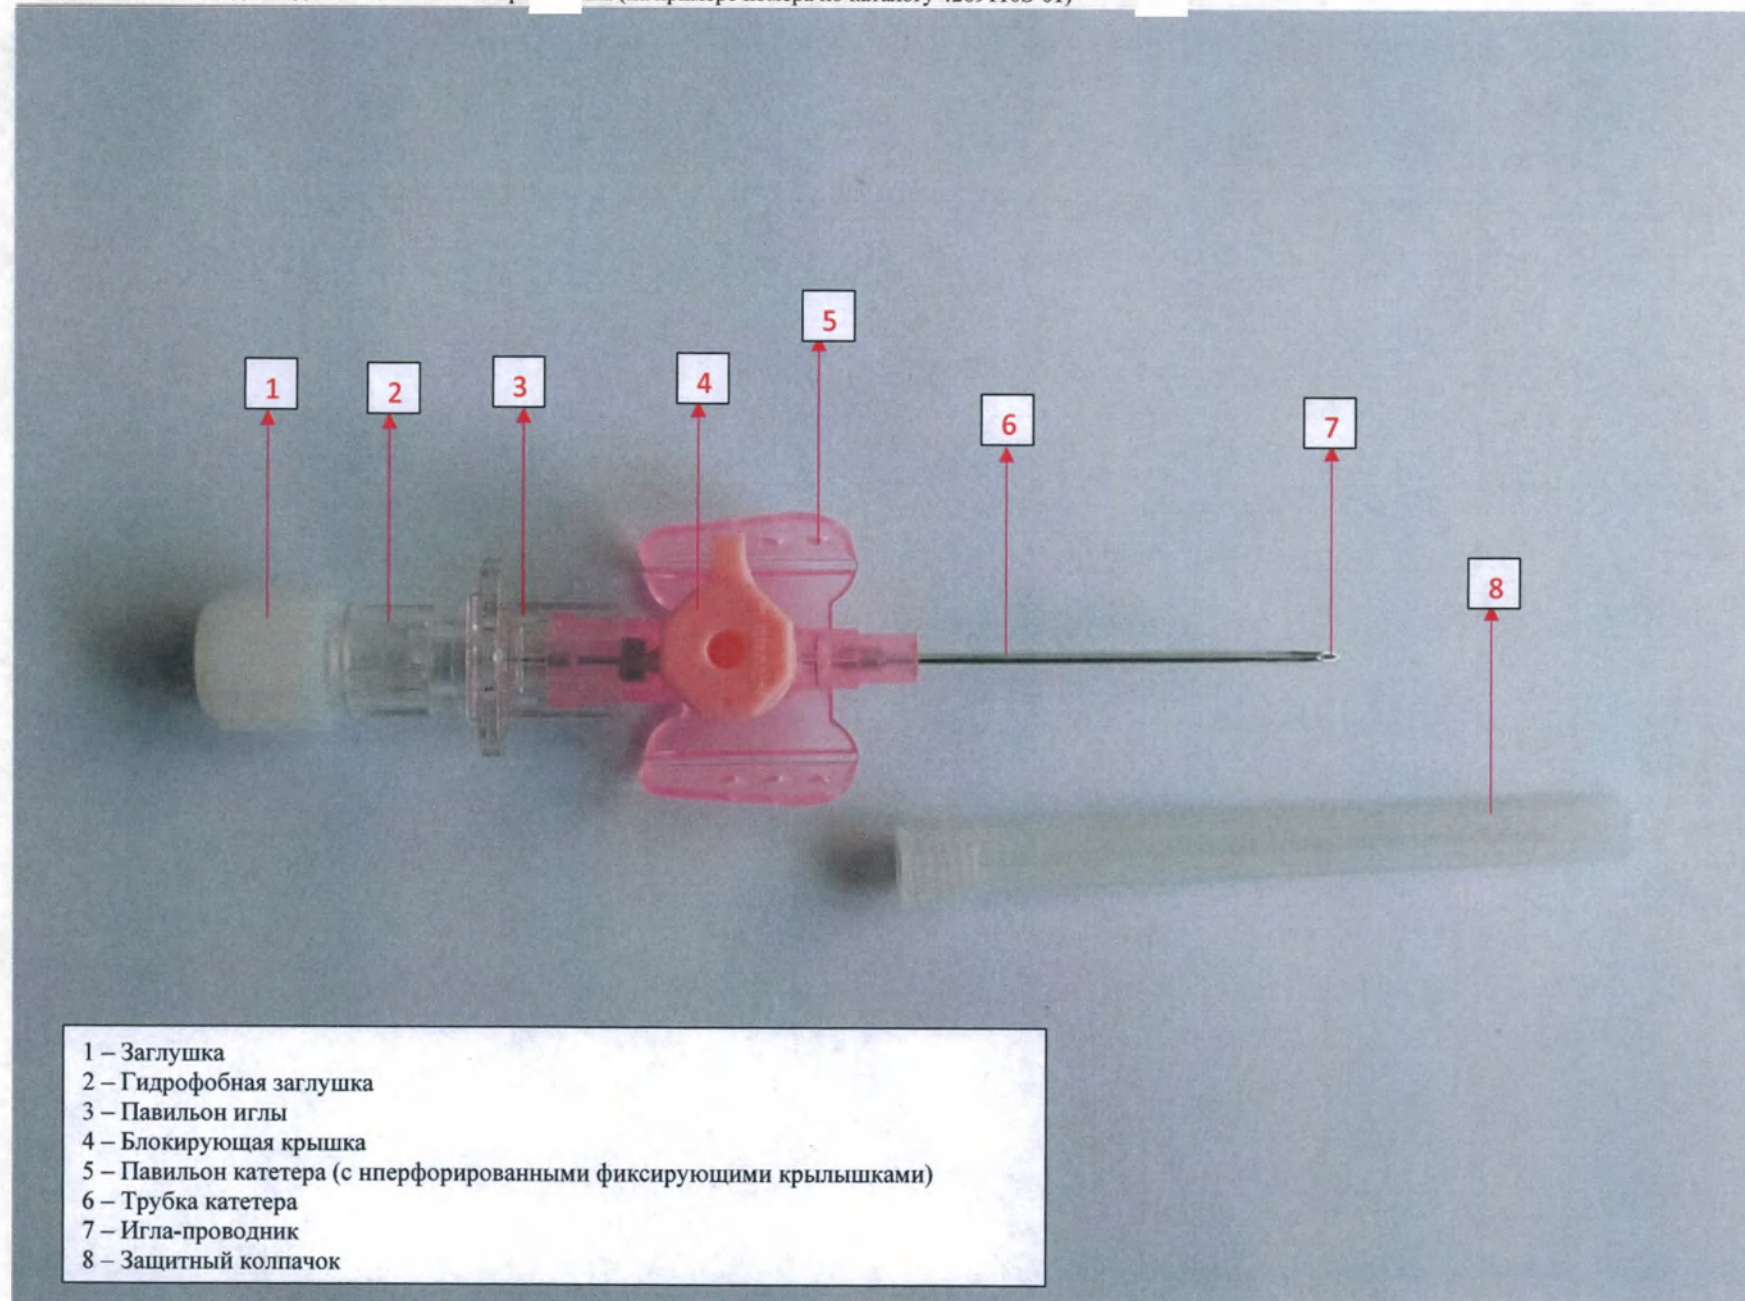


4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-1 дника (на примере номера по каталогу 4269110S-01)

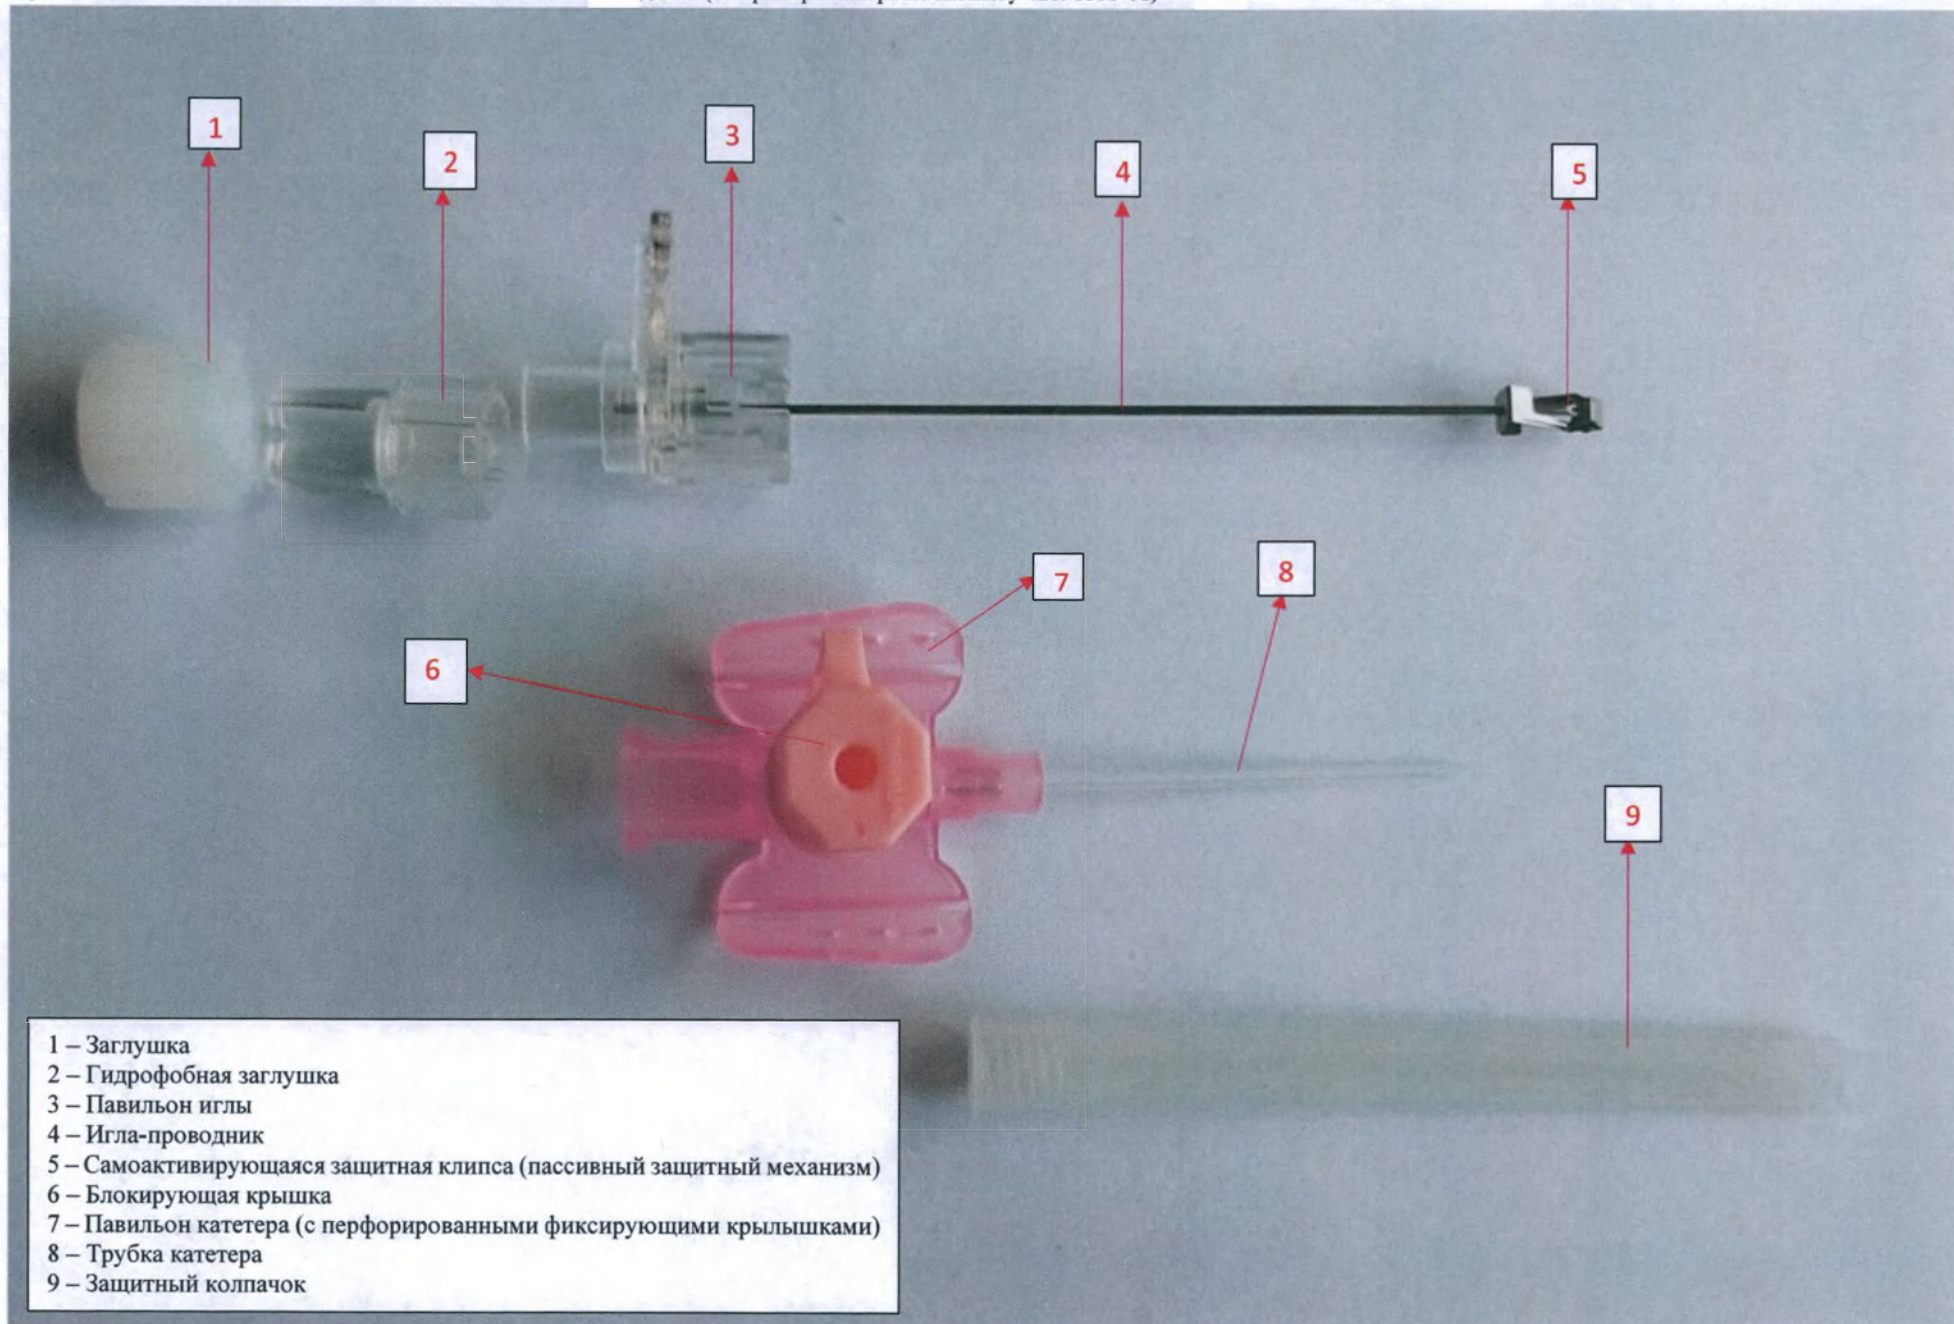


7. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйф /asofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269152S-20)

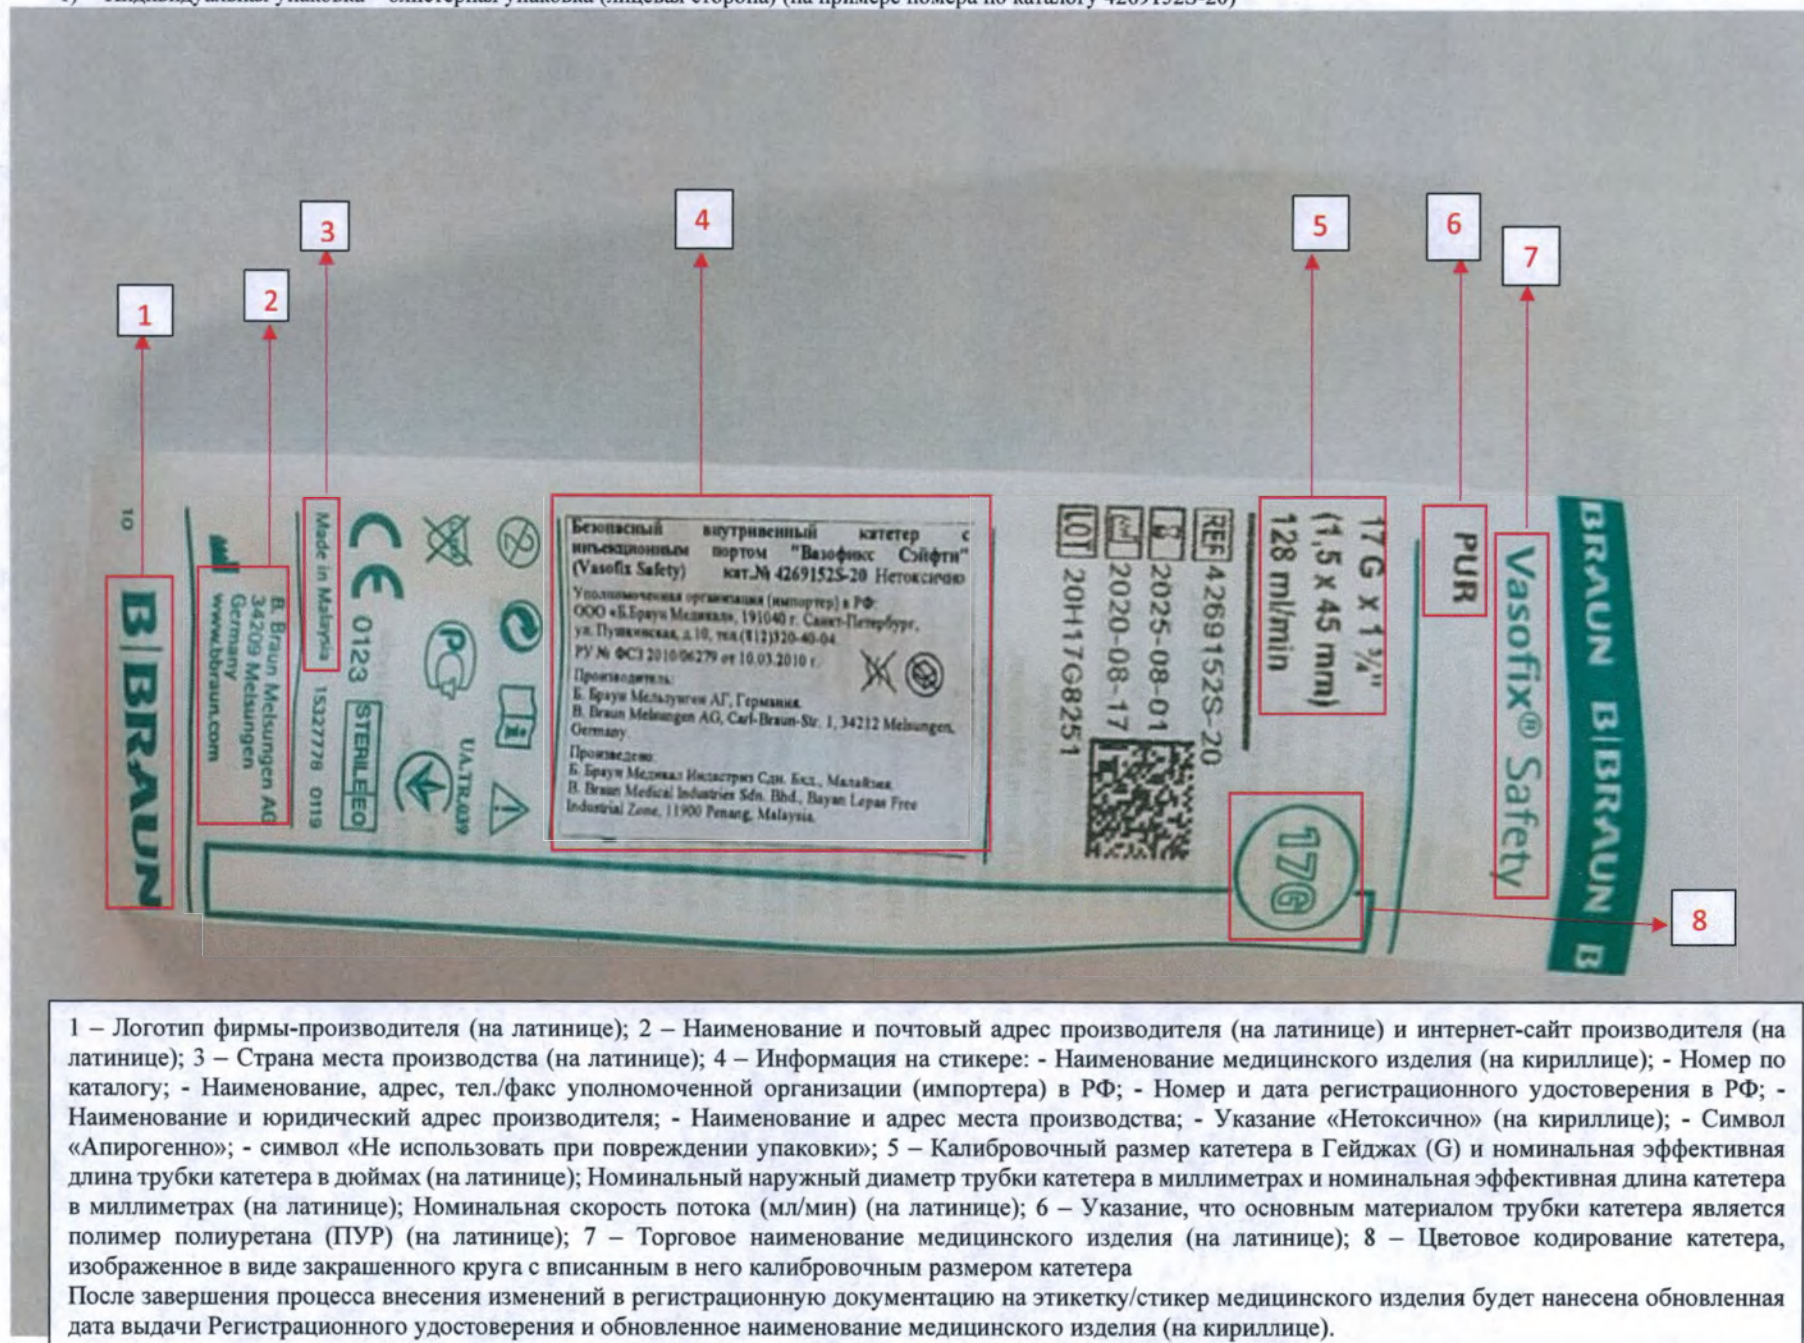


2) Общий вид медицинского изделия (на примере ...ра по каталогу 4269152S-20)

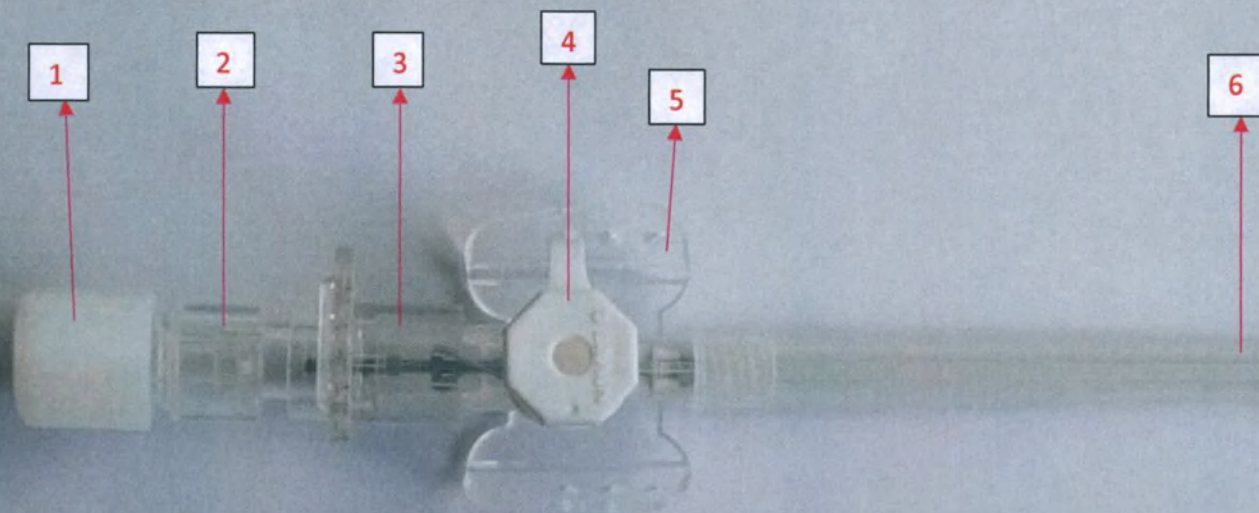

- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Блокирующая крышка
- 5 – Павильон катетера с перфорированными фиксирующими крылышками
- 6 – Защитный колпачок

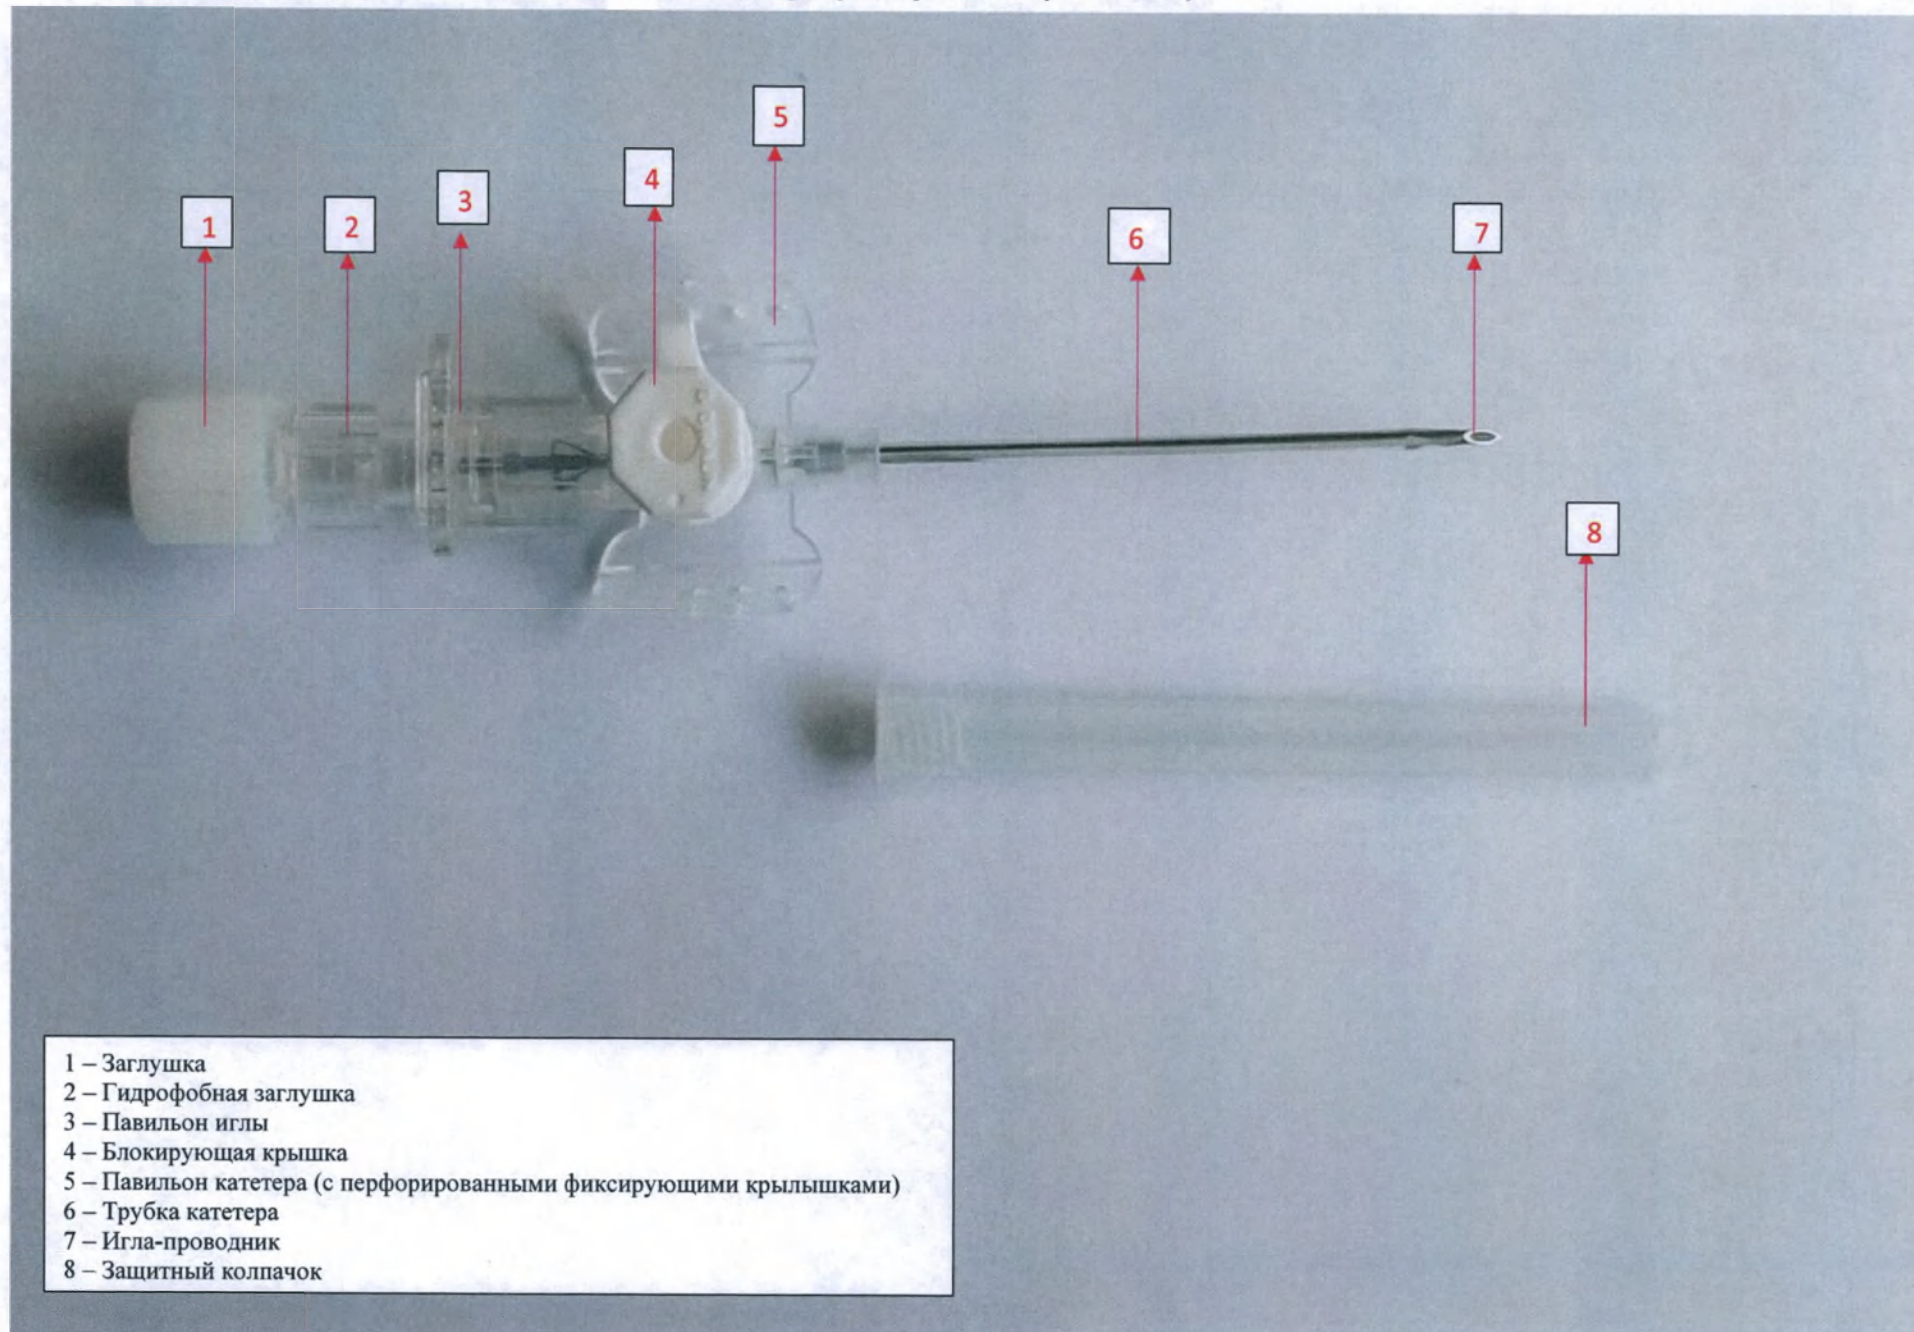



4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269152S-20)

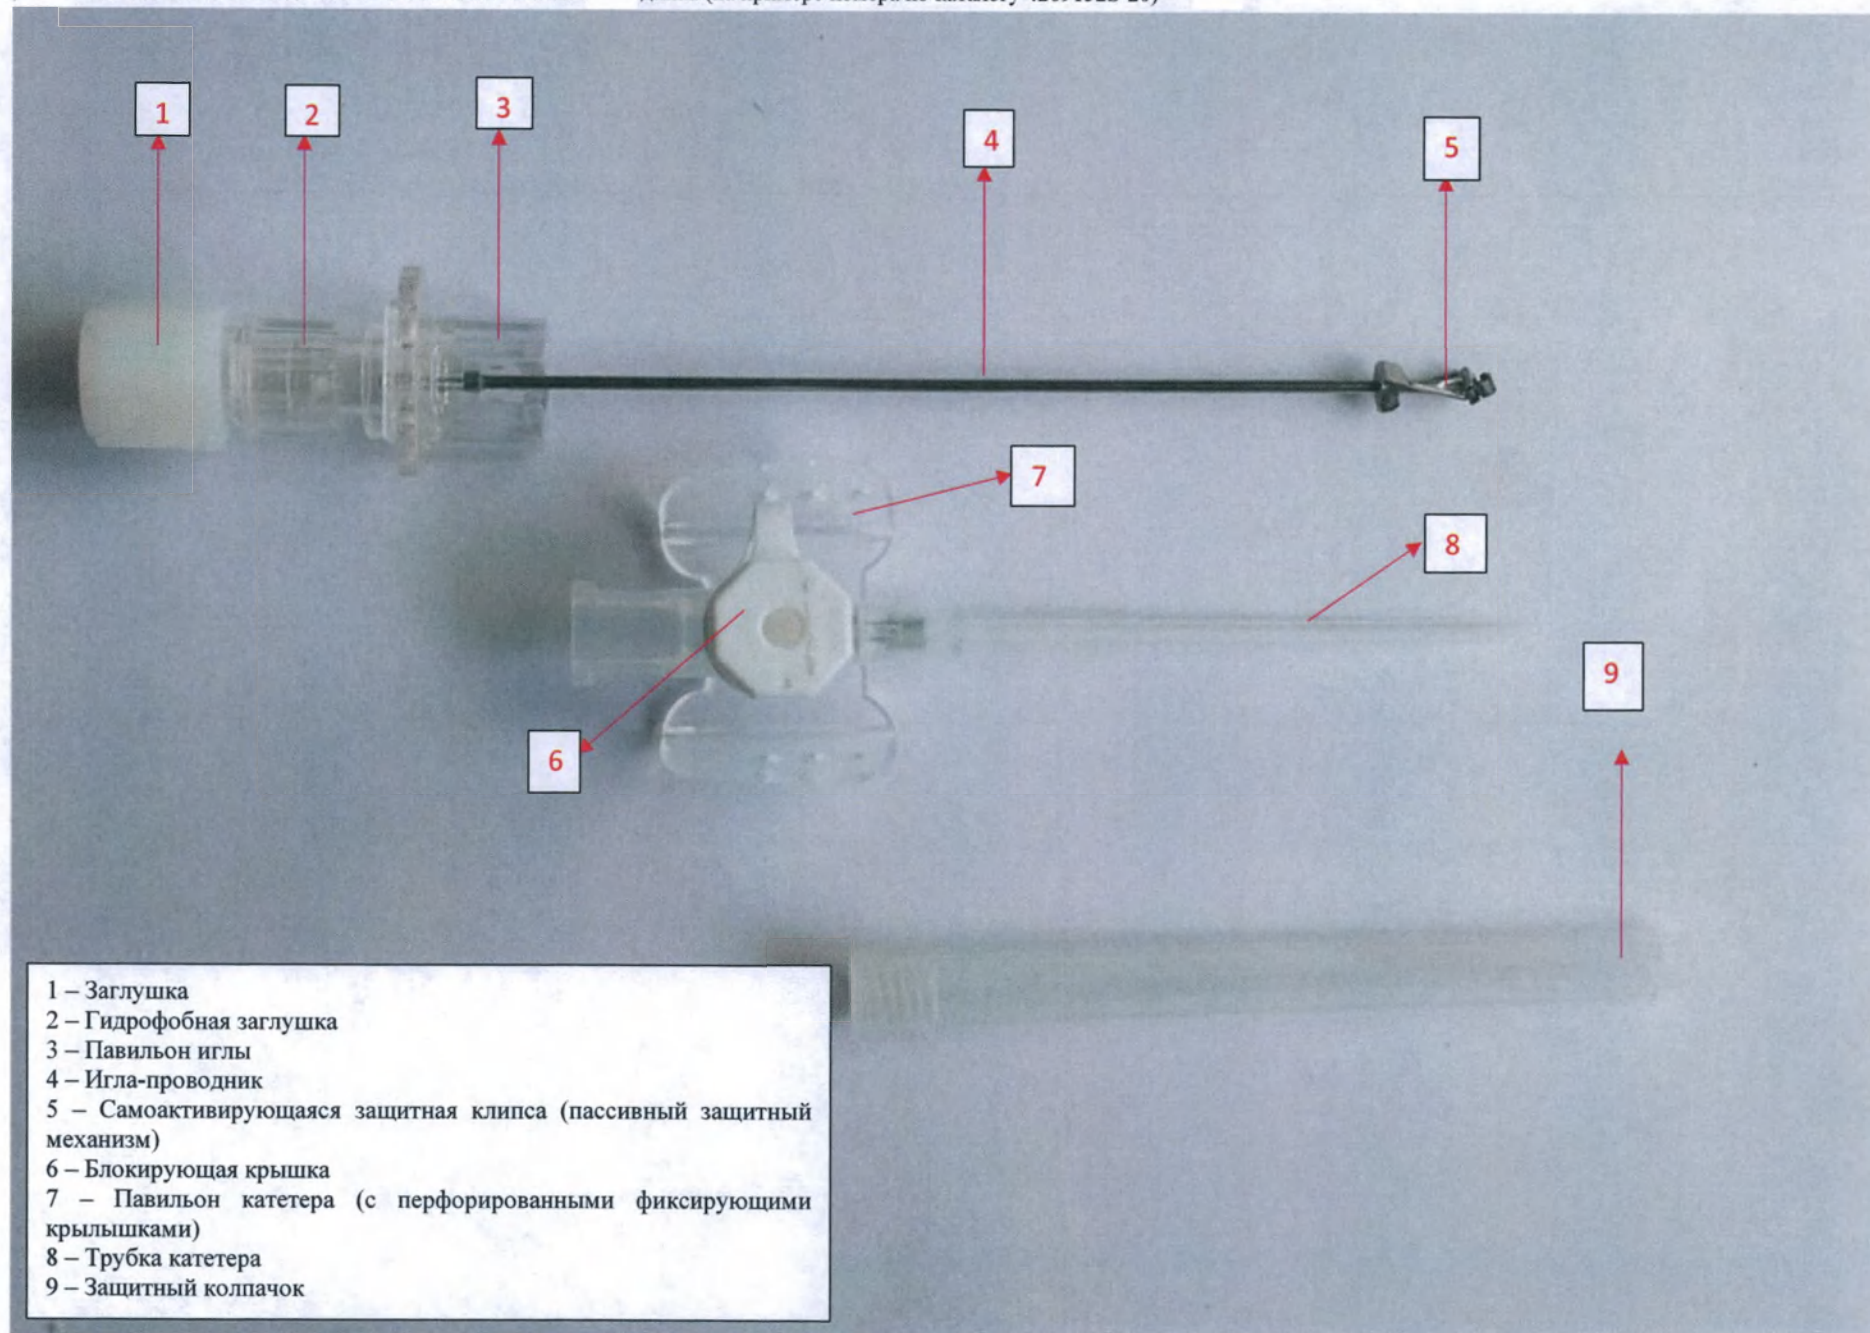

8. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом


1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)

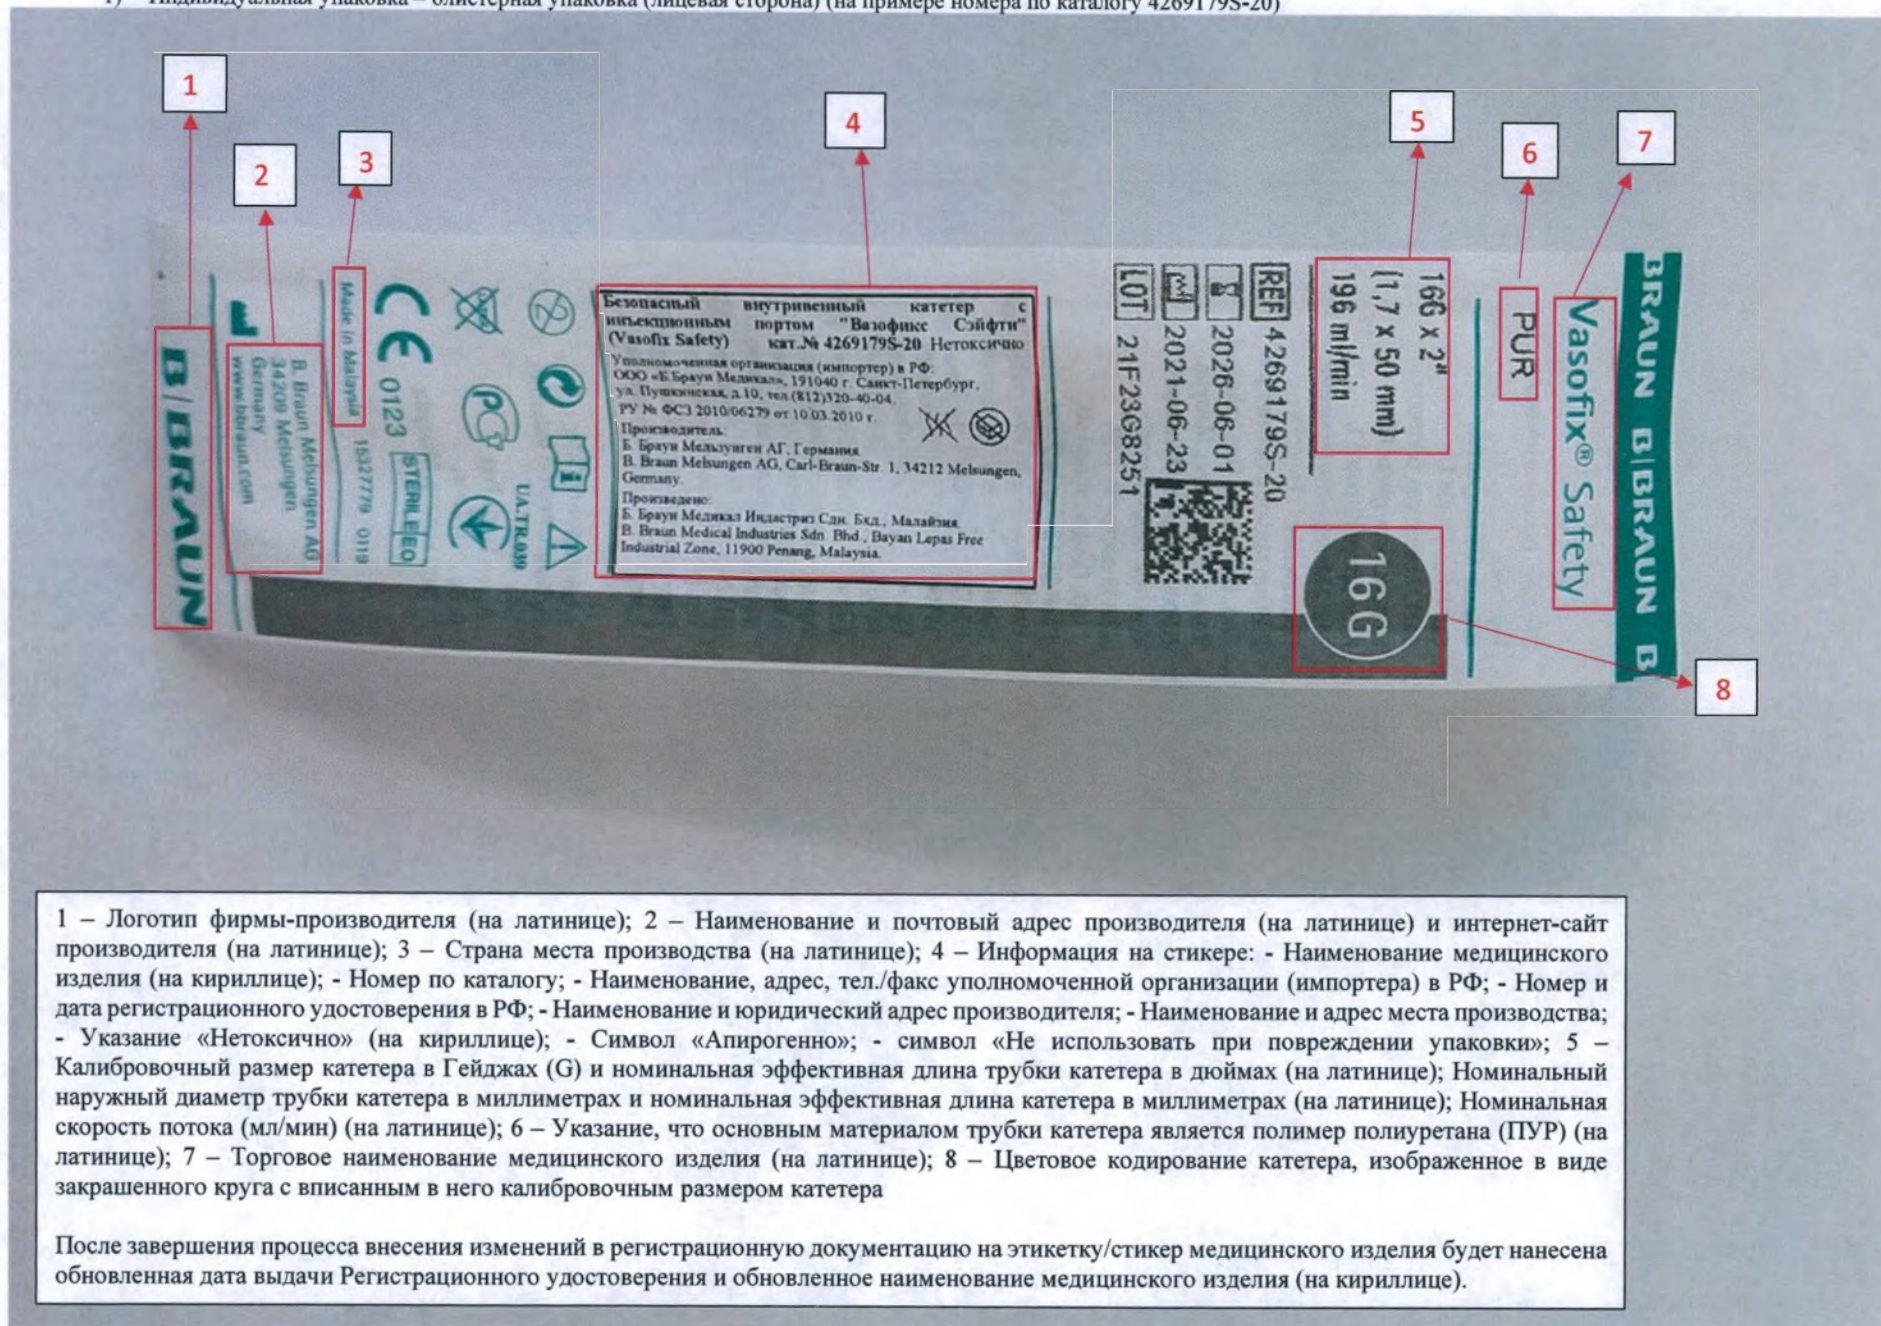

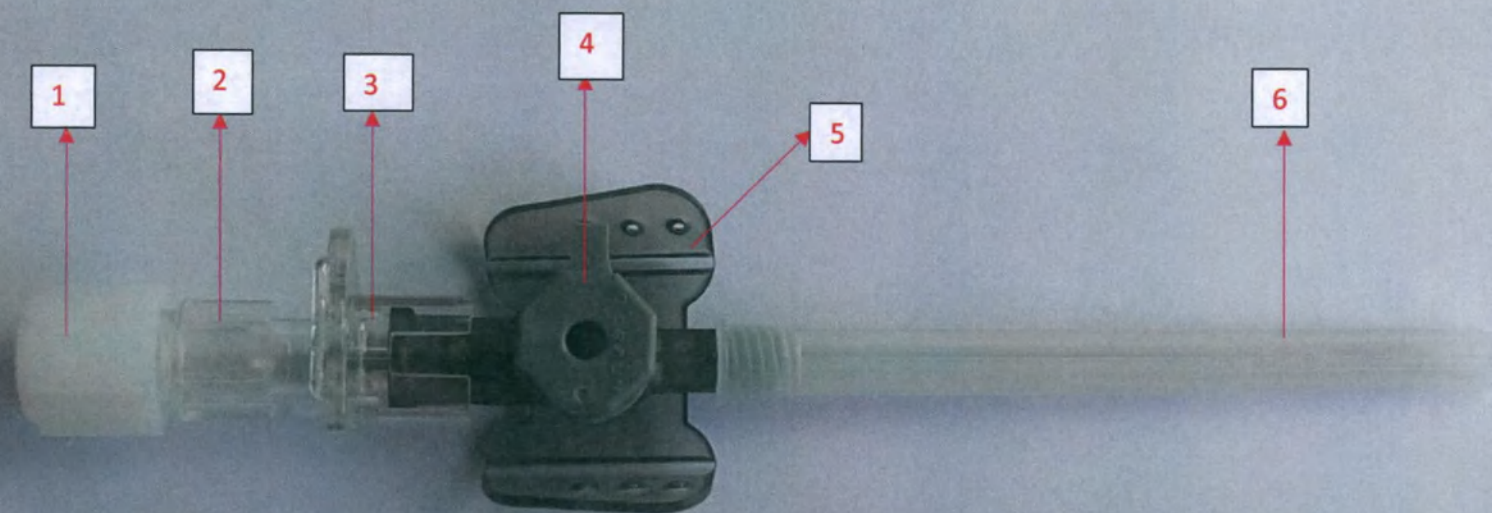


- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Блокирующая крышка
- 5 – Павильон катетера с перфорированными фиксирующими крылышками
- 6 – Защитный колпачок


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы проводника (на примере номера по каталогу 4269179S-20)

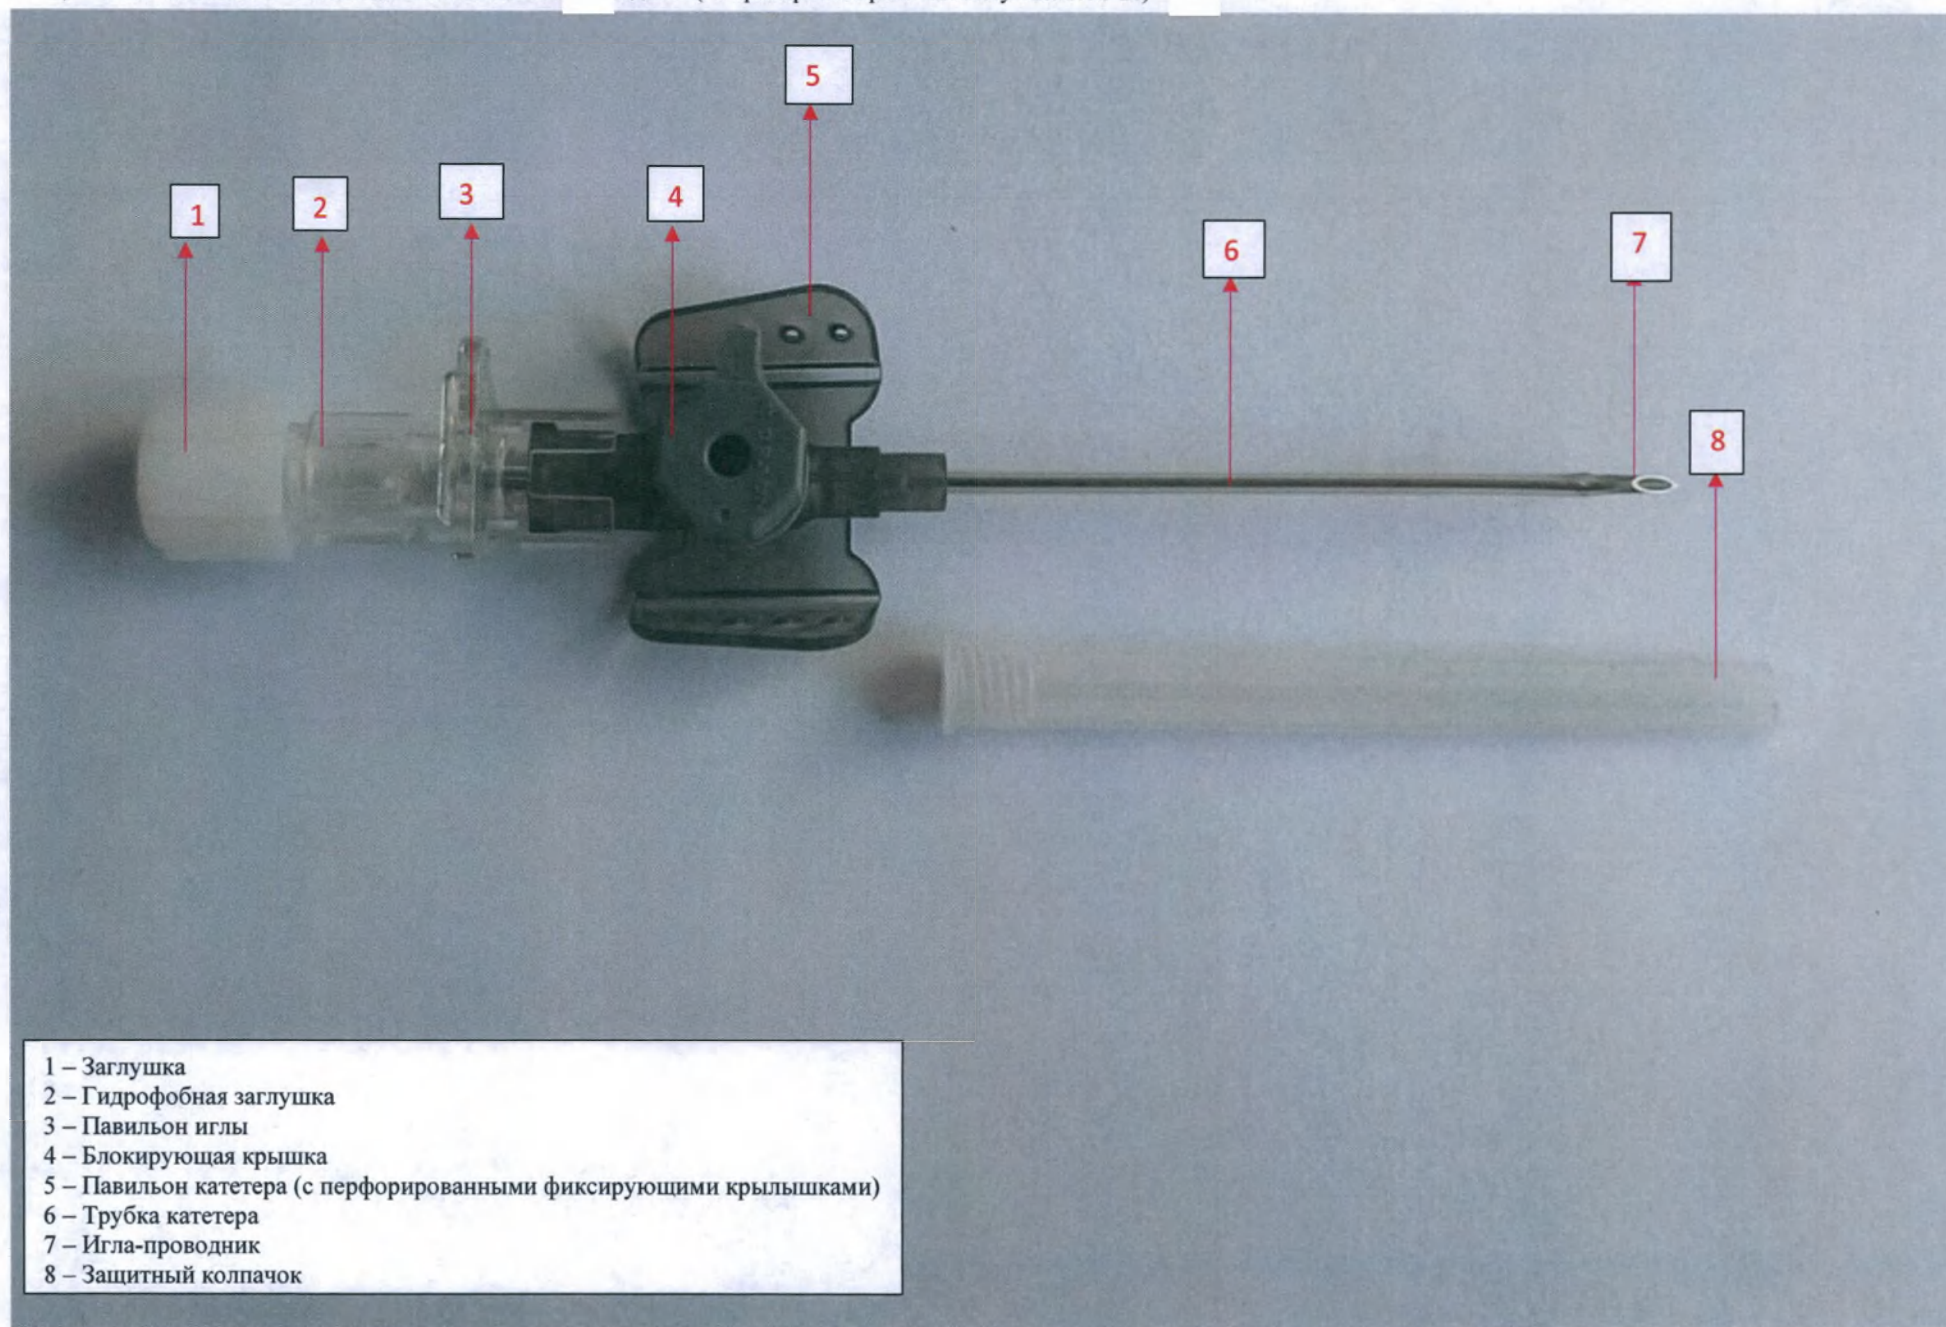

4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269179S-20)

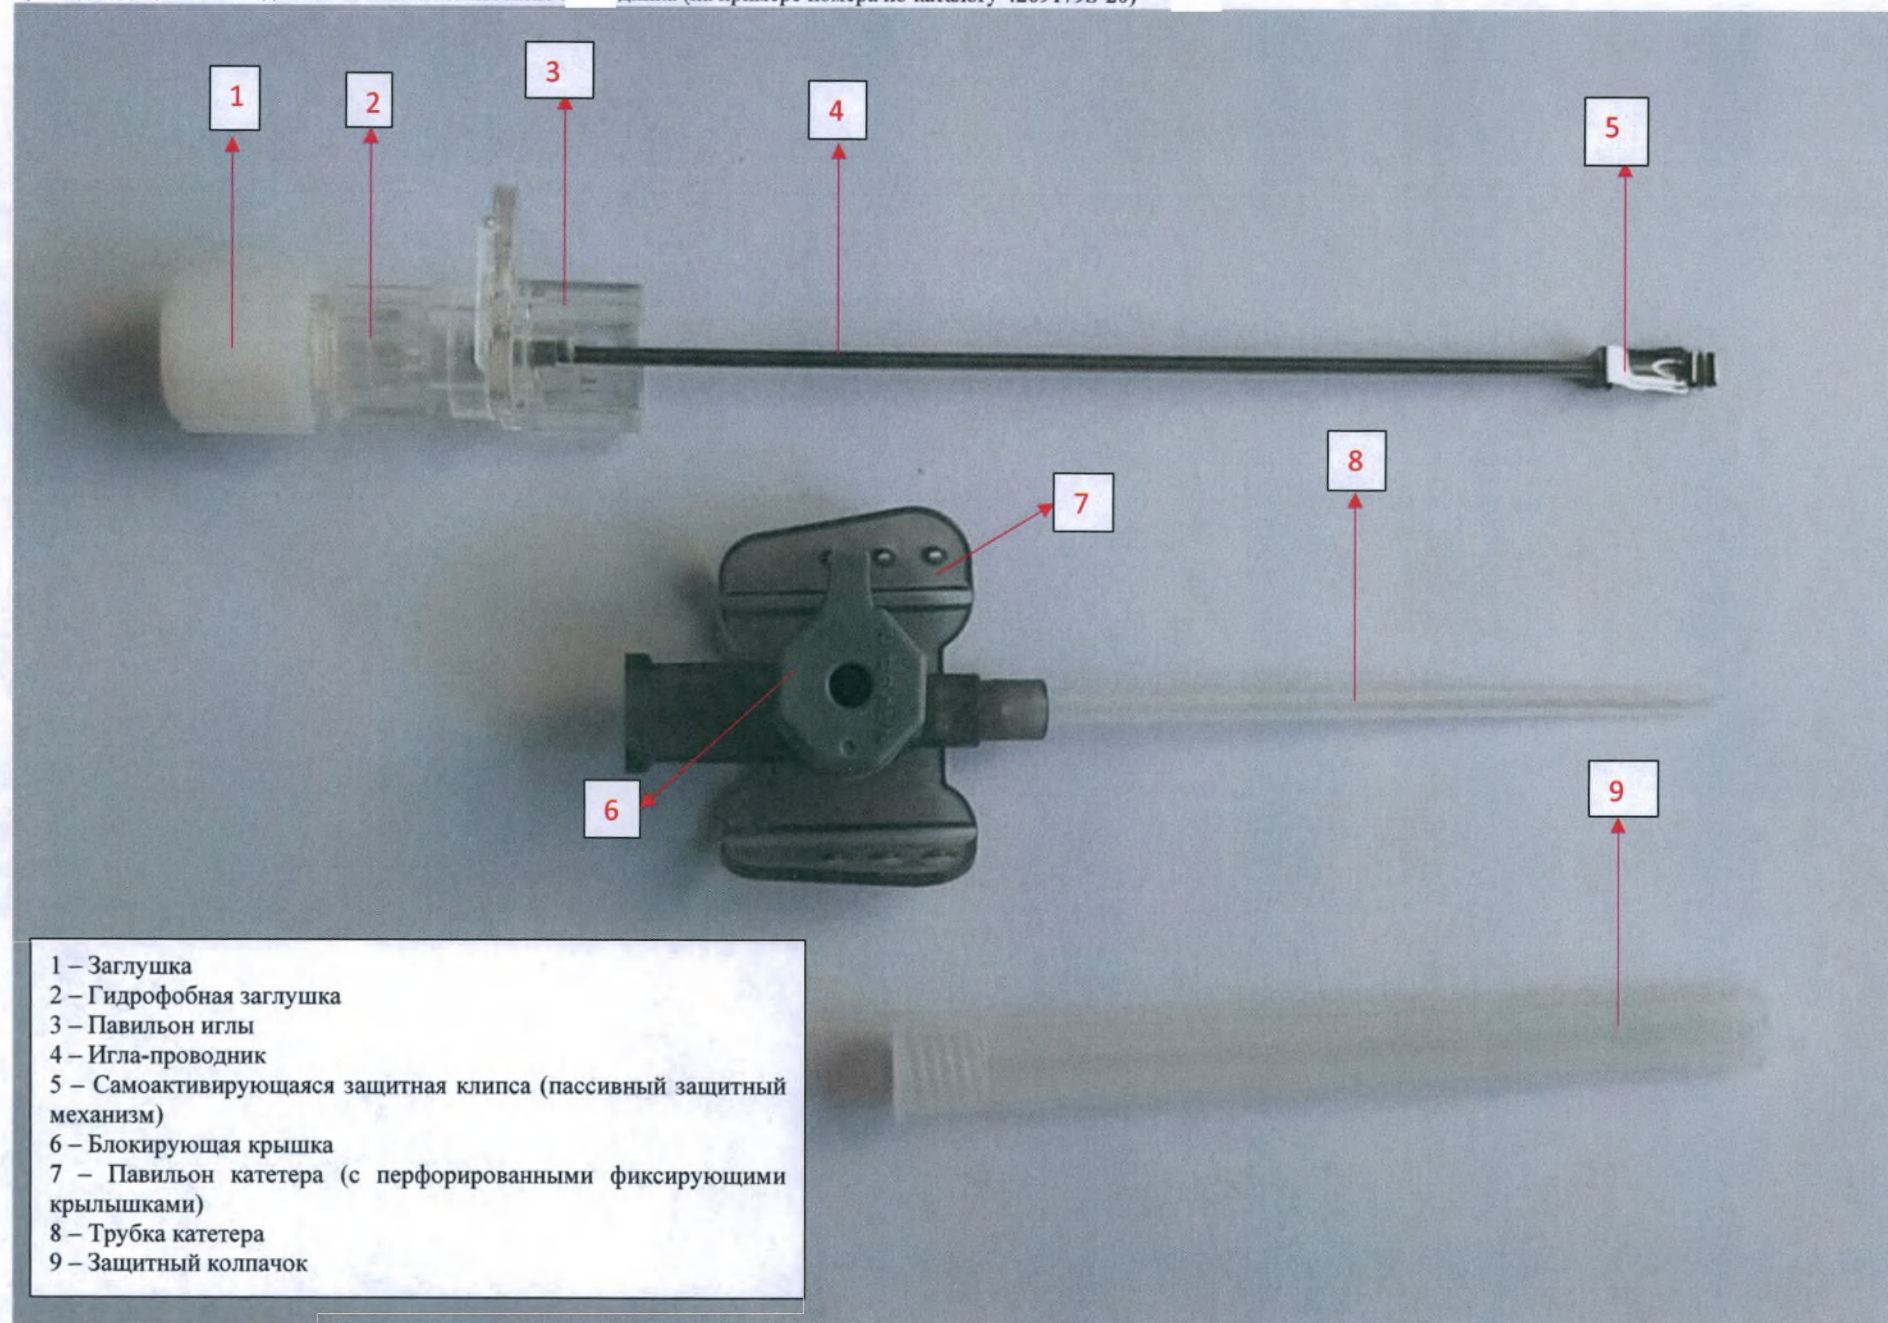


9. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйф /asofix® Safety) с инъекционным портом
- 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)

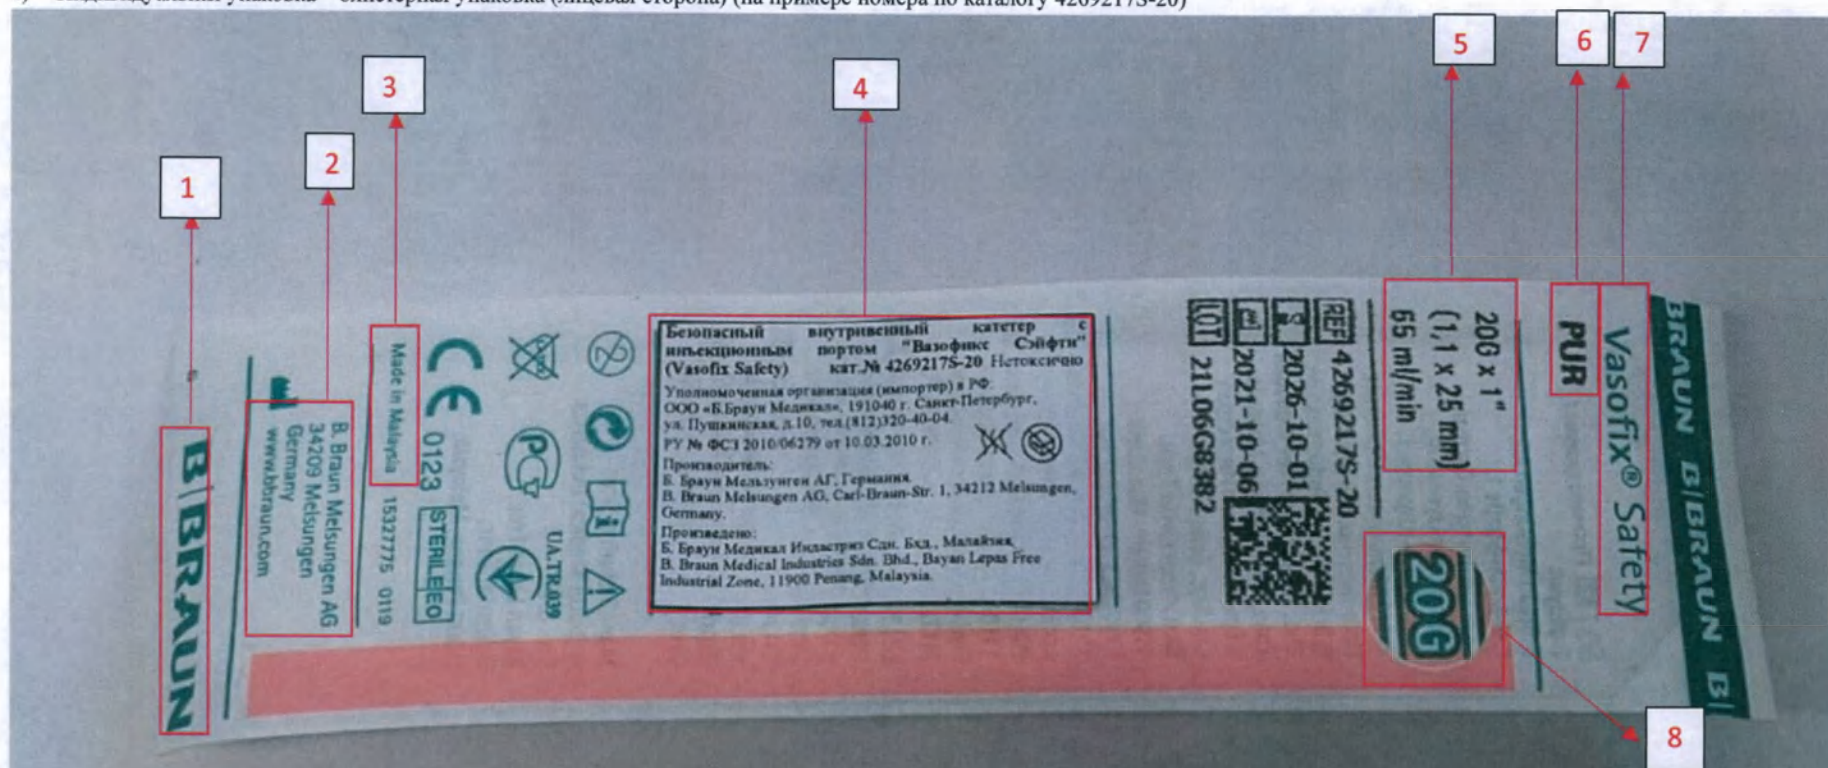


1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 2 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице) и интернет-сайт производителя (на латинице); 3 – Страна места производства (на латинице); 4 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; - Символ «Не использовать при повреждении упаковки»; 5 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); 6 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице); 7 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 8 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с белыми полосами с вписанным в него калибровочным размером катетера

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере ном. ... каталогу 4269217S-20)

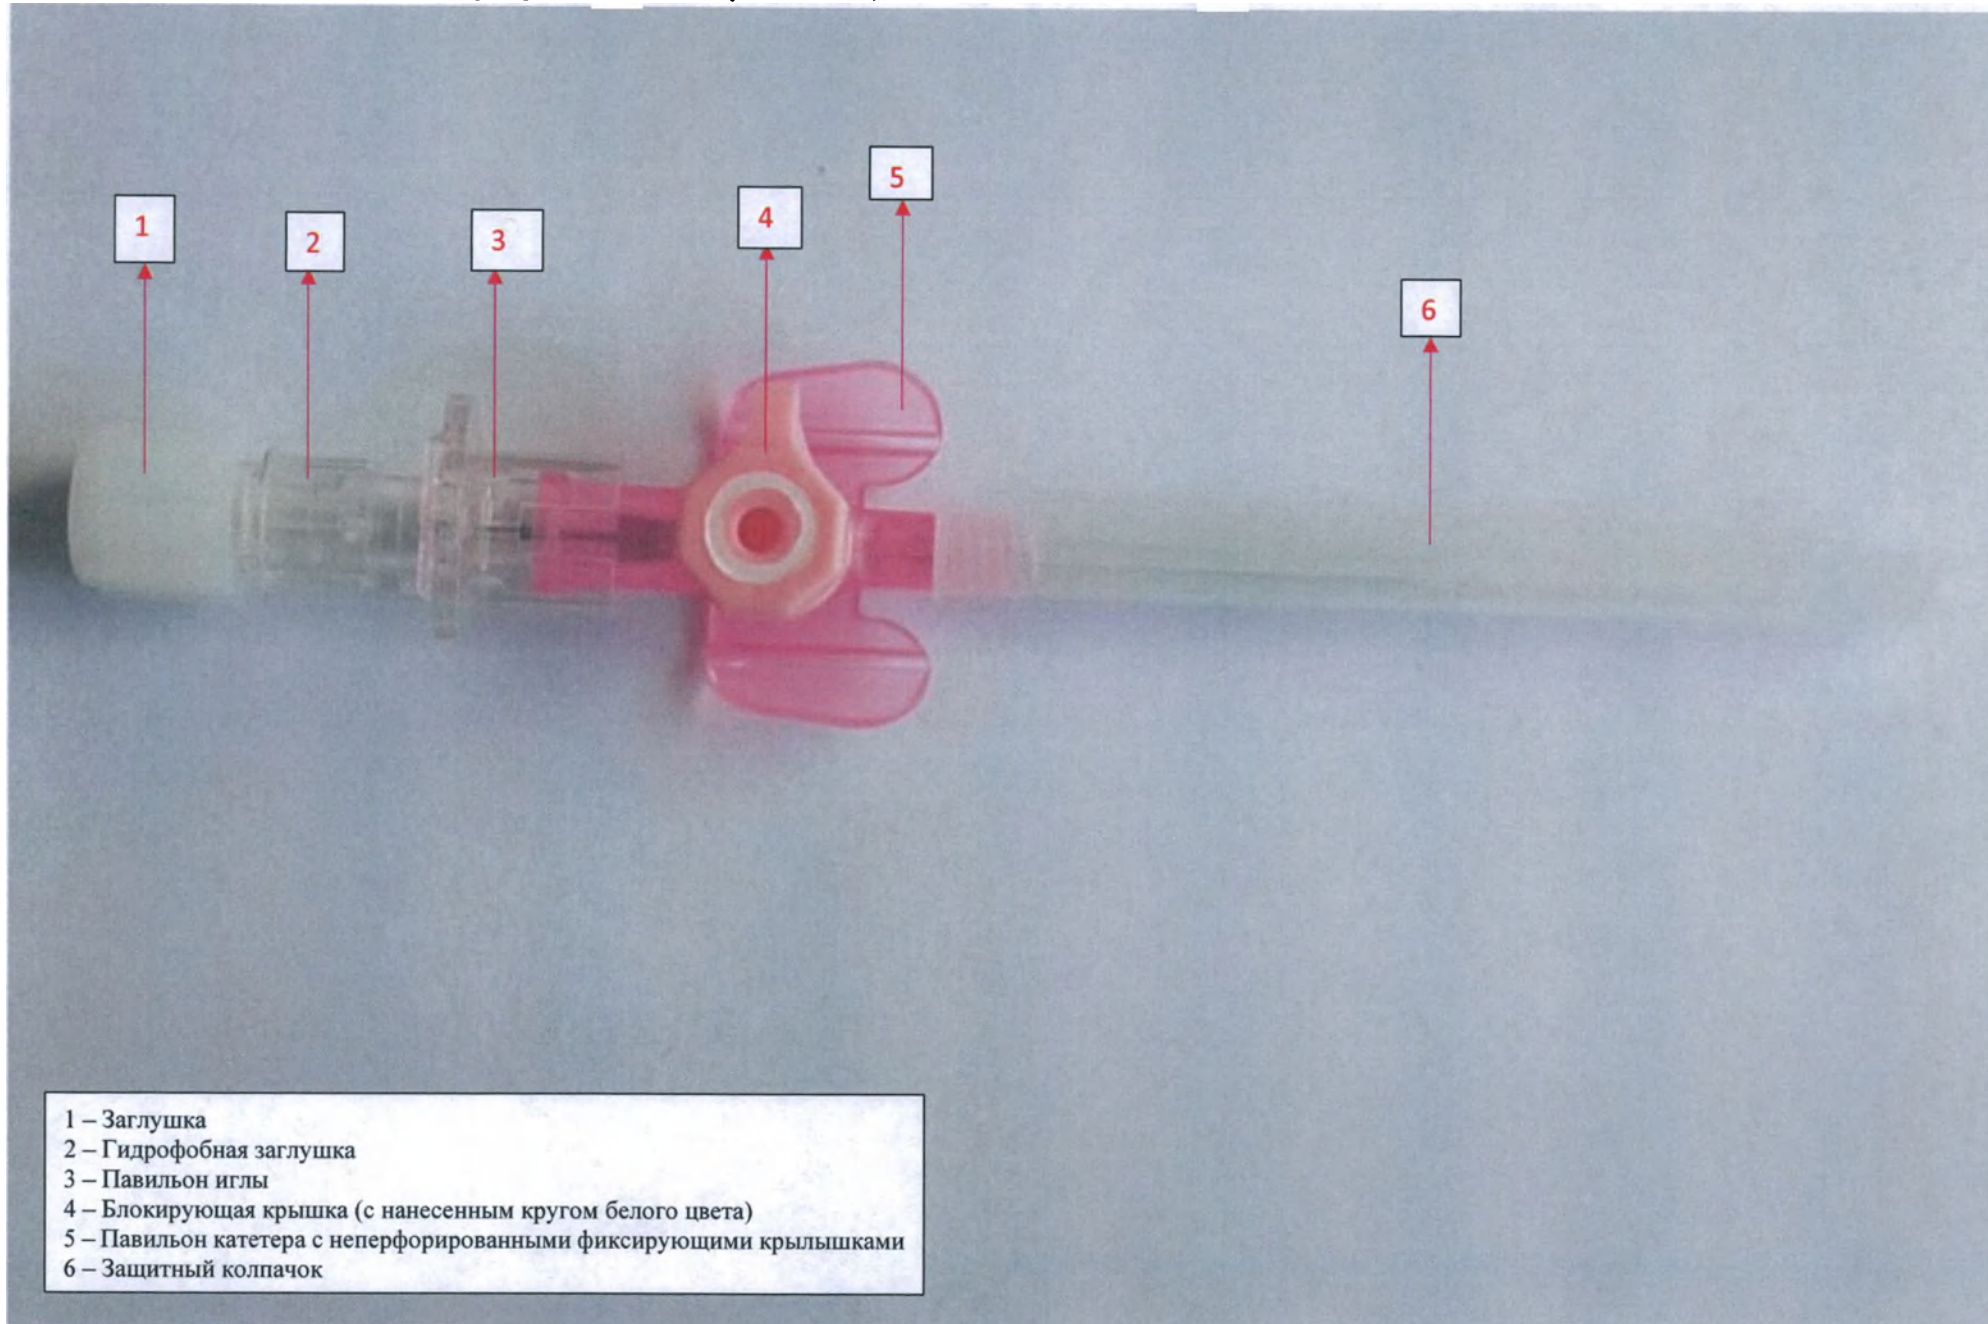


3) Вид медицинского изделия до извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269217S-20)

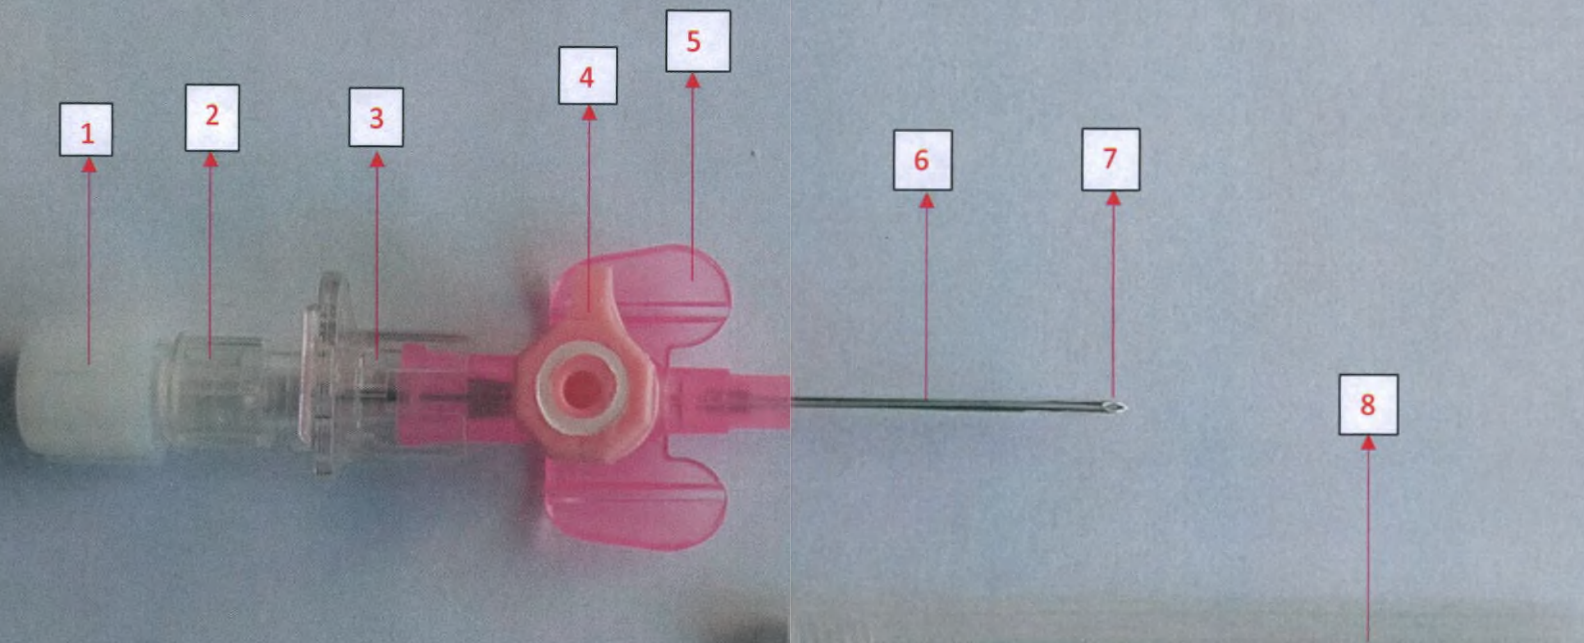

- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Блокирующая крышка (с нанесенным кругом белого цвета)
- 5 – Павильон катетера (с неперфорированными фиксирующими крылышками)
- 6 – Трубка катетера
- 7 – Игла-проводник
- 8 – Защитный колпачок

4) Вид медицинского изделия после извлечения иглы-проводника (на примере номера по каталогу 4269217S-20)

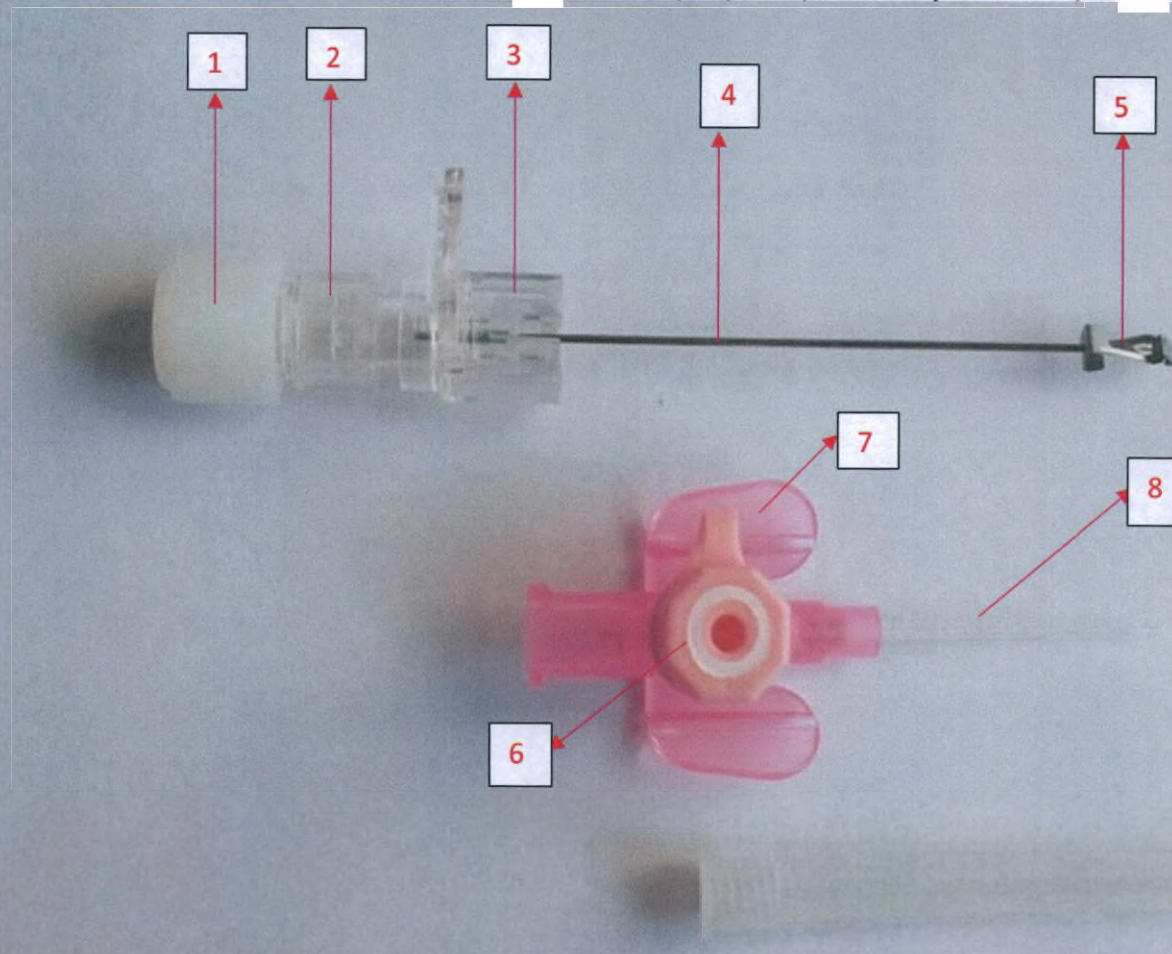


- 1 – Заглушка
- 2 – Гидрофобная заглушка
- 3 – Павильон иглы
- 4 – Игла-проводник
- 5 – Самоактивирующаяся защитная клипса (пассивный защитный механизм)
- 6 – Блокирующая крышка (с нанесенным кругом белого цвета)
- 7 – Павильон катетера (с неперфорированными фиксирующими крылышками)
- 8 – Трубка катетера
- 9 – Защитный колпачок

II. Групповая упаковка.

1. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.


1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269330S-20)

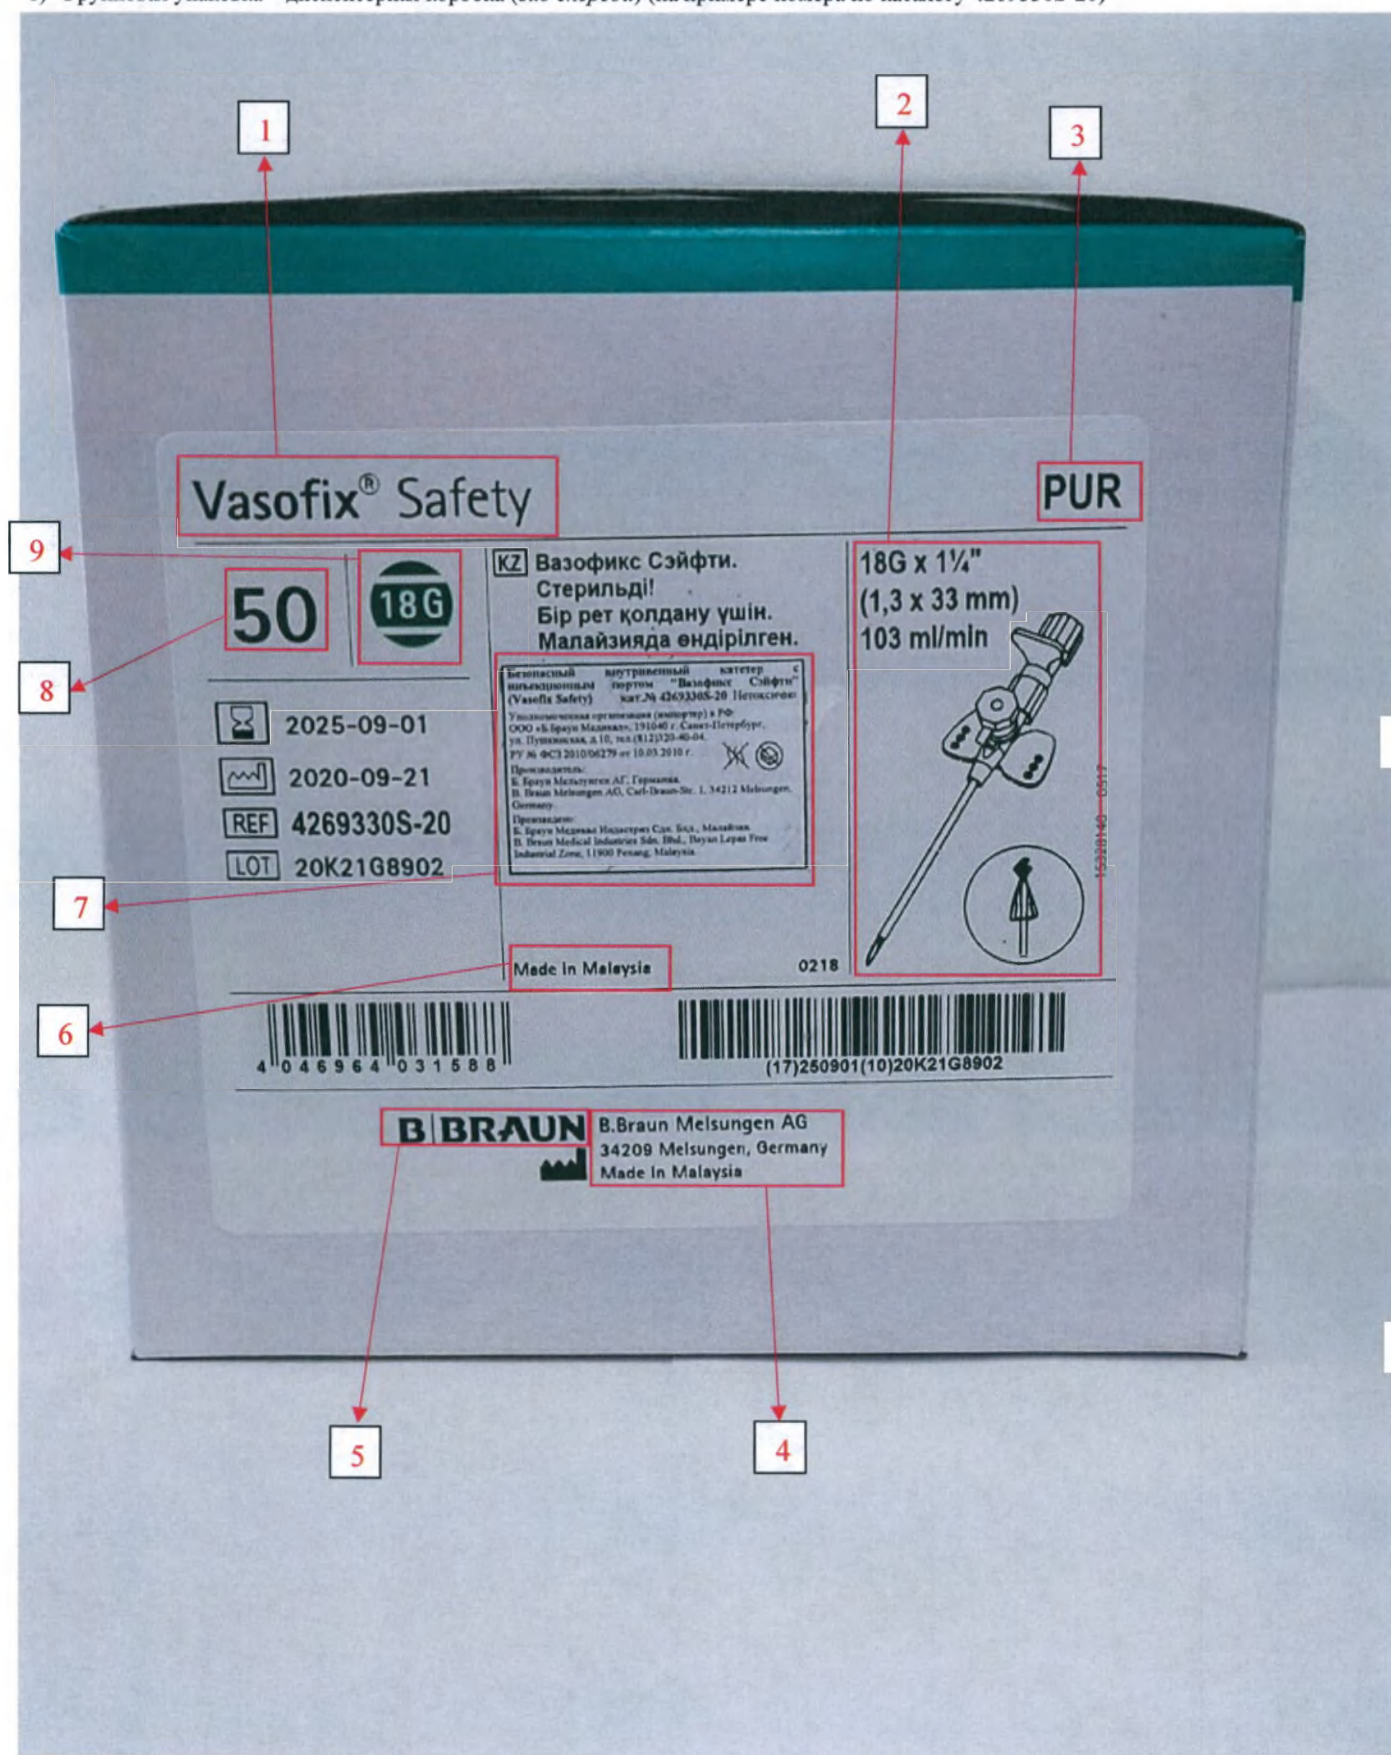


Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 3 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с белыми полосами с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

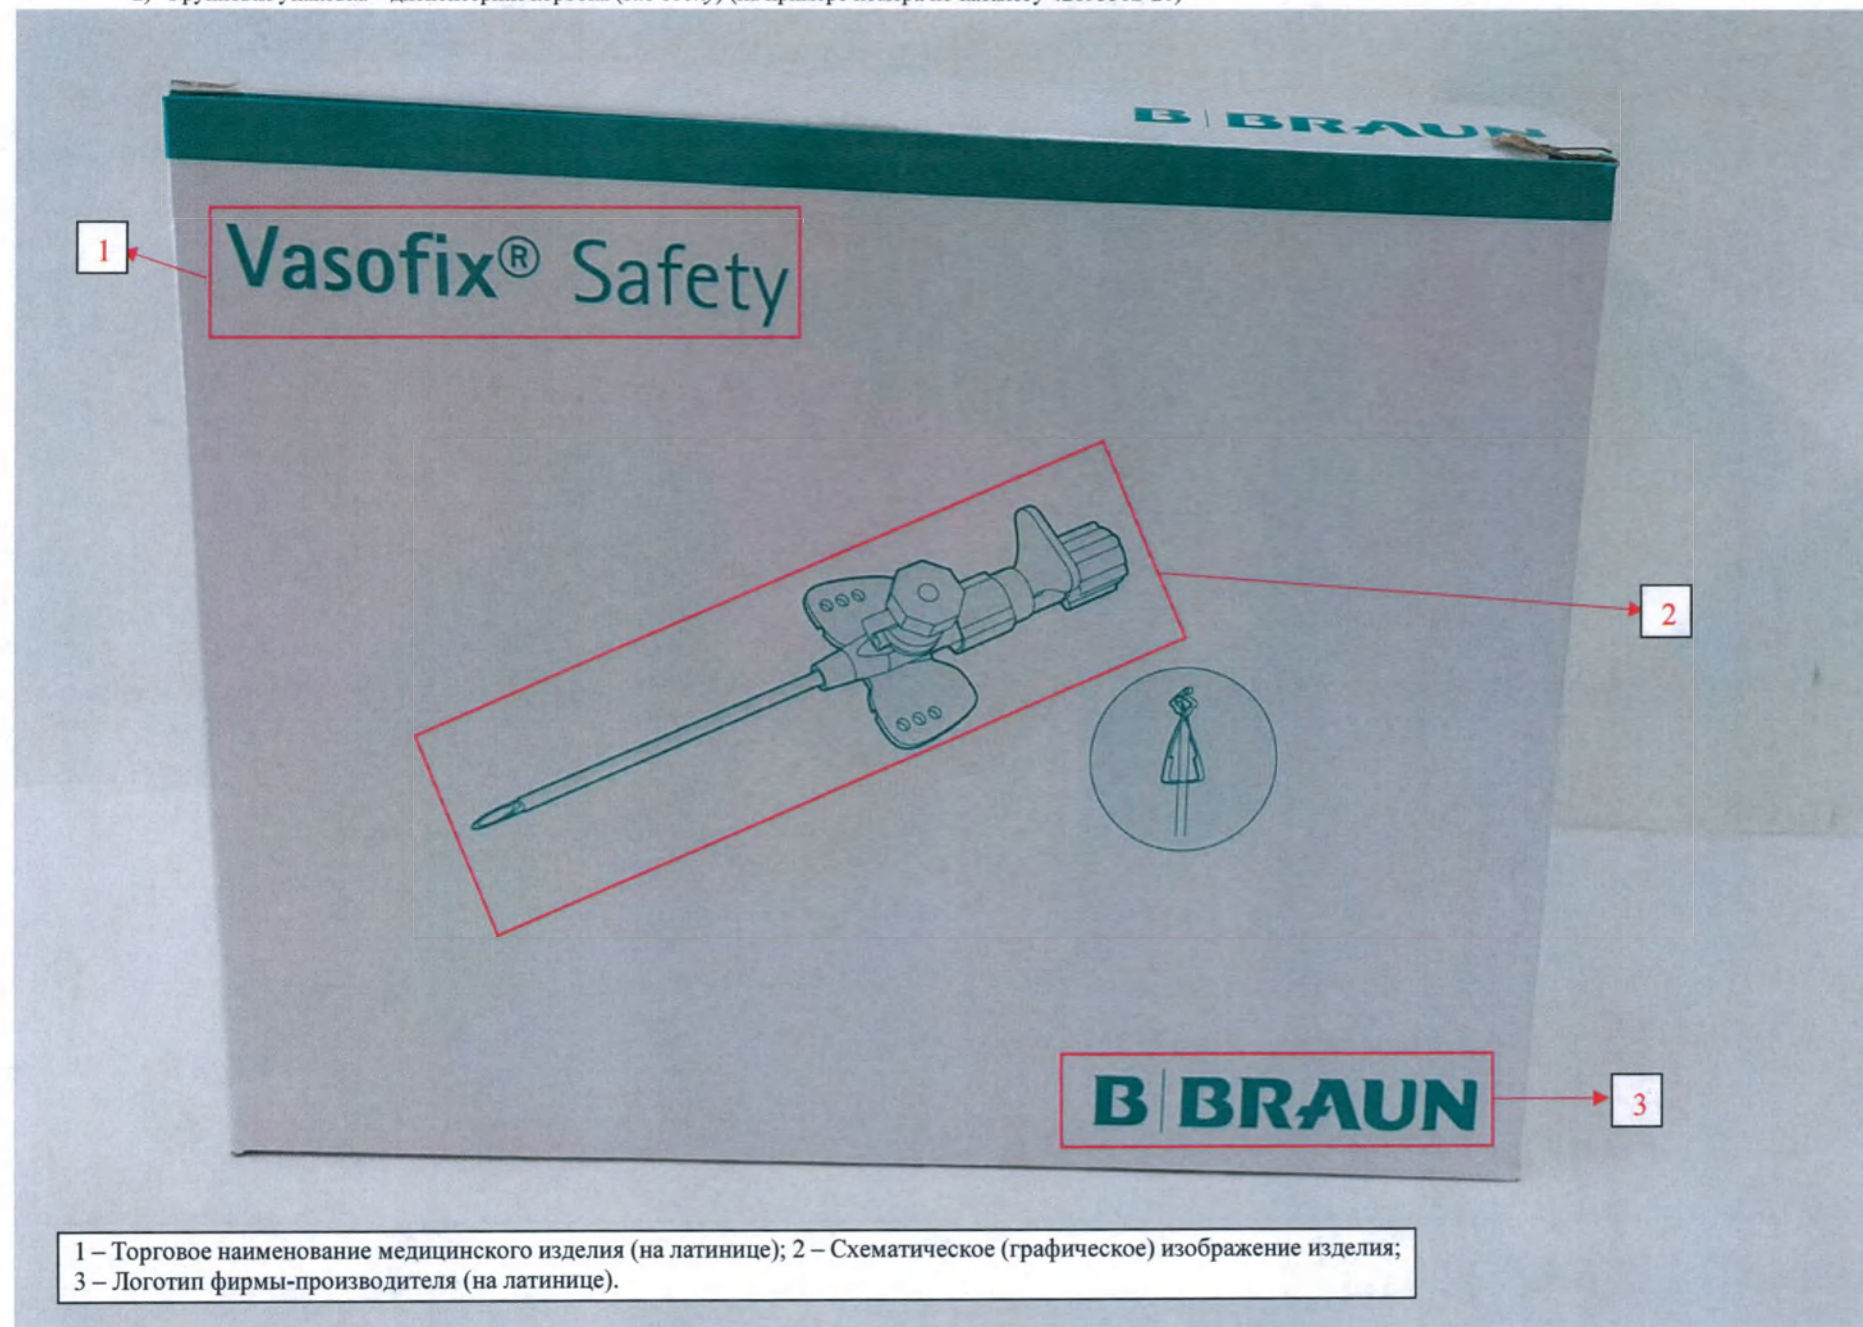


1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия;
3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

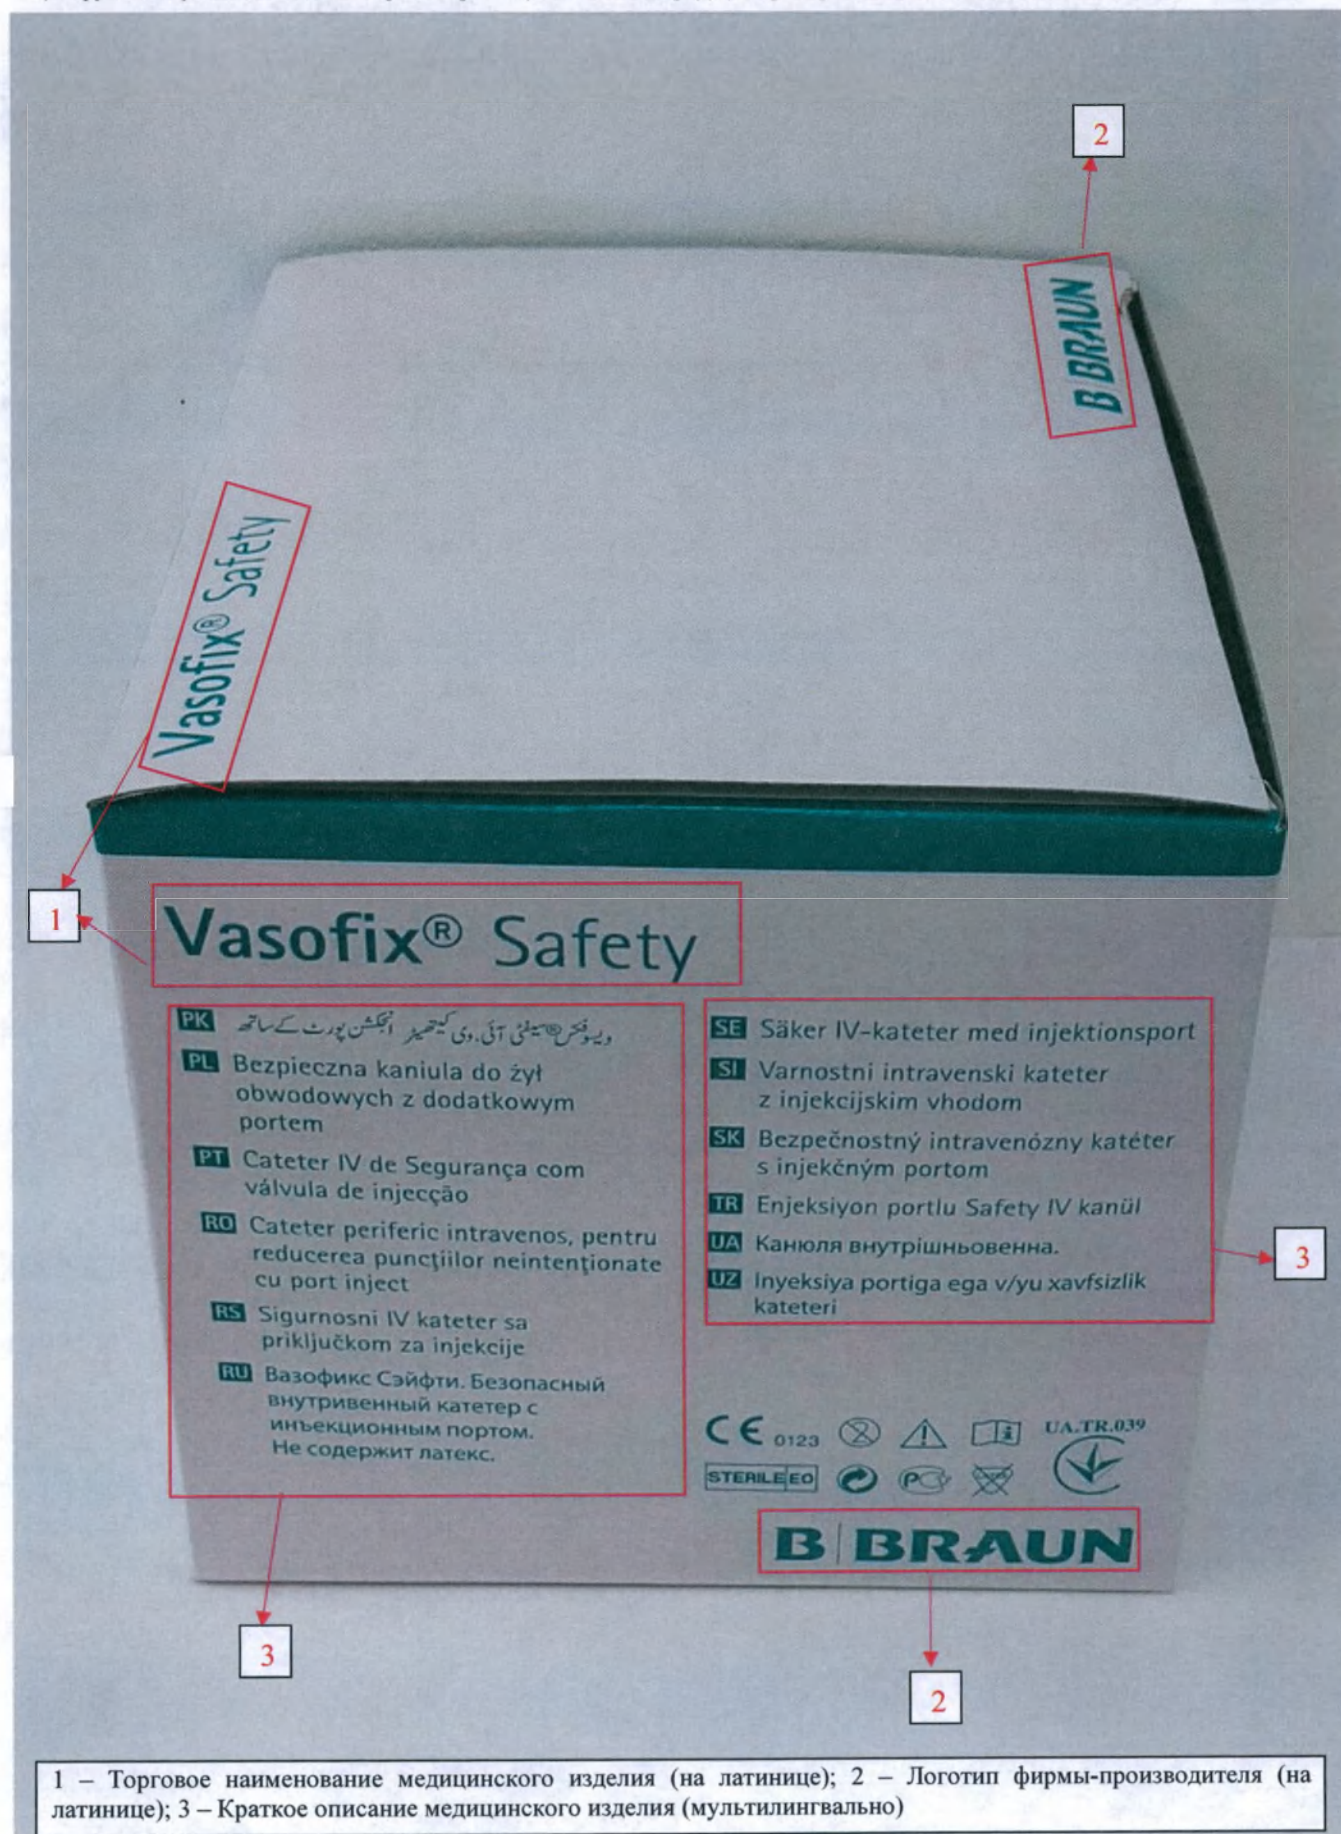

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

2. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.
- 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269136S-20)

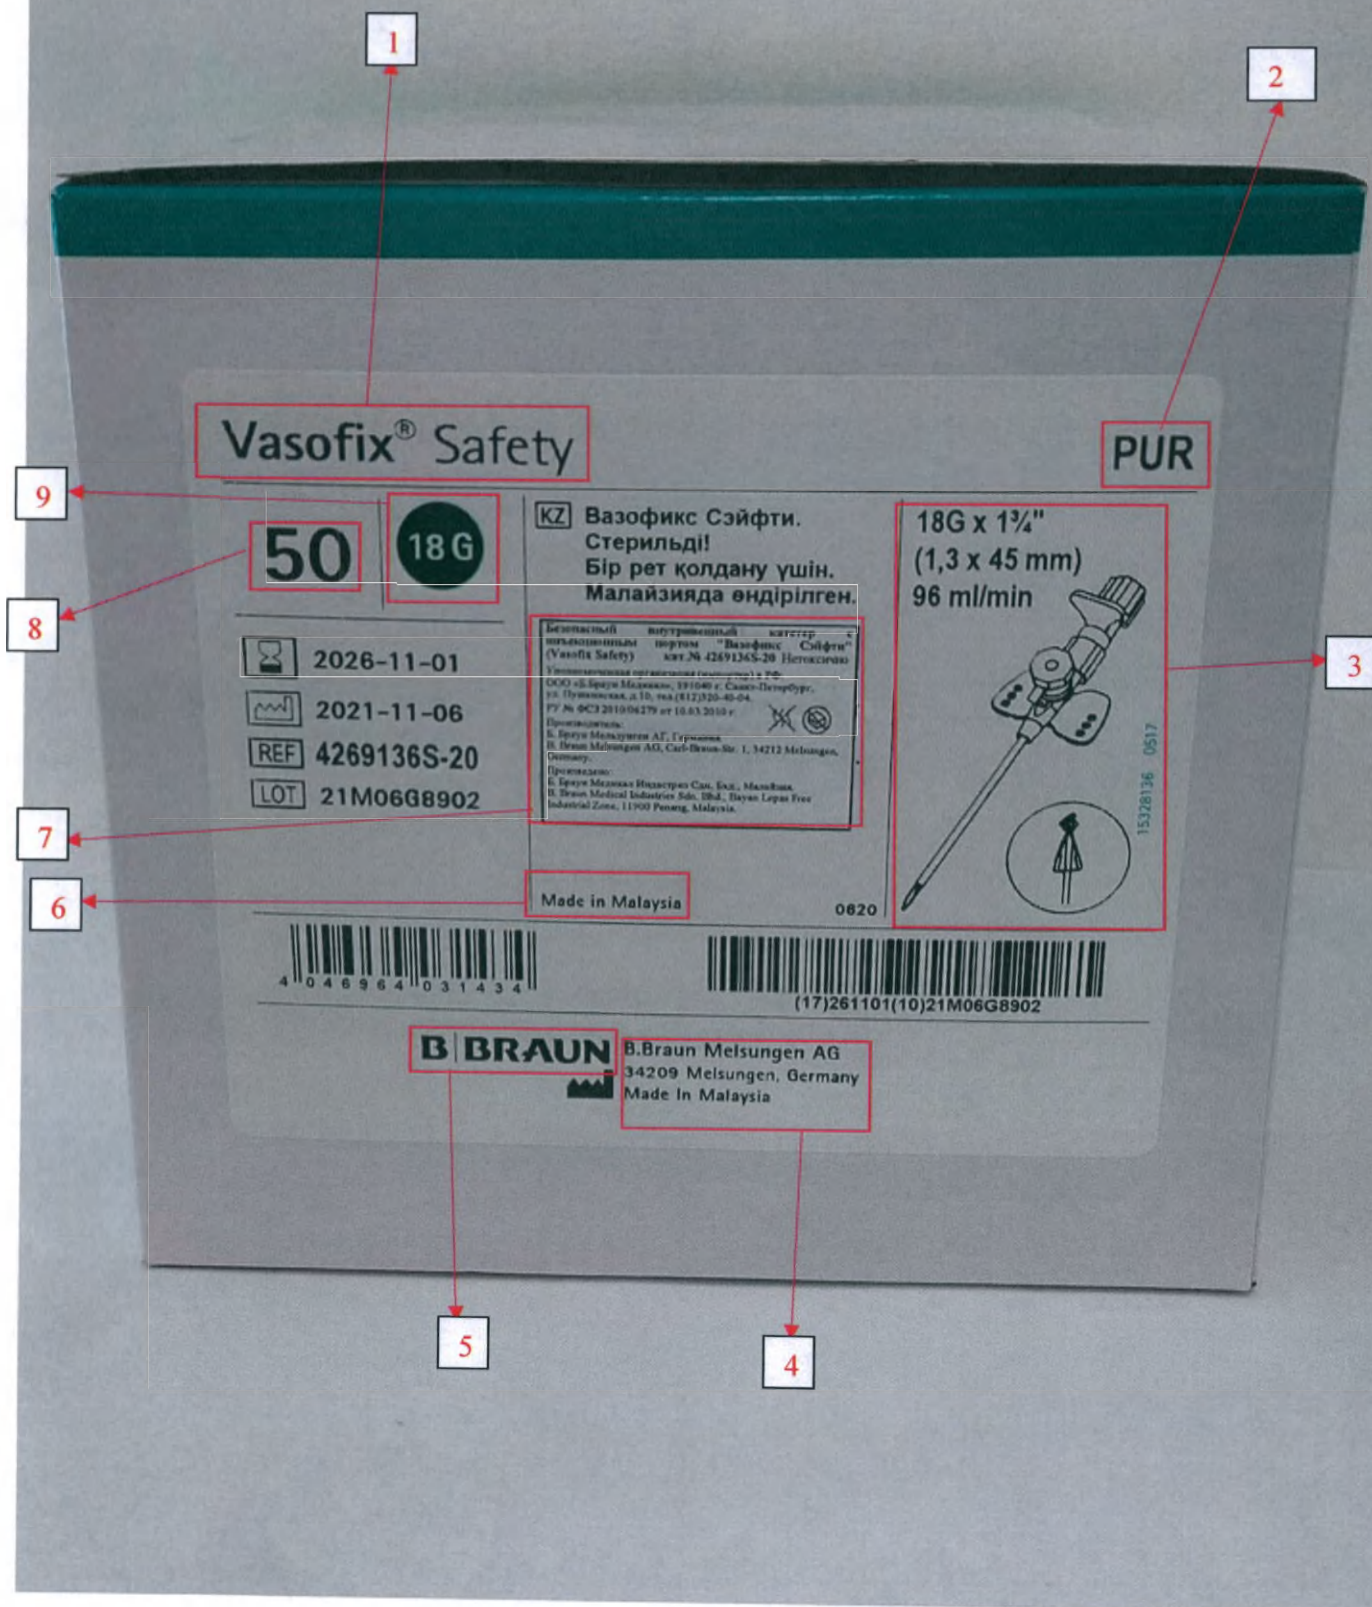

Информация на групповой упаковке:


- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269136S-20)



1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия;
3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

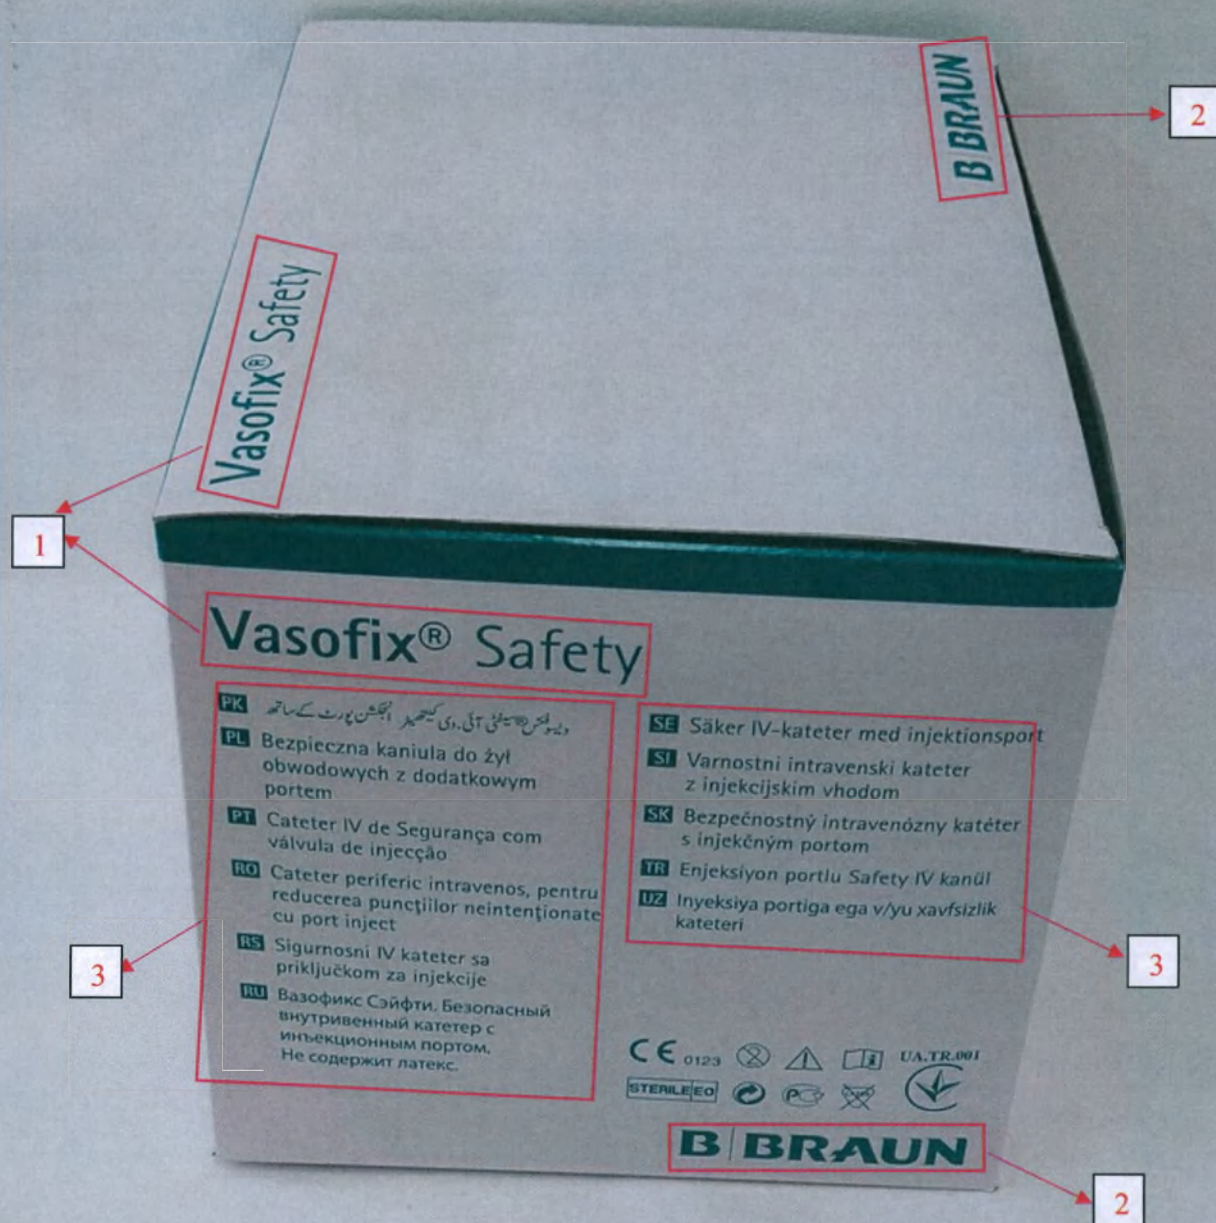

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

3. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269071S-01)



Информация на групповой упаковке:


- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);**
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);**
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;**
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);**
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 6 – Страна места производства (на латинице);**
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».**
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;**
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.**

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269071S-01)

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).




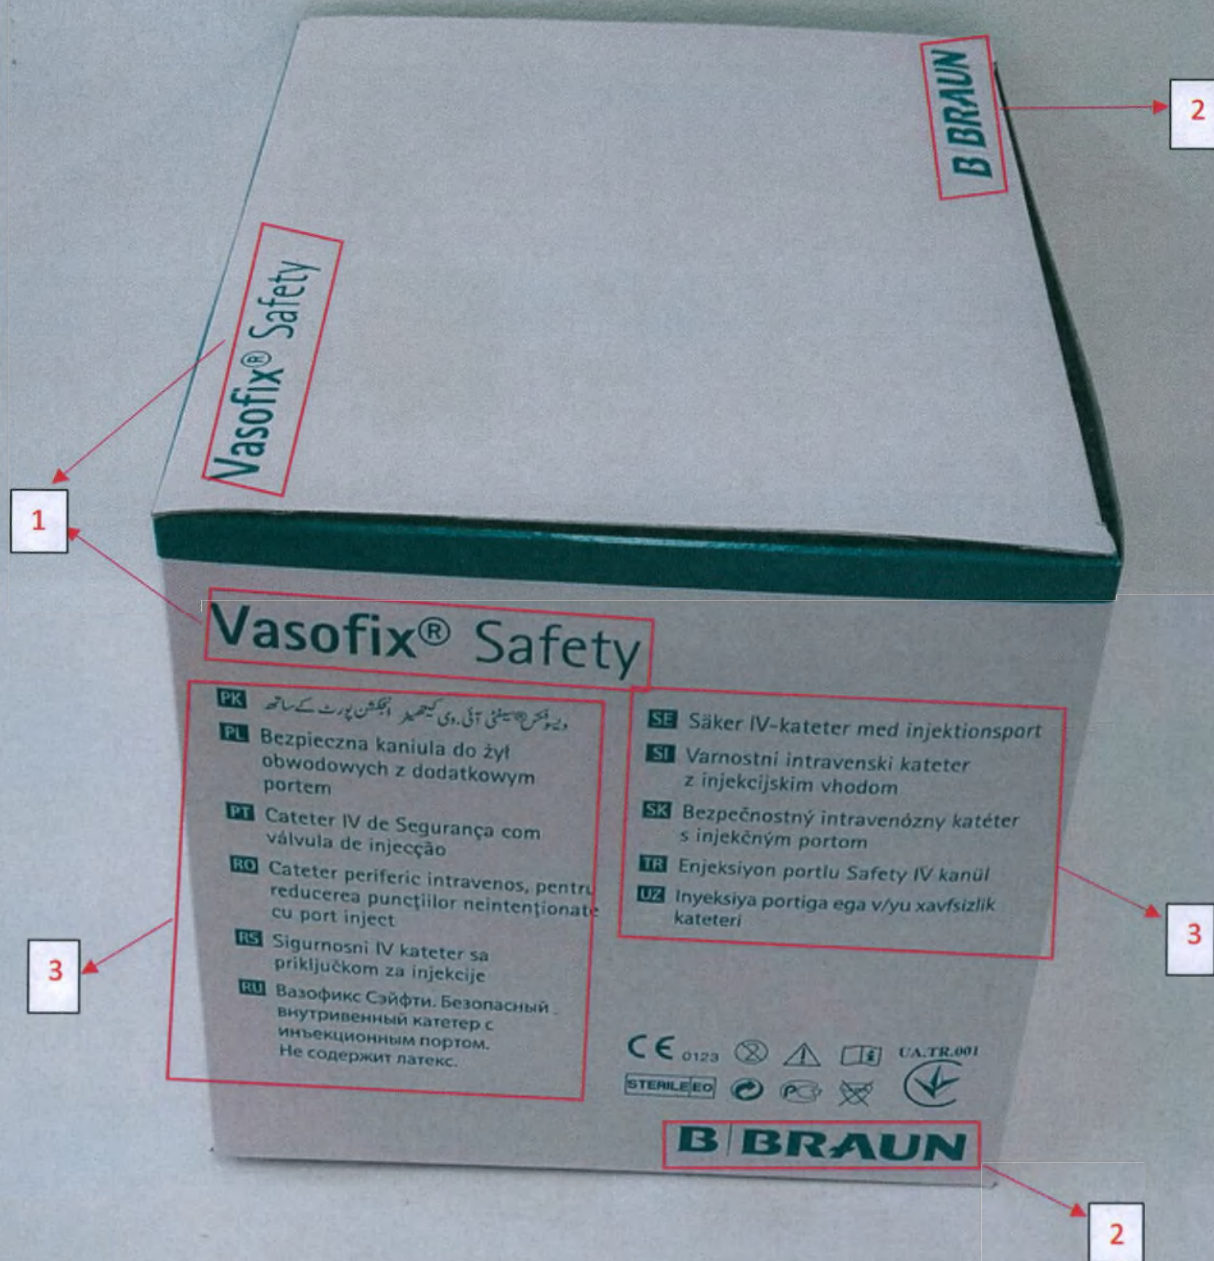

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

4. Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269110S-01)

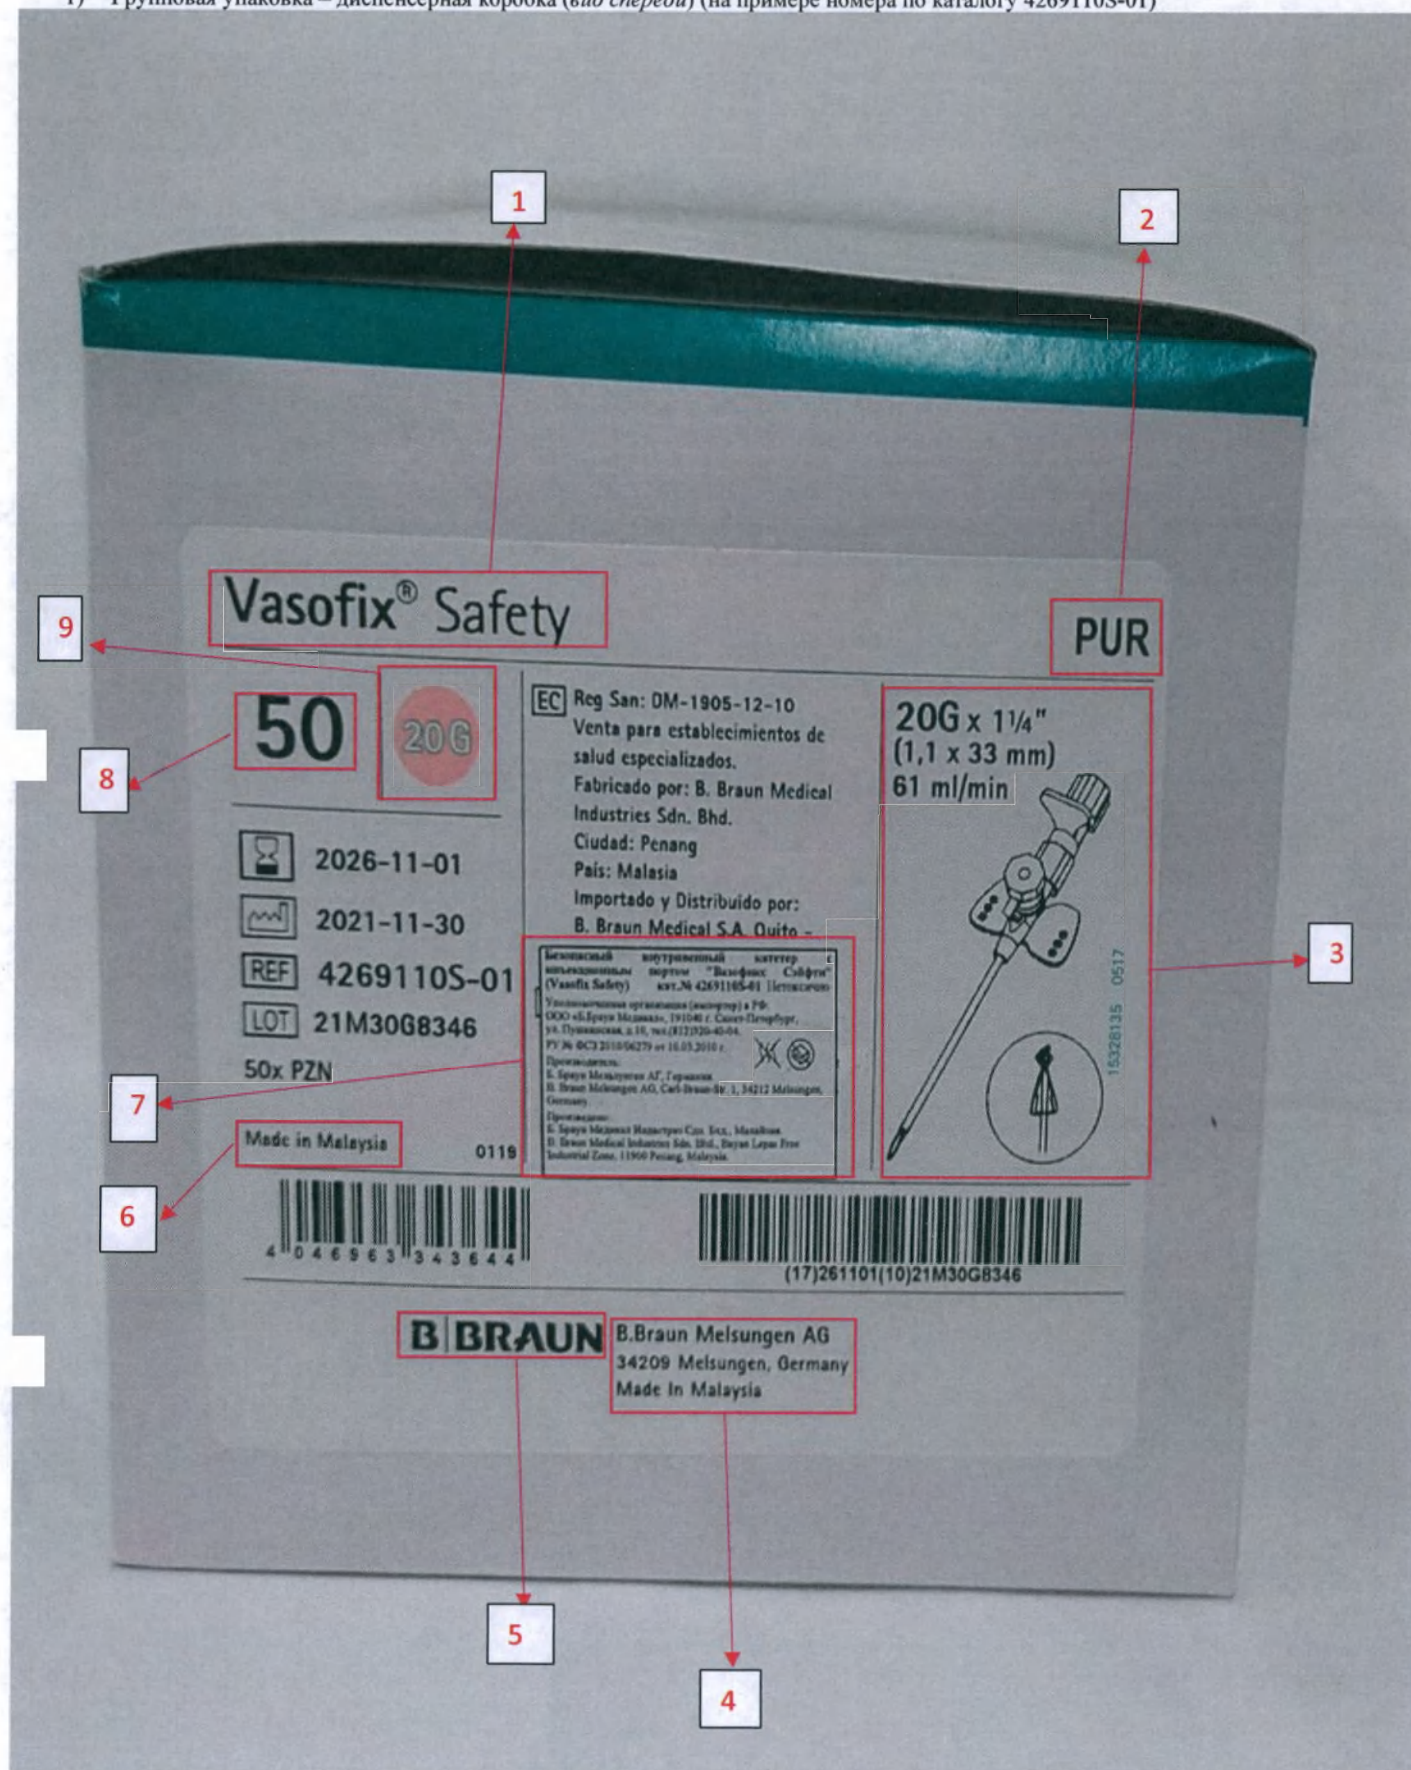

Информация на групповой упаковке:


- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку, пример номера по каталогу 4269110S-01)

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).



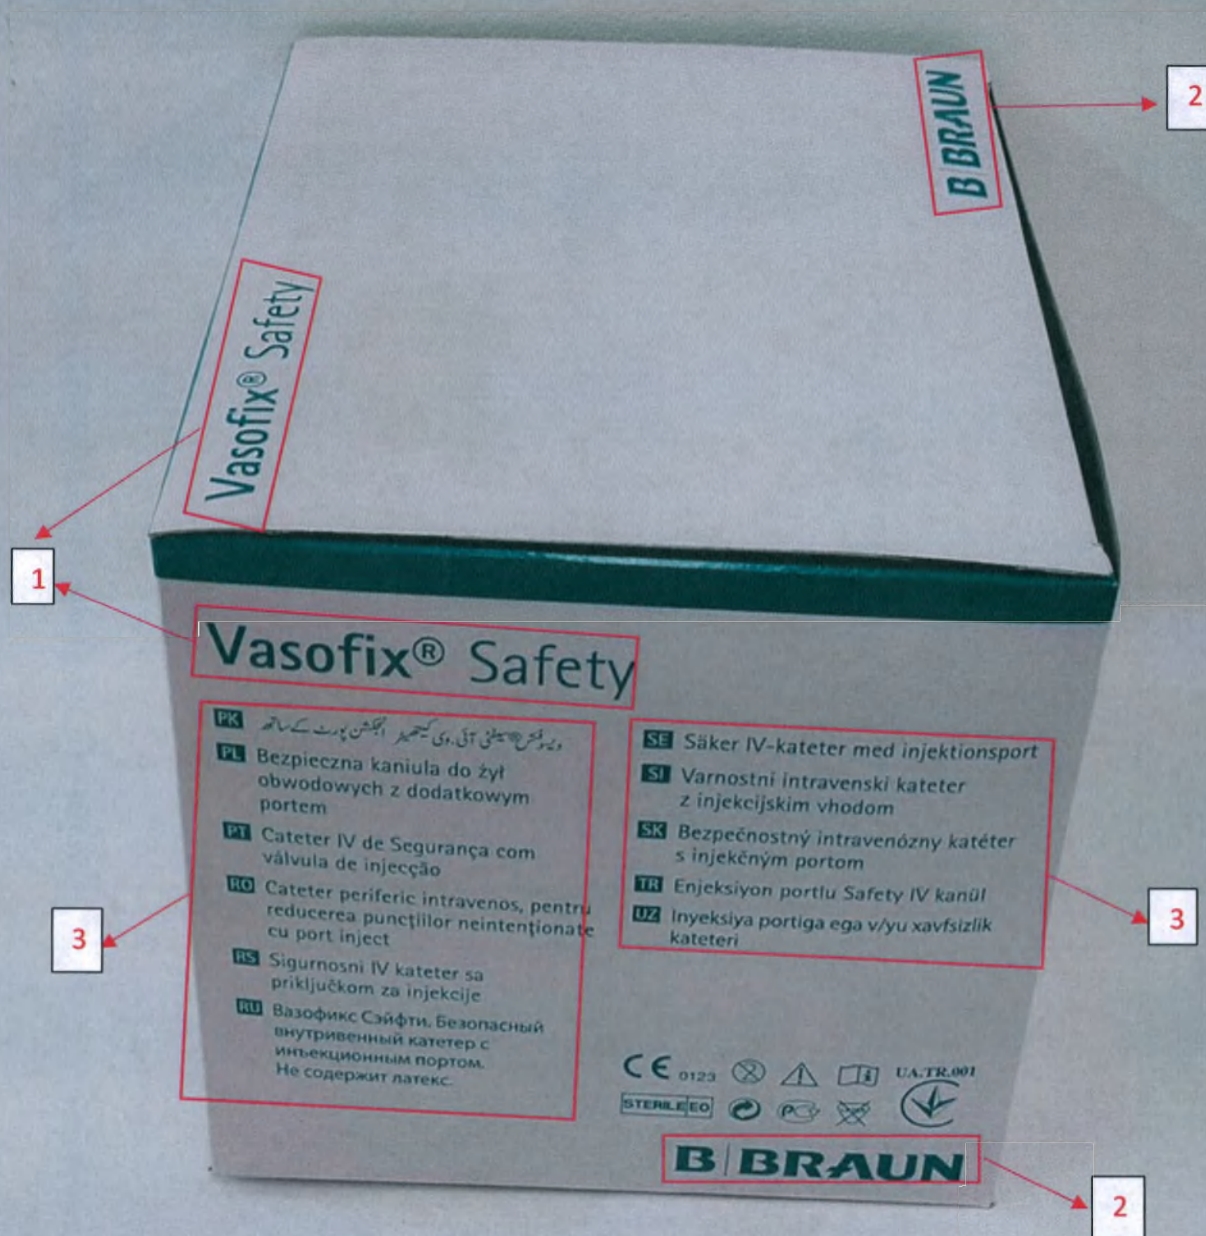

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

5) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269152S-20)





Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269152S-20)

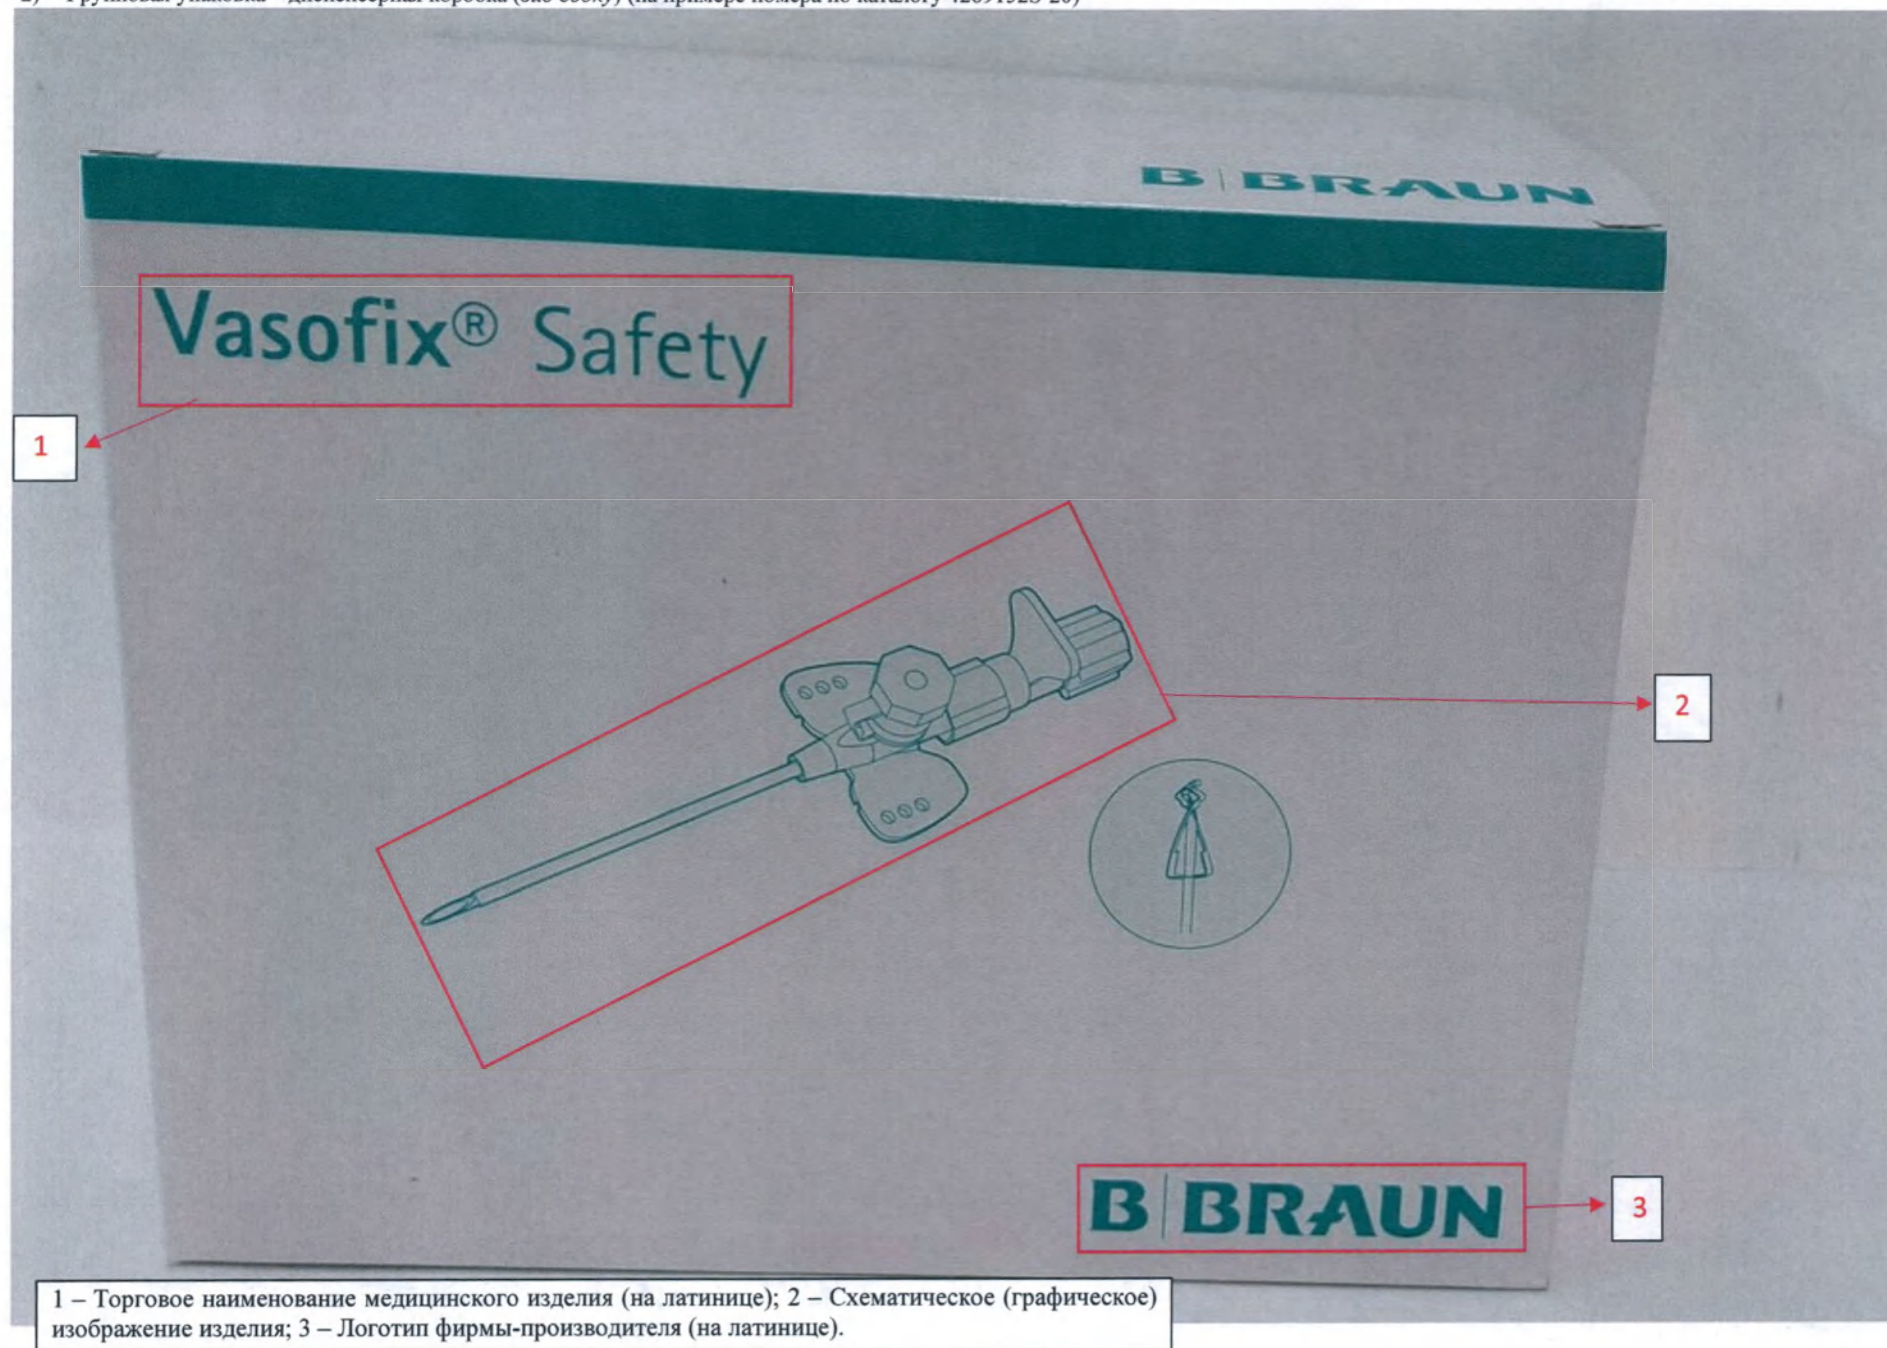

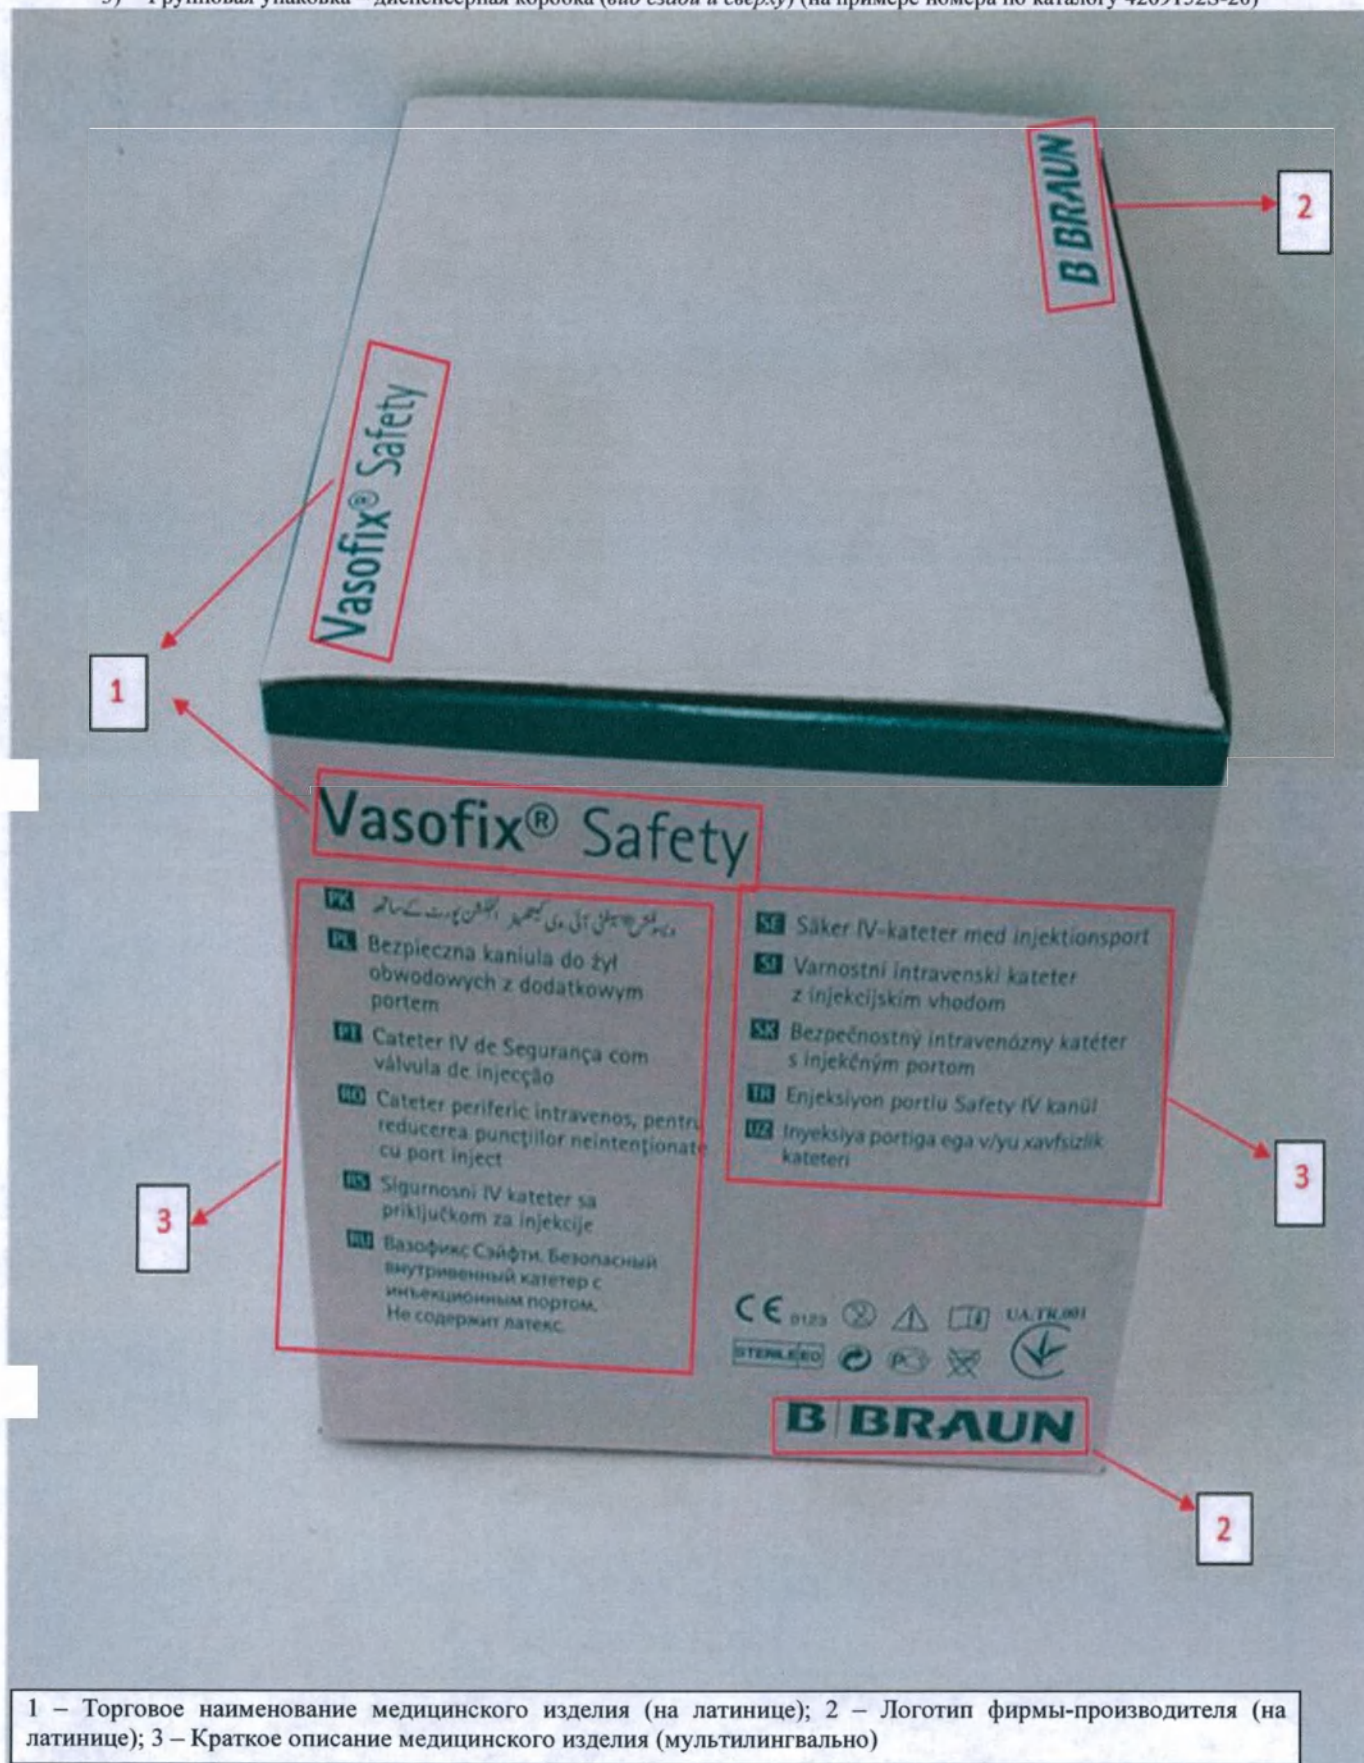

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

6) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)




Информация на групповой упаковке:


- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269179S-20)

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

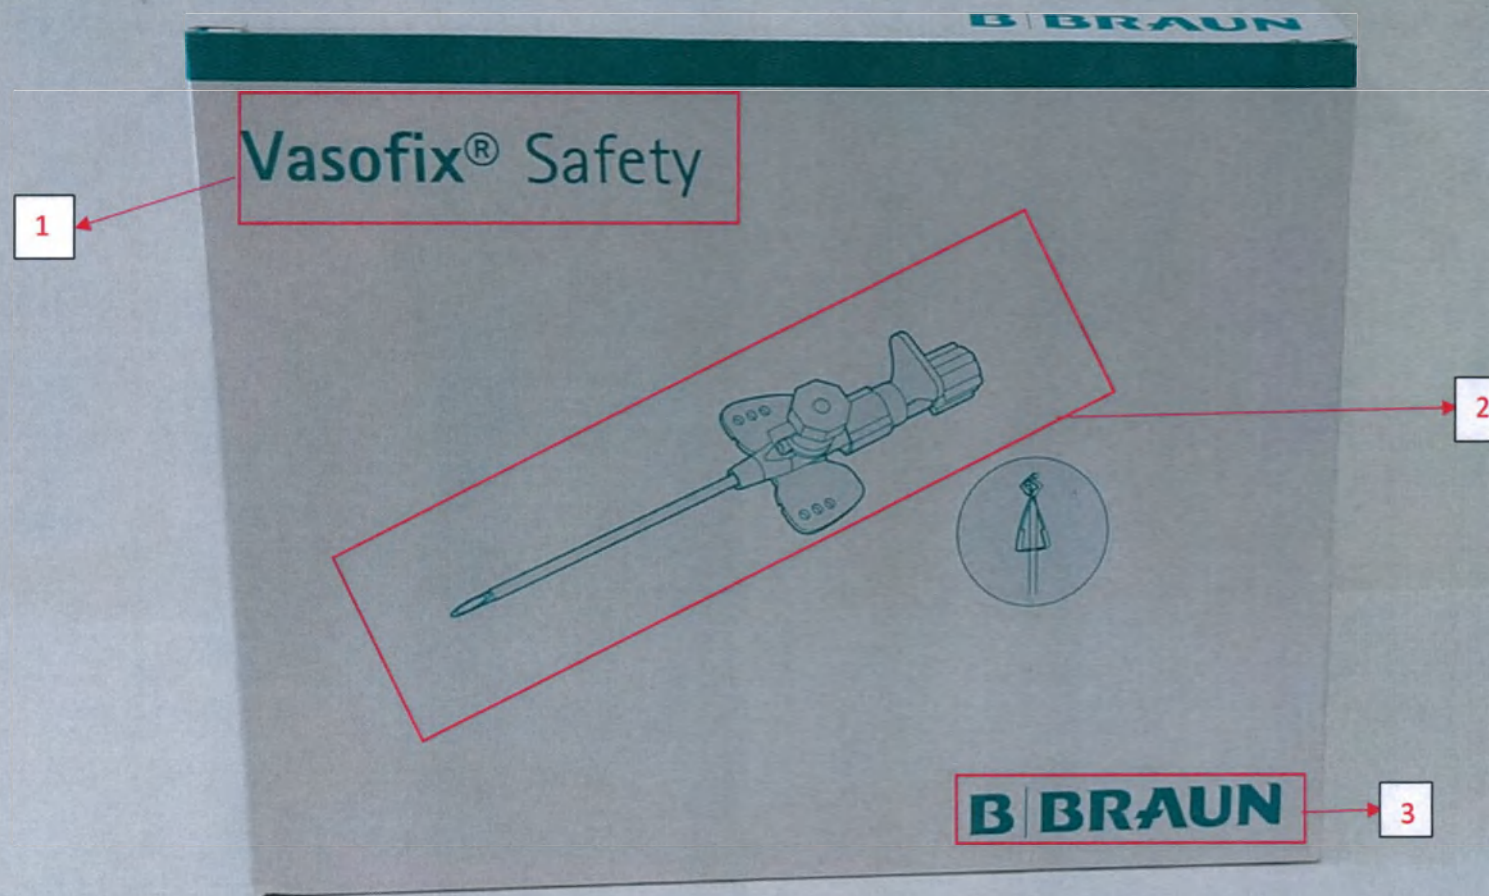


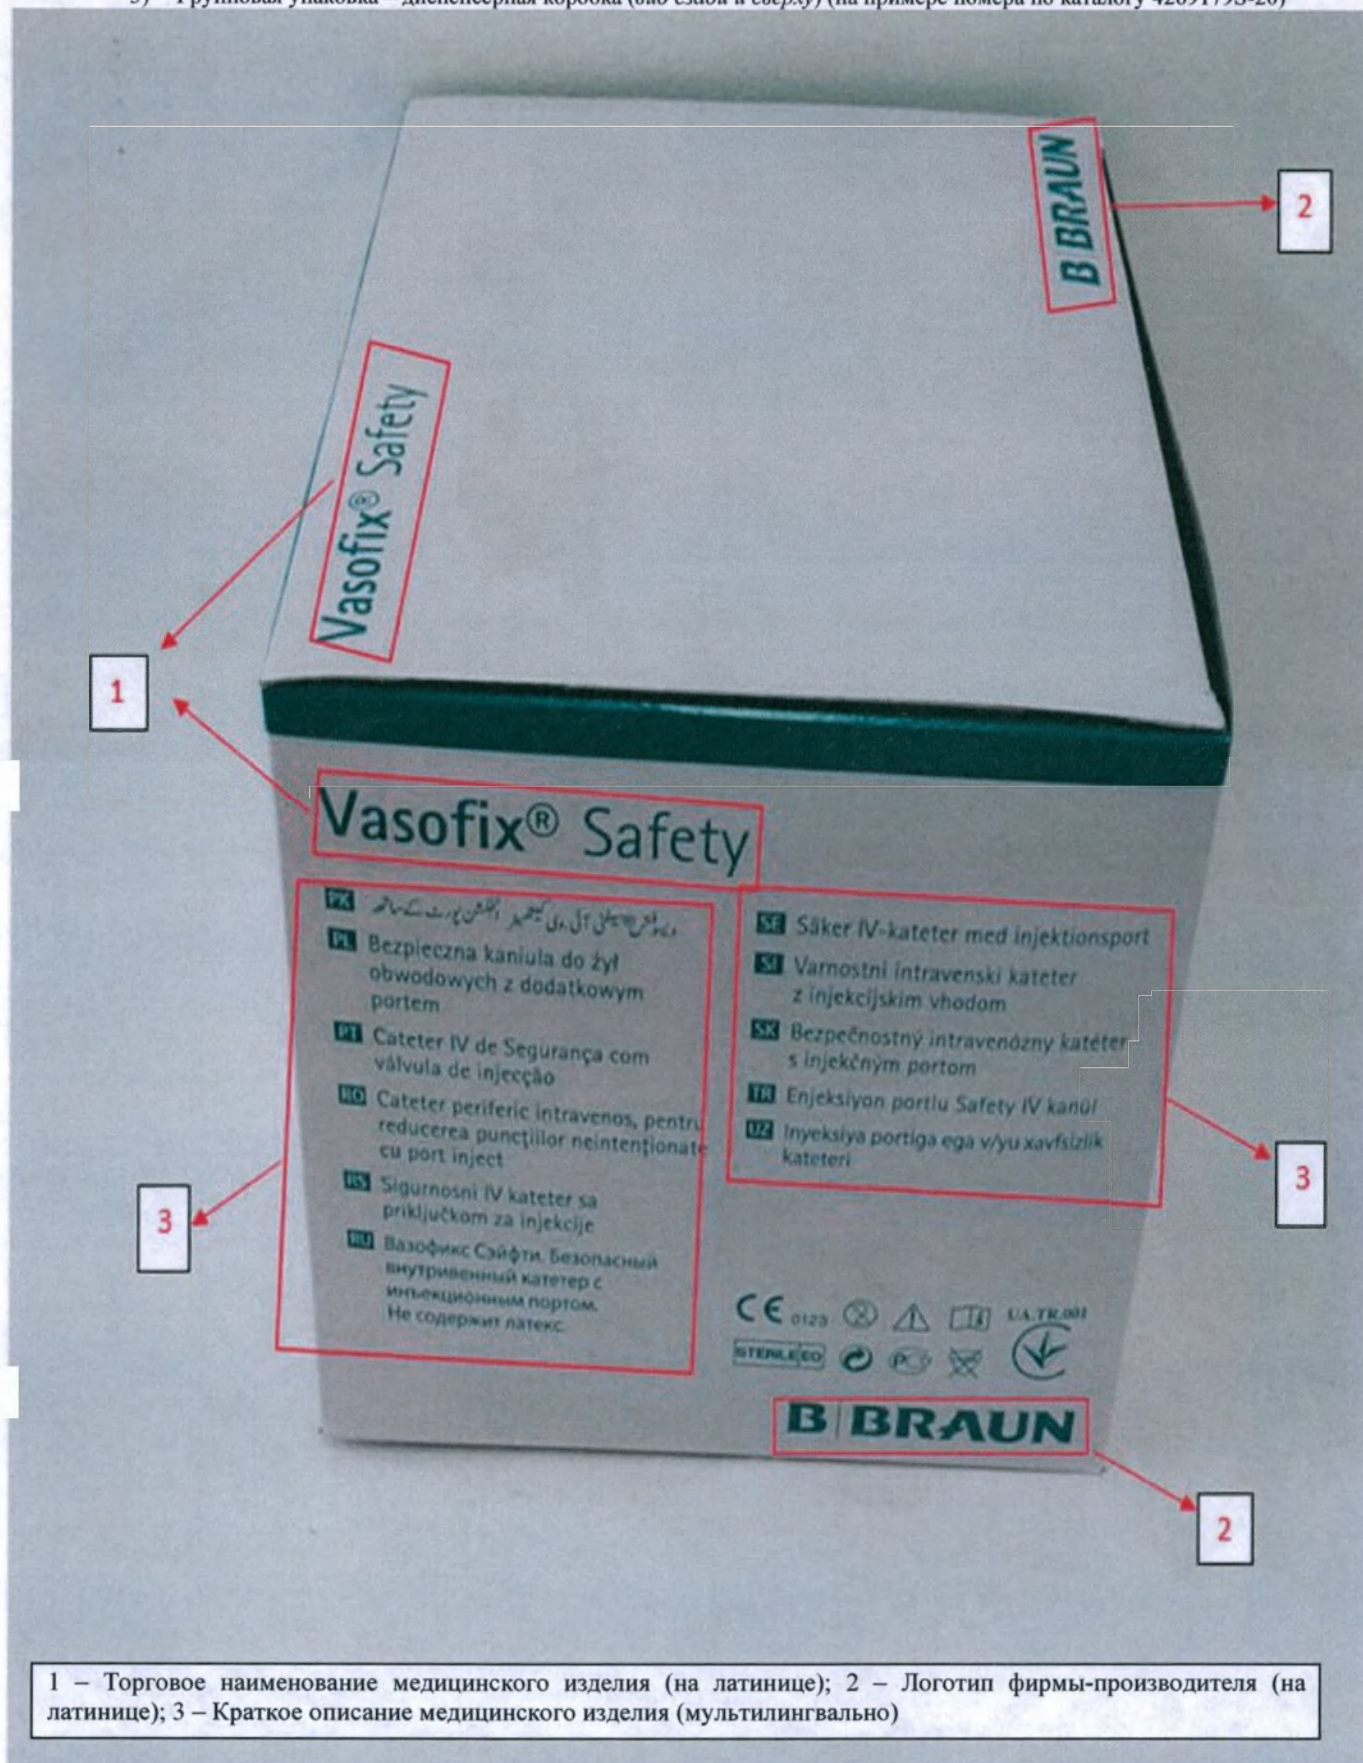

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

7) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)

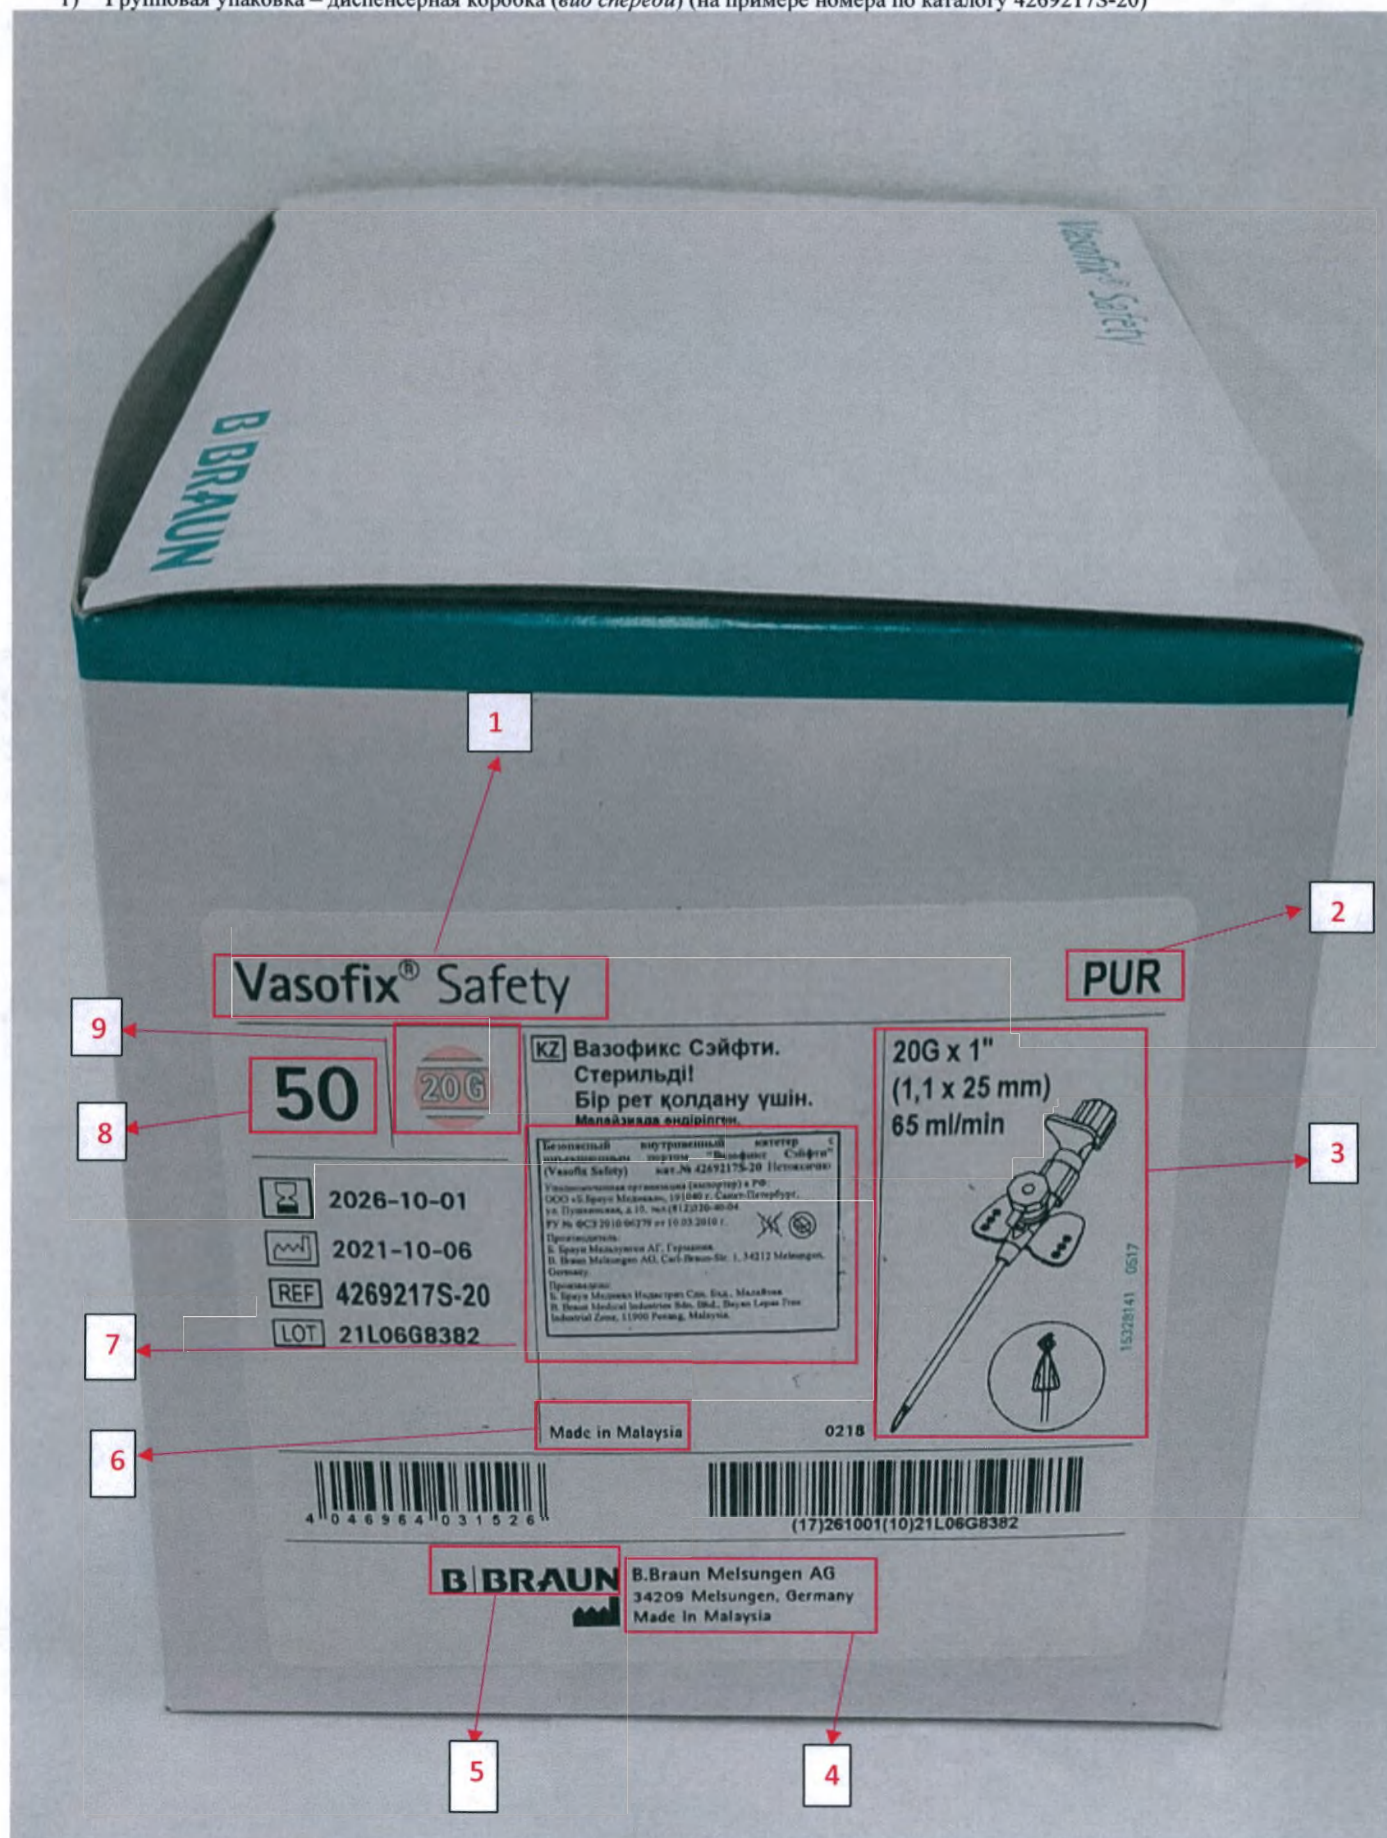



Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с белыми полосами с вписанным в него калибровочным размером катетера.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269217S-20)

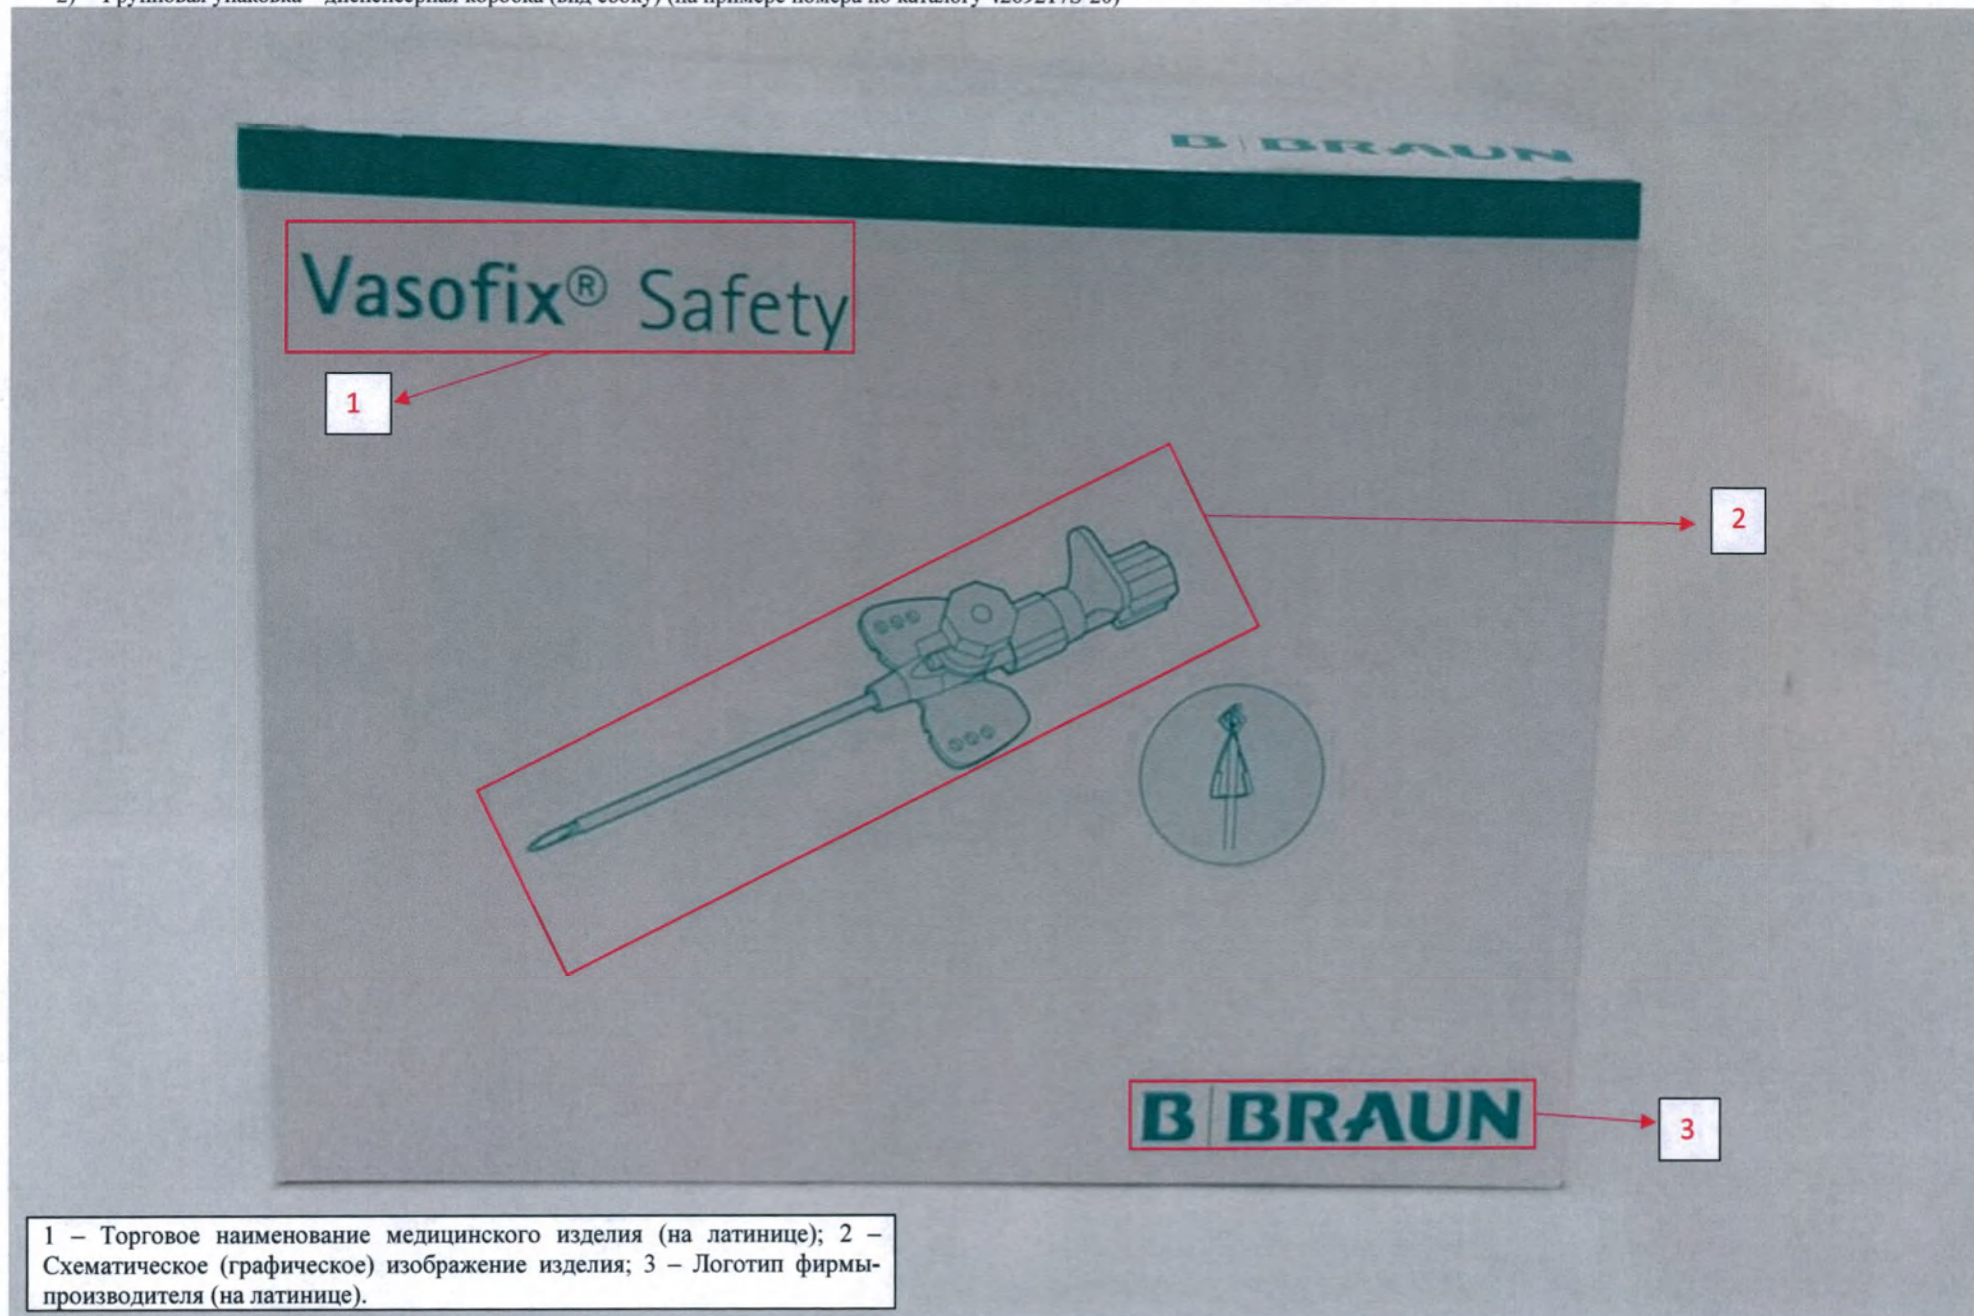

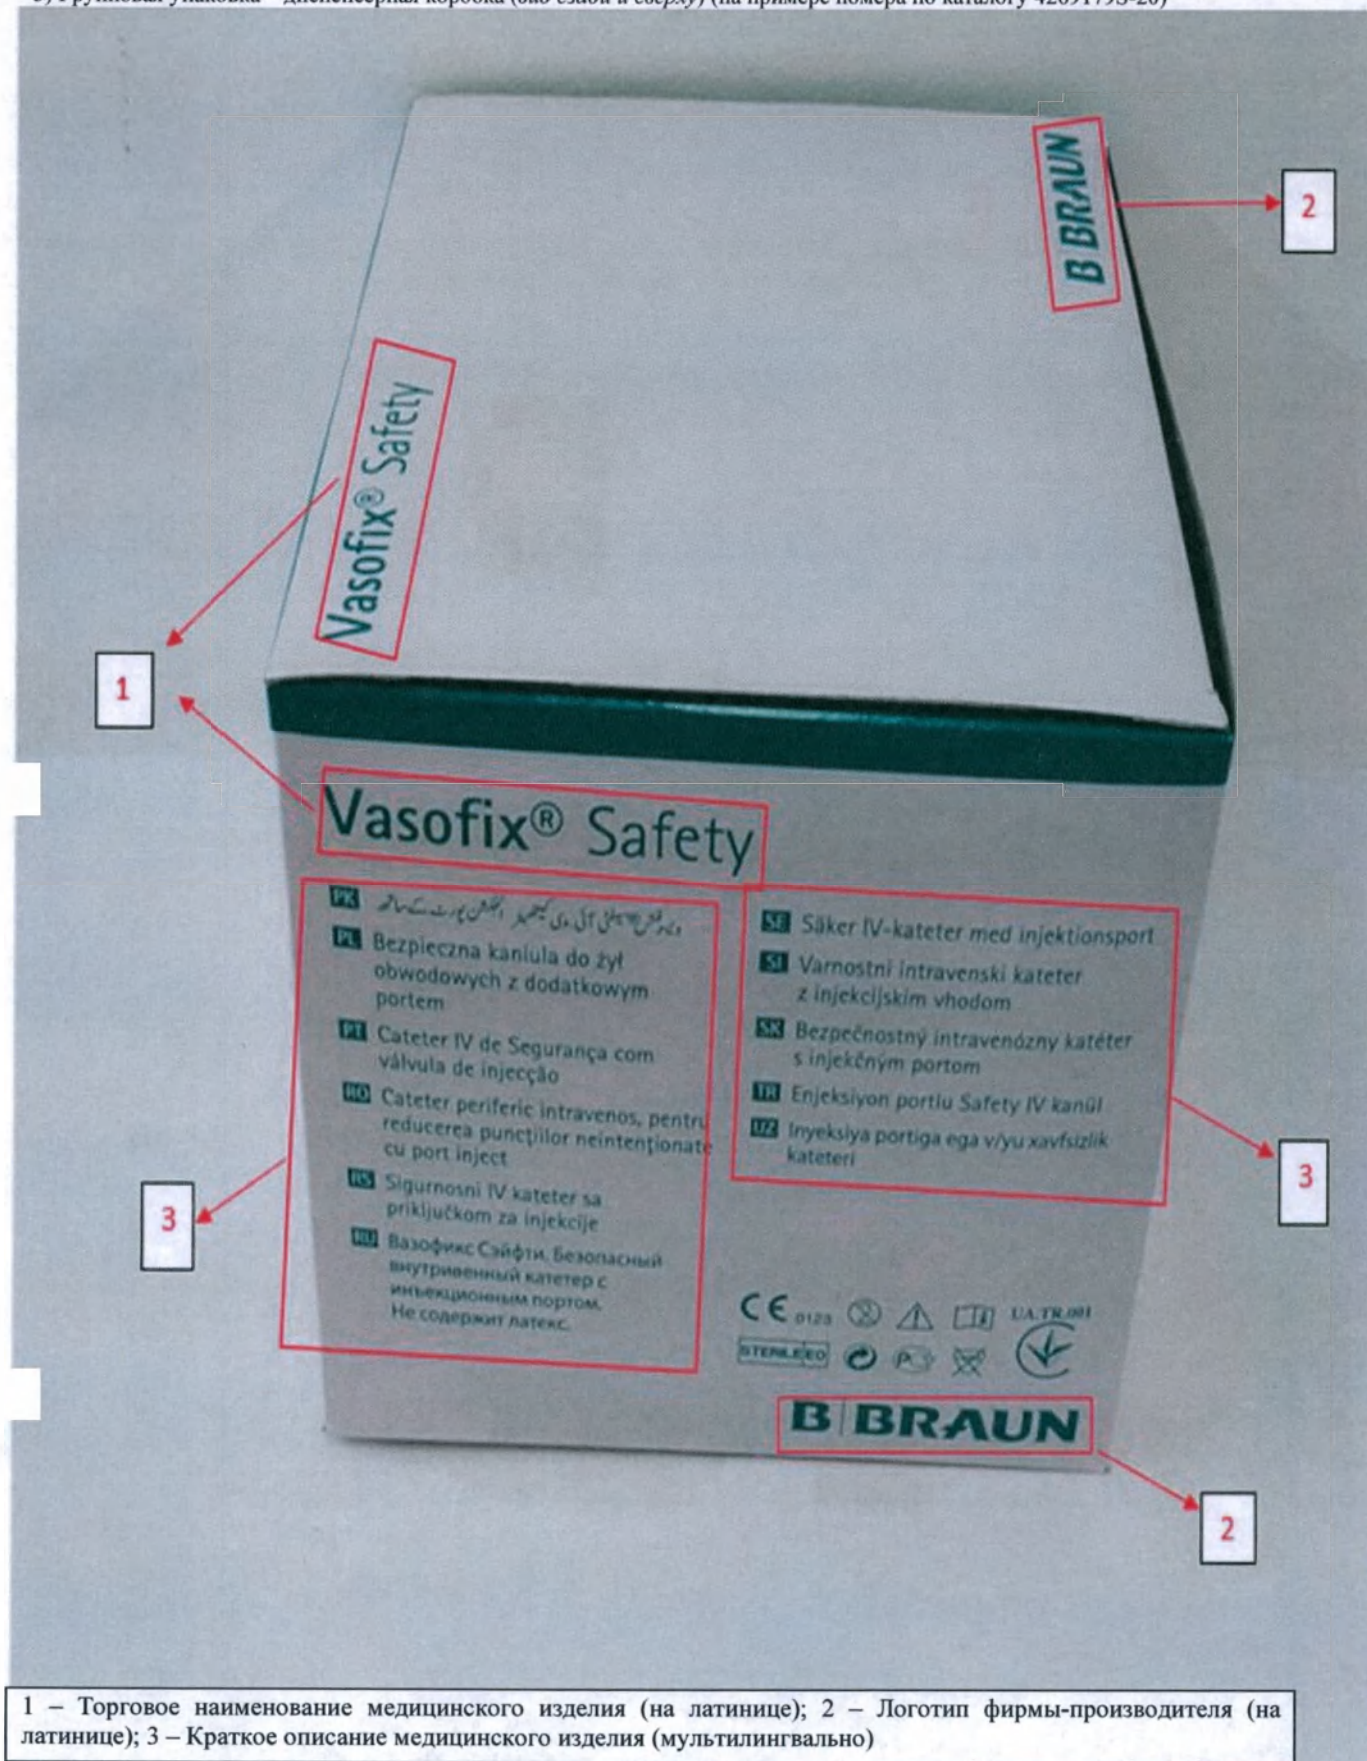

8) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)




Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с белыми полосами с вписанным в него калибровочным размером катетера.


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269098S-20)

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

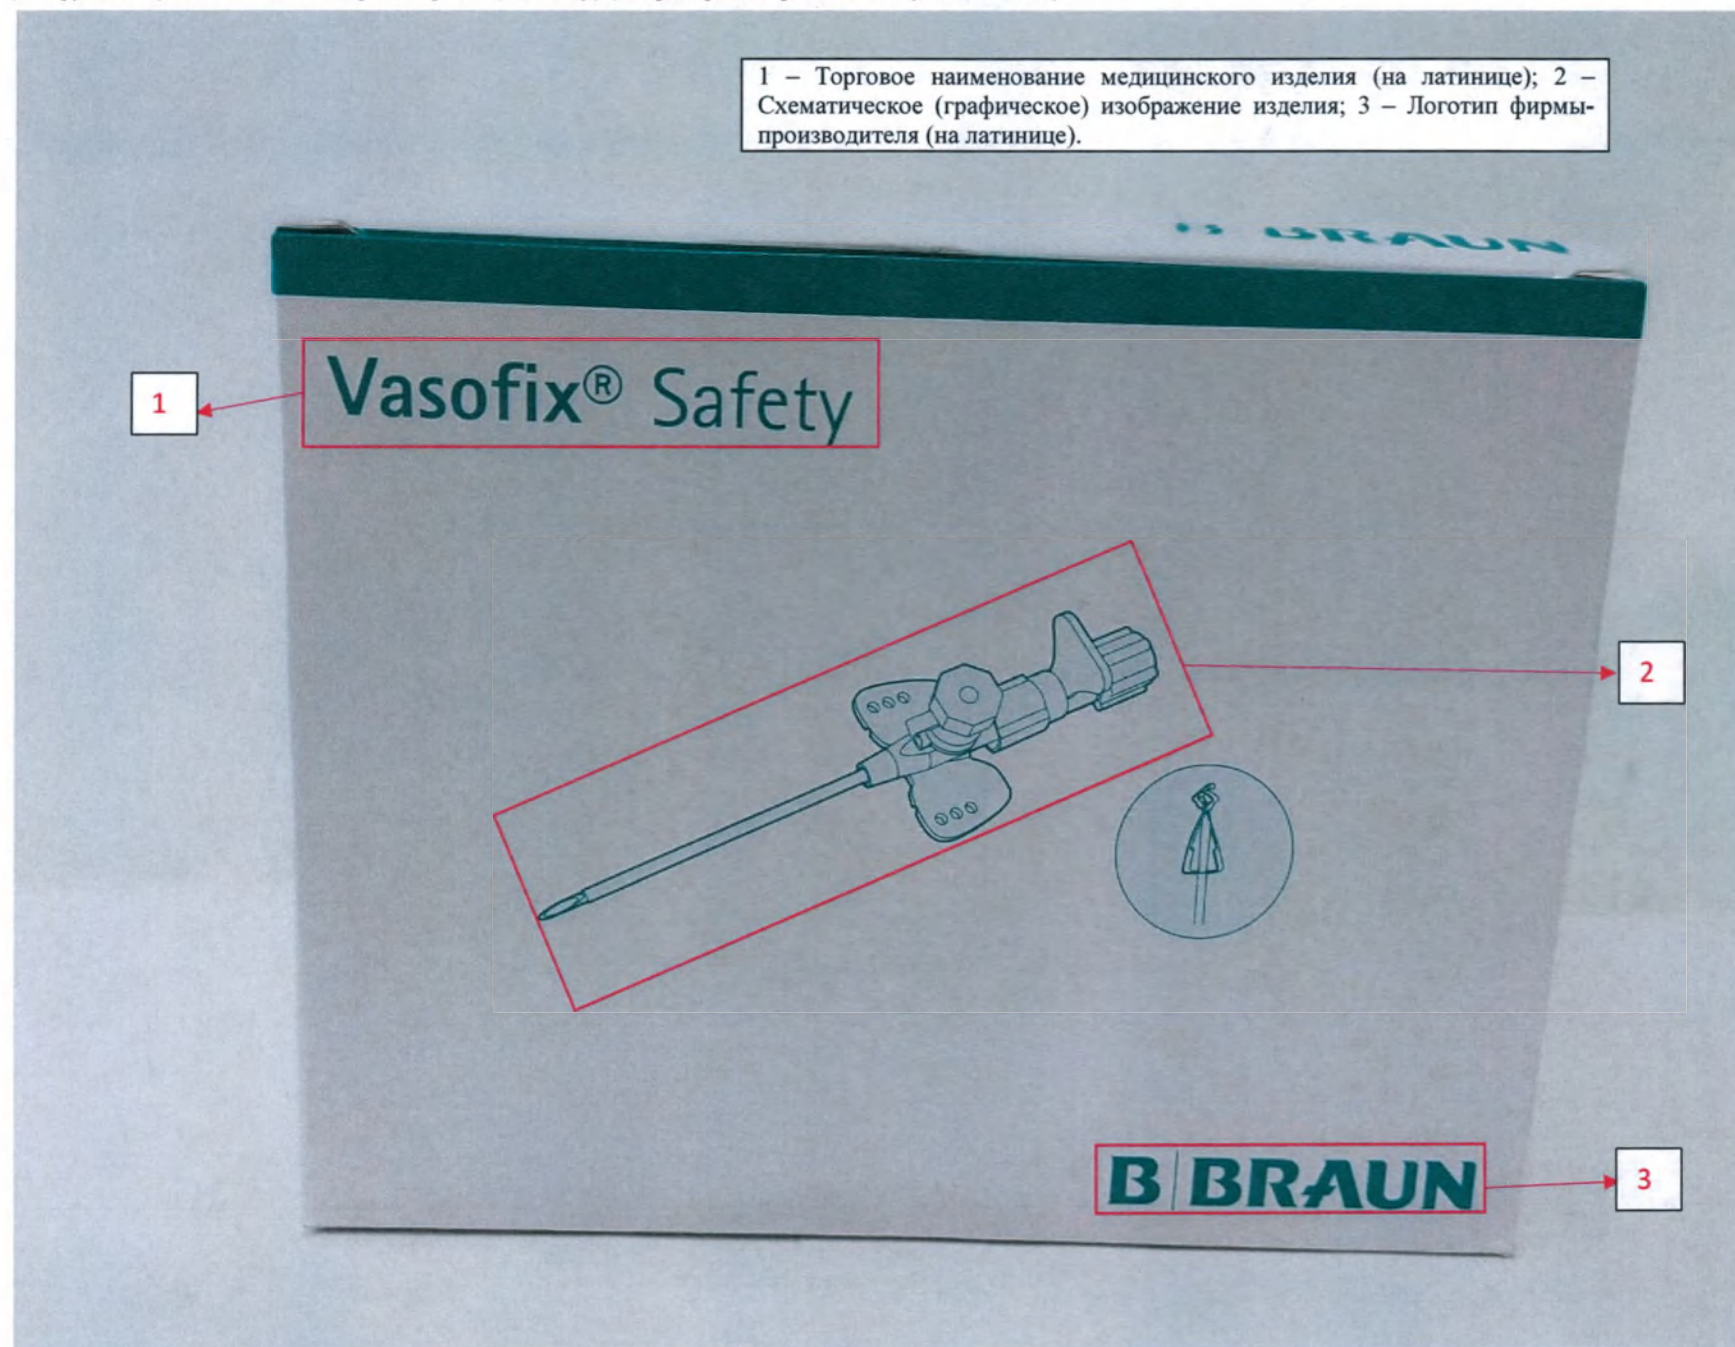


1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

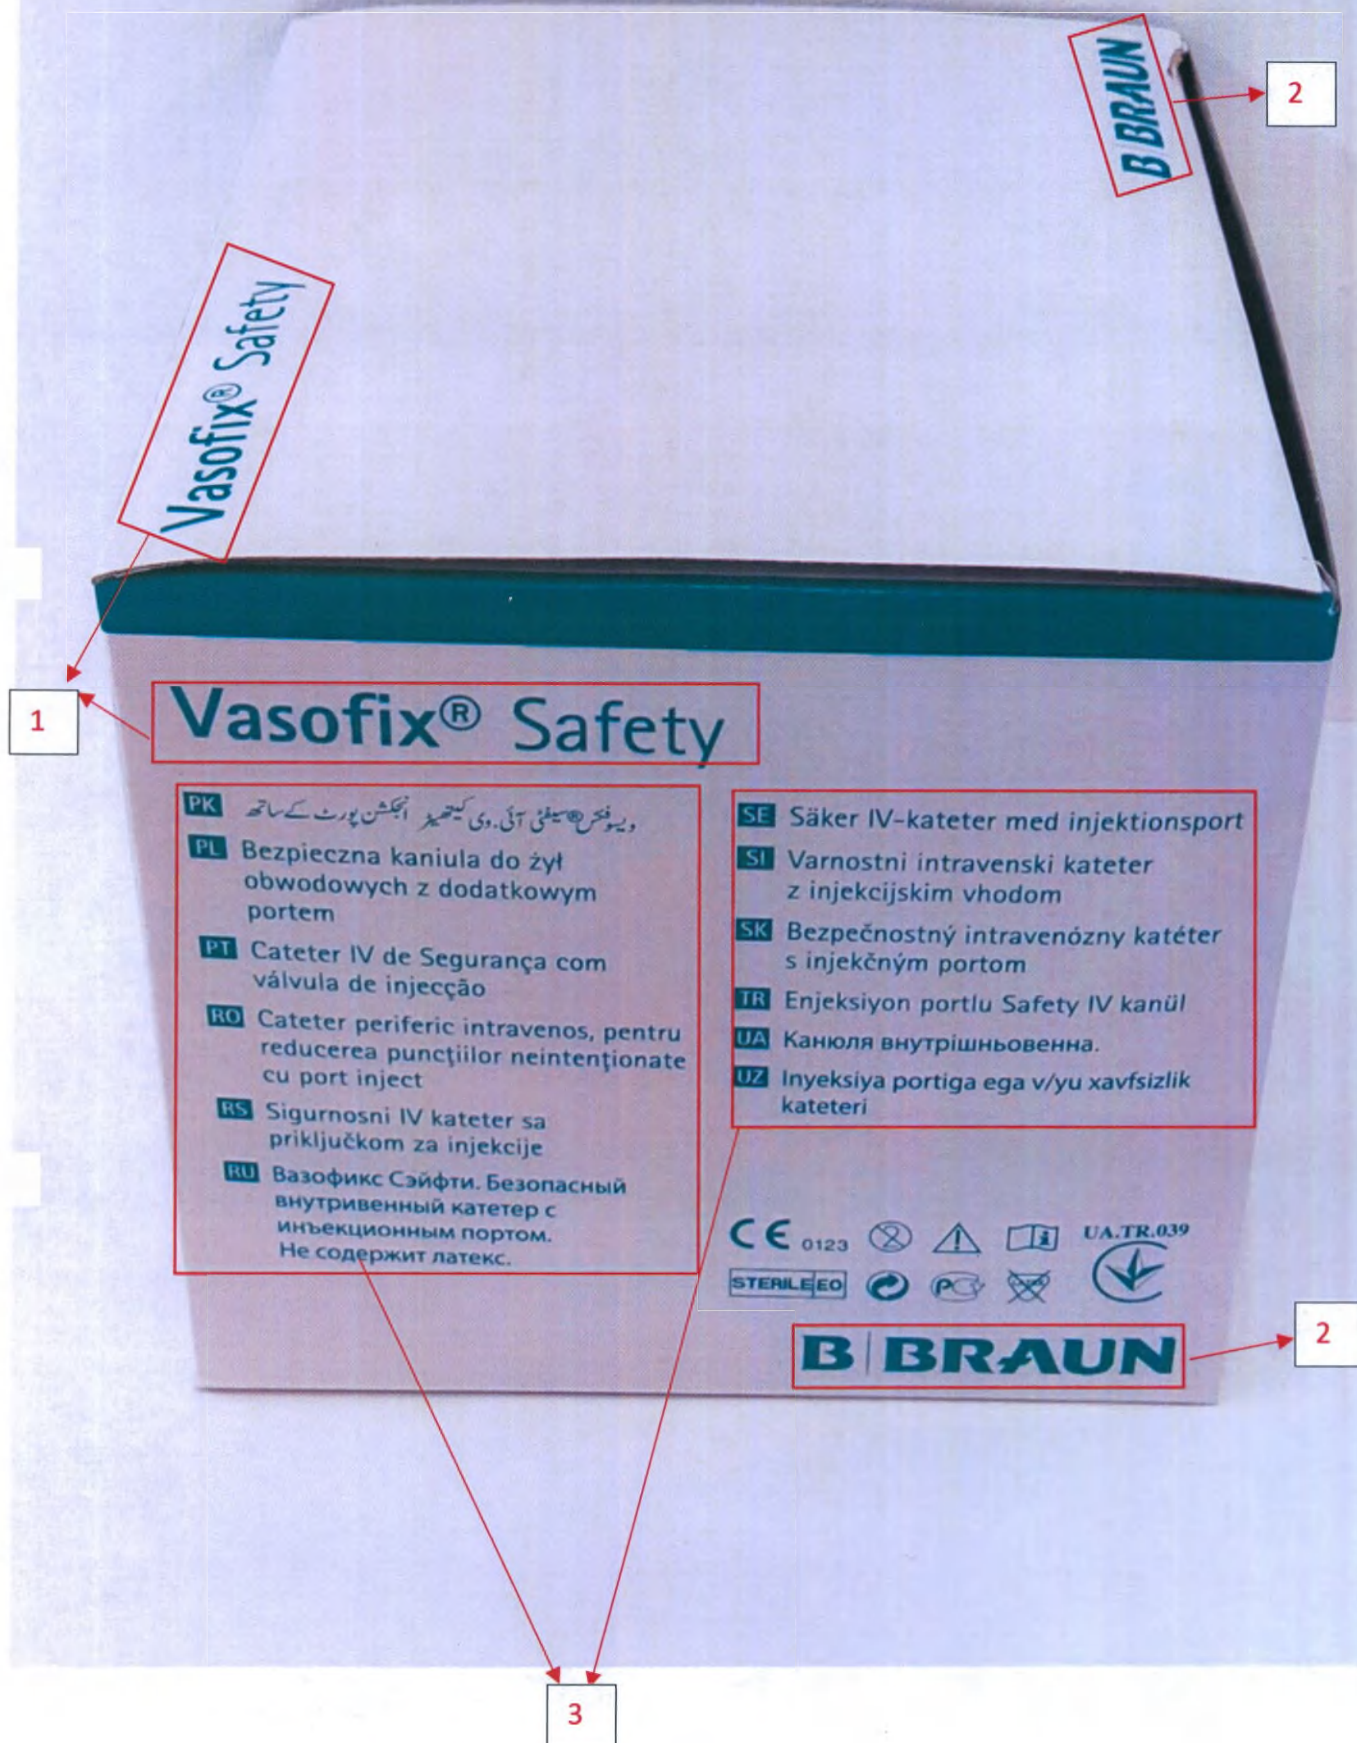

9) Катетер внутривенный безопасный Вазофикс® Сэйфти (Vasofix® Safety) с инъекционным портом.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)

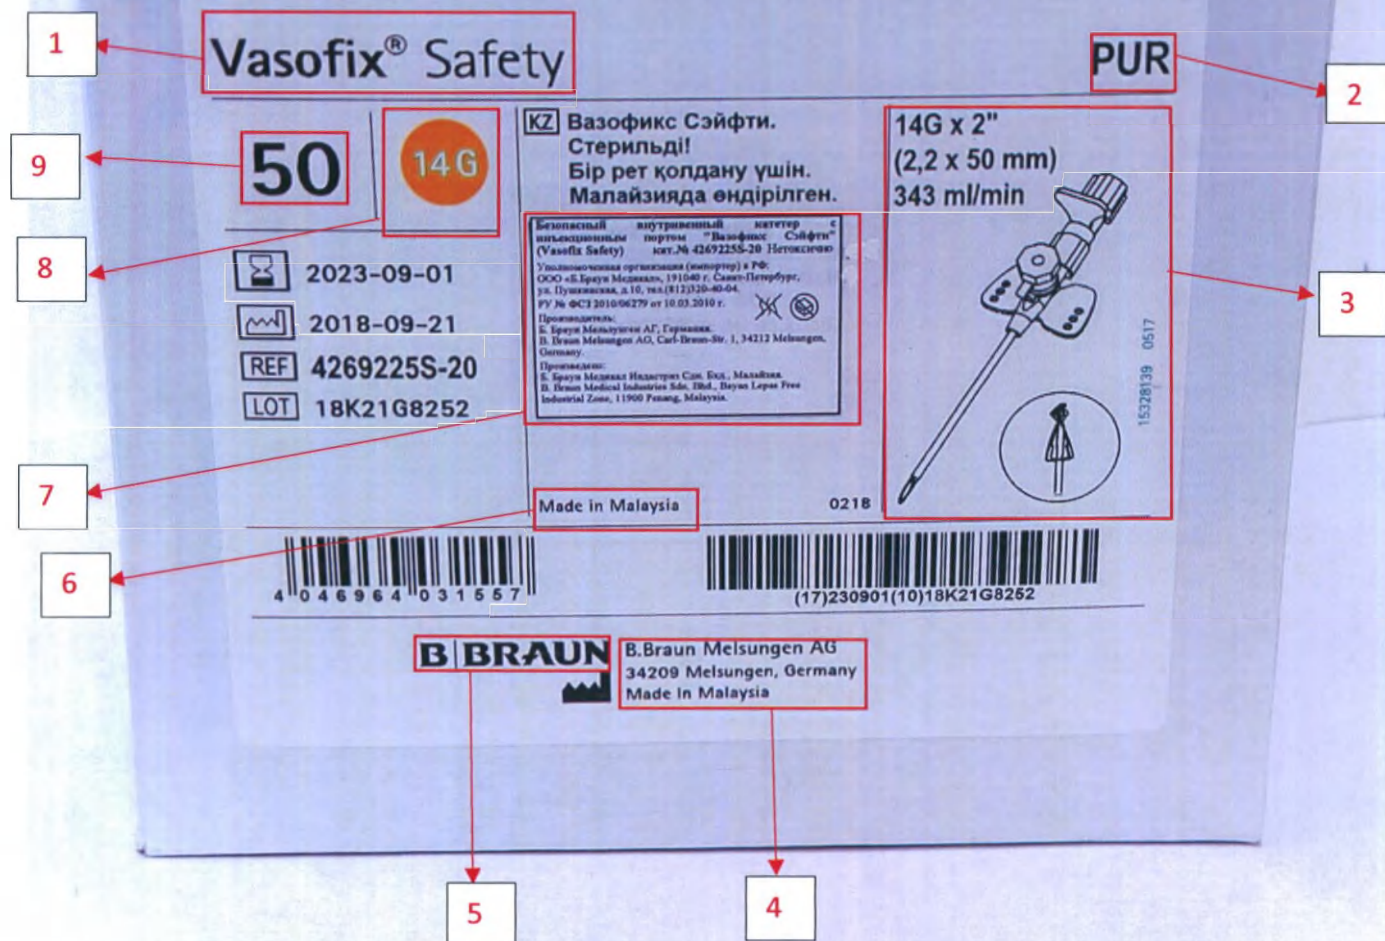


Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Указание, что основным материалом трубки катетера является полимер полиуретана (ПУР) (на латинице);
- 3 – Калибровочный размер катетера в Гейджах (G) и номинальная эффективная длина трубки катетера в дюймах (на латинице); Номинальный наружный диаметр трубки катетера в миллиметрах и номинальная эффективная длина катетера в миллиметрах (на латинице); Номинальная скорость потока (мл/мин) (на латинице); Схематическое (графическое) изображение изделия; Символ «Устройство защиты от укола иглой»;
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя (на латинице); Страна места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 6 – Страна места производства (на латинице);
- 7 – Информация на стикере: - Наименование медицинского изделия (на кириллице); - Номер по каталогу; - Наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ; - Номер и дата регистрационного удостоверения в РФ; - Наименование и юридический адрес производителя; - Наименование и адрес места производства; - Указание «Нетоксично» (на кириллице); - Символ «Апирогенно»; Символ «Не использовать при повреждении упаковки».
- 8 – Количество изделий в упаковке, шт.;
- 9 – Цветовое кодирование катетера, изображенное в виде закрашенного круга с вписанным в него калибровочным размером катетера.


После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере номера по каталогу 4269225S-20)

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Схематическое (графическое) изображение изделия; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

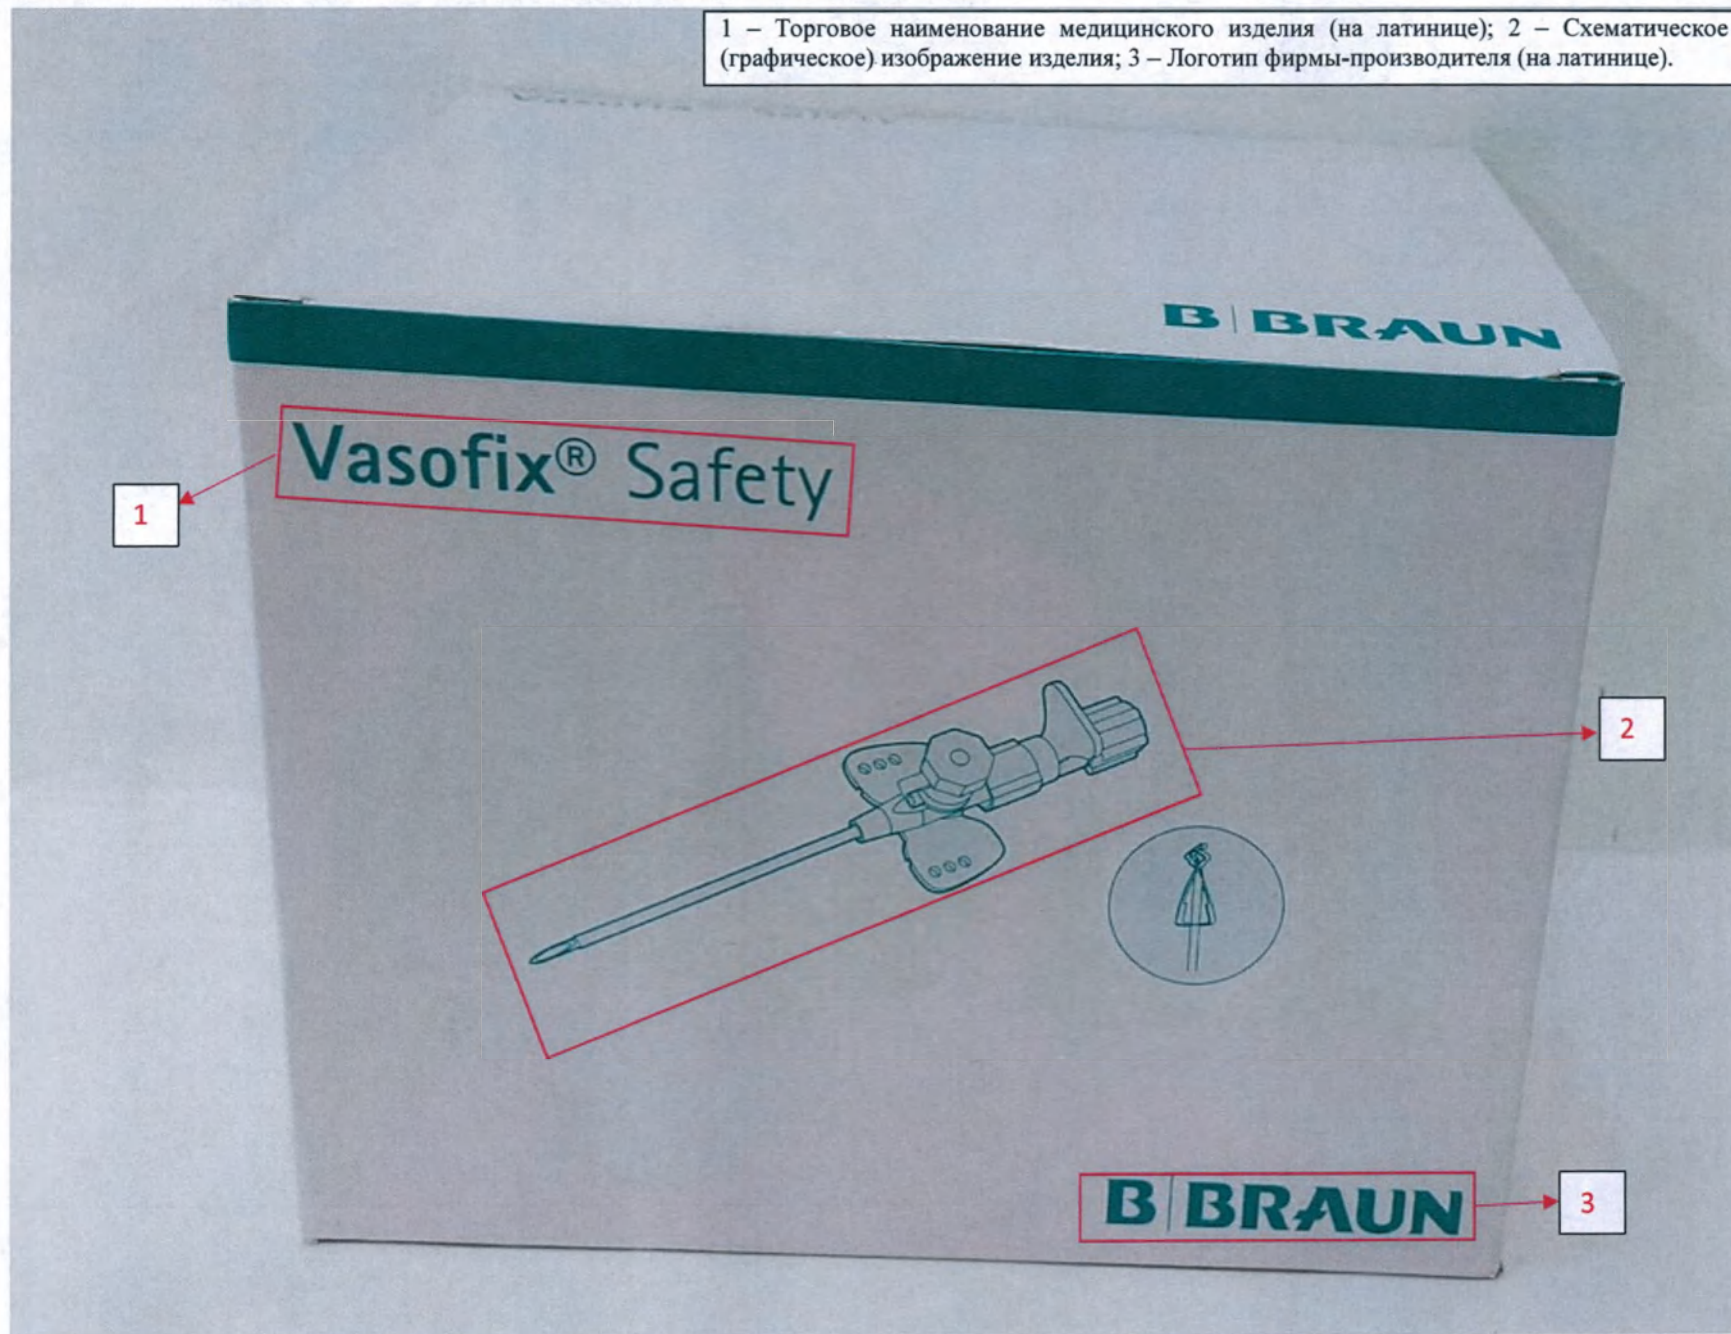

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально)

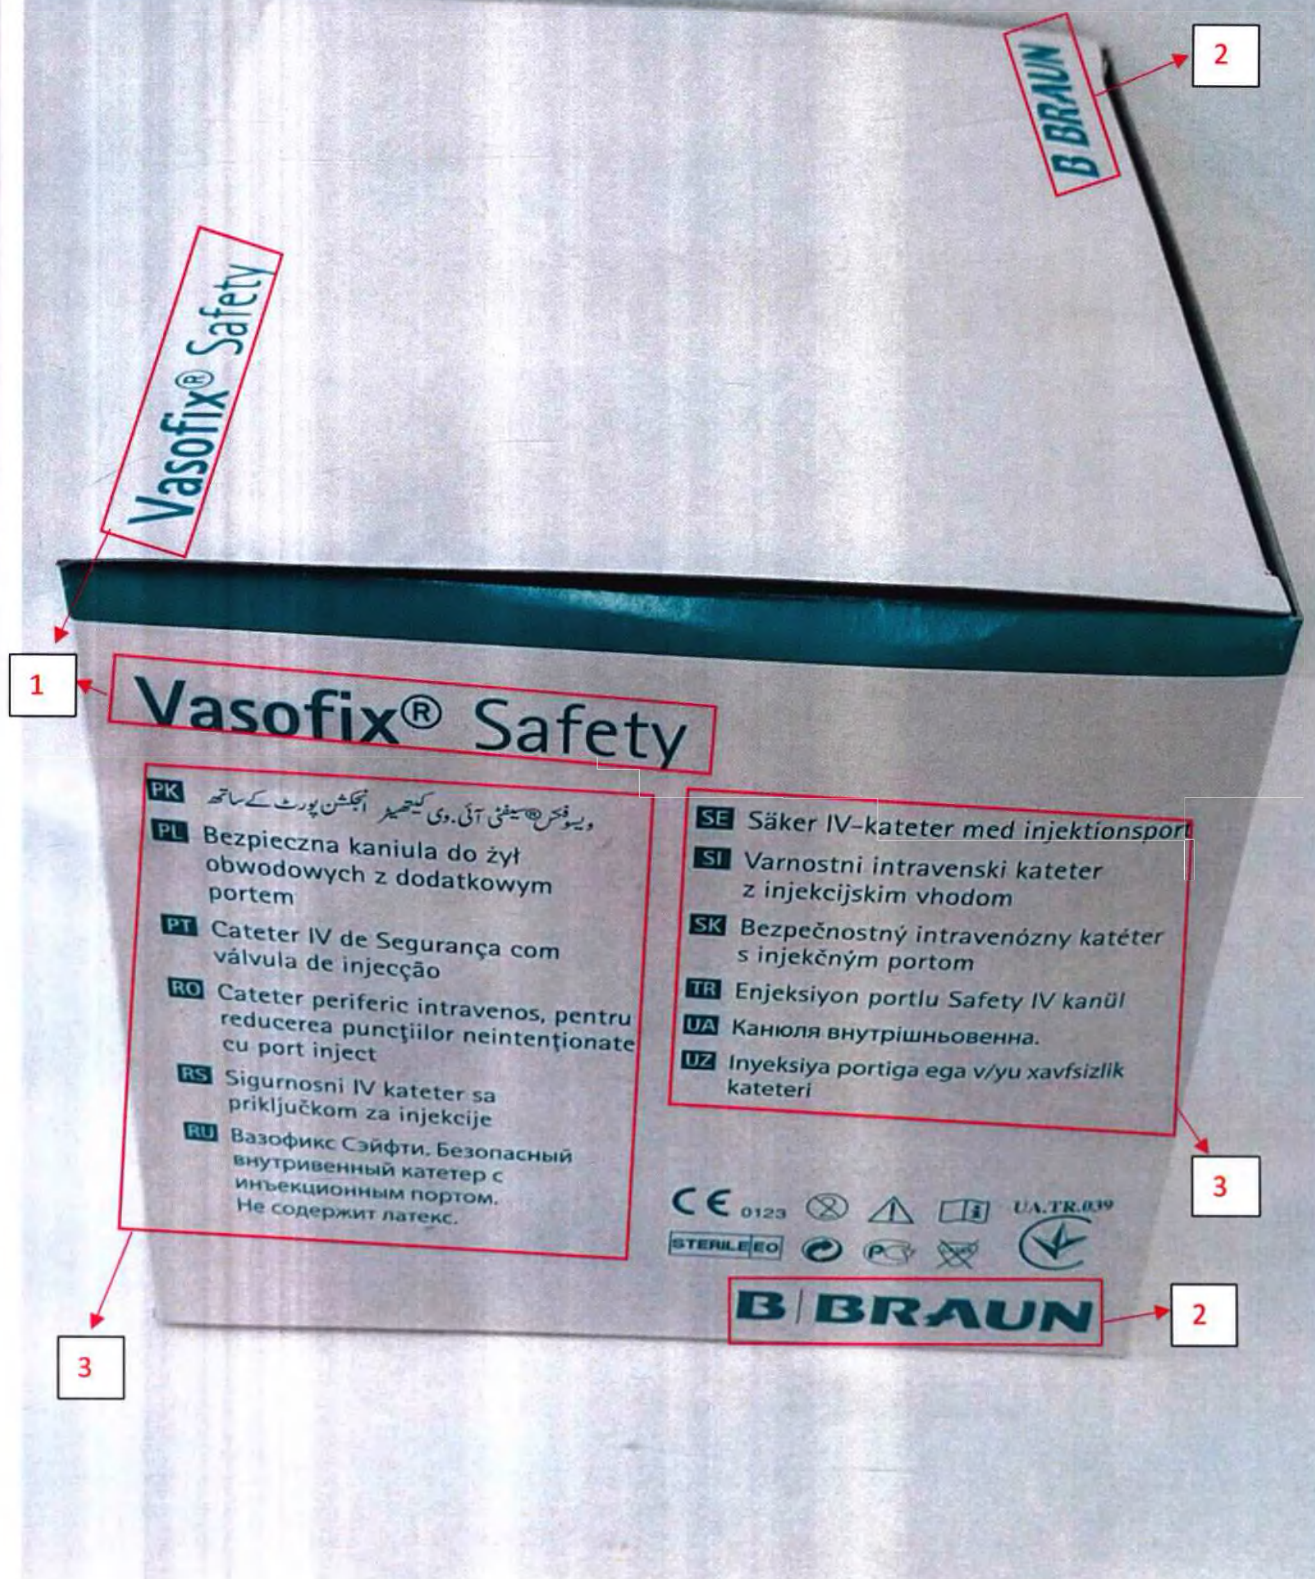

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 48

(срок восемь) листа(ов).

Директор по регуляторным отношениям
и связям с органами государственной
власти

Пашков И.В.

(подпись)

М.П.

«04» октября 2022 года

