

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого
герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«HSV-2 IgG Калибратор для ARCHITECT (HSV-2 IgG Calibrator)»**

IVD

CE

0123





HSV-2 IgG Calibrator

FOR USE WITH
ARCHITECT

CAL

1

CAL	1	1 x	4.0 mL
-----	---	-----	--------



CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Blokit, S.A.
Av. Can Montcau 7
08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona, Spain

The graph shows the temperature of water as it is heated. The x-axis represents time in minutes, and the y-axis represents temperature in degrees Celsius. The graph shows a steady increase in temperature from 2°C to 8°C over a period of 10 minutes.



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finiskin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

PRODUCT OF SPAIN

HSV-2 IgG Calibrator

FOR USE WITH
ARCHITECT



HSV-2 IgG

REF 04U6001

H21272R01

S4U600

Created June 2021.

Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of
results cannot be guaranteed if there are any deviations from

The following warnings and precautions apply to: **CAL 1**

(01) 00380740196516 (17) 220709
(10) 00121H000 (240) 04U6001

Exp. 2022-07-09
Lot 00121H000



REF 04U6001 HSV-2 IgG Cal R01
www.corelaboratory.abbott/IFU

CE IVD 0123

HSV-2 IgG Calibrator

FOR USE WITH ARCHITECT

CAL 1 1 x 4.0 mL

CONTAINS, AZIDE

WARNING, SENSITIZER

PRODUCED FOR ABBOTT BY
BioRx, S.A.
Av. Can Montcau 7
08100 Lliga d'Armunt
Barcelona, Spain

Abbott brand
Diagnostic Division
Frederick, Maryland, USA
+33-71-877712
PRODUCT OF SPAIN
Abbott

HSV-2 IgG Calibrator

FOR USE WITH ARCHITECT

REF 04U6001
H2127R01
SAU600

Created June 2021.



Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of
any results cannot be guaranteed if there are any deviations from
instructions in this package insert.
laboratory professional use only.



WARNING

Contains methylisothiazolone and sodium
azide.



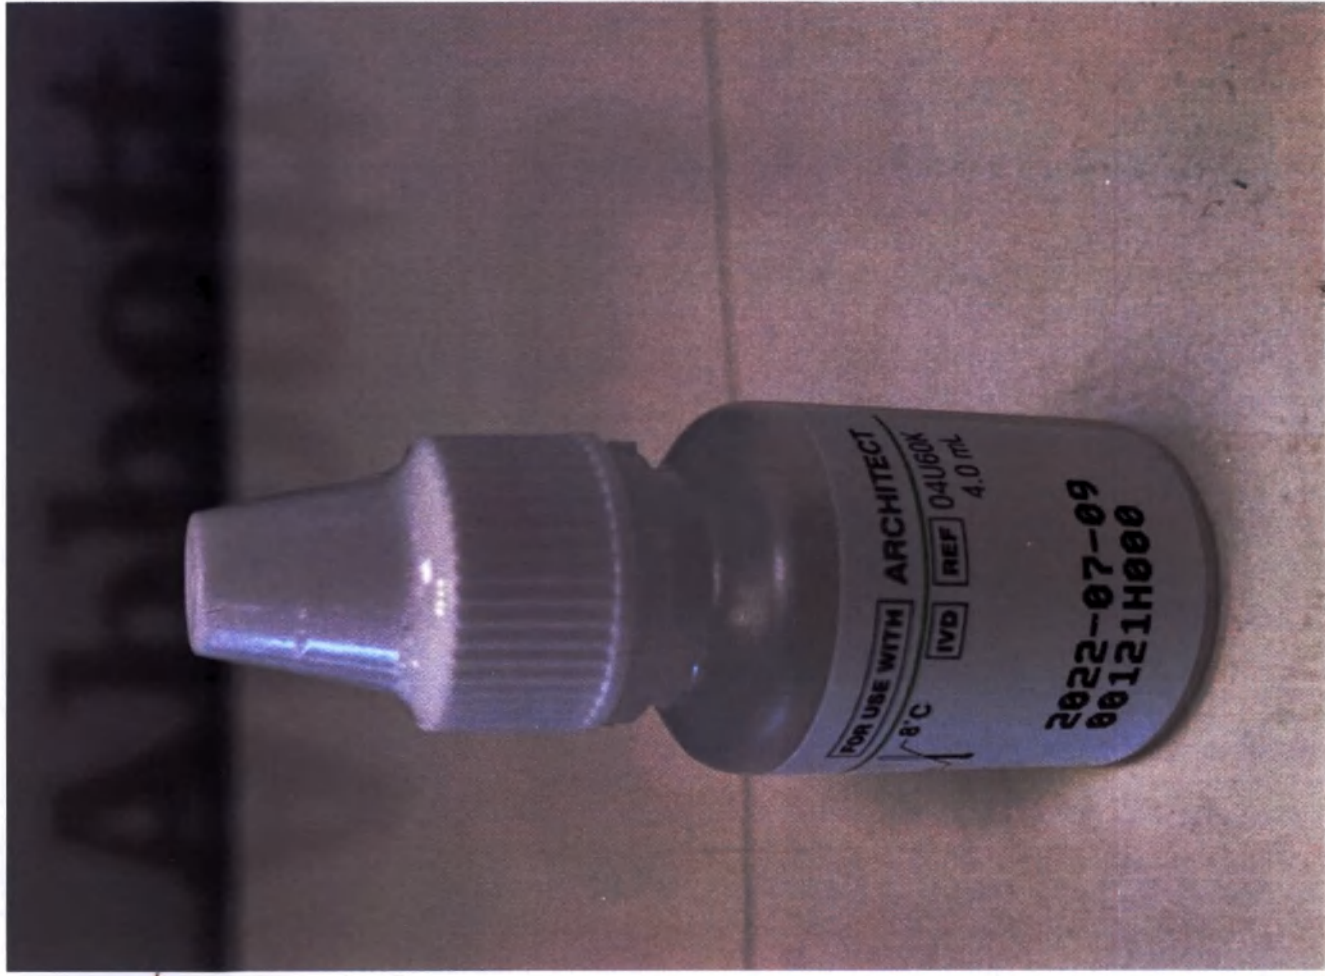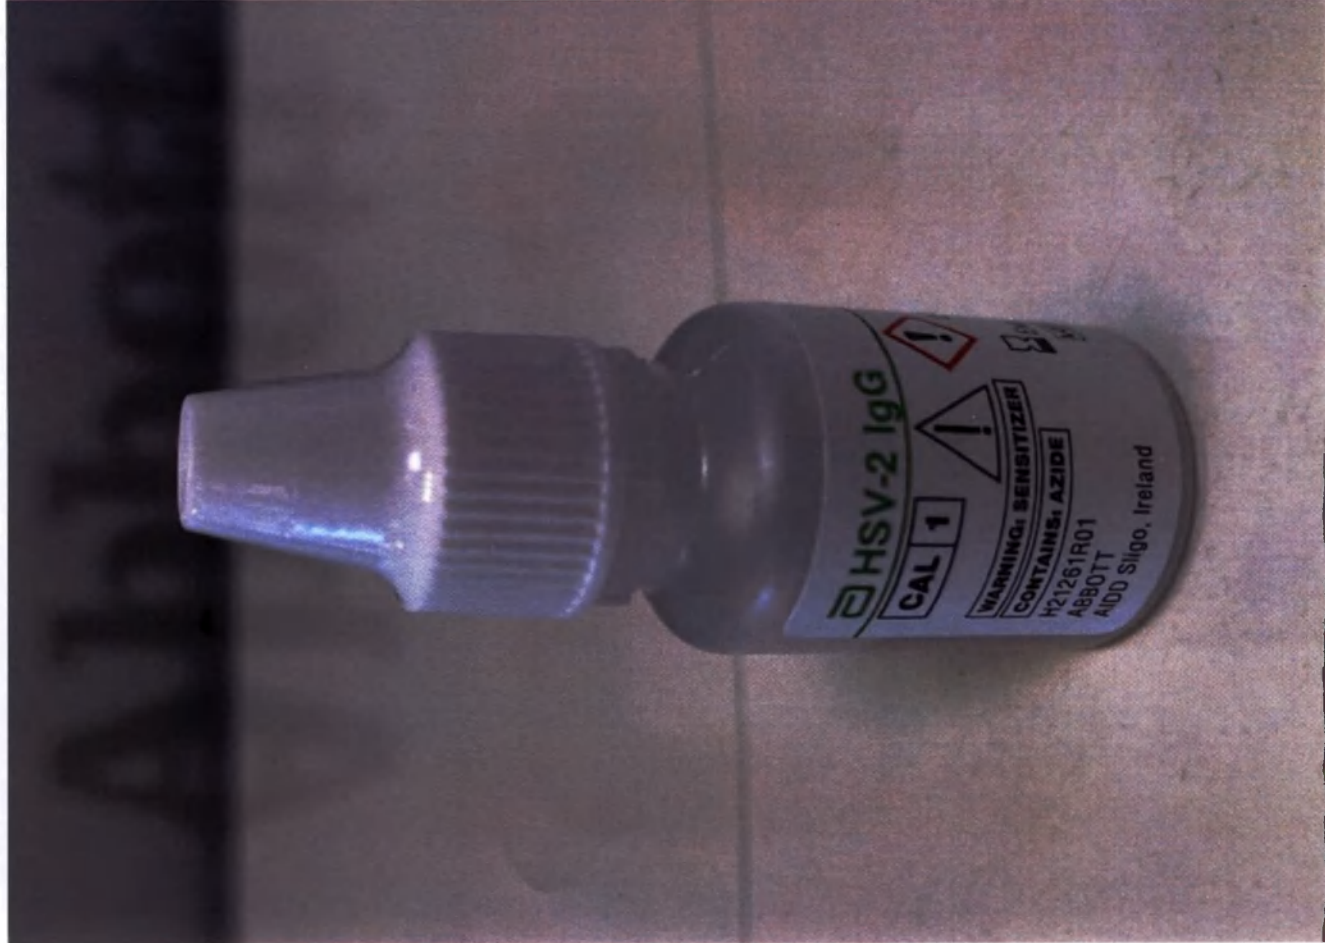

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ листов



Подпись

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого
герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«HSV-2 IgG Калибратор для ARCHITECT (HSV-2 IgG Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



04U6001




Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «HSV-2 IgG Калибратор для ARCHITECT (HSV-2 IgG Calibrator)»

В составе: Калибратор 1 (ARCHITECT HSV-2 IgG CAL 1) - 1 флакон х 4,0 мл; Инструкция по применению/ Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/ / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.
Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:
ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HSV-2 IgG Калибратор для ARCHITECT (HSV-2 IgG Calibrator)

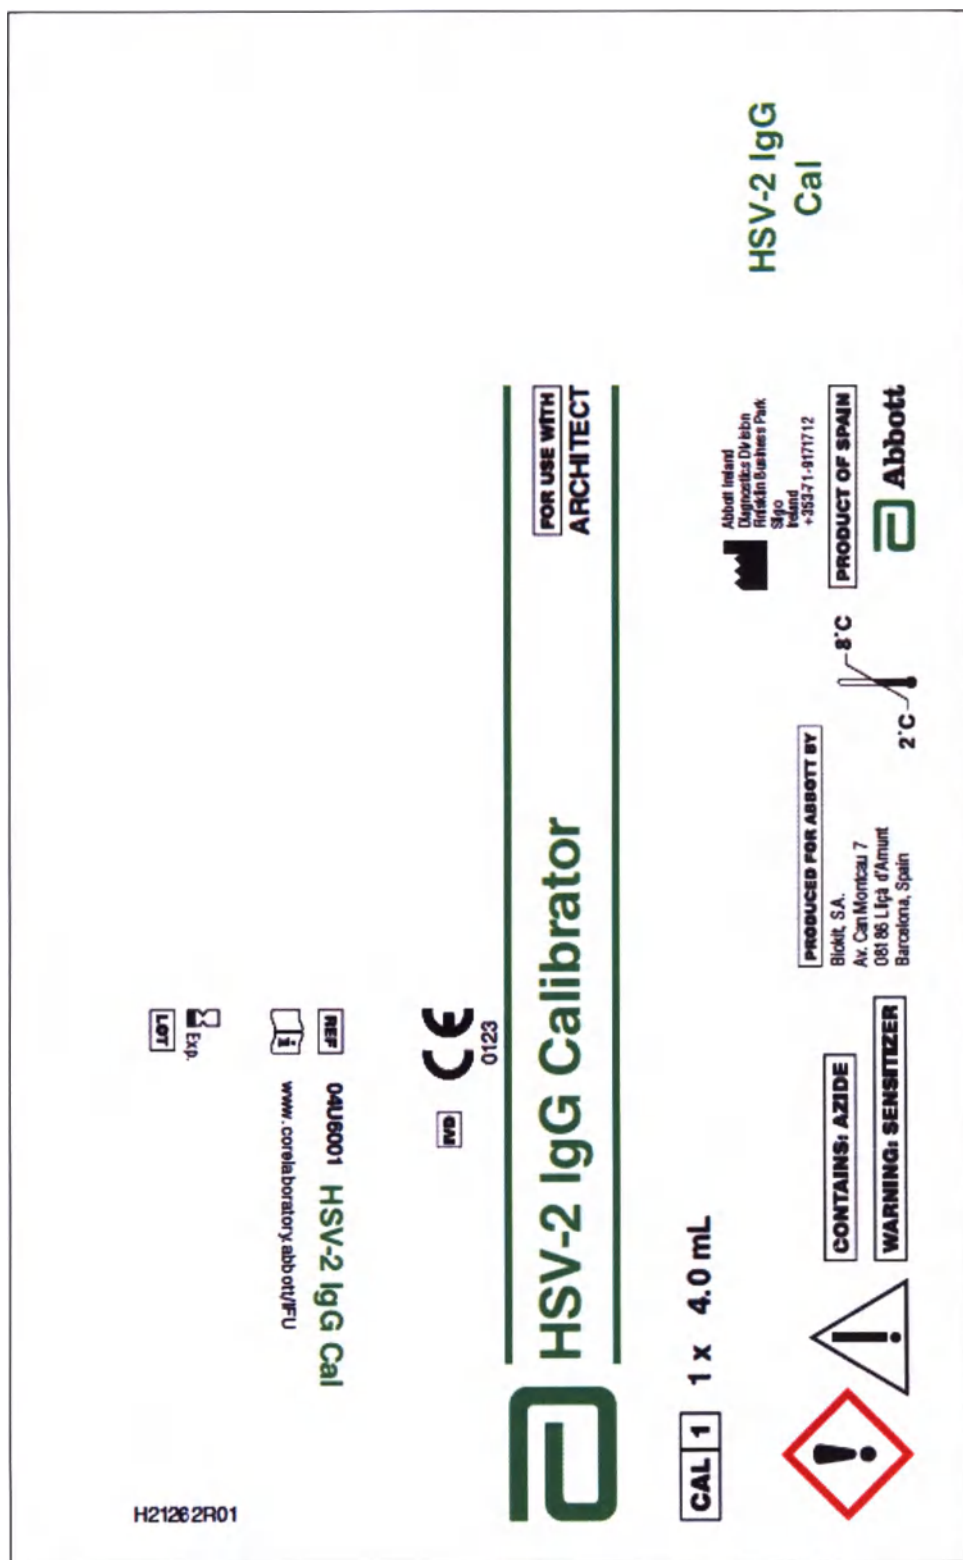

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (ARCHITECT HSV-2 IgG CAL 1)

