

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-1 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-1 IgG Calibrator)»**

HSV-1 IgG Calibrator

 Abbott

CAL 1

1 x 3.0 mL



CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER



www.corelaboratory.abbott/IFU

REF

04W2001

R01



Exp.


2022-06-06

LOT

01047L821



H21246R01




(01) 00380740196493 (17) 220606

(10) 01047L821 (240) 04W2001 (91) HSV-1 IgG



HSV-1 IgG Calibrator

FOR USE WITH
Alinity i



HSV-1 IgG

REF 04W2001


H21251R01


S4W200



Created June 2021.

Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from instructions in this package insert.
For professional use only.

The following warnings and precautions apply to: **CAL 1**



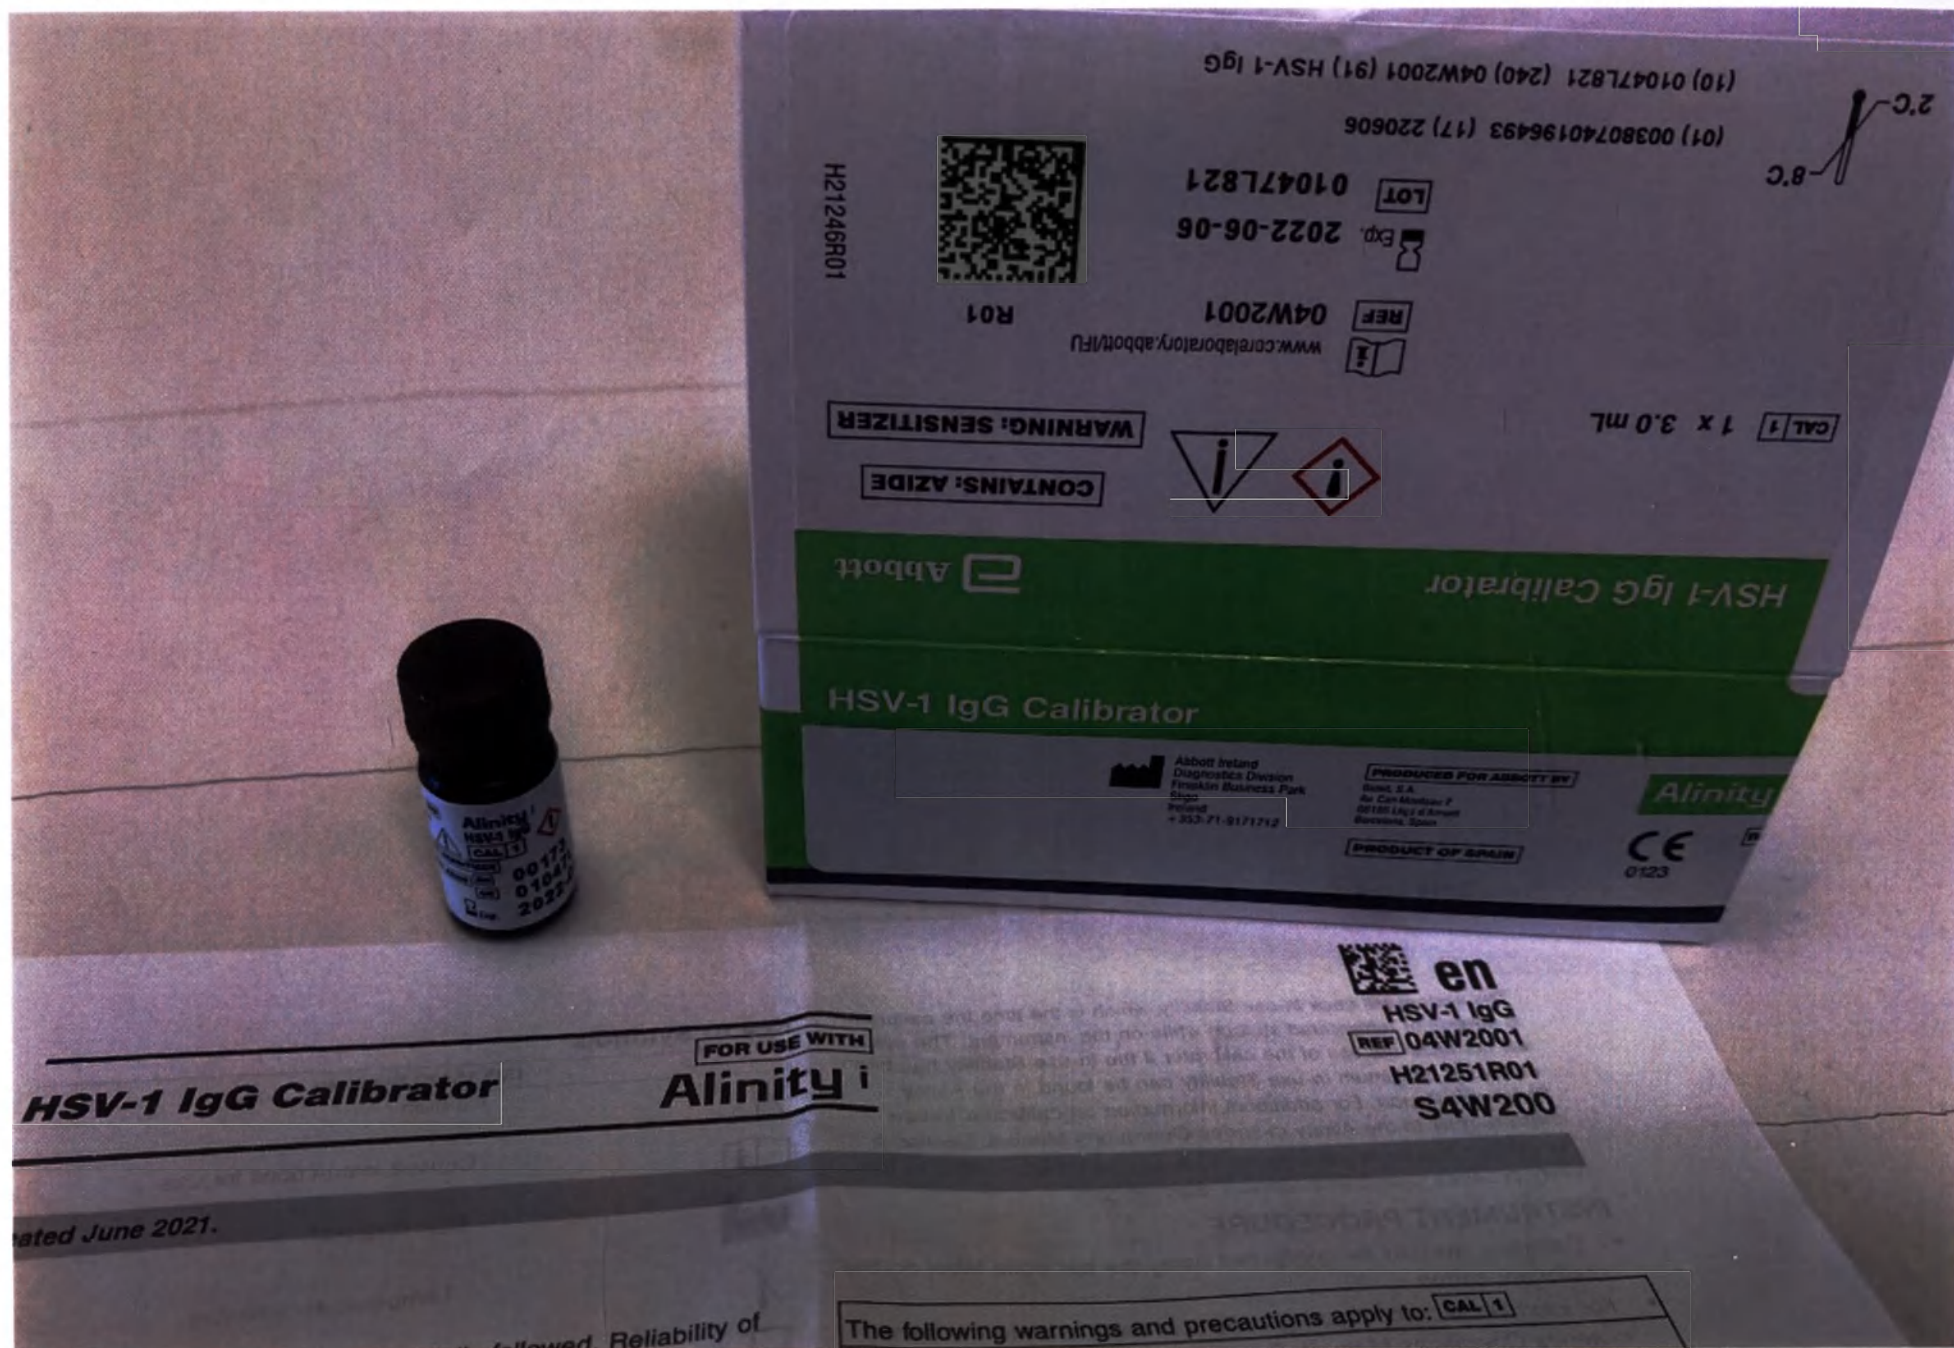

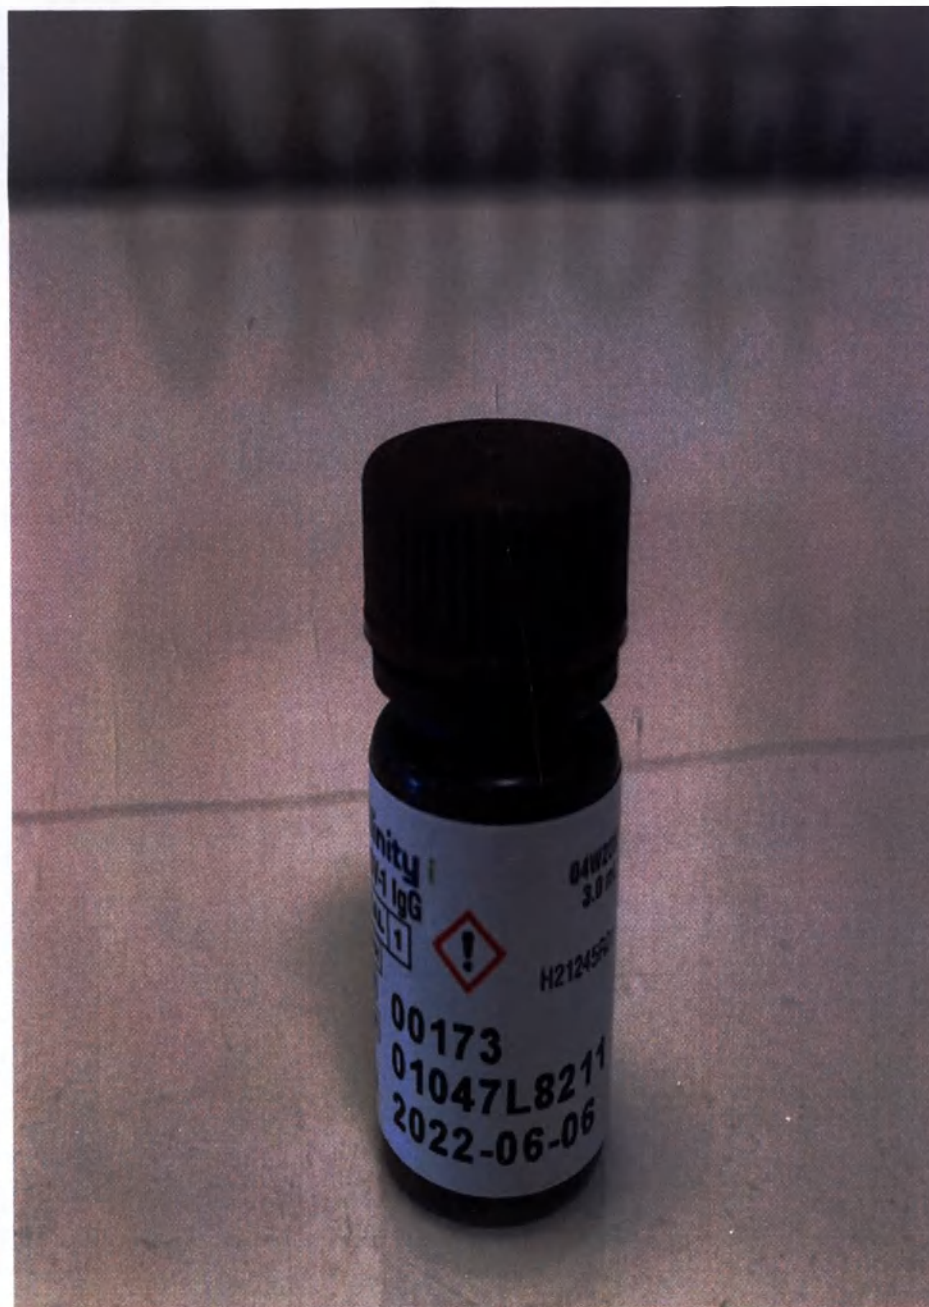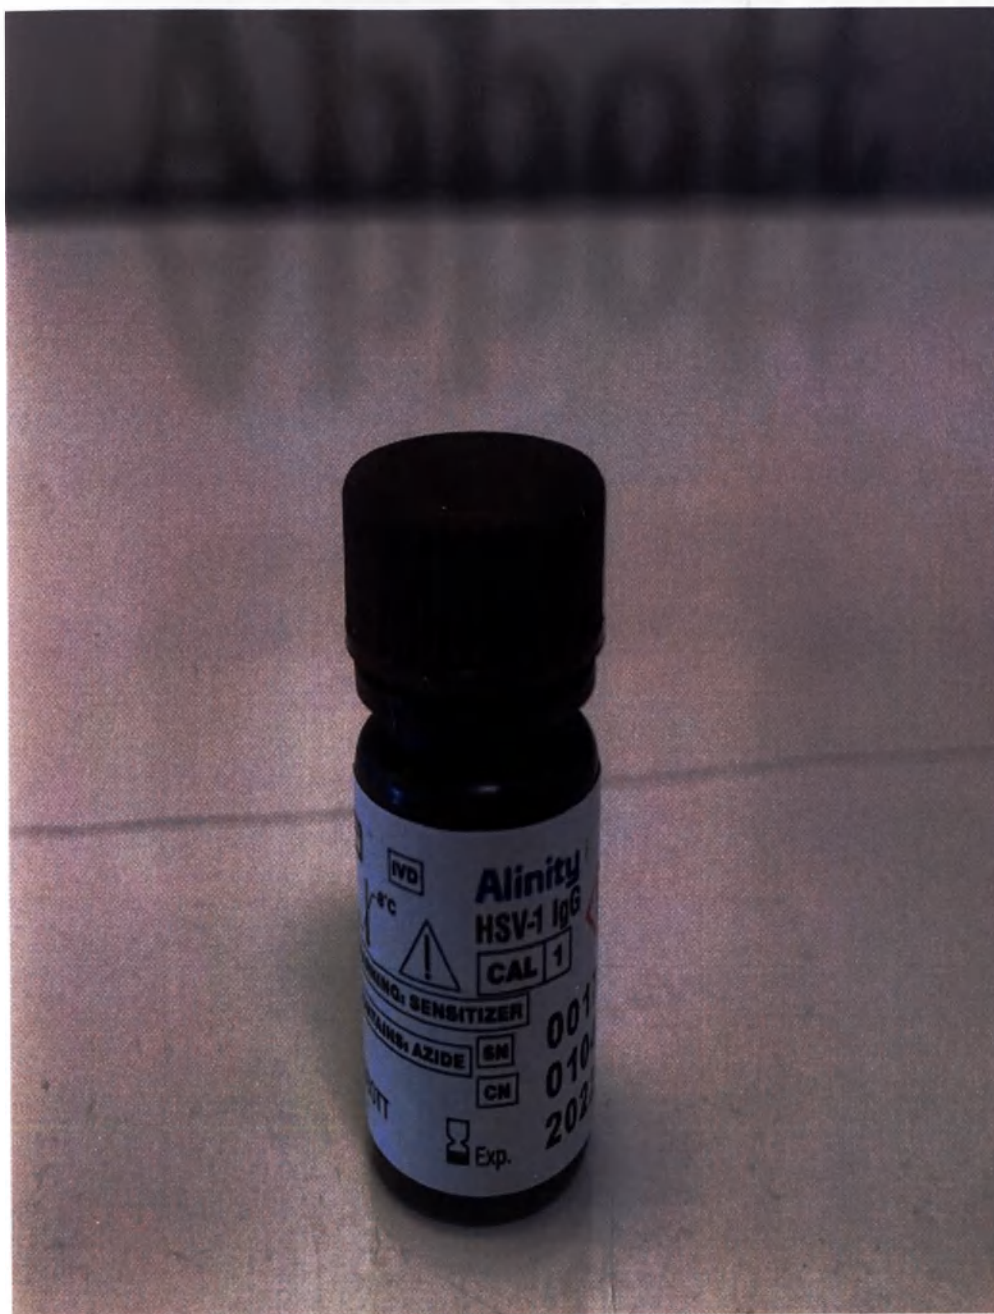



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого
герпеса 1 типа (HSV-1), иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-1 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-1 IgG Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



REF 04W2001

IVD



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HSV-1 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-1 IgG Calibrator)».

В составе: Калибратор 1 (Alinity i HSV-1 IgG CAL 1) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению/Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1


Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HSV-1 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-1 IgG Calibrator)

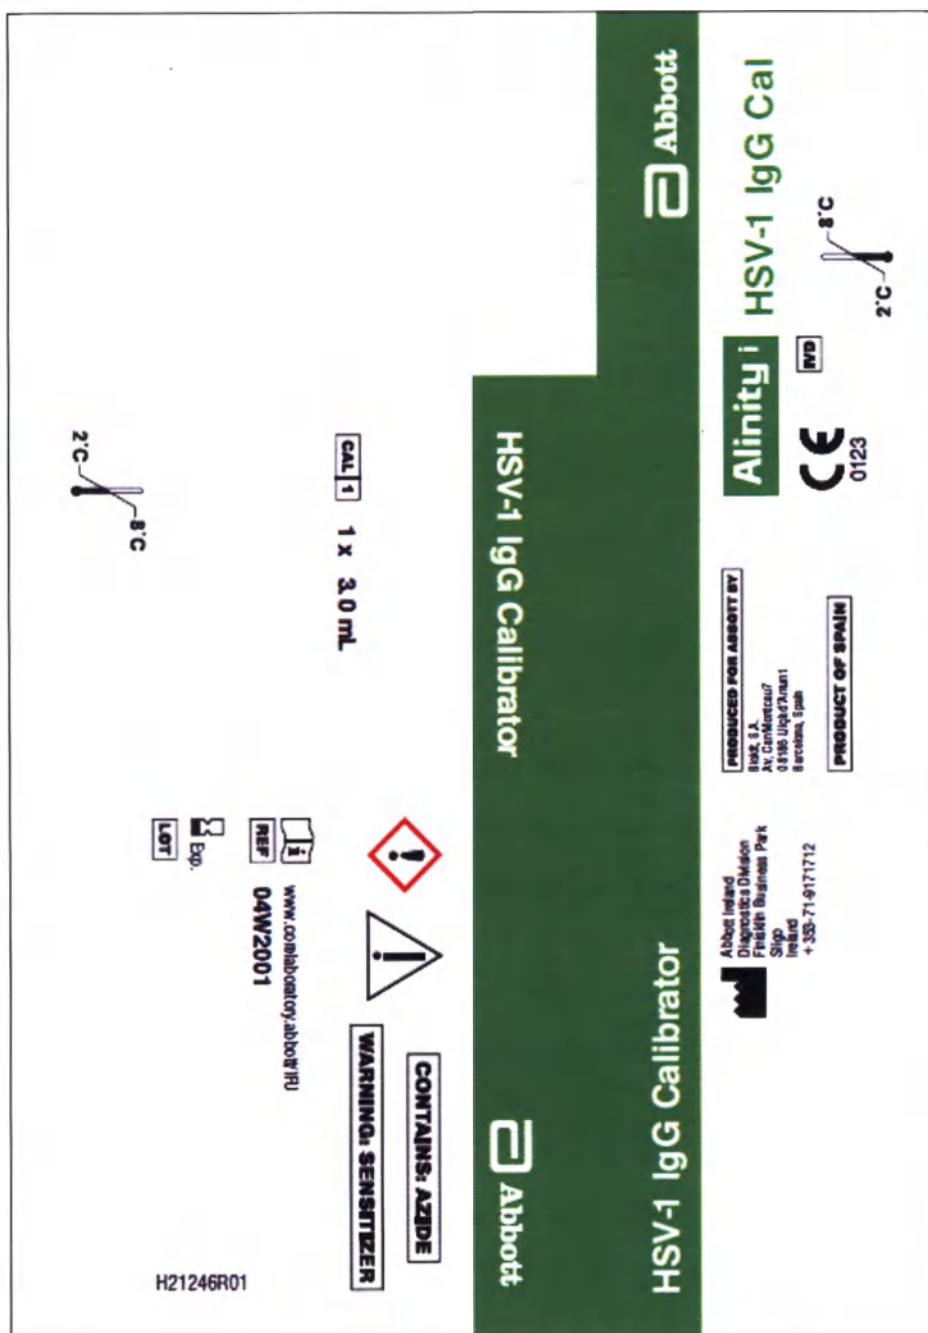

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (Alinity i HSV-1 IgG CAL 1)

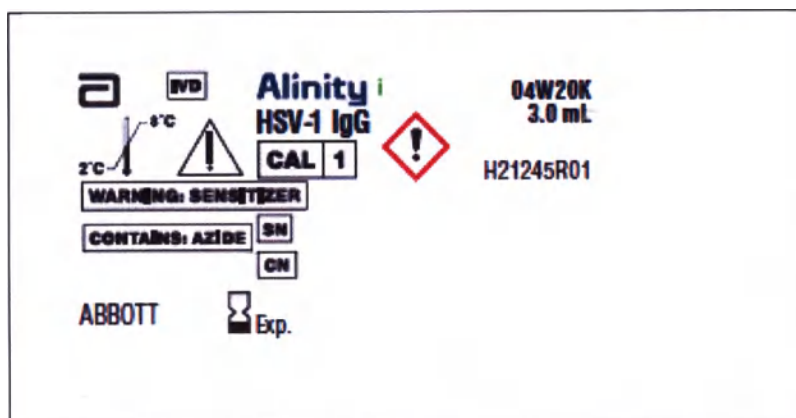

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

