


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-1 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-1 IgG Controls)»**

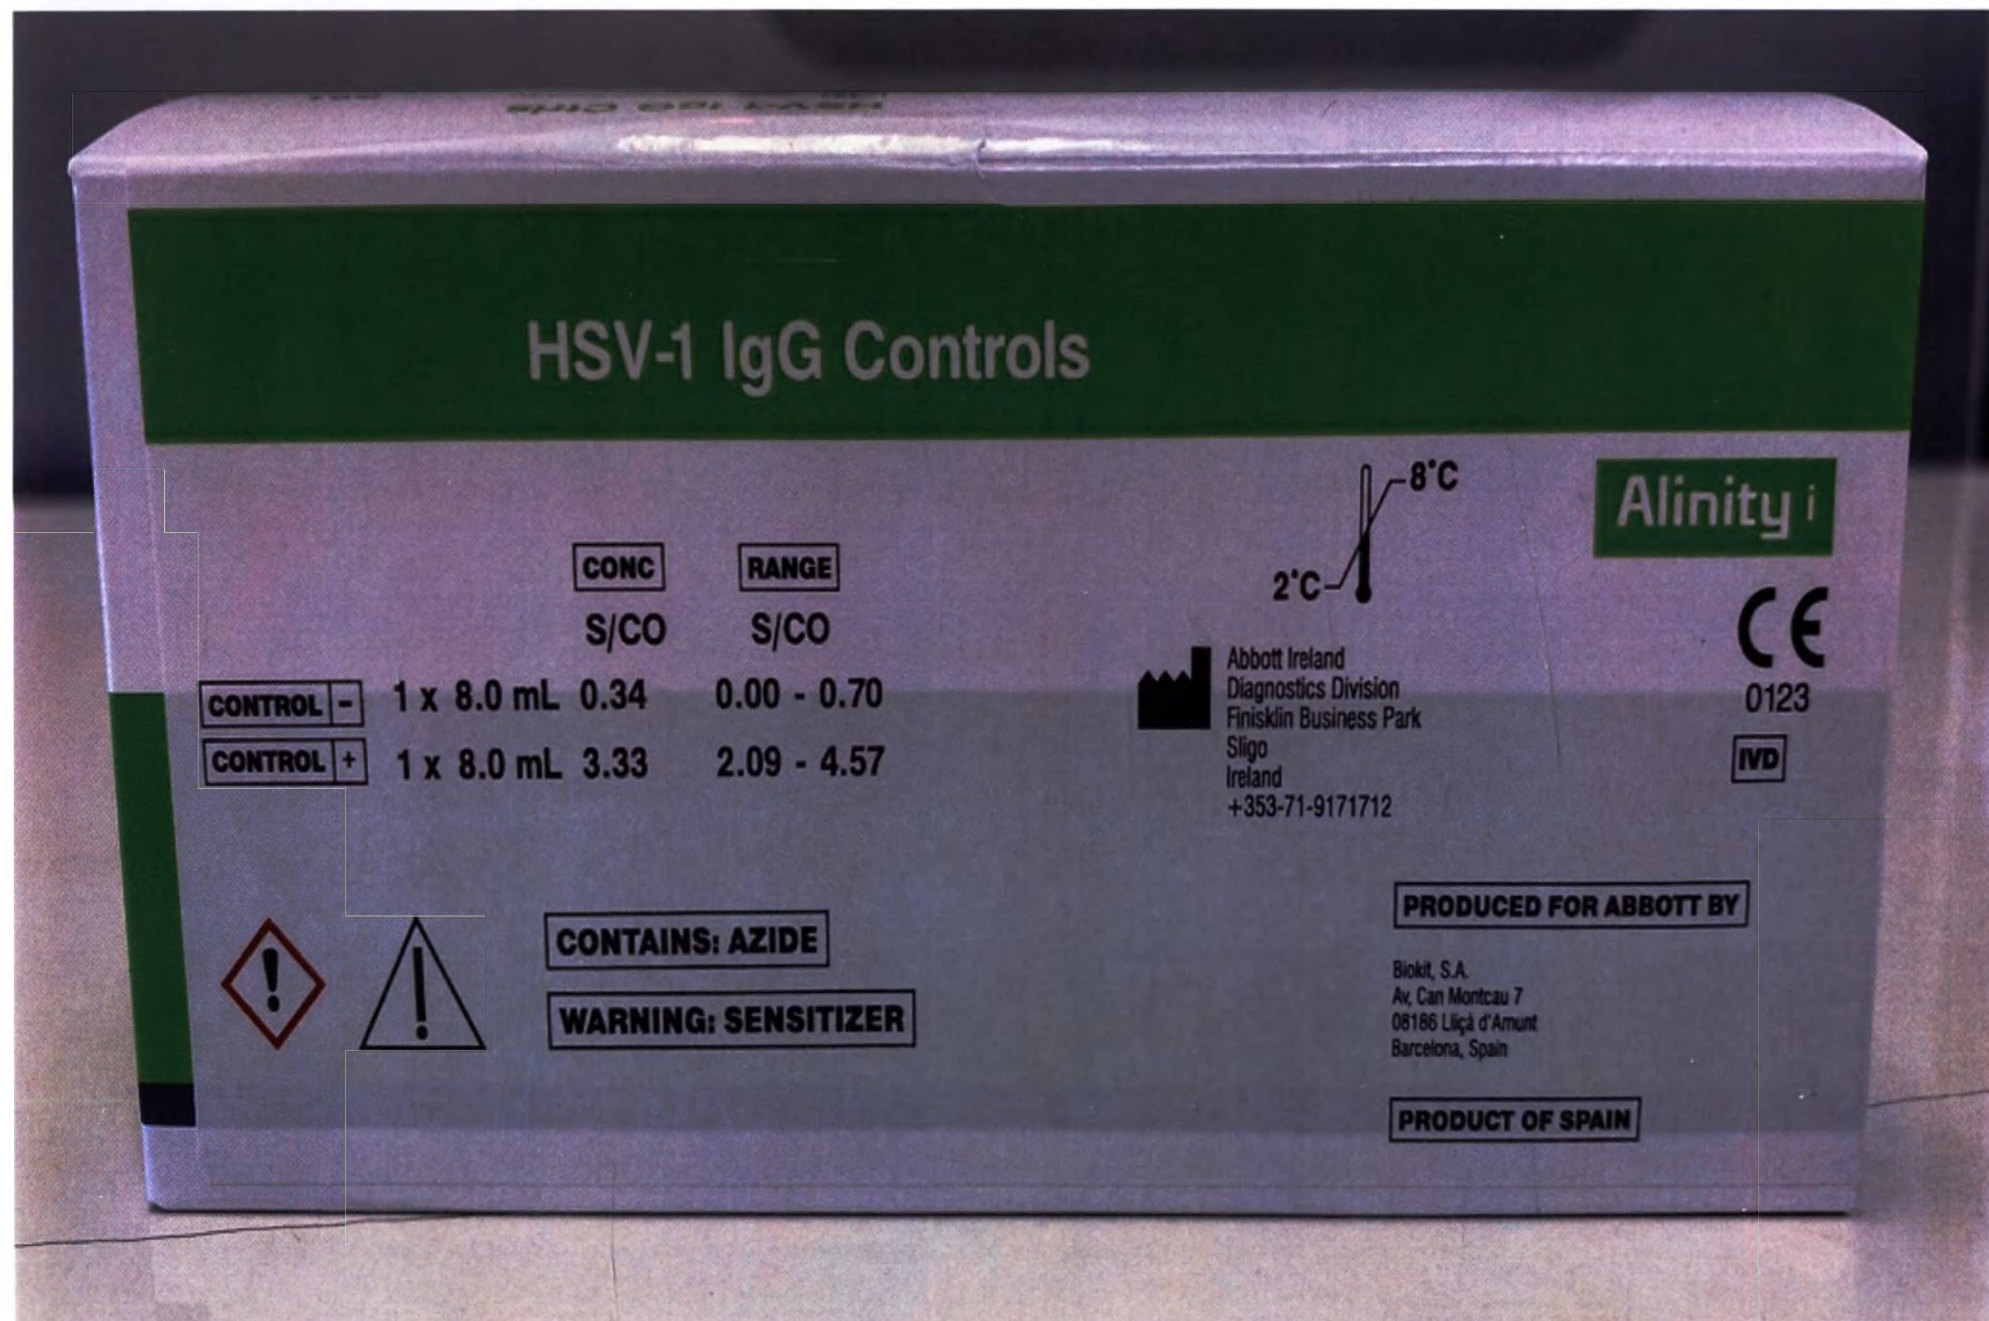

Фотографическое изображение МИ ИВД HSV-1 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-1 IgG Controls), упаковка, вид изнутри

HSV-1 IgG Controls

FOR USE WITH
Alinity i



HSV-1 IgG

REF 04W2010

H21252R01

C4W200

Created June 2021.


Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this package insert.

For laboratory professional use only.

Safety Precautions



CAUTION: This product contains human-sourced and/

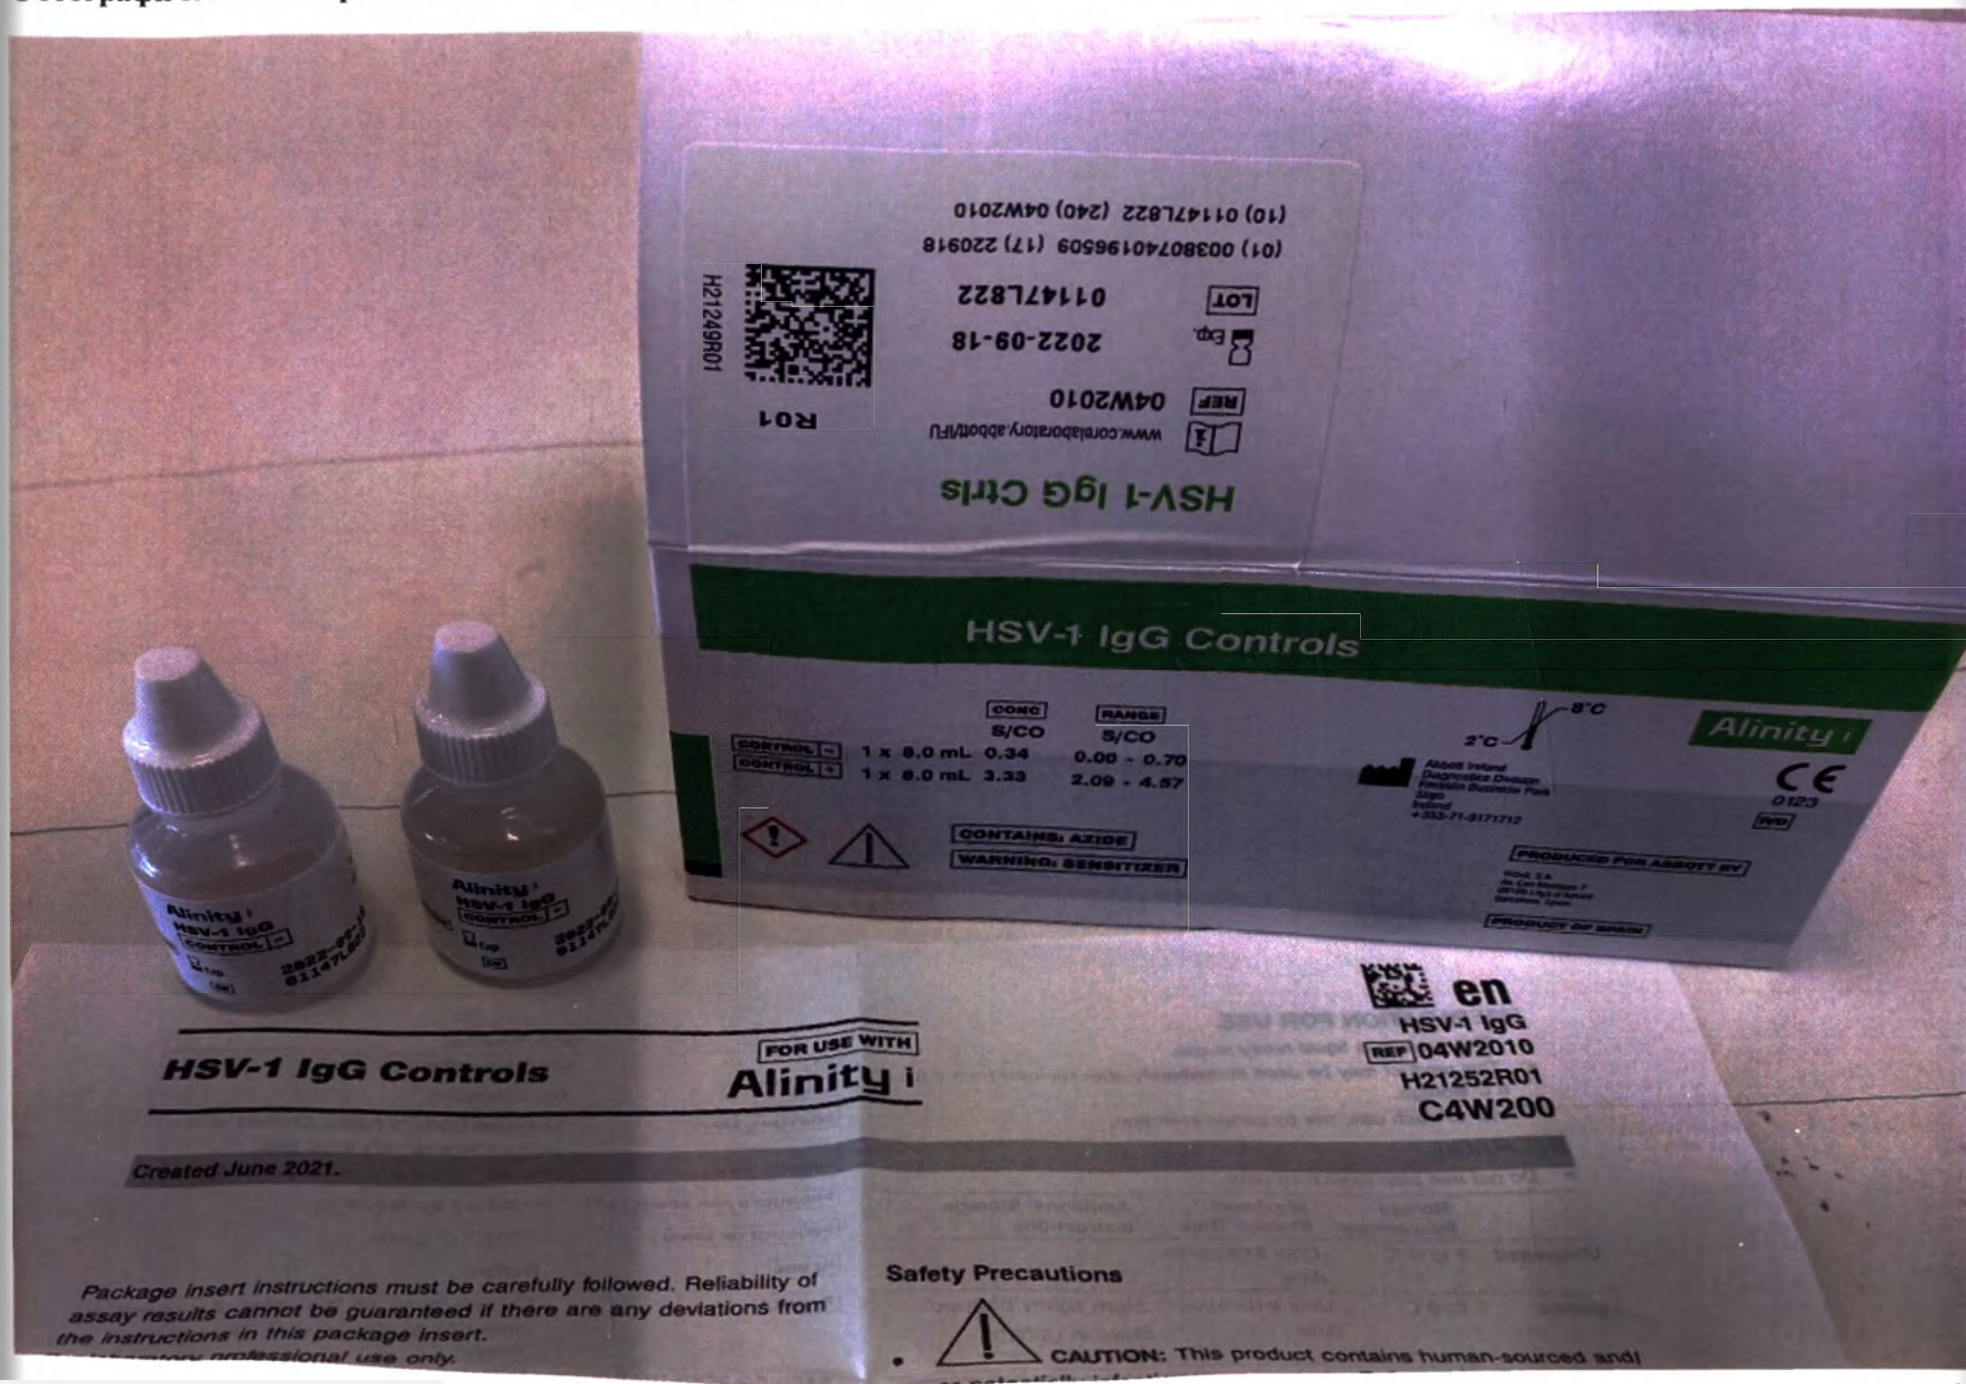

Фотографическое изображение МИ ИВД HSV-1 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-1 IgG Controls), флаконы



всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 ЛИСТОВ



Подпись

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-1 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-1 IgG Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



REF 04W2010



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HSV-1 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-1 IgG Controls)»

В составе: Контроль «-» (Alinity i HSV-1 IgG Control -) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль «+» (Alinity i HSV-1 IgG Control +) - 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению/ Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:


ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (Alinity i HSV-1 IgG Control -)

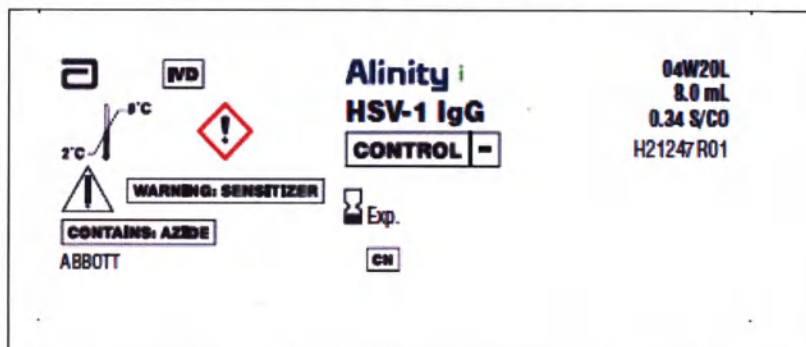

- Контроль «+» (Alinity i HSV-1 IgG Control +)

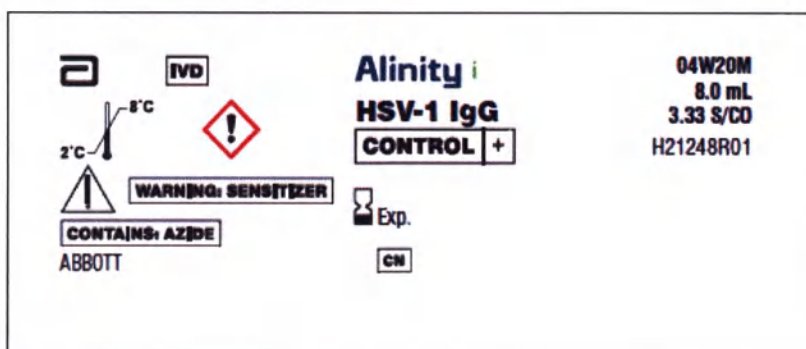

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

