








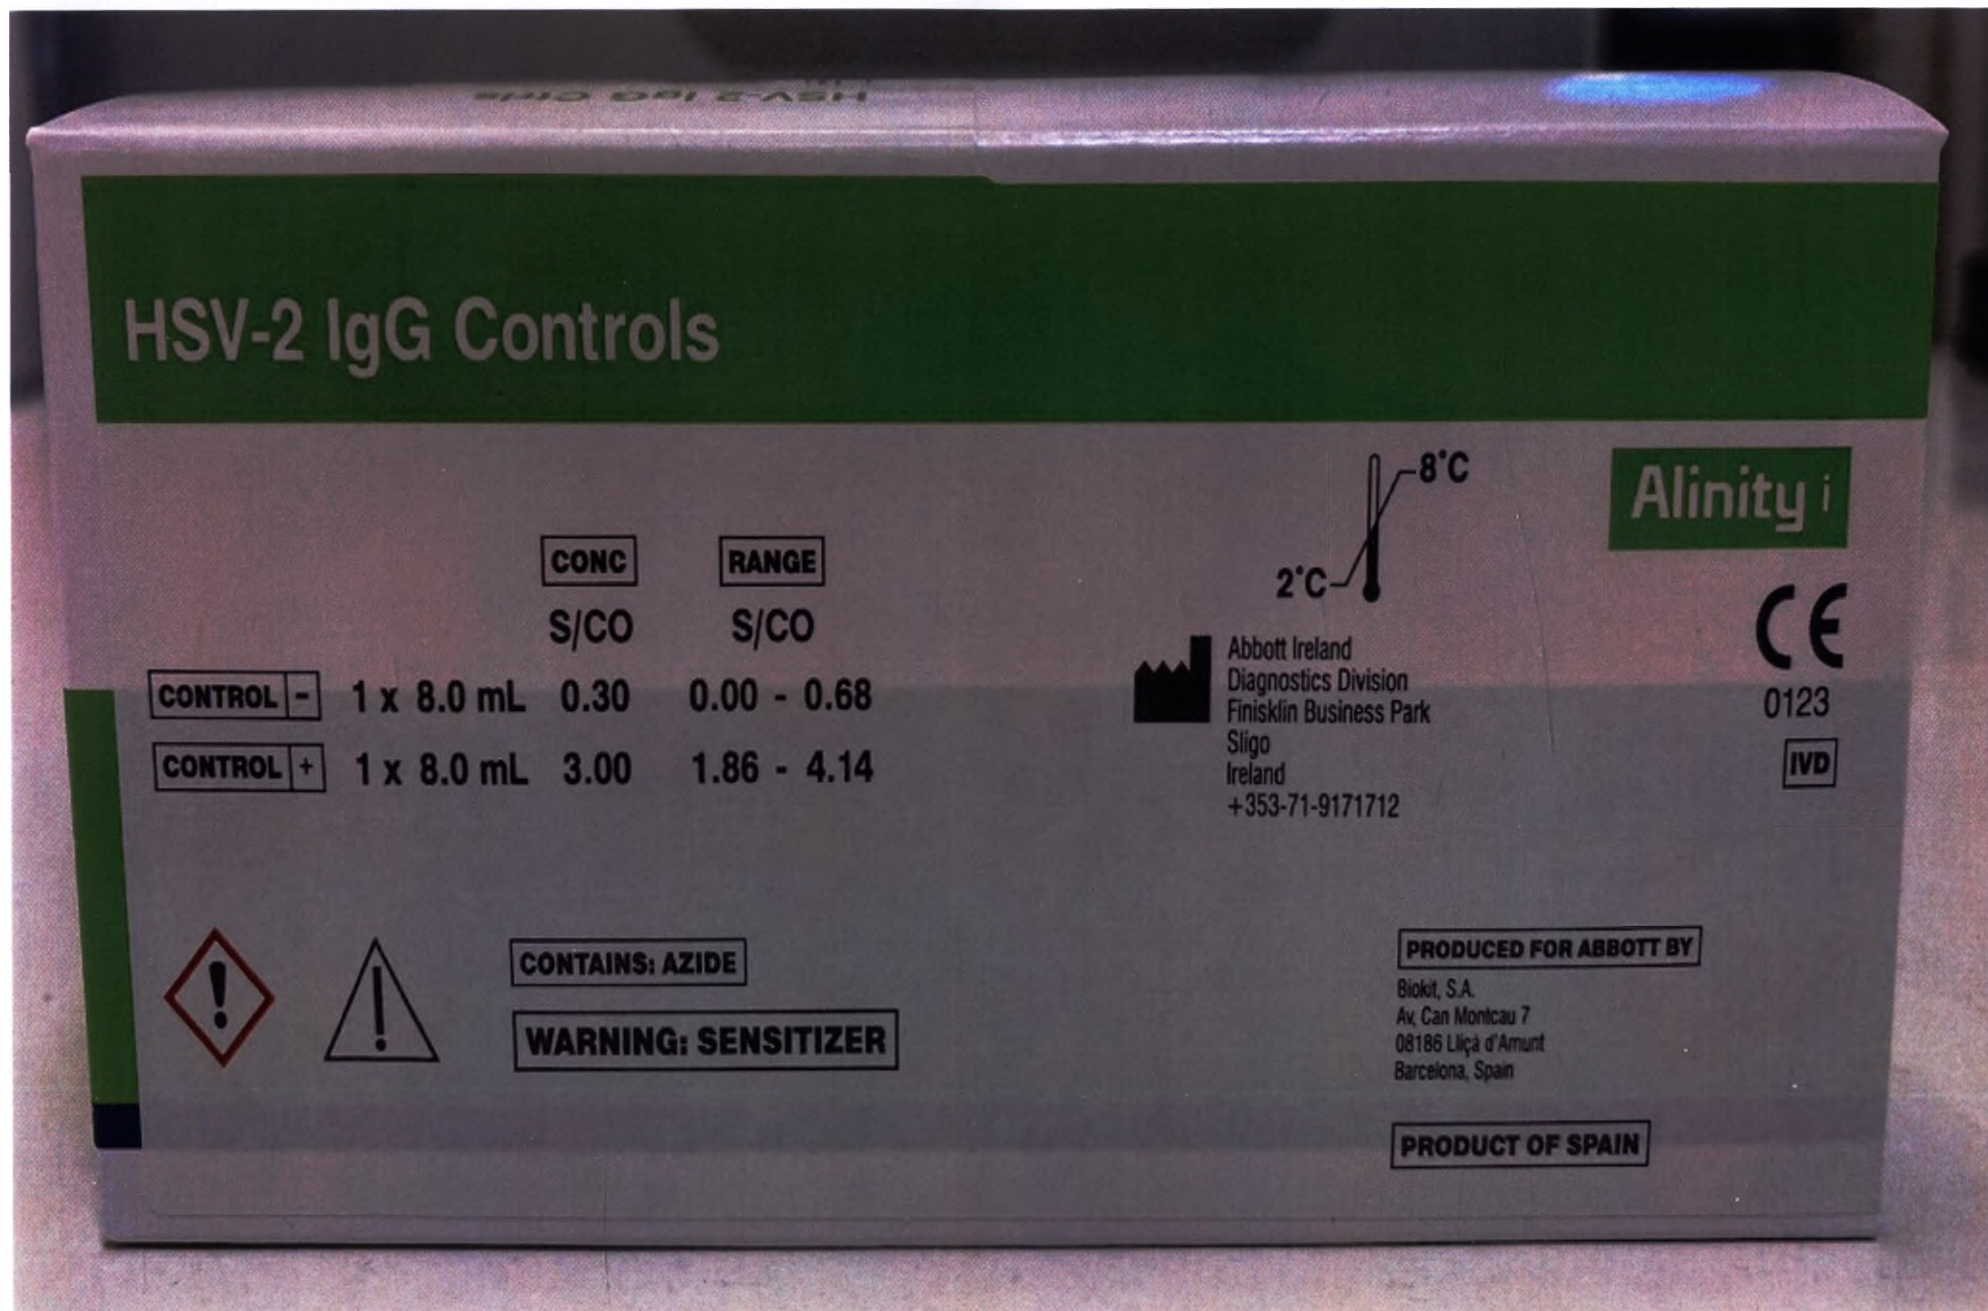

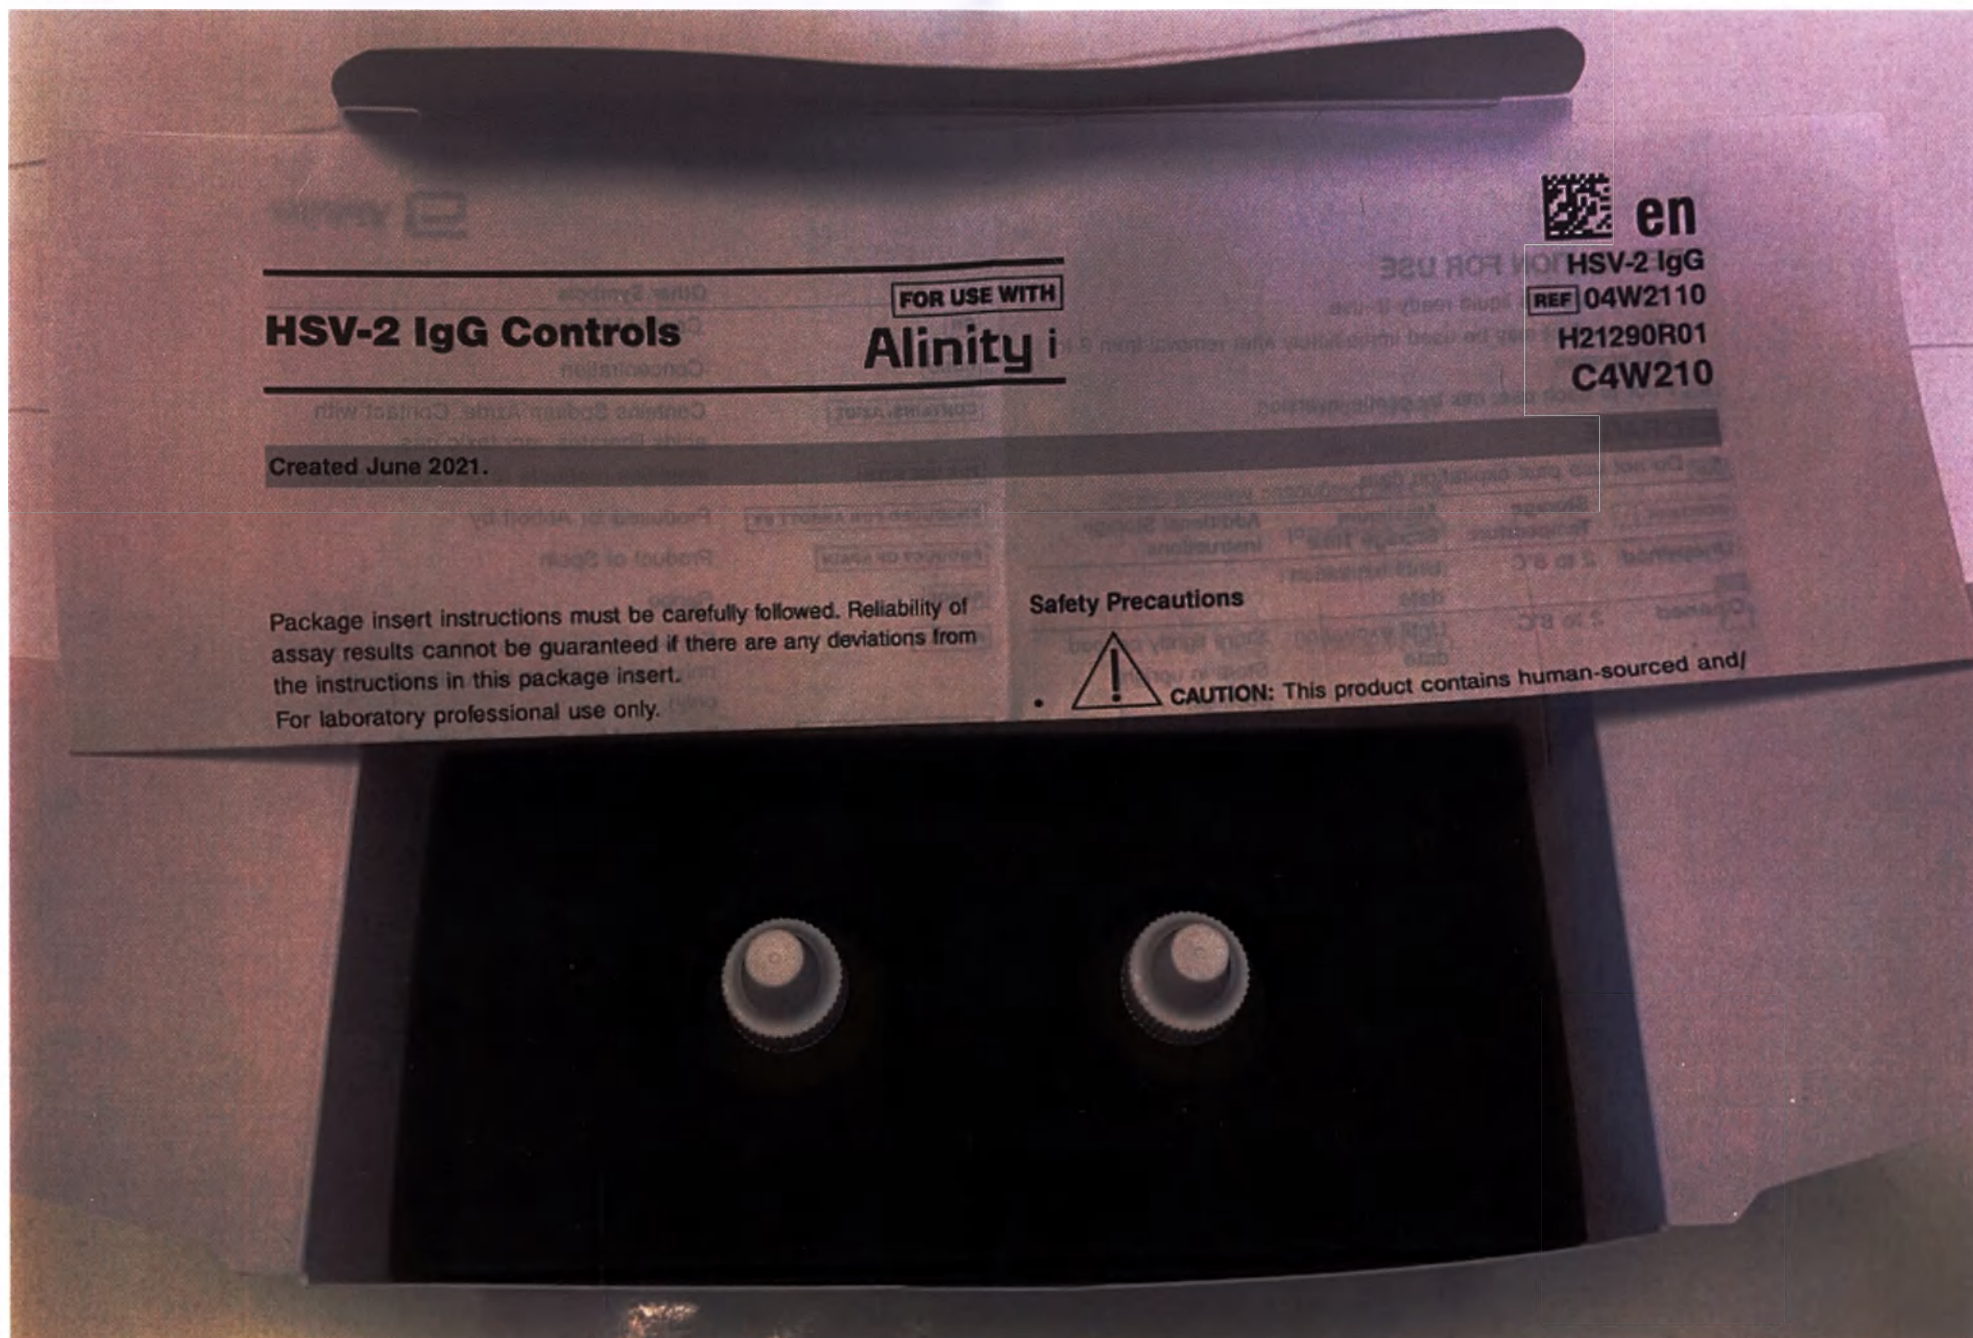

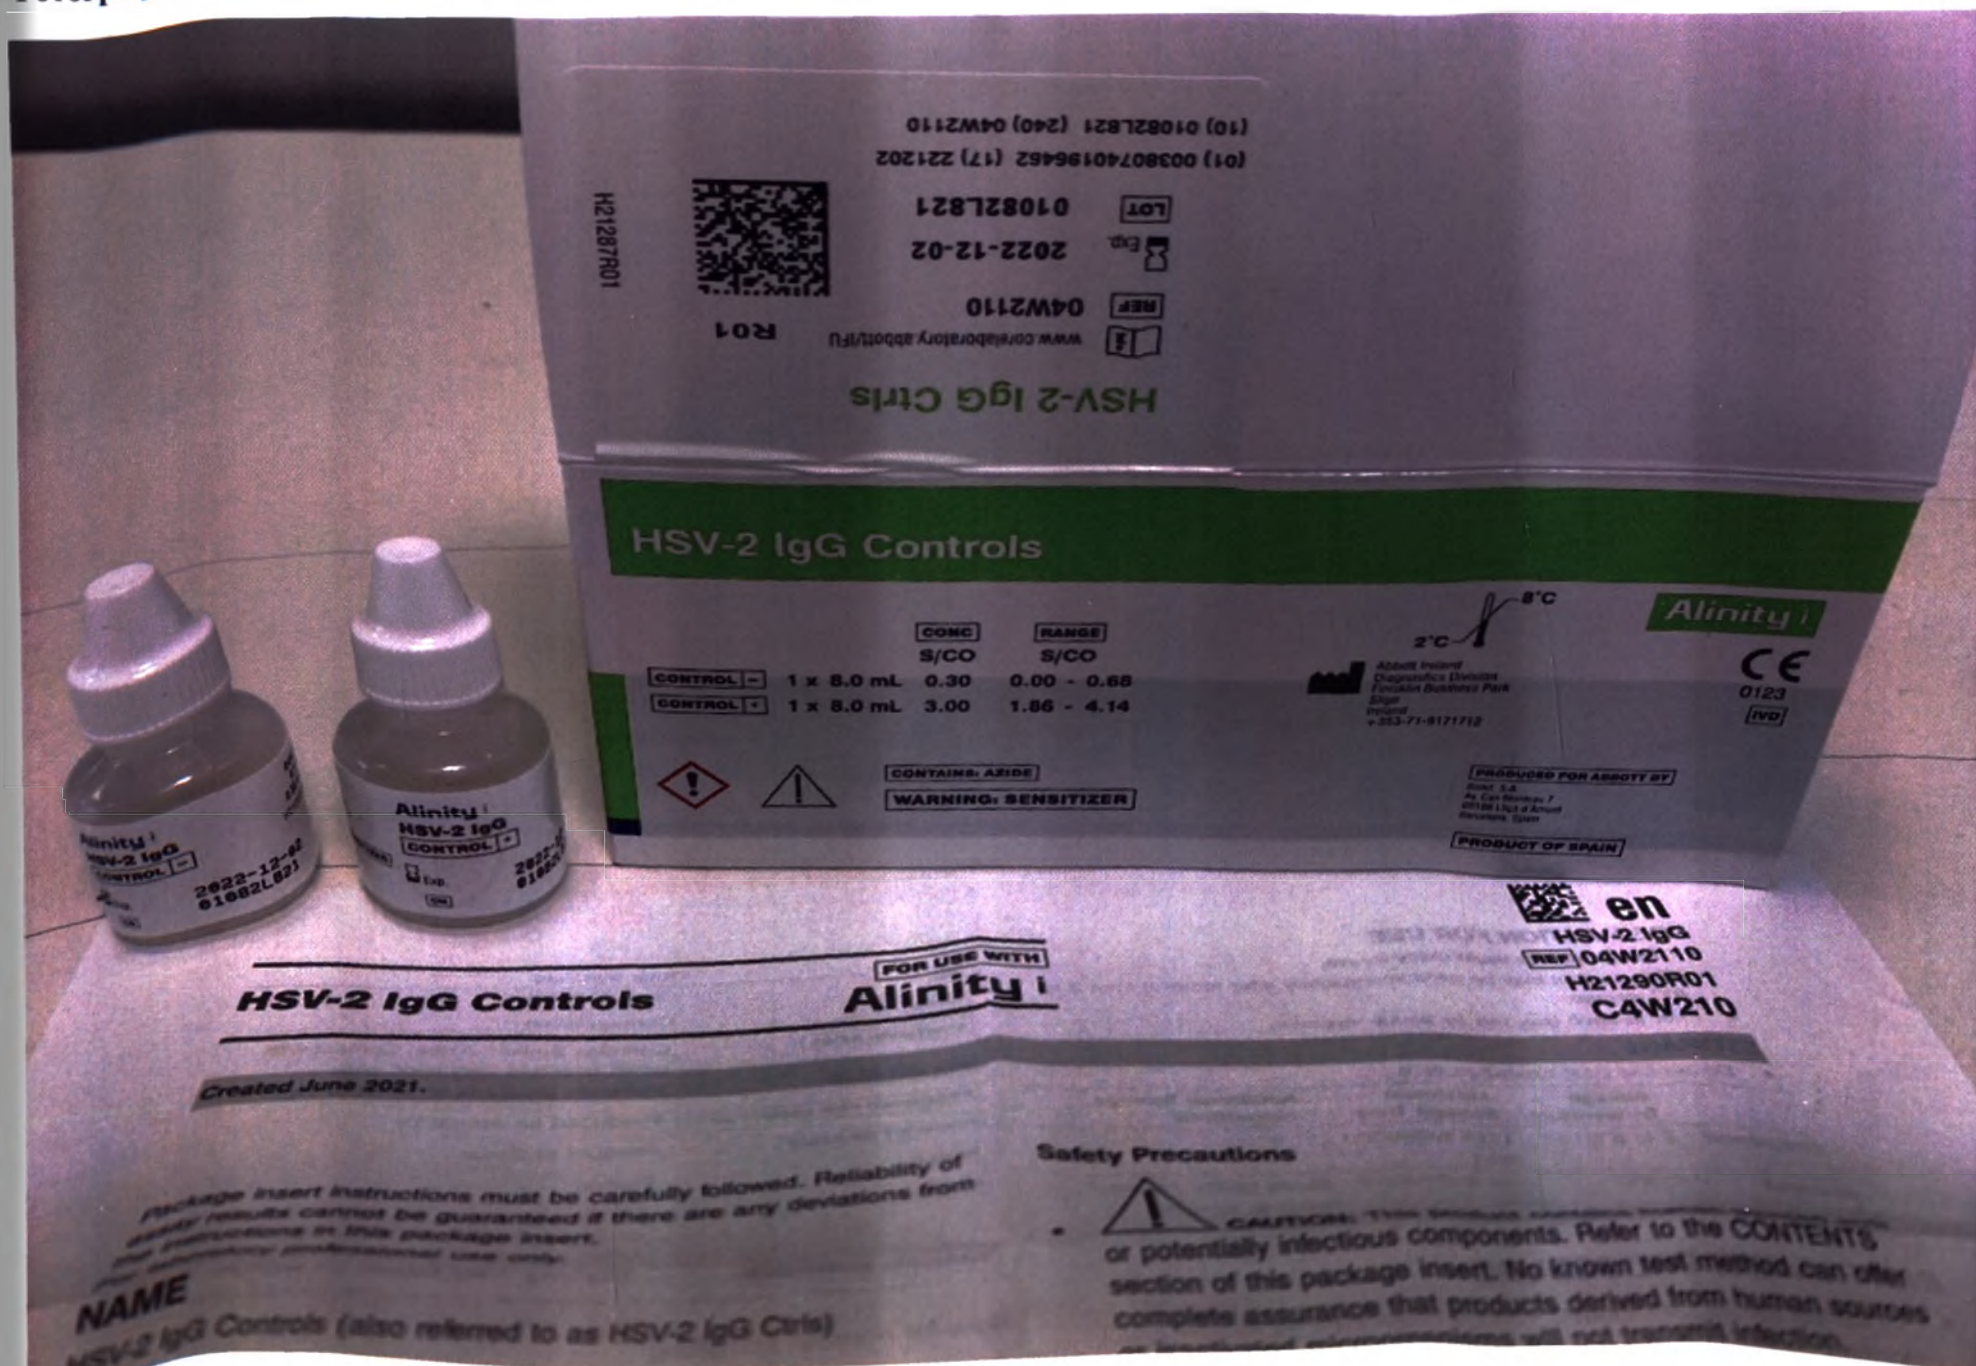

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-2 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-2 IgG Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



04W2110



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HSV-2 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-2 IgG Controls)».

В составе: Контроль «-» (Alinity i HSV-2 IgG Control -) - 1 флакон x 8,0 мл; Контроль «+» (Alinity i HSV-2 IgG Control +) - 1 флакон x 8,0 мл; Инструкция по применению/ Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/ ____ от _____. ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HSV-2 IgG Контрольные материалы для Alinity i (HSV-2 IgG Controls)

H21287R01

HSV-2 IgG Ctrls

REF 04W2110

www.celldiag.abbott.ru

Exp. Lot

HSV-2 IgG Controls

Alinity i

HSV-2 IgG Ctrls

CE 0123

IND

2°C 8°C

Abbott Ireland
Diagnostic Division
Pharmaceutical Park
Shannon
Ireland
+353 21 917 1712

PRODUCED FOR ABBOTT BY
Biotest S.A.
Av. Can Muntaner 7
08180 L'Hospitalet del
Barcelona, Spain

PRODUCT OF SPAIN

CONTROL	CONC	RANGE	S/CO
1 x 8.0 mL	0.30	0.00 - 0.68	
1 x 8.0 mL	3.00	1.86 - 4.14	

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

2°C 8°C

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (Alinity i HSV-2 IgG Control -)



- Контроль «+» (Alinity i HSV-2 IgG Control +)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

