


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«HSV-1 IgG Контрольные материалы для ARCHITECT (HSV-1 IgG Controls)»**



HSV-1 IgG Controls

**FOR USE WITH
ARCHITECT**

		CONC	S/CO	RANGE	S/CO
CONTROL -	1 x 8.0 mL	0.34	0.00 - 0.70		
CONTROL +	1 x 8.0 mL	3.33	2.09 - 4.57		



CONTAINS: AZIDE


WARNING: SENSITIZER

PRODUCED FOR ABBOTT BY


Biokit, S.A.
Av. Can Montcau 7
08186 Lliçà d'Amunt
Barcelona, Spain

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712


PRODUCT OF SPAIN



 **Abbott**

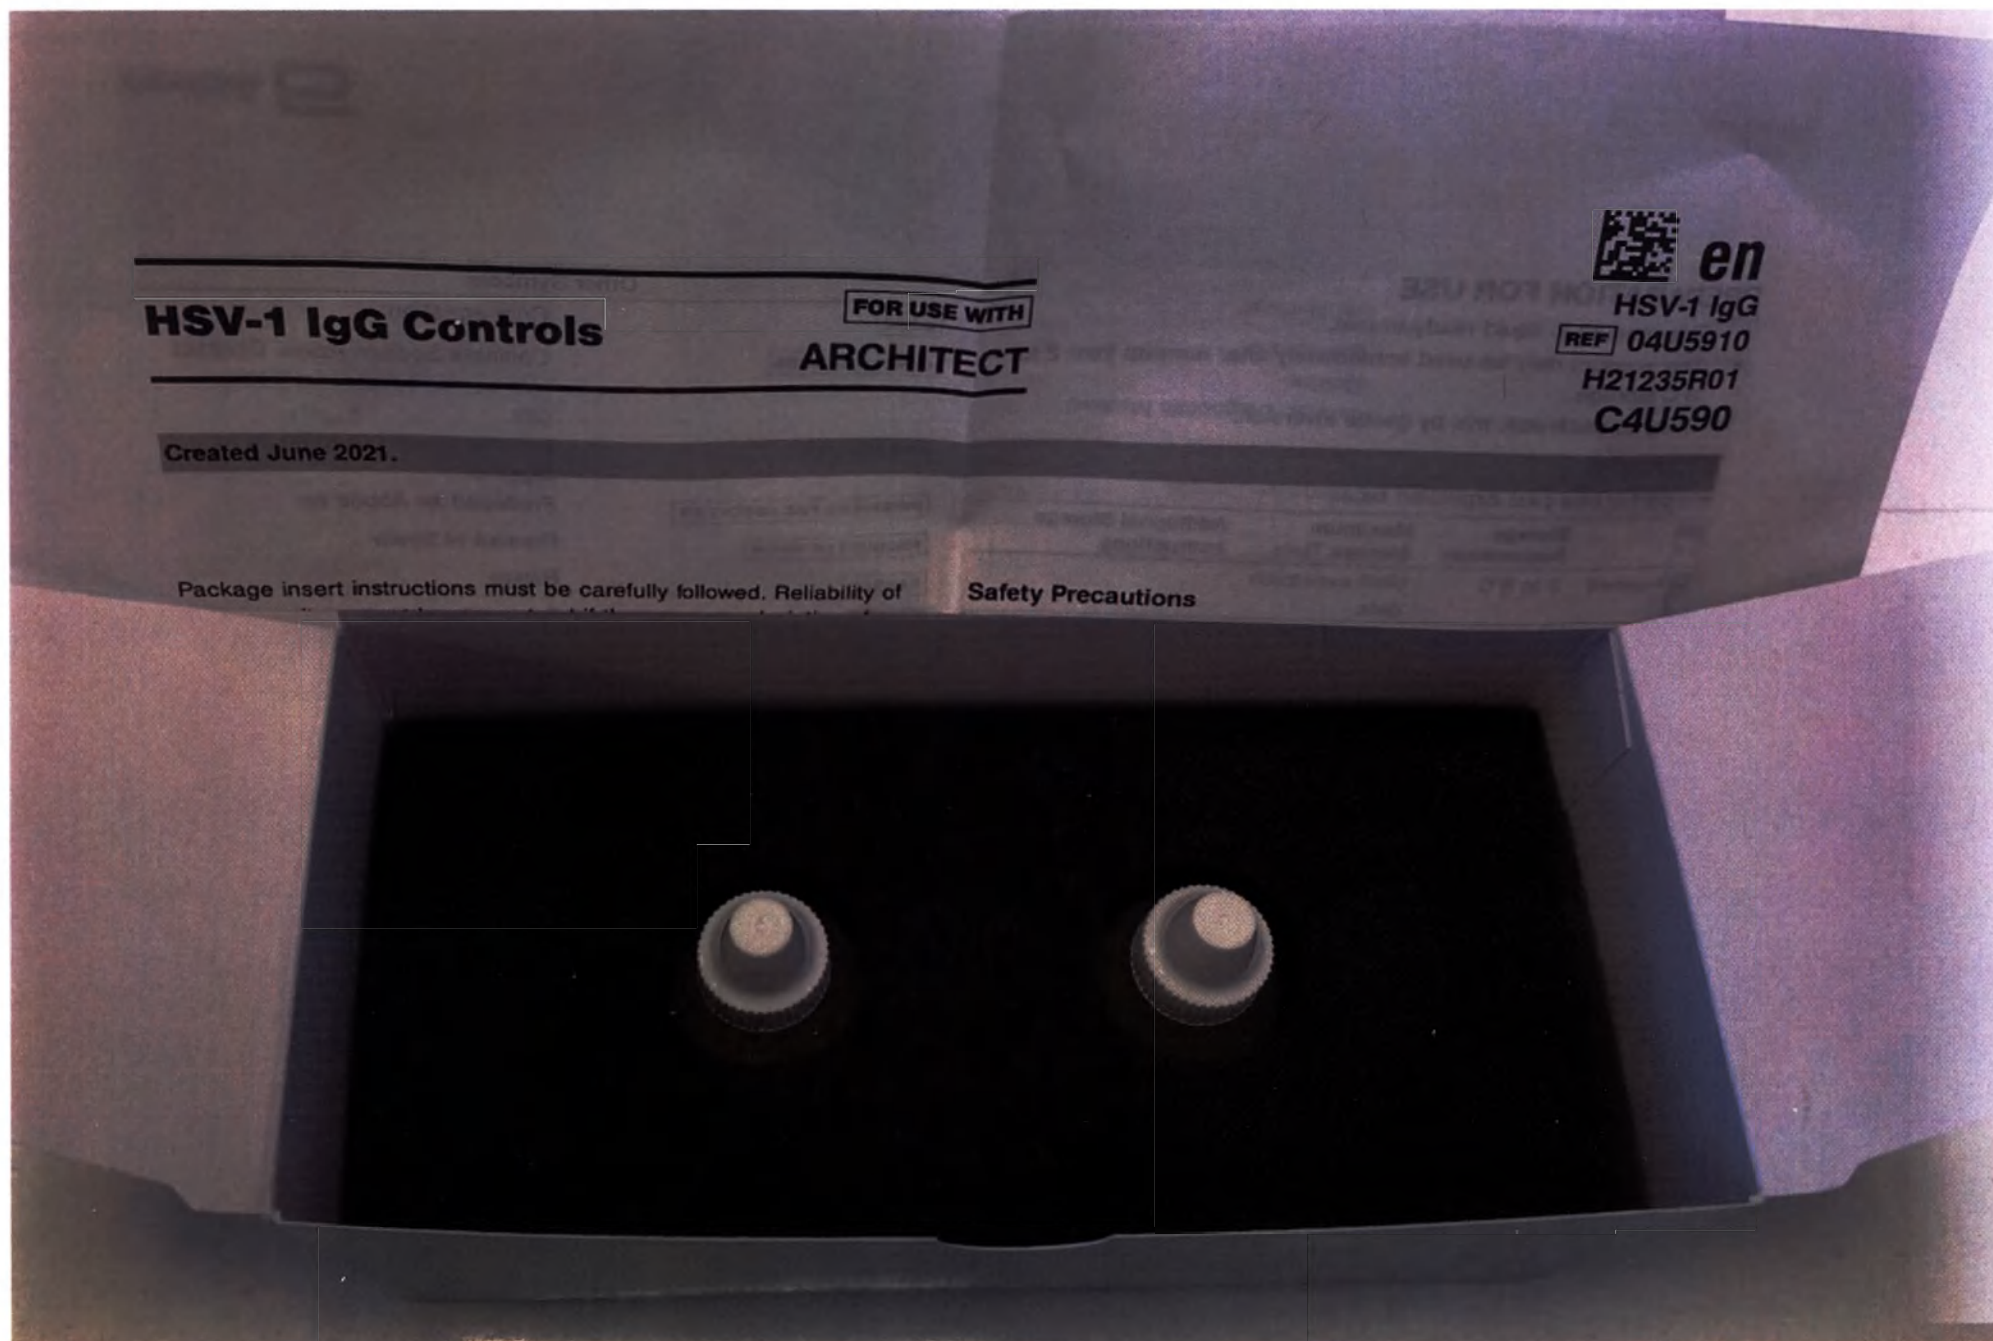

Фотографическое изображение МИ ИВД HSV-1 IgG Контрольные материалы для ARCHITECT (HSV-1 IgG Controls), упаковка, состав

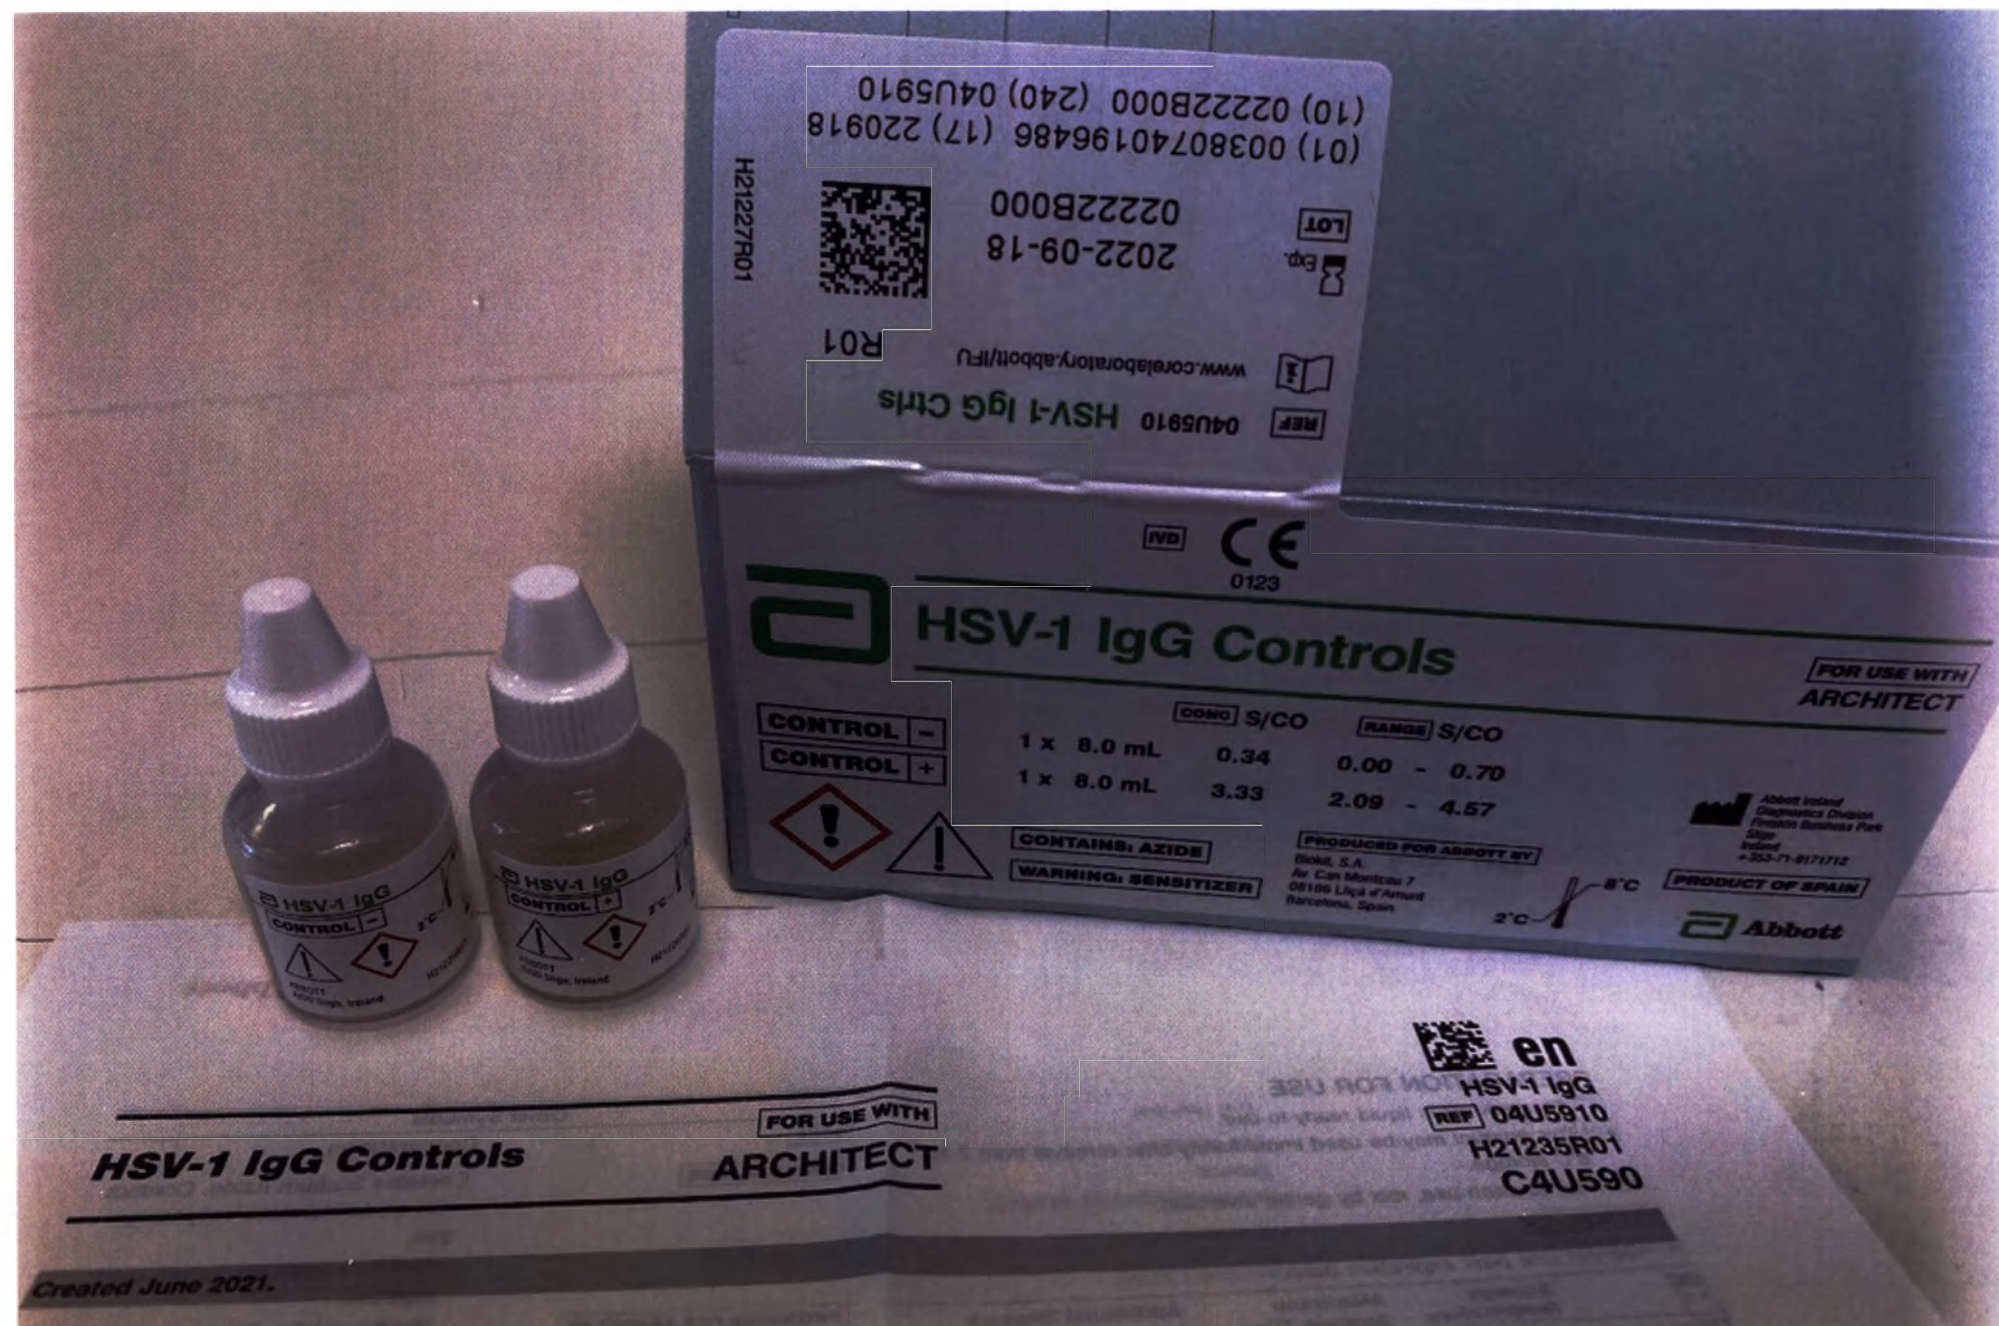



Подпись 


Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG,
специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1),
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«HSV-1 IgG Контрольные материалы для ARCHITECT (HSV-1 IgG Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



REF 04U5910



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 1 типа (HSV-1), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT

«HSV-1 IgG Контрольные материалы для ARCHITECT (HSV-1 IgG Controls)»

В составе: Контроль «-» (ARCHITECT HSV-1 IgG Control -) - 1 флакон х 8,0 мл; Контроль «+» (ARCHITECT HSV-1 IgG Control +) - 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению/ Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HSV-1 IgG Контрольные материалы для ARCHITECT (HSV-1 IgG Controls)

H21227R01

REF 04U5910 HSV-1 IgG Ctrls

www.cerbia-biotech.ru/abbott/FU

LOT Exp

IVD

CE 0123

FOR USE WITH
ARCHITECT

HSV-1 IgG Controls

CONC	S/CO	RANGE	S/CO
1 x 8.0 mL	0.34	0.00 - 0.70	
1 x 8.0 mL	3.33	2.09 - 4.57	

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Parsippany Business Park
810
New Jersey
+353-71-9771712

PRODUCT OF SPAIN

Abbott

CONTROL -

CONTROL +

CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Bolli, S.A.
Av. Can Muntic au 7
08196 L'Isle d'Aumont
Barcelona, Spain

2°C


8°C

HSV-1 IgG Ctrls


Abbott

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (ARCHITECT HSV-1 IgG Control -)

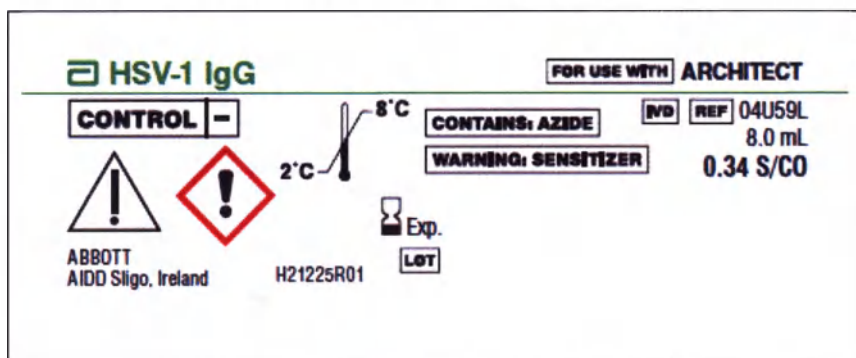

- Контроль «+» (ARCHITECT HSV-1 IgG Control +)

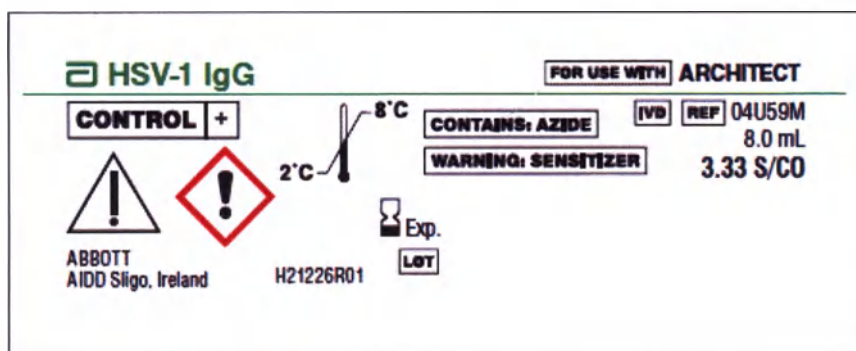

всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

4 листов



Подпись

«Абботт Лаборатории»
limited liability company
Abbott Laboratories