

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого
герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-2 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-2 IgG Calibrator)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации



04W2101



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2), иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «HSV-2 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-2 IgG Calibrator)».

В составе: Калибратор 1 (Alinity i HSV-2 IgG CAL 1) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению/ Производитель: Эбботт Ирландия, Диагностическое подразделение, Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park, Sligo, Ireland / Место производства: Biokit S.A., Av. Can Montcau, 7, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona, Spain / Страна происхождения: Испания/ ПУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1


Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка медицинского изделия HSV-2 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-2 IgG Calibrator)

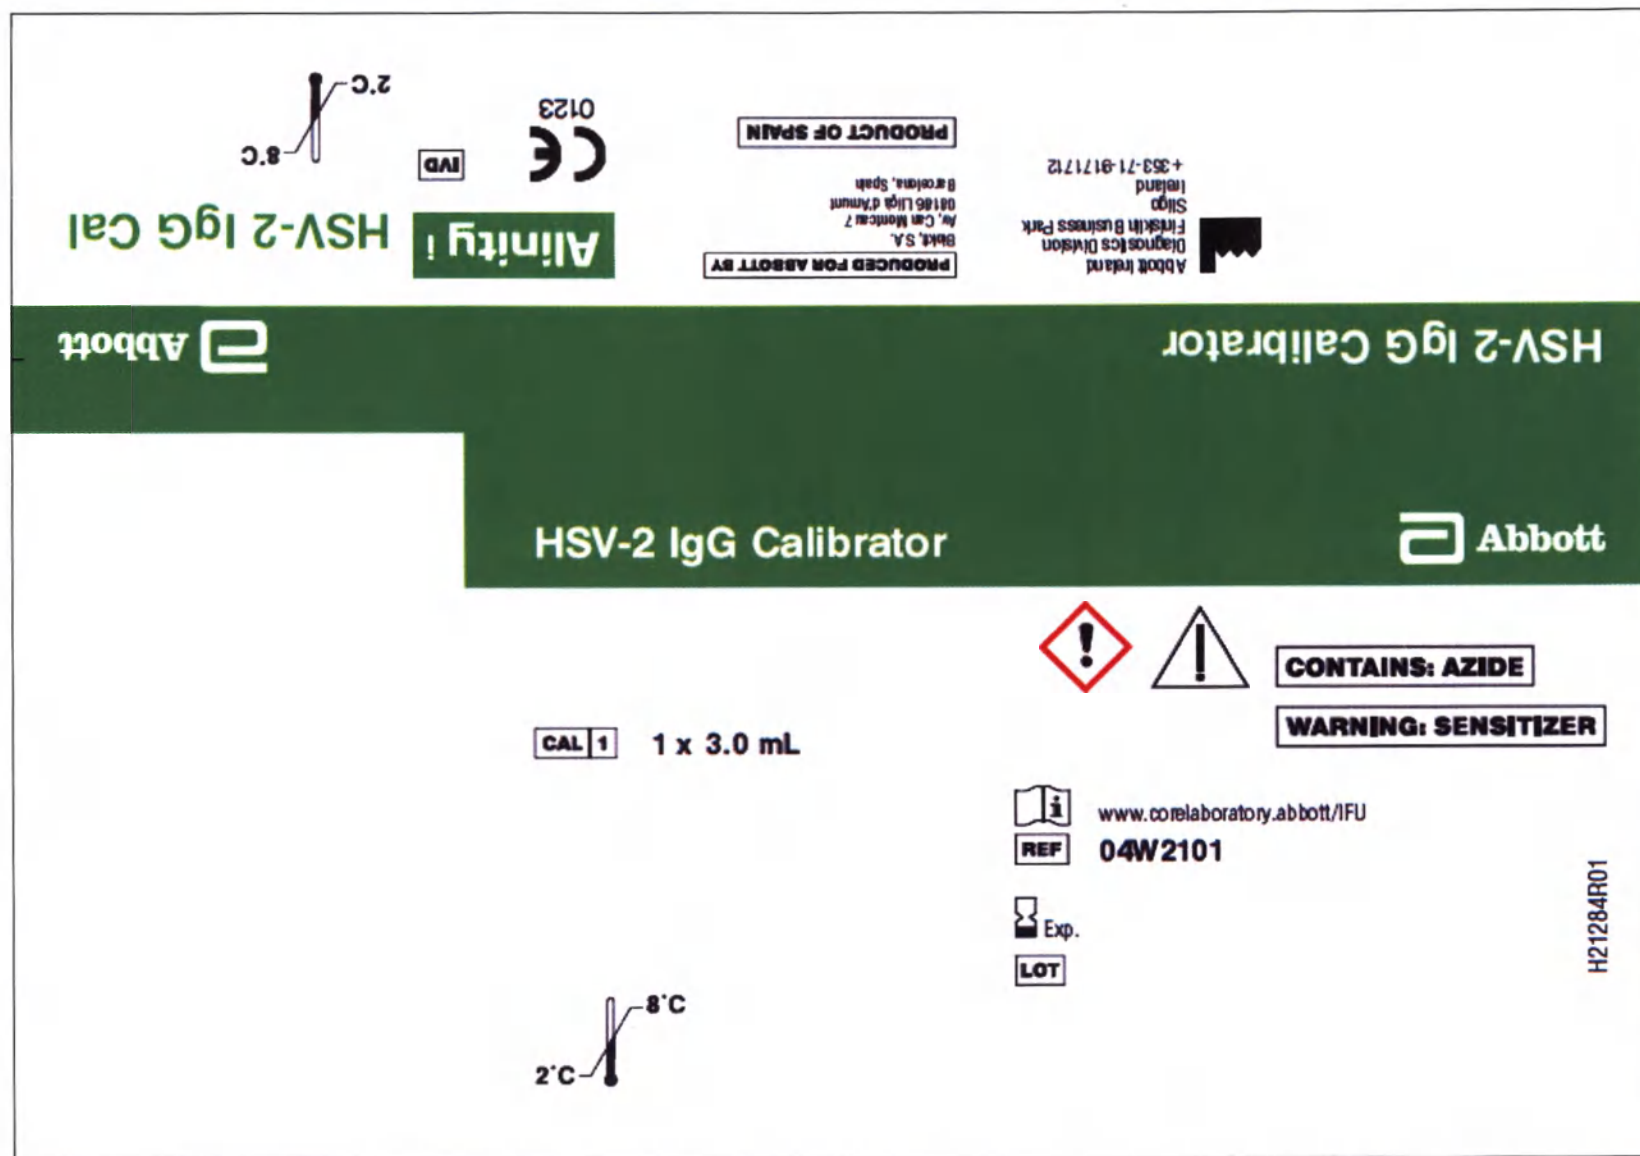

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Калибратор 1 (Alinity i HSV-2 IgG CAL 1)

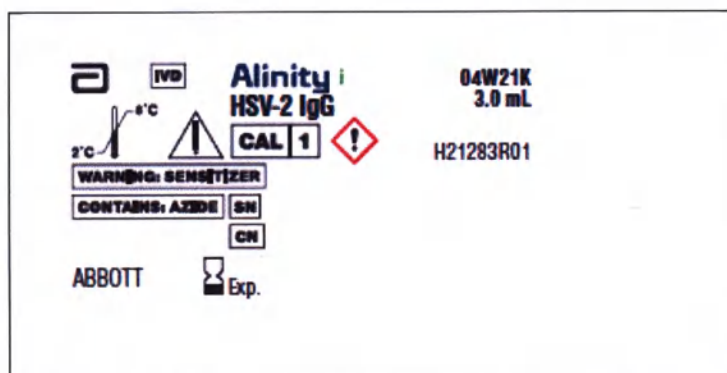

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител класса IgG, специфичных к вирусу простого герпеса 2 типа (HSV-2),
иммуохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HSV-2 IgG Калибратор для Alinity i (HSV-2 IgG Calibrator)»**

HSV-2 IgG Calibrator

 Abbott



CONTAINS: AZIDE

WARNING: SENSITIZER

CAL 1 1 x 3.0 mL



www.corelaboratory.abbott/IFU

REF

04W2101

R01



Exp.


2022-12-02

LOT

01083L821



H21284R01



(01) 00380740196530 (17) 221202

(10) 01083L821 (240) 04W2101 (91) HSV-2 IgG

