




ООО "Эбботт Лэбораториз"  
125171, Москва, Ленинградское  
шоссе, 16 А., стр 1,  
БЦ Метрополис  
Тел: (495) 258 42 80

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель подразделения молекулярной  
диагностики  
ООО «Эбботт Лэбораториз» в России и странах  
СНГ

«01» августа 2022 года  
 Коничева Е.Р.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

«Набор контролей «Alinity m SARS-CoV-2 CNTRL Kit» для качественного определения  
РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в мазках из носоглотки  
и ротоглотки человека на анализаторе Alinity m», производства Abbott Molecular Inc.  
(Эбботт Молекуляр Инк.)

2022



Фотографическое изображение 1. «Набор контролей «Alinity m SARS-CoV-2 CNTRL Kit» для качественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в мазках из носоглотки и ротоглотки человека на анализаторе Alinity m», внешний вид потребительской упаковки

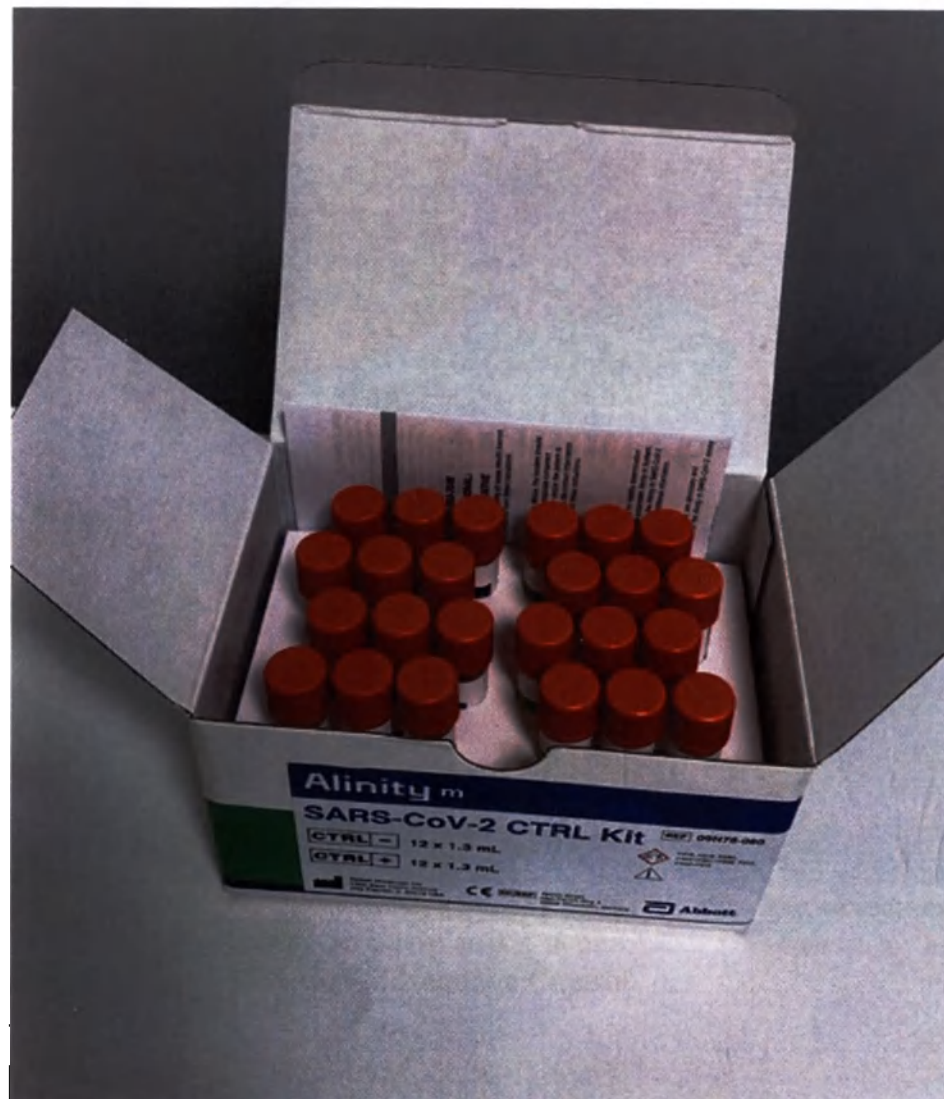

**Фотографическое изображение 2. «Набор контролей «Alinity m SARS-CoV-2 CNTRL Kit» для качественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в мазках из носоглотки и ротоглотки человека на анализаторе Alinity m», содержимое потребительской упаковки.**






Фотографическое изображение 3. «Набор контролей «Alinity m SARS-CoV-2 CNTRL Kit» для качественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в мазках из носоглотки и ротоглотки человека на анализаторе Alinity m», внешний вид флаконов с отрицательным контролем Alinity m SARS-CoV-2 Negative Control.



Фотографическое изображение 4. «Набор контролей «Alinity m SARS-CoV-2 CNTRL Kit» для качественного определения РНК SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в мазках из носоглотки и ротоглотки человека на анализаторе Alinity m», внешний вид флаконов с положительным контролем Alinity m SARS-CoV-2 Positive Control.

Прошито, пронумеровано

количество листов 5

 / Конишева Е.Р. /

Подпись

ФИО