

**Макет маркировки «Набор калибраторов «Alinity m HCV Cal Kit» для
количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в
плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m»**

2021г.

Макет маркировки «Набор калибраторов «Alinity m HCV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m»

Alinity^m

HCV CAL Kit

Набор калибраторов «Alinity m HCV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m

REF 08N50-070

CAL A 4 x 1.95 мл. H317, P261, P280, P272, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P501

CAL B 4 x 1.95 мл.

PRODUCT OF USA

In Vitro Test

IVD

EC REP

www.molecular.abbott/portal

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ: ООО «Эбботт Лэбораториз», Россия, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1 Abbott-russia@abbott.com

Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.) 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA

XX.XX.XXXX

-15°C

-25°C

LOT XXXXXX

Набор пробирок с калибратором А (Калиб. А)

Alinity^m

Alinity m HCV Cal Kit

Набор пробирок с калибратором А

CAL A

1,95 мл.

REF 8N50A

XX.XX.XXXX

LOT XXXXXX

53-602009/R1

Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.) 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA

-15°C

-25°C

Набор пробирок с калибратором В (Калиб. В)

Alinity^m

Alinity m HCV Cal Kit

Набор пробирок с калибратором В

CAL B

1,95 мл.

REF 8N50B

XX.XX.XXXX

LOT XXXXXX

53-6020210/R1

Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.) 1300 E. Touhy Avenue, Des Plaines, IL 60018, USA

-15°C

-25°C

Сшито и заверено печатью 2
(962) лист а

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Конишева Е.Р.



Фотографические изображения общего вида
Набор калибраторов «Alinity m HCV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса
гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе
Alinity m


2021г.

В состав наборов входят следующие компоненты:

Набор пробирок с калибратором А (Калиб. А)



Набор пробирок с калибратором В (Калиб. В)

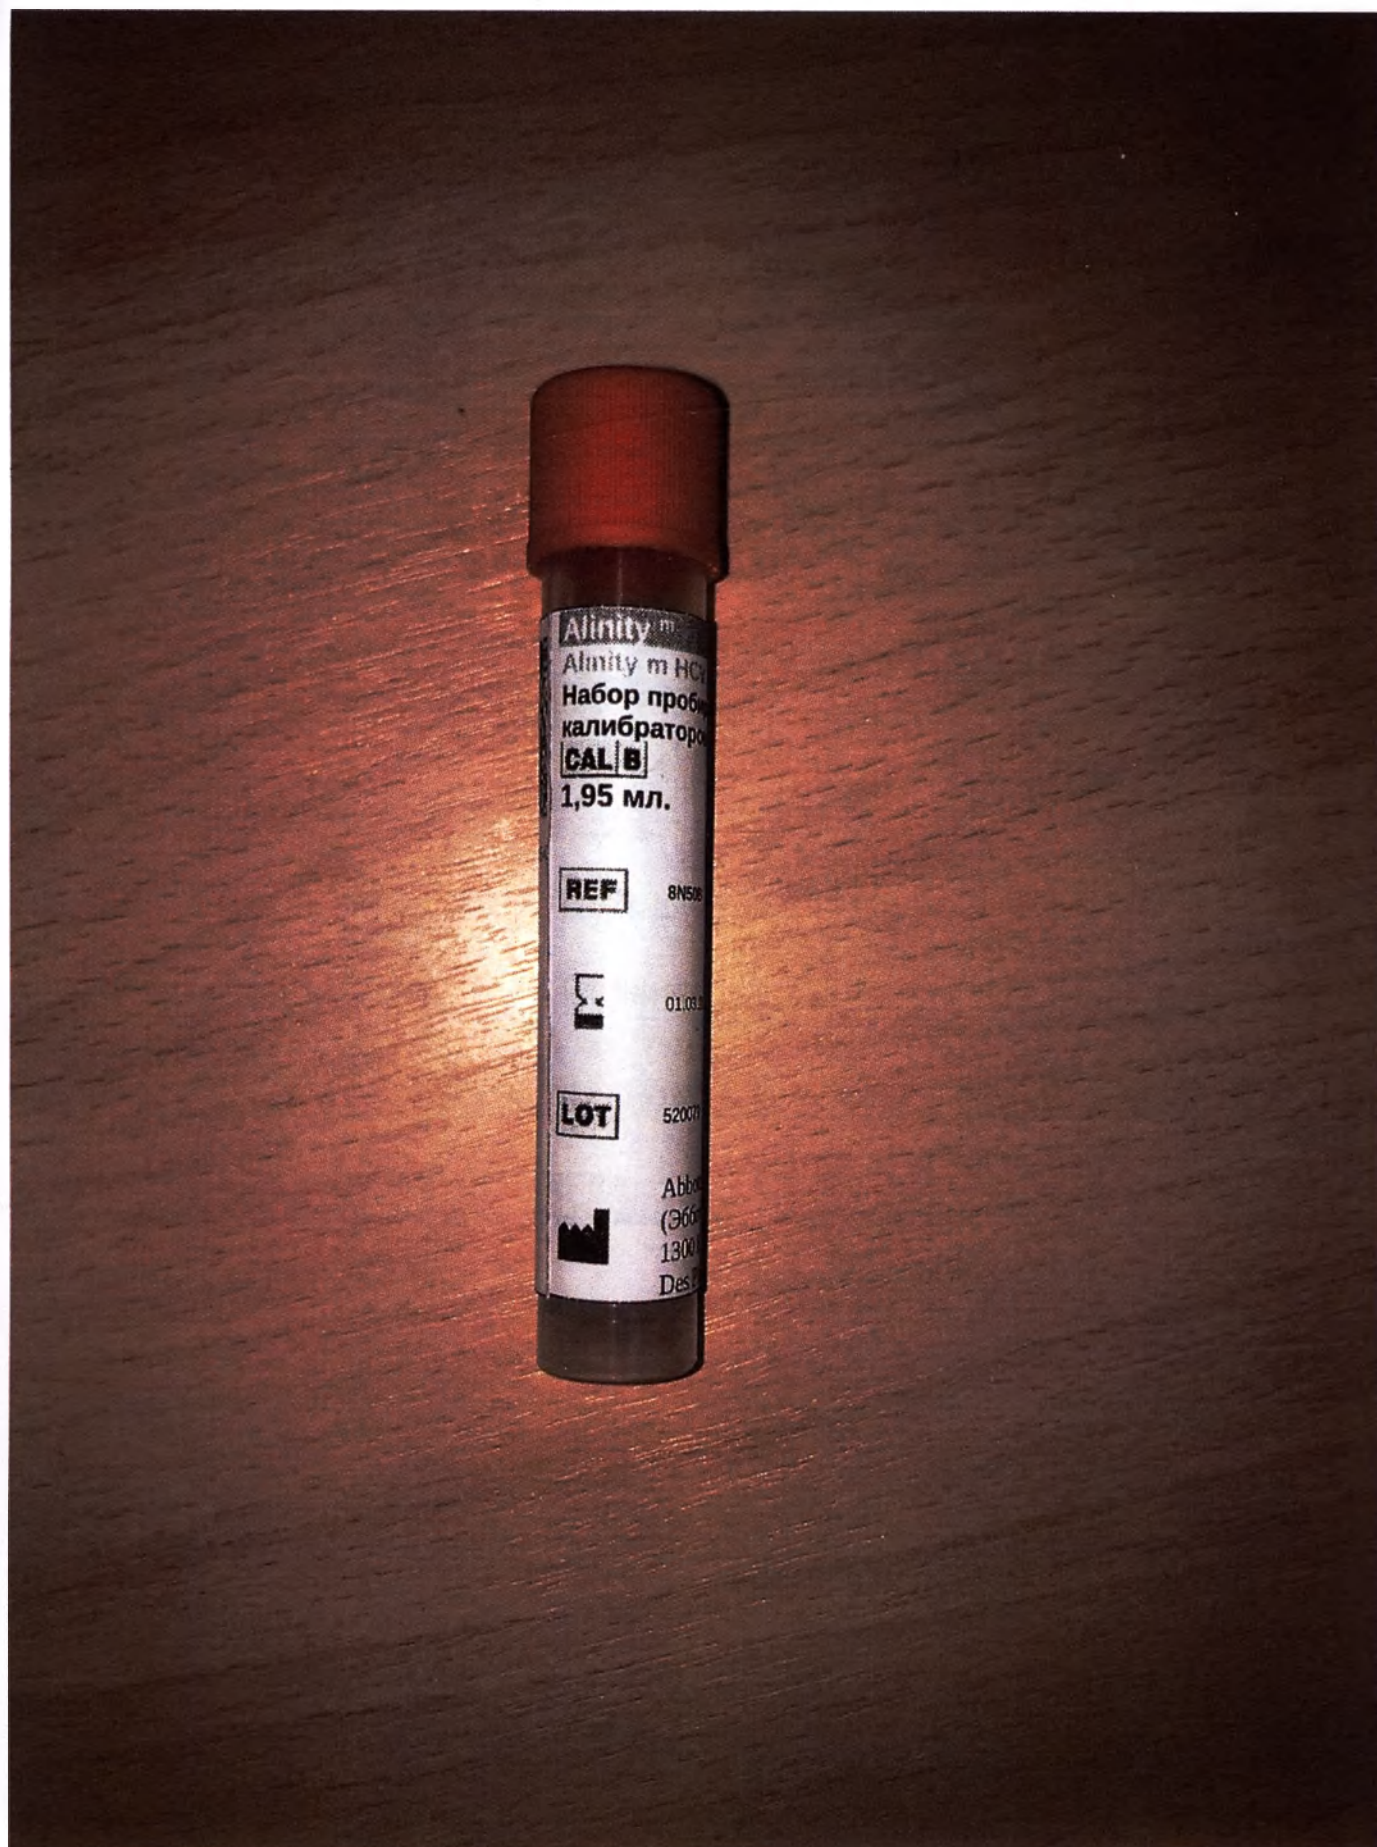

Набор калибраторов «Alinity m HCV Cal Kit» для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в плазме или сыворотке крови человека на анализаторе Alinity m с компонентами



Руководитель Подразделения Молекулярной
Диагностики по России ООО «Эбботт Лэбораториз»

Е.Р. Коничева

Сшито и заверено печатью 4

(печать) лист а

Руководитель подразделения молекулярной диагностики
по России ООО Эбботт Лэбораториз
Коничева Е.Р.

