

Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМ»

ИНН 9721060980, КПП 772202001, ОГРН 1187746029020

111250, г. Москва, проезд Завода Серп и молот, д. 6, корпус 1, эт. 6, комн. 601-609

тел. +7 (499) 450-90-08

Фотографические изображения медицинского изделия

***Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFLAS COVID-19
nAb для анализаторов серии AFLAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G***

УТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию отдела продаж

медицинских товаров и оборудования

ООО «Аксиом»



Немолов М.А.

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(Пример оригинальной маркировки производителя на коробке LOT HJRFB08G)



Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(Пример оригинальной маркировки производителя на коробке LOT HJRFB09G)



Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(пример макета дополнительной маркировки на русском языке, LOT HJRFB08G)

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа
AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G

Состав:

1. Картридж – 24 шт.
2. Наконечник дозатора – 24 шт.
3. Пакет с застежкой-молнией – 1 шт.
4. ID-чип – 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения, транспортирования, срок годности и номер партии
указаны на упаковке.

Производитель:

Boditech Med Inc. (Бодитек Мед Инк.)

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si,
Gangwon-do, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ, импортер:

ООО «Аксном»

111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот,

дом 6, корпус 1, этаж 6, комн. 601-609

тел: 8-499-450-90-08

РУ № _____ от _____

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(пример макета дополнительной маркировки на русском языке, LOT HJRFB09G)

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа
AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB09G

Состав:

1. Картридж – 24 шт.
2. Наконечник дозатора – 24 шт.
3. Пакет с застежкой-молнией – 1 шт.
4. ID-чип – 1 шт.
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения, транспортирования, срок годности и номер партии
указаны на упаковке.

Производитель:

Boditech Med Inc. (Бодитек Мед Инк.)

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si,
Gangwon-do, Republic of Korea

Уполномоченный представитель производителя в РФ, импортер:


ООО «Аксном»

111250, г. Москва, проезд завода Серп и Молот,
дом 6, корпус 1, этаж 6, комн. 601-609

тел: 8-499-450-90-08

РУ № _____ от _____

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G (Общий вид)

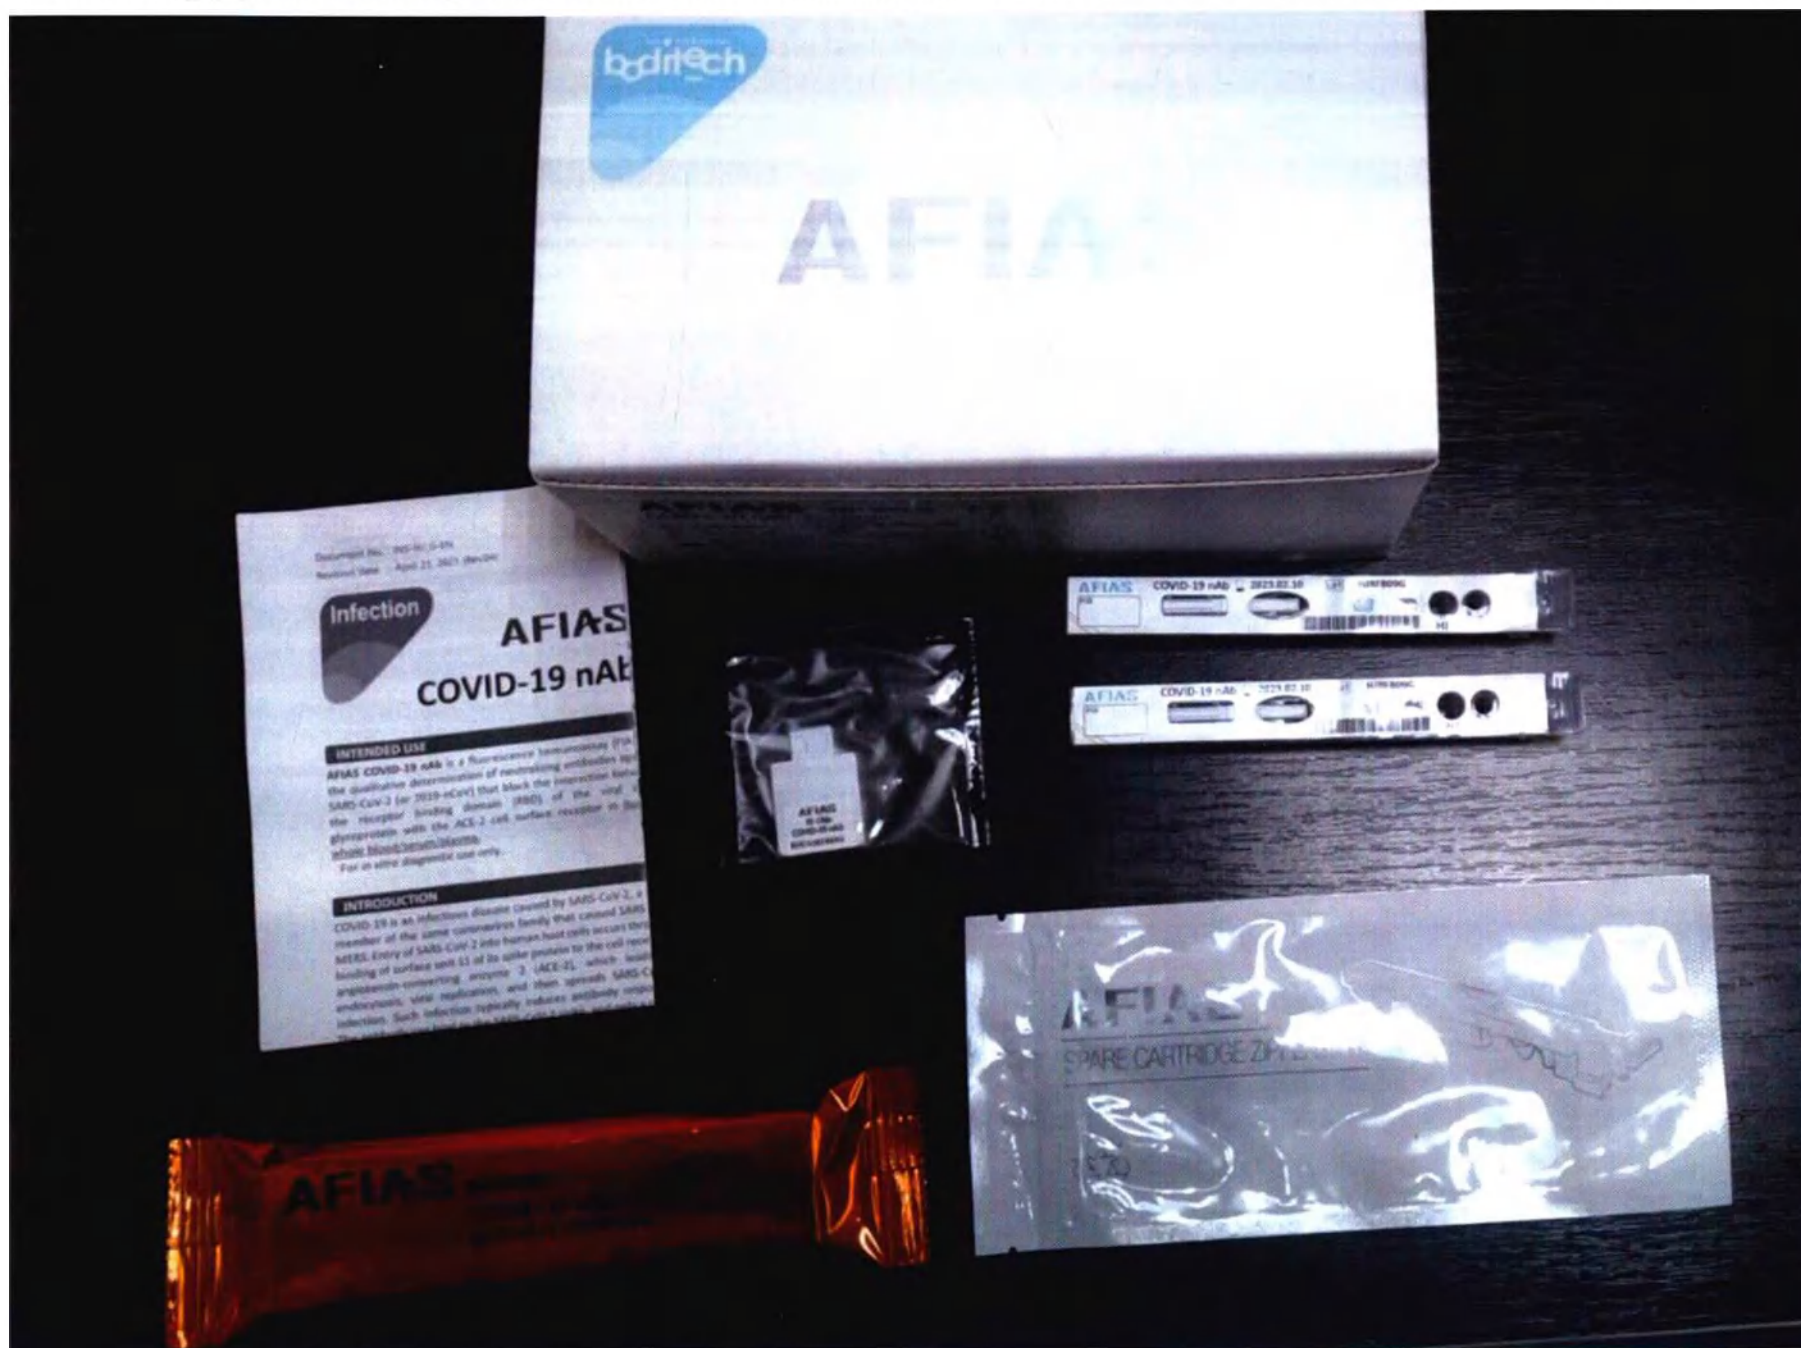

Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(Пример внешнего вида: 1. Картридж)








Тест-система флуоресцентного иммуноанализа AFIAS COVID-19 nAb для анализаторов серии AFIAS, LOT HJRFB08G, HJRFB09G
(Пример внешнего вида: 5. ID-чип)



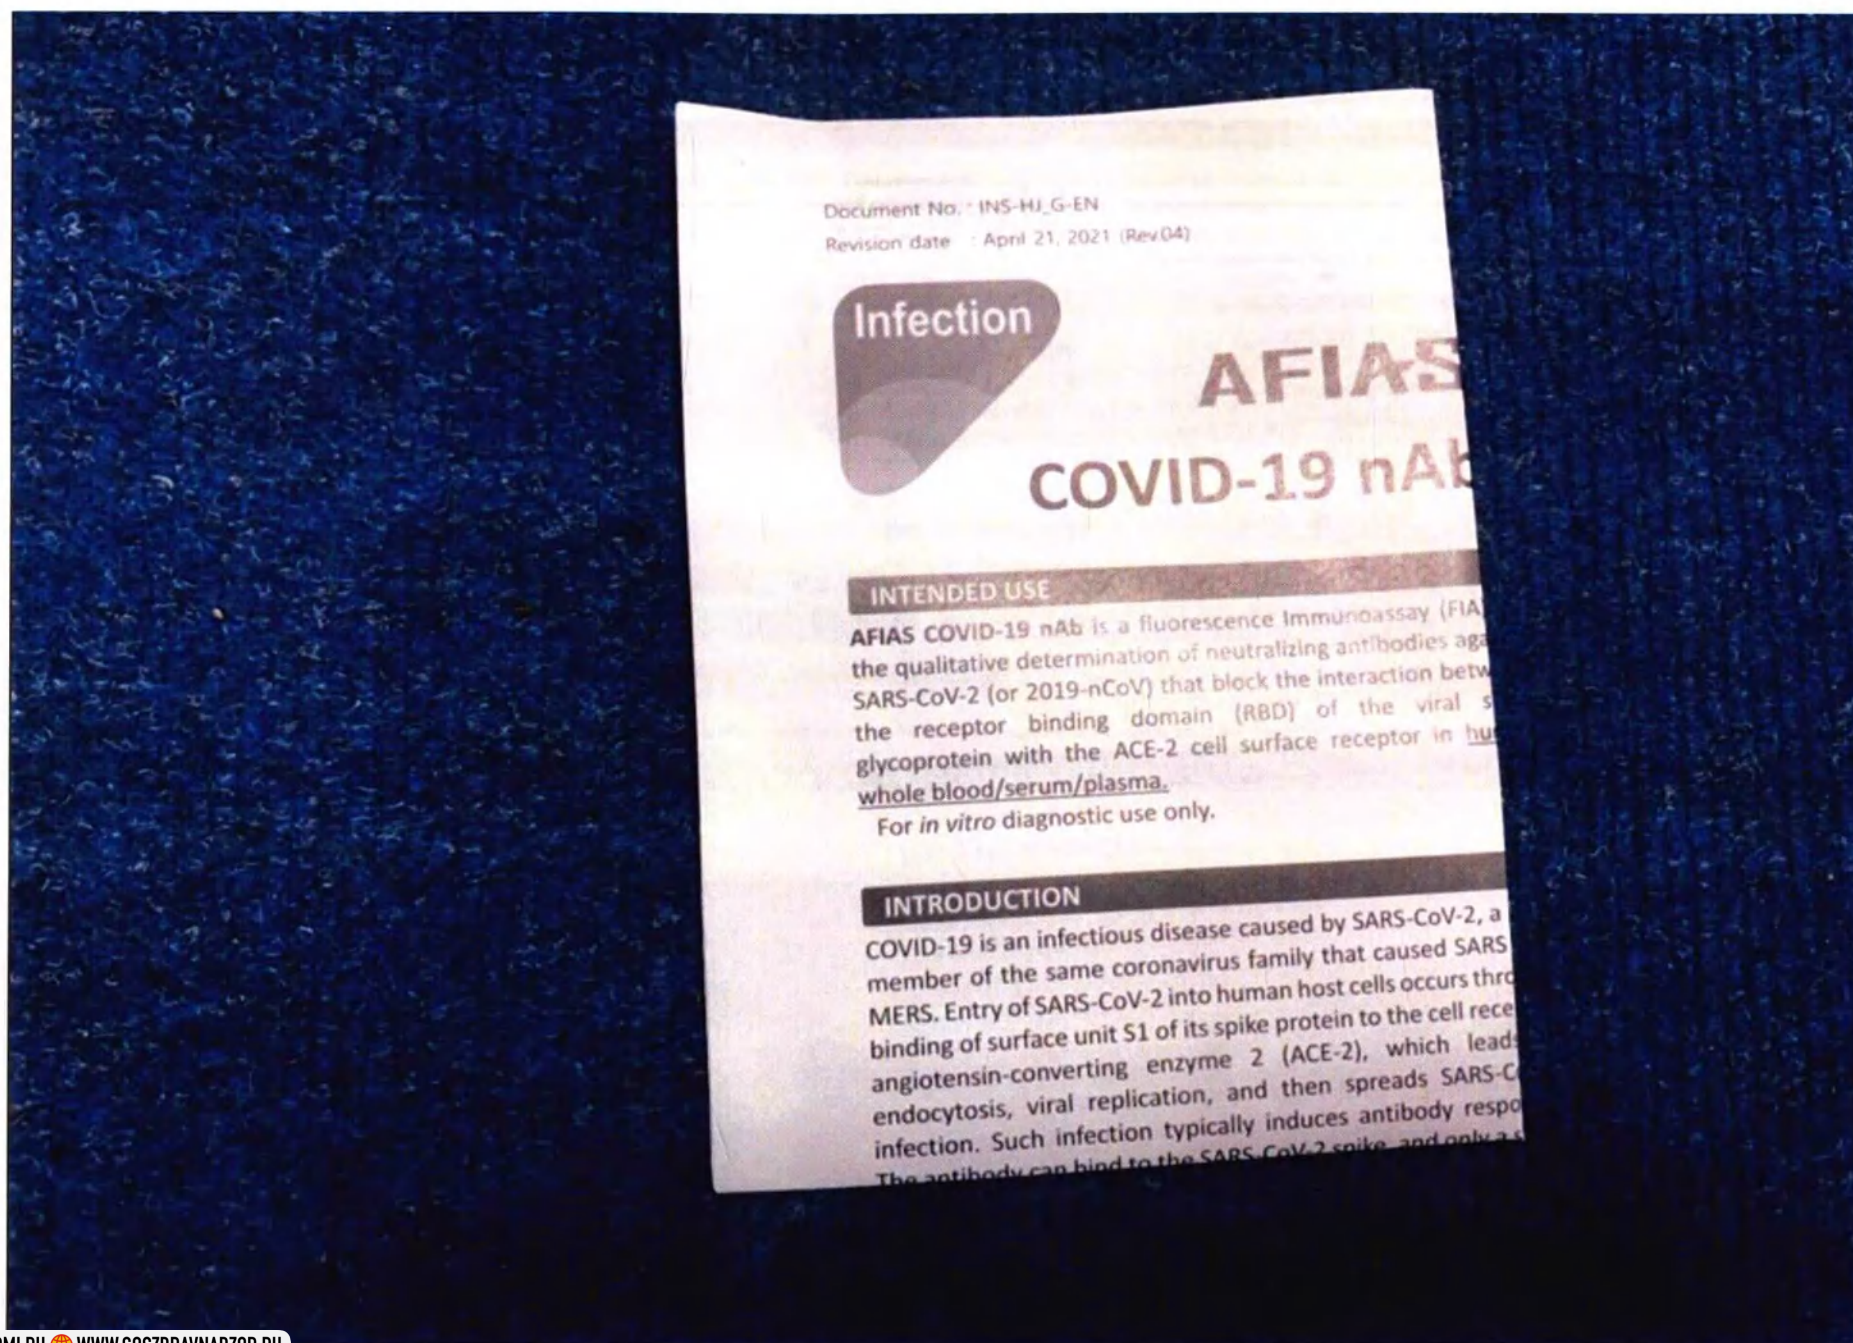



Всего прошито и скреплено
печать 0 12 лист (об)

