

**Фотографии общего вида
медицинского изделия:**

**«Комплекты узлов, деталей и инструментов для сборки аппаратов
внешней фиксации при переломах костей»**

производства

**Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-
технологический парк БНТУ “Политехник”, Республика Беларусь**

Полукольцо Илизарова, Ø140 мм;



Полукольцо Илизарова, Ø140 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 101.01.140-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Полукольцо с комбинированными отверстиями, Ø140 мм;



Полукольцо с отогнутыми краями, Ø140 мм;



Полукольцо с загнутыми краями, Ø140 мм;



Кольцо Илизарова, Ø140 мм;



Дуга 60°, диаметр отверстий: 7,0 мм;



Дуга к аппарату внешней фиксации, R80;



Дуга бедренная комбинированная;



Дуга бедренная комбинированная (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехпарк», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 103.03.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Дуга с пазом, R90 мм;



Дуга с пазом R90 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 103.04.090-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Приставка радиусная, R80; диаметр отверстий 7,0 мм; количество отверстий 2;



Приставка радиусная R80 диаметр отверстий 7,0 мм количество отверстий 2 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рожденская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 104.01.001-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стяжка резьбовая, резьба метрическая М6; длина 100 мм;



Стяжка резьбовая резьба метрическая М6 длина 100 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфил групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 105.01.100-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C;

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стяжка с отверстием, резьба метрическая М6; длина 100 мм;



Стяжка с отверстием, резьба метрическая М6; длина 100 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 105.02.100-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нераскаевающая сталь»

Стяжка distractionная, резьба метрическая М6; длина 40 мм;



Стяжка distractionная, резьба метрическая М6; длина 40 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 105.03.040-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стяжка для телескопической стойки малой, резьба метрическая М5; длина 100 мм;



Стяжка для телескопической стойки малой резьба метрическая М5 длина 100 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ Г К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 105.04.100-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Стяжка для телескопической стойки стандартной, резьба метрическая М6; длина 200 мм;



Стяжка для телескопической стойки стандартной, резьба метрическая М6 длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 105.05.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор для спиц с отверстием;



Фиксатор для спиц с отверстием (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.01.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор для спиц с пазом;



Фиксатор для спиц с пазом (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.02.001-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор стержней с отверстием, диаметр отверстия 5,0 мм;



Фиксатор стержней с отверстием, диаметр отверстия 5.0 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ 3 ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.03.001-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор стержней с хвостовиком, количество отверстий 1; длина 31 мм;



Фиксатор стержней с хвостовиком, количество отверстий 1, длина 31 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Родинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.04.031-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор стержней с резьбовым отверстием, количество отверстий 1;



Фиксатор стержней с резьбовым отверстием, количество отверстий 1 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.05.018 - 01 - 10 - 21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор кистевой;



Фиксатор кистевой (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ЛОМ Г К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.06.130-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор балка-стержень (для АВФ);



Фиксатор балка-стержень (для АВФ) (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.07.001-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор балка-балка (для АВФ);



Фиксатор балка-балка (для АВФ) (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.08.001-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор универсальный (для АВФ);



Фиксатор универсальный (для АВФ) (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 106.09.001-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Фиксатор экстракортикальный, длина 149,7 мм;



Фиксатор экстракортикальный длина 149,7 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 300.000.00.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Титан»

Шайба для винтов, Ø4,2 мм;



Шайба для винтов Ø4.2 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 107.01.003-01-10-21

ПУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Шайба плоская, наружный диаметр Ø10 мм;



Шайба для винтов Ø10 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 107.02.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Шайба с пазом;



Шайба с пазом (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 107.03.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Шайба двойная;

Шайба двойная (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 107.04.001-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Гайка шестигранная;



Гайка шестигранная (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 108.01.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Болт с шестигранной головкой, длина 10 мм;



Болт с шестигранной головкой длина 10 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 109.01.010-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Муфта;



Муфта (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 110.01.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Муфта квадратного сечения, количество рядных отверстий 3;



Муфта квадратного сечения, количество рядных отверстий 3 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Родинская, дом 4, Э.3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 110.02.003-01-07-21

РУ № от:

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Муфта супримекс;



Муфта супримекс (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 110.03.001-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Втулка, длина 20,0 мм;



Втулка, длина 20.0 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 111.01.020-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Планка прямая, количество отверстий 7; толщина 6,0 мм;



Планка прямая, количество отверстий 7; толщина 6,0 мм (1 шт.)
Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Колоса, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, 9-3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021	Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 112.01.006 - 01 - 07 - 21	РУ № от

Транспортирование и хранение металлических изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (У) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.


«Нержавеющая сталь»

Планка винтообразная, количество отверстий 2; толщина 6,0 мм;



Планка винтообразная количество отверстий 2 толщина 6.0 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 112.02.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Планка с резьбовым хвостовиком, количество отверстий 7; толщина 6,0 мм,



Планка с резьбовым хвостовиком количество отверстий 7 толщина 6.0 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 112.03.006-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.


Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Балка круглого сечения из нержавеющей стали, диаметр 11,0 мм; длина 200 мм;



Балка круглого сечения из нержавеющей стали, диаметр 11,0 мм длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 113.01.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Балка круглого сечения из композитных материалов, диаметр 11,0 мм; длина 200 мм;



Балка круглого сечения из композитных материалов диаметр 11.0 мм длина 200 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 113.02.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Кронштейн двухосевой;



Кронштейн двухосевой (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 114.01.001-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Кронштейн угловой;



Кронштейн угловой (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 114.02.001-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (JI) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Телескопическое приспособление, длина 250 мм;



Телескопическое приспособление, длина 250 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К В ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 115.01.200-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°С;
 - относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°С.
- Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°С;
 - относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С.



«Нержавеющая сталь»

Телескопическая стойка малая, диаметр резьбы стержня М5; длина стержня 100 мм;



Телескопическая стойка малая, диаметр резьбы стержня М5; длина стержня 100мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 111.001.80.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Телескопическая стойка стандартная, диаметр резьбы стержня М6; длина стержня 150 мм;



Телескопическая стойка стандартная, диаметр резьбы стержня М6; длина стержня 150мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 102.001.80.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Платик прямой для стержней диаметром М5;



Платик прямой для стержней диаметром М5 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 111.001.22.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Патик Z-образный для стержней диаметром М6;



Патик Z-образный для стержней диаметром М6 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 102.001.23.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Маркер малый, порядковый номер маркера 2;



Маркер малый, порядковый номер маркера 2 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 111.001.00.013-01

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»



Маркер стандартный, порядковый номер маркера 4 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 102.001.60.001-03

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Рентгеновский маркер, порядковый номер маркера 1;



Рентгеновский маркер, порядковый номер маркера 1 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I K 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 100.002.00.000

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Рама для тазовых костей;



Направитель с рукояткой, внутренний диаметр направителя 2,5 мм;



Направитель с рукояткой, внутренний диаметр направителя 2,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 119.01.006-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Скоба для скелетного вытяжения, размер рабочей части 140 мм;



Спицелативатель;



Спицелативатель (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Мінск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рондинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 121.01.001-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Спицентажитель с зажимными винтами;



Спицентажитель с зажимными винтами (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34-1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошонская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 121.01.002-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Троакар, пробойник Ø3,2 мм;



Троакар, пробойник Ø3,2 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ Г К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 122.01.013-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (JI) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Троакар тройной, пробойник Ø3,5 мм;



Троакар тройной, пробойник Ø3,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Родинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 122.02.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Измеритель костного канала;



Измеритель костного канала (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Палатехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.08.2021
Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 123.01.001-01-08-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (П) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Измеритель сторон треугольника;



Ключ для ввода стержней;



Ключ-цанга;



Ключ для ввода винтов I-образный, квадратное сечение наконечника 1,2 мм;



Ключ для ввода винтов I-образный, квадратное сечение наконечника 1,2 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ I K 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.03.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ для ввода винтов I-образный, шестигранное сечение наконечника S2,5 мм;



Ключ для ввода винтов I-образный, шестигранное сечение наконечника S2,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфил групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.10.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.04.001-01-10-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ для ввода винтов с Т-образной рукояткой, квадратное сечение наконечника 1,2 мм;



Ключ для ввода винтов с Т-образной рукояткой, шестигранное сечение наконечника S2,5 мм;



Ключ для ввода винтов с Т-образной рукояткой, шестигранное сечение наконечника S2,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.06.001-01-07-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ универсальный, размер рабочей части 10 мм;



Ключ универсальный, размер рабочей части 10 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Подлiтехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.07.003-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ рожковый, размер рабочей части 10 мм;



Ключ рожковый, размер рабочей части 10 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.08.001-01-11-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ торцевой, размер рабочей части основания (внутреннего шестигранника) S5,5 мм,



Ключ торцевой, размер рабочей части основания (внутреннего шестигранника) S5,5 мм (1 шт.)
Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфей Групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К В ОФ 42А

Дата изготовления: 01.11.2021 Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 124.09.001 - 01 - 11 - 21 РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования и хранения инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

«Нержавеющая сталь»



Ключ рукоятка, размер цапгового отверстия Ø6,5 мм;



Ключ рукоятка, размер цапгового отверстия Ø6,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коваса, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, ЭЗ ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.09.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.10.006-01-09-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Ключ канюлированный, размер сечения наконечника S2,5 мм; диаметр канюлированного отверстия 1,6 мм;



Ключ канюлированный, размер сечения наконечника S3,5 мм; диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм;



Ключ канюлированный, размер сечения наконечника S3,5 мм; диаметр канюлированного отверстия 2,1 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехника», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рошинская, дом 4, Э 3 ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.06.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 124.11.002-01-06-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;

- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Метчик с Т-образной рукояткой, диаметр нарезаемой резьбы 3,5 мм;



Сверло атравматическое, размер рабочей (сверлящей) части Ø2,5 мм;



Сверло атравматическое, размер рабочей (сверлящей) части Ø2,5 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.05.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 126.01.006-01-05-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Сверло каниюлированное, Ø3,2 мм; диаметр внутреннего отверстия Ø1,6 мм; длина 180 мм;



Сверло каниюлированное, Ø3,2 мм; диаметр внутреннего отверстия Ø1,6 мм; длина 180 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3 ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.04.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 126.02.180-01-04-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Сверло канюлированное, Ø4,5 мм; диаметр внутреннего отверстия Ø2,1 мм; длина 180 мм;



Сверло канюлированное, Ø4,5 мм; диаметр внутреннего отверстия Ø2,1 мм; длина 180 мм (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ
«Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 24, к. 34/1

Уполномоченный представитель: ООО «Орфан группа», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ I К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.04.2021

Срок годности (хранения): 5 лет

Серийный номер: 126.03.180-01-04-21

РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.

Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:

- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.

Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Изгибатель пластин ИПМ-1;



Изгибатель пластин ИПМ-1 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я. Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфин групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, Э 3
ПОМ 1 К 8 ОФ 42А

Дата изготовления: 01.07.2021
Срок годности (хранения): 5 лет
Сертификат номер: 127.01.001-01-07-21
РУ № от

Транспортирование и хранение медицинских изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C.
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Д) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.



«Нержавеющая сталь»

Изгибатель пластин ИПМ-2;



Изгибатель пластин ИПМ-2 (1 шт.)

Производитель: Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», Республика Беларусь, 22013, г. Минск, ул. Я.Коласа, д.24, к. 34/1
Уполномоченный представитель: ООО «Орфан групп», Россия, 115191, г. Москва, улица 2-я Ровинская, дом 4, ЭЗ
ПОМ 1 К & ОФ-42А

Дата изготовления: 01.09.2021
Срок годности (хранения): 5 лет
Серийный номер: 127.02.001-01-09-21
Р/У № от

Транспортирование и хранение металлических изделий по ГОСТ 19126.
Условия транспортирования инструментов для условий хранения 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150:
- температура от -50 до +50°C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре +25°C;
Условия хранения инструментов для условий хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150:
- температура от +5 до +35°C;
- относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°C.

 «Нержавеющая сталь»


Ящик для хранения и стерилизации со сменными фильтрами, ширина 290 мм; длина 580 мм;
высота 170 мм;



Сетка для хранения и стерилизации винтов Ø2,7 мм; ширина 115 мм; длина 180 мм; высота 45 мм;





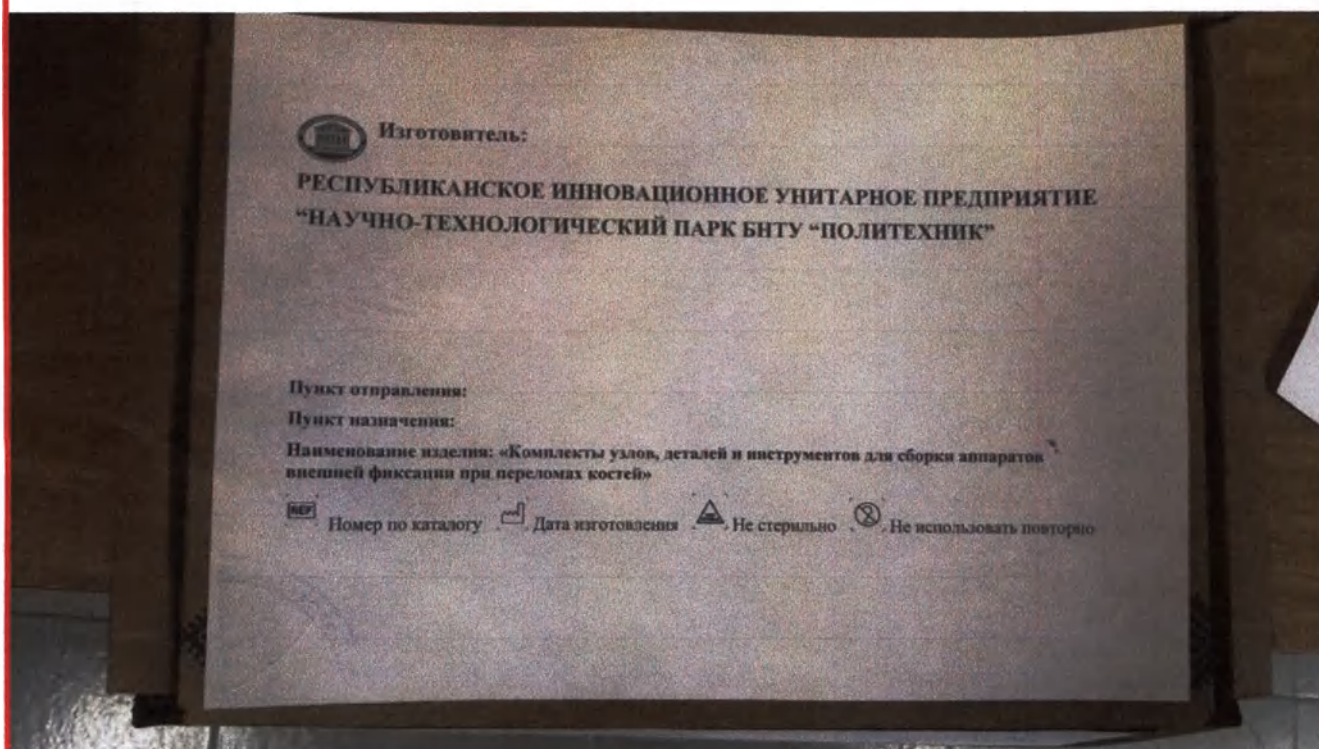

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 82 листа

Генеральный директор ООО «Орфан групп»



Беляков Д.В.