

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Научно-производственная фирма

«ВИНАР»

В.С. Андреев

«19» января 2022 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

МАКЕТЫ УПАКОВКИ И ЭТИКЕТОК

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЕ ЭомиТЕСТ®

ТУ 9398-180-11764404-2016

Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».

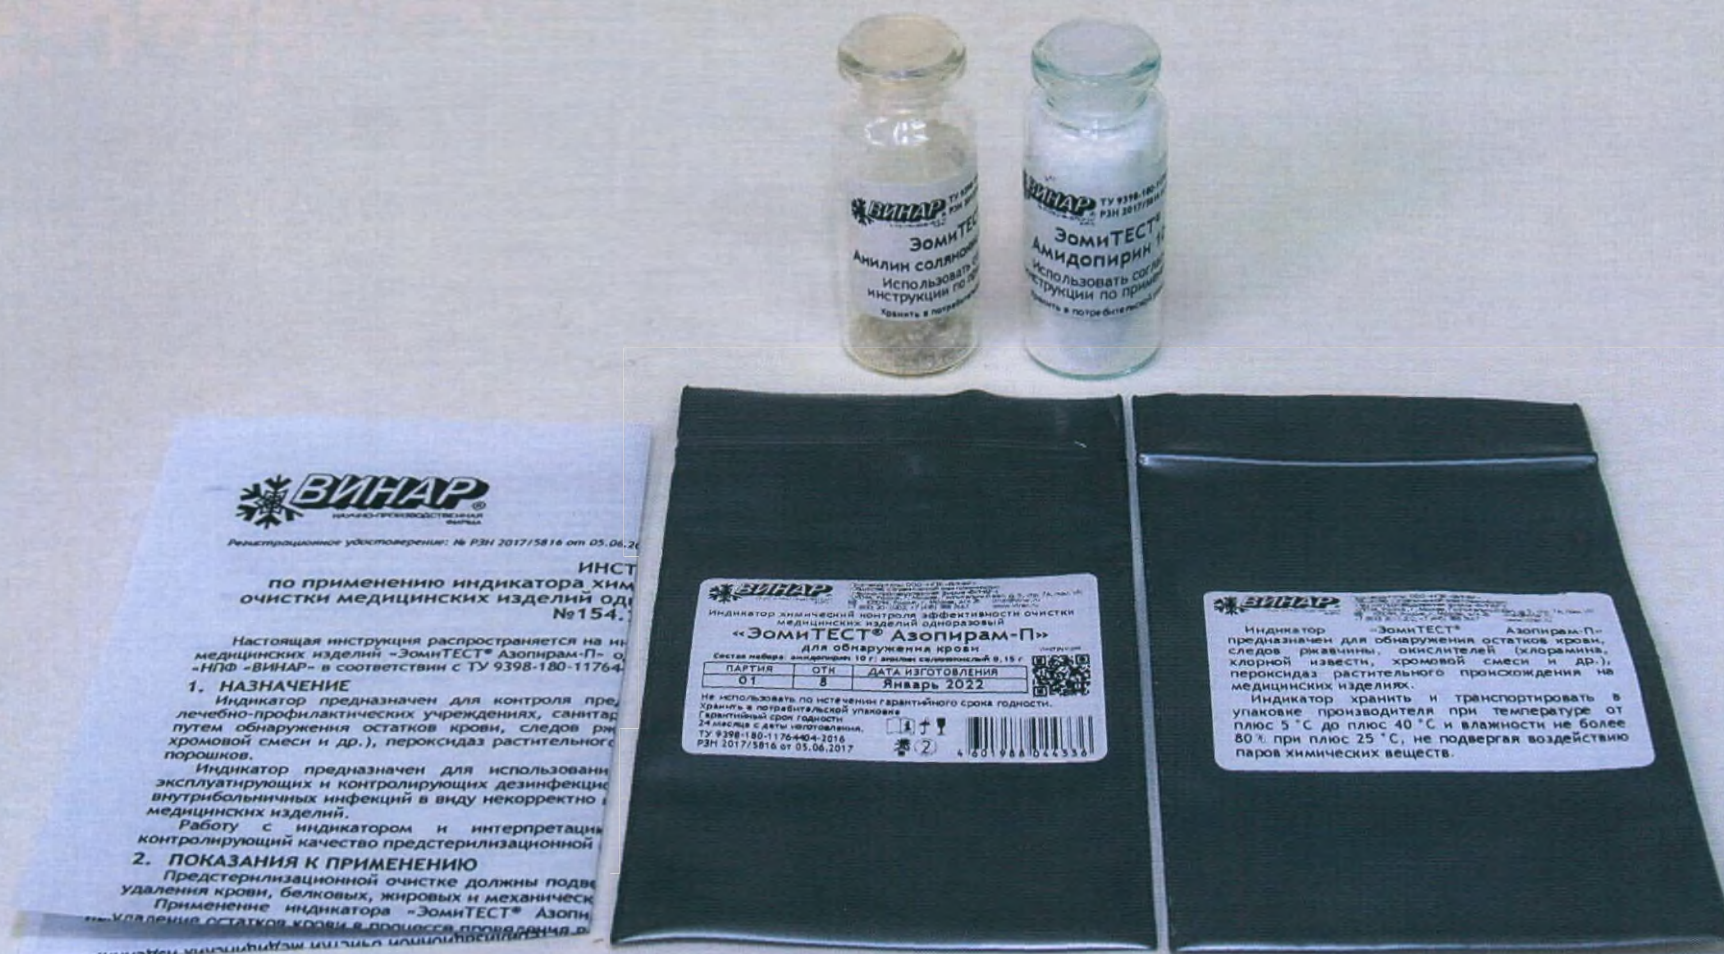

Макеты этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-П» для обнаружения крови

Инструкция

Состав набора: амидопирин 10 г; анилин солянокислый 0,15 г

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

Хранить в потребительской упаковке

Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016

РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П»
предназначен для обнаружения остатков крови,
следов ржавчины, окислителей (хлорамина,
хлорной извести, хромовой смеси и др.),
пероксидаз растительного происхождения на
медицинских изделиях.

Индикатор хранить и транспортировать в
упаковке производителя при температуре от
плюс 5 °С до плюс 40 °С и влажности не более
80 % при плюс 25 °С, не подвергая воздействию
паров химических веществ.

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».

Инструкция



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».



ЭомиТЕСТ®
Амидопирин 10 г
Использовать согласно
инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке



ЭомиТЕСТ®
Анилин солянокислый 0,15 г
Использовать согласно
инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Азопирам-П».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-П»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность
80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».



Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Гостеприимный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С»
для обнаружения крови

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С» предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения на медицинских изделиях.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С и влажности не более 80% при плюс 25 °С, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Состав набора: амидопирин 10 г,
анилин солянокислый 0,15 г, спирт 100 мл

Инструкция



ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Не использовать по истечении гарантийного срока годности.


Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017




Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».


Инструкция

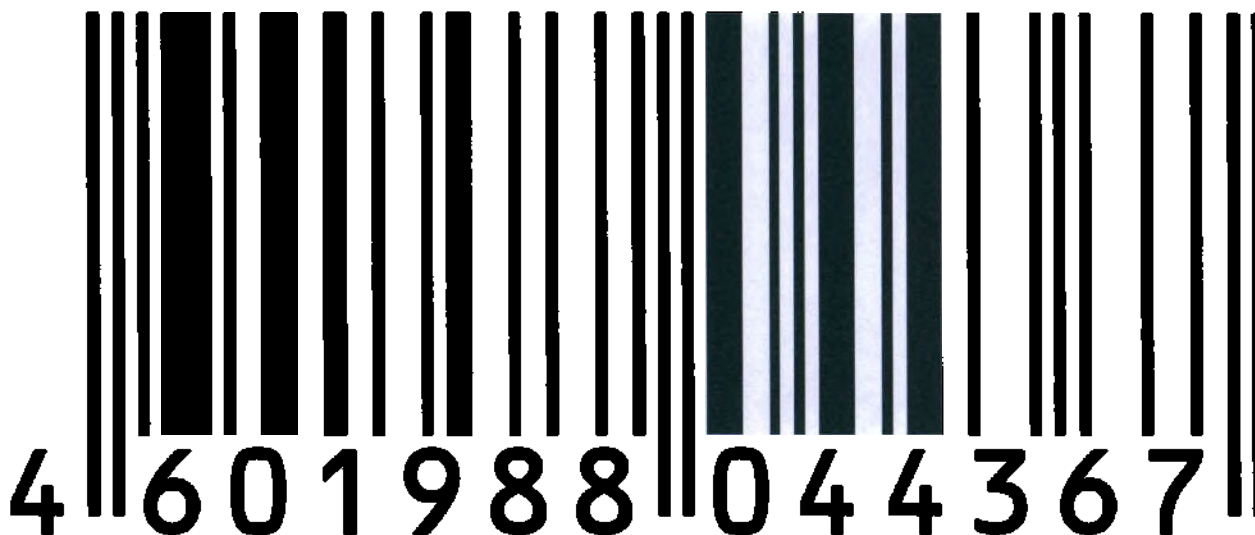

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».

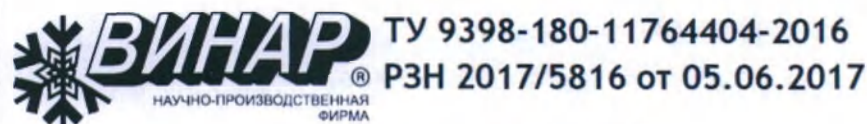

ЭомиТЕСТ®
Амидопирин 10 г
Использовать согласно
инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

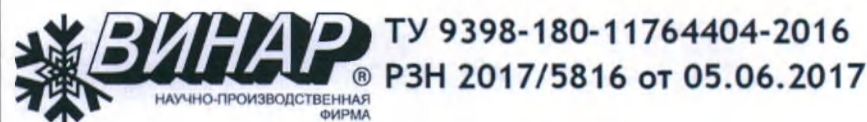

ЭомиТЕСТ®
Анилин солянокислый 0,15 г
Использовать согласно
инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке




ЭомиТЕСТ®
Спирт
100 мл

Использовать
согласно инструкции
по применению

Хранить в потребительской
упаковке

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».

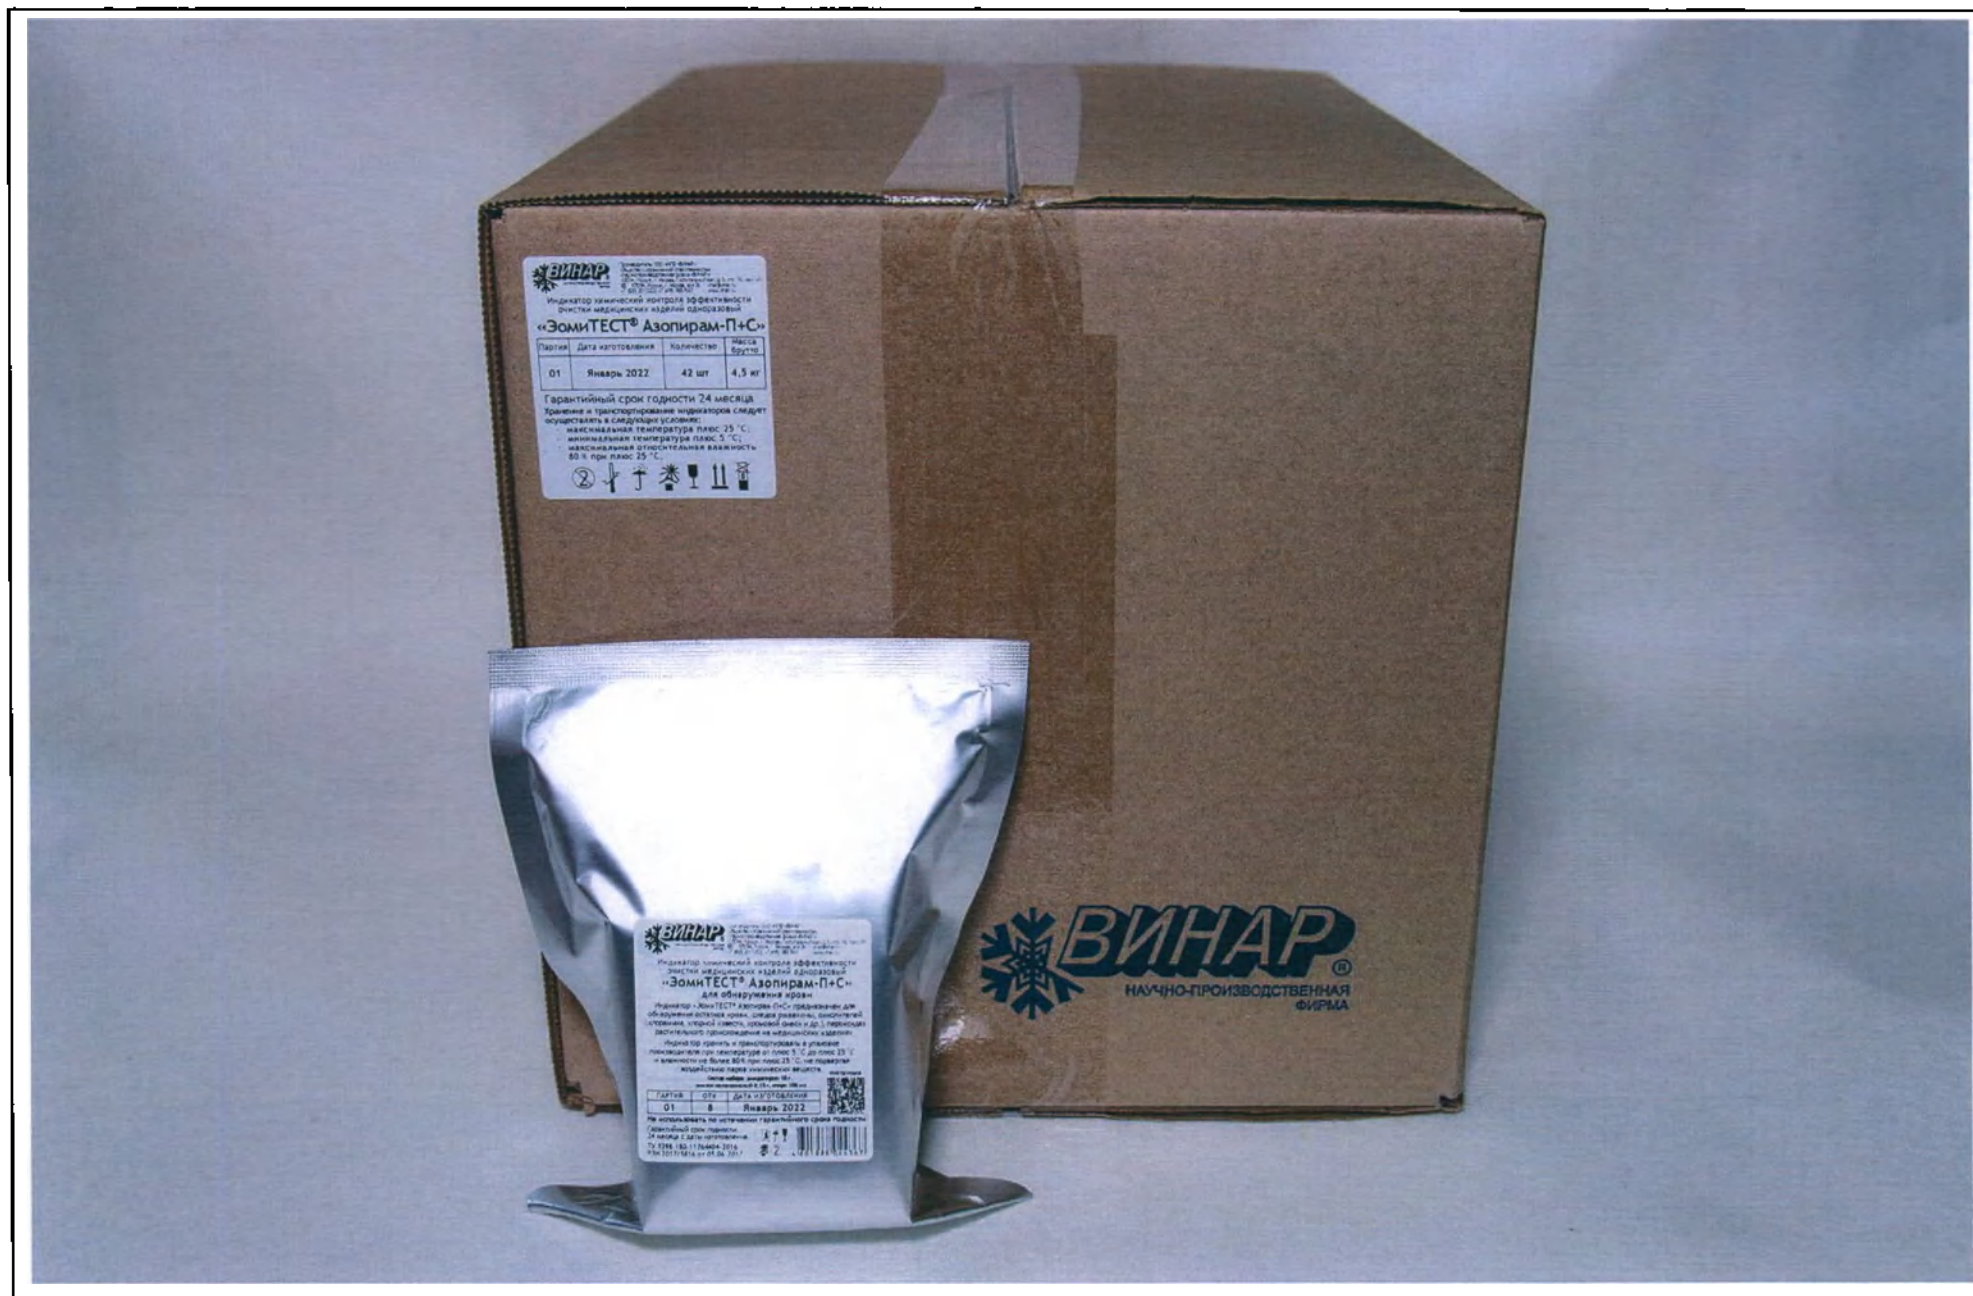

Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-П+С»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто


Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».

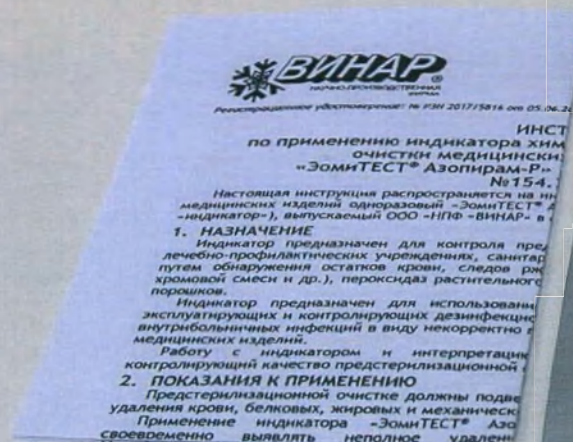

Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р»
для обнаружения крови

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р» предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения на медицинских изделиях.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С и влажности не более 80 % при плюс 25 °С, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Инструкция

Состав набора: амидопирин 10 г,
раствор анилина солянокислого 10мл

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Макет вкладыша в блистер. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ

Состав набора:
амидопирин 10 г
раствор анилина солянокислого 10 мл

РУ № РЗН 2017/5816 от 05.06.2017
ТУ 9398-180-11764404-2016

ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ!

Для однократного применения.
Использовать в соответствии с инструкцией по применению.
Беречь от влаги, не допускать воздействия солнечного света.



ИНСТРУКЦИЯ



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80% при плюс 25 °С.

Гарантийный срок годности 24 месяца.

Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

ПАРТИЯ ОТК ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».

ИНСТРУКЦИЯ



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®

Анилин солянокислый 10 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®

Амидопирин 10 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность
80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».



Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р»
для обнаружения крови

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р» предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения на медицинских изделиях.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С и влажности не более 80% при плюс 25 °С, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Состав набора: амидопирин 10 г (2),
раствор анилина солянокислого 10мл (2)

Инструкция



ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Макет вкладыша в блистер. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ

Состав набора:

амидопирин 10 г (2)

раствор анилина солянокислого 10 мл (2)

ПУ № РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ТУ 9398-180-11764404-2016

ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ!

Для однократного применения.

Использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Беречь от влаги, не допускать воздействия солнечного света.



ИНСТРУКЦИЯ



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80% при плюс 25 °С.

Гарантийный срок годности 24 месяца.

Не использовать по истечении гарантийного срока годности.


ПАРТИЯ ОТК ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».

ИНСТРУКЦИЯ



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».

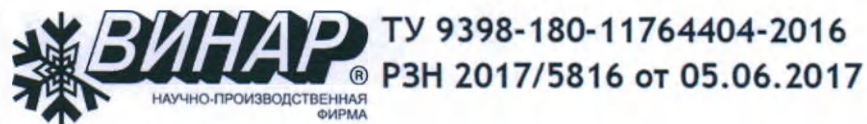


ЭомиТЕСТ®

Анилин солянокислый 10 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

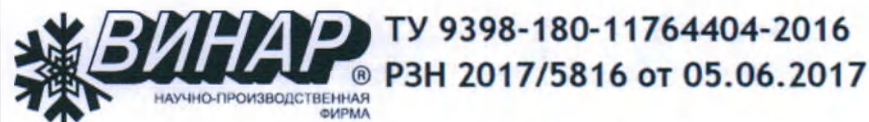

ЭомиТЕСТ®

Амидопирин 10 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-Р+Р»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов
следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность
80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Азопирам-К»
для обнаружения крови

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К» предназначен для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси и др.), пероксидаз растительного происхождения на медицинских изделиях.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С и влажности не более 80% при плюс 25 °С, не подвергая воздействию паров химических веществ.

Инструкция

Состав набора: раствор амидопирина 90 мл,
раствор анилина солянокислого 10 мл

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».

ИНСТРУКЦИЯ



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®

Анилин солянокислый 10 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке



ЭомиТЕСТ®
Амидопирин
90 мл

Использовать
согласно инструкции
по применению

Хранить в потребительской
упаковке

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроль эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Азопирам-К».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Азопирам-К»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».



Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Хема 1

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ

Количество 10 штук

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Инструкция

Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С
- минимальная температура плюс 2 °С
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°С


Допускается хранение индикаторов при температуре до плюс 25 °С не более пяти суток

Транспортирование индикаторов допускается в условиях:


- максимальная температура плюс 25 °С
 - минимальная температура плюс 5 °С
- не более 5 суток

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».

Инструкция

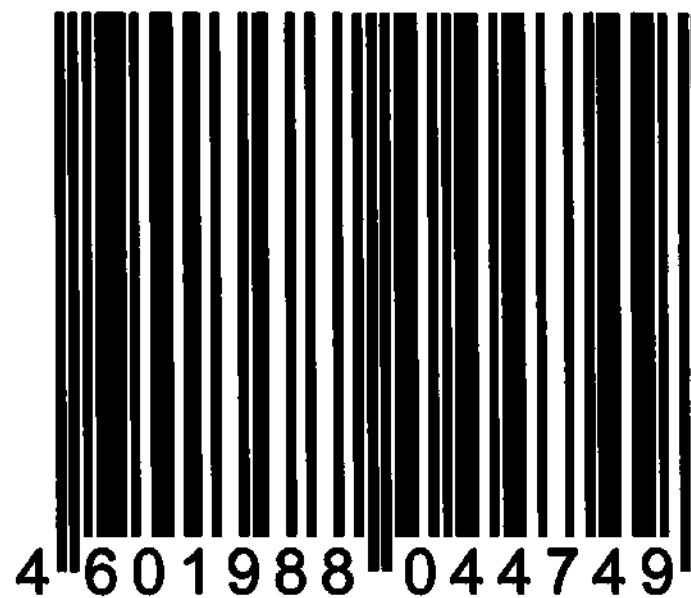

Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».

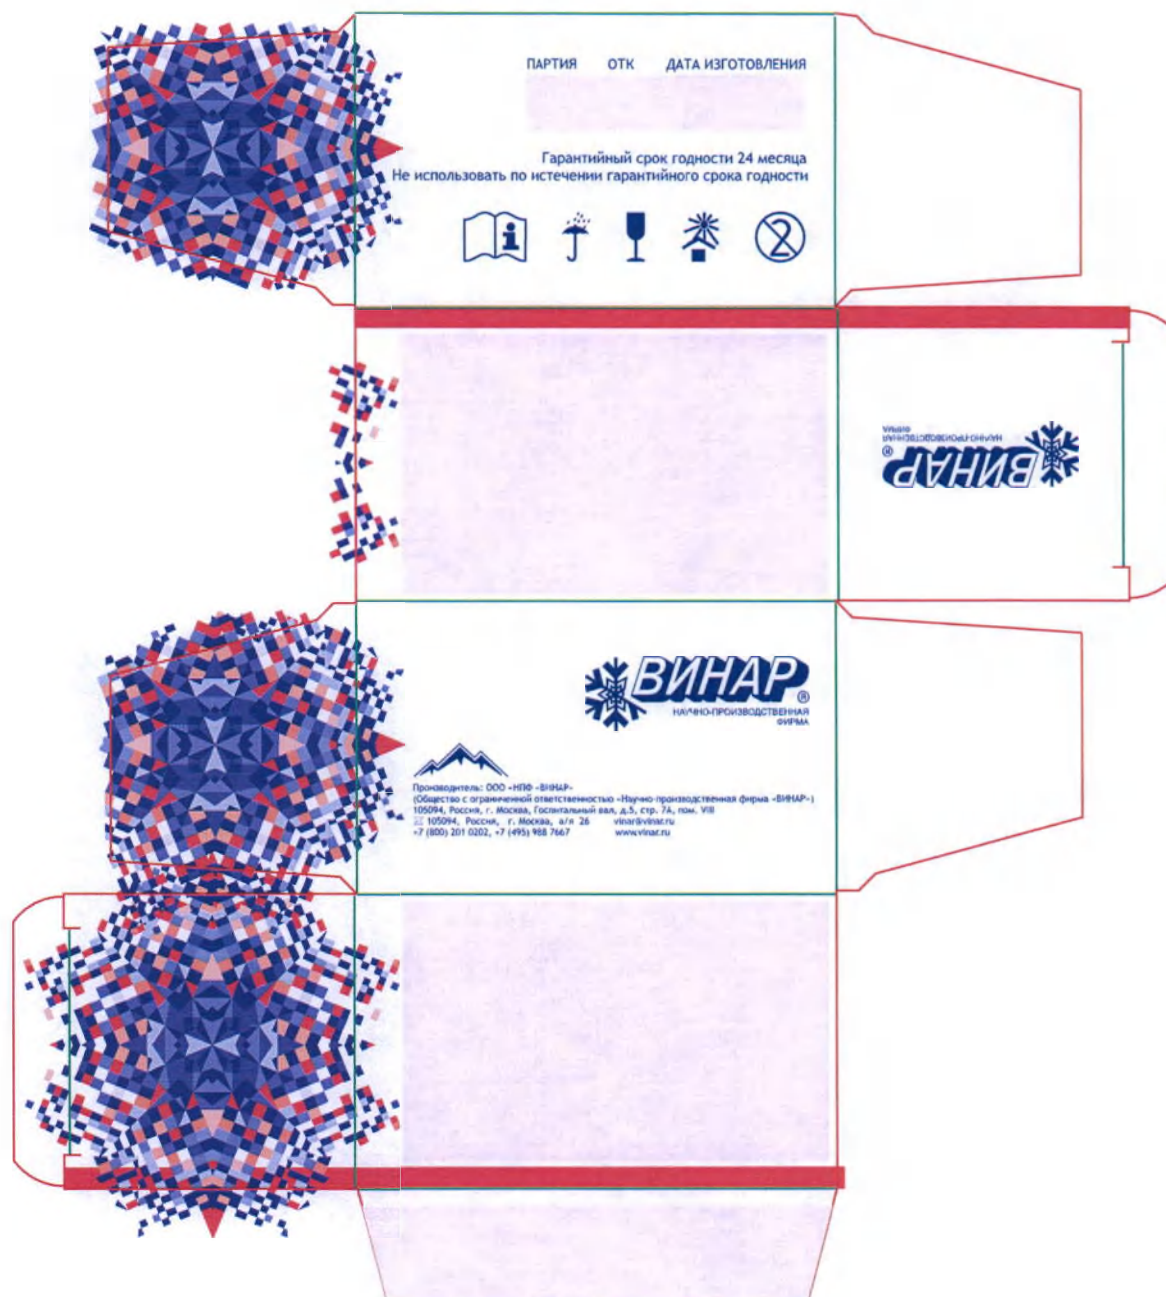

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».

ЭомиТЕСТ® Индикаторный состав Хема



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема 1»

для обнаружения крови
Индикаторный состав Хема
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 1».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема 1»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.





Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Хема 2

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ

Количество 1 комплект

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С
- минимальная температура плюс 2 °С
- максимальная относительная влажность 80 % при

плюс 25°С

Допускается хранение индикаторов при температуре до плюс 25 °С не более пяти суток


Транспортирование индикаторов допускается в условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С
- минимальная температура плюс 5 °С

не более 5 суток

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».

Инструкция

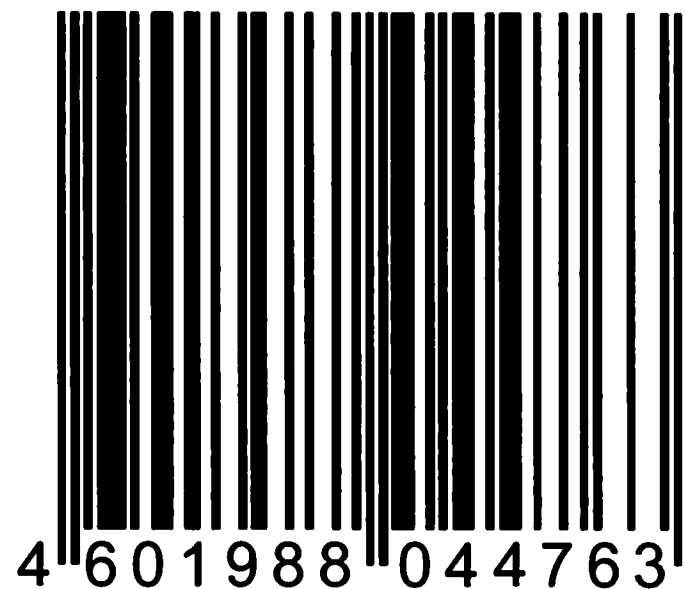

Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

ТУ 9398-180-11764404-2016

РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®
Индикаторный состав
Хема 15 мл

Использовать согласно
инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема 2».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема 2»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».



Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».




ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Хема К

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ

Количество 10 штук

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Инструкция



Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С
- минимальная температура плюс 2 °С
- максимальная относительная

влажность 80 % при плюс 25°С

Допускается хранение индикаторов при температуре до плюс 25 °С не более пяти суток

Транспортирование индикаторов допускается в условиях:


- максимальная температура плюс 25°С
 - минимальная температура плюс 5 °С
- не более 5 суток

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».

Инструкция



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».

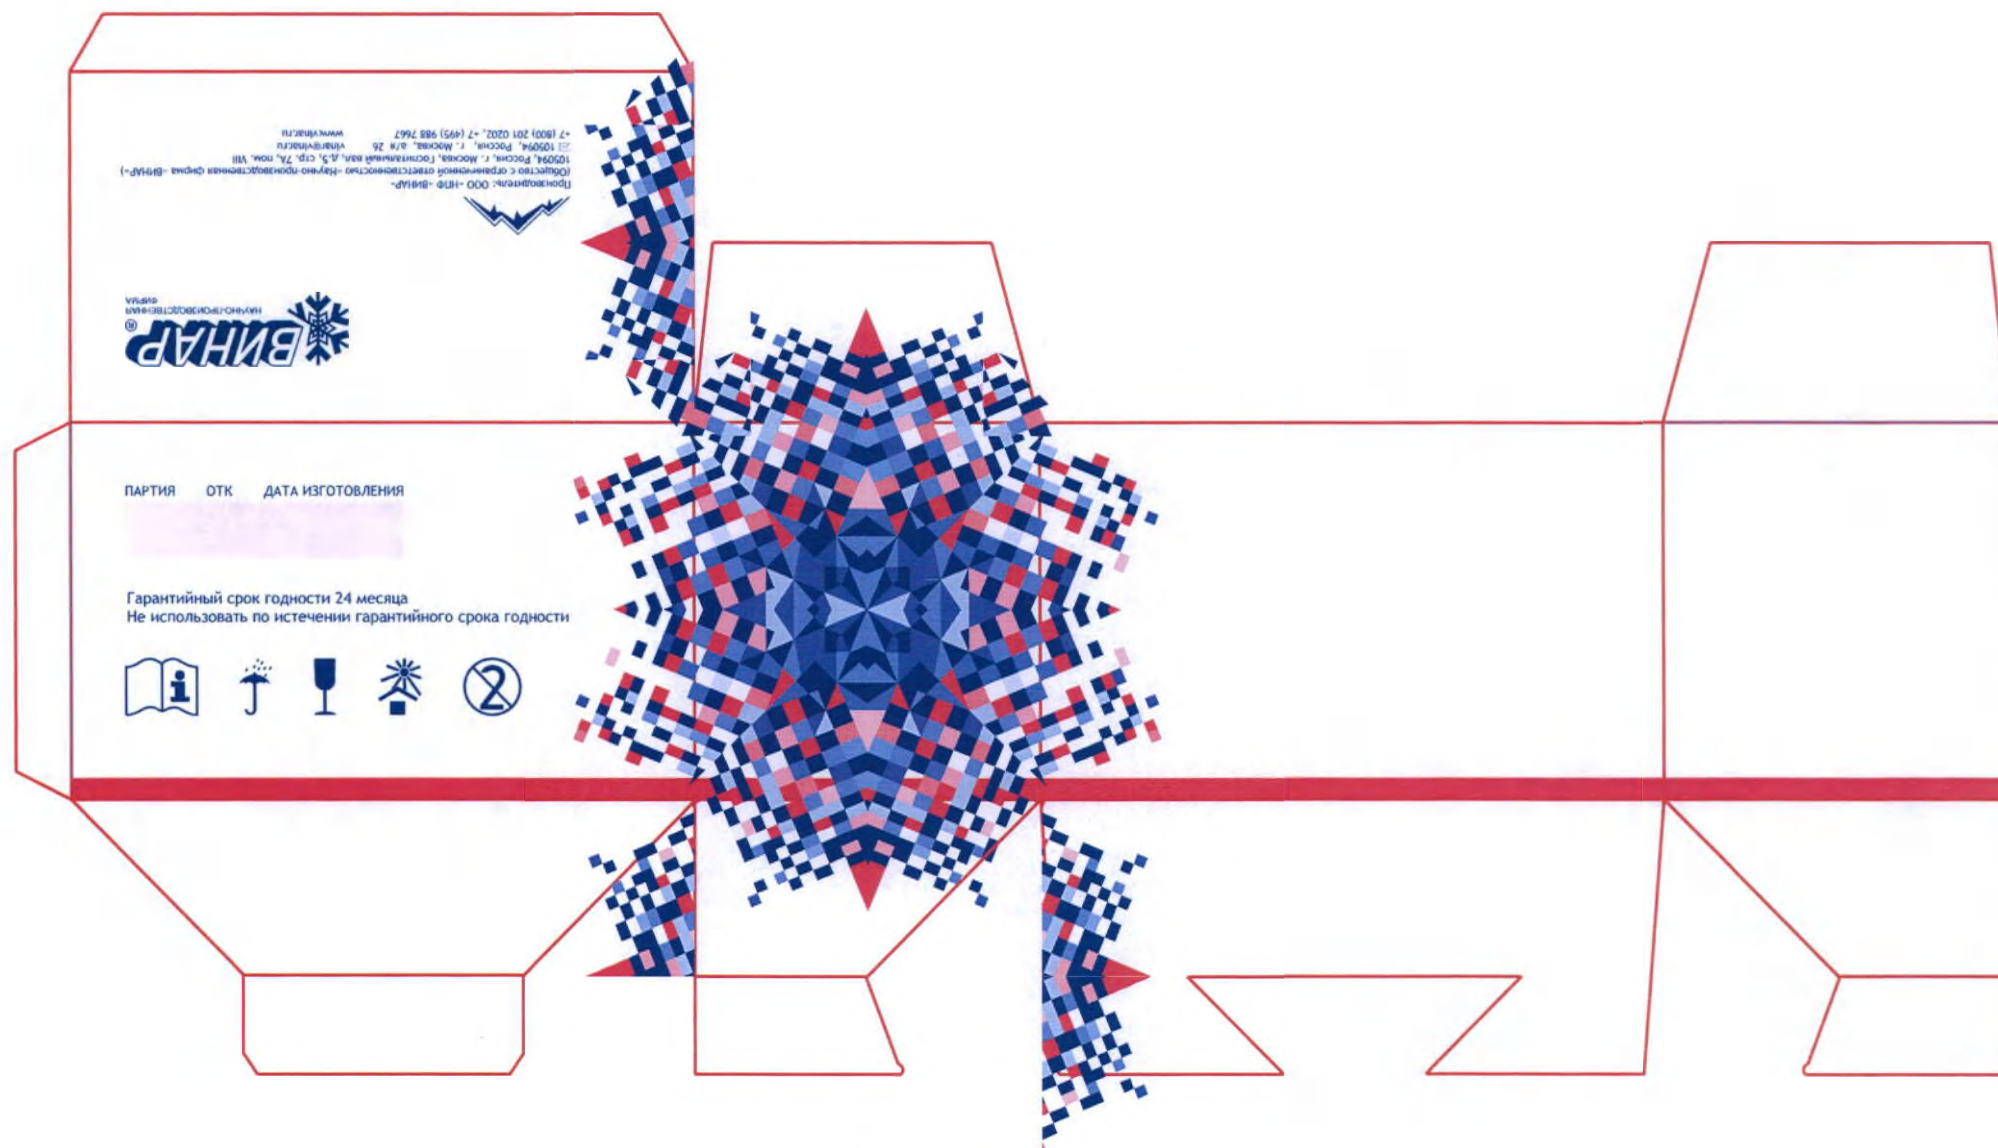

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».

ЭомиТЕСТ® **Индикаторный состав** **Хема**

ЭомиТЕСТ® **Перекись водорода 3%** **стабилизированная**



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема К»

для обнаружения крови
Индикаторный состав Хема
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема К»

для обнаружения крови
Перекись водорода 3% стабилизированная
0,1 г X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема К».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема К»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».



Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Хема эндо



Инструкция



ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КРОВИ


Количество 10 штук

ТУ 9398-180-11764404-2016


ПУ № РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».

Инструкция

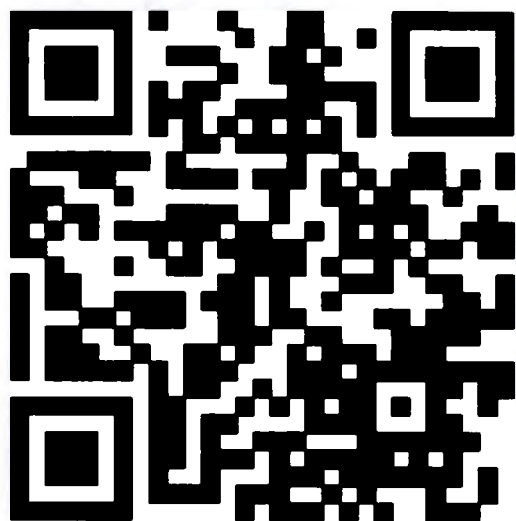

Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».

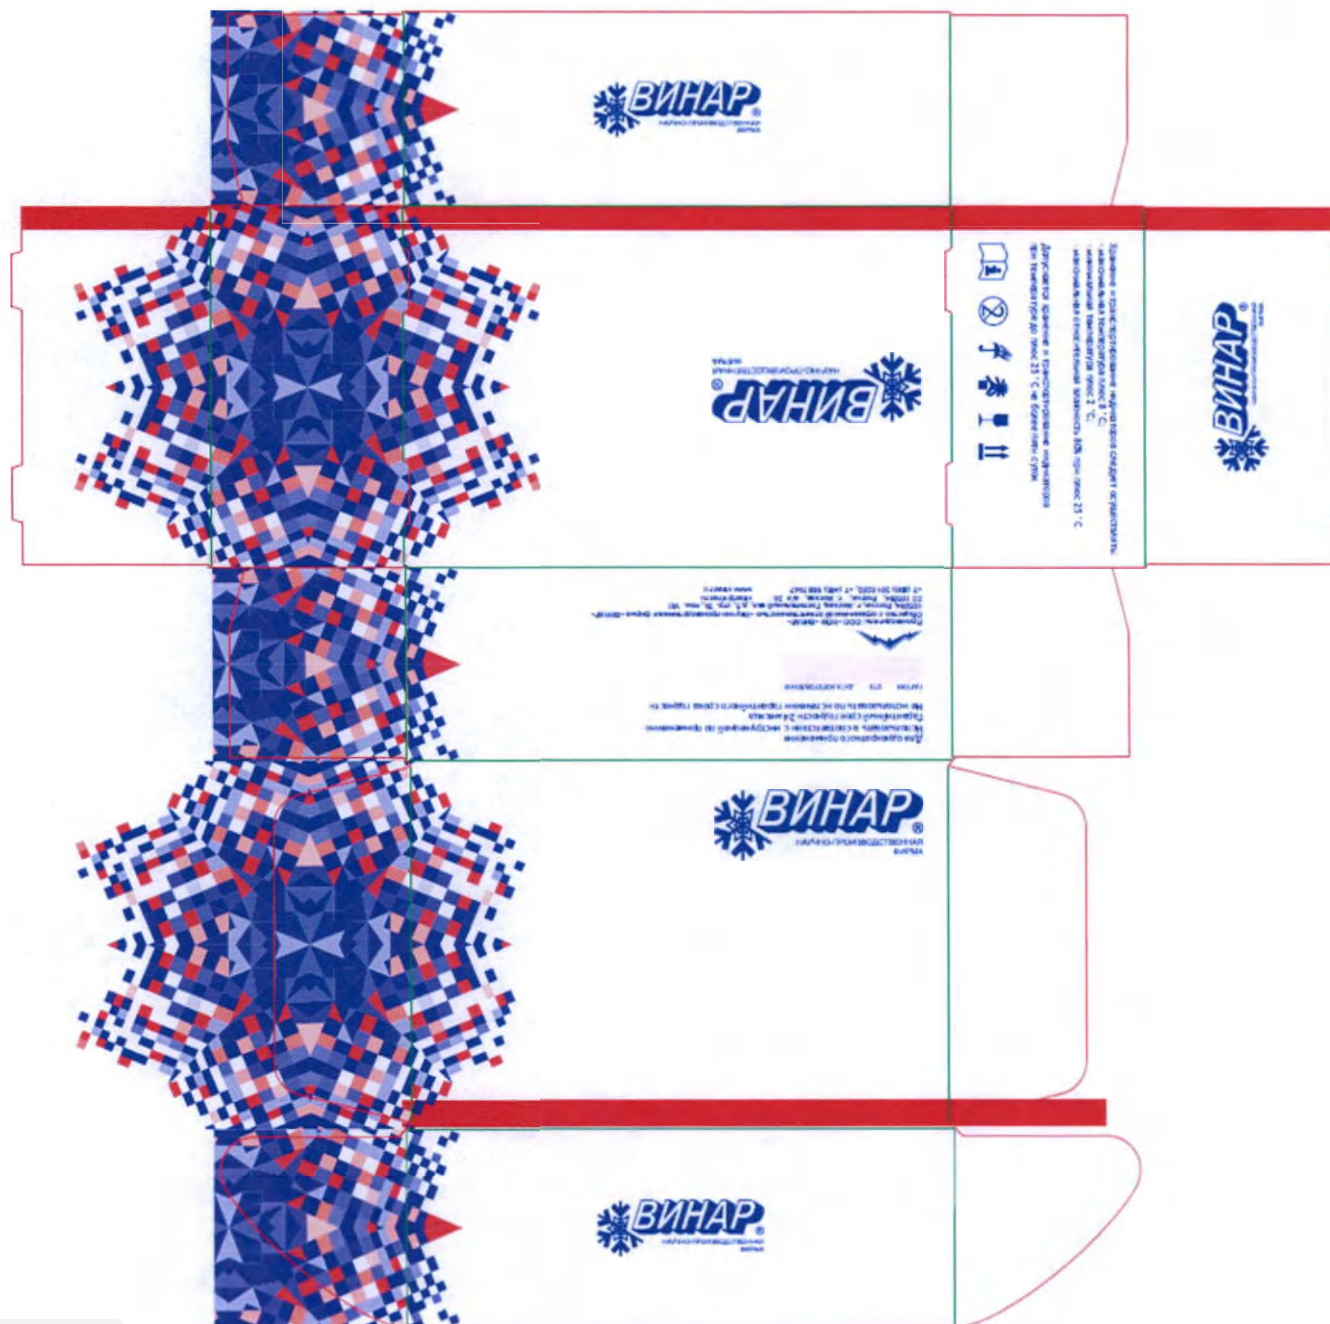

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».

ЭомиТЕСТ®

Индикаторный состав Хема

ЭомиТЕСТ®

Перекись водорода 3% стабилизированная



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Хема эндо»
для обнаружения крови
Индикаторный состав Хема
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Хема эндо»
для обнаружения крови
Перекись водорода 3% стабилизированная
0,1 г X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Хема эндо».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Хема эндо»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».



Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Белок 1



ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Инструкция



Количество 10 штук

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С
- минимальная температура плюс 2 °С
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°С

Допускается хранение индикаторов при температуре до плюс 25 °С не более пяти суток

Транспортирование индикаторов допускается в условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С
- минимальная температура плюс 5 °С

не более 5 суток

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».

Инструкция



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».



Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».

ЭомиТЕСТ® Индикаторный состав Белок



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 1»
для обнаружения белковых загрязнений
Индикаторный состав Белок
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 1».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Белок 1»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 2».



Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 2».

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Белок 2

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Инструкция

Количество 1 комплект

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:


- максимальная температура плюс 25 °С
- минимальная температура плюс 5 °С
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°С

Транспортирование индикаторов допускается в условиях


- максимальная температура плюс 40 °С
- минимальная температура плюс 5 °С
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°С

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 2».


Инструкция

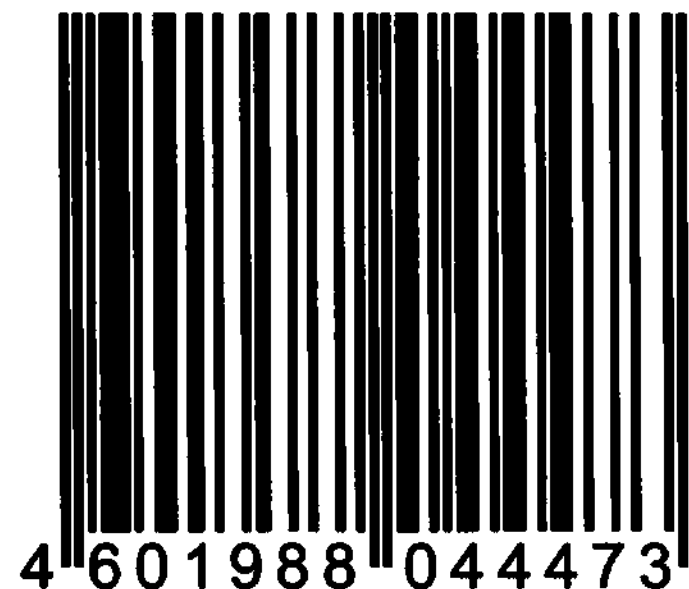

Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 2».

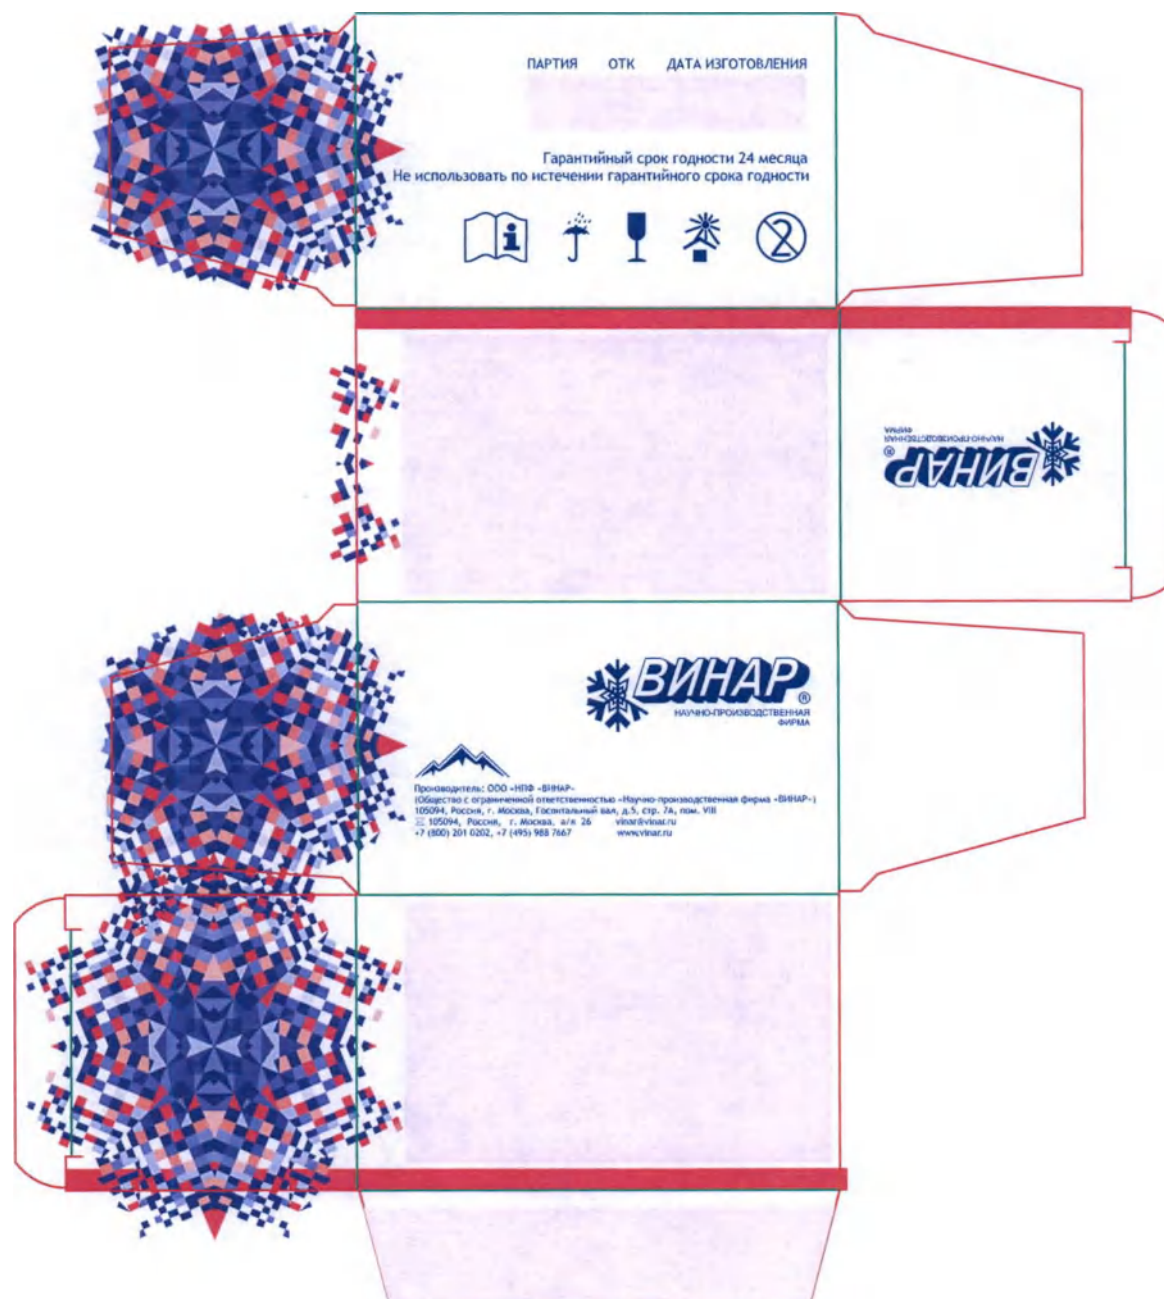

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 2».

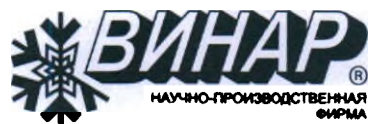

ТУ 9398-180-11764404-2016


РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®

Реактив Белок №1 15 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

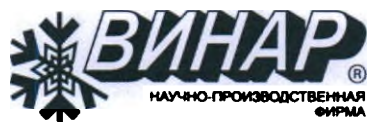

ТУ 9398-180-11764404-2016

РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®

Реактив Белок №2 15 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 2».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 2».



Производитель: ООО «НПО «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Белок 2»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение индикаторов следует осуществлять в
следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при
плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 40 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».




Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».



ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Белок 3



ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Инструкция



Количество 10 штук

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Хранение индикаторов следует осуществлять в упаковке производителя в течение всего срока годности в помещении при условиях:

- максимальная температура плюс 25°C
- минимальная температура плюс 5 °C
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°C

Транспортирование индикаторов допускается в условиях:


- максимальная температура плюс 40°C
- минимальная температура плюс 5 °C
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25°C

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».

Инструкция



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 3».

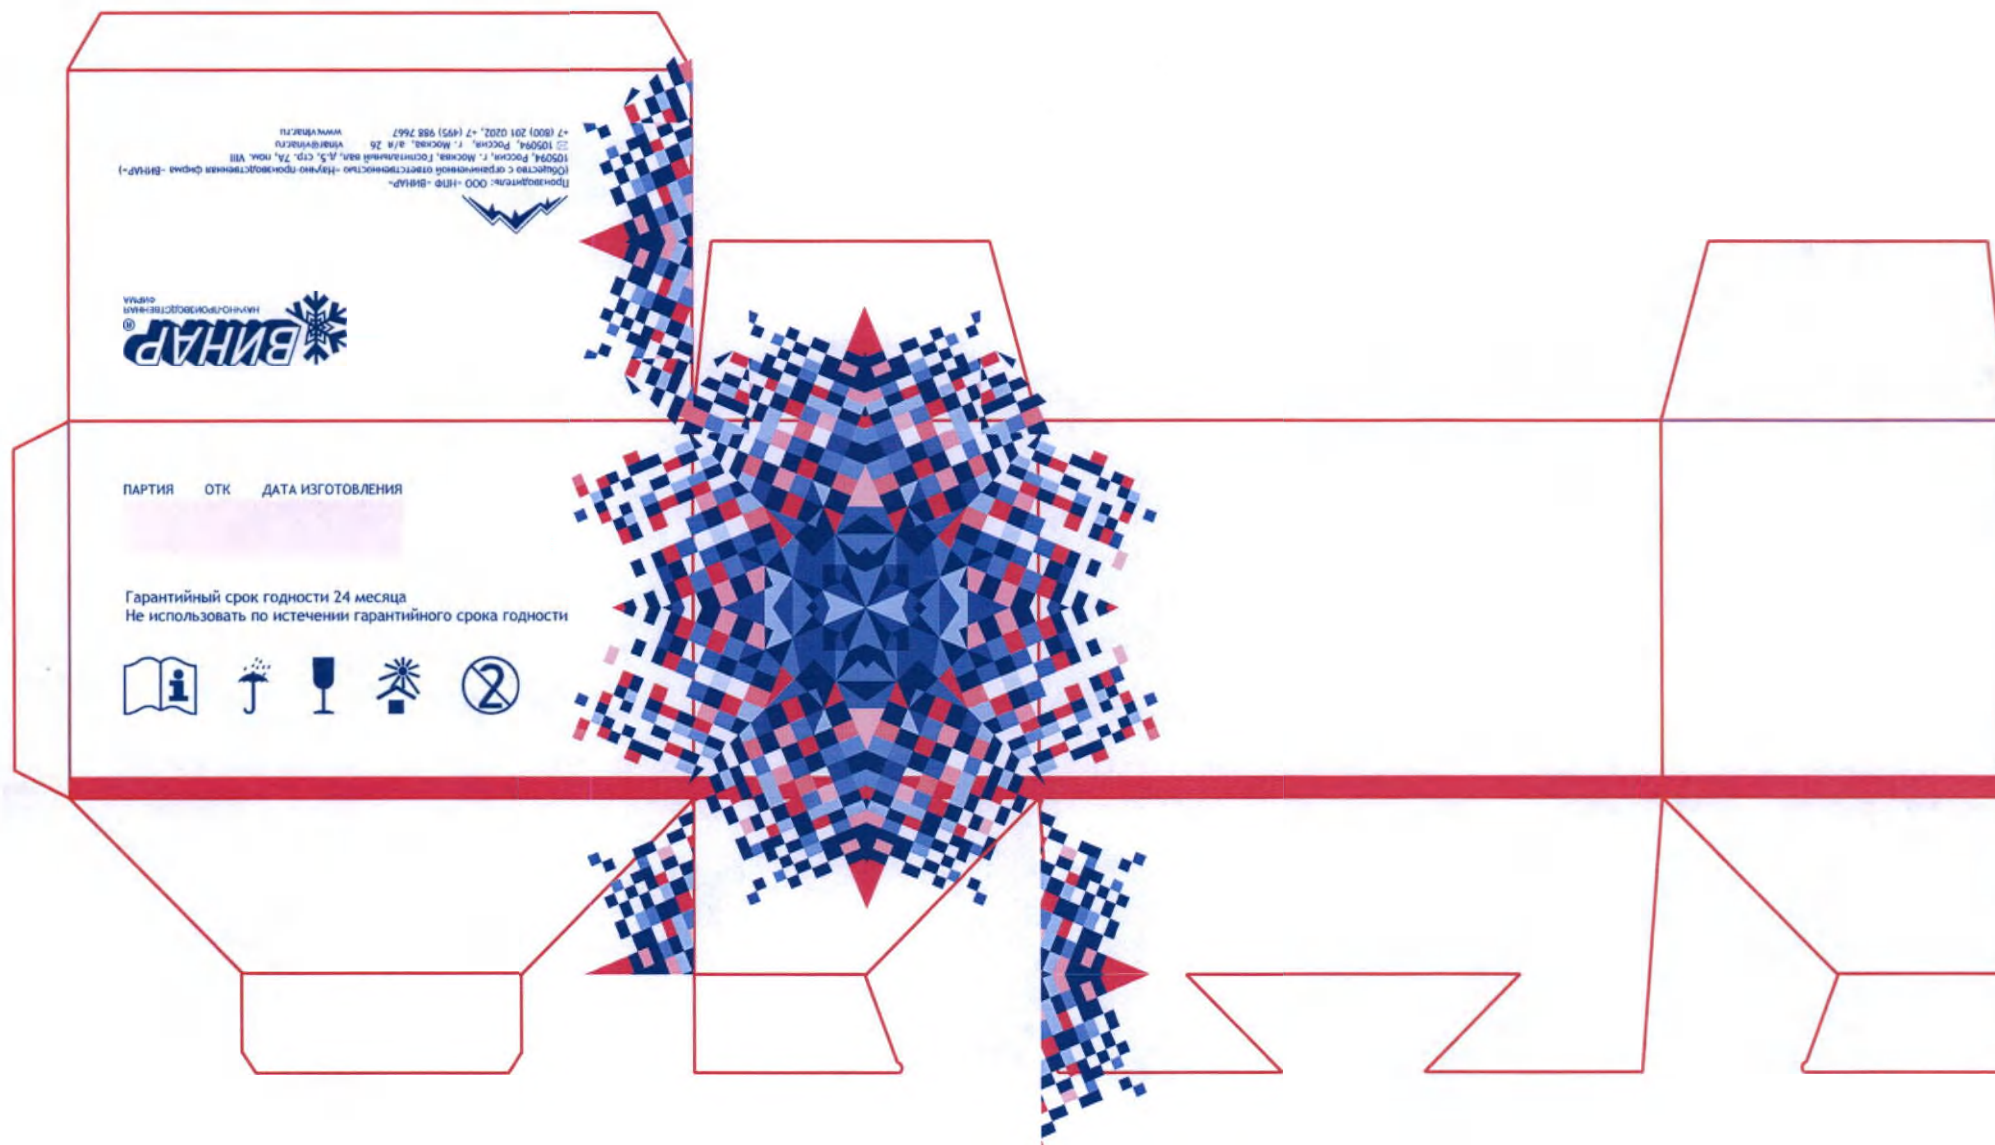

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».

ЭомиТЕСТ® Реактив Белок №1

ЭомиТЕСТ® Реактив Белок №2



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 3»
для обнаружения белковых загрязнений
Реактив Белок №1
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок 3»
для обнаружения белковых загрязнений
Реактив Белок №2
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок 3».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Белок 3»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца


Хранение индикаторов следует осуществлять в
следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при
плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 40 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок эндо».

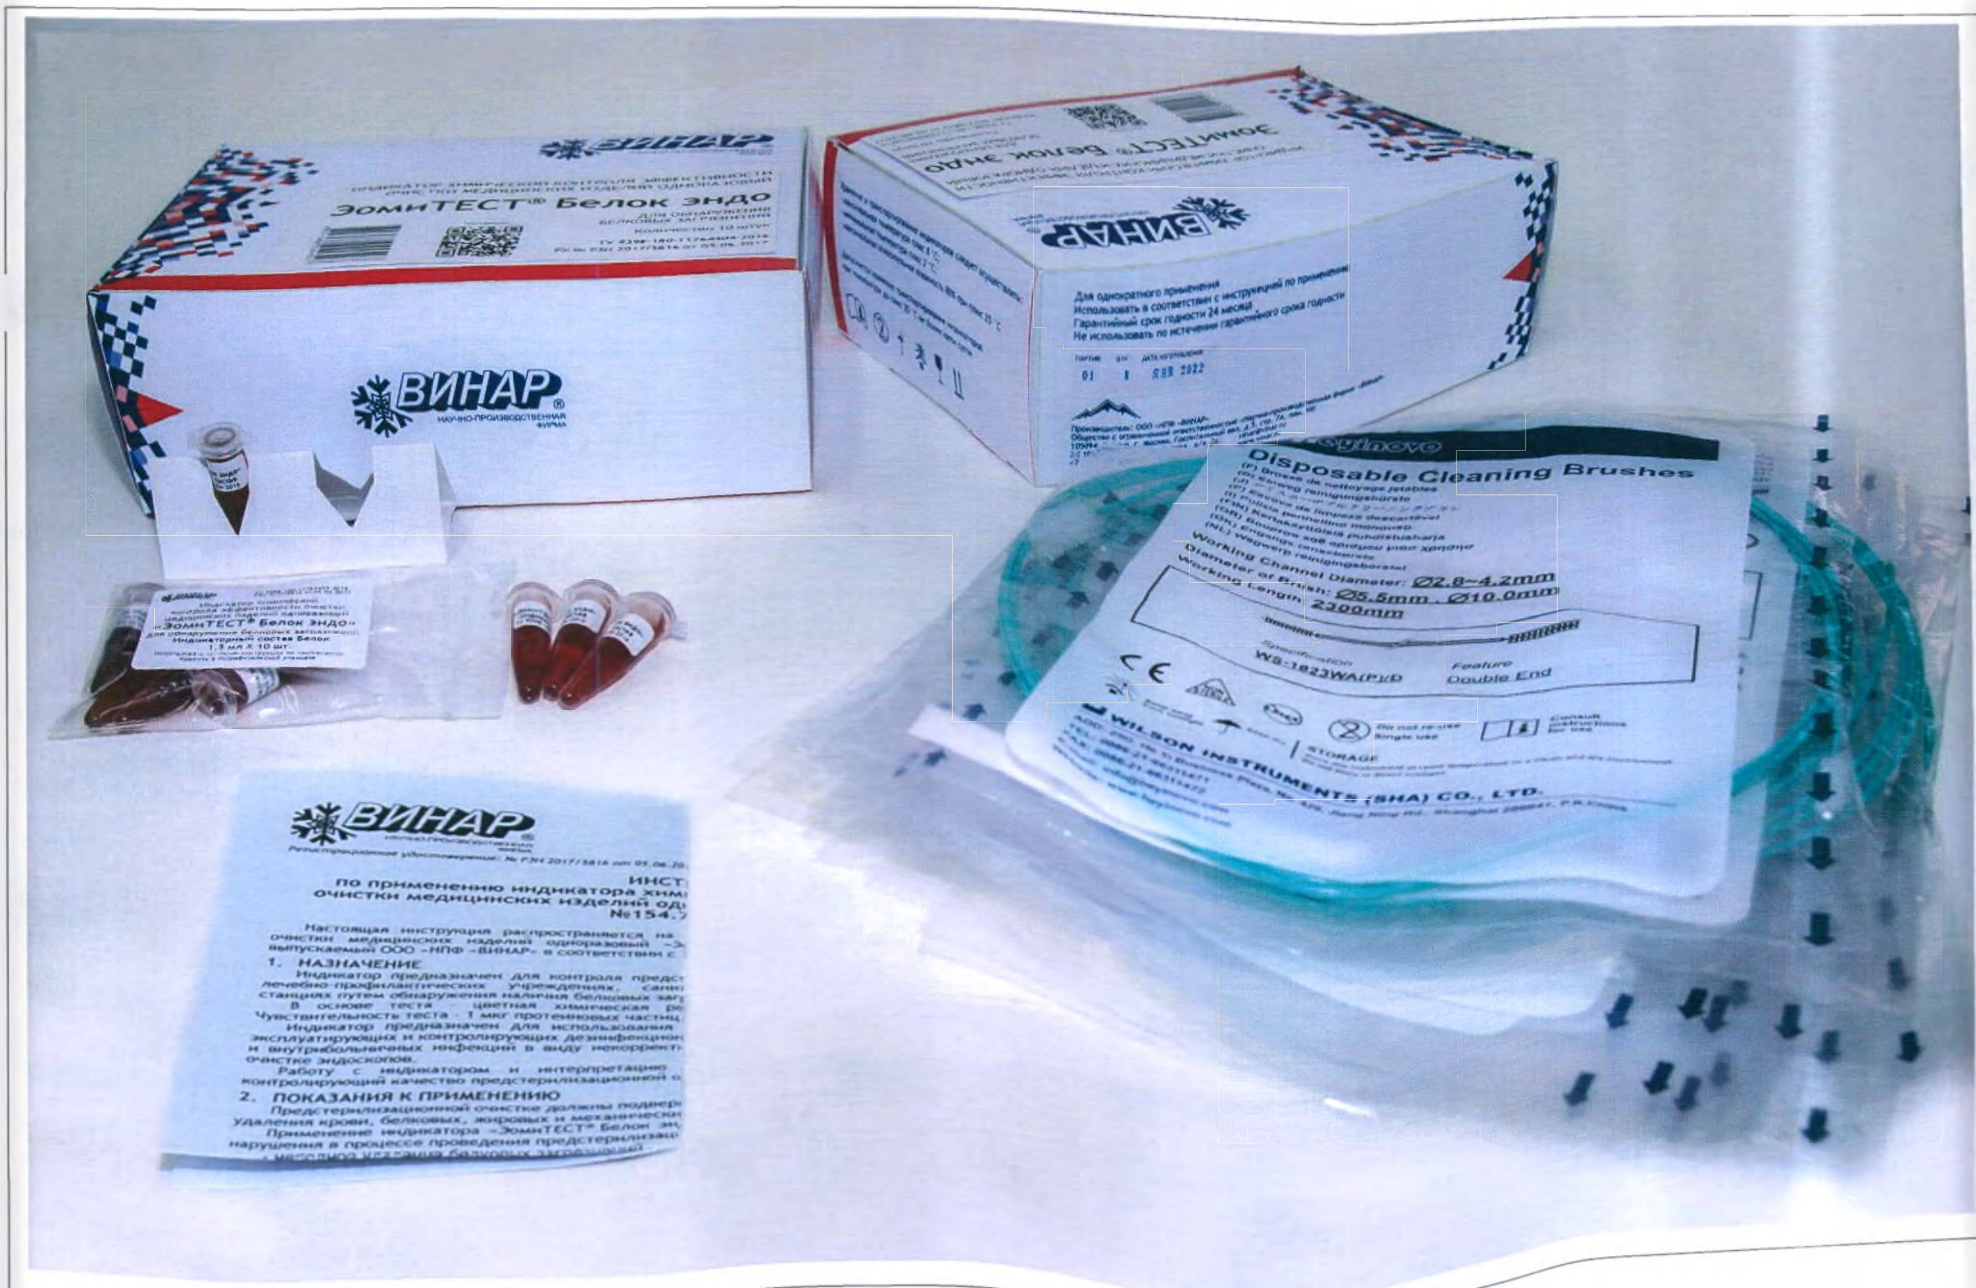

Макет этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок эндо».

ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ

ЭомиТЕСТ® Белок эндо



Инструкция



ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
БЕЛКОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Количество 10 штук


ТУ 9398-180-11764404-2016
ПУ № РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок эндо».

Инструкция



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок эндо».

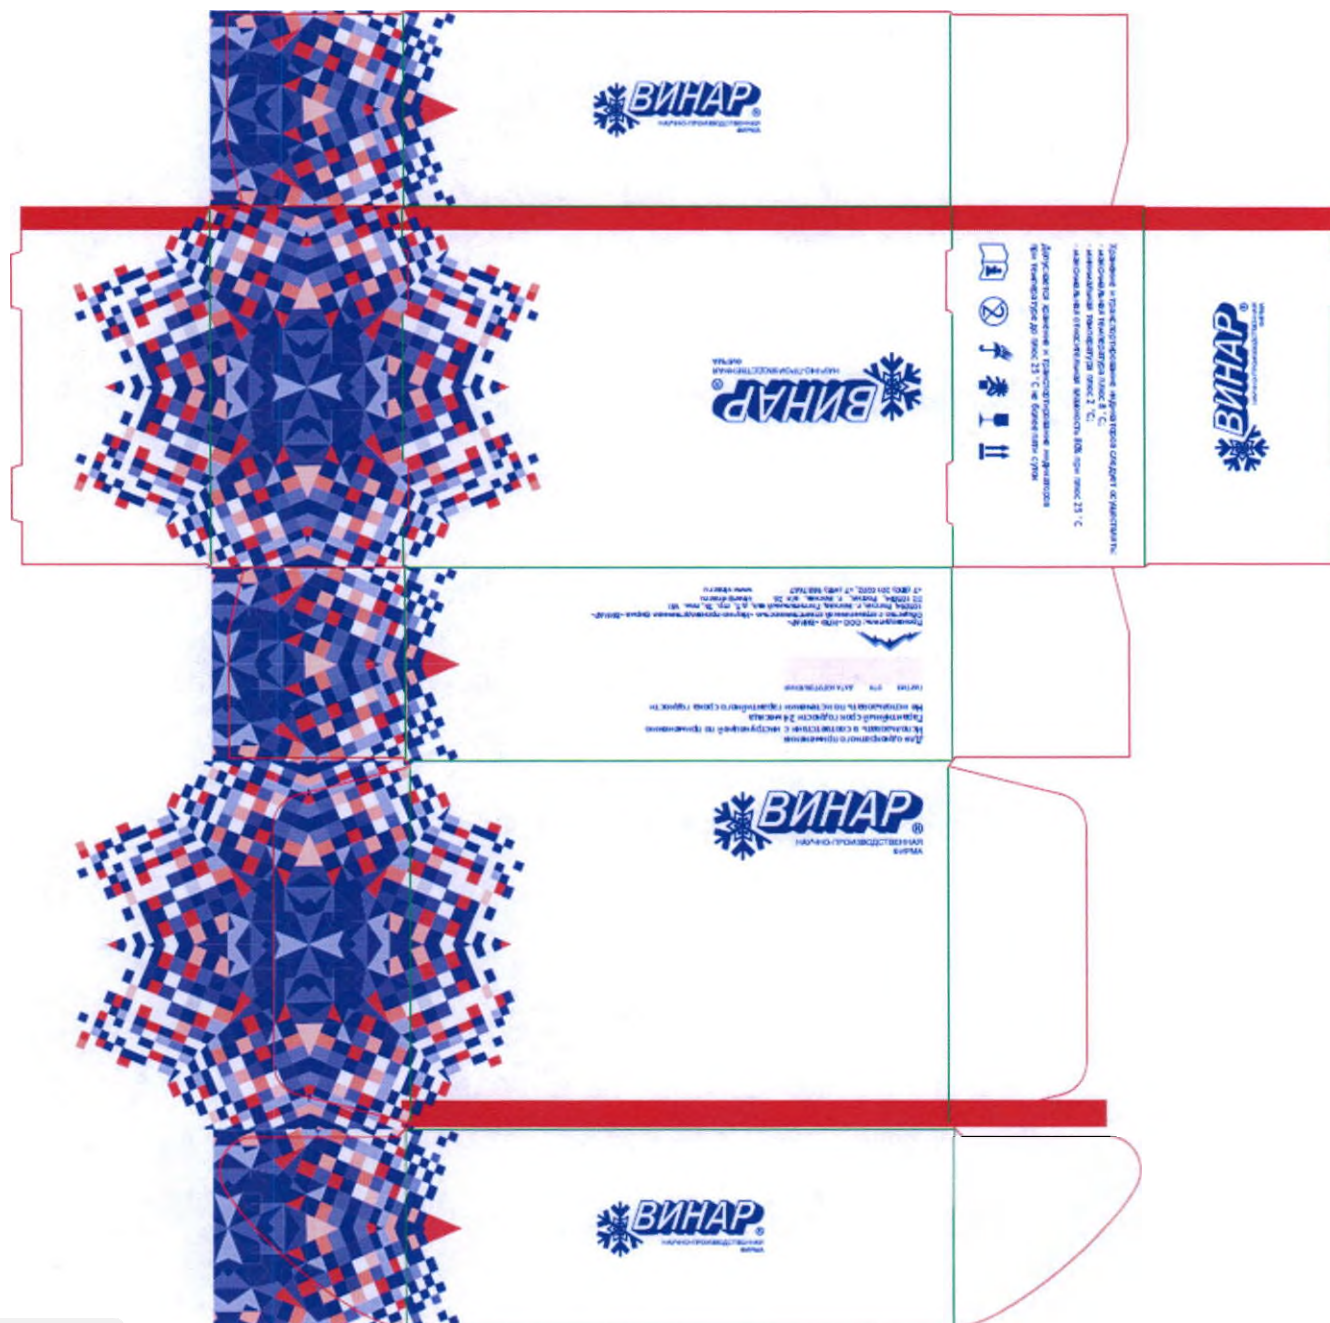

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Белок эндо».

ЭомиТЕСТ®

Индикаторный состав

Белок



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок эндо»
для обнаружения белковых загрязнений
Индикаторный состав Белок
1,5 мл X 10 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЗомиТЕСТ® Белок эндо».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Белок эндо».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Белок эндо»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 8 °С;
- минимальная температура плюс 2 °С;
- максимальная относительная влажность 80 %
при плюс 25 °С.

Допускается транспортирование индикаторов при
температуре до плюс 25 °С не более пяти суток.



Индикаторы химические контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовые ЭомиТЕСТ® ТУ 9398-180-11764404-2016

Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».



Макеты этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Судан III»
для обнаружения жировых загрязнений Инструкция
Состав набора: судан III 0,2 г; метиленовый синий 0,2 г

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.
Хранить в потребительской упаковке
Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

4 601988 044602



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Судан III»
предназначен для определения эффективности
очистки медицинских инструментов от жировых
загрязнений.


Индикатор хранить и транспортировать в
упаковке производителя при температуре от
плюс 5 °С до плюс 40 °С и влажности не более
80 % при плюс 25 °С, не подвергая воздействию
паров химических веществ.

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».

Инструкция




Макет этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».

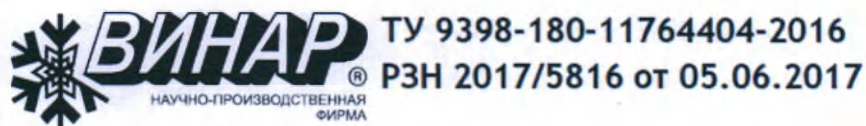

ЭомиТЕСТ®
Судан III 0,2 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

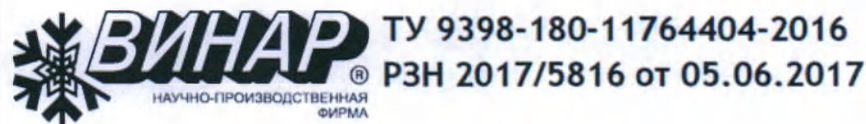

ЭомиТЕСТ®
Метиленовый синий 0,2 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Судан III»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто


Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III+С».

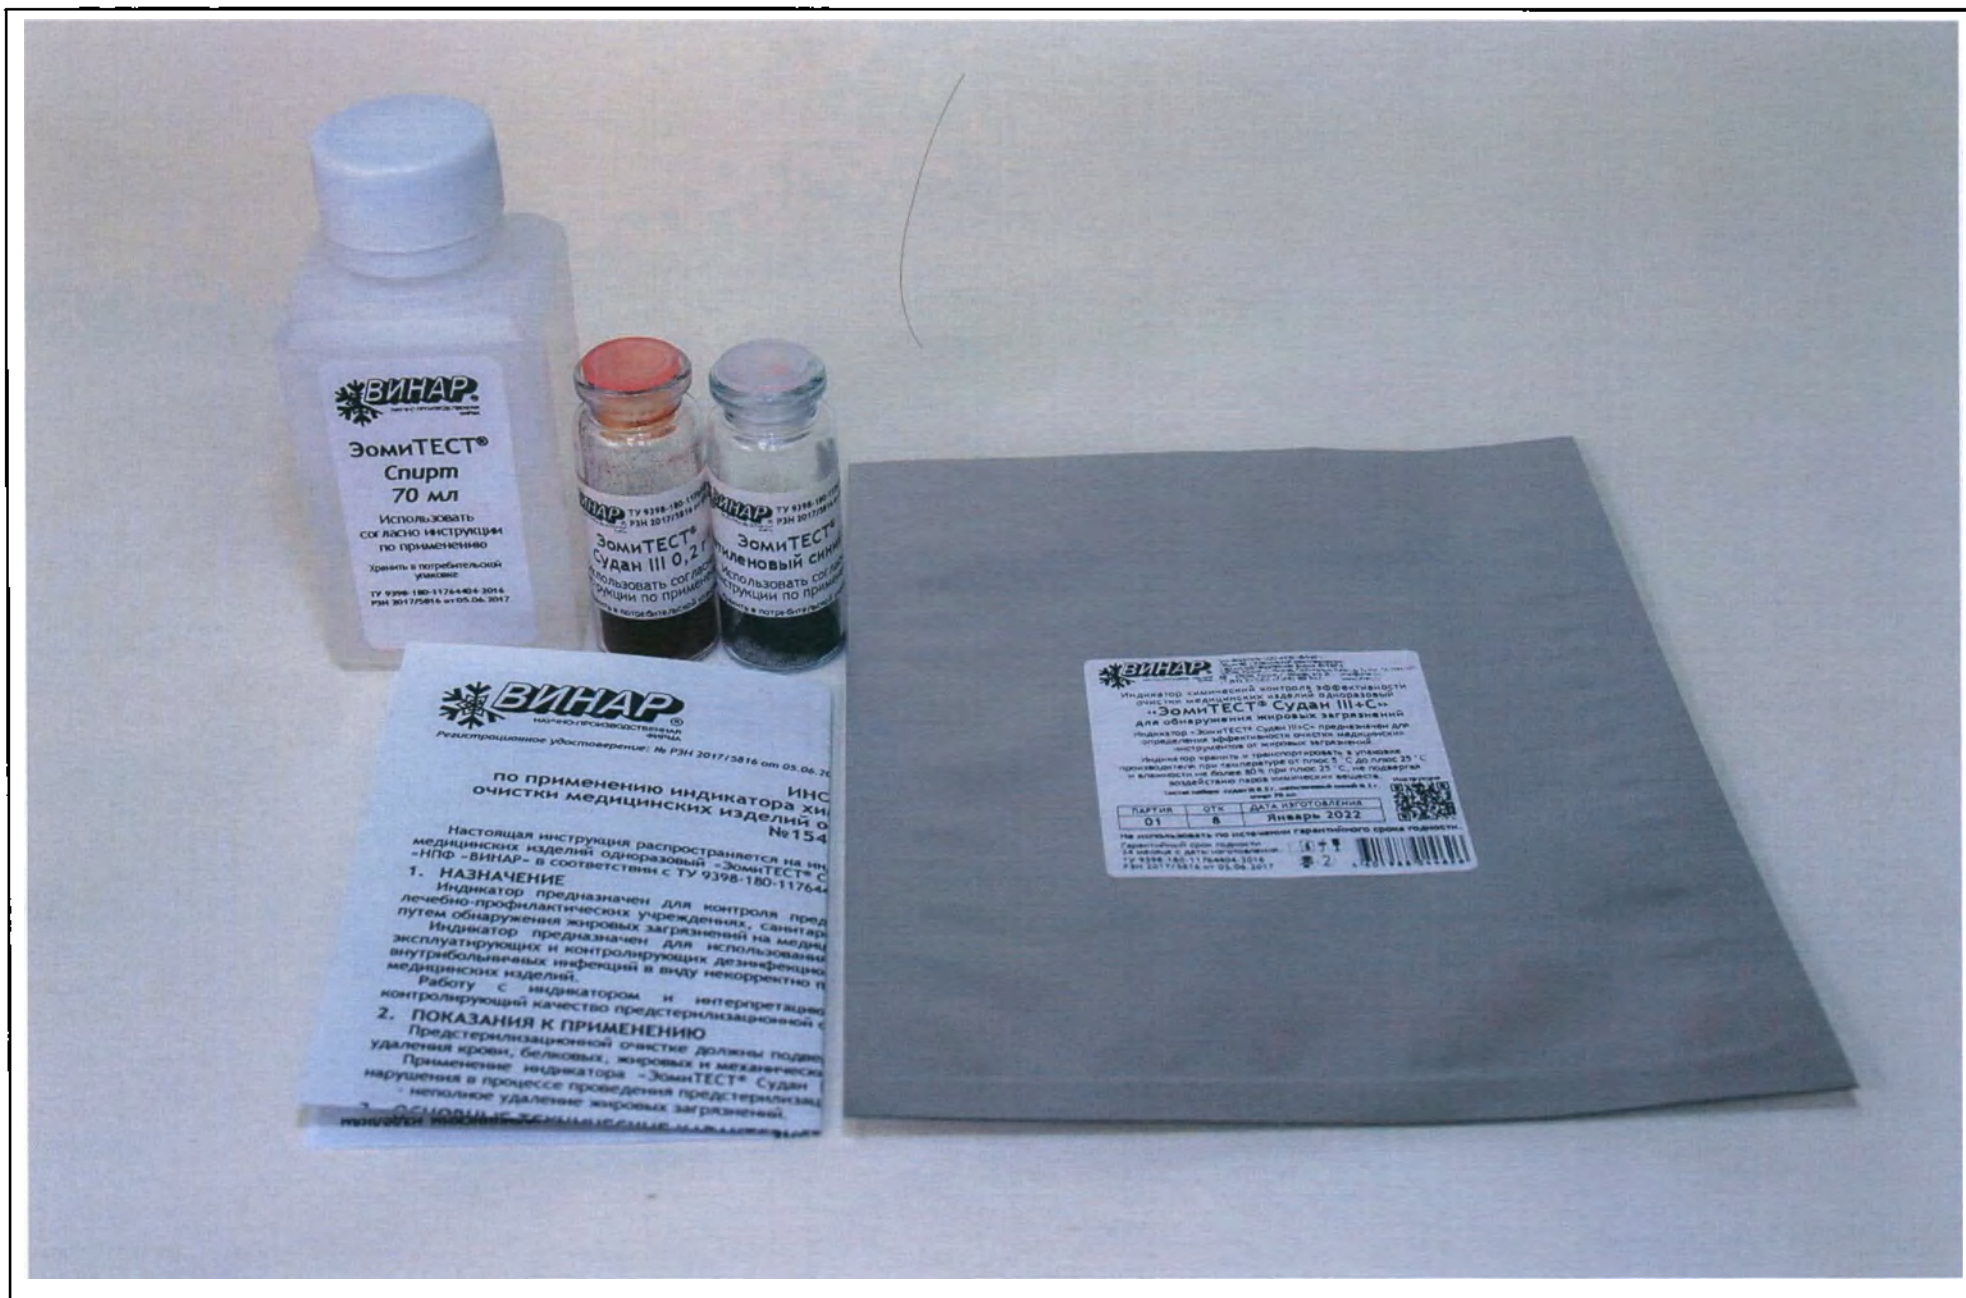

Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III+C».



Производитель: ООО «НПО «ВИАНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Гостеприимный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Судан III+C»
для обнаружения жировых загрязнений

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Судан III+C» предназначен для
определения эффективности очистки медицинских
инструментов от жировых загрязнений.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке
производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С
и влажности не более 80 % при плюс 25 °С, не подвергая
воздействию паров химических веществ.

Состав набора: судан III 0,2 г, метиленовый синий 0,2 г,
спирт 70 мл

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Инструкция



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.


Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017




Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III+С».

Инструкция

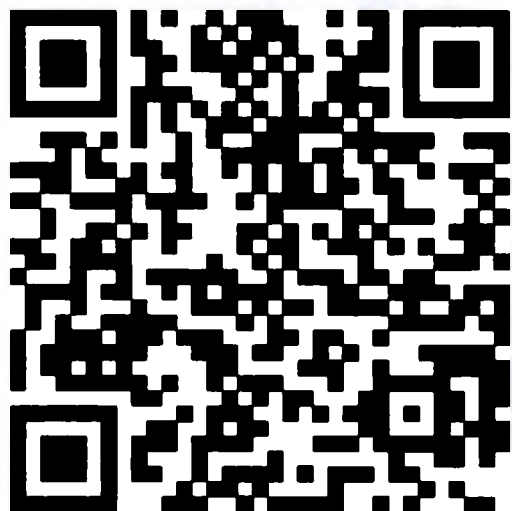


Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III+С».

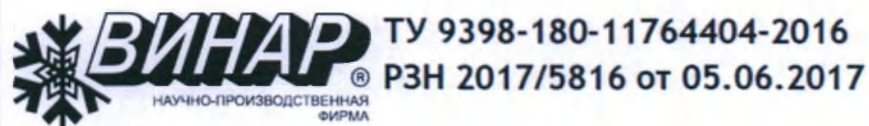

ЭомиТЕСТ®
Судан III 0,2 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

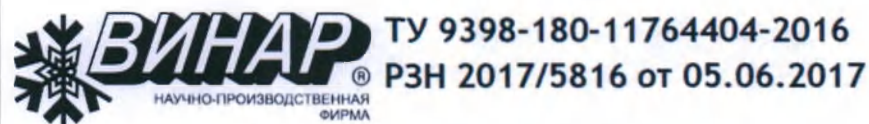

ЭомиТЕСТ®
Метиленовый синий 0,2 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке




ЭомиТЕСТ®
Спирт
70 мл

Использовать
согласно инструкции
по применению

Хранить в потребительской
упаковке

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III+С».

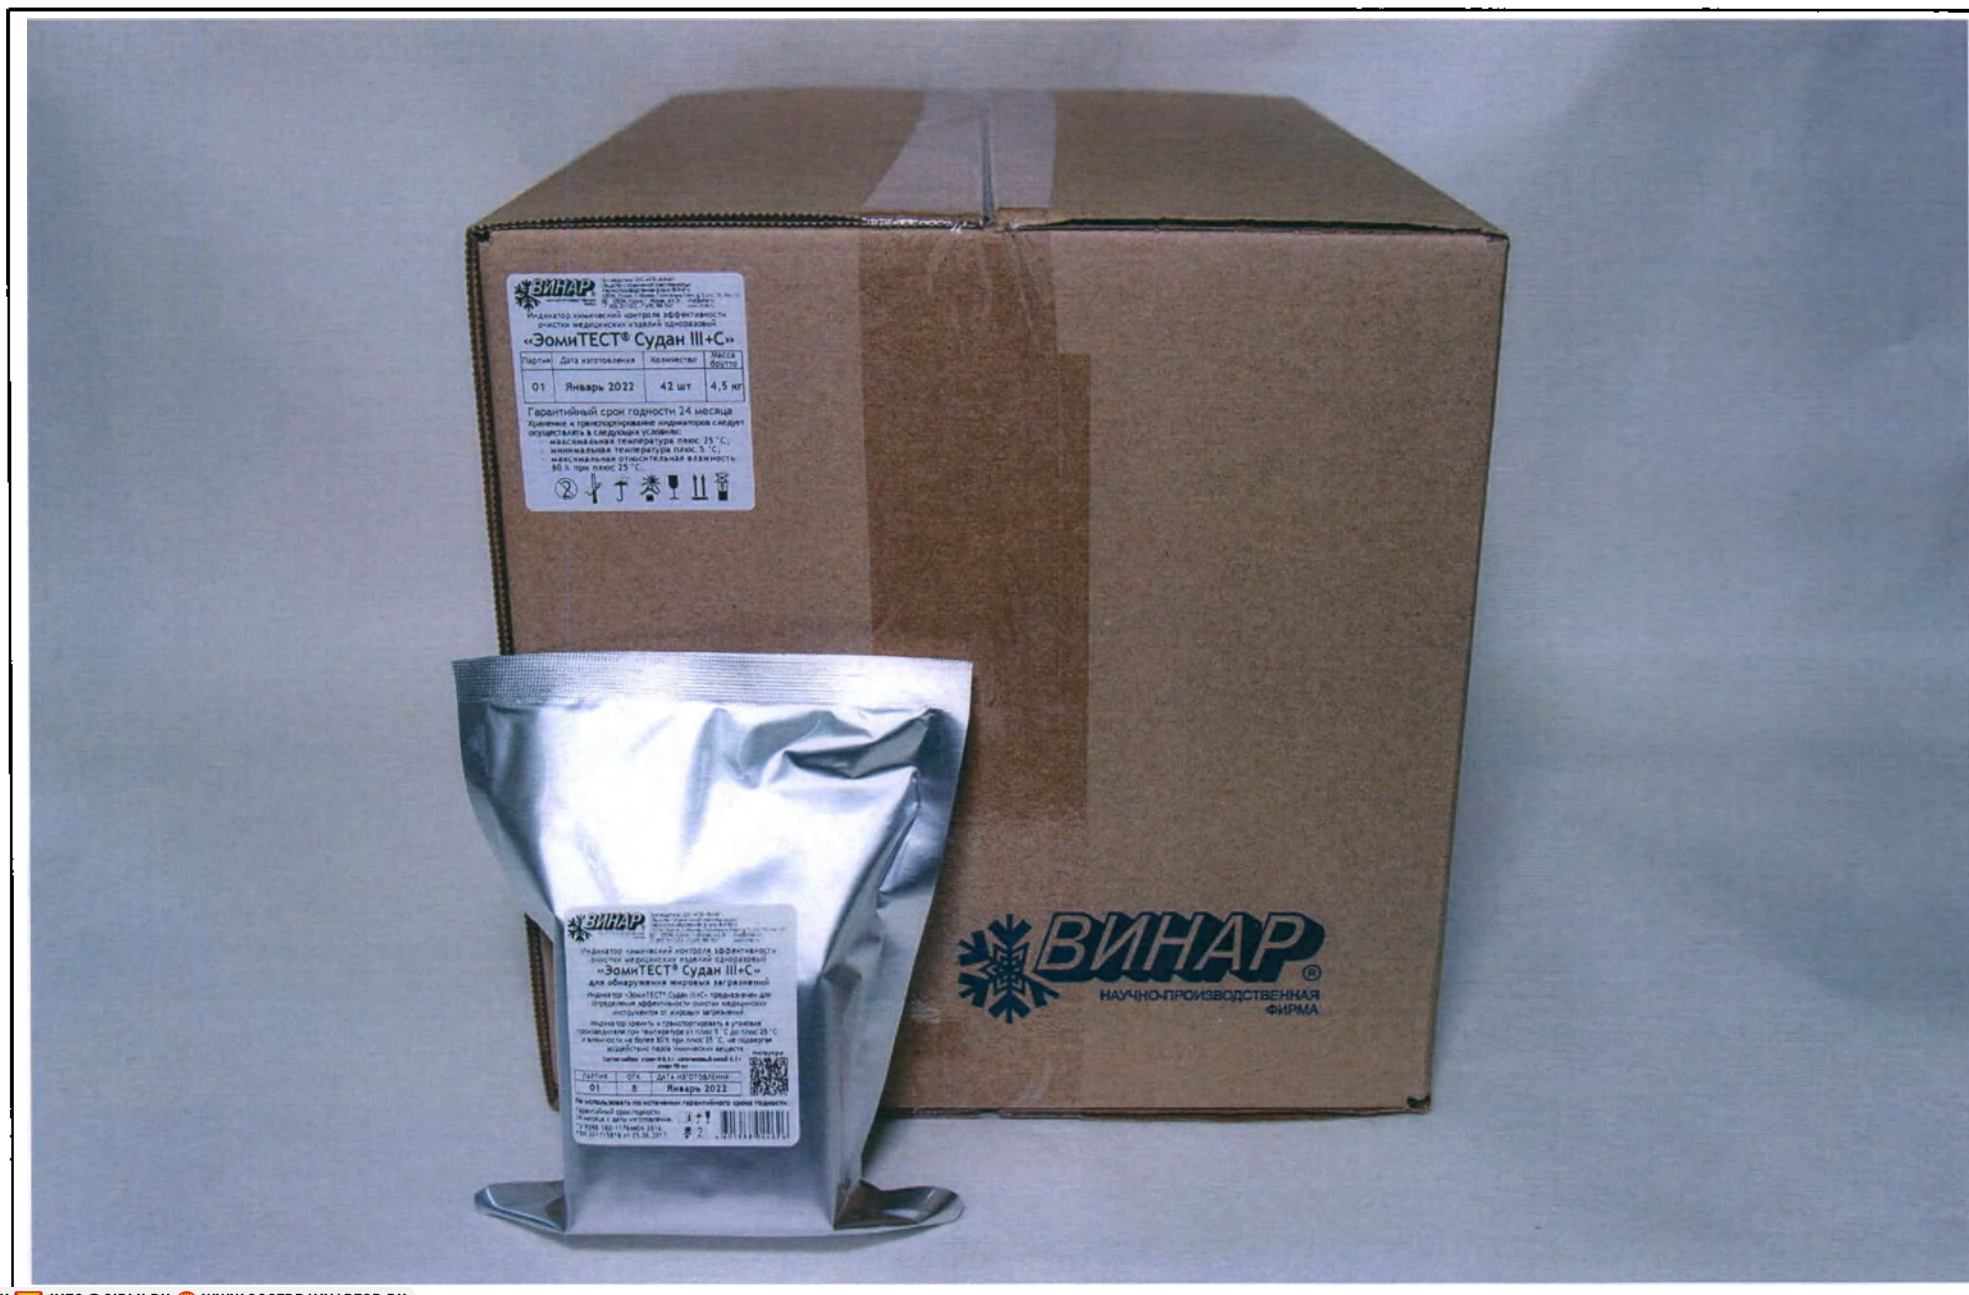

Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Судан III+С».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Судан III+С»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность
80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».



Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Судан III-Р»
для обнаружения жировых загрязнений

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р» предназначен для
определения эффективности очистки медицинских
инструментов от жировых загрязнений.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке
производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С
и влажности не более 80 % при плюс 25 °С, не подвергая
воздействию паров химических веществ.

Состав набора: раствор судана III 70 мл,
раствор метиленового синего 10мл

Инструкция



ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Не использовать по истечении гарантийного срока годности.


Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».

Инструкция

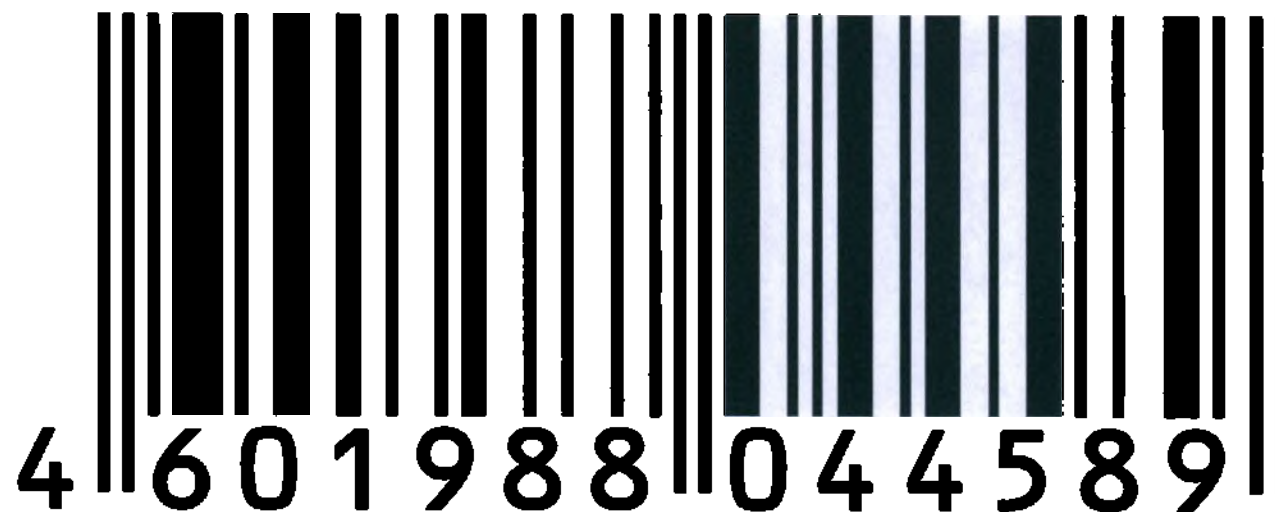

Макеты этикеток на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ®
Метиленовый синий 10 мл

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке




ЭомиТЕСТ®
Судан III
70 мл

Использовать
согласно инструкции
по применению

Хранить в потребительской
упаковке

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».

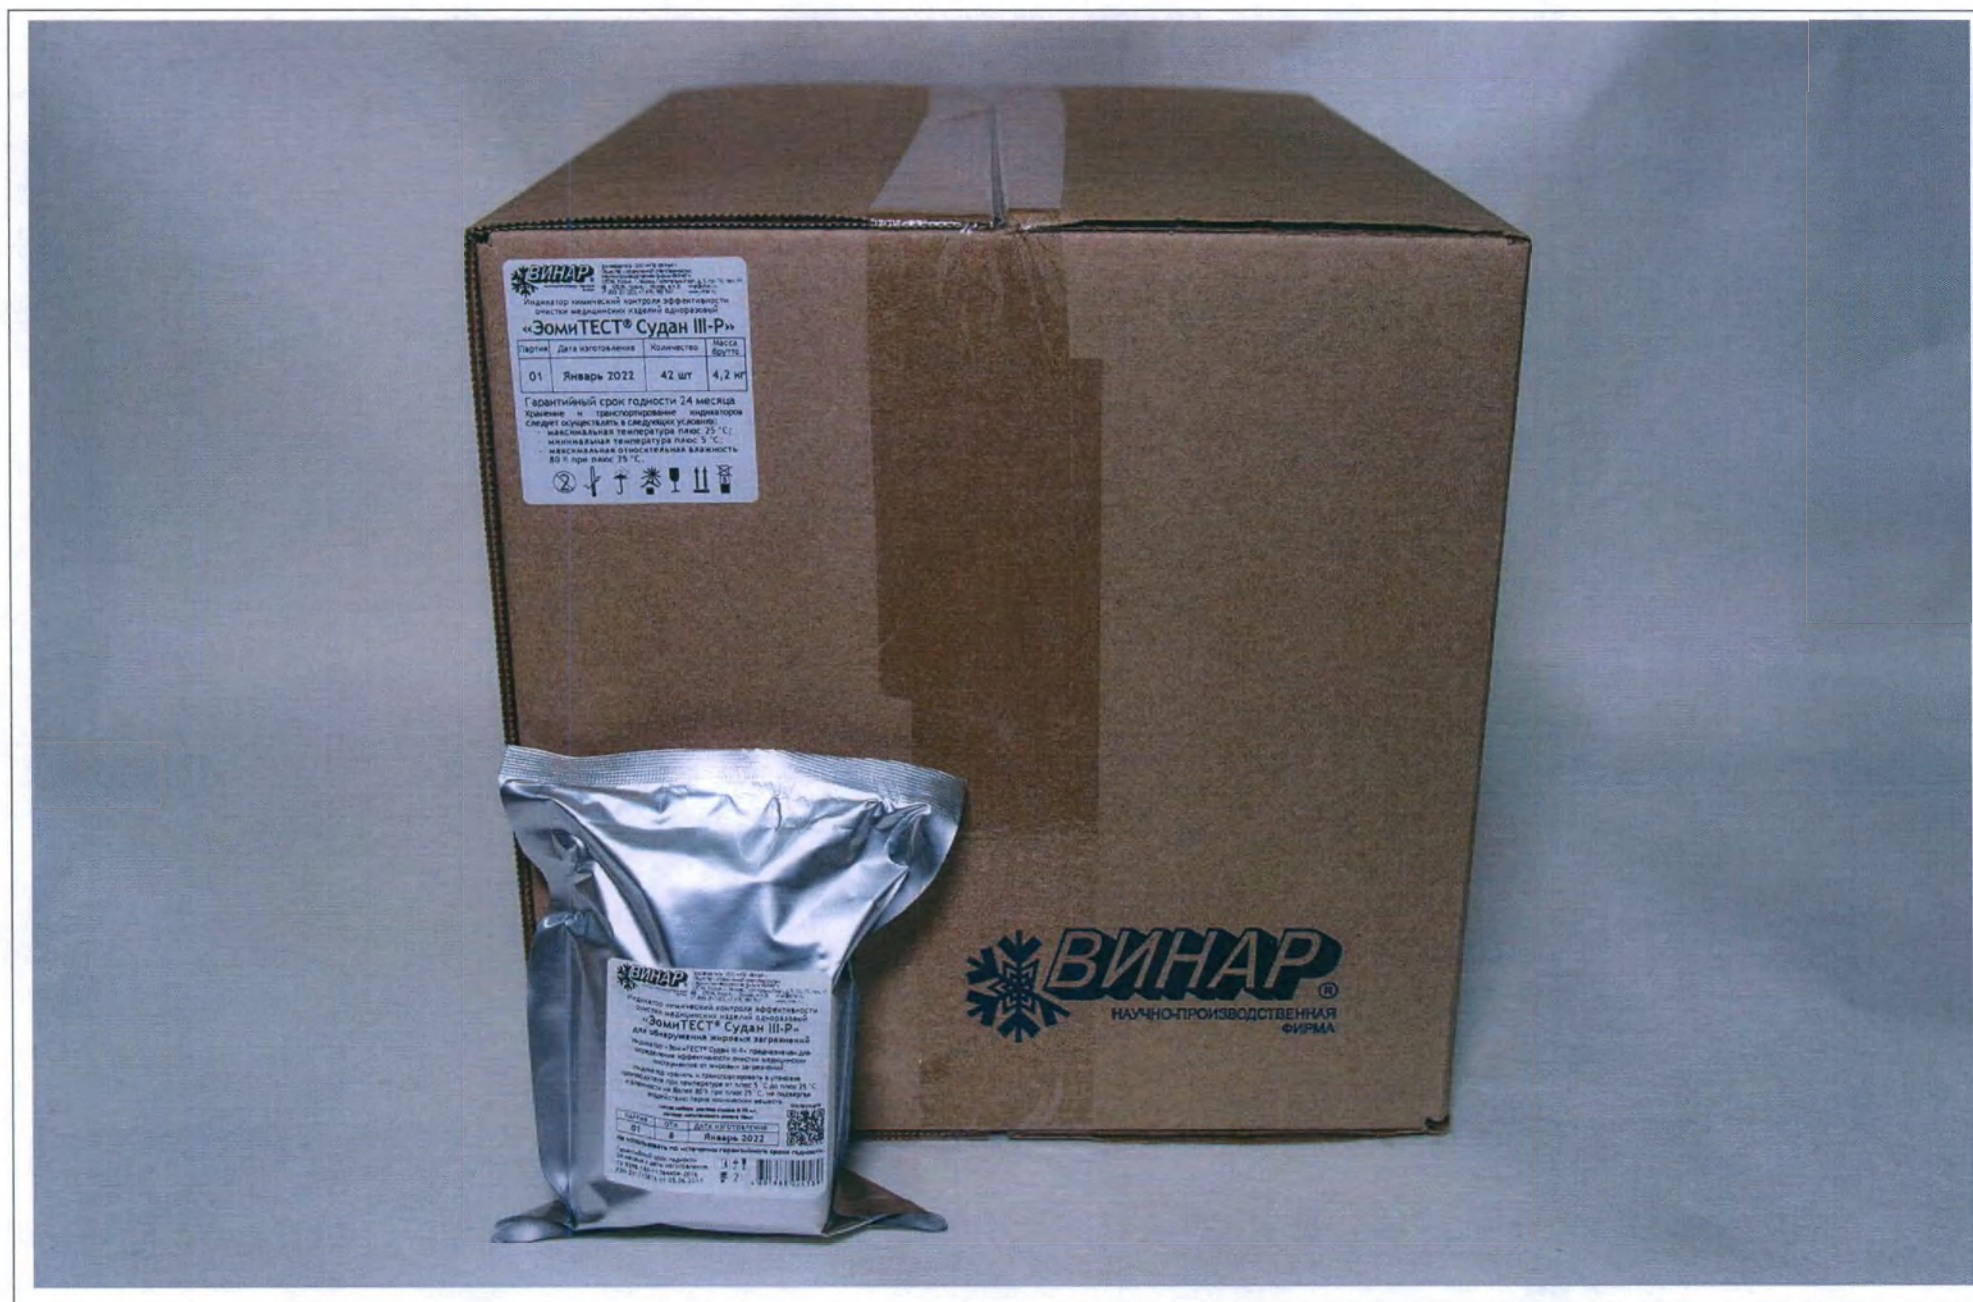

Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Судан III-Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Судан III-Р»


Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов
следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П».

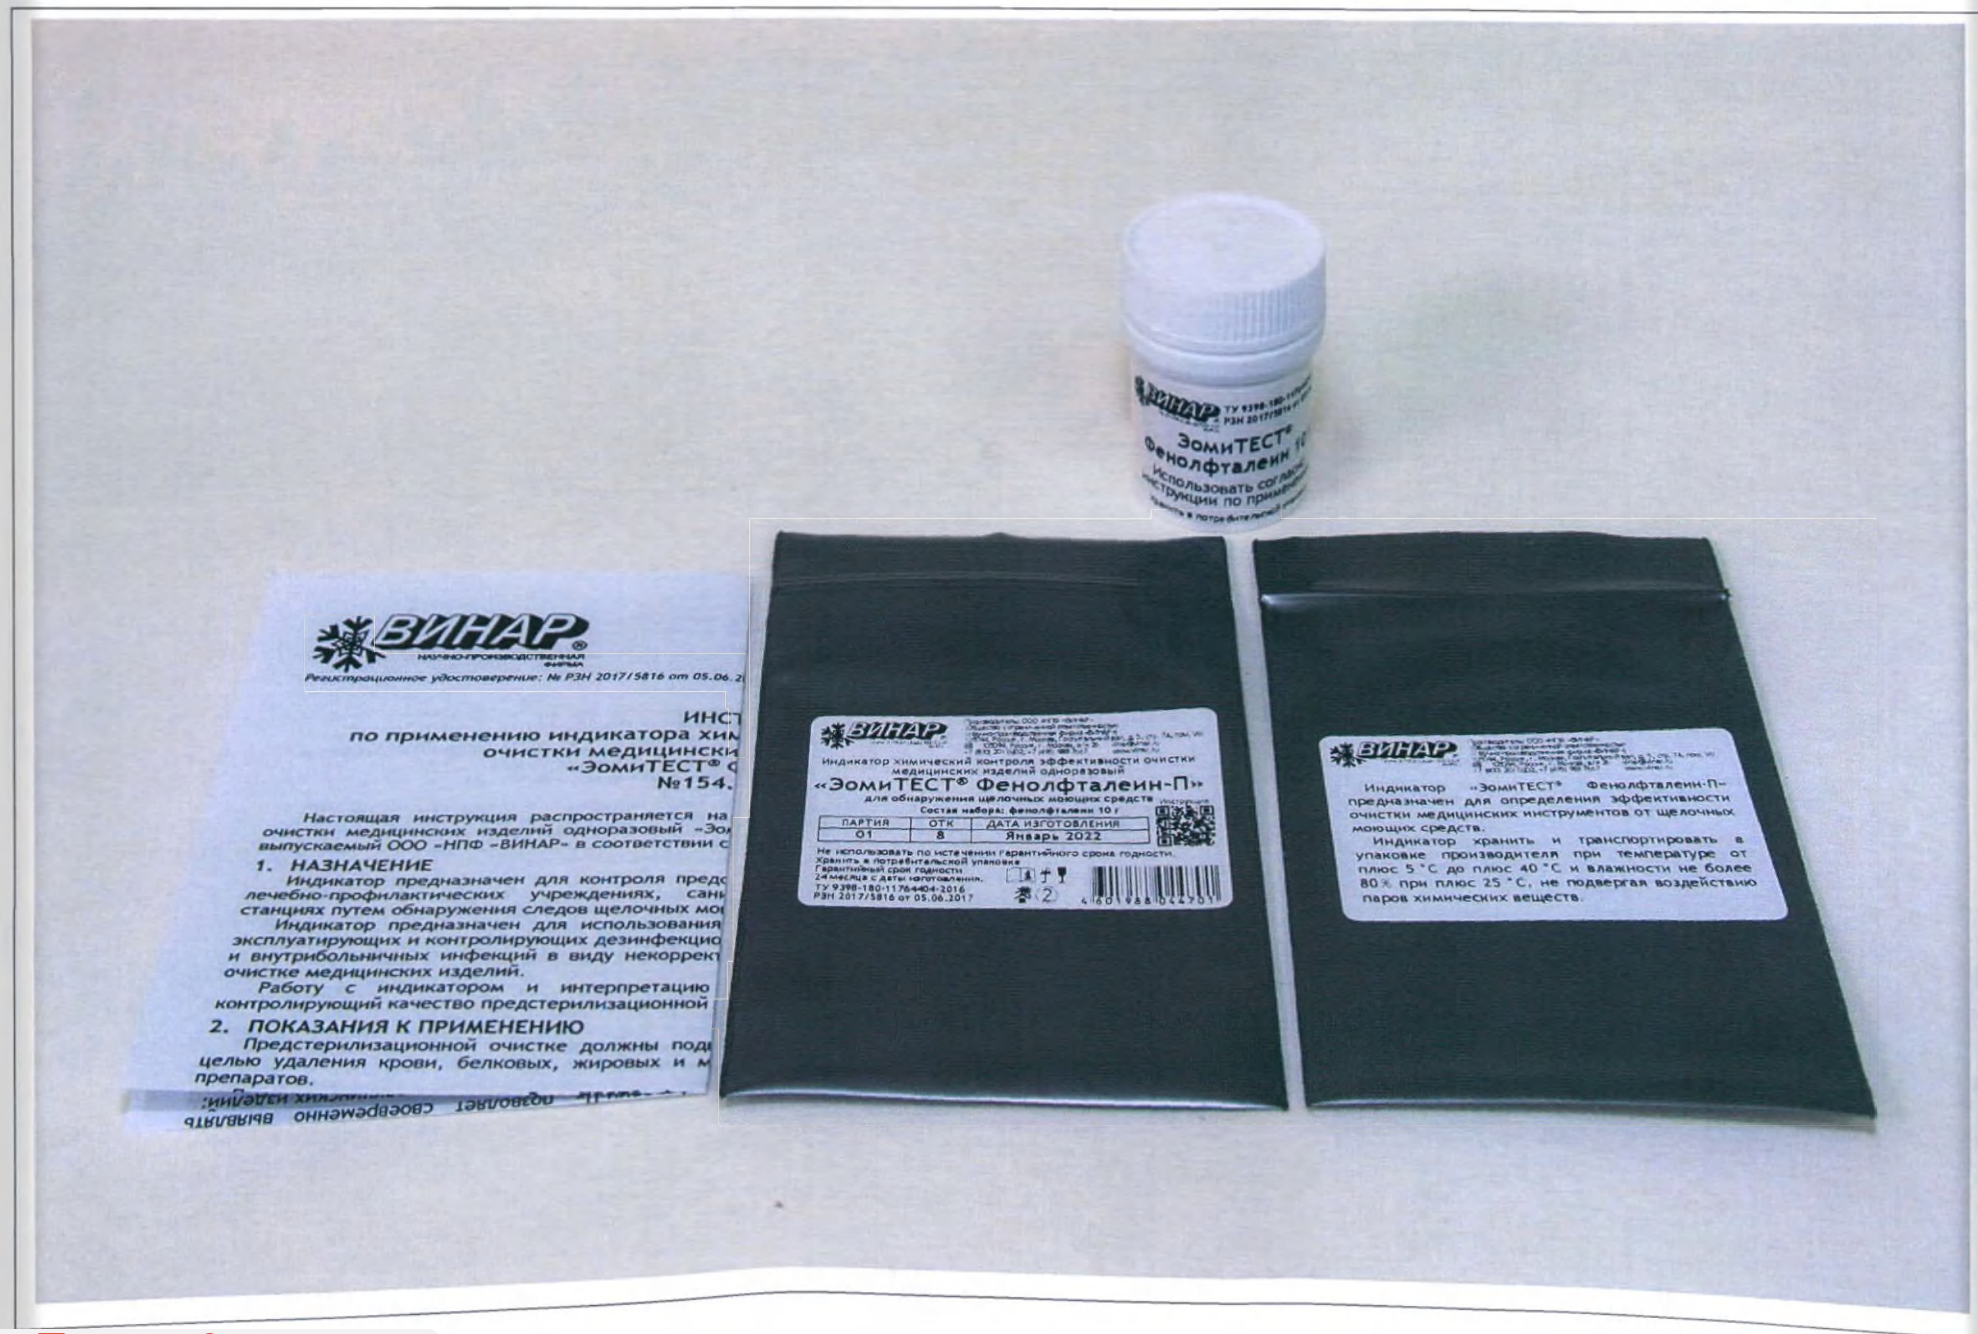

Макеты этикеток на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П».



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П»

для обнаружения щелочных моющих средств Инструкция

Состав набора: фенолфталеин 10 г

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.

Хранить в потребительской упаковке

Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016

РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П»
предназначен для определения эффективности
очистки медицинских инструментов от щелочных
моющих средств.

Индикатор хранить и транспортировать в
упаковке производителя при температуре от
плюс 5 °С до плюс 40 °С и влажности не более
80 % при плюс 25 °С, не подвергая воздействию
паров химических веществ.

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П».

Инструкция



Макет этикетки на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П».



ТУ 9398-180-11764404-2016

РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин 10 г

Использовать согласно
инструкции по применению

Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-П».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Фенолфталейн-П».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Фенолфталейн-П»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность 80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р».



Макет этикетки на потребительскую упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р»
для обнаружения щелочных моющих средств

Индикатор «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р» предназначен для
определения эффективности очистки медицинских
инструментов от щелочных моющих средств.

Индикатор хранить и транспортировать в упаковке
производителя при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С
и влажности не более 80 % при плюс 25 °С, не подвергая
воздействию паров химических веществ.

Инструкция

Состав набора: фенолфталеин 100 мл

ПАРТИЯ	ОТК	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ



Не использовать по истечении гарантийного срока годности.


Гарантийный срок годности
24 месяца с даты изготовления.

ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017



Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р».

Инструкция

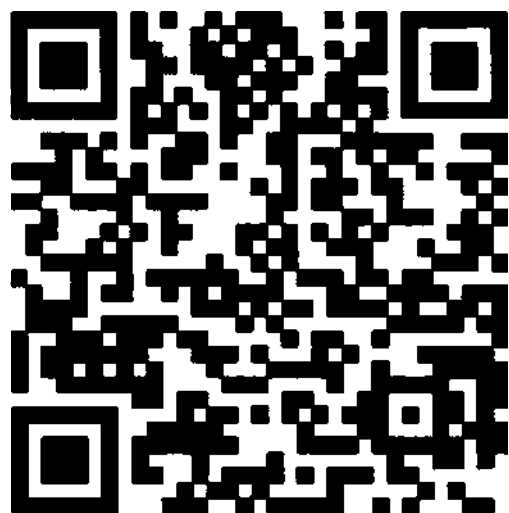

Макет этикетки на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р».



ЭомиТЕСТ®

**Фенолфталеин
100 мл**

**Использовать
согласно инструкции
по применению**

**Хранить в потребительской
упаковке**

**ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017**

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомитеСТ® Фенолфталеин-Р».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р».



Производитель: ООО «НПО «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

«ЭомиТЕСТ® Фенолфталеин-Р»

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца
Хранение и транспортирование индикаторов следует
осуществлять в следующих условиях:


- максимальная температура плюс 25 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная влажность
80 % при плюс 25 °С.



Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».



Макет потребительской упаковки. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».

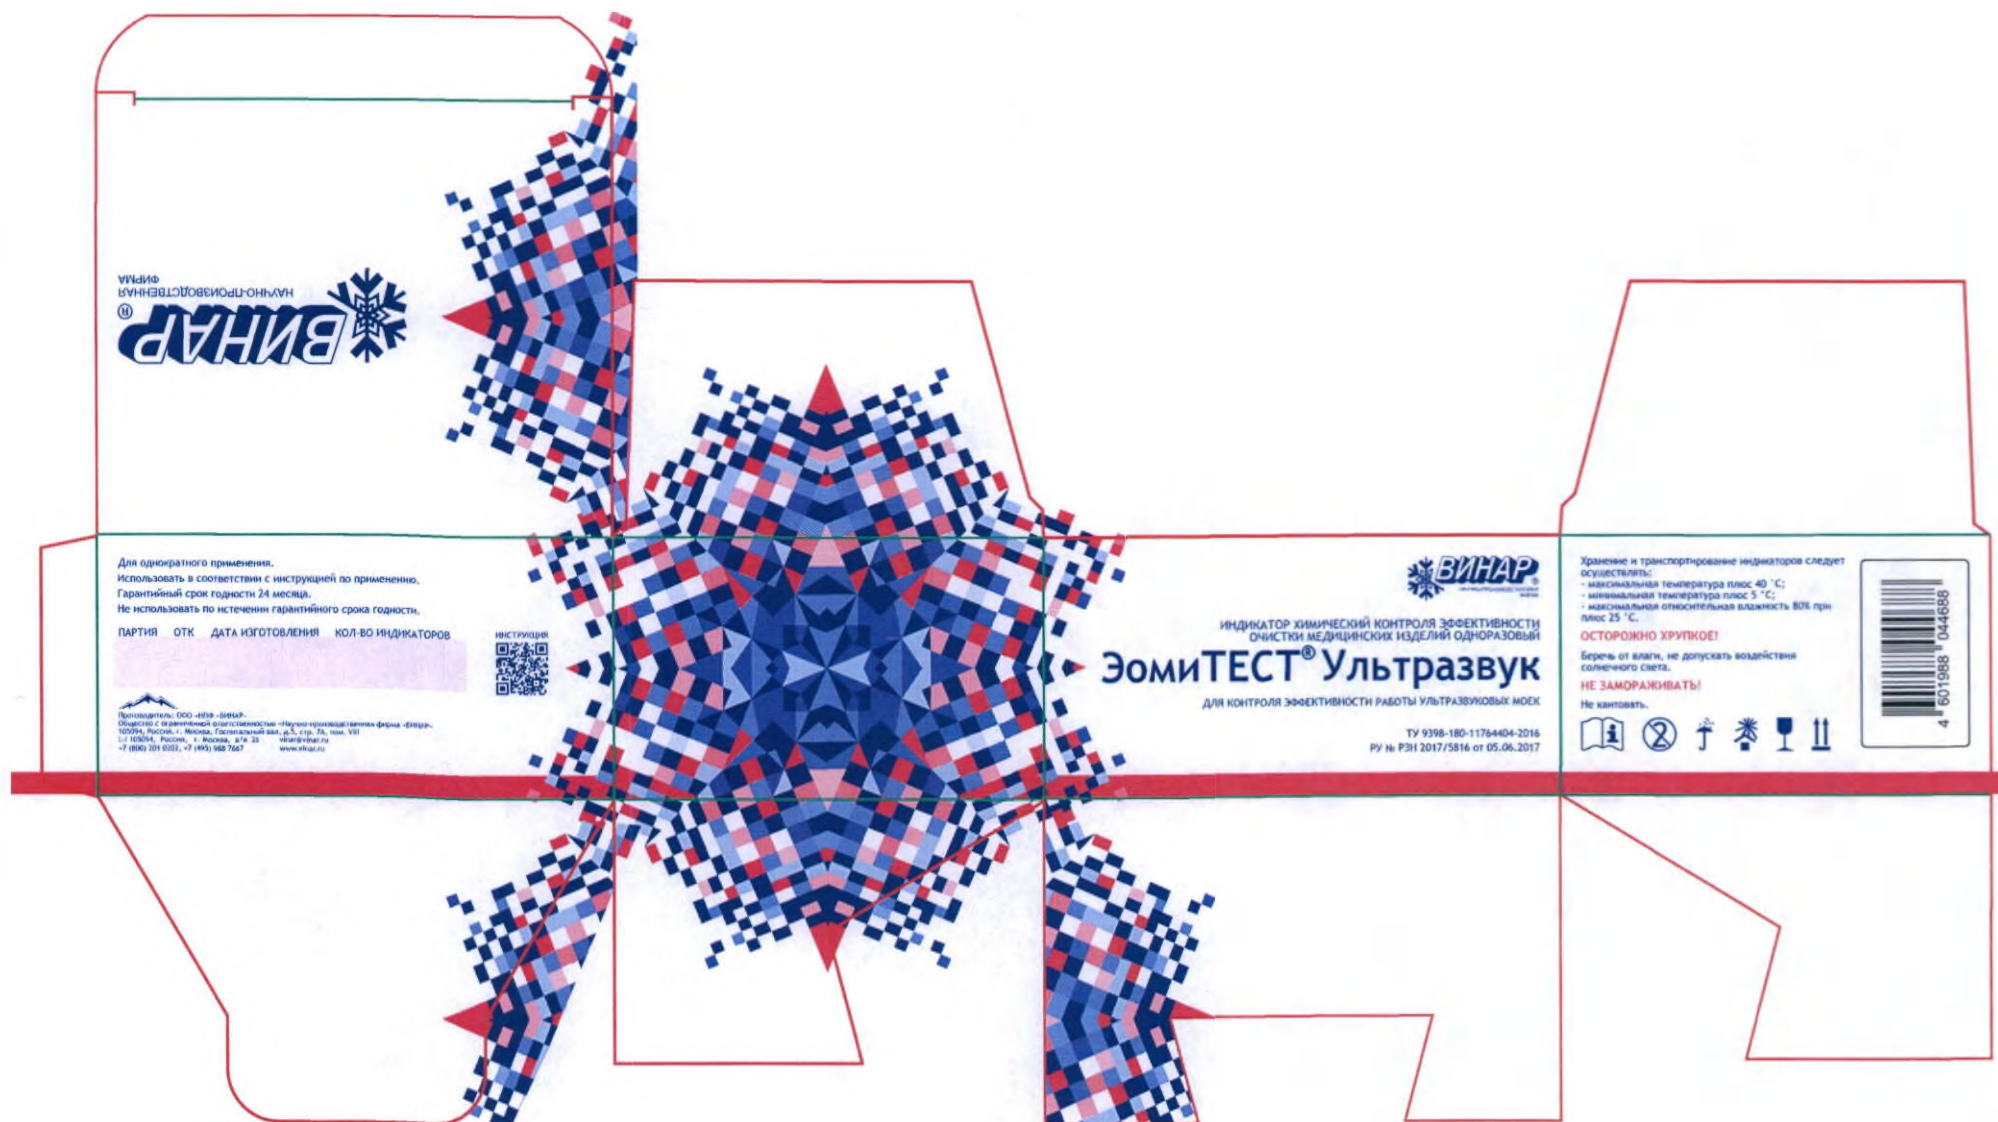

Линейный и двухмерный штрихкоды. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».

ИНСТРУКЦИЯ



Макет этикетки на индивидуальную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».



ТУ 9398-180-11764404-2016
РЗН 2017/5816 от 05.06.2017

Индикатор химический
контроля эффективности очистки
медицинских изделий одноразовый
«ЭомиТЕСТ® Ультразвук»
для контроля эффективности работы
ультразвуковых моек

Индикаторный состав: 24 шт.

Использовать согласно инструкции по применению
Хранить в потребительской упаковке

Транспортная упаковка. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».



Макет этикетки на транспортную упаковку. Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ® Ультразвук».



Производитель: ООО «НПФ «ВИАНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «ВИАНАР»)
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д. 5, стр. 7А, пом. VIII
✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Индикатор химический контроля эффективности
очистки медицинских изделий одноразовый

ЭомиТЕСТ® Ультразвук

Партия	Дата изготовления	Количество	Масса брутто

Гарантийный срок годности 24 месяца

Хранение и транспортирование индикаторов
следует осуществлять в следующих условиях:

- максимальная температура плюс 40 °С;
- минимальная температура плюс 5 °С;
- максимальная относительная
влажность 80 % при плюс 25 °С.

Не замораживать!



Всего прошнуровано и скреплено
печатью

126 лист 06

Генеральный директор

ООО «НПФ «ВИНАР»



В.С. Андреев