

Фотографические изображения

«Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e analyzers)»

решениях сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e

PreciControl Toxo IgM

Elecsys and
cobas e analyzers

REF 04618866 190

CONTENT

PC-TOXIGM1 8 x 0.67 mL

PC-TOXIGM2 8 x 0.67 mL



COBAS, COBAS E,
PRECICONTROL and ELECSYS
are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany



0123



2-8 °C

001



04618866190
<http://rs-labdoc.roche.com>



cobas®

ольных сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к gondii в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на лх и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e

PreciControl Toxo IgM

For IISA: [REDACTED]


REF 04618866190

Rx only

04

Roche

ольных сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к gondii в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e

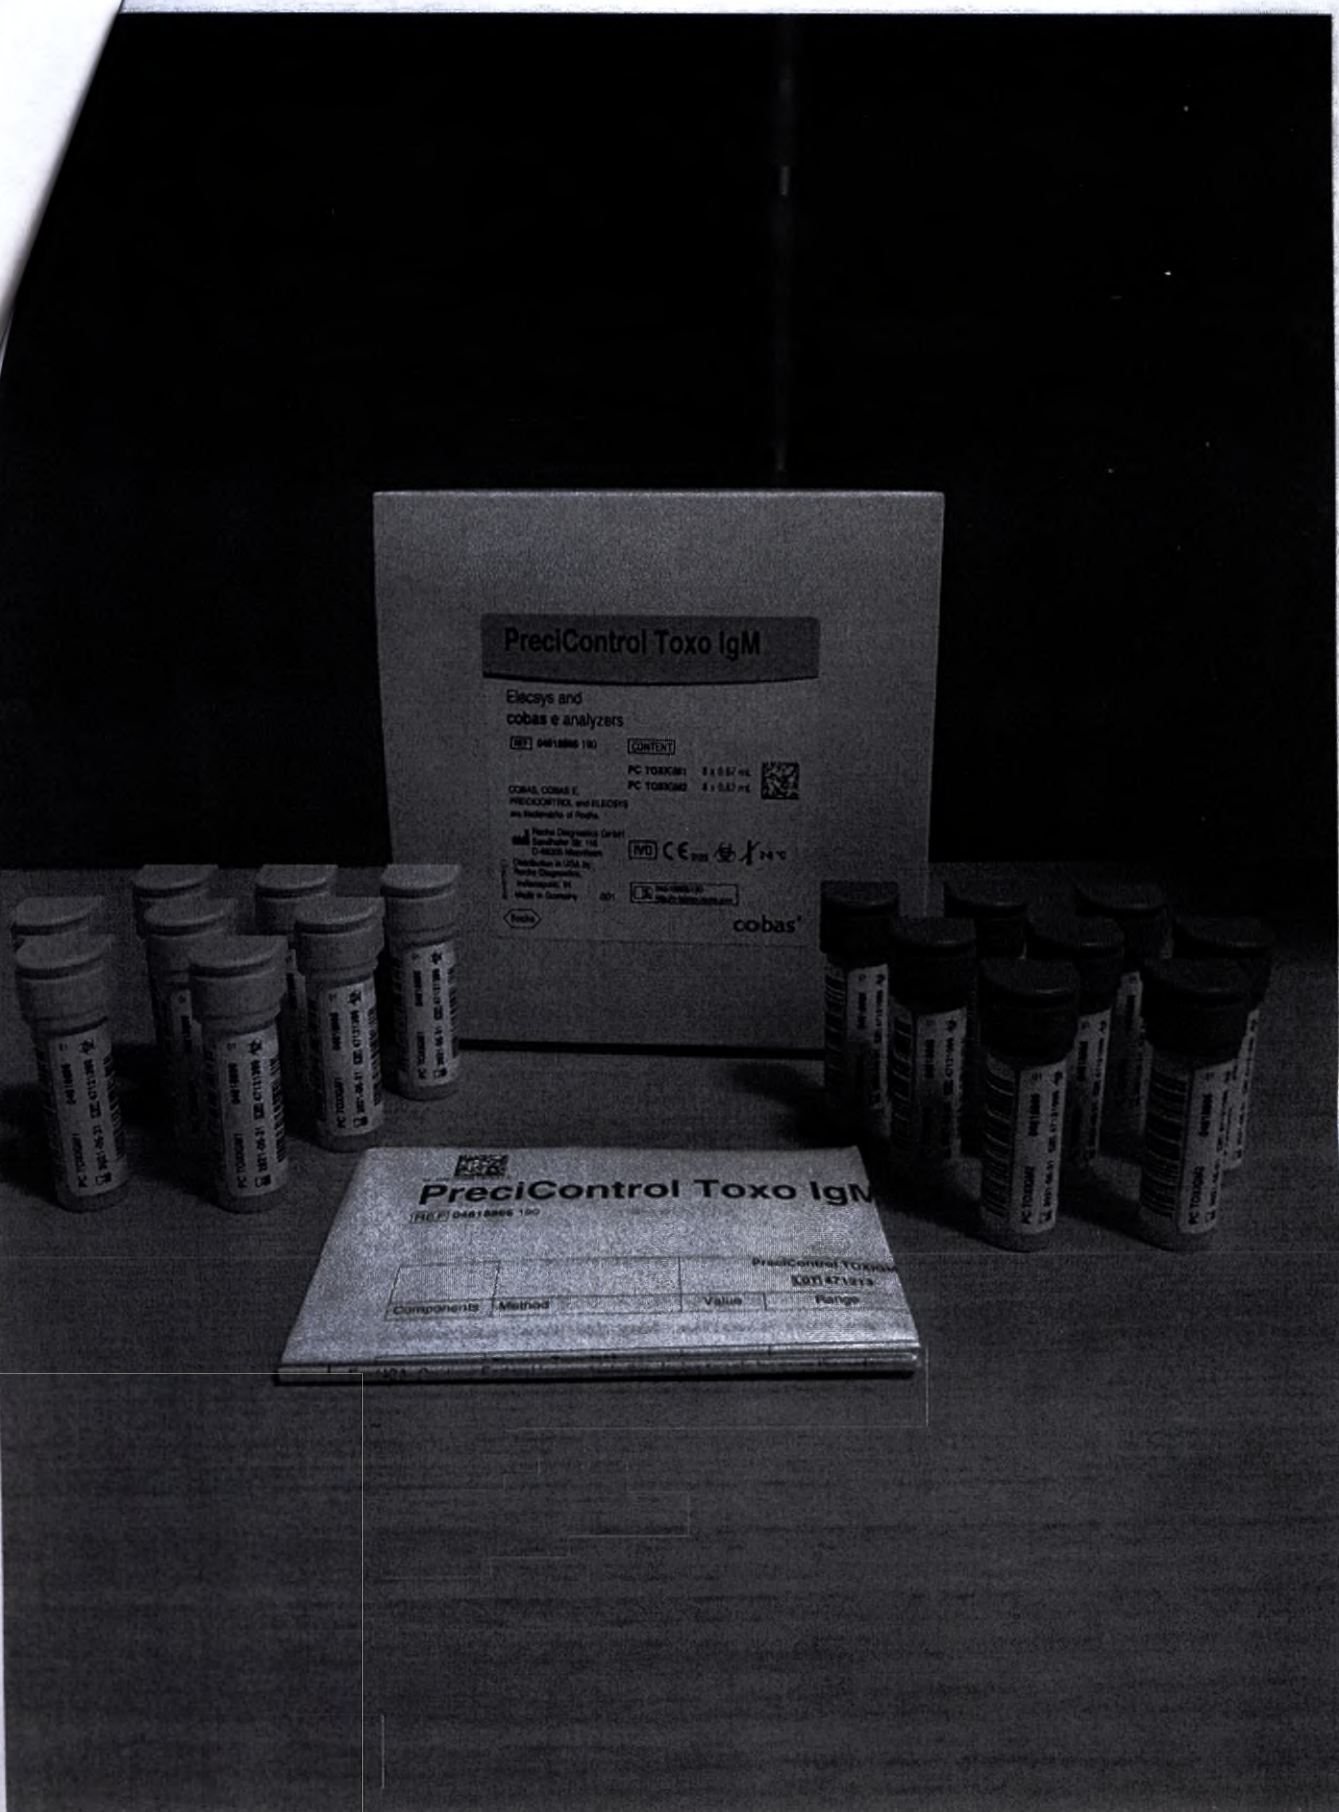

данных сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител класса IgM к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических Elecsys и cobas e (PreciControl Toxo IgM Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Сыворотка контрольная 1 (PC TOXIGM1), флакон, объем 0,67 мл – 8 шт.
2. Сыворотка контрольная 2 (PC TOXIGM2), флакон, объем 0,67 мл – 8 шт.
3. Карточка со штрихкодом – 2 шт.
4. Лист со штрихкодом контрольного материала – 1 шт.
5. Инструкция по применению.
6. Паспорт присвоенных значений.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке


Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 118, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики In vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус»
(ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: +7 495 229-89-99, факс: +7 495 229-52-54
E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат.номер 04618866190

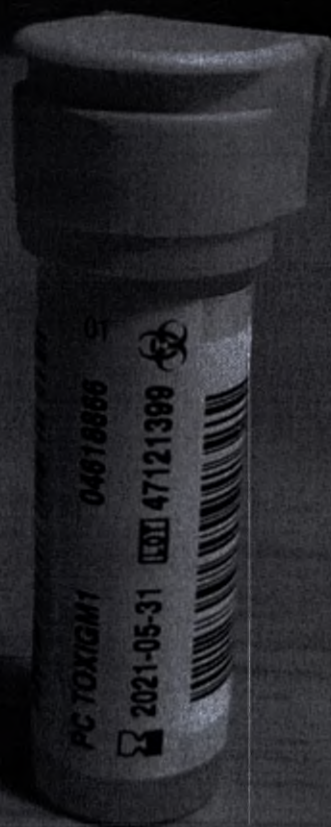

Контрольная 2 (PC TOXIGM2), флакон, объем 0,67 мл

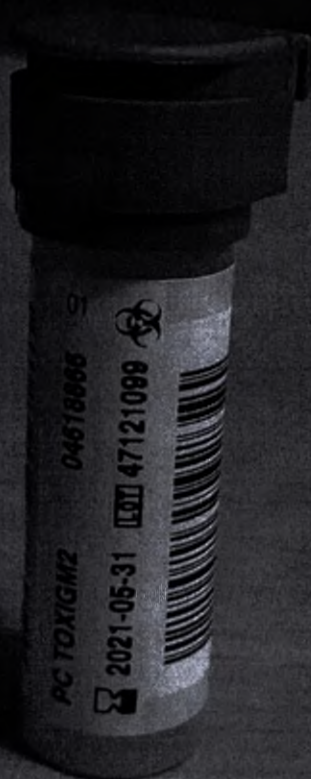

PC TOXIGM1

and  analyzers

04618866

 471213



01



PC TOXIGM2

Elecsys
and cobas e analyzers

 1

LOT 471210



01





PreciControl Toxo IgM

REF 04618856 190

LOT 479749

cobas®
2021-08

		PreciControl TOXIGM I			PreciControl TOXIGM II			
		LOT 471213			LOT 471210			
Components	Method	Value	Range	ISO	Value	Range	ISO	Unit
cobas e 611 analyzer								
TOXIGM	Elecsys Toxo IgM 04618856	0.18	0.00 - 0.36	0.06	3.08	2.16 - 4.00	0.31	COI
TOXIGM	⚠ Elecsys Toxo IgM 04618856 LOT 442622	0.18	0.00 - 0.36	0.06	2.93*	2.05 - 3.81	0.29	COI
cobas e 601 analyzer								
TOXIGM	Elecsys Toxo IgM 04618856	0.18	0.00 - 0.36	0.06	3.08	2.16 - 4.00	0.31	COI
TOXIGM	⚠ Elecsys Toxo IgM 04618856 LOT 442622	0.18	0.00 - 0.36	0.06	2.93*	2.05 - 3.81	0.29	COI
cobas e 602 analyzer								
TOXIGM	Elecsys Toxo IgM 04618856	0.18	0.00 - 0.36	0.06	3.08	2.16 - 4.00	0.31	COI
TOXIGM	⚠ Elecsys Toxo IgM 04618856 LOT 442622	0.18	0.00 - 0.36	0.06	2.93	2.05 - 3.81	0.29	COI

Cover be scanned into instrument by barcode. Please manually enter all parameter details.
Nicht-Lab-Barcode einlezen. Bitte alle Parameterangaben manuell eingeben.
Tous les code-barres. Saisir toutes les valeurs manuellement.
No hay código de barras. Introducir los valores manualmente.
Nur mit einem into halo strumento con il codice a barre. Introducere tutti i dati manualmente.
Nicht-Lab-Barcode einlezen. Bitte alle Parameterangaben manuell eingeben.
Tous les code-barres. Saisir toutes les valeurs manuellement.
No hay código de barras. Introducir los valores manualmente.
Nur mit einem into halo strumento con il codice a barre. Introducere tutti i dati manualmente.
Nicht-Lab-Barcode einlezen. Bitte alle Parameterangaben manuell eingeben.
Tous les code-barres. Saisir toutes les valeurs manuellement.
No hay código de barras. Introducir los valores manualmente.
Nur mit einem into halo strumento con il codice a barre. Introducere tutti i dati manualmente.
Nicht-Lab-Barcode einlezen. Bitte alle Parameterangaben manuell eingeben.
Tous les code-barres. Saisir toutes les valeurs manuellement.
No hay código de barras. Introducir los valores manualmente.
Nur mit einem into halo strumento con il codice a barre. Introducere tutti i dati manualmente.
Nicht-Lab-Barcode einlezen. Bitte alle Parameterangaben manuell eingeben.
Tous les code-barres. Saisir toutes les valeurs manuellement.
No hay código de barras. Introducir los valores manualmente.
Nur mit einem into halo strumento con il codice a barre. Introducere tutti i dati manualmente.

Сервис

по Доверенности
от 04.02.2021

«Рош»
Диспости

ОГРНИП * МОСКВА *

Всё произведено,
вручено лично

Диспости

ОГРНИП * МОСКВА *

«Рош»

Диспости

ОГРНИП * МОСКВА *

Всё произведено,
вручено лично