

PHILIPS

«УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

по нормативному регулированию



ООО "ФИЛИПС"

Горкуша Д.В.

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


«Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями»

Производства: Philips Medical Systems, USA

(Филипс Медикал Системс, США)




1.1. Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями. Общий вид.

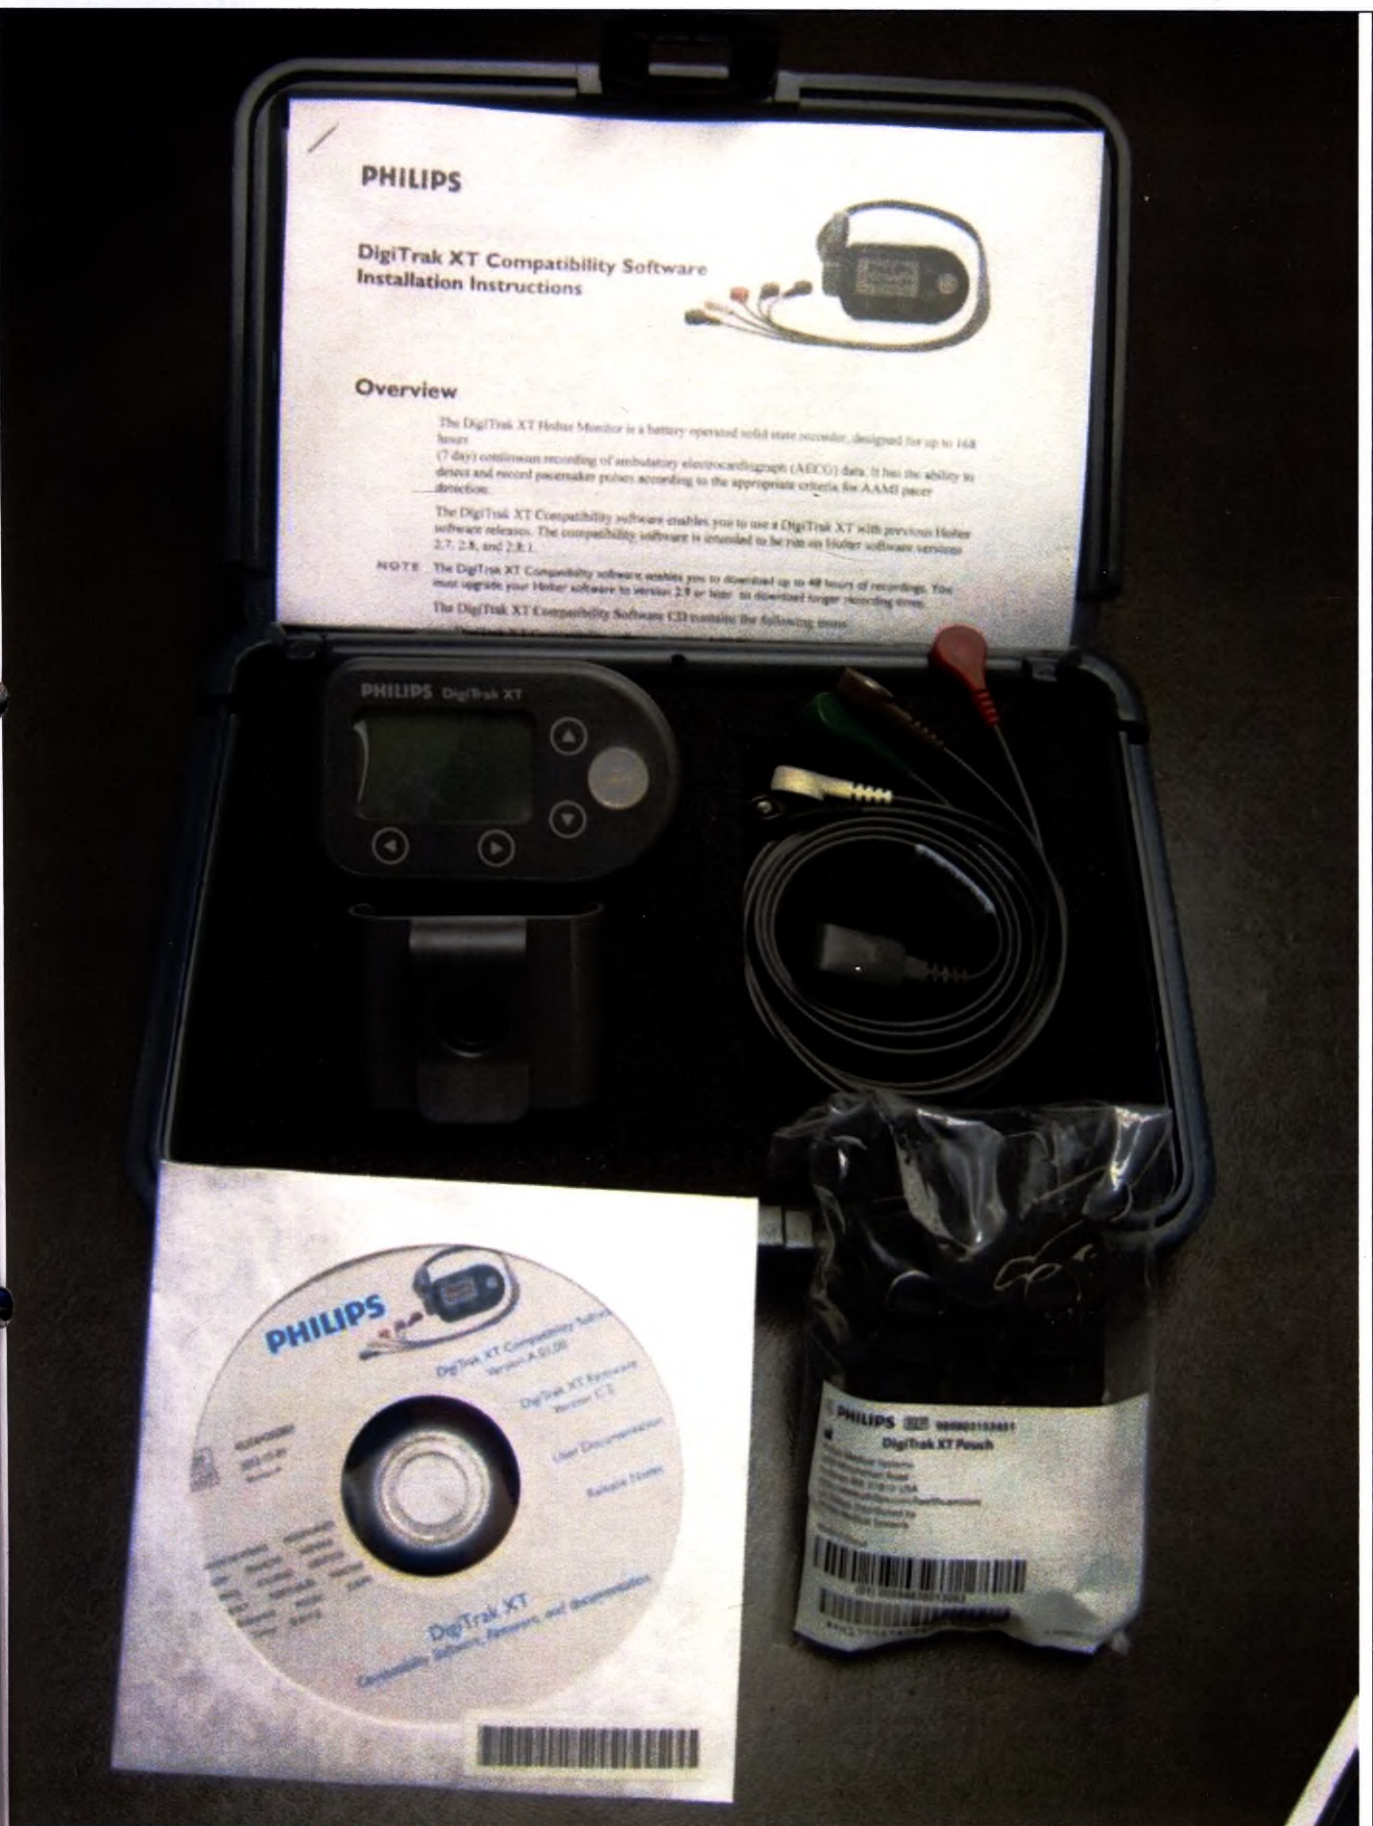

1.2. Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями. Общий вид в упаковке.

Принадлежности:

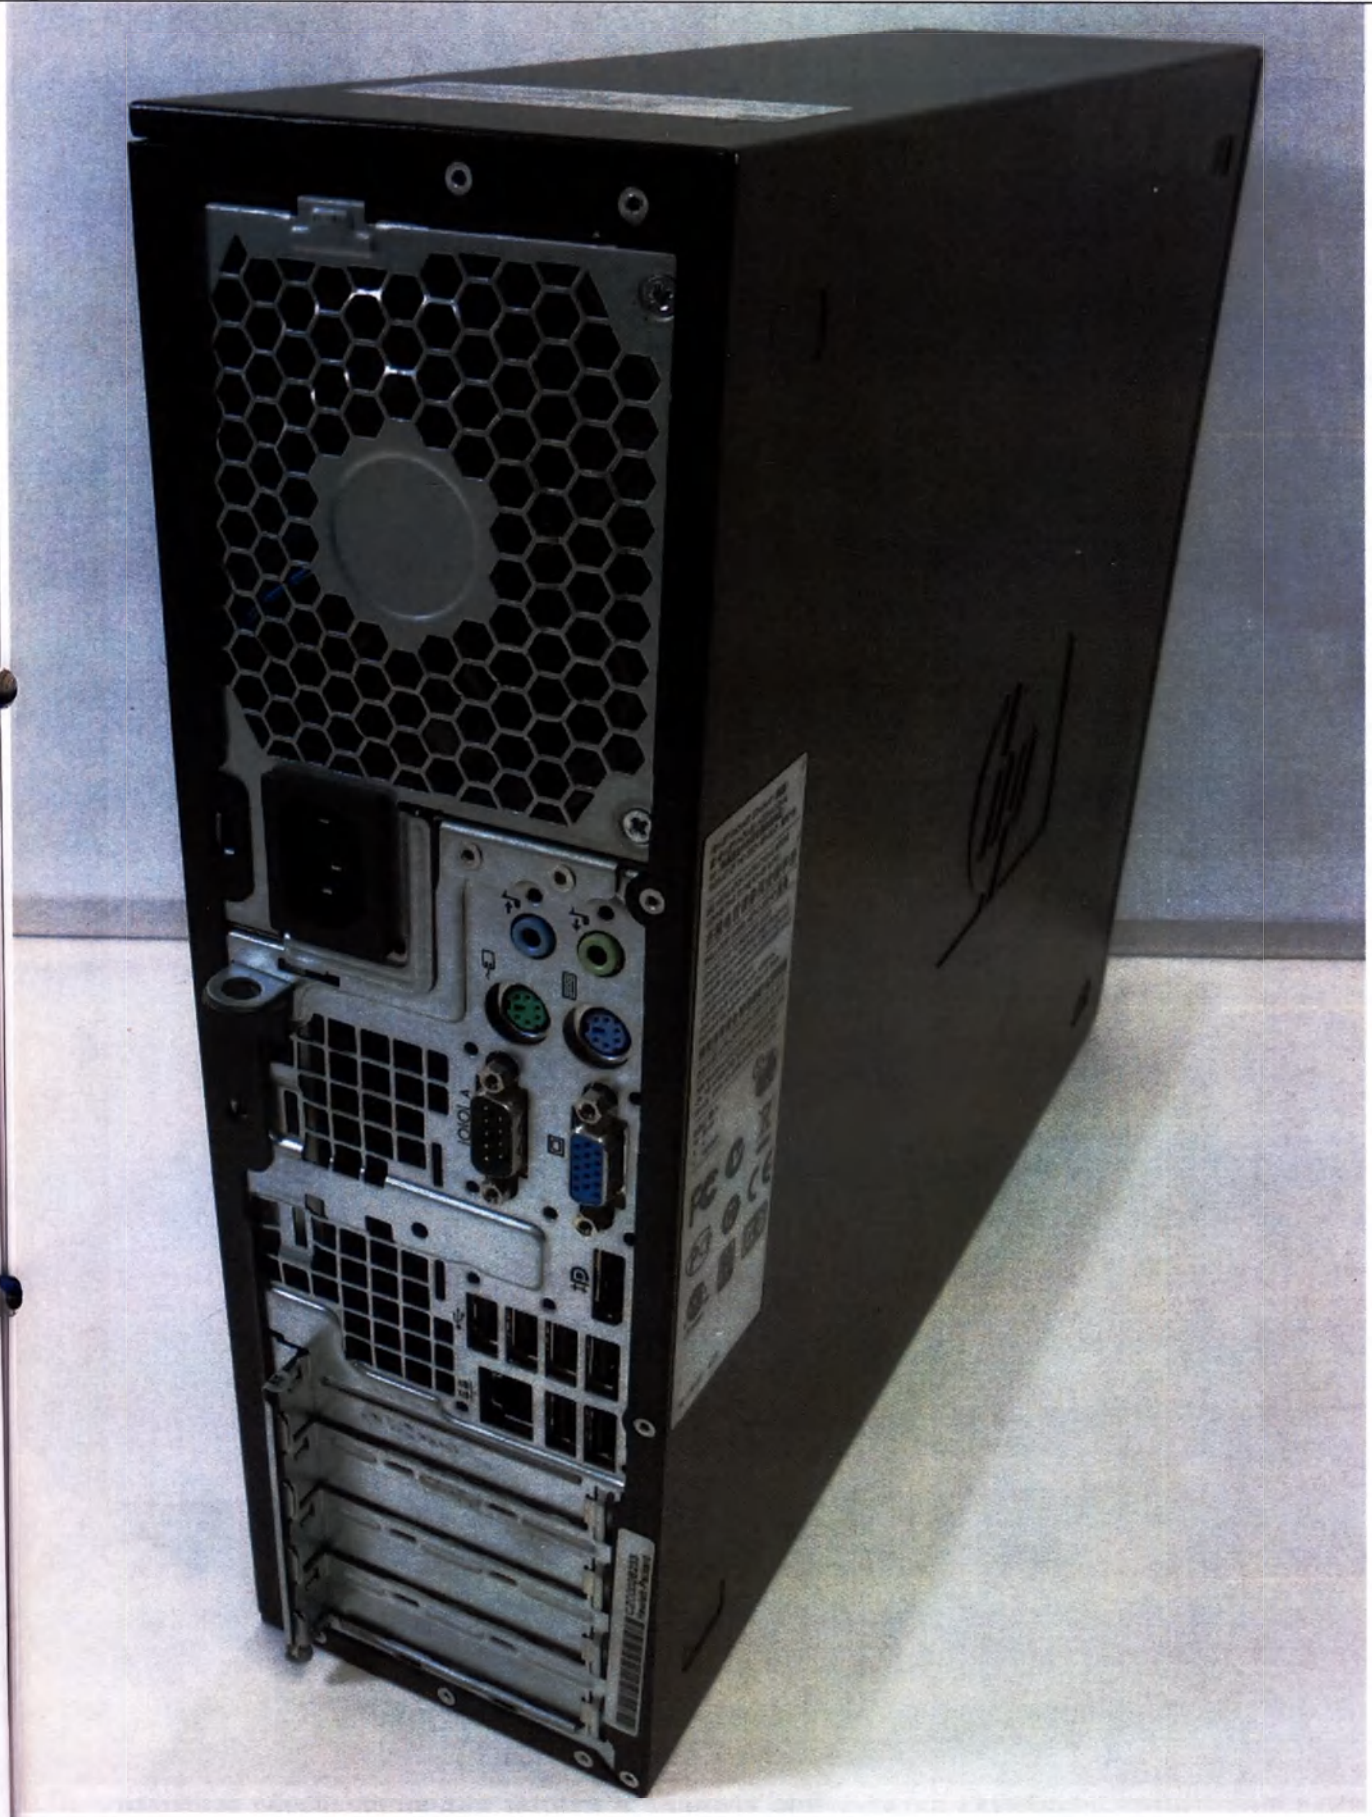

1. Блок получения, обработки и архивации данных о состоянии пациента.

PHILIPS

Holter Software
Software Version 3.0.4



© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved.

CE 0123

REF 860292

Qty: 1

Rx only

Software Installation Disk



(01) 00884838094895
(10) 3.0.4
(11) 2020-06-12

Software installation
for this product must
be completed by
qualified service
personnel. Refer to
installation instructions.

Software activated by
hardware license key.

www.healthcare.philips.com




Philips Medical Systems
3000 Minuteman Road
Andover MA 01810-1099 USA
Tel: 1 (978) 687-1501
2020-06-12

EU REP

Philips Medizin Systeme
Böblingen GmbH
Hewlett-Packard Str.2 71034
Böblingen
Germany

453564428941 Revision F



Kit Lot #:
30000399021

2. Программное обеспечение для записи и анализа результатов суточного мониторирования ЭКГ.



3. USB Ключ.



4. 1. Носимое устройство – регистратор для записи ЭКГ. Вид спереди.



4. 2. Носимое устройство – регистратор для записи ЭКГ. Вид сзади. Маркировка.



5. Сумка для регистратора.



6. ЭКГ кабель 61 см , ЭКГ кабель 91 см , ЭКГ кабель 137 см.



7. Электроды ЭКГ.



8. Аккумуляторы.



9.1. Устройство для считывания информации с регистратора. Вид спереди.




9.2. Устройство для считывания информации с регистратора. Вид сзади. Маркировка.



10.1. Зажим для фиксации регистратора на ремне. Вид сзади.



10.2. Зажим для фиксации регистратора на ремне. Вид спереди.

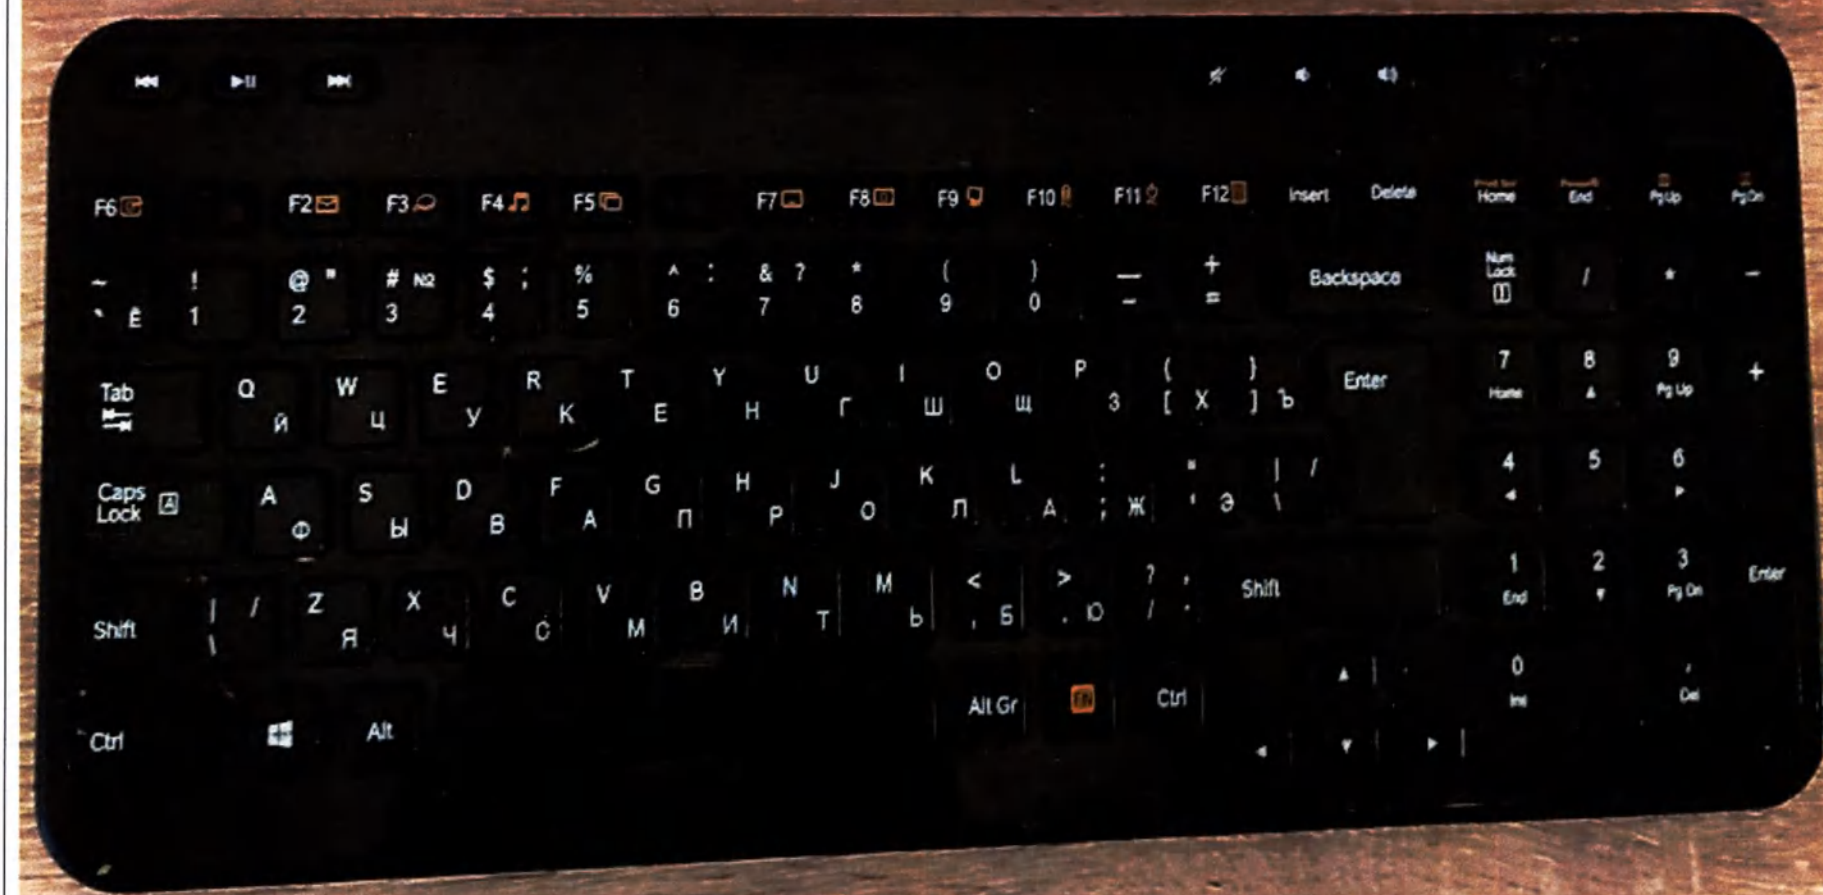

11. Клавиатура.



12. Трекбол.



13. Дисплей.



14. Лазерный принтер.



15. Источник бесперебойного питания.



16. Коммутационные кабели.

PHILIPS

Регистратор
DigiTrak XT

Версия С.2

Русский



Инструкция по эксплуатации

17. Инструкция по эксплуатации.


Philips DigiTrak XT (DTXT) Holter Recorder (860322) Overview Course




G. Aleman
Value Segment Solutions – Diagnostic ECG
July 2013

ATTENTION: THIS PAGE CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS THAT ARE CONFIDENTIAL AND/OR PROPRIETARY. ANY RELEASE OR DISTRIBUTION OF THIS MATERIAL WITHOUT PERMISSION IS A VIOLATION OF LAW.

18. Сервисная инструкция.

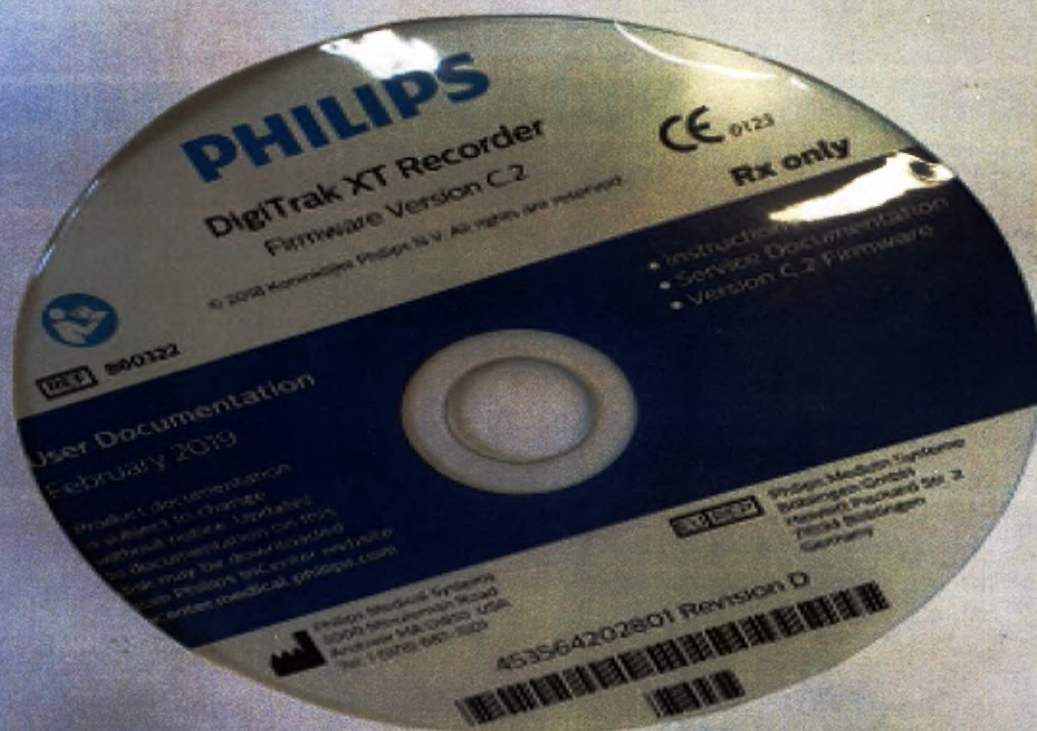

Kit Lot #
30000410101

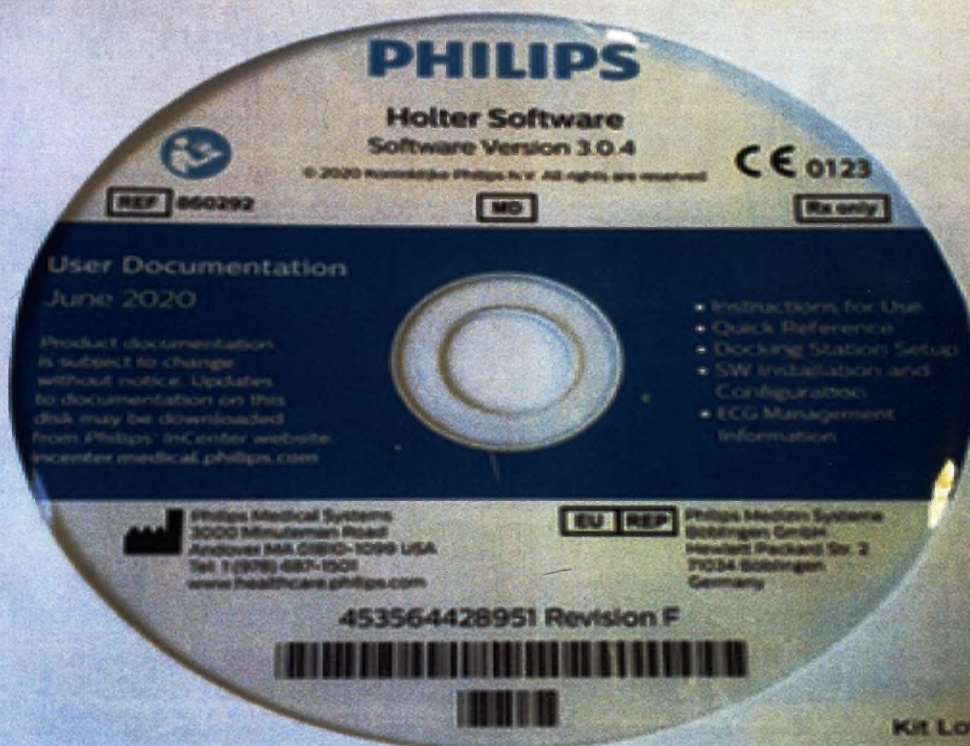


Kit Lot #
30000407135

19. Обучающая и сервисная информация на CD.

PHILIPS

MEDICAL EQUIPMENT

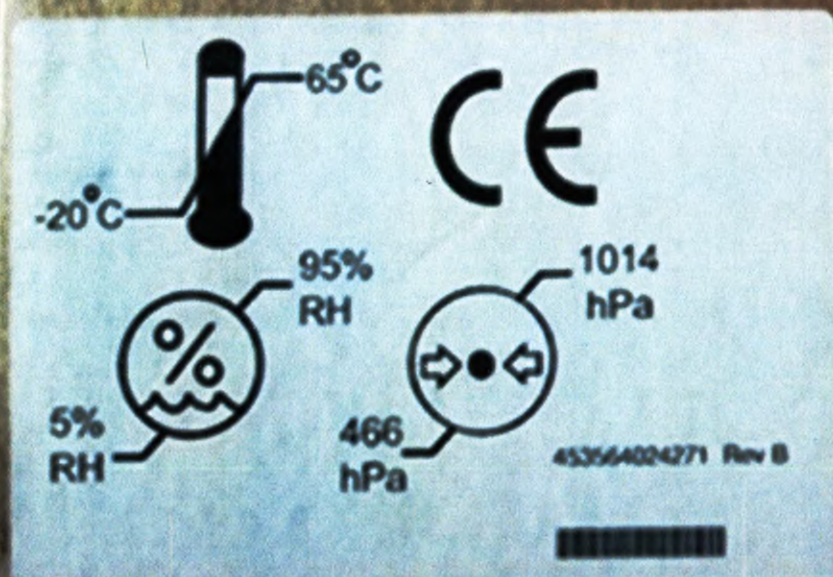

TRANSPORT AND SHIPPING
LABELS HERE

Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями. Транспортная упаковка.

PHILIPS
DigiTrak XT

Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями. Упаковка монитора.

Производитель:

"Филипс Медикал Системс", США

**Philips Medical Systems, 3000 Minuteman Road, Andover, MA 01810-1099,
USA**

Медицинское Изделие:

Монитор холтеровский DigiTrak XT с принадлежностями

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Номинальный режим работы: см.  или см. на основной маркировке

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2008/03139

EAC

Макет русскоязычной маркировки.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
28 листа (об)

