

Фотографические изображения медицинского изделия:


Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером

г. Москва


Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером, варианты исполнения:

1. Проводник управляемый NEUROSCOUT: Neuroscout Standard, общая длина 205 см;
2. Проводник управляемый NEUROSCOUT: Neuroscout Standard XL, общая длина 300 см;
3. Проводник управляемый NEUROSCOUT: Neuroscout Soft, общая длина 205 см;
4. Проводник управляемый NEUROSCOUT: Neuroscout Soft XL, общая длина 300 см.

Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид проводника):

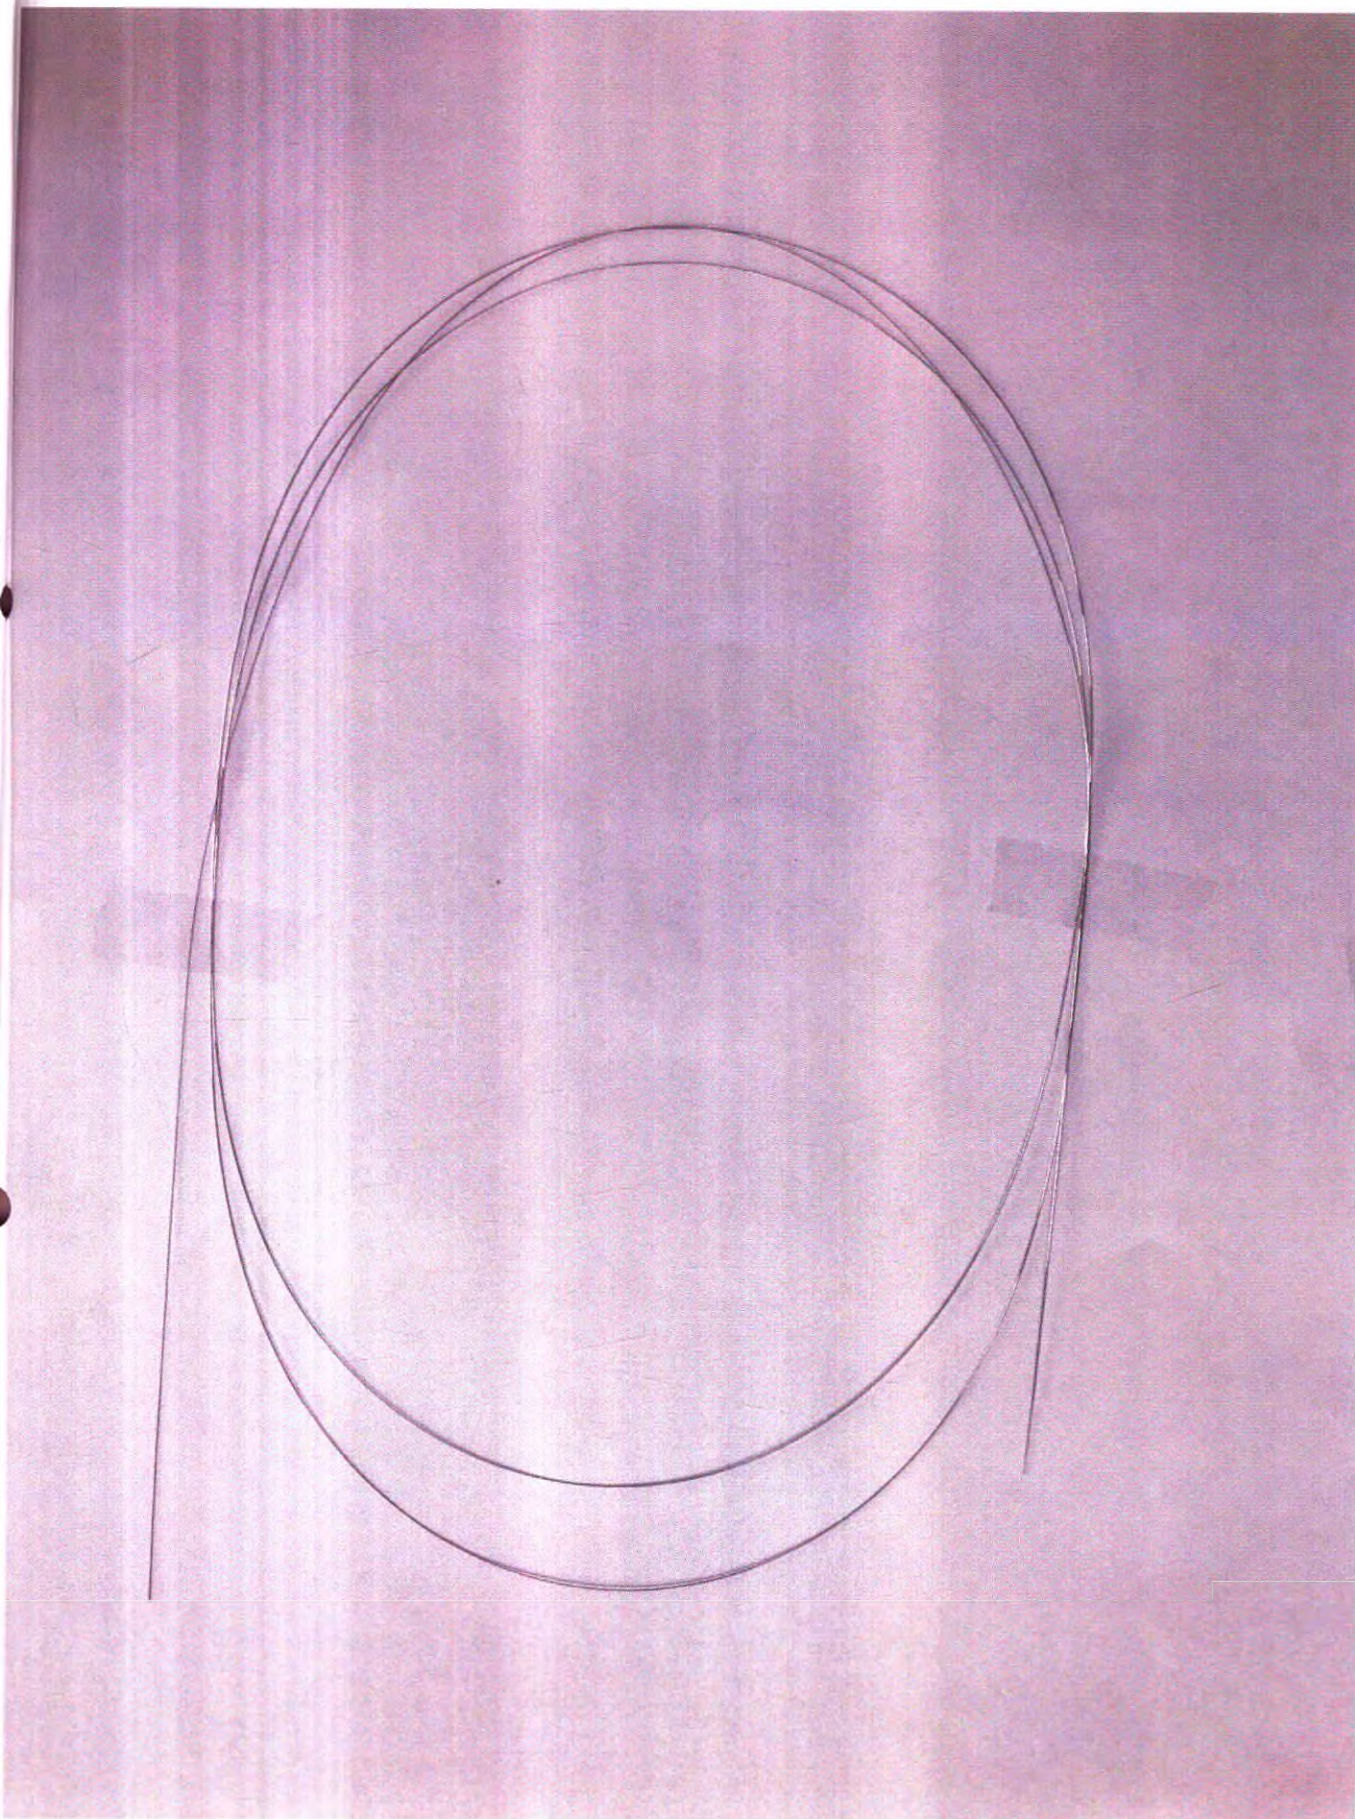


Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид интродьюсера):

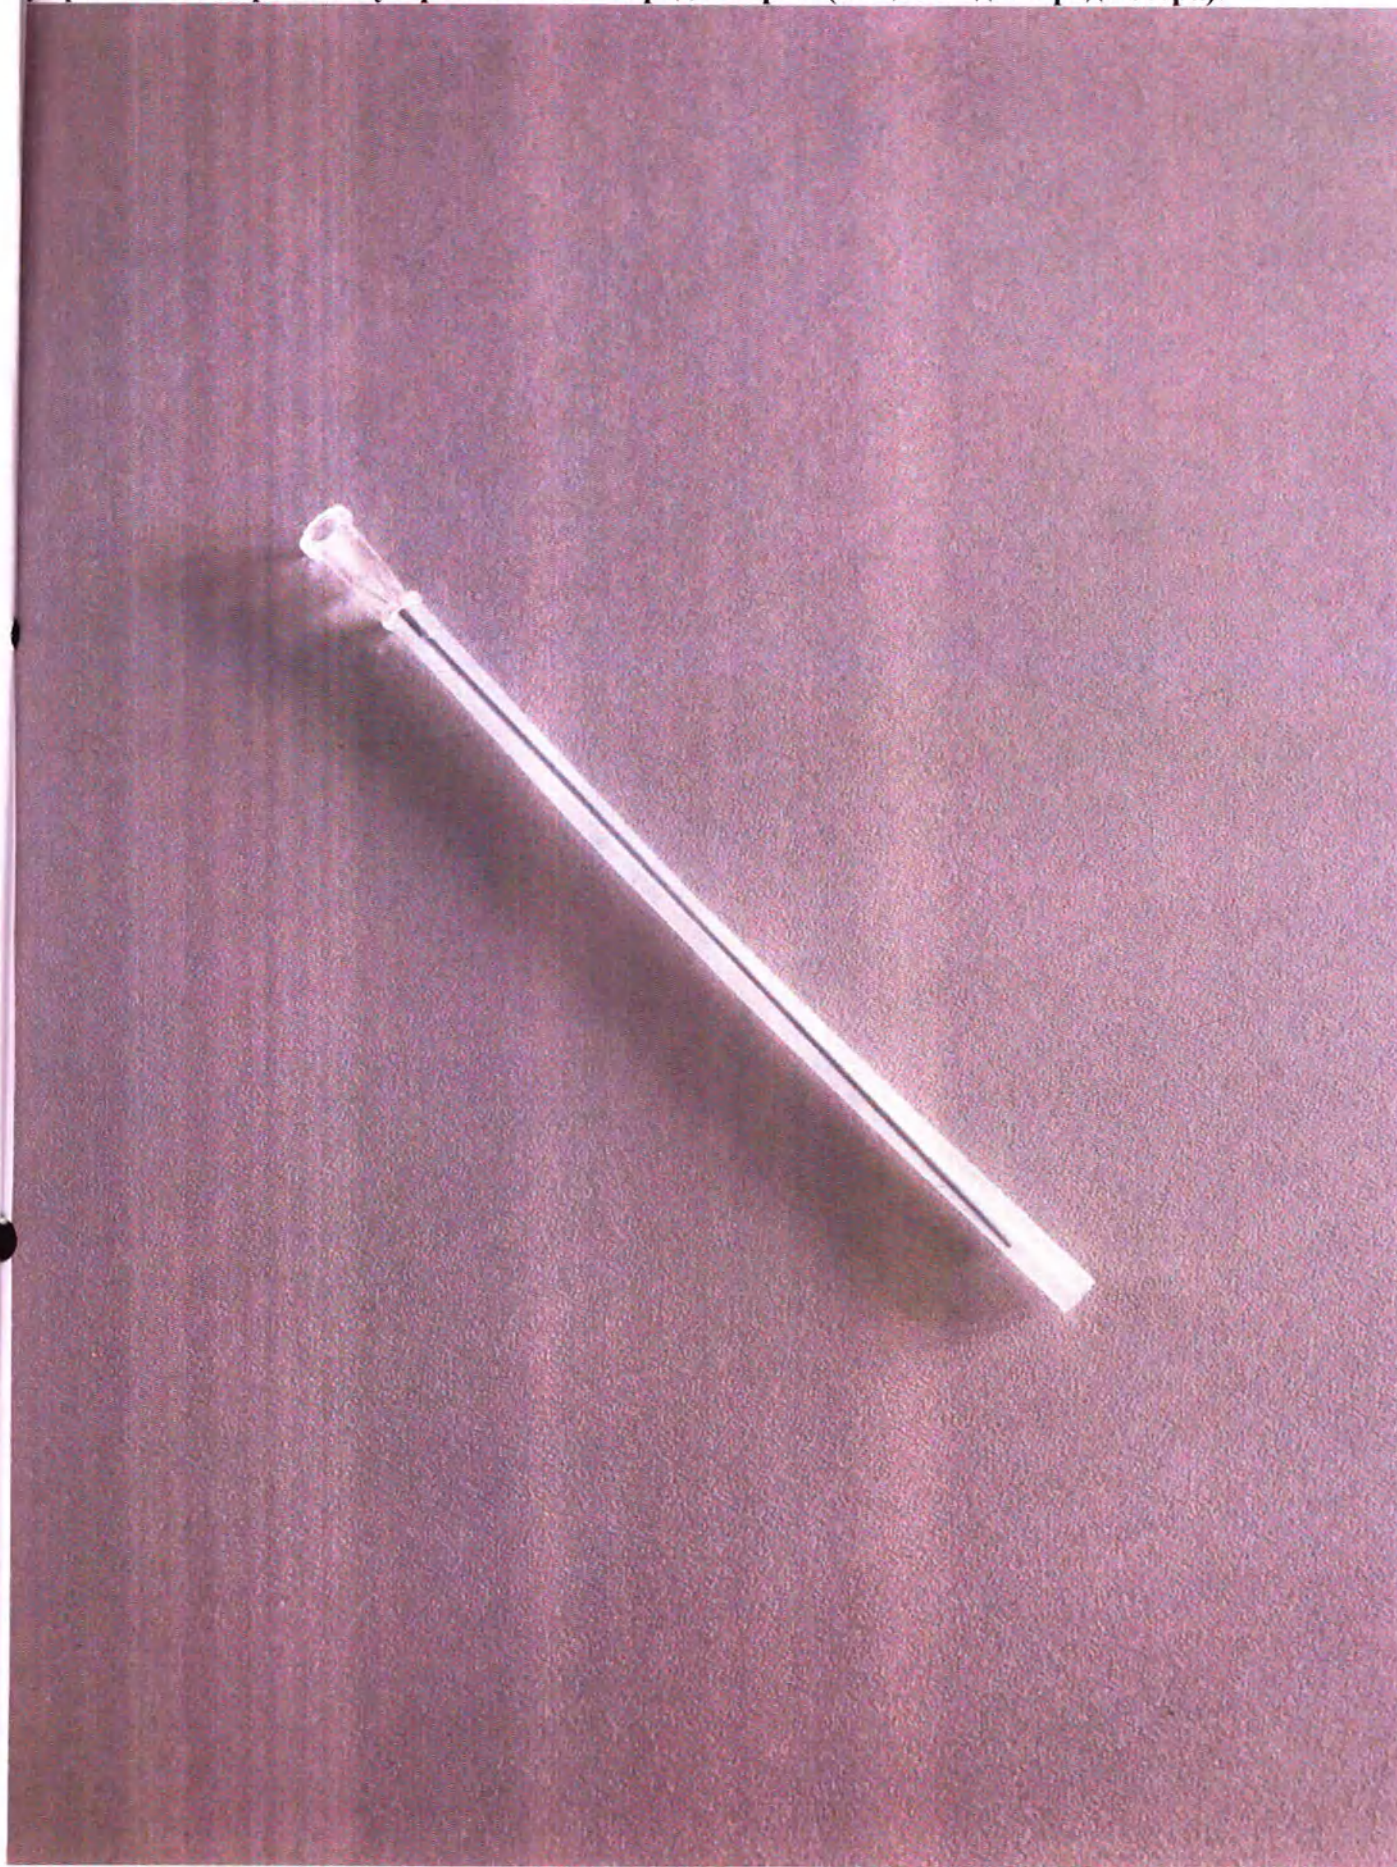


Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид поворотного устройства):



Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: упаковочной трубки проводника с проводником внутри, с зажимами и размещенными в них поворотным устройством и интродьюсером):

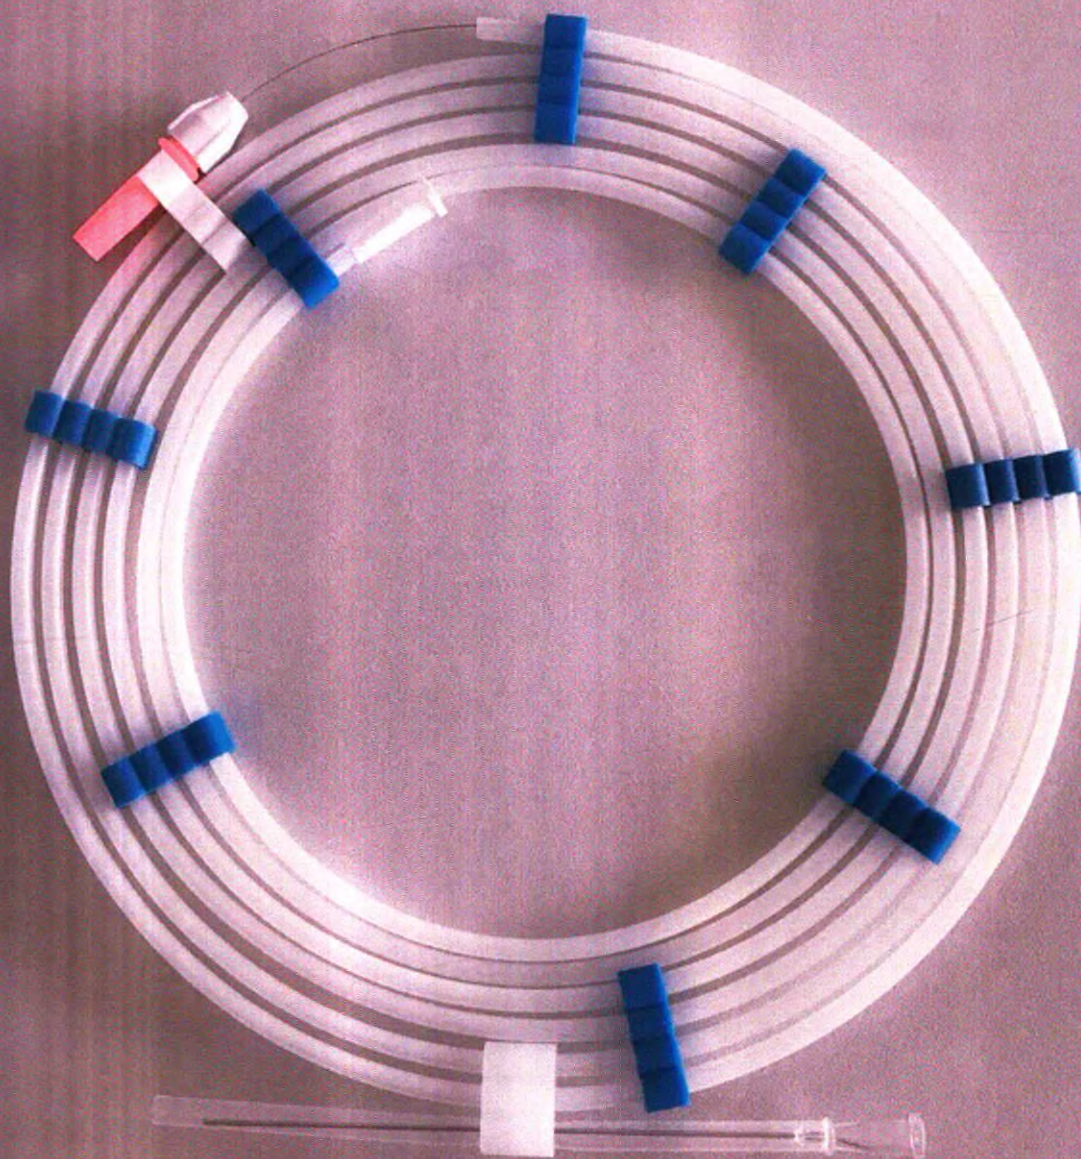


Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: стерильного пакета с изделием внутри (лицевая сторона)):

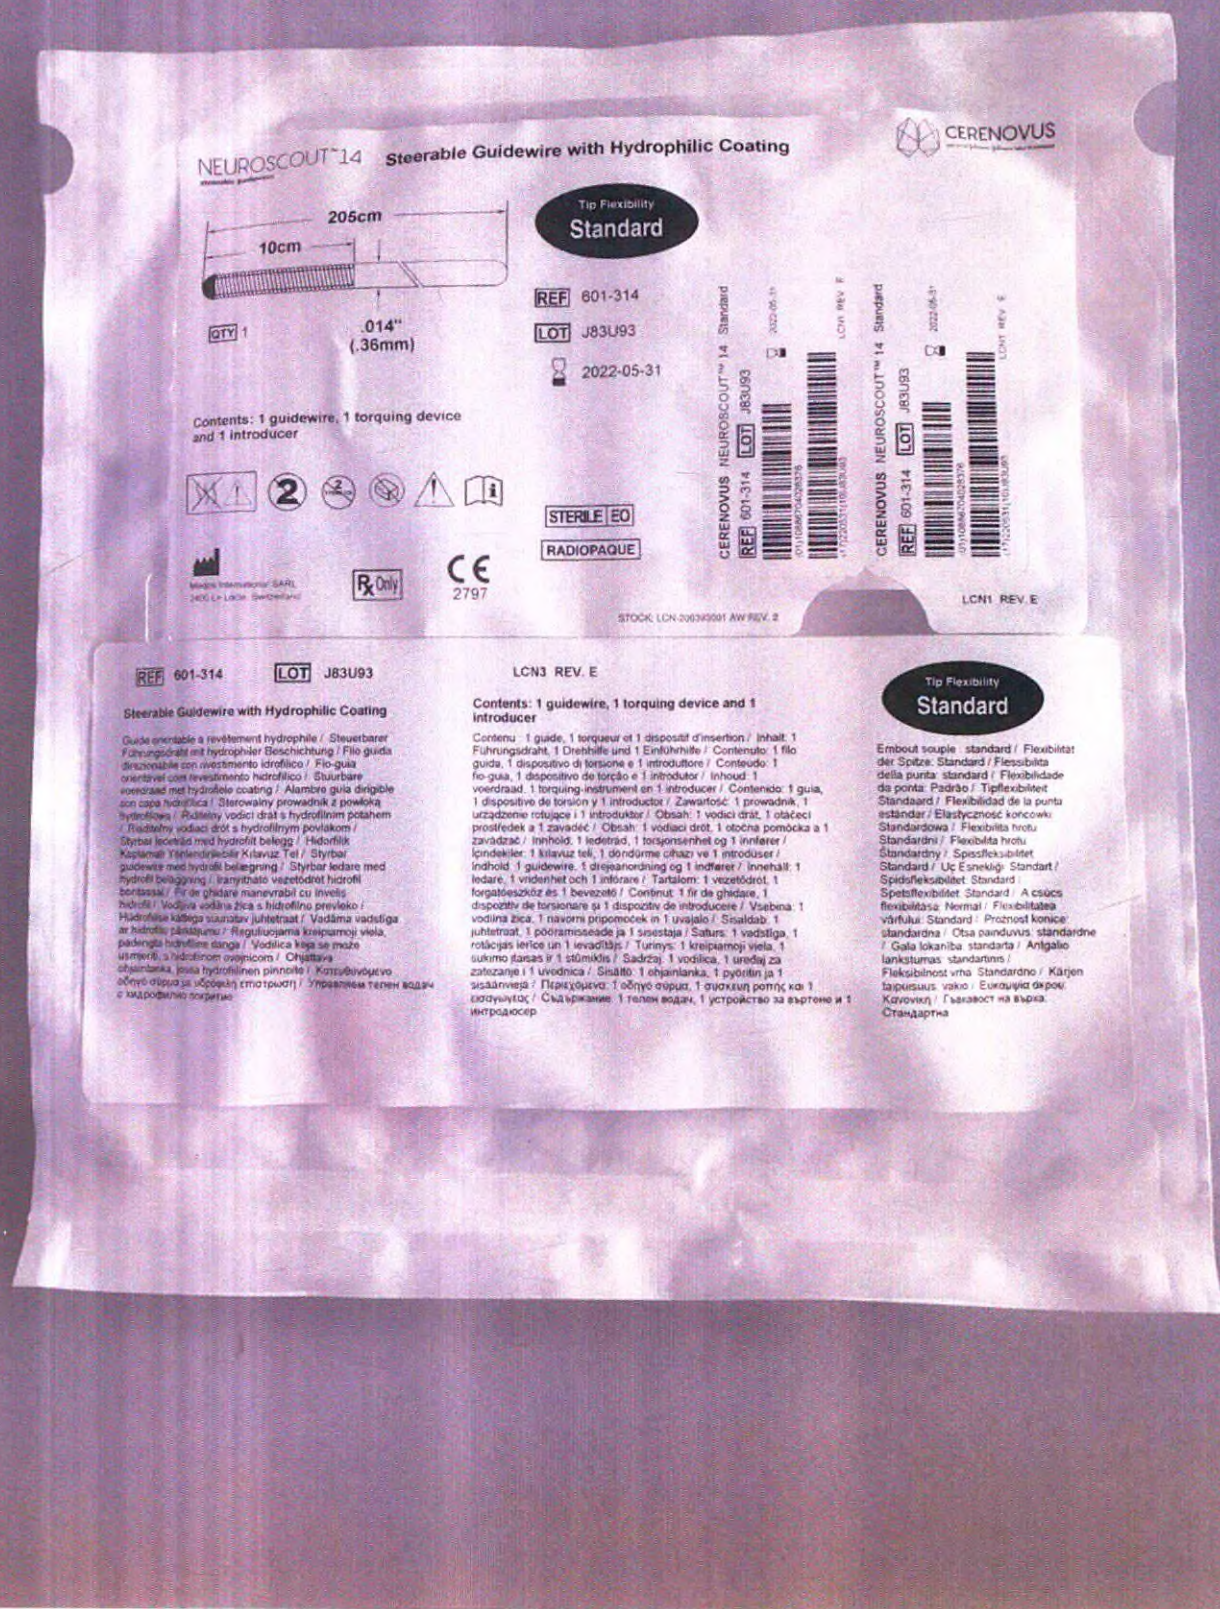

Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: стерильного пакета с изделием внутри (обратная сторона)):



Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: картонной коробки (вид сзади)):

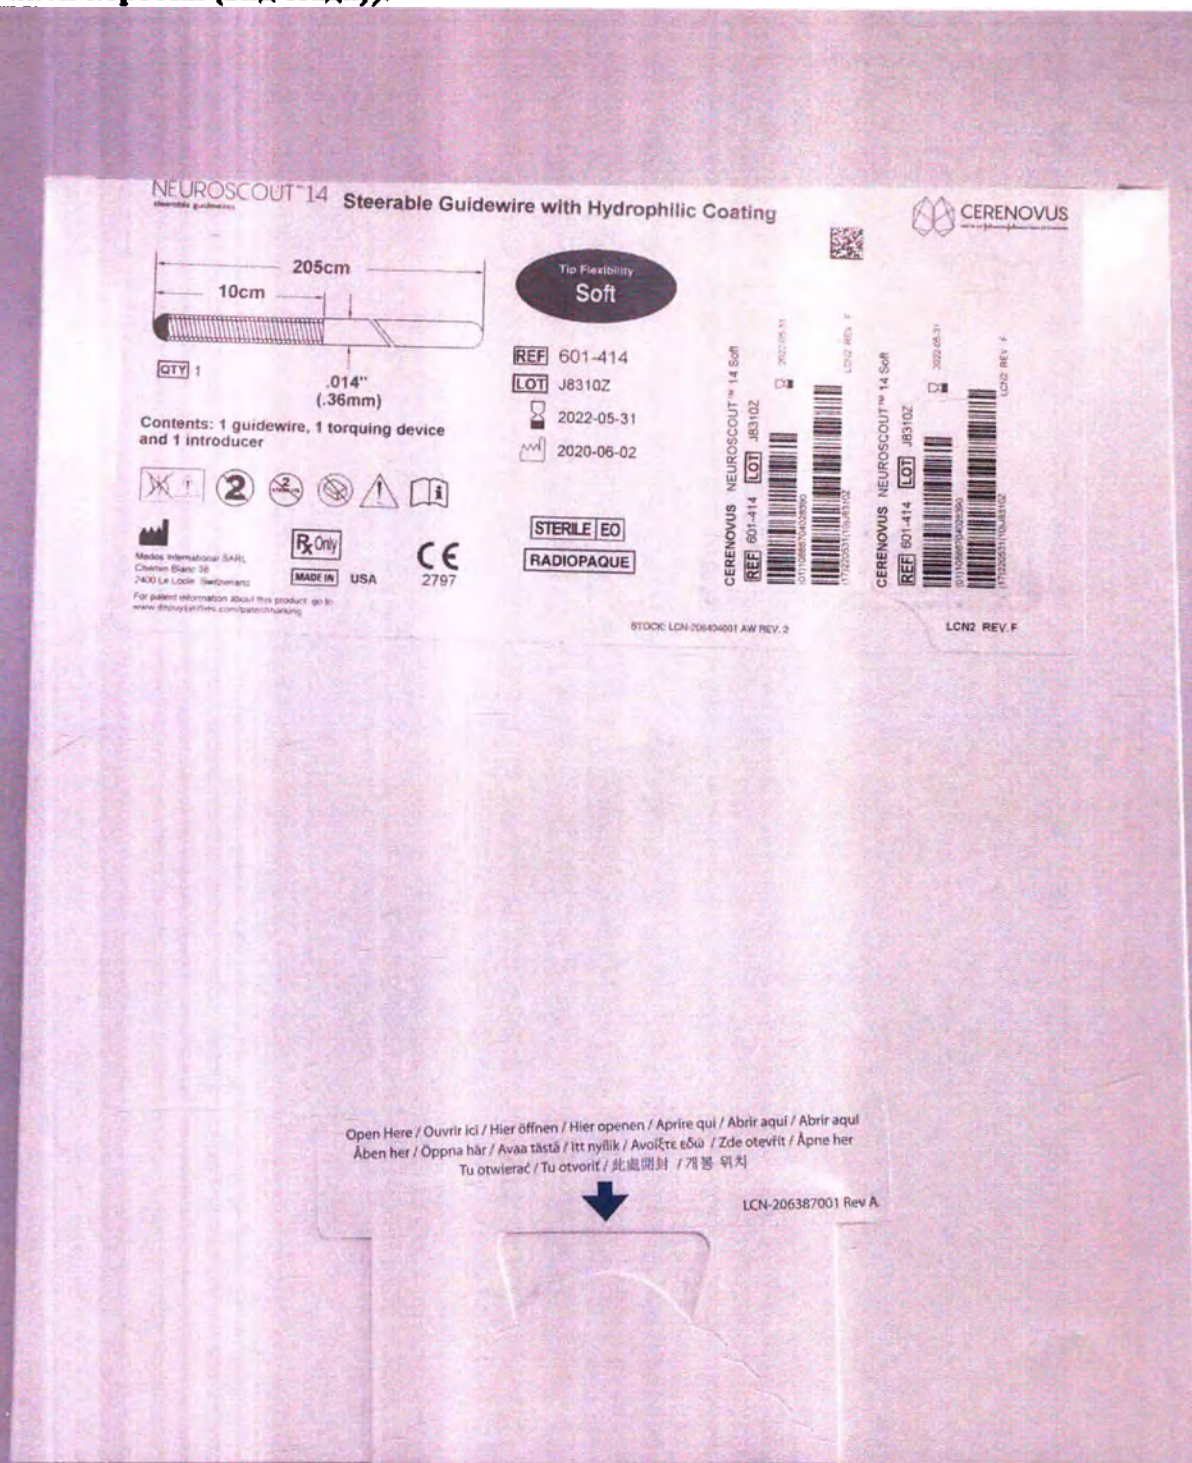

Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: картонной коробки (вид спереди)):

REF 801-314

LOT J83U93

Steerable Guidewire with Hydrophilic Coating

Guide orientable à revêtement hydrophile / Steuerbarer Führungsdraht mit hydrophiler Beschichtung / File guida direzionabile con rivestimento idrofilico / Fio-guia orientável com revestimento hidrofílico / Stuurbare voerdraad met hydrofiele coating / Alambre guía dirigible con capa hidrofílica / Sterowalny przewódnik z powłoką hydrofilową / Rodeleiny vodiči drôt s hydrofilnim potahom / Rieaditfiny vodiaci drôt s hydrofilným povlakom / Styrbar ledetråd med hydrofili bellegg / Hidrofiliik Kapitalmali Yönlendimlebilir Kılavuz Tel / Styrbar guidewire med hydrofil beläggning / Styrbar ledare med hydrofil beläggning / Vänythäkö vezetődíró hidrofili borítással / Fir de ghidare manevrabil cu înveli hidrofili / Vodljiva vodilna žica s hidrofilno prevleko / Hidrofiliise kartliga suunetav juhtetråd / Vadljama vadstiga ar hidrofilu pärlitajumi / Regulujusima krepiamoji viela, padengta hidrofiline danga / Vodilica koja se može usmeriti, s hidrofilnom opovincom / Ohjattava ohjainlanka, jossa hydrofilinen pinnoite / Katsutuvijokivo obnuy obratki statoruol / Управляем тепен водан с гидрофилно покритте


LCN3 REV. E

Contents: 1 guidewire, 1 torquing device and 1 introducer

Contenu: 1 guide, 1 torqueur et 1 dispositif d'insertion / Inhalt: 1 Führungsdraht, 1 Drehhilfe und 1 Einstöbhilfe / Conținut: 1 filo-guia, 1 dispozitiv de torsione și 1 introduttore / Conteúdo: 1 fio-guia, 1 dispositivo de torção e 1 introdutor / Inhoud: 1 voerdraad, 1 torquing-instrument en 1 introducer / Contendo: 1 guia, 1 dispositivo de torsion y 1 introducer / Zawartość: 1 przewódnik, 1 urządzenie nitujące i 1 introduktor / Obsah: 1 vodiči drôt, 1 stačecel protředek a 1 zaváděč / Obsah: 1 vodiaci drôt, 1 otočná pomôcka a 1 zavádzáč / Innhald: 1 ledetråd, 1 torsjonsenhet og 1 innfører / Innehåll: 1 guidewire, 1 drejesenordning og 1 indfører / Innehåll: 1 ledare, 1 vridenhet och 1 inifrare / Tartalom: 1 vezetődíró, 1 forgatóeszköz és 1 bevezető / Continut: 1 fir de ghidare, 1 dispozitiv de torsionare și 1 dispozitiv de introducere / Všetina: 1 vodilna žica, 1 navoim priponček in 1 uvajalo / Sisaldab: 1 juhtetråd, 1 pöörimiseseade ja 1 sisestaja / Saturs: 1 vadstiga, 1 rotācijas ierīce un 1 ievadītājs / Turmyns: 1 krepiamoji viela, 1 sukimo ratas ir 1 stūmikas / Sadržaj: 1 vodilica, 1 uređaj za zatezanje i 1 uvodnica / Sadržaj: 1 ohjainlanka, 1 pyörittin ja 1 sisästäin / Περιεχόμενα: 1 οδηγός ροπής, 1 συσκευή ροπής και 1 εισαγωγέας / Съдържание: 1 тепен водан, 1 устройство за въртене и 1 интродюсер

Top Flexibility
Standard


Embout souple: standard / Flexibilität der Spitze: Standard / Flessibilità della punta: standard / Flexibilidade da ponta: Padrão / Topflexibilitet: Standard / Flexibilidad de la punta: estándar / Elastyczność końcówki: Standardowa / Flexibilita hrotu: Standardní / Flexibilita hrotu: Standardní / Spetsflexibilitet: Standard / Spetsflexibilitet: Standard / Ácsúcs flexibilitása: Normál / Flexibilitate vârfului: Standard / Prožnost konice: standardna / Otsa panduvus: standardine / Gala lokanilba: standart / Antgalo pandumas: standartinis / Fleksibilitet vrha: Standardno / Karjen tapausuus: vakio / Elastisuus okron: Kovovoki / Гнзкзкост на върха: Стандартна



CERENOVUS

PART OF THE **Johnson & Johnson** FAMILY OF COMPANIES

Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (общий вид индивидуальной упаковки: картонной коробки (вид сбоку)):

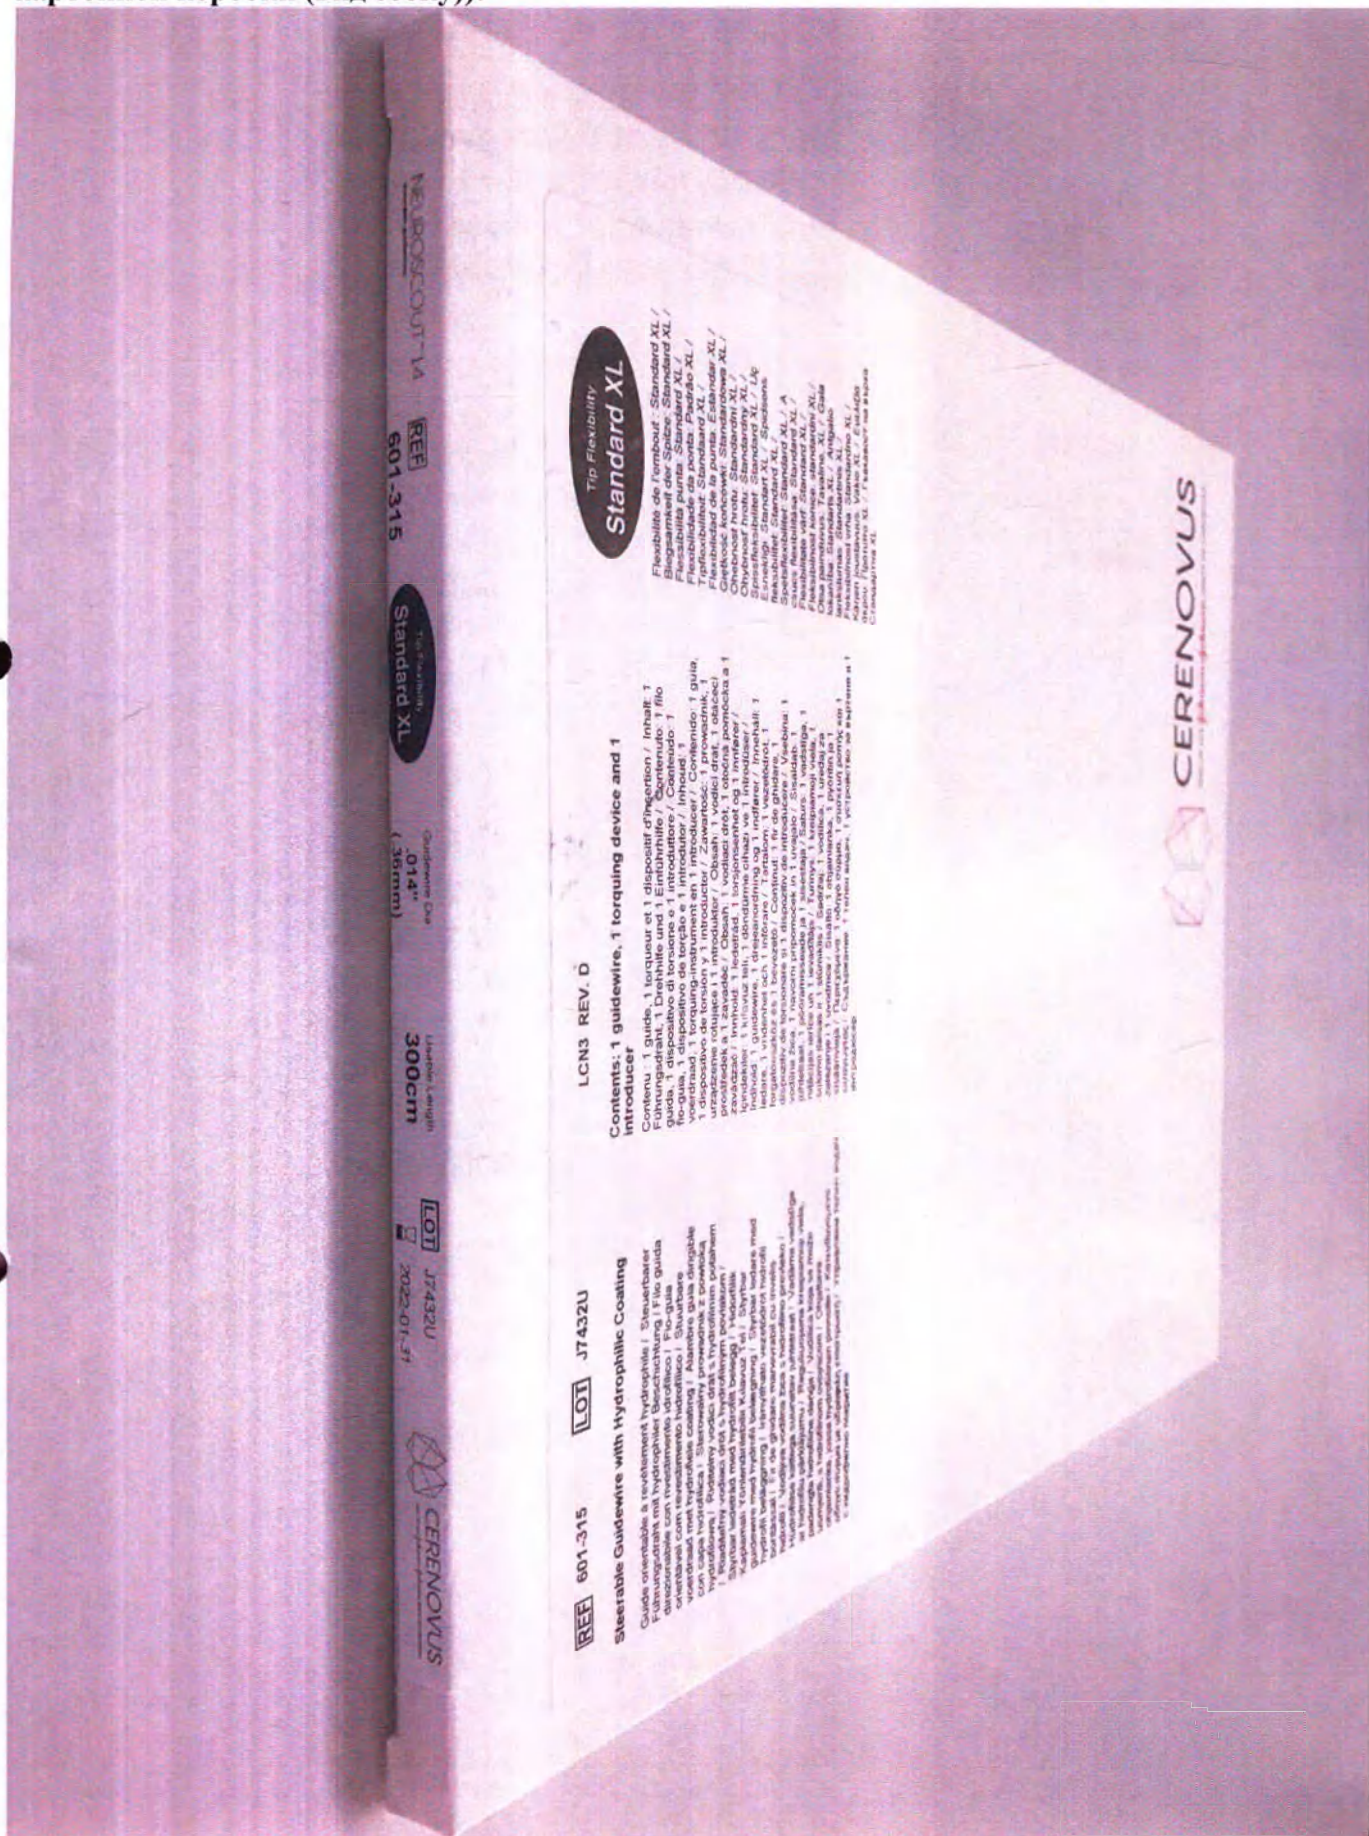

проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером (проект маркировки упаковки для применения в Российской Федерации):

REF 601314

Проводник управляемый NEUROSCOUT для избирательного проведения эндоваскулярных устройств с поворотным устройством и интродьюсером: Проводник управляемый NEUROSCOUT: Neuroscout Standard, общая длина 205 см

Область применения: Нейроваскулярная хирургия
Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2011/10025 от ДД.ММ.ГГГГ

Производитель (изготовитель): Medos International SARL (Медос Интернешнл САПЛ). Chemin-Blanc 38, Le Locle, CH-2400, Switzerland, Швейцария.

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Условия хранения и транспортировки:

температура не более 55°C, относительная влажность не более 80%, атмосферное давление 700-1060 гПа.

Общая длина 205 см



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

12 (Двенадцать)
листов

Менеджер по регистрации

Р.Б. Финкель

