

Генеральный директор
ООО "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ"
Александр Яковлевич Шестаков

«25»

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флуоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с
принадлежностями, в составе



Рис. 1 Внешний вид «Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флюоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с принадлежностями, в составе»



Рис. 2 Вид сзади «Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флюоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с принадлежностями, в составе» совместно с Кабель USB 2.0 и Электрический шнур



Рис. 3 Маркировка «Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флюоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с принадлежностями, в составе»



CE
IVD



QX200™ Droplet Reader, IVD

REF

12001045

Product

Description

Includes droplet reader, manual, 2 plate holders, USB cable, power cord, and software DVD

SN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bio-Rad Laboratories, Inc. www.bio-rad.com

Made in USA



Dio-Rad Laboratories, Inc.
5731 W. Las Positas Blvd, Pleasanton,
CA 94588, USA



10000049763 A




Рис. 4 Транспортная маркировка «Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флюоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с принадлежностями, в составе»

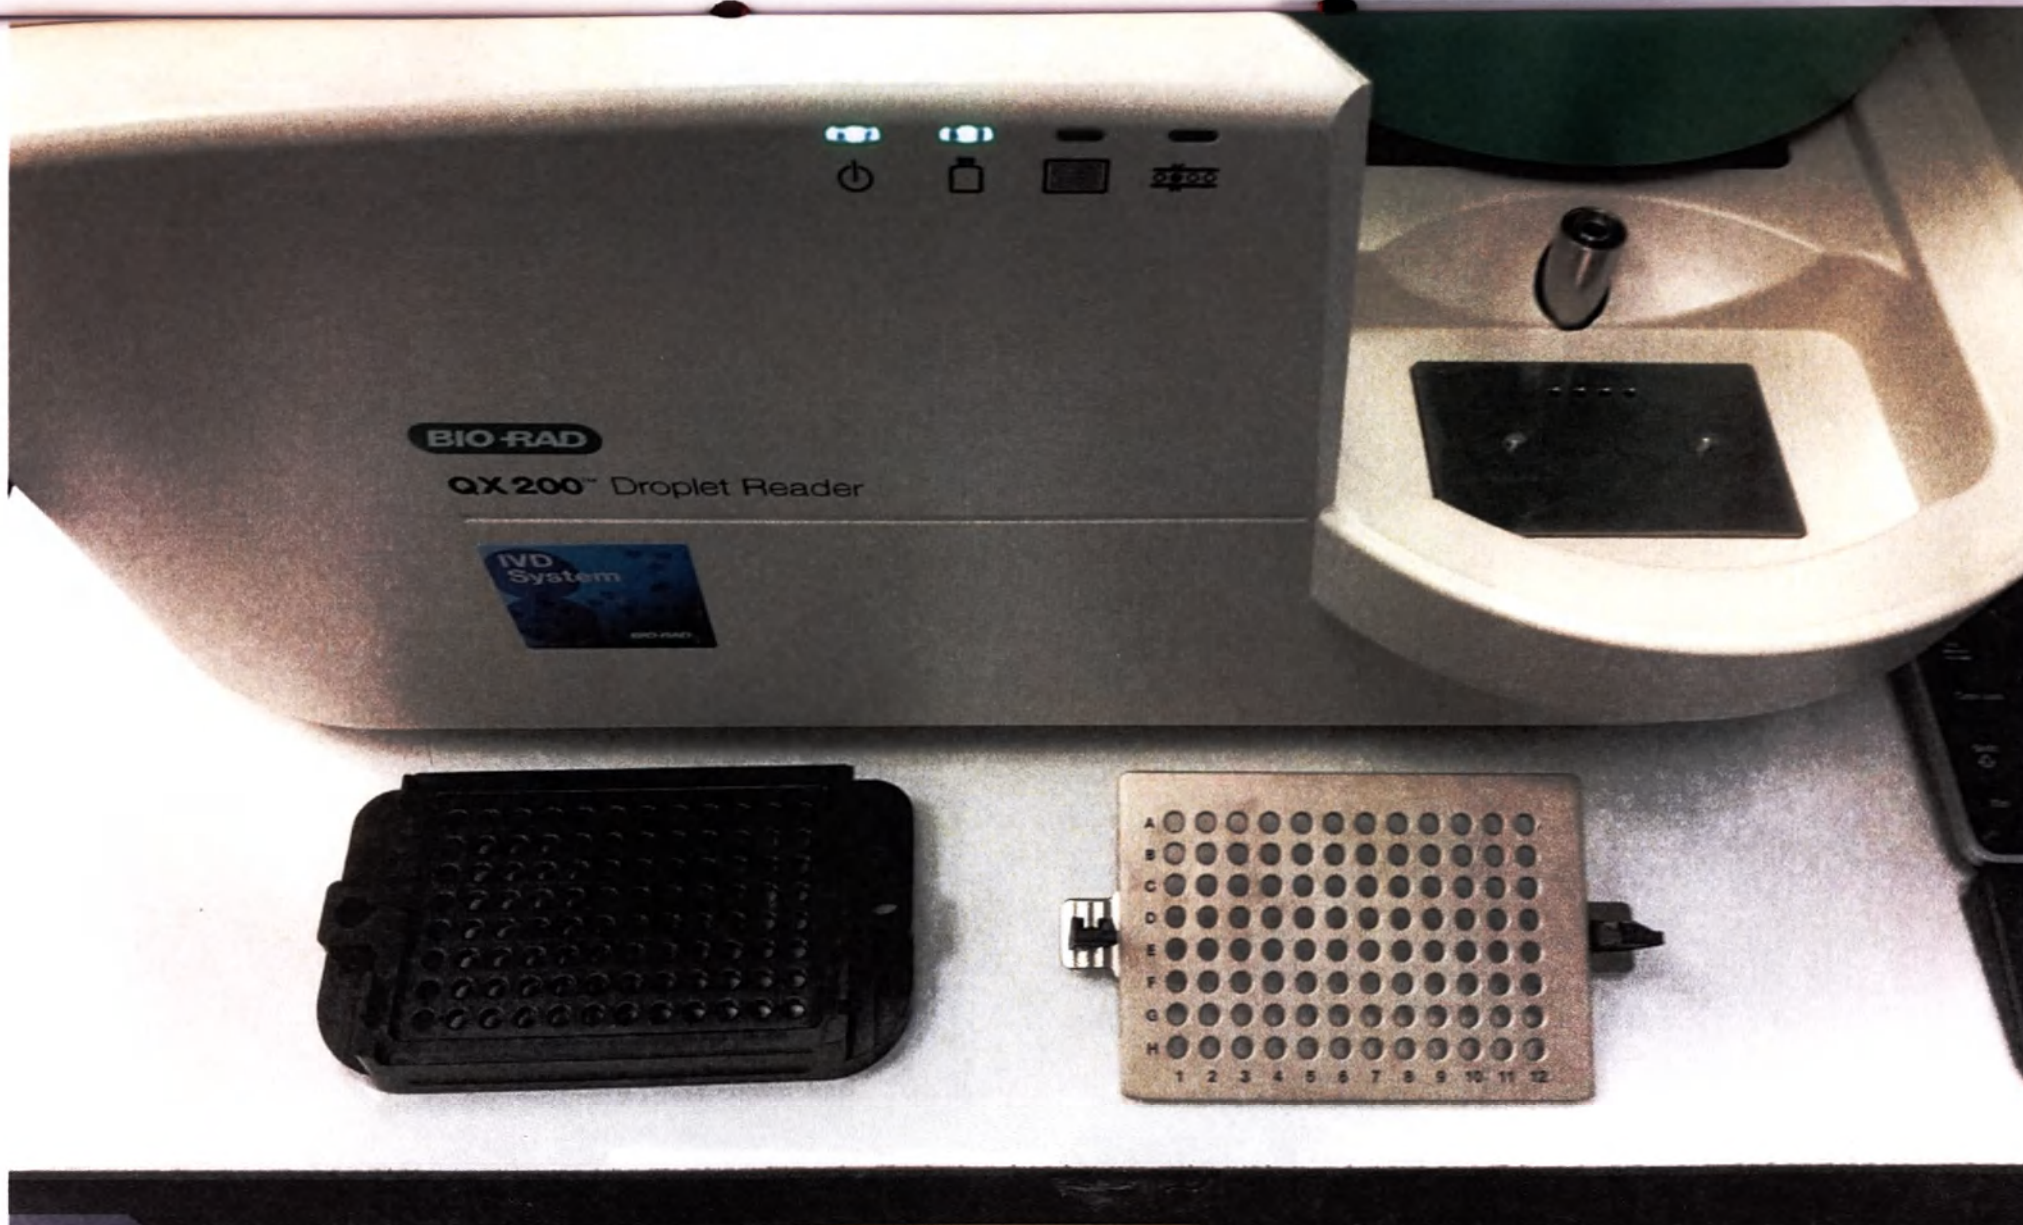


Рис. 5 Внешний вид - Держатель планшета для прибора для считывания капель



Рис. 6 Внешний вид – Компьютер и Подставка для компьютера

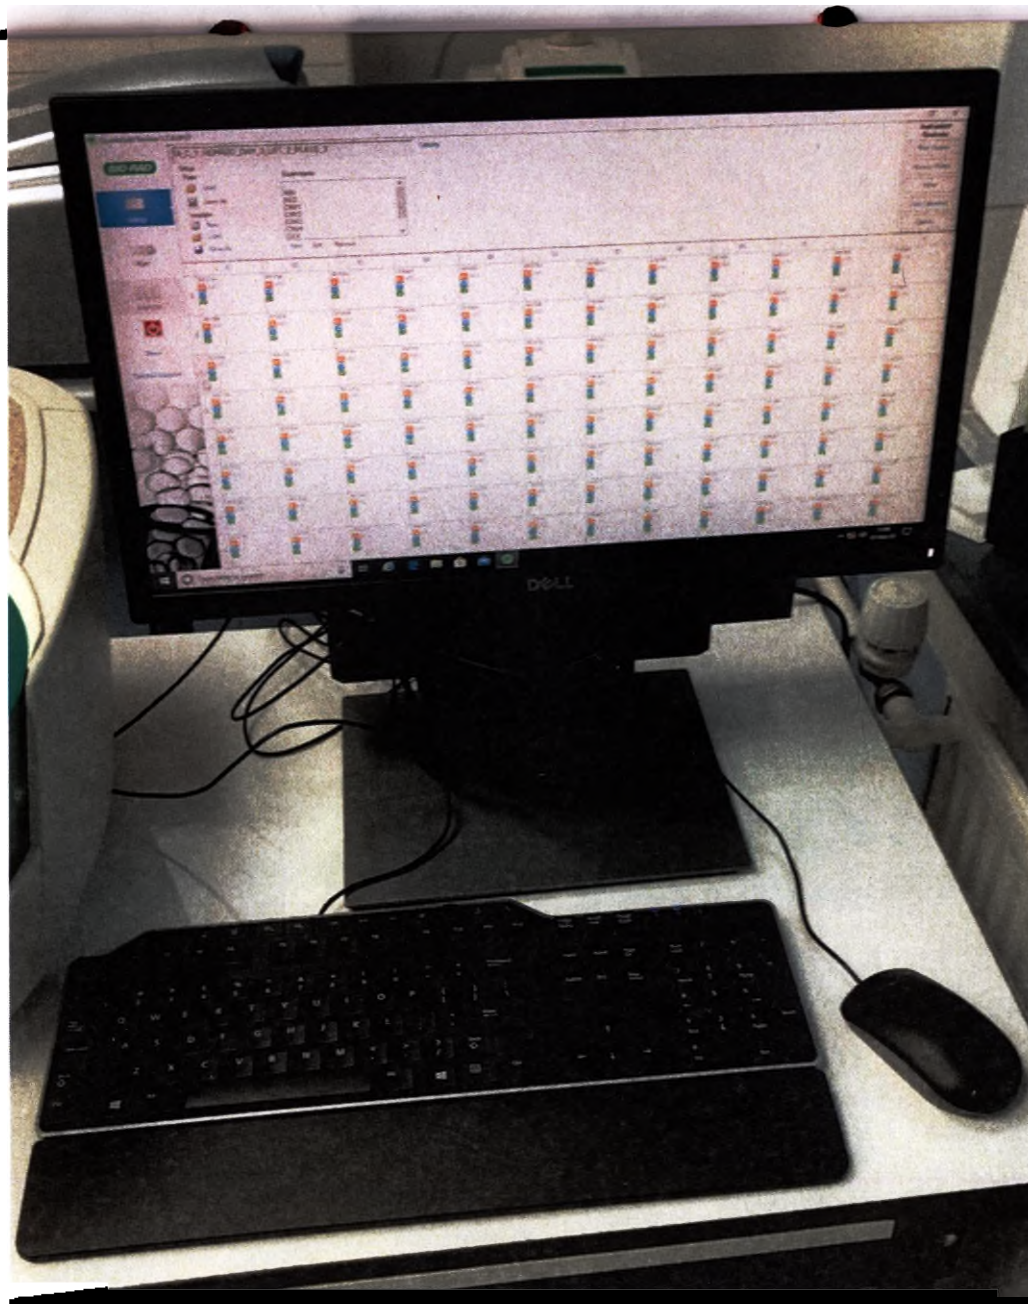


Рис. 7 Внешний вид - Монитор компьютер, Клавиатура и Мышь для компьютера



Рис. 8 Внешний вид Принадлежности к «Ридер «QX200 Droplet Reader» для детекции флюоресценции капель в методе цифровой капельной ПЦР, с принадлежностями, в составе»- Масло для ридера капель для системы цифровой капельной ПЦР, 1000 мл в одном флаконе

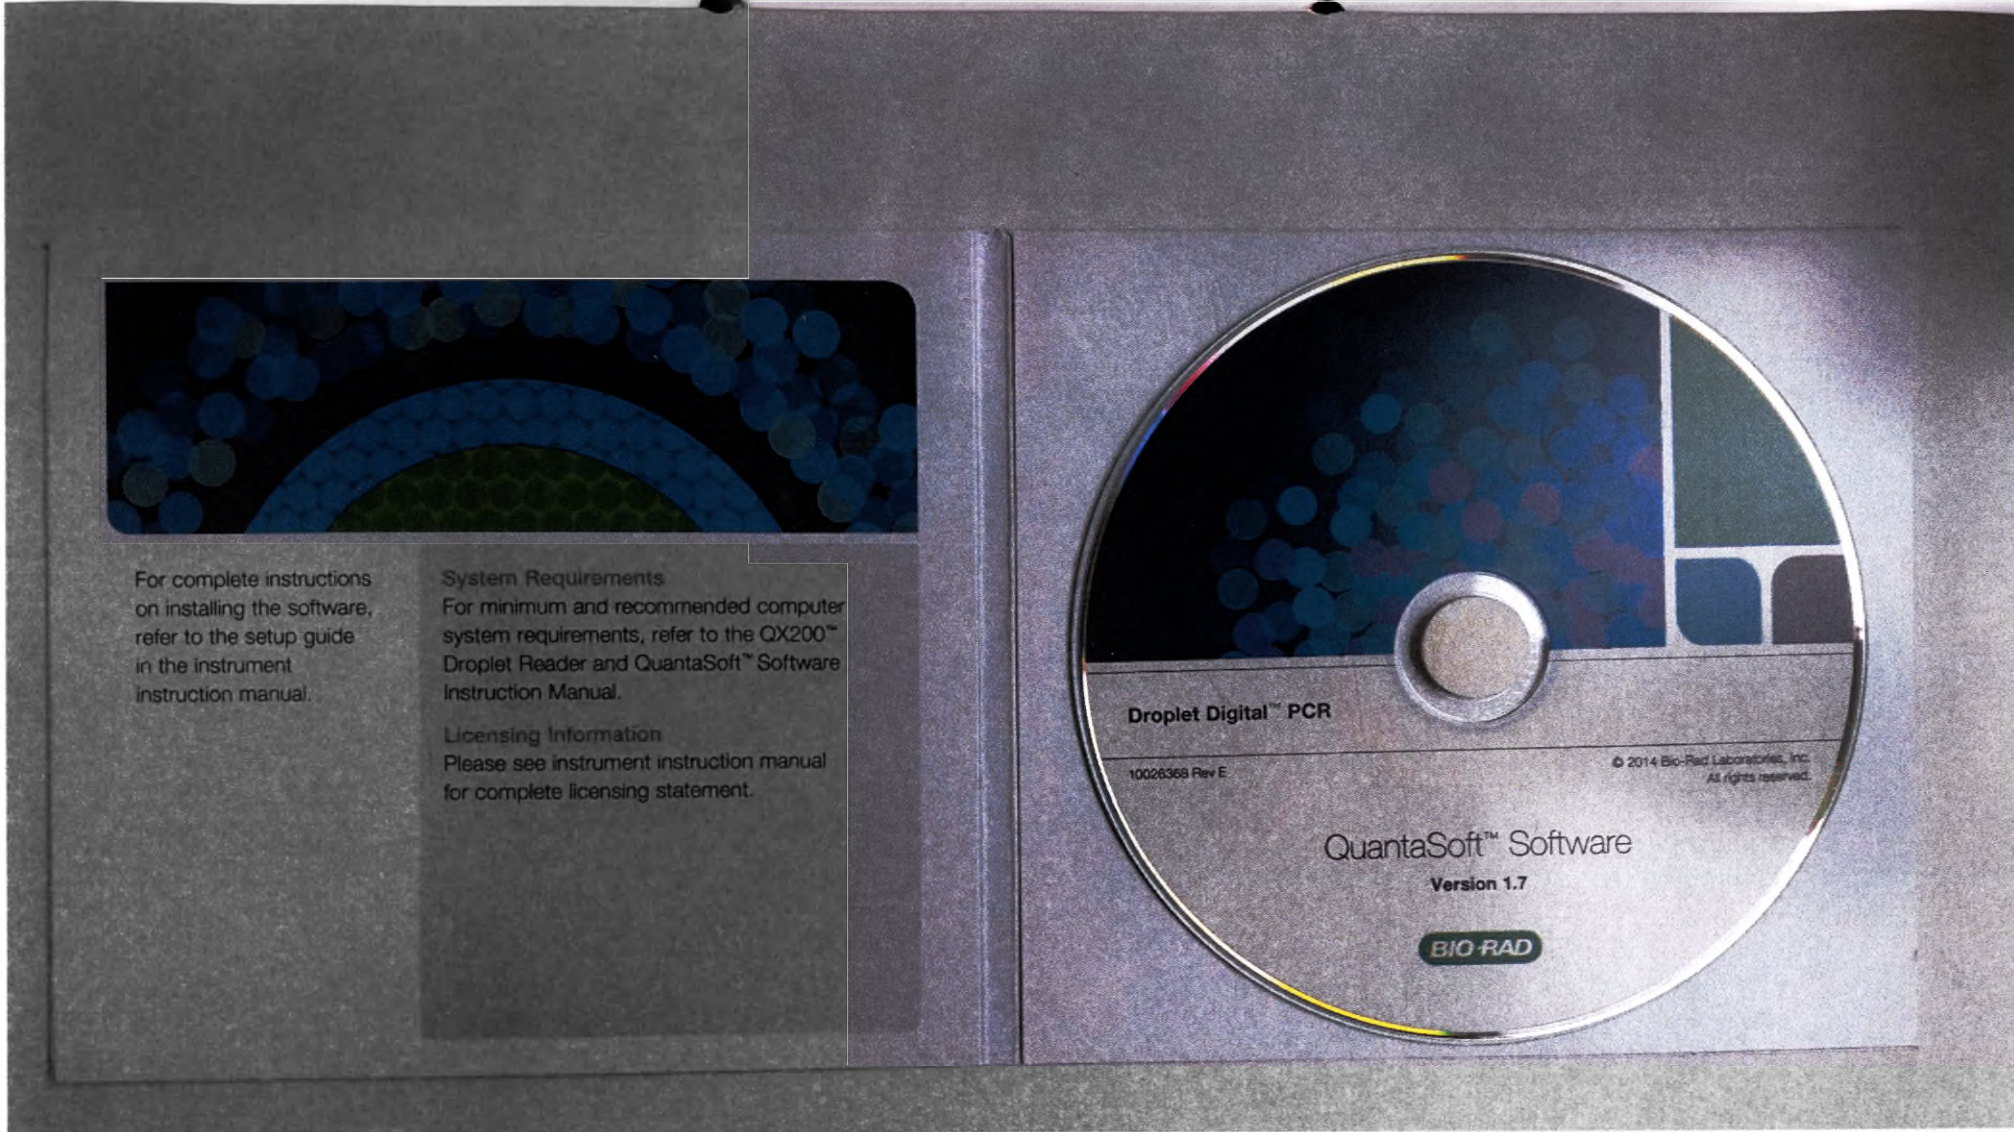


Рис. 9 Внешний вид - Программное обеспечение QuantaSoft

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов.

Генеральный директор
ООО «Био-Радикал»
Иванов А.Я.

