
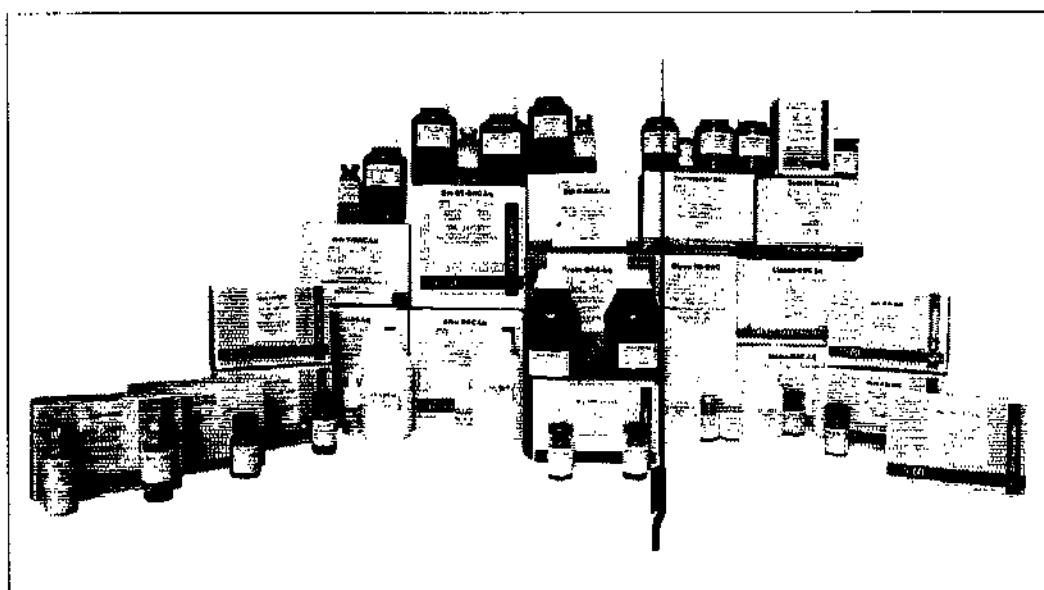


Приложение
К ПРОТОКОЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ № 110/12 от 25.04.12 г.
Внешний вид изделия медицинского назначения:
«Экспресс-тесты иммунохроматографические диагностические»,
производства DAC-SpectroMed s.r.l., Молдавия

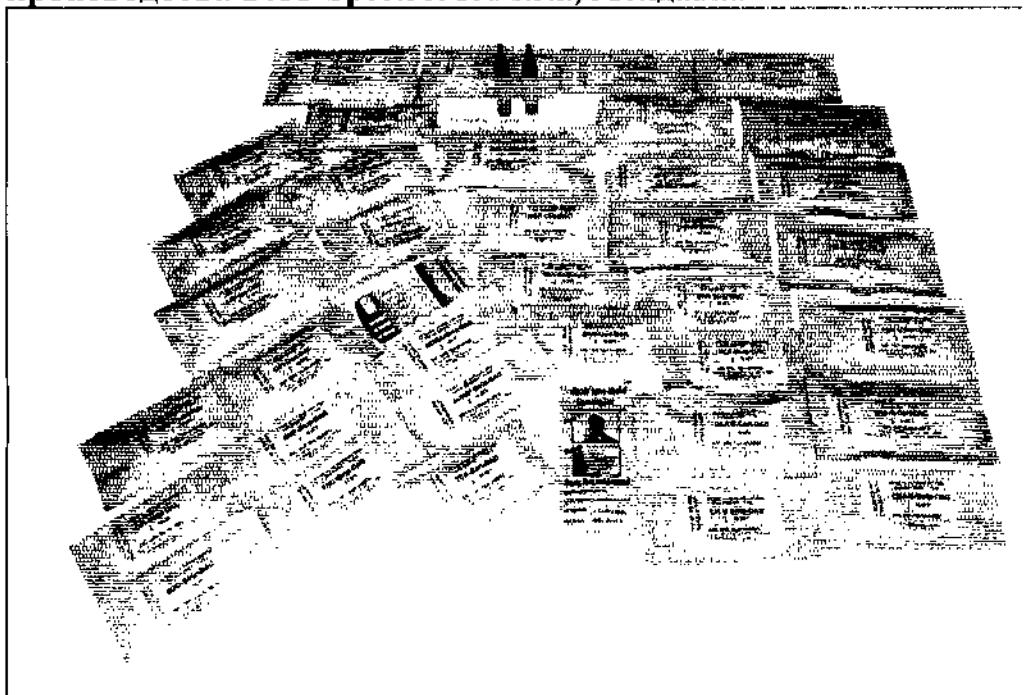

Испытания проводили:
Приемочная комиссия в составе:

Доцент кафедры КЛД РМАПО,
к.м.н., Ройтман А.П.

Доцент кафедры КЛД РМАПО,
к.м.н., Ракова Н.Г.