




Генеральный директор

ООО «Асвомед»

Стройков С.П.

«18 ФЕВ 2019» 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

**Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd» в вариантах
исполнения с принадлежностями**

г. Москва, 2019

Оглавление

1. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdeos» в составе:.....	9
1.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок.....	10
1.2. Очки защитные.....	11
1.3. Насадка, размер S.....	12
1.4. Насадка, размер M.....	13
1.5. Насадка, размер L.....	14
1.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем.....	15
1.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем.....	16
1.8. Тележка аппаратная с блоком питания.....	17
1.9. Шнур сетевой.....	18
1.10. Кабель питания соединительный.....	19
1.11. Адаптер сетевой.....	20
2. Руководство по эксплуатации.....	21
3. Кронштейн в комплекте с насадкой.....	22
4. Световод.....	23
5. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным -.....	24
6. Вставка фиксации держателя насадок.....	25
7. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	26
8. Подставка под держатель насадок.....	27
9. Держатель насадок.....	28
10. Упаковка принадлежности:.....	29
11. Упаковка транспортировочная.....	29
12. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdeosplus» в составе:.....	30
12.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок.....	31
12.2. Очки защитные.....	32
12.3. Насадка, размер S.....	33
12.4. Насадка, размер M.....	34
12.5. Насадка, размер L.....	35
12.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем.....	36
12.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем.....	37

2.8. Тележка аппаратная с блоком питания	38
2.9. Шнур сетевой.....	39
2.10. Кабель питания соединительный.....	40
2.11. Адаптер сетевой.....	41
2.12. Руководство по эксплуатации.....	42
2.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	43
2.14. Световод	44
2.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	45
2.16. Вставка фиксации держателя насадок	46
2.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	47
2.18. Подставка под держатель насадок – 1 шт. (при необходимости).	48
2.19. Держатель насадок – 1шт. (при необходимости).....	49
Принадлежности:.....	50
- Сумка транспортировочная – 1 шт.....	50
3. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdares» в составе:	51
3.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок.....	52
3.2. Очки защитные.....	53
3.3. Насадка, размер S.....	54
3.4. Насадка, размер M	55
3.5. Насадка, размер L.....	56
3.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	57
3.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем.....	58
3.8. Тележка аппаратная с блоком питания	59
3.9. Шнур сетевой.....	60
3.10. Кабель питания соединительный.....	61
3.11. Адаптер сетевой.....	62
3.12. Руководство по эксплуатации.....	63
3.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	64
3.14. Световод	65
3.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	66
3.16. Вставка фиксации держателя насадок – 1 шт. (при необходимости).	67
3.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери – 1 шт. (при необходимости).....	68

3.18. Подставка под держатель насадок	69
3.19. Держатель насадок.....	70
Принадлежности:.....	71
- Сумка транспортировочная.....	71
4. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdhelios» в составе:.....	72
4.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок.....	73
4.2. Очки защитные.....	74
4.3. Насадка, размер S.....	75
4.4. Насадка, размер M	76
4.5. Насадка, размер L.....	77
4.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	78
4.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем	79
4.8. Тележка аппаратная с блоком питания.....	80
4.9. Шнур сетевой.....	81
4.10. Кабель питания соединительный.....	82
4.11. Адаптер сетевой.....	83
4.12. Руководство по эксплуатации.....	84
4.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	85
4.14. Световод	86
4.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	87
4.16. Вставка фиксации держателя насадок.....	88
4.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной вери.....	89
4.18. Подставка под держатель насадок	90
4.19. Держатель насадок.....	91
Принадлежности:.....	92
Сумка транспортировочная.....	92
Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos cryo-thermal» в составе:	93
Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 808 нм со световодом и держателем насадок.....	94
Очки защитные.....	95
Насадка, размер S.....	96
Насадка, размер M	97


5.5. Насадка, размер L.....	98
5.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	99
5.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем	100
5.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см	101
5.9. Шнур сетевой.....	102
5.10. Кабель питания соединительный.....	103
5.11. Кабель управления соединительный.....	104
5.12. Руководство по эксплуатации.....	105
5.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	106
5.14. Световод	107
5.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	108
5.16. Вставка фиксации держателя насадок	109
5.17. Вставка фиксации держателя аппликатора	110
5.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	111
5.19. Контур регулировки температуры аппликатора	112
5.20. Подставка под держатель насадок	113
5.21. Держатель насадок.....	114
5.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см	115
Принадлежности:.....	116
- Сумка транспортировочная.....	116
6. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdeospluscryo-thermal» в составе:	117
6.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок.....	118
6.2. Очки защитные.....	119
6.3. Насадка, размер S.....	120
6.4. Насадка, размер М	121
6.5. Насадка, размер L.....	122
6.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	123
6.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем	124
6.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см	125
6.9. Шнур сетевой.....	126


6.10. Кабель питания соединительный.....	127
6.11. Кабель управления соединительный.....	128
6.12. Руководство по эксплуатации.....	129
6.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	130
6.14. Световод	131
6.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	132
6.16. Вставка фиксации держателя насадок.....	133
6.17. Вставка фиксации держателя аппликатора	134
6.18. Разъем подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	135
6.19. Контур регулировки температуры аппликатора	136
6.20. Подставка под держатель насадок	137
6.21. Держатель насадок.....	138
6.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см	139
Принадлежности:.....	140
- Сумка транспортировочная.....	140
7. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный«qmdarescryo-thermal» в составе:	141
7.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок.....	142
7.2. Очки защитные.....	143
7.3. Насадка, размер S.....	144
7.4. Насадка, размер М	145
7.5. Насадка, размер L.....	146
7.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	147
7.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем.....	148
7.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см	149
7.9. Шнур сетевой.....	150
7.10. Кабель питания соединительный.....	151
7.11. Кабель управления соединительный.....	152
7.12. Руководство по эксплуатации.....	153
7.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	154
7.14. Световод	155
7.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	156

7.16. Вставка фиксации держателя насадок	157
7.17. Вставка фиксации держателя аппликатора	158
7.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	159
7.19. Контур регулировки температуры аппликатора	160
7.20. Подставка под держатель насадок	161
7.21. Держатель насадок.....	162
7.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см.....	163
Принадлежности:.....	164
- Сумка транспортировочная.....	164
8. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdhelioscryo-thermal» в составе:	165
8.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины волн: 1064 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок.....	166
8.2. Очки защитные.....	167
8.3. Насадка, размер S.....	168
8.4. Насадка, размер M	169
8.5. Насадка, размер L.....	170
8.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем	171
8.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем	172
8.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см	173
8.9. Шнур сетевой.....	174
8.10. Кабель питания соединительный.....	175
8.11. Кабель управления соединительный.....	176
8.12. Руководство по эксплуатации.....	177
8.13. Кронштейн в комплекте с насадкой	178
8.14. Световод	179
8.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным.....	180
8.16. Вставка фиксации держателя насадок.....	181
8.17. Вставка фиксации держателя аппликатора	182
8.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери.....	183
8.19. Контур регулировки температуры аппликатора	184
8.20. Подставка под держатель насадок	185

8.21. Держатель насадок.....	186
8.22. Аппликатор контактный диаметром 6 см.....	187
Принадлежности:.....	188
- Сумка транспортировочная.....	188
9. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd cryo-thermal» в составе:	189
9.1. Основной блок управления	190
9.2. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см	191
9.4. Кабель питания соединительный	193
9.5. Кабель управления соединительный	194
9.6. Руководство по эксплуатации	195
9.7. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным	196
9.8. Вставка фиксации держателя аппликатора	197
9.9. Контур регулировки температуры аппликатора	198
9.10. Аппликатор контактный диаметром 6 см	199
Принадлежности:.....	200
- Сумка транспортировочная.....	200


1. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos» в составе:

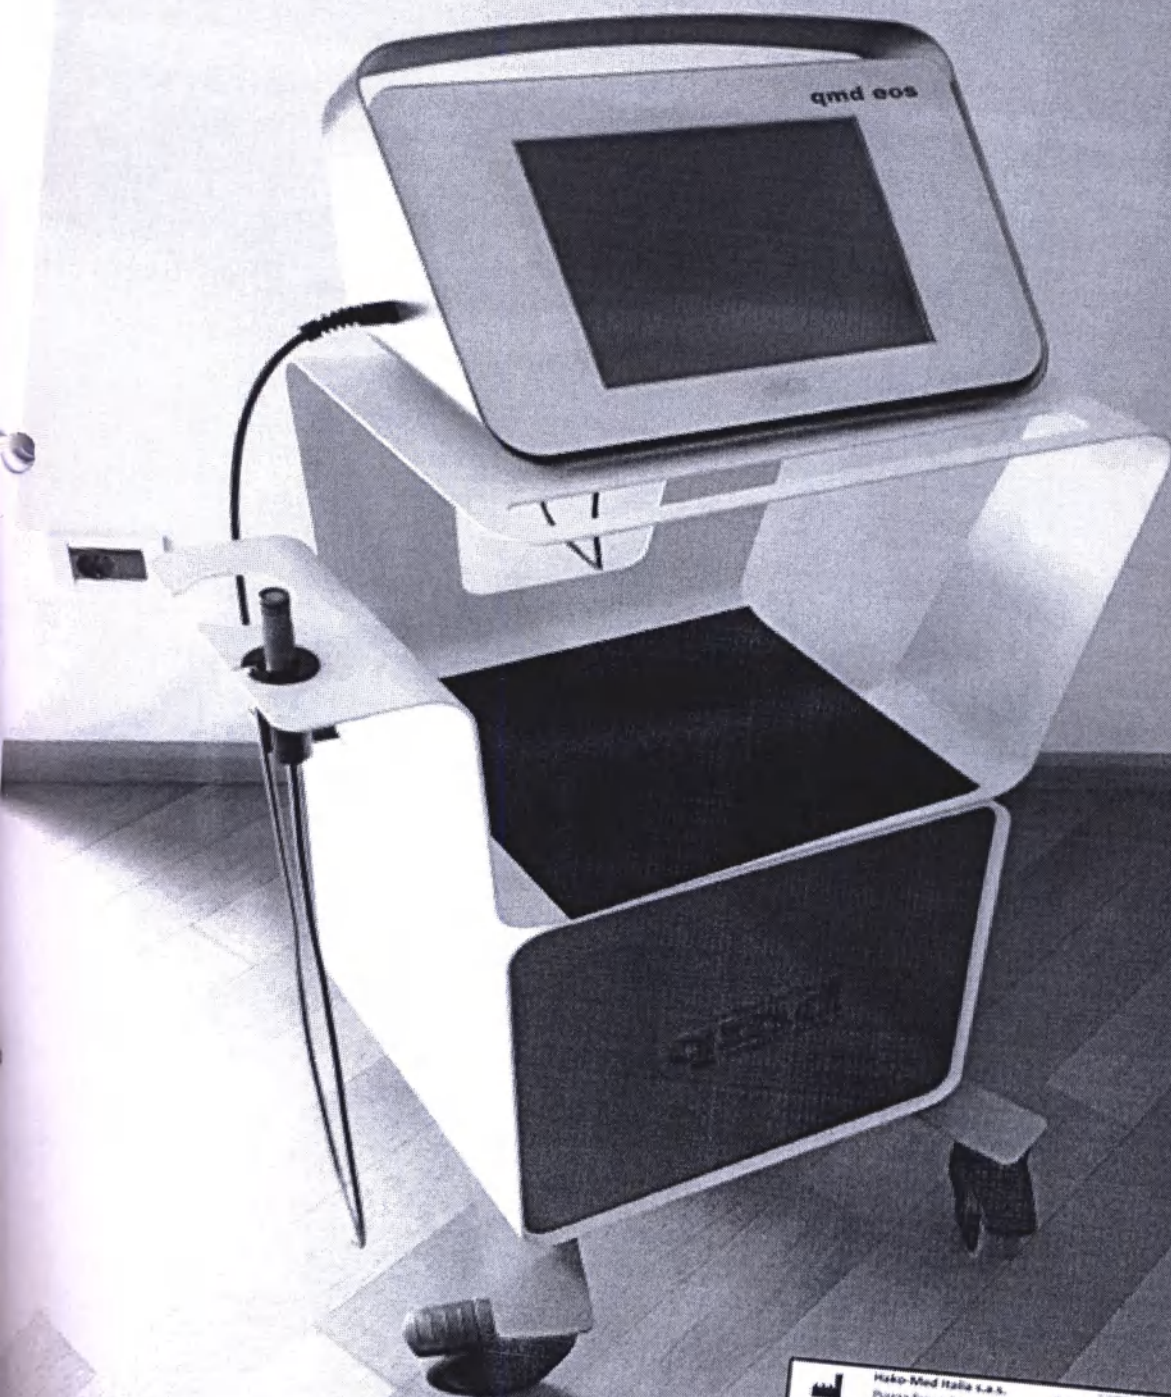


 HAKOMED Italia Hako-Med Italia s.a.s. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (BZ) - Italy	
REF	☒ qmd eos ☐ qmd eos plus ☐ qmd are ☐ qmd helios
S/N	
12V - 15A max	 follow instructions for use
	

1.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок.




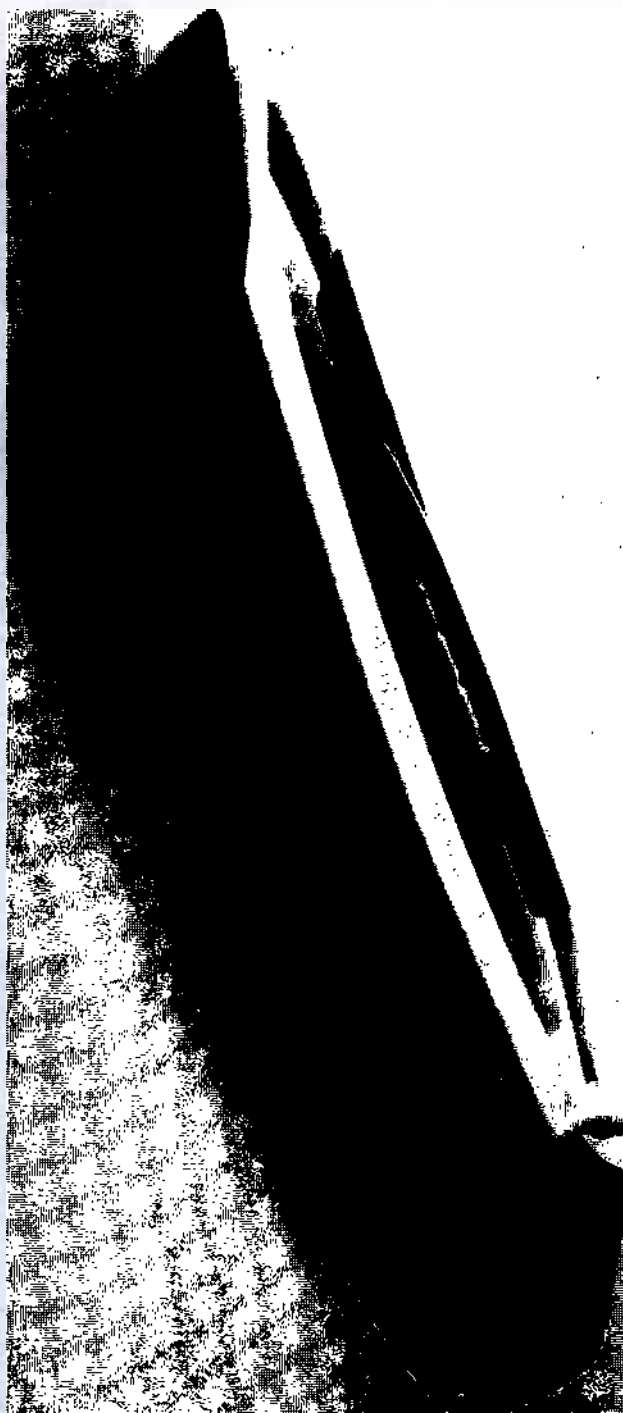


1.3. Насадка, размер S

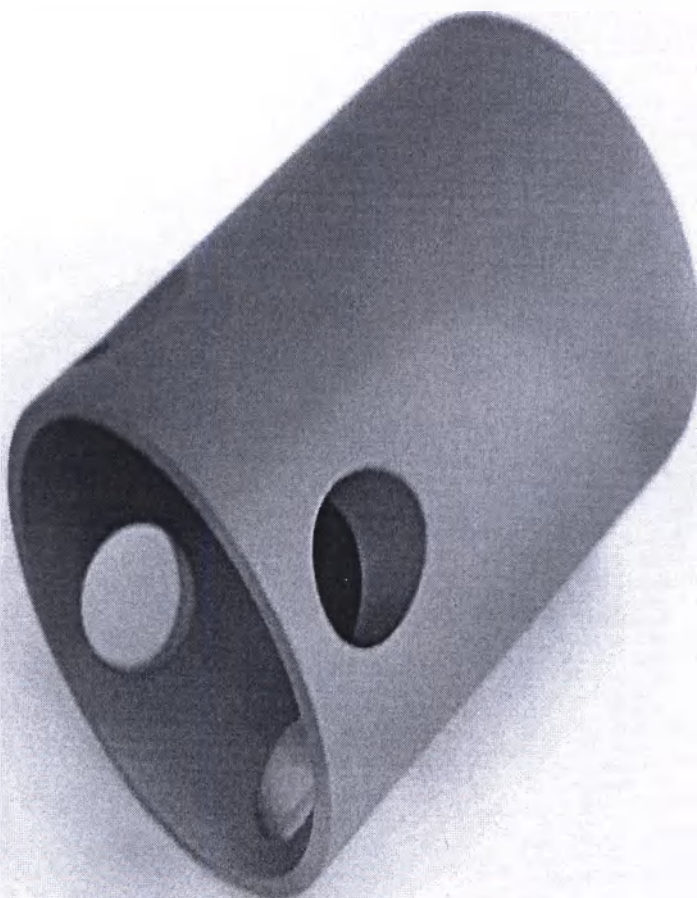


1.4. Насадка, размер М

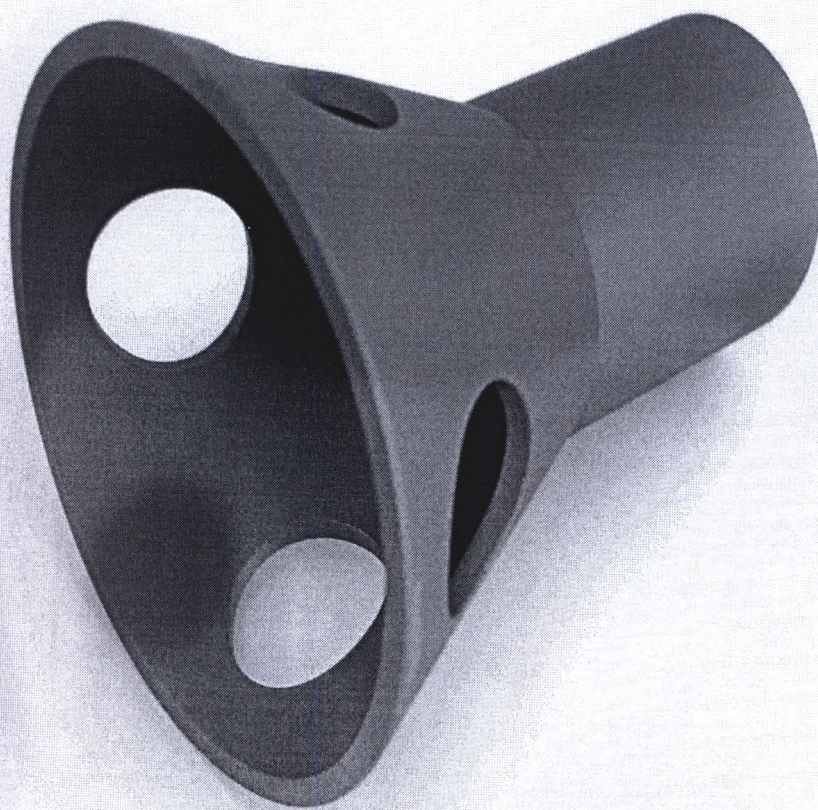

1.5. Насадка, размер L

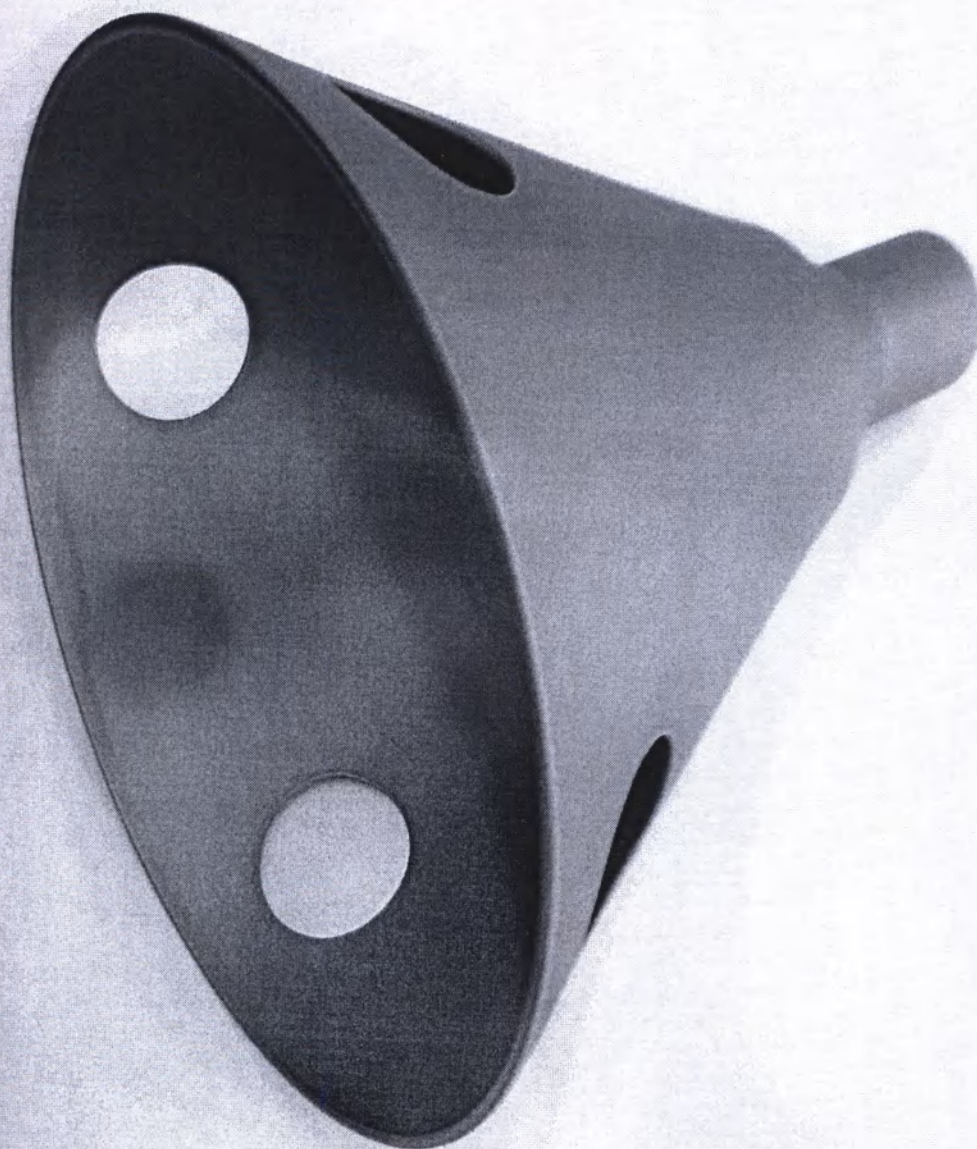



1.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем

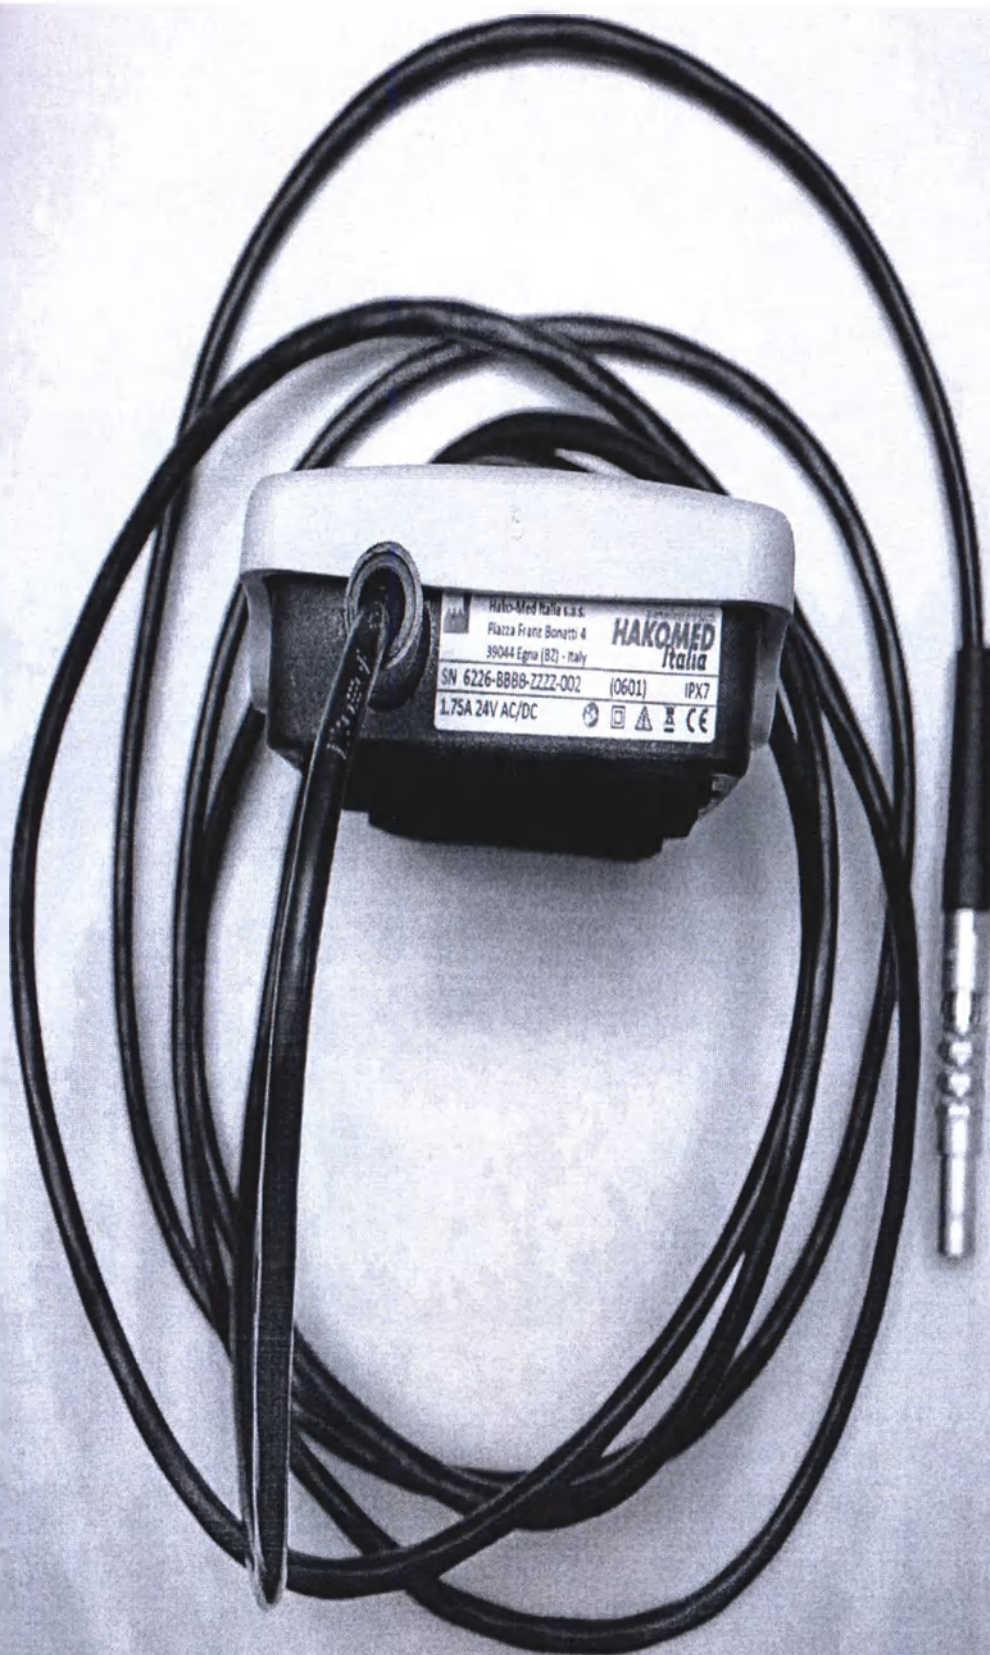



8. Тележка аппаратная с блоком питания

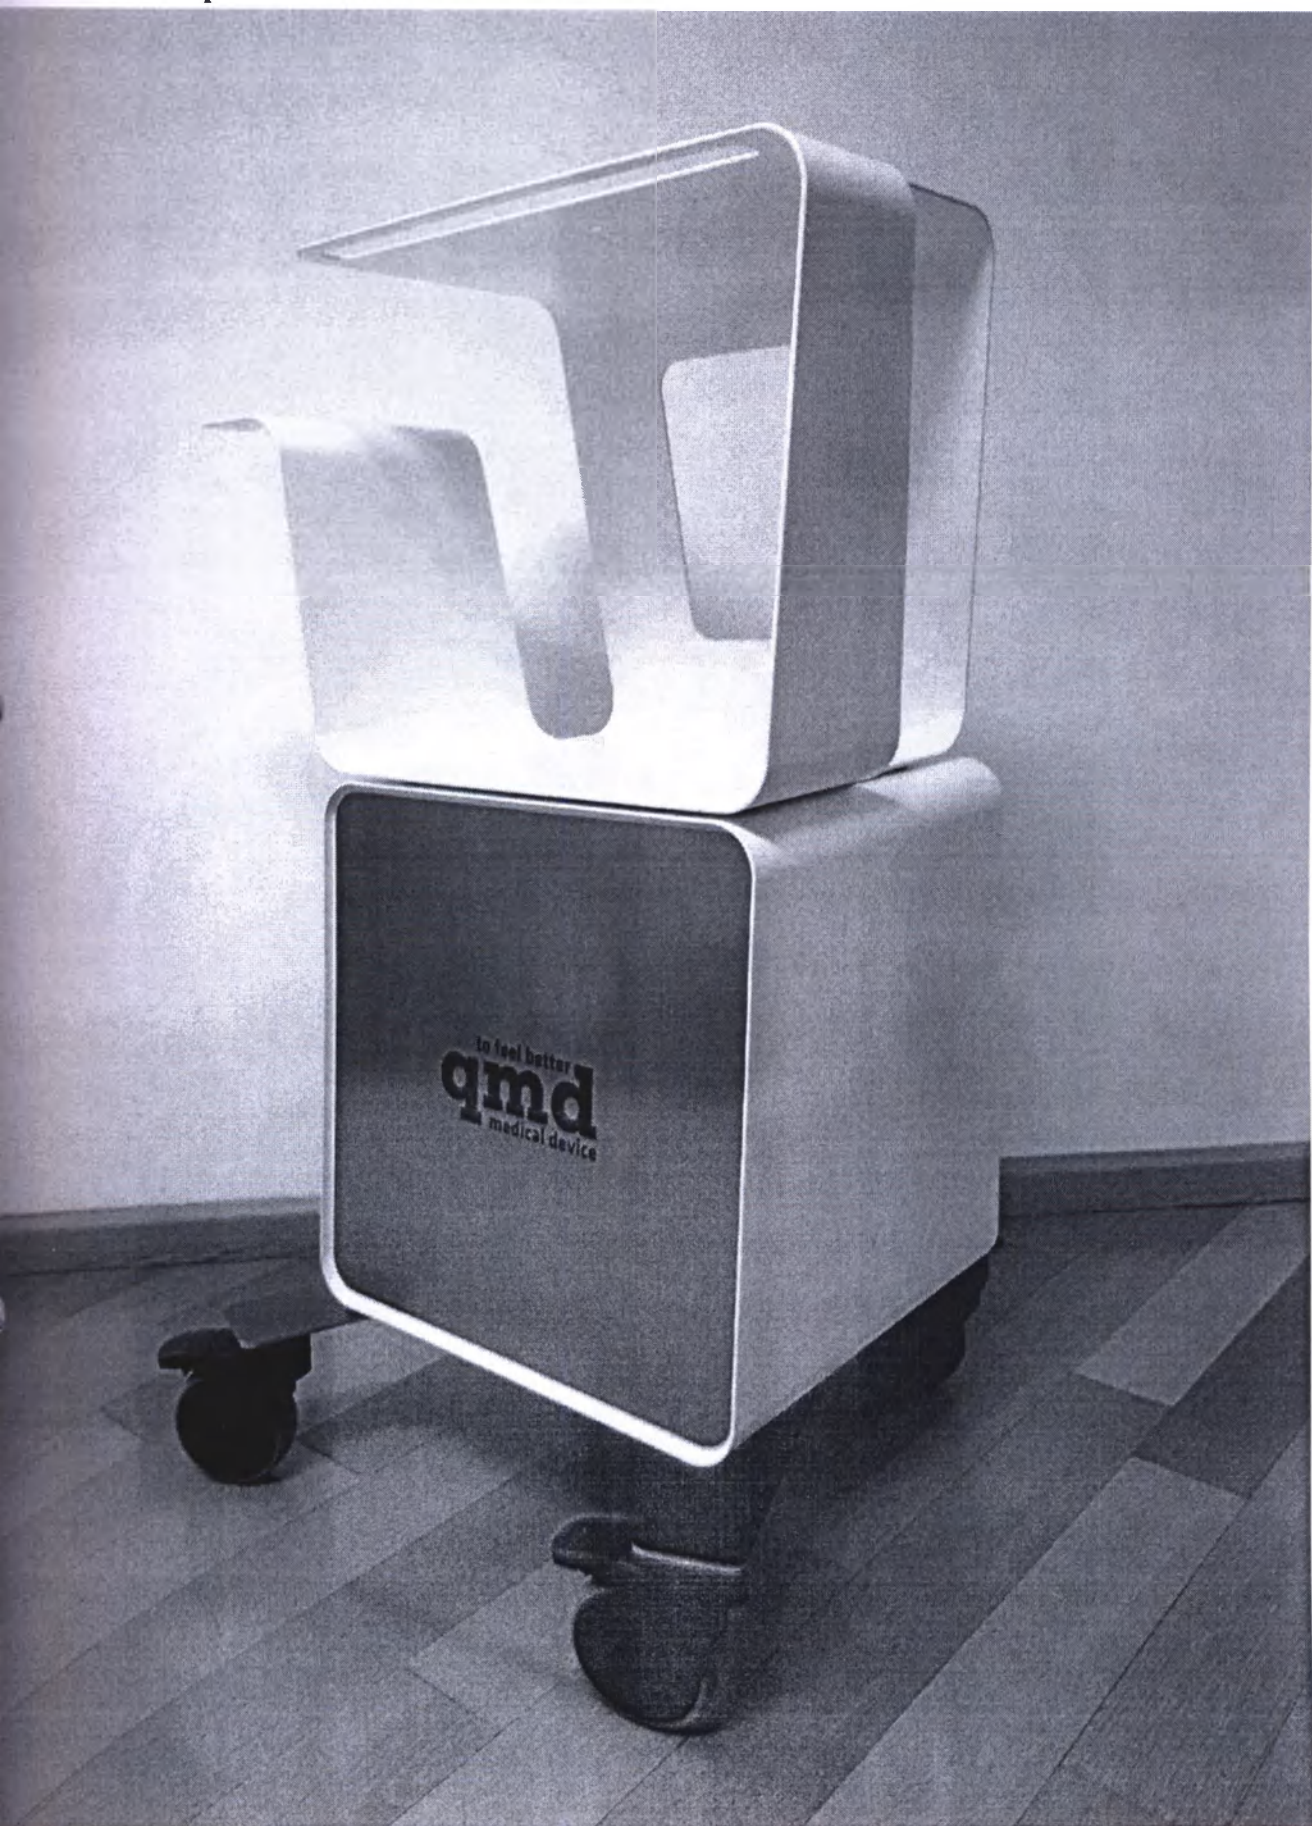

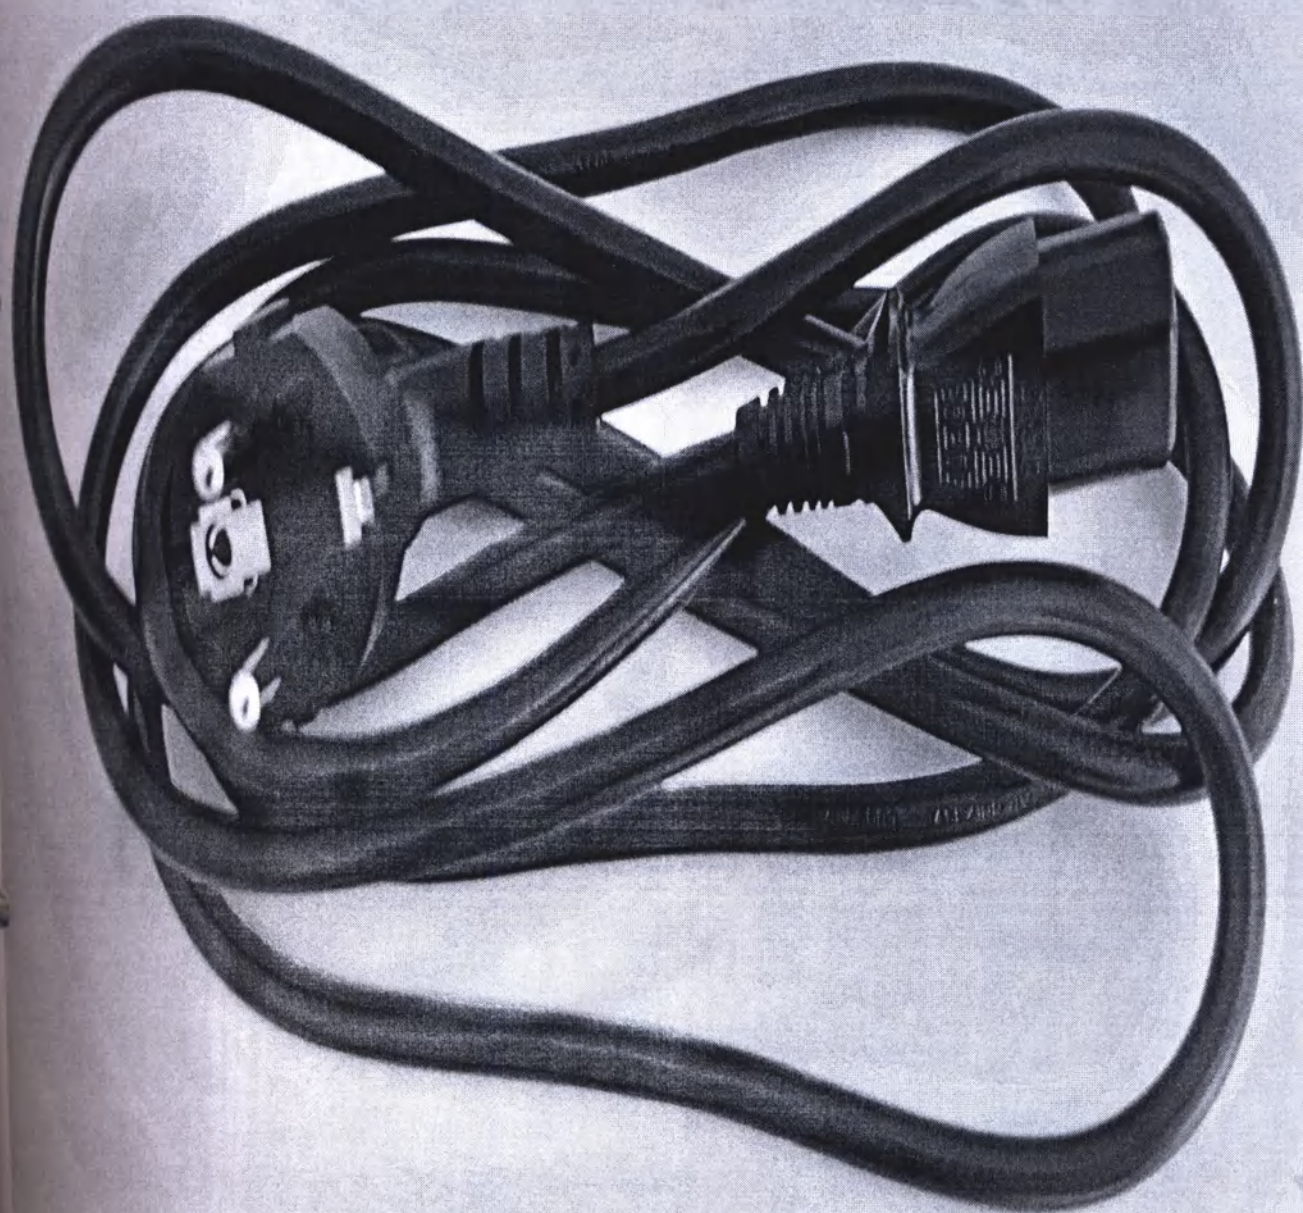

1.10. Кабель питания соединительный







Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:


qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

1.13. Кронштейн в комплекте с насадкой

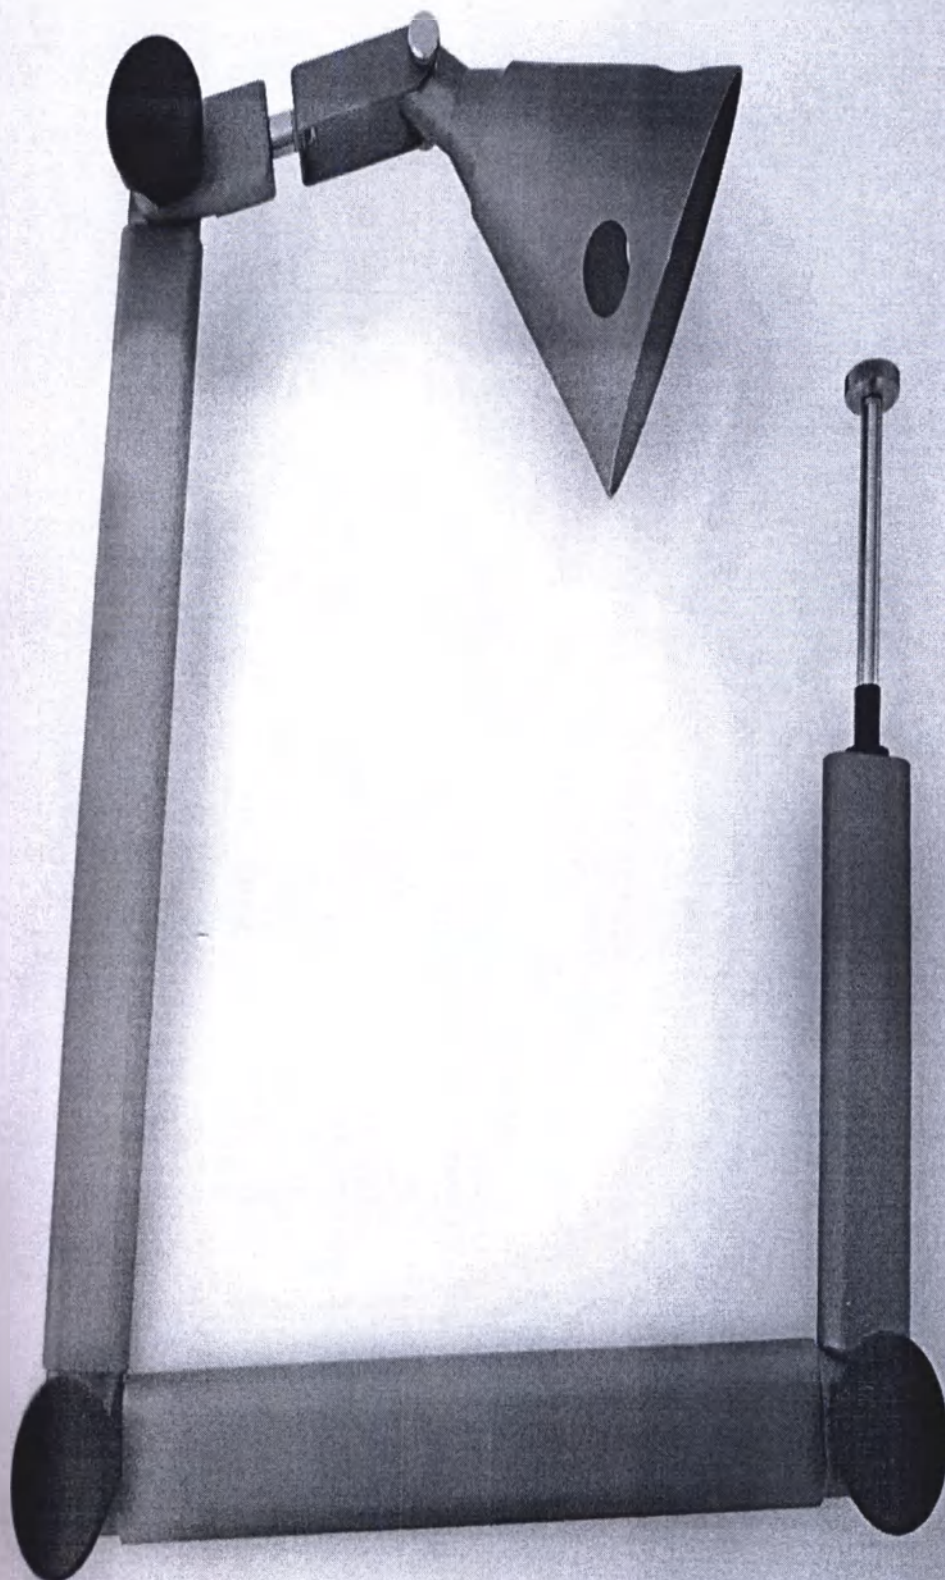


1.14. Световод

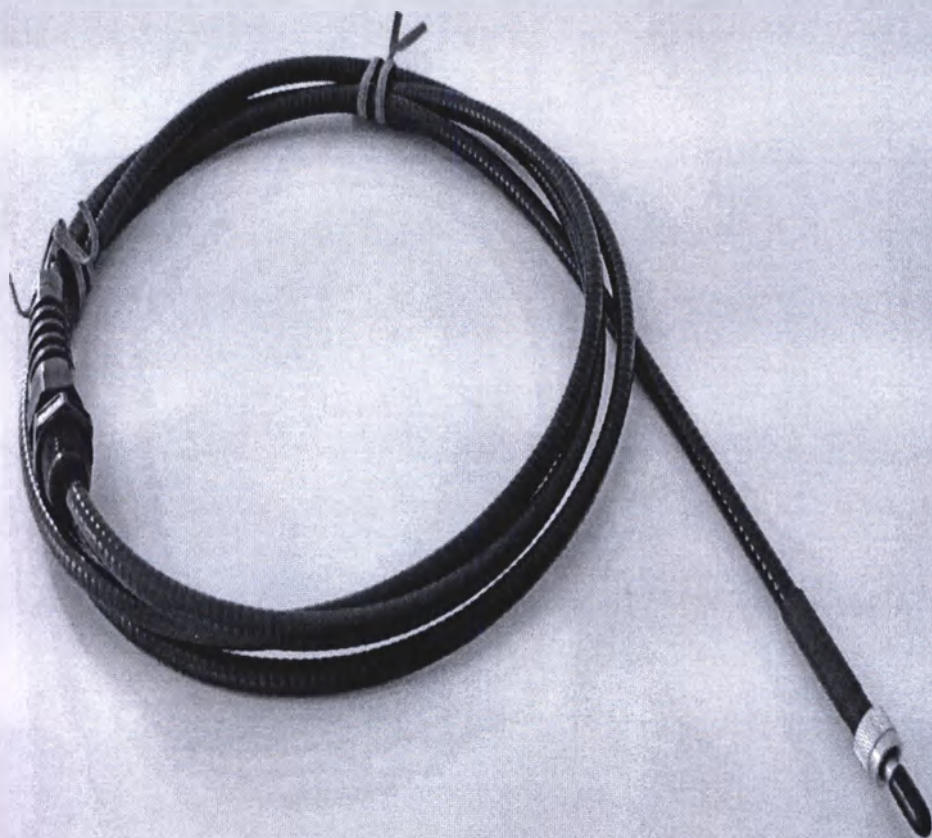

1.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным –




1.16. Вставка фиксации держателя насадок

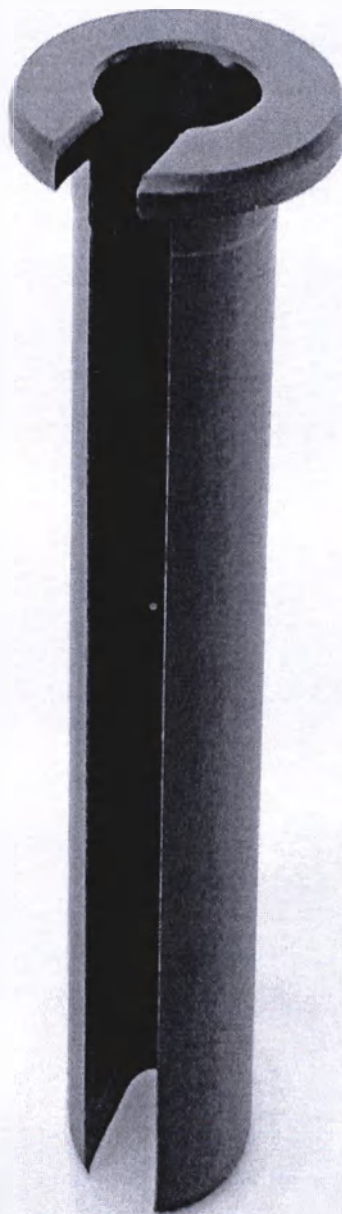

1.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери



1.18. Подставка под держатель насадок

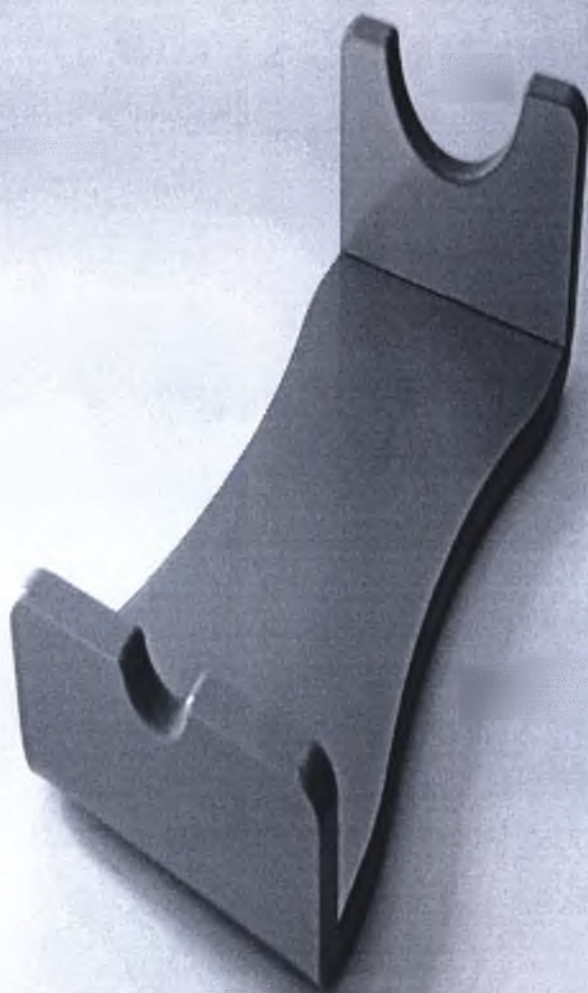



Принадлежности:

- Сумка транспортировочная




2. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdeosplus» в составе:




2.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок



2.2. Очки защитные

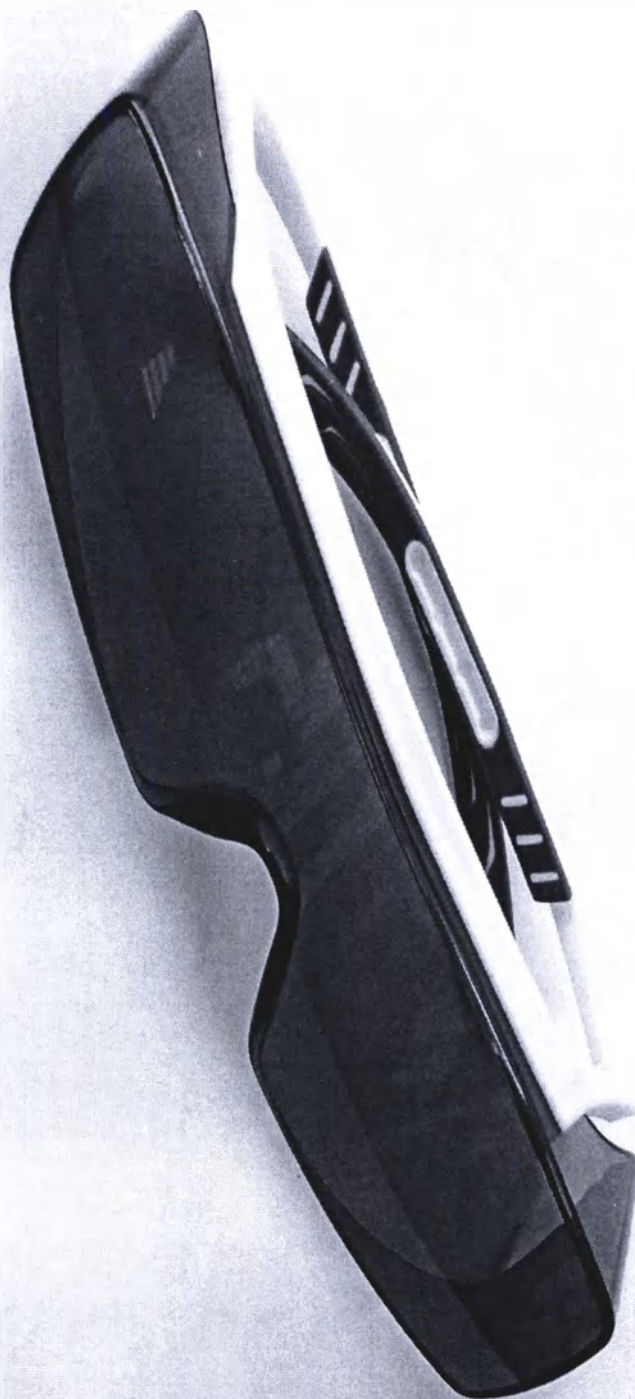


2.3. Насадка, размер S

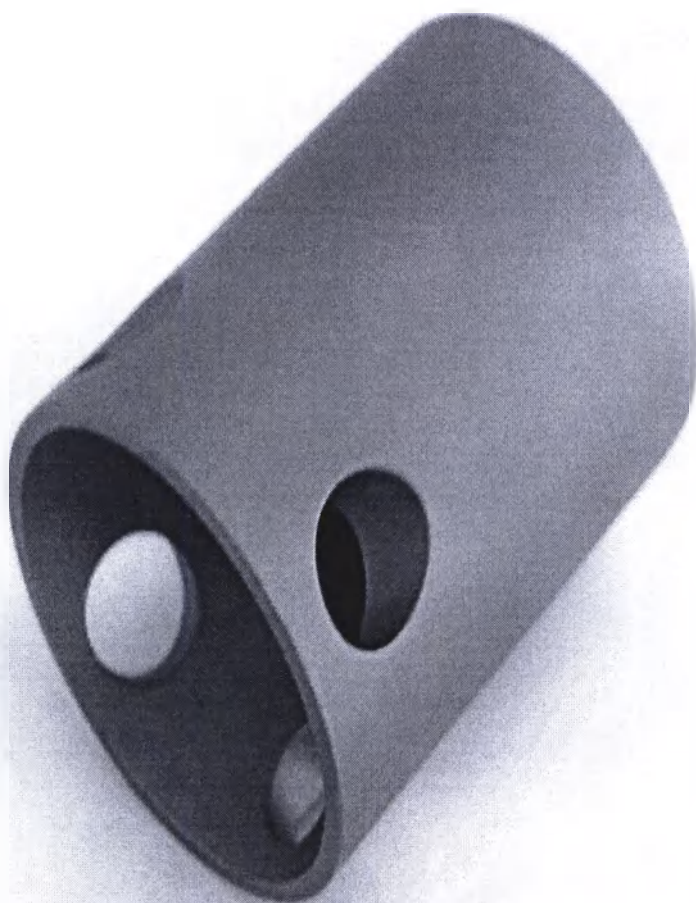


2.4. Насадка, размер М



2.5. Насадка, размер L

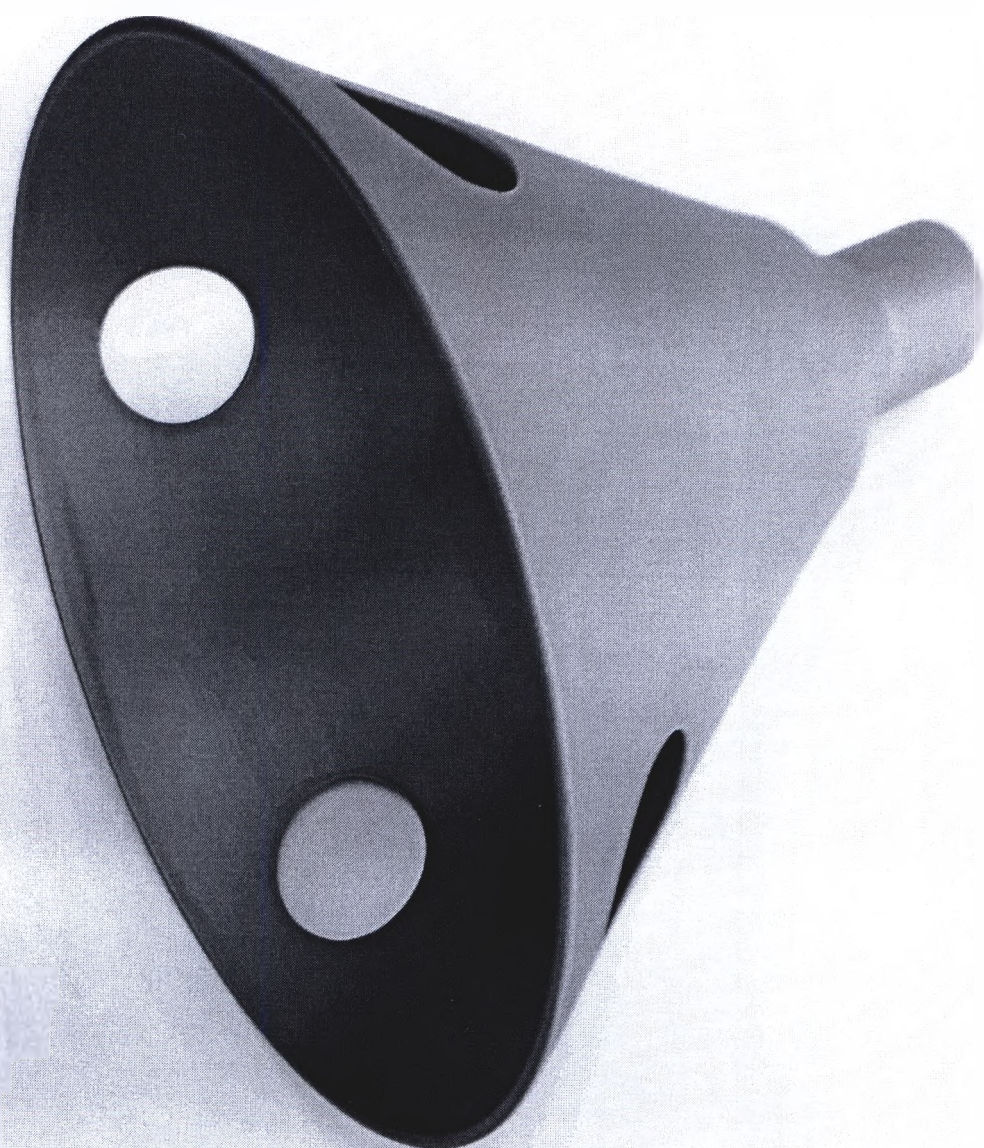

2.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем

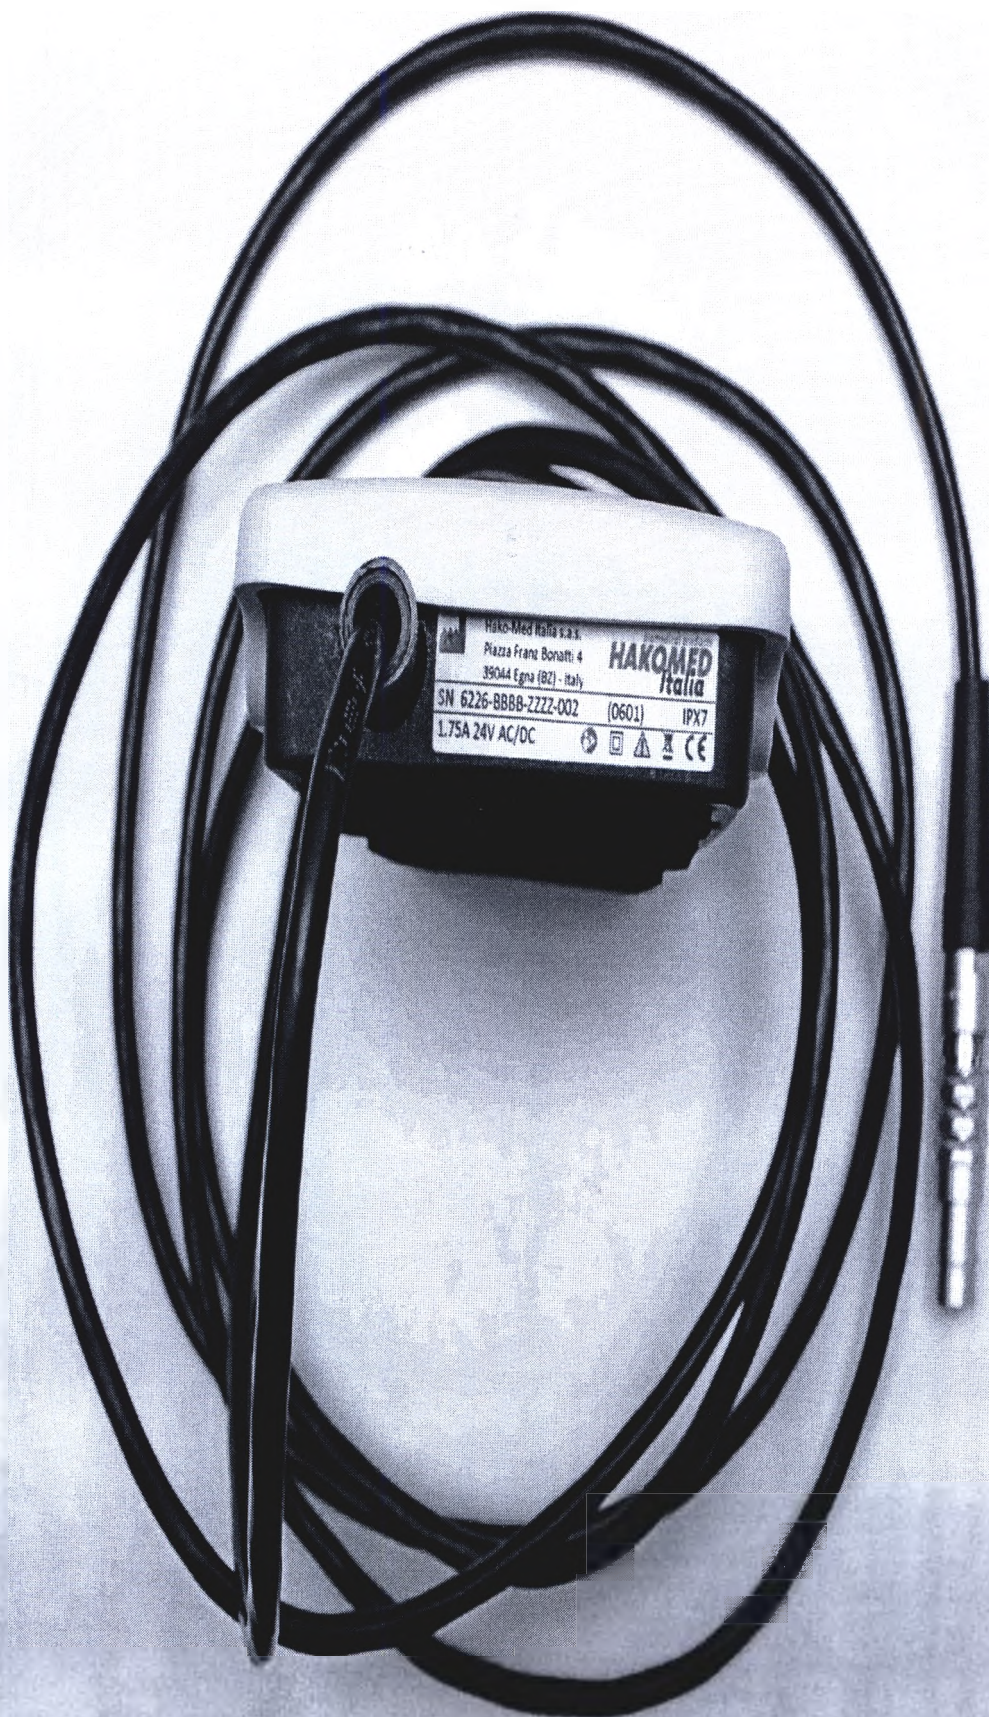



2.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем



2.8. Тележка аппаратная с блоком питания .



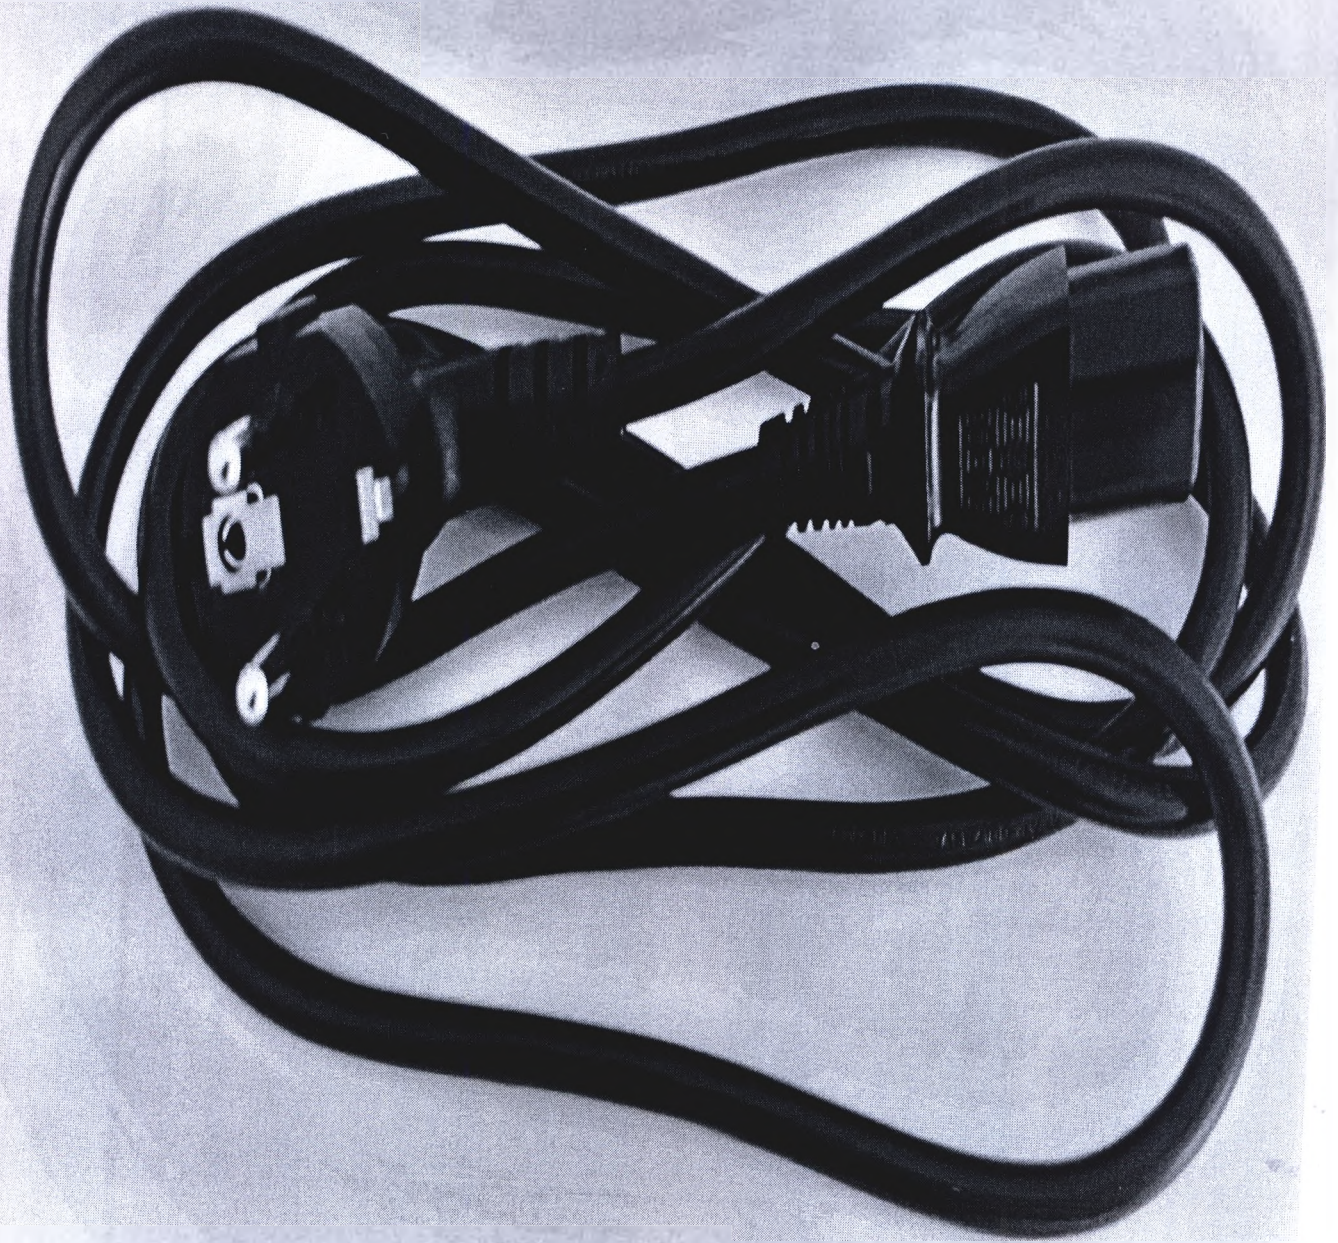

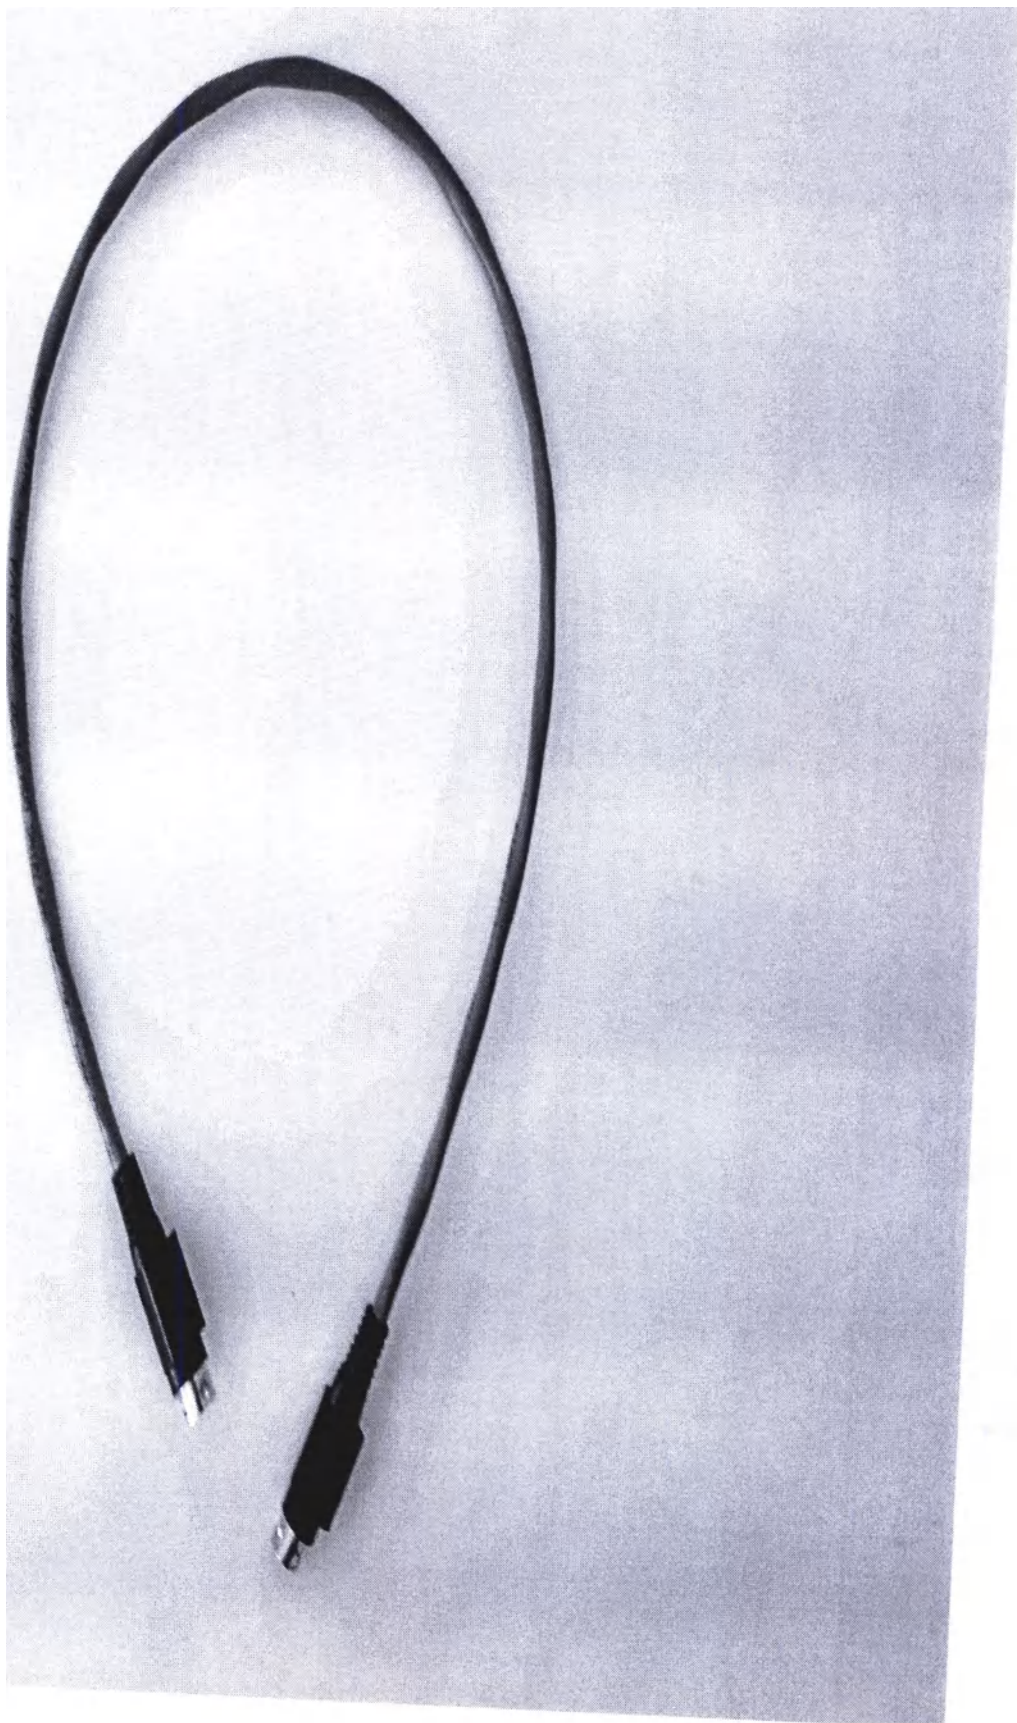





Руководство по эксплуатации





Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

2.13. Кронштейн в комплекте с насадкой

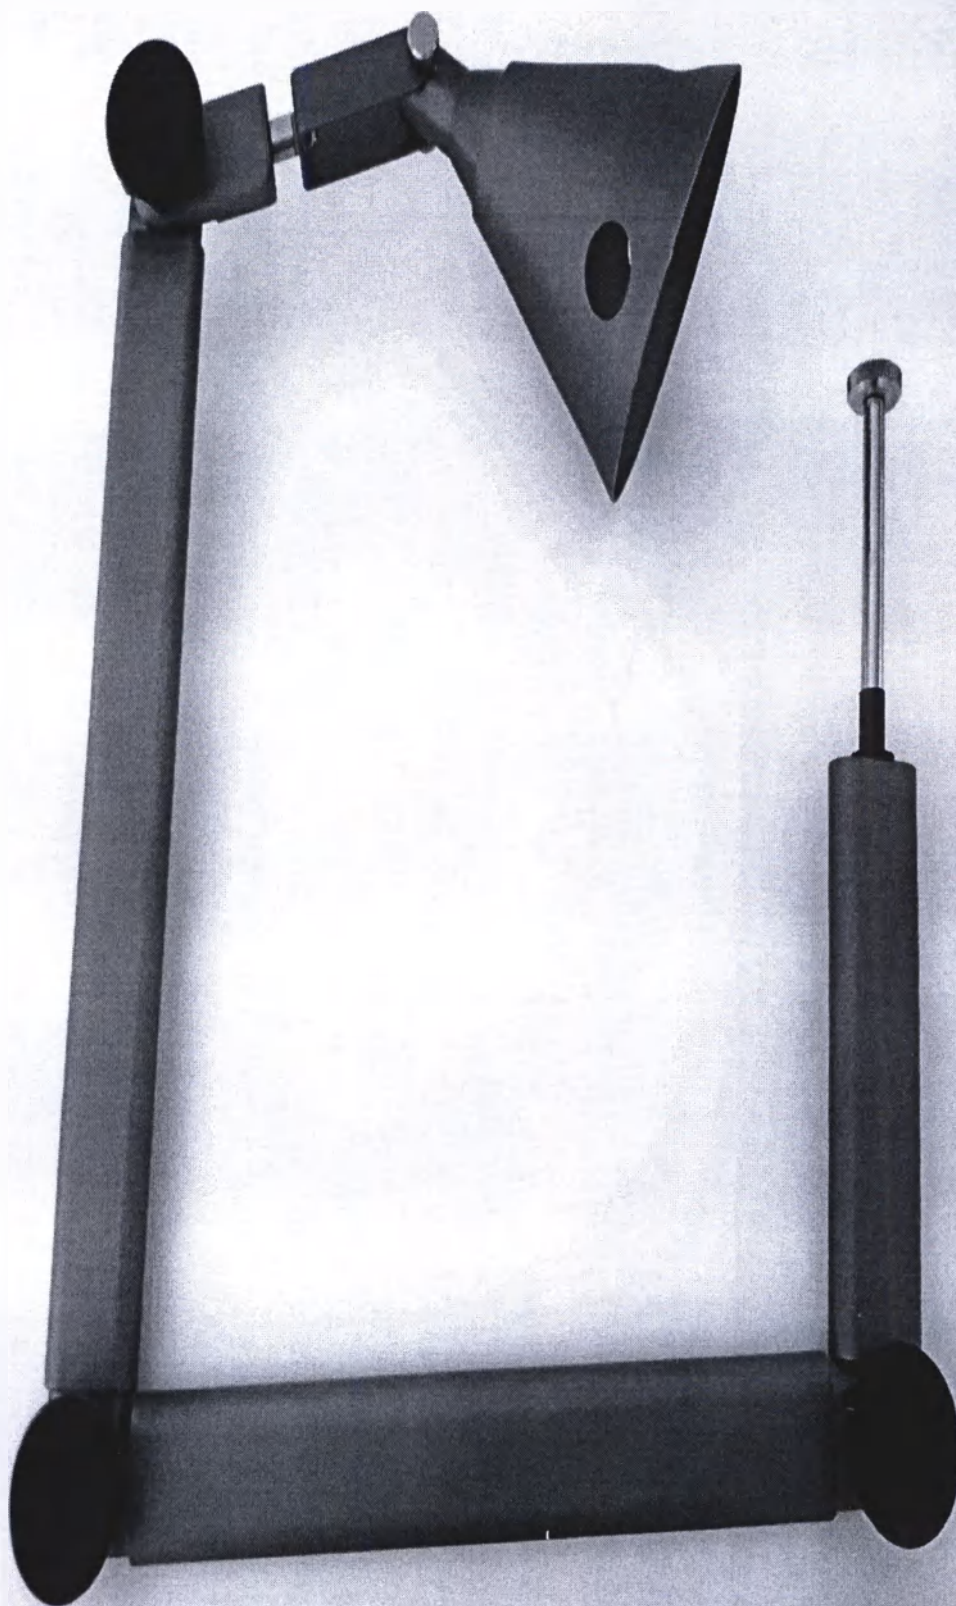


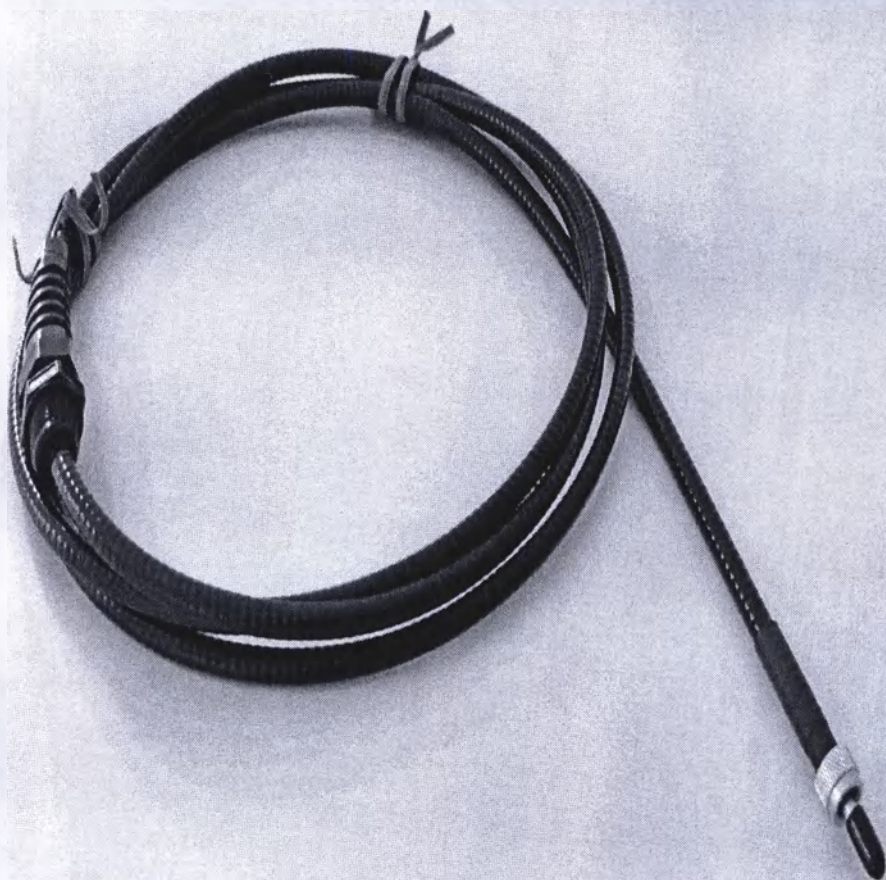

2.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным




2.16. Вставка фиксации держателя насадок

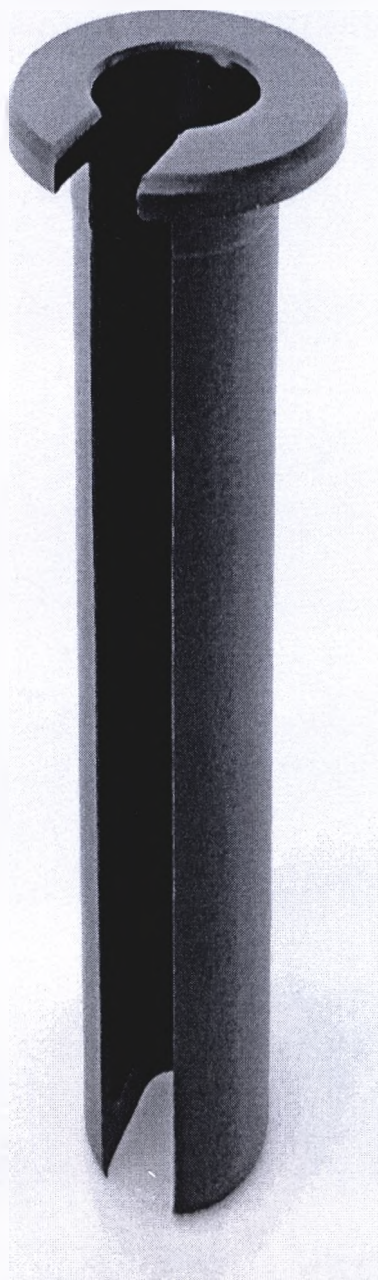

2.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери



2.18. Подставка под держатель насадок – 1 шт. (при необходимости).

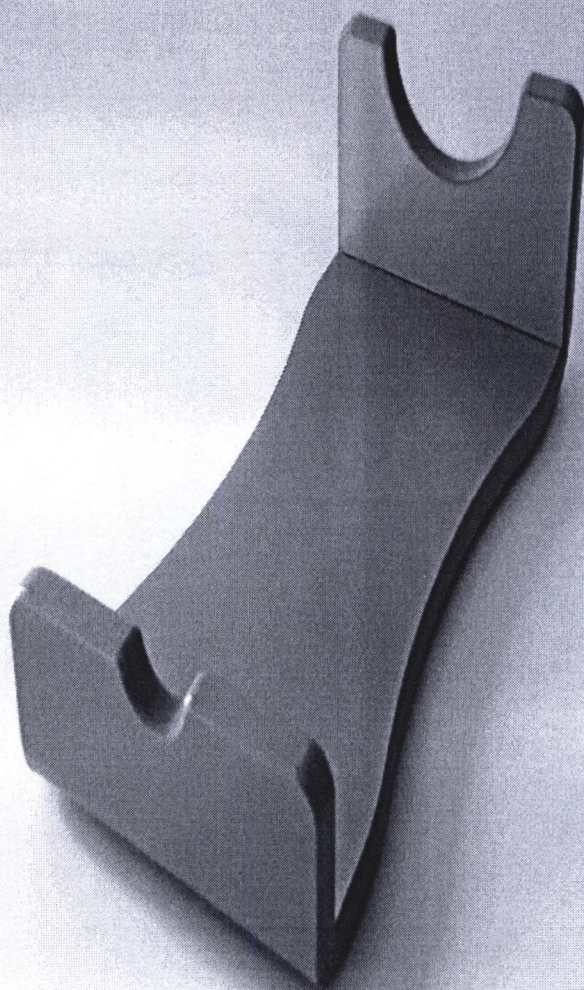

2.19. Держатель насадок – 1 шт. (при необходимости).



Сумка транспортировочная – 1 шт.







HAKOMED Italia s.r.l. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (BZ) - Italy	
REF	☐ qmd eos ☒ qmd ares ☐ qmd eos plus ☐ qmd helios
SN	
12V - 15A max	follow instructions for use

3.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок



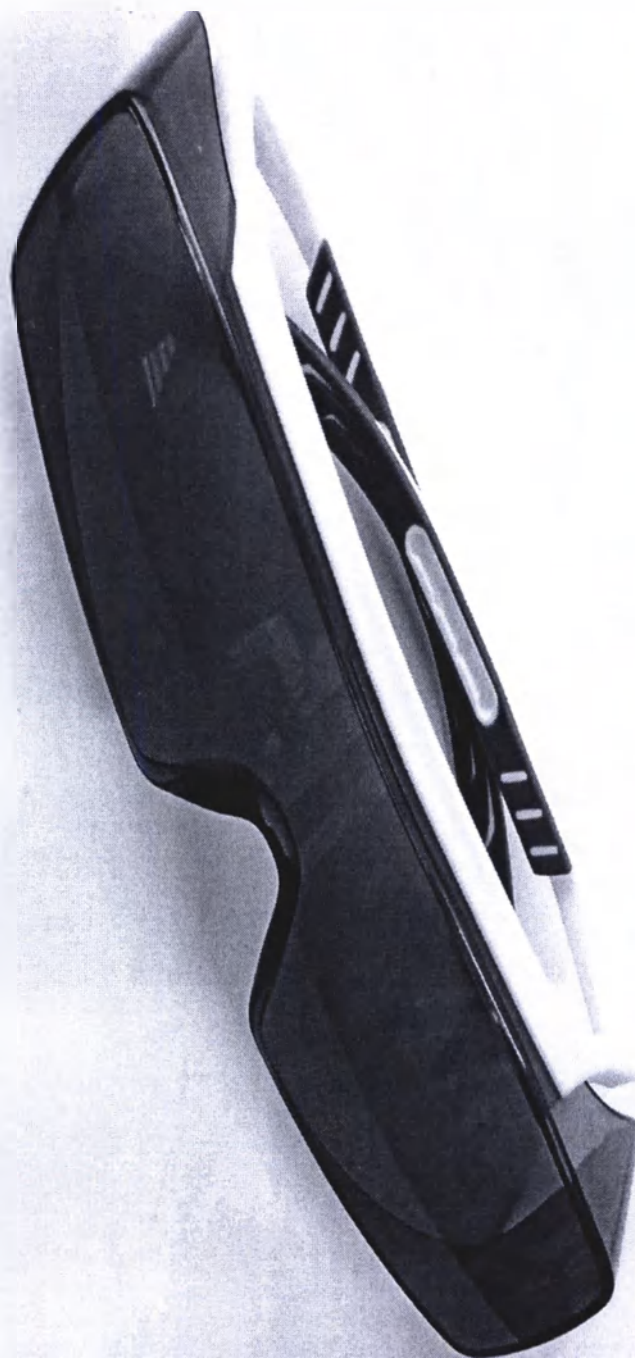


3.3. Насадка, размер S

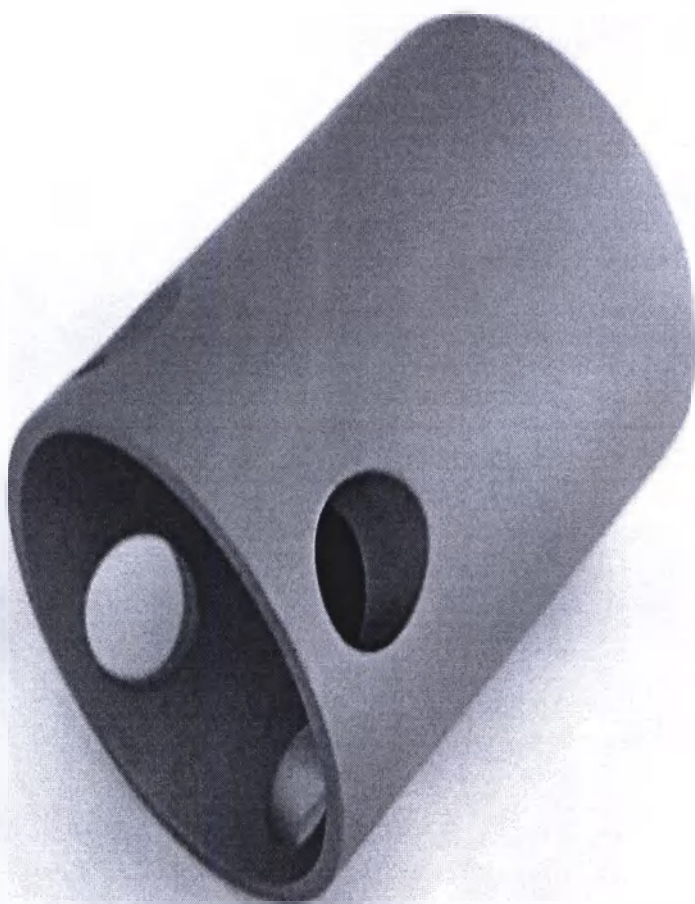

3.4. Насадка, размер М



3.5. Насадка, размер L

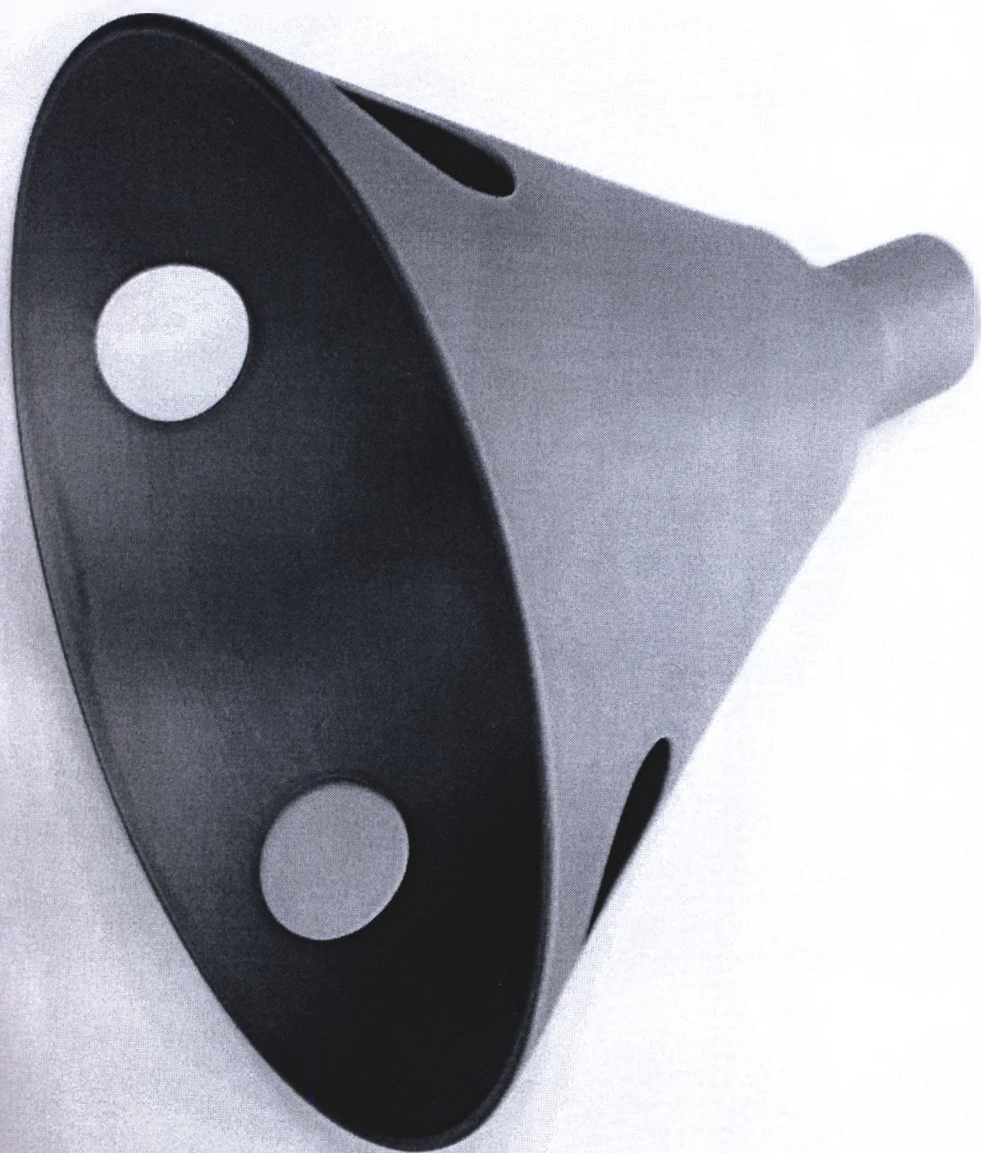

3.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем






3.8. Тележка аппаратная с блоком питания



3.9. Шнур сетевой



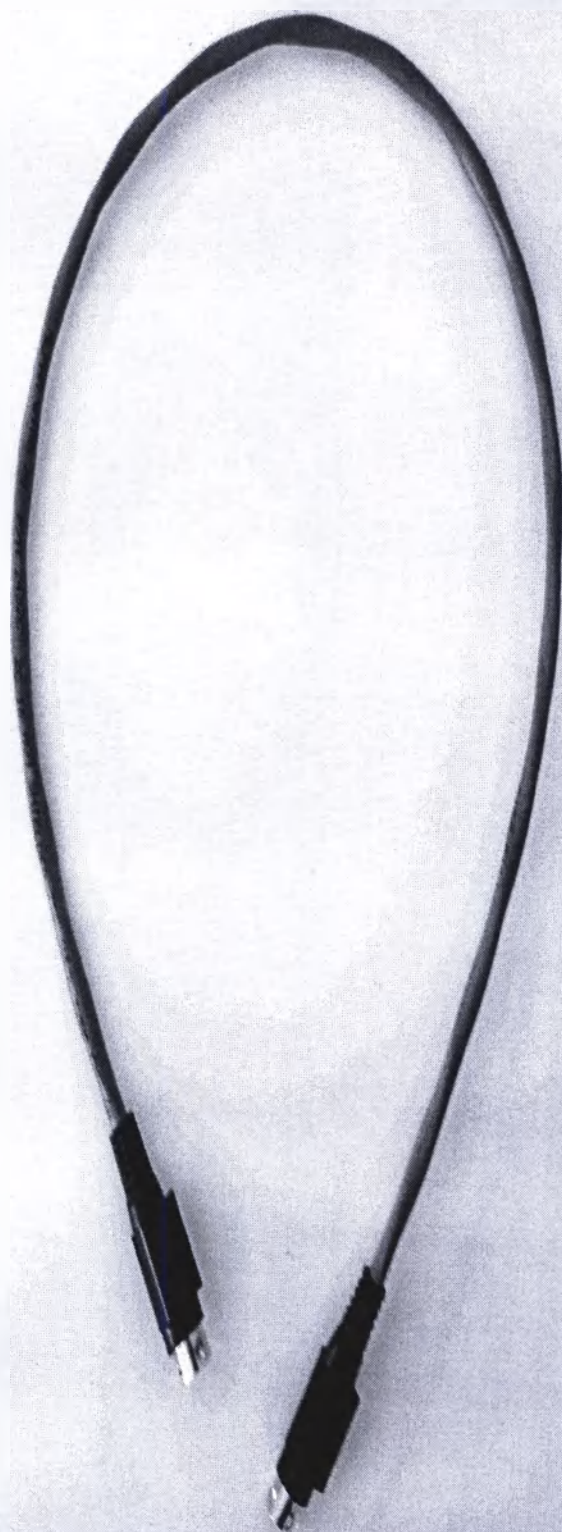






Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

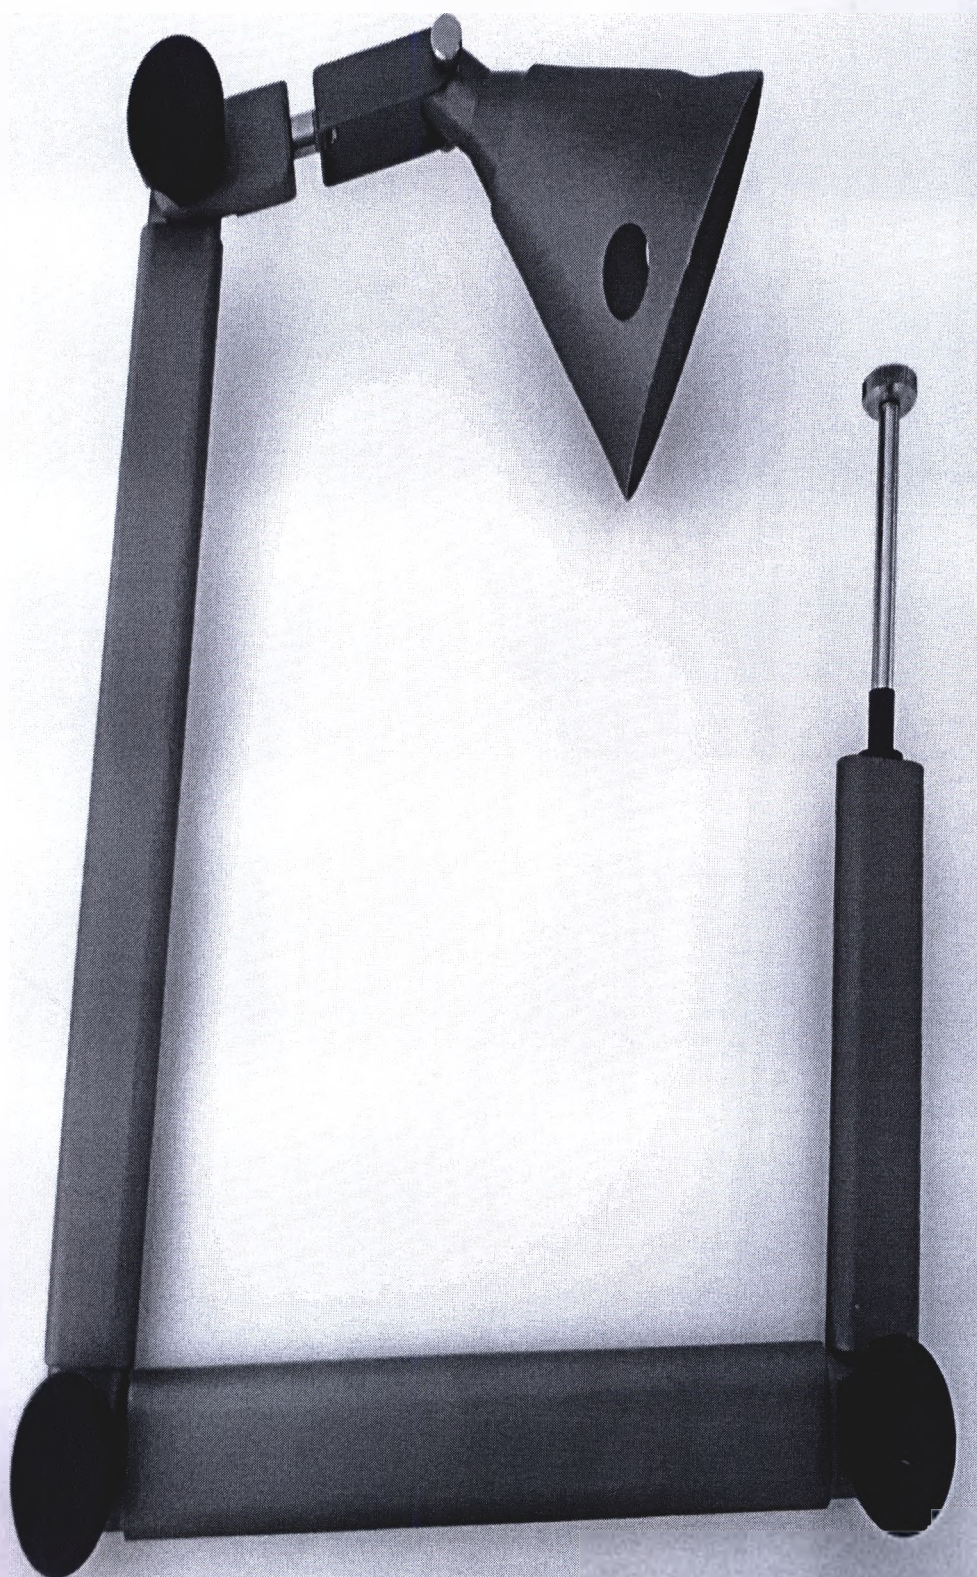


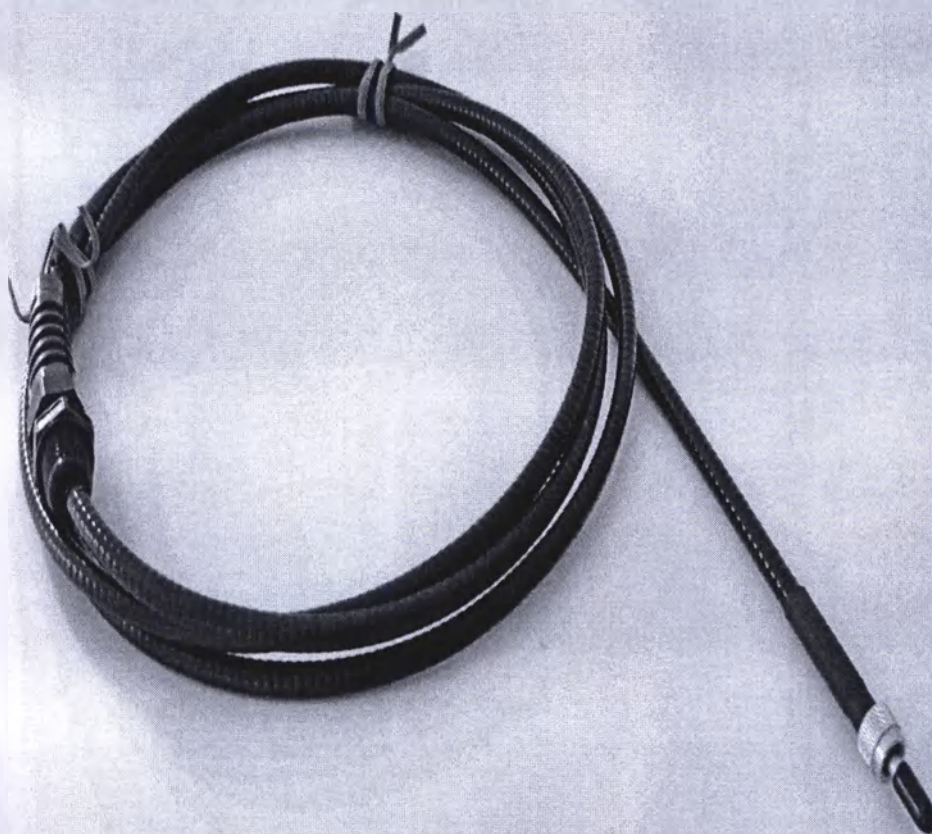

3.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным




3.16. Вставка фиксации держателя насадок – 1 шт. (при необходимости).

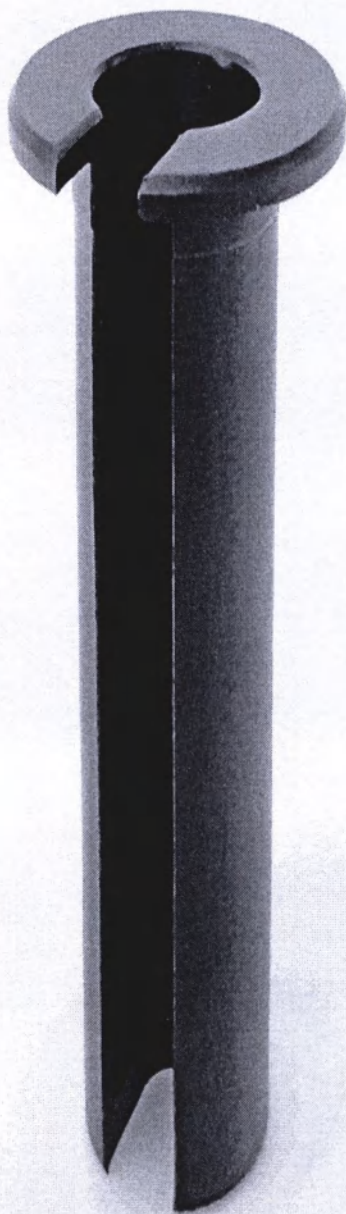


3.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери – 1 шт. (при необходимости).



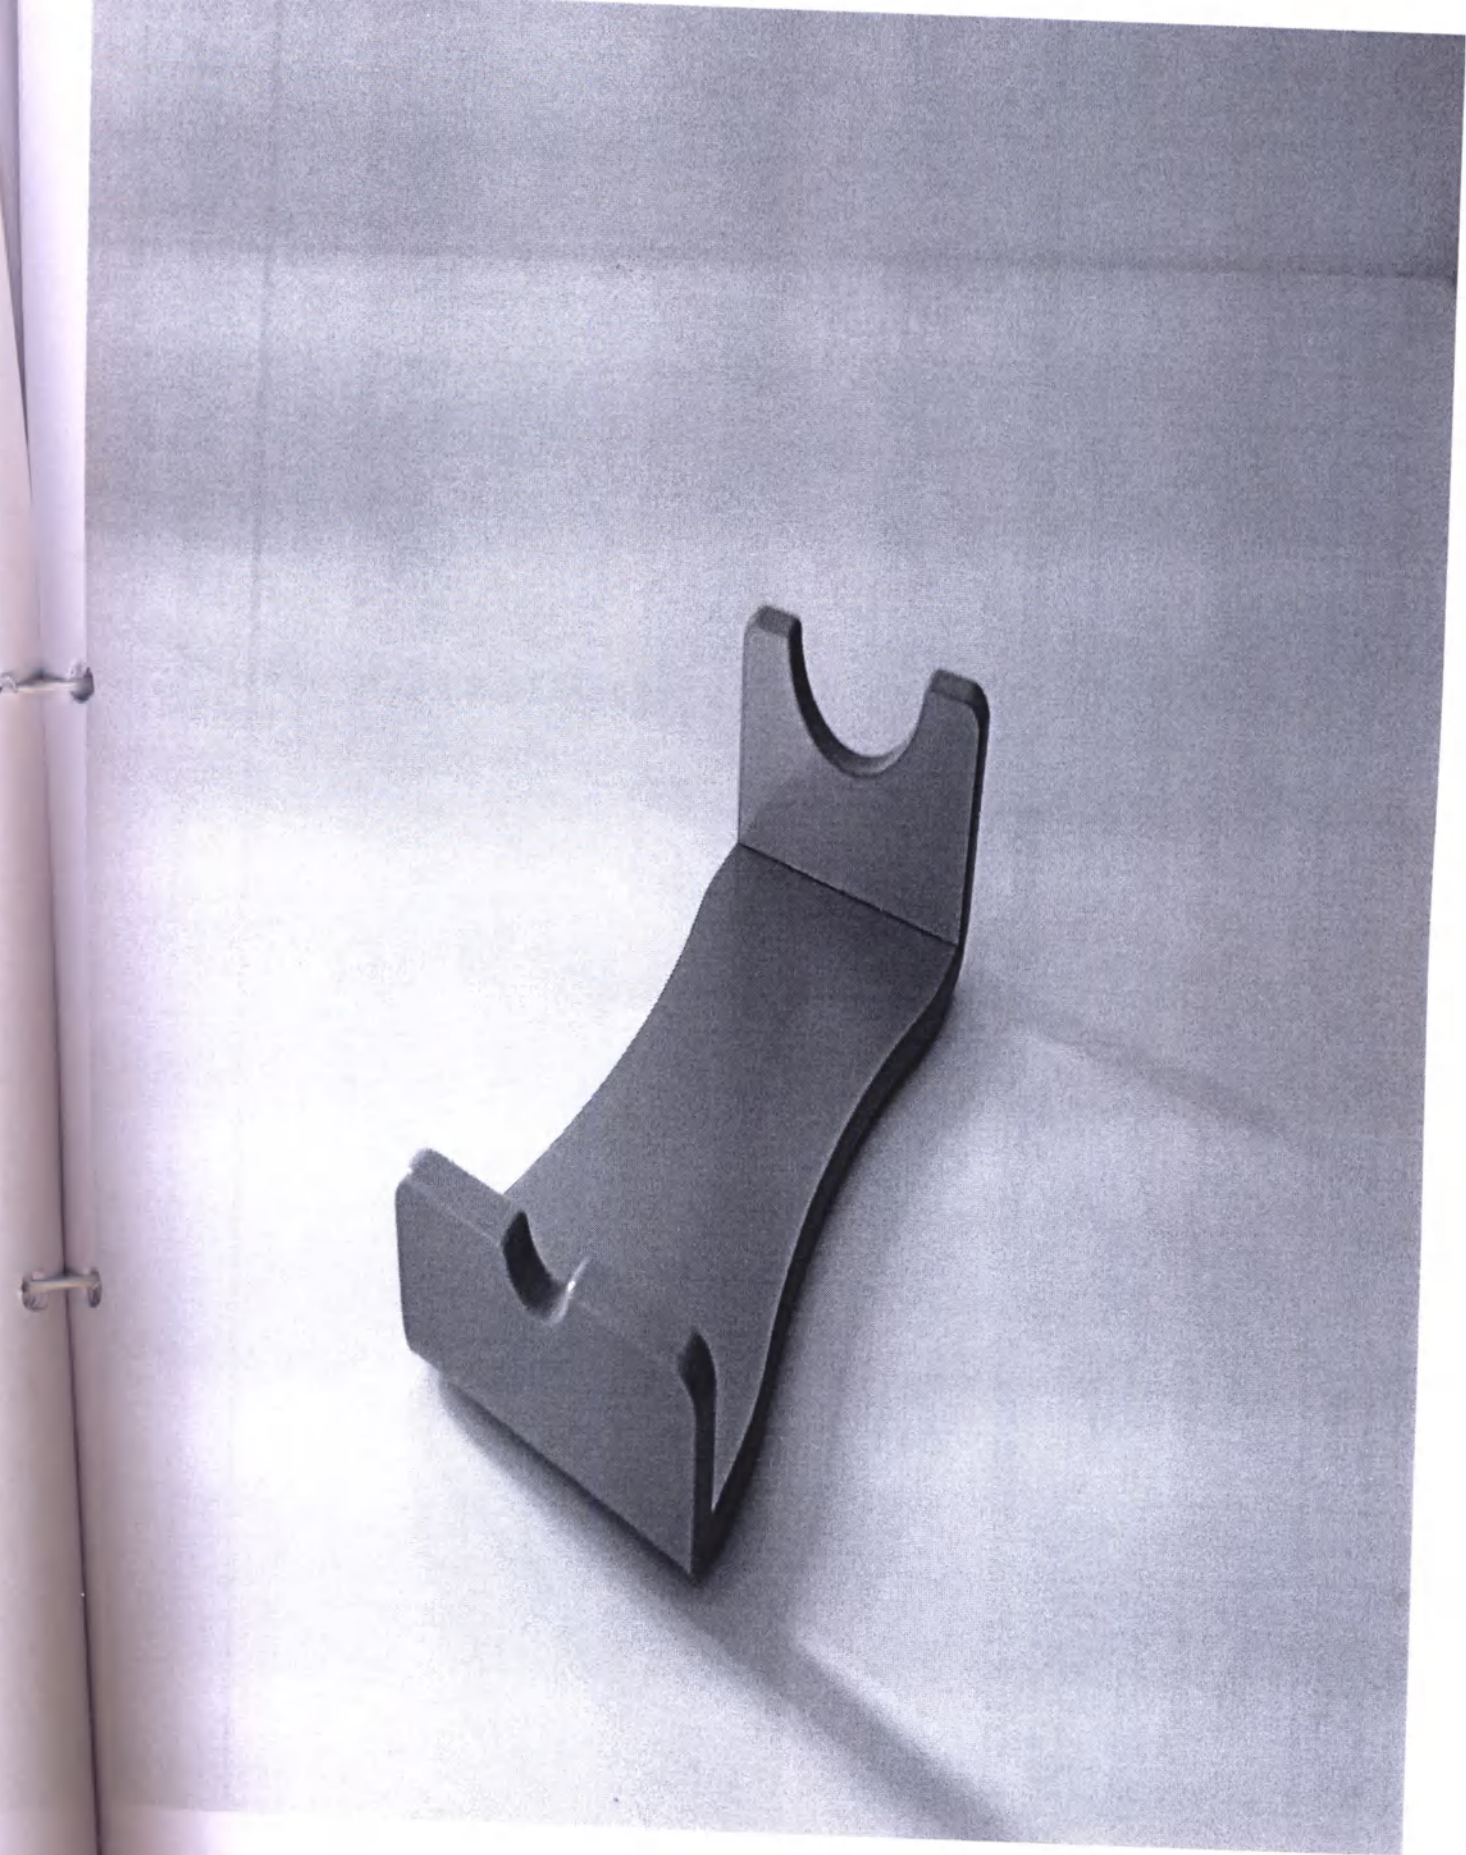






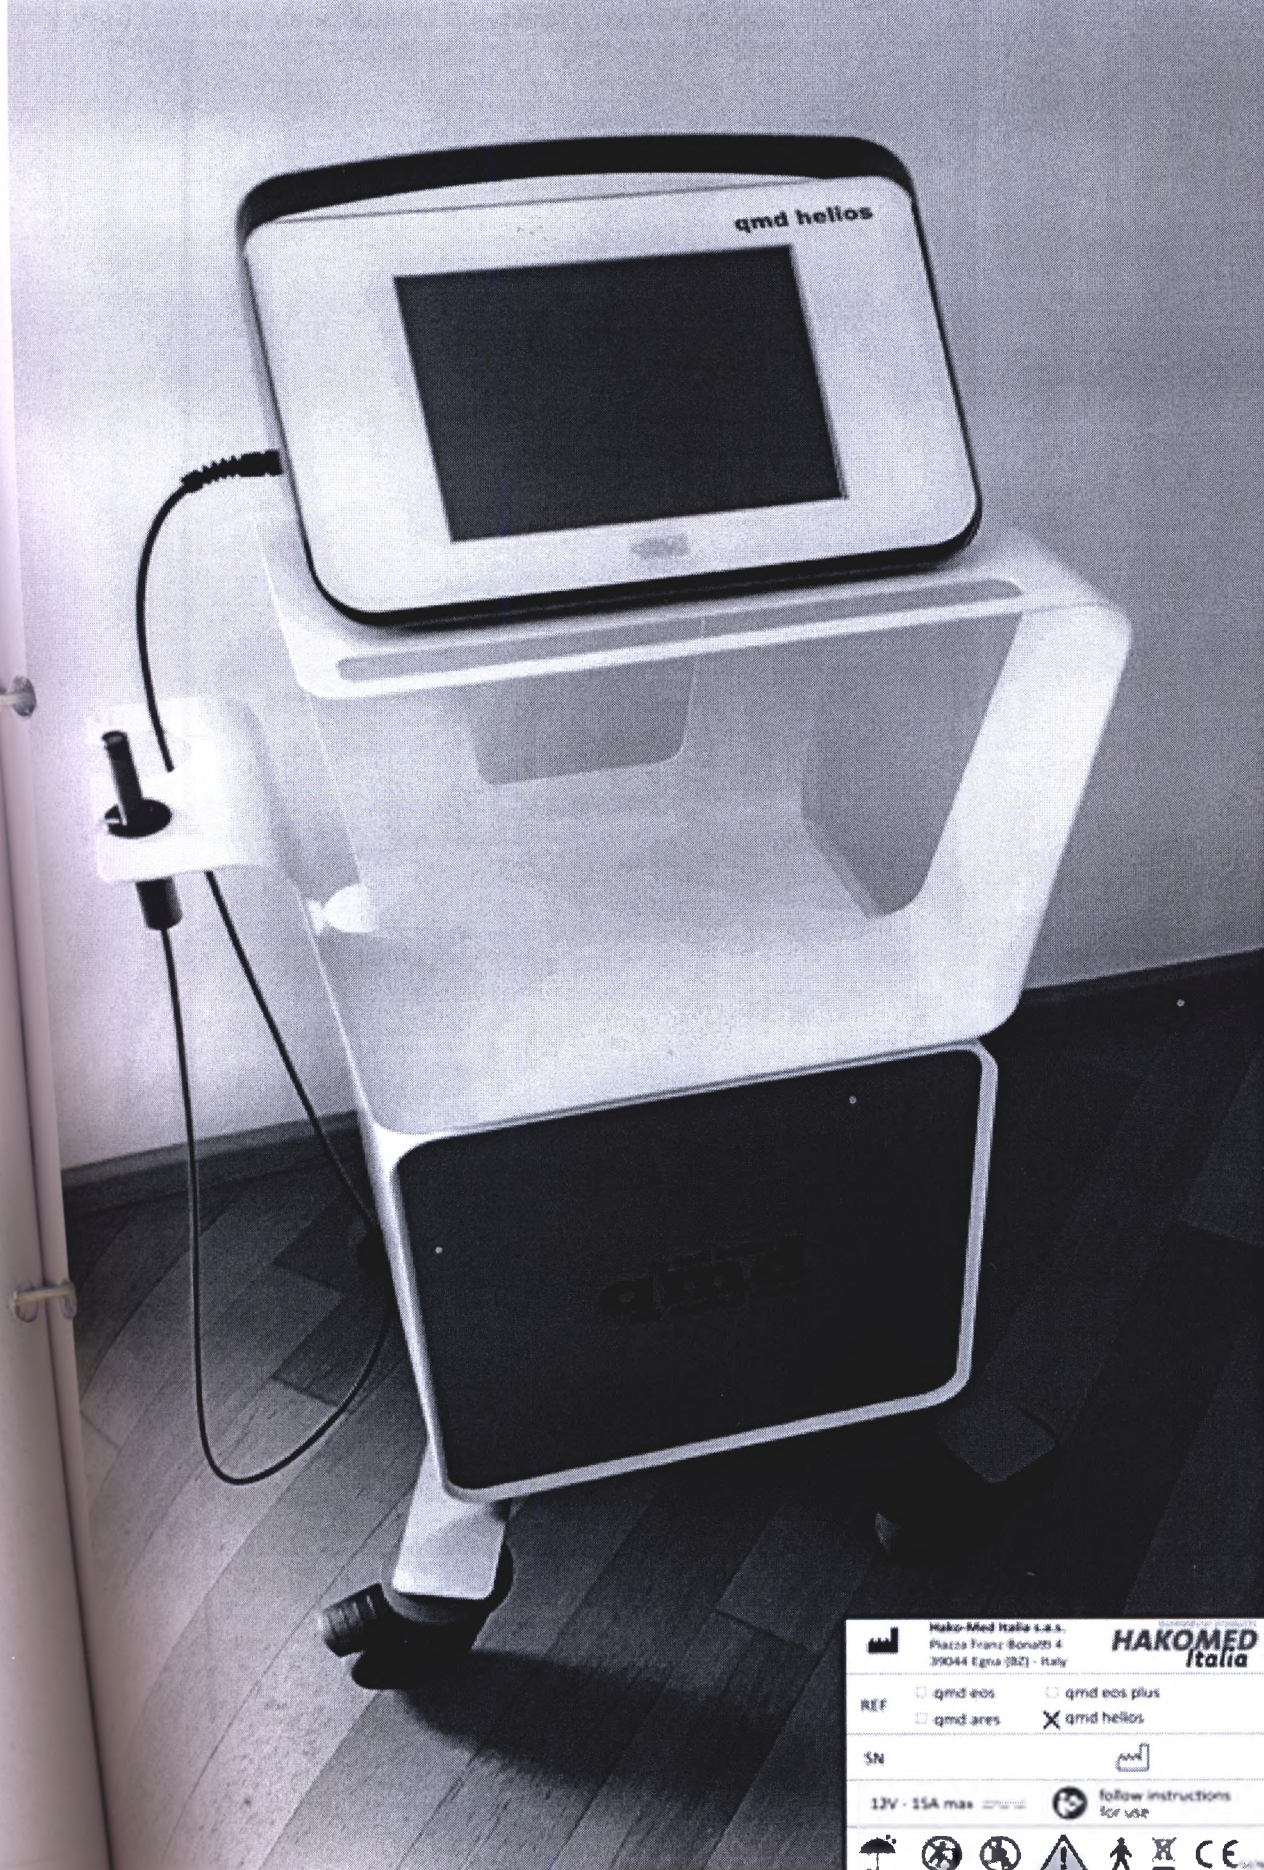


 Hako-Med Italia s.a.s. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (BZ) - Italy		HAKOMED Italia	
REF	☐ qmd eos ☐ qmd ares	☐ qmd eos plus ☒ qmd helios	
SN			
12V - 15A max		 follow instructions for use	
      			

4.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок




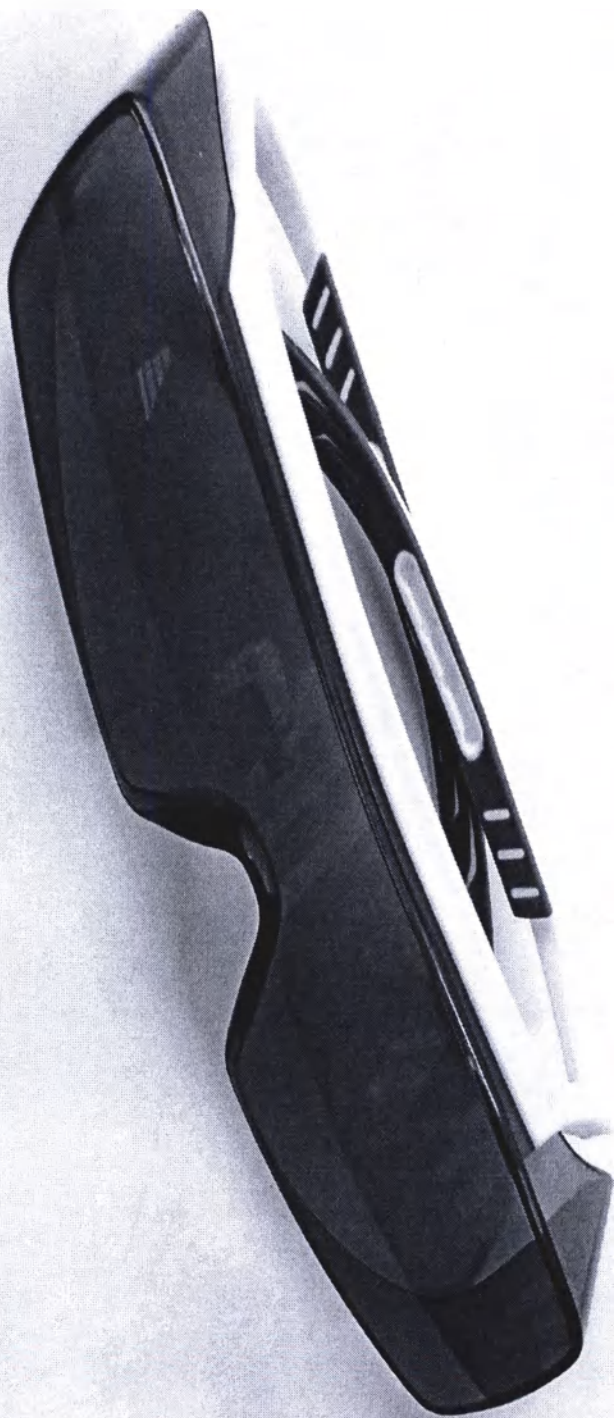


4.3. Насадка, размер S

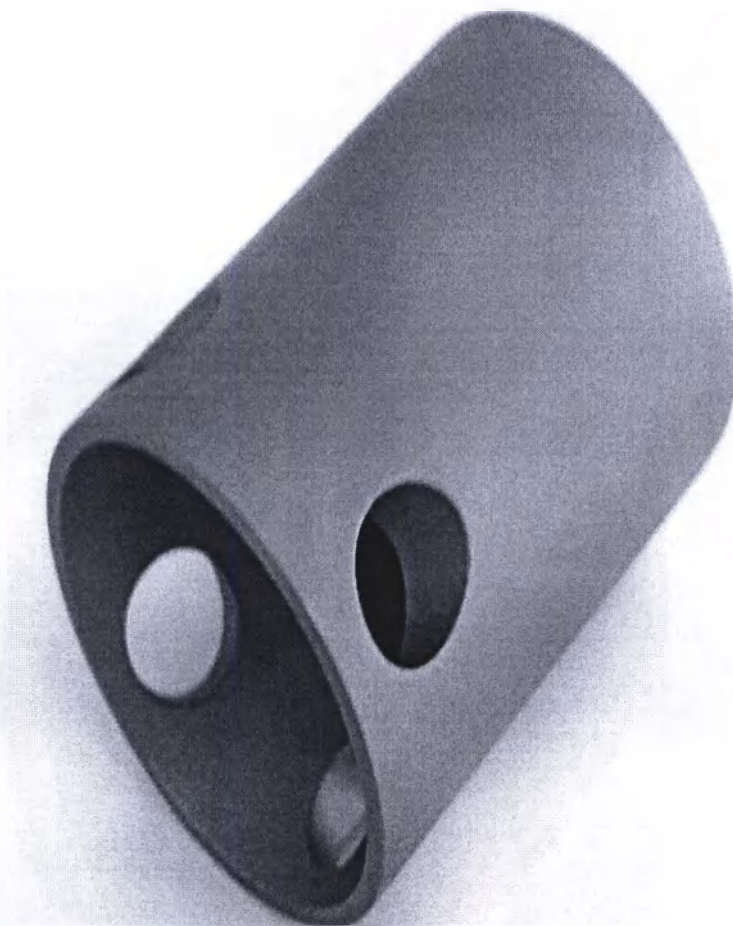


4.4. Насадка, размер М

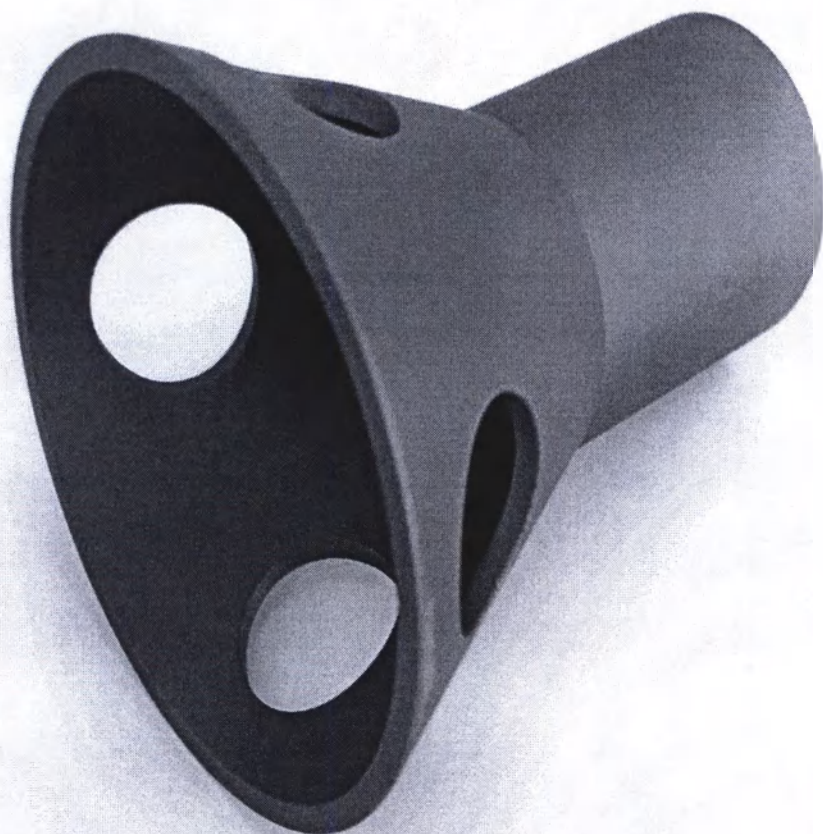

4.5. Насадка, размер L

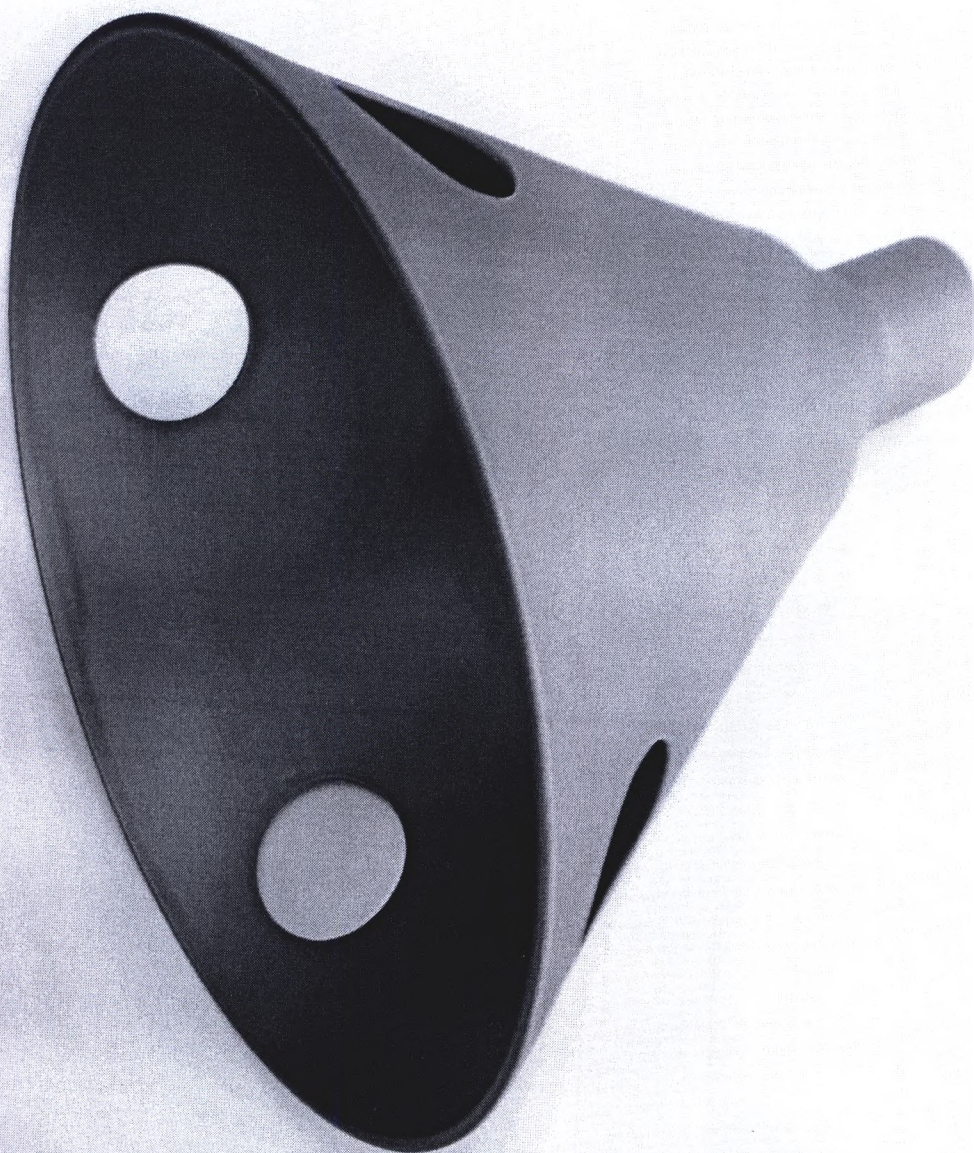


4.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем

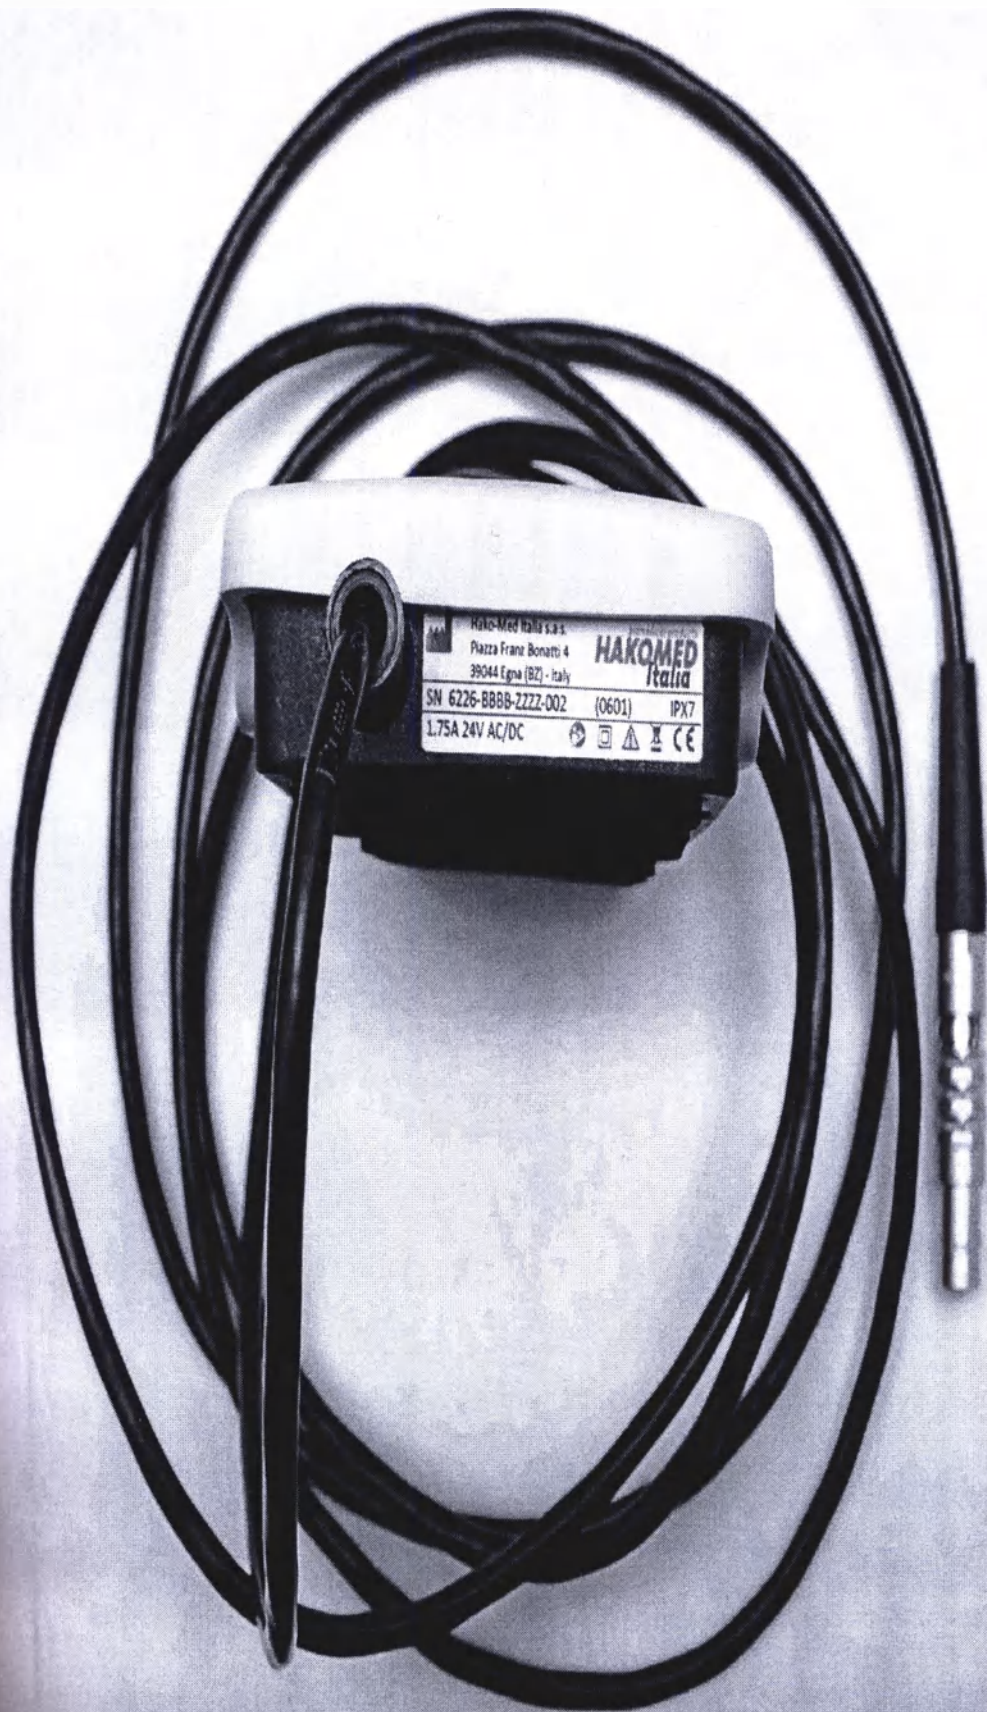

4.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем




4.8. Тележка аппаратная с блоком питания

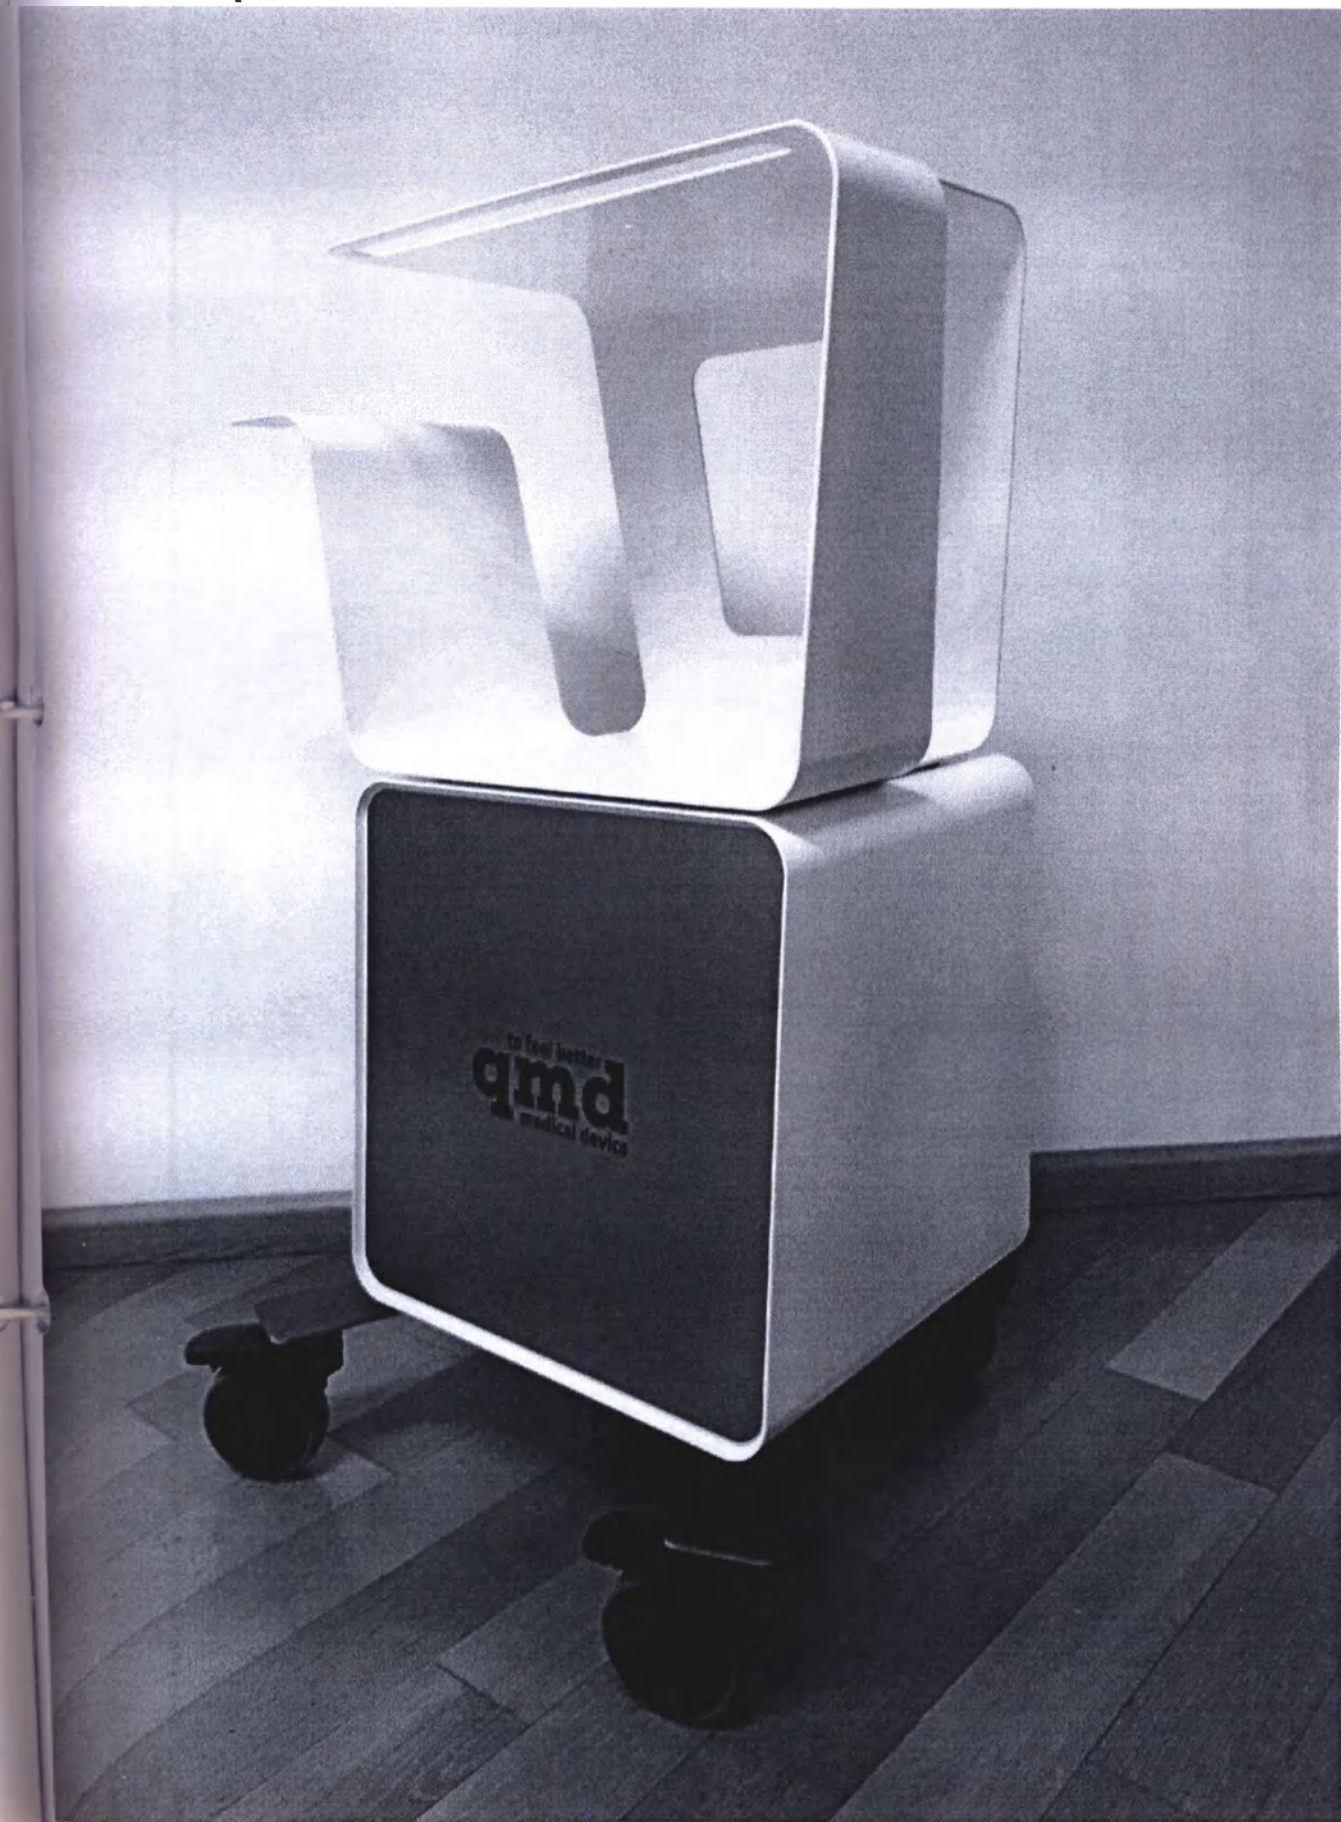

4.9. Шнур сетевой



4.10. Кабель питания соединительный

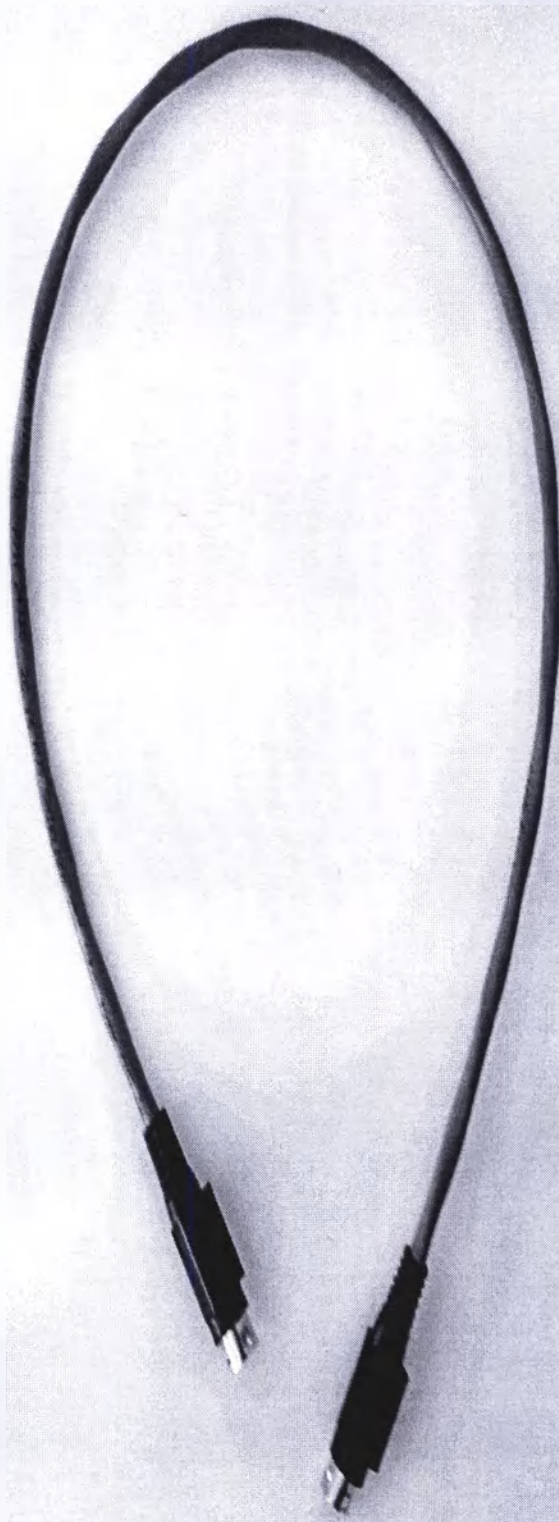

4.11. Адаптер сетевой






Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal


Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

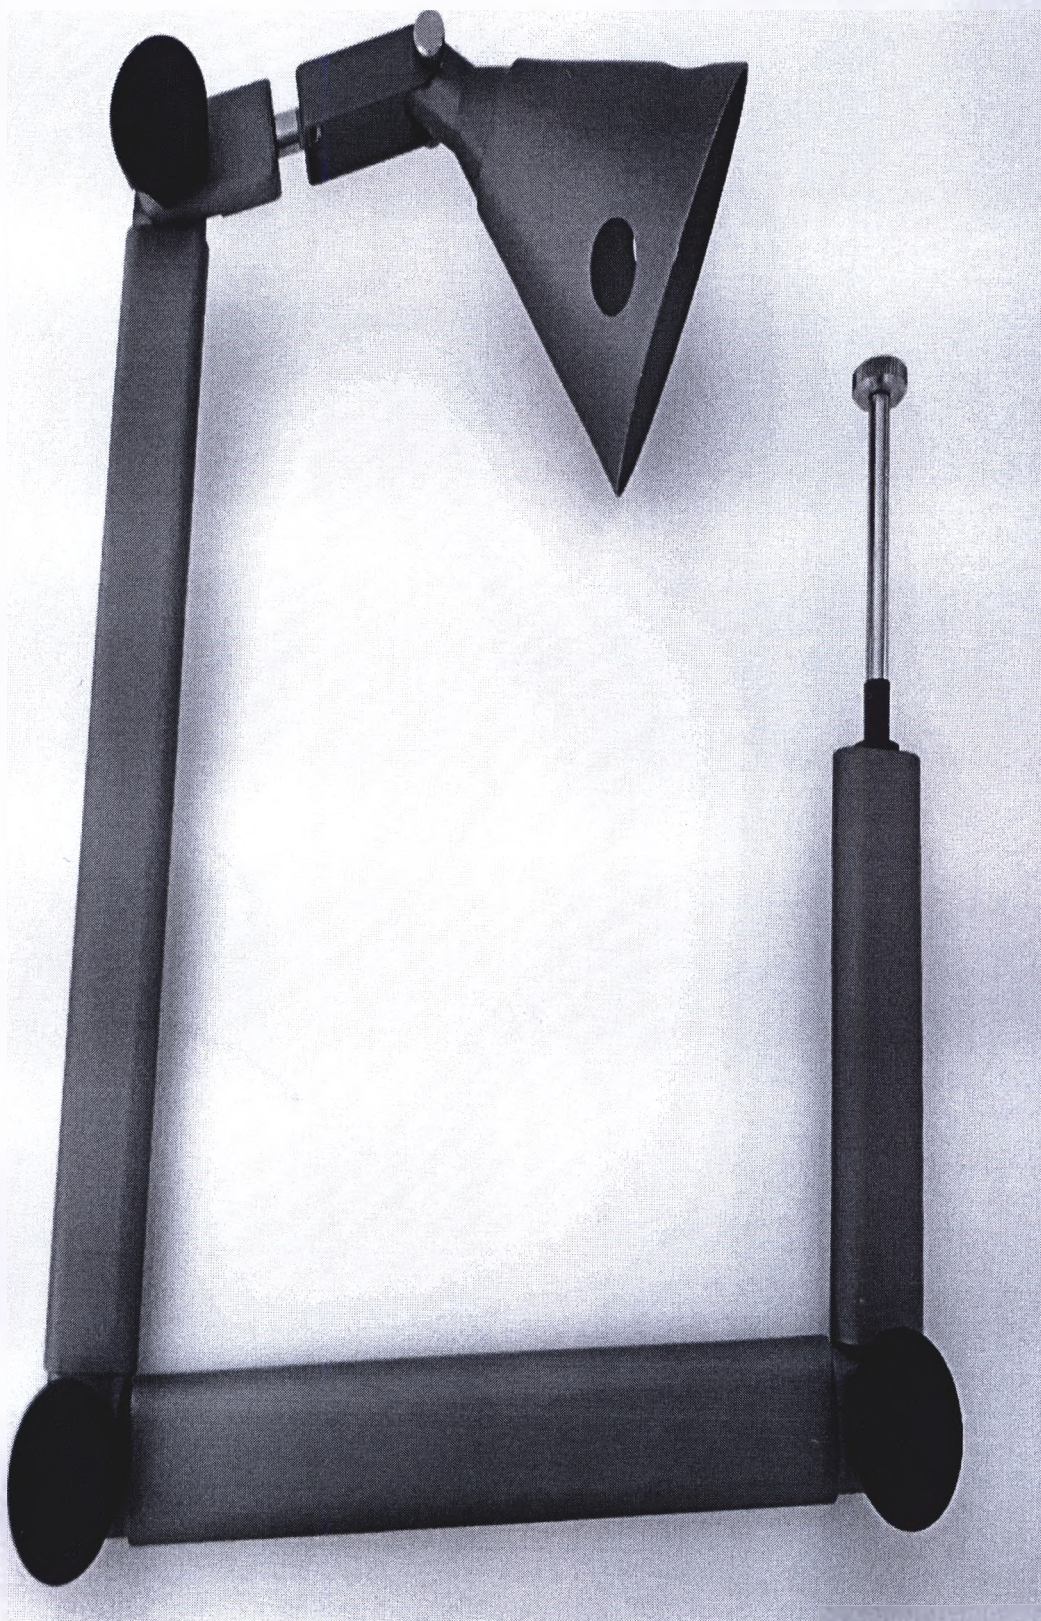

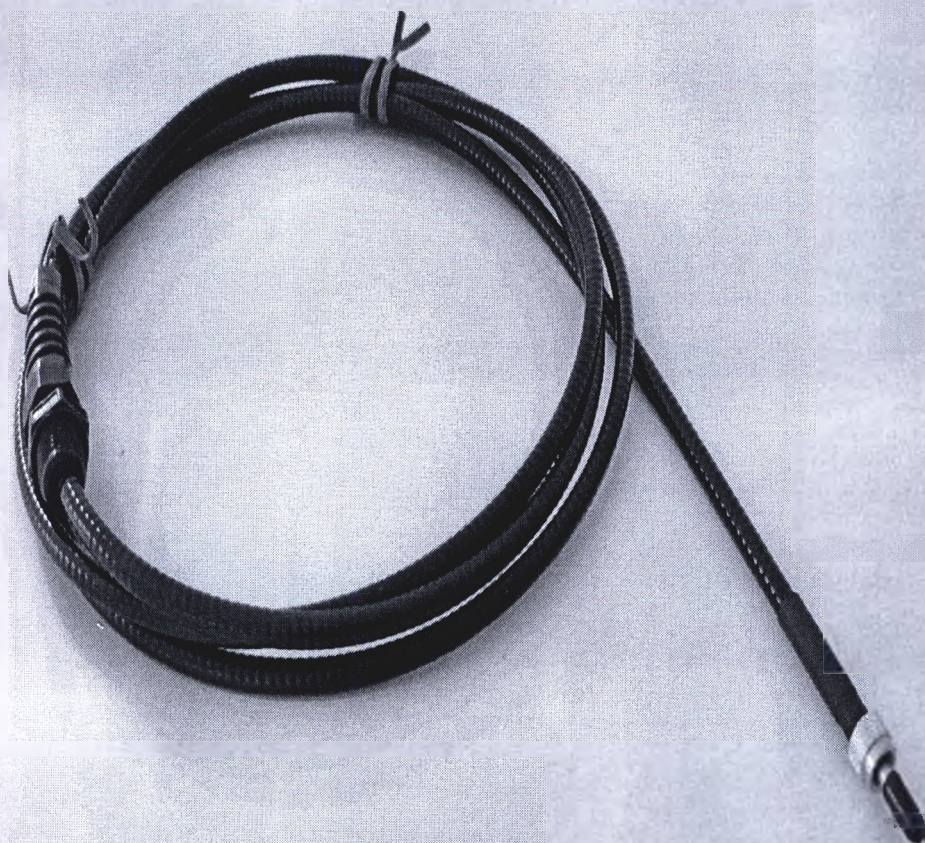

4.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным




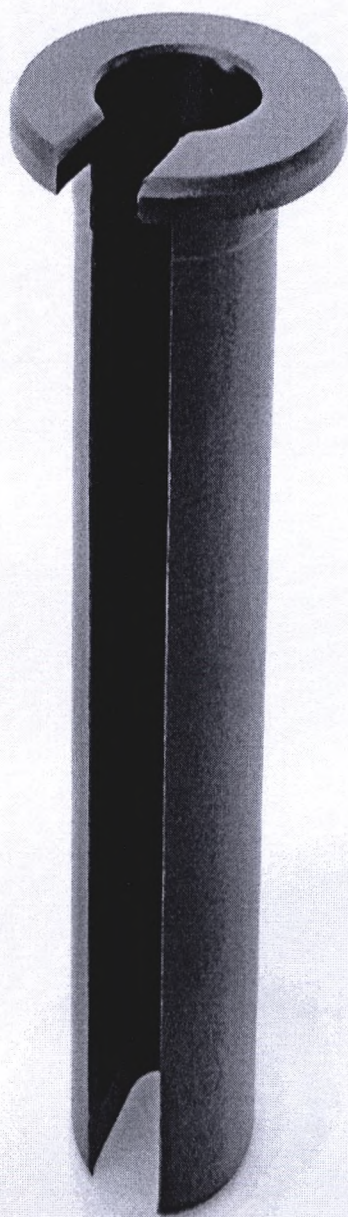

4.17. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери



4.18. Подставка под держатель насадок

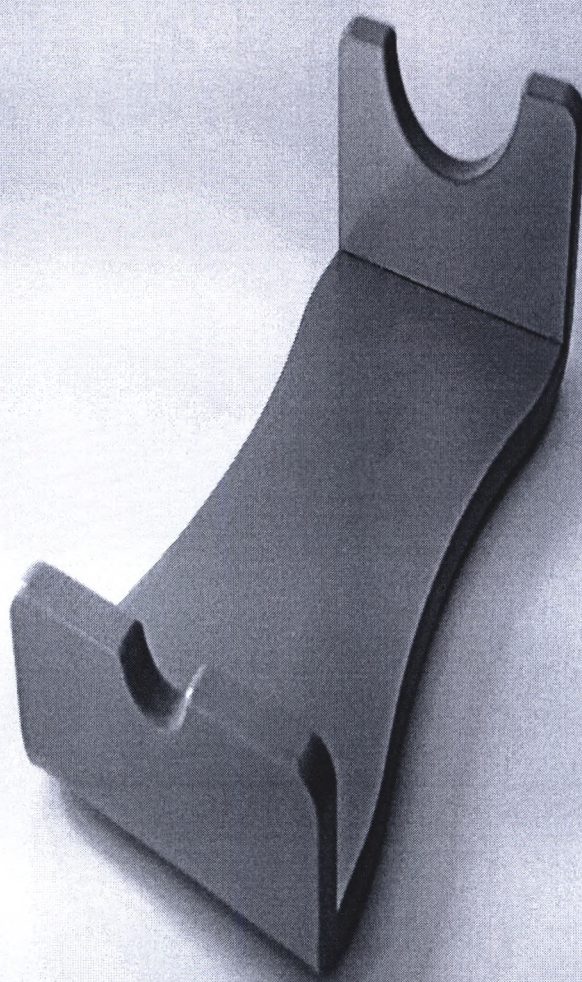

4.19. Держатель насадок



Принадлежности:

· Сумка транспортировочная






Hako-Med Italia s.a.s. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (S2) - Italy		HAKOMED Italia	
REF	☒ qmd eos ☐ qmd ares	☐ qmd eos plus ☐ qmd helios	
SN			
12V - 15A max			follow instructions for use

11. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 8 Вт, длина волны 1064 нм, световодом и держателем насадок






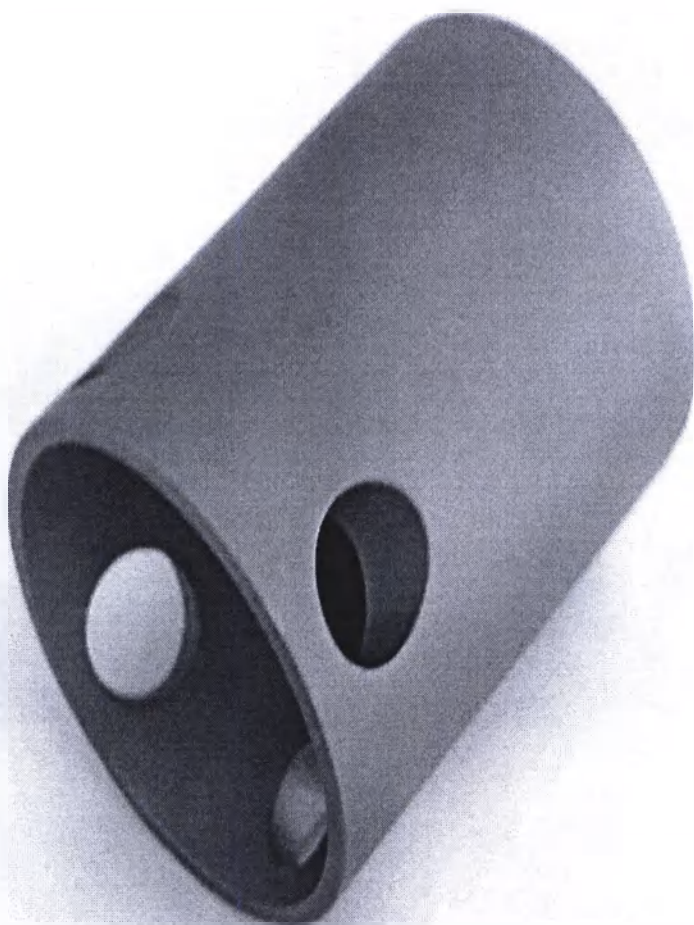

34. Насадка, размер М



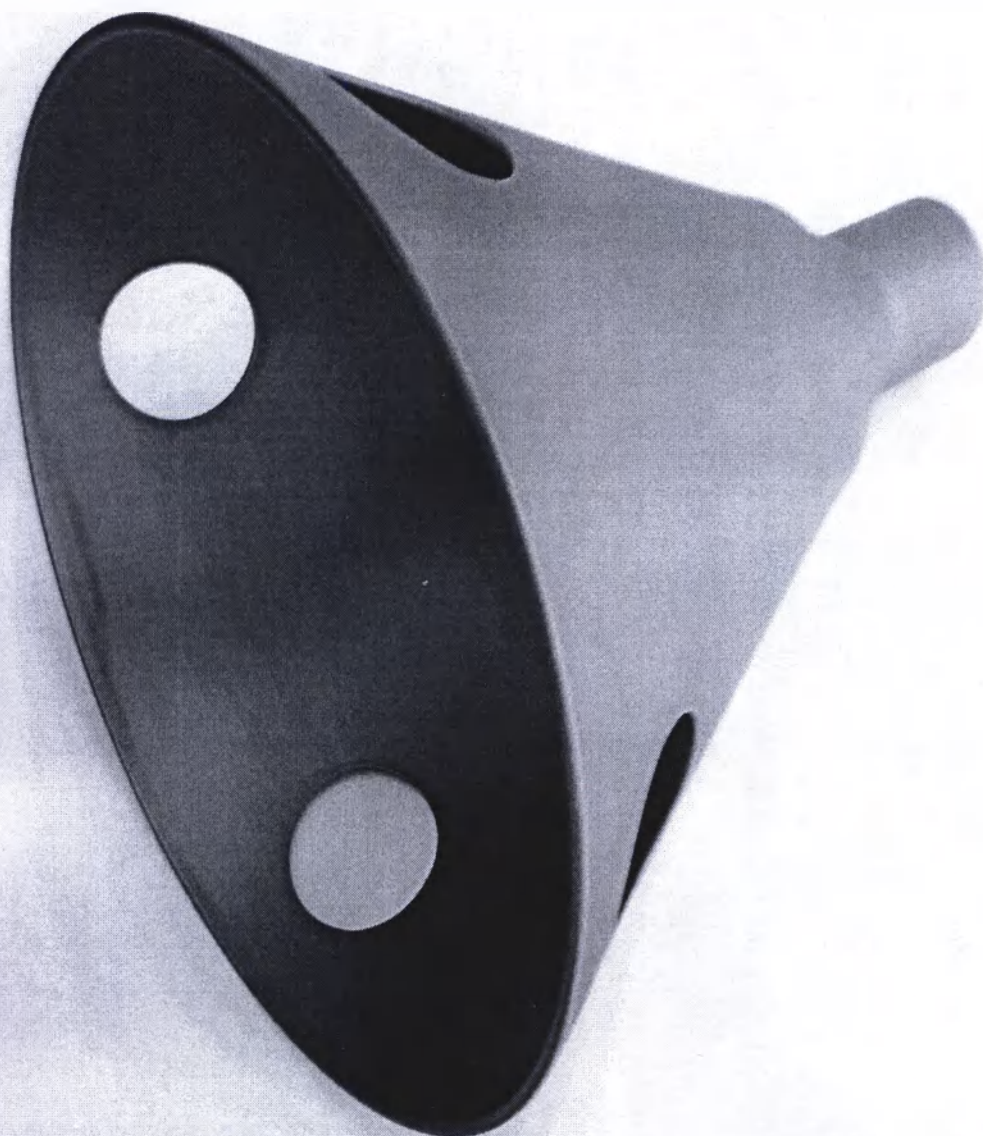

5.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем






5.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см





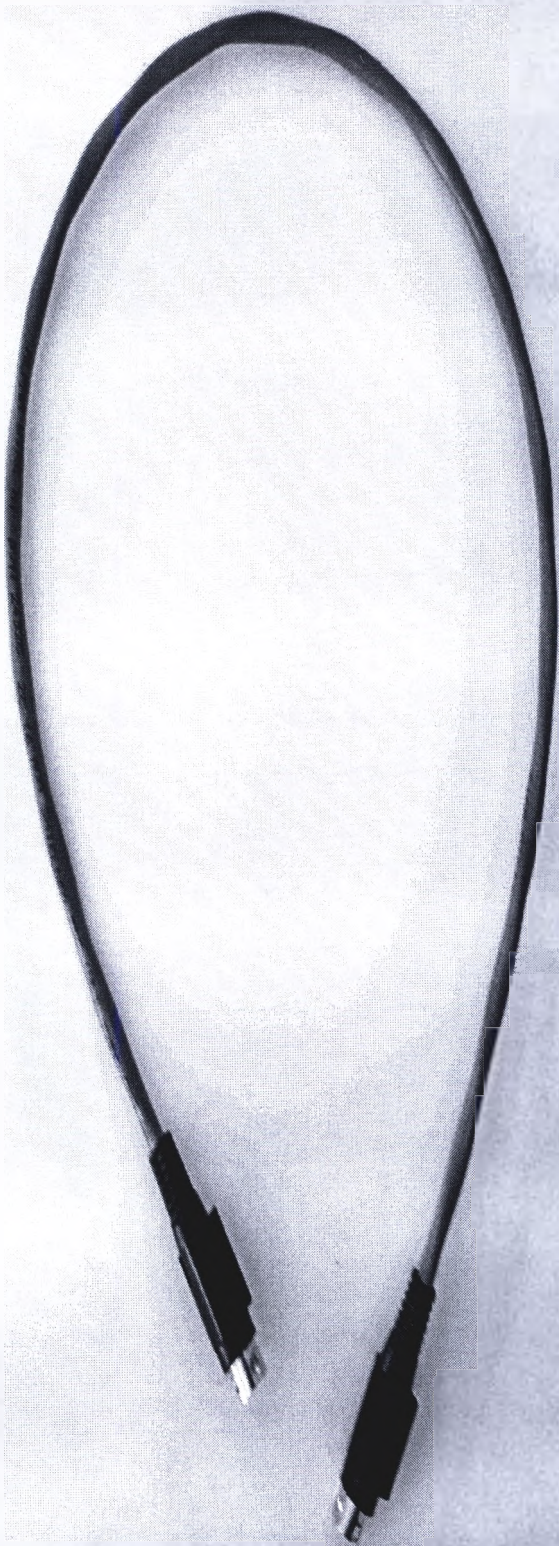

5.11. Кабель управления соединительный






Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal


Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

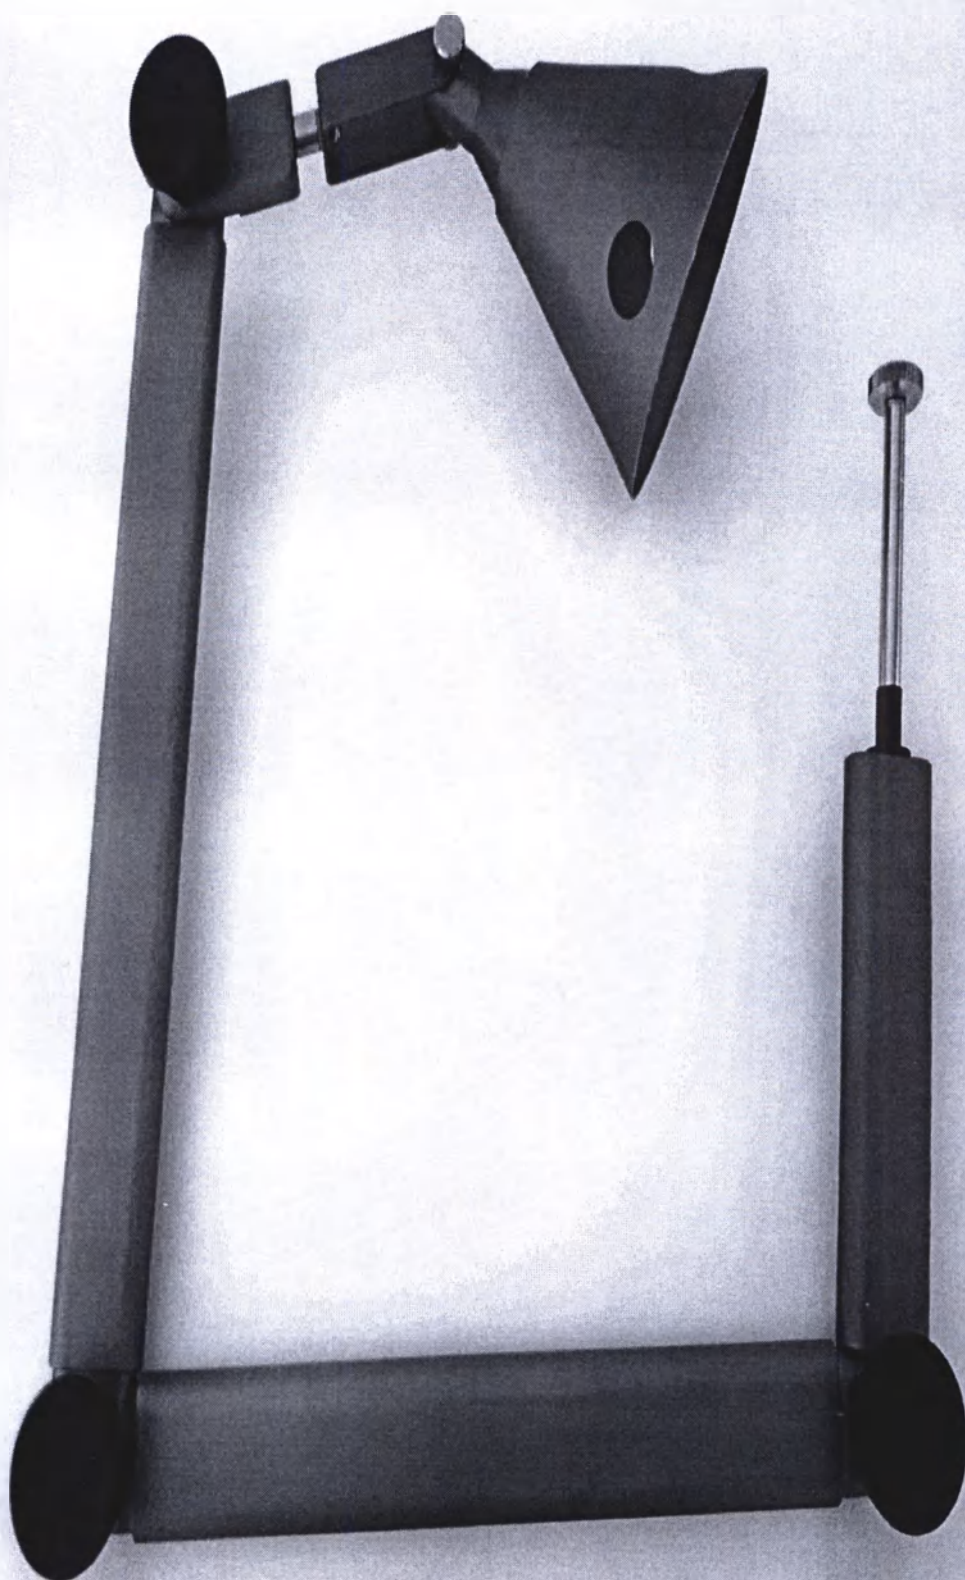

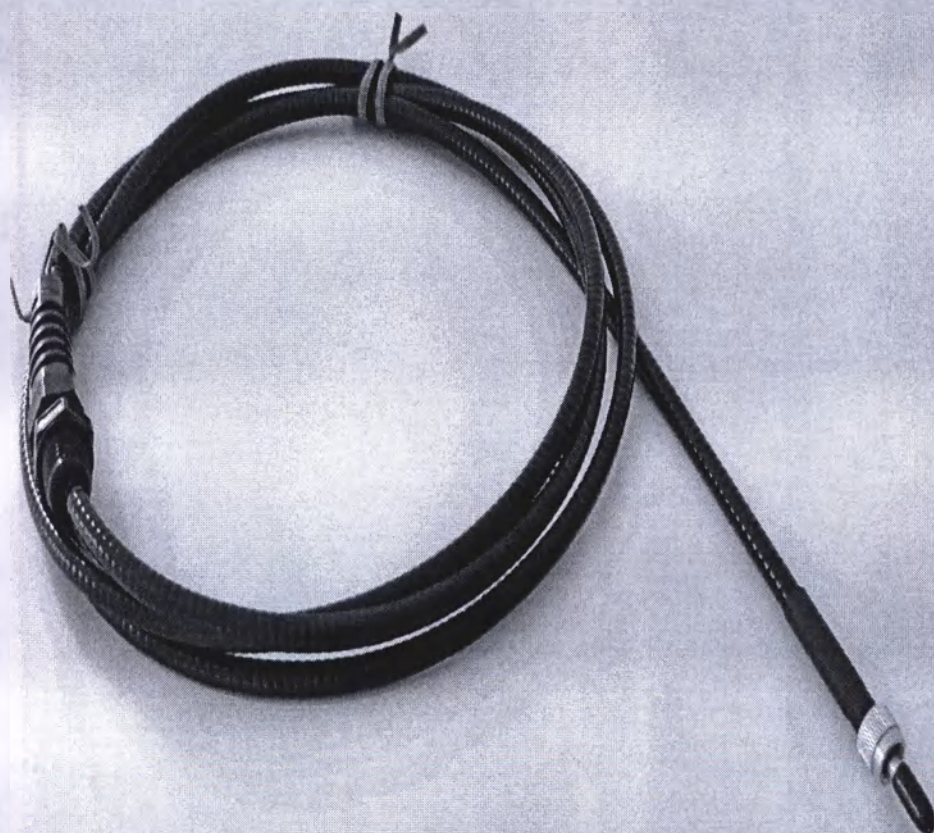


5.15. Датчик матричный контраста зоны воспаления с проводом соединительным




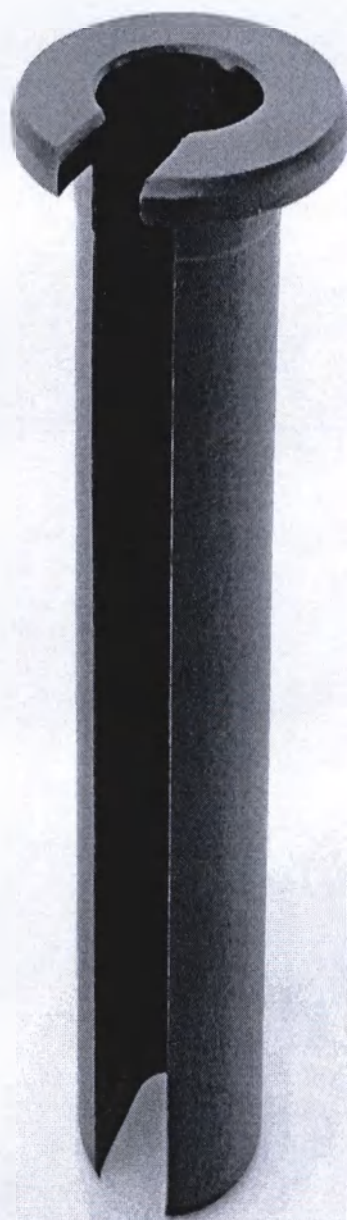





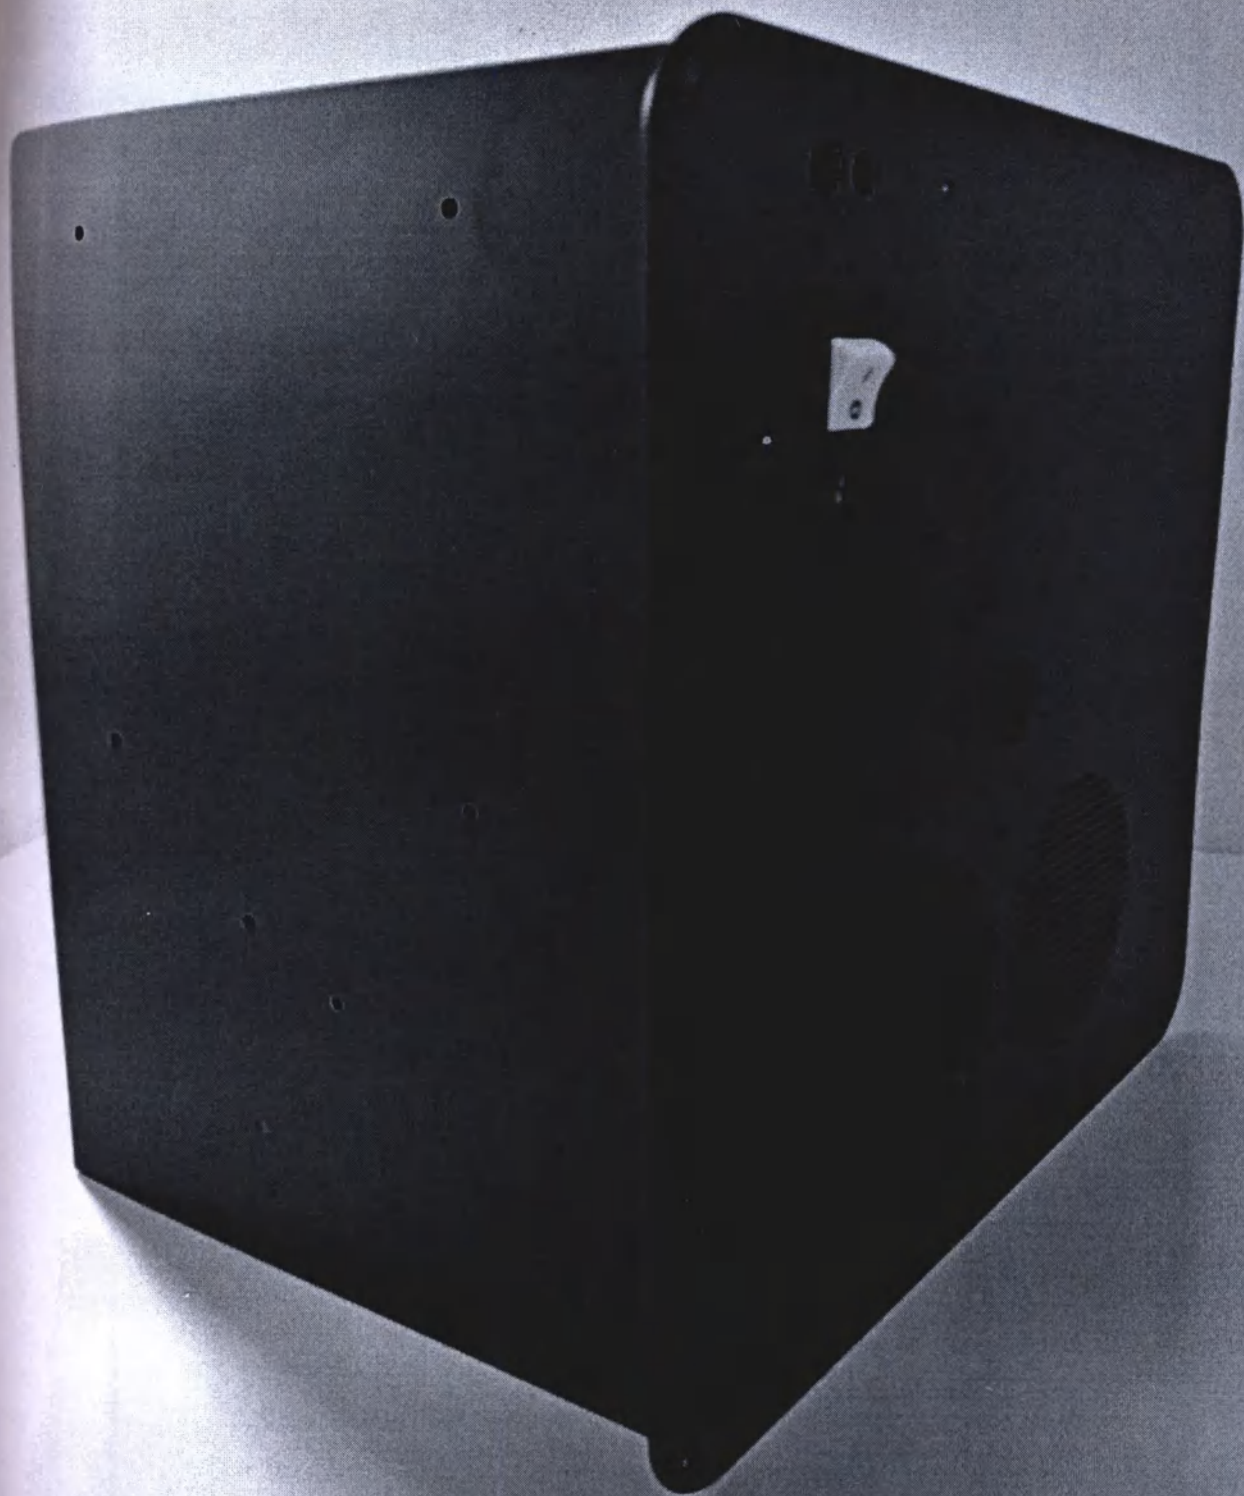

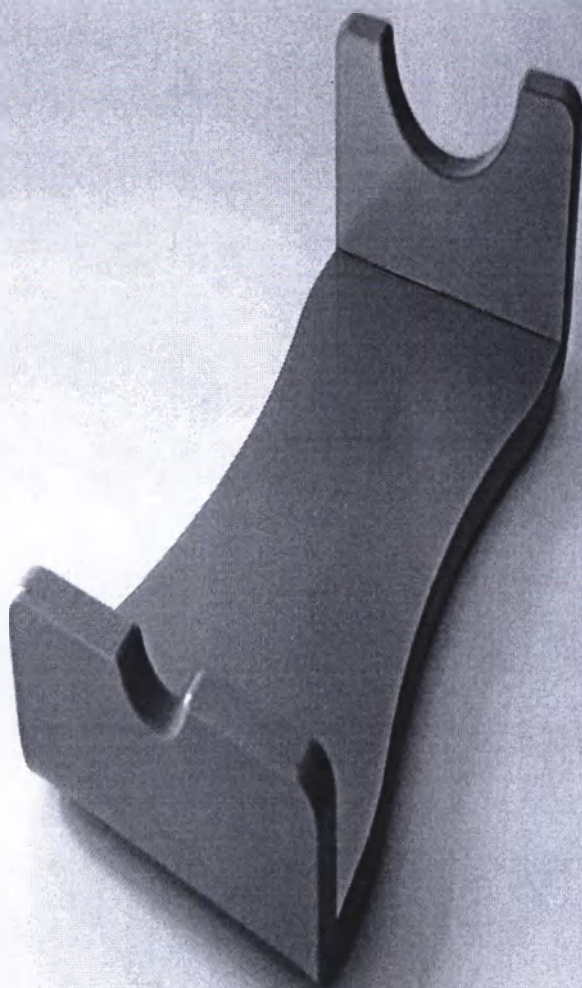





Принадлежности:

· Сумка транспортировочная



6. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd eos plus cryo-thermal» в составе:




Hako-Med Italia s.a.s. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (BZ) - Italy		HAKOMED Italia	
REF	☐ qmd eos ☐ qmd ares	☒ qmd eos plus ☐ qmd helios	
SN			
12V - 15A max			follow instructions for use

6.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 15 Вт, длина волны 1064 нм со световодом и держателем насадок






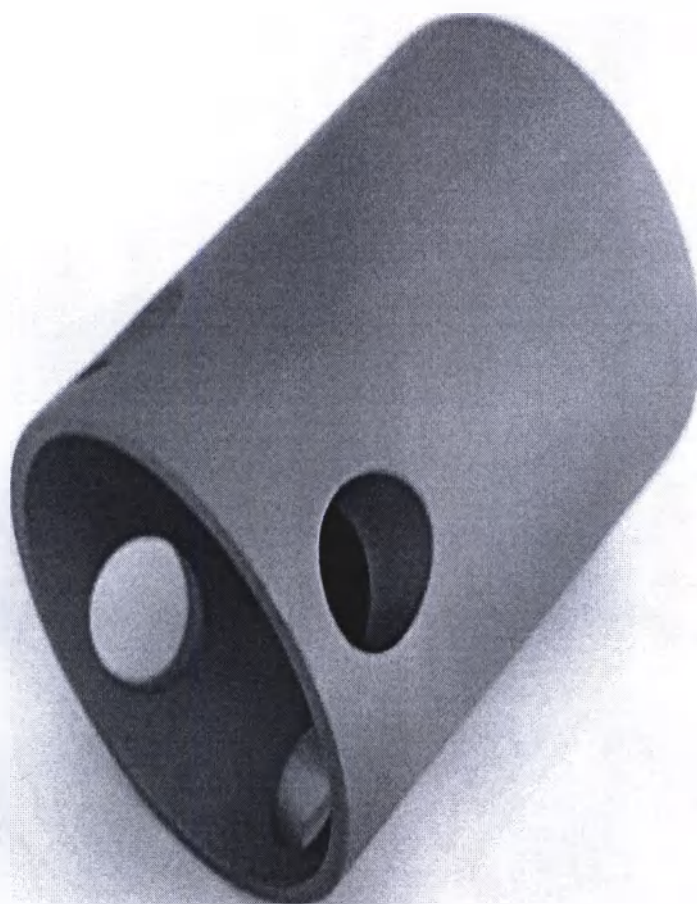


6.4. Насадка, размер М



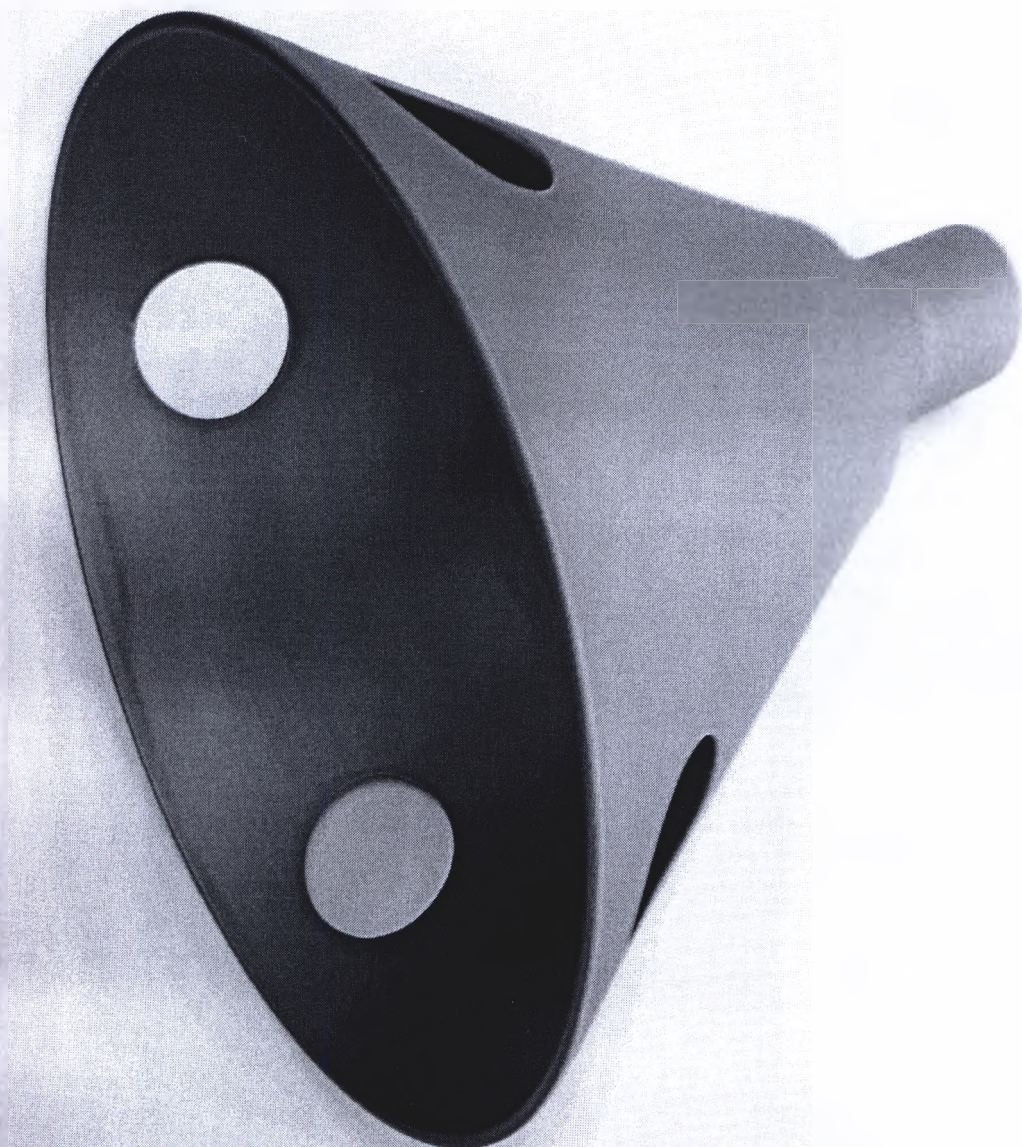

6.6. Педаль включения лазерного излучения с кабелем

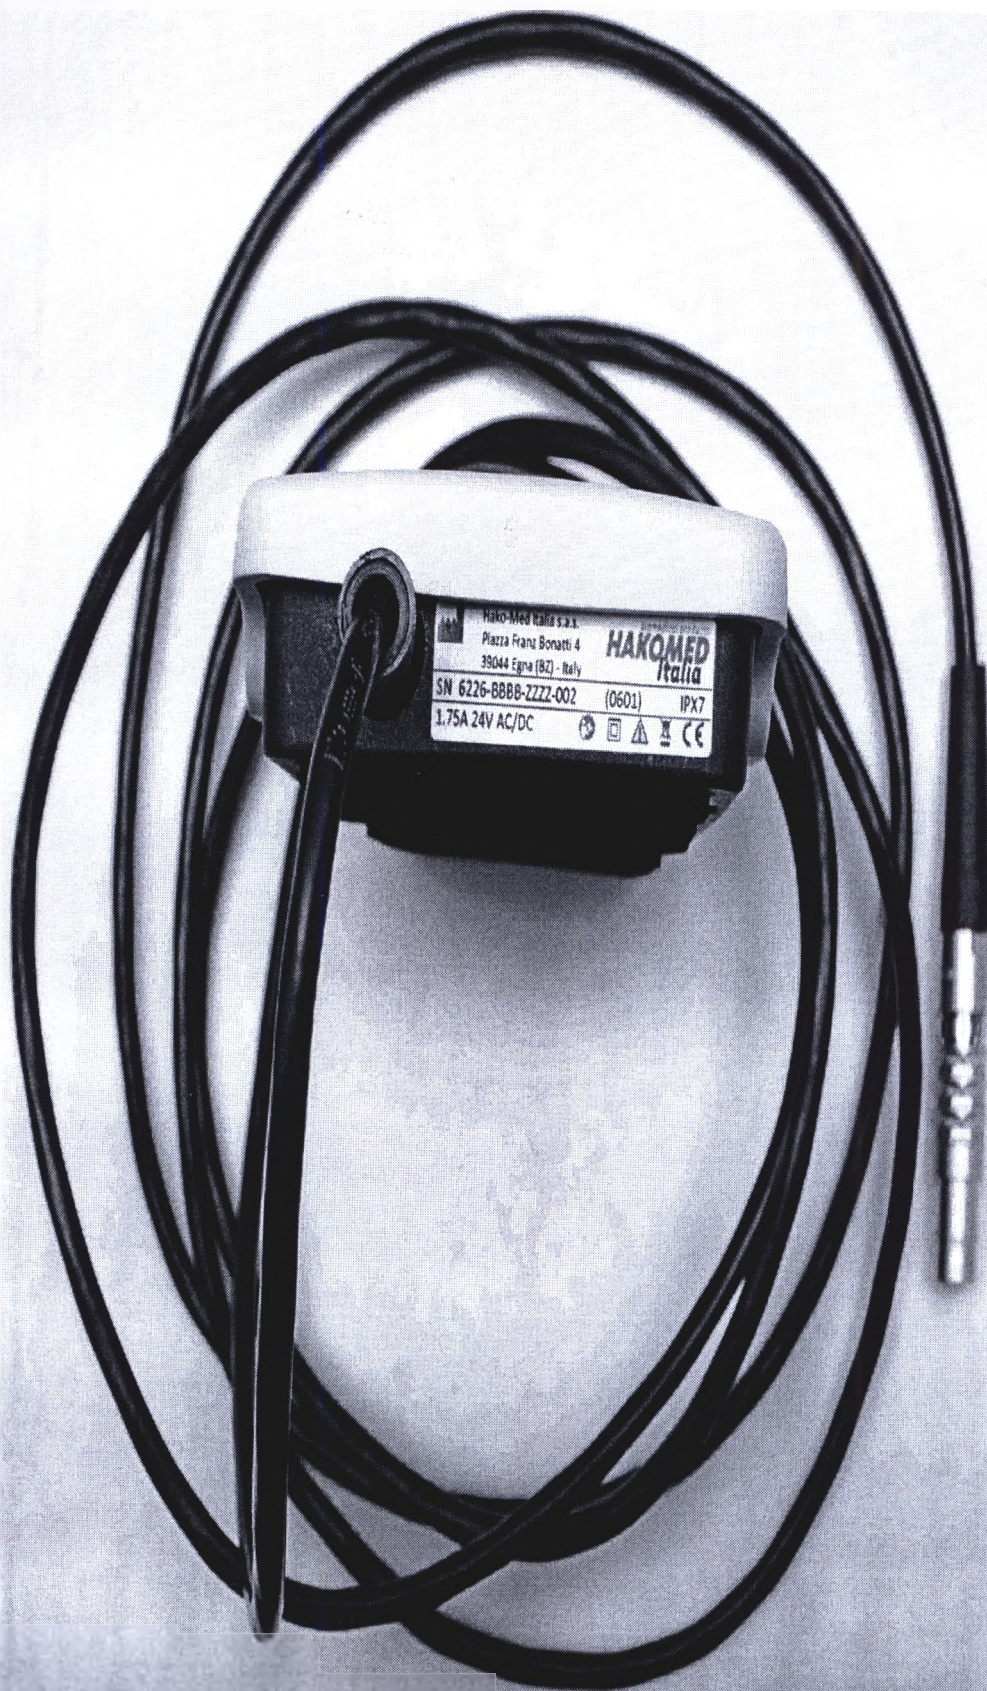


6.7. Кнопка включения лазерного излучения с кабелем




6.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см



6.9. Шнур сетевой

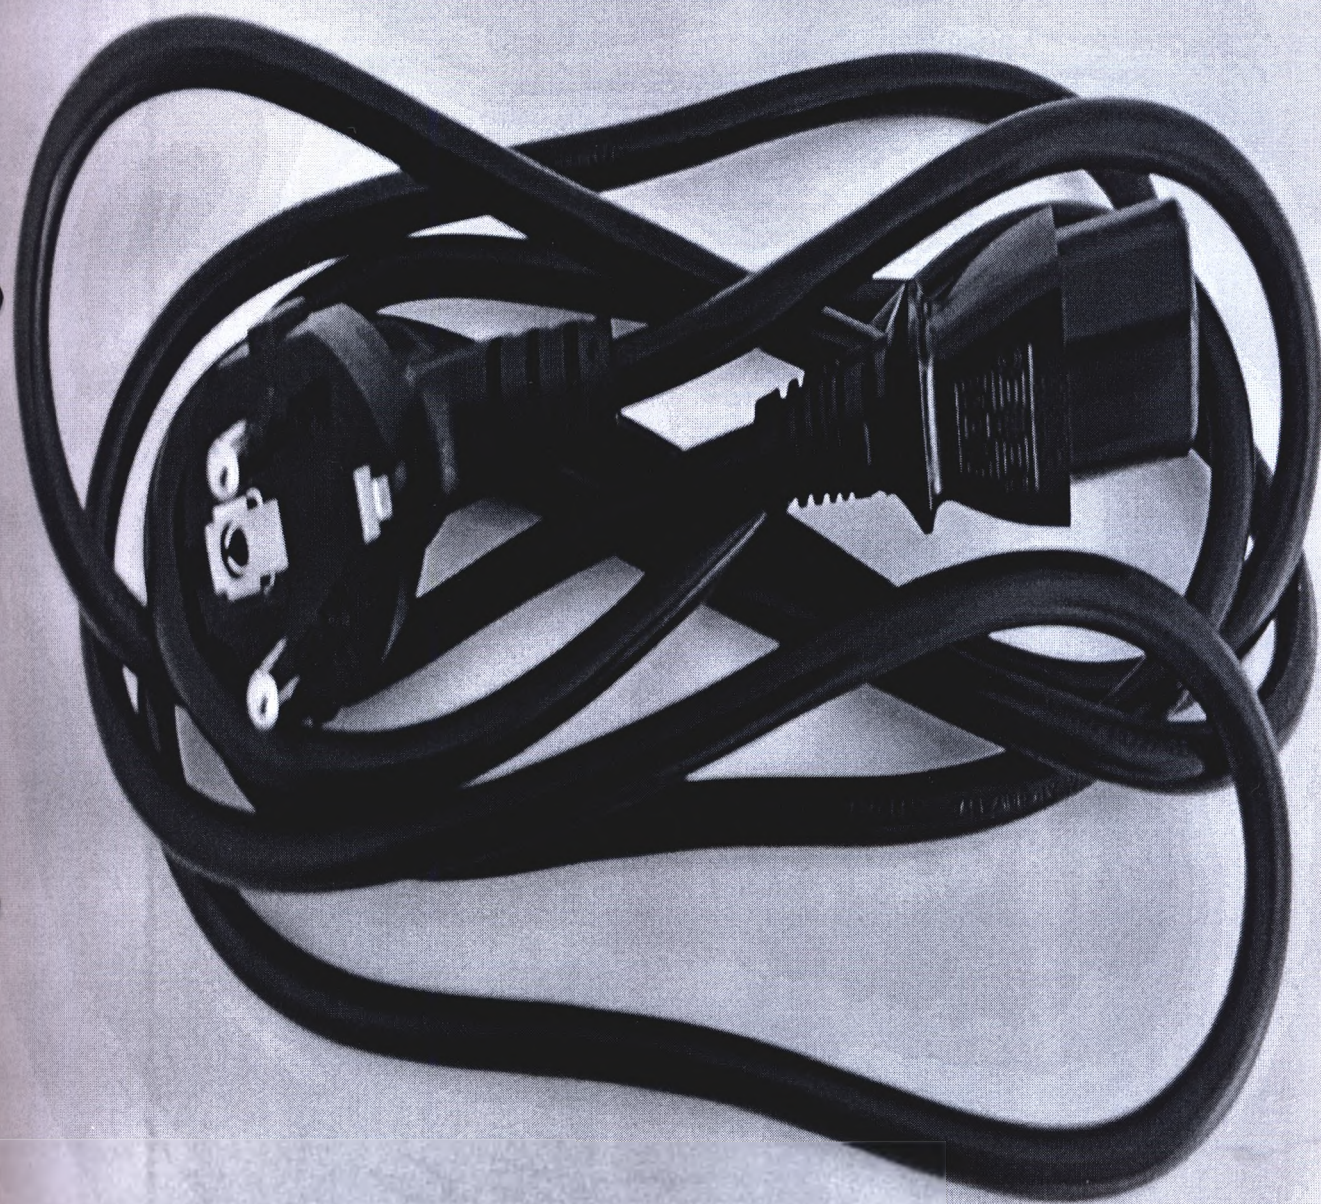


6.10. Кабель питания соединительный

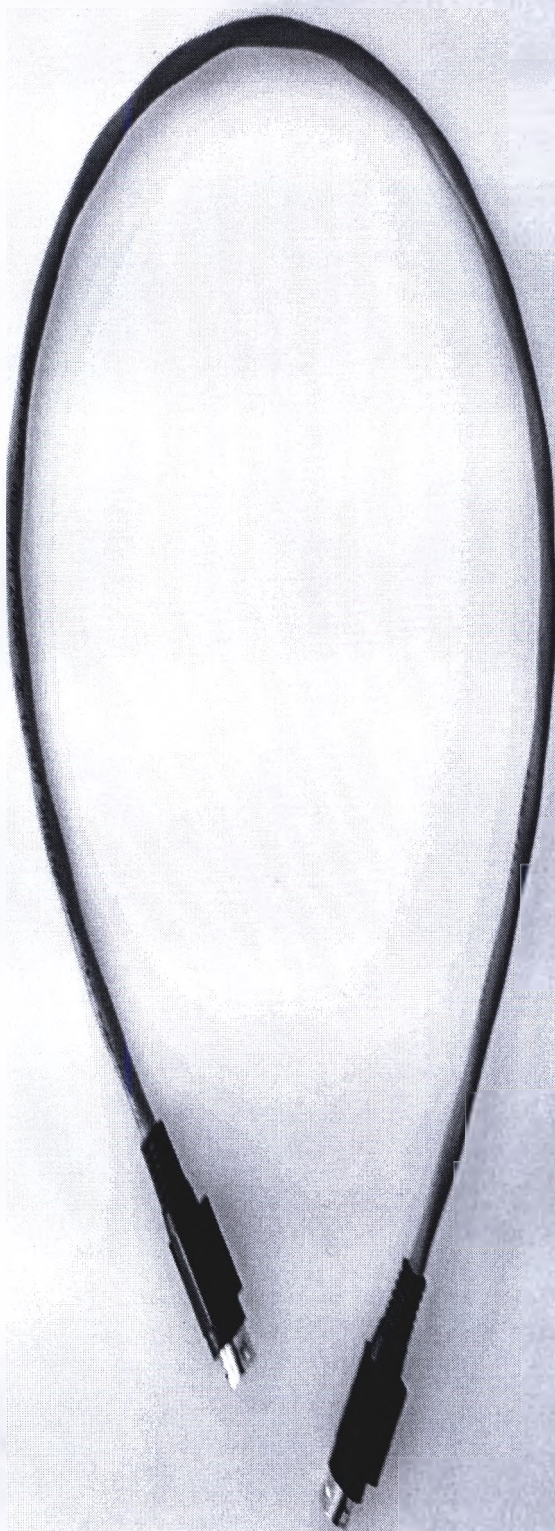

6.11. Кабель управления соединительный





Руководство по эксплуатации





Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd»,
варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal


Дата создания: 02.08.2017


Версия: 02

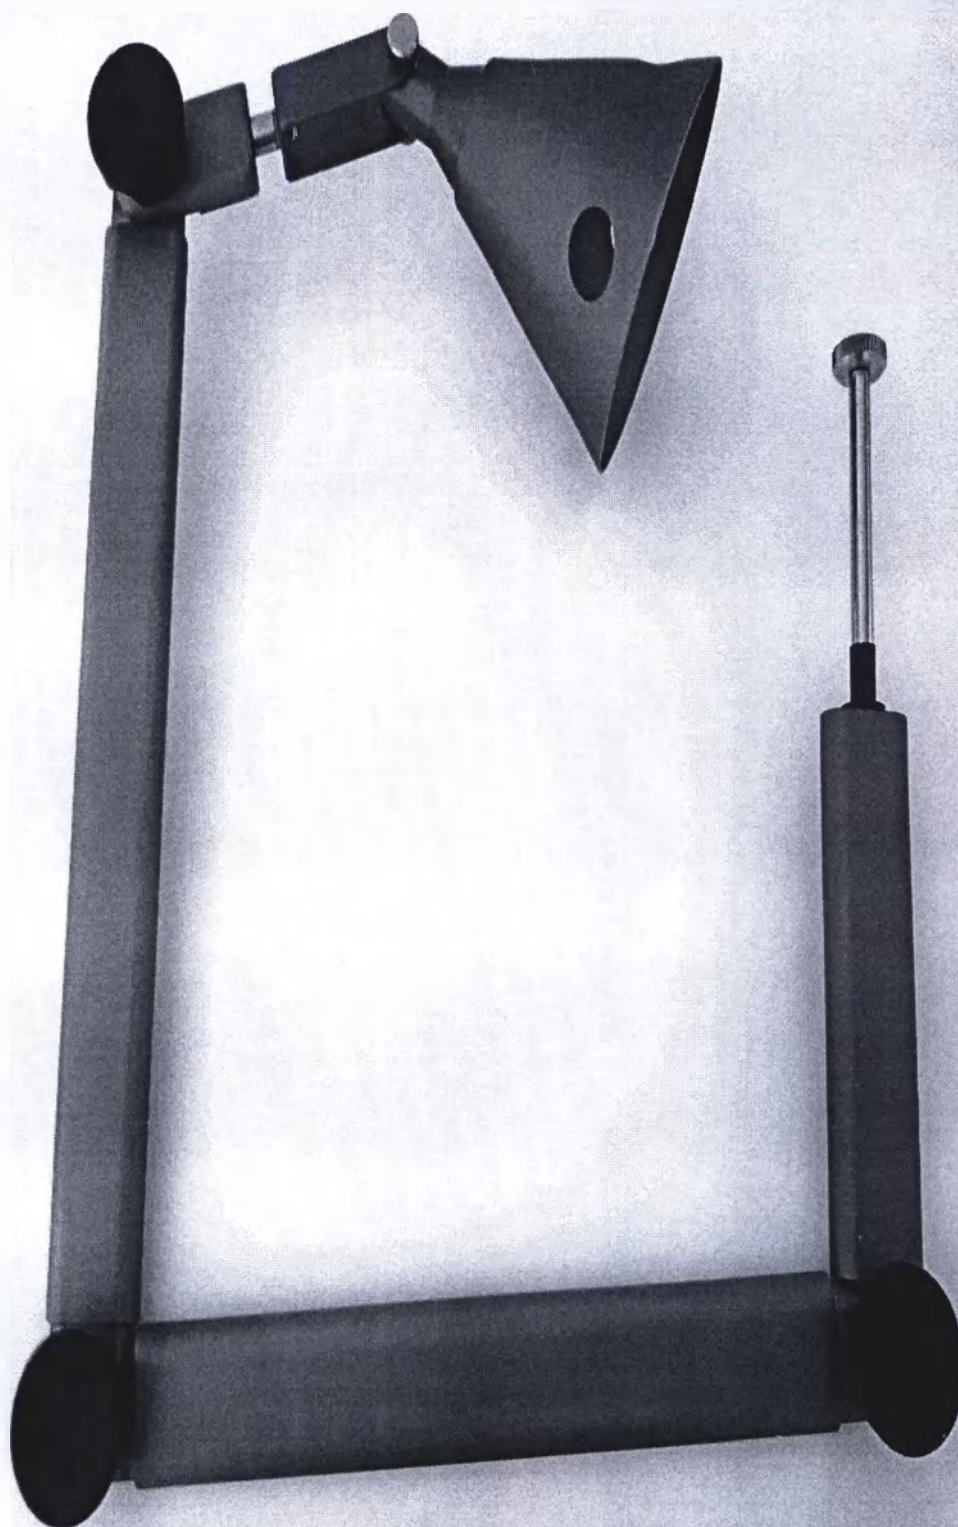

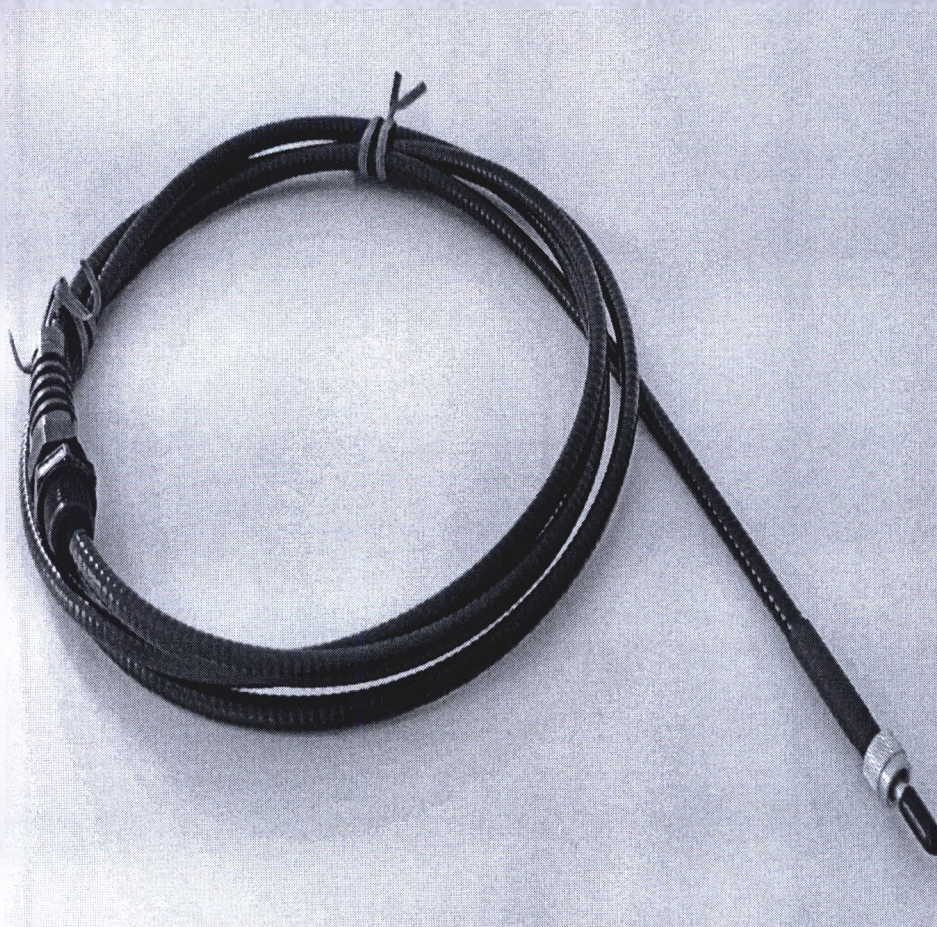




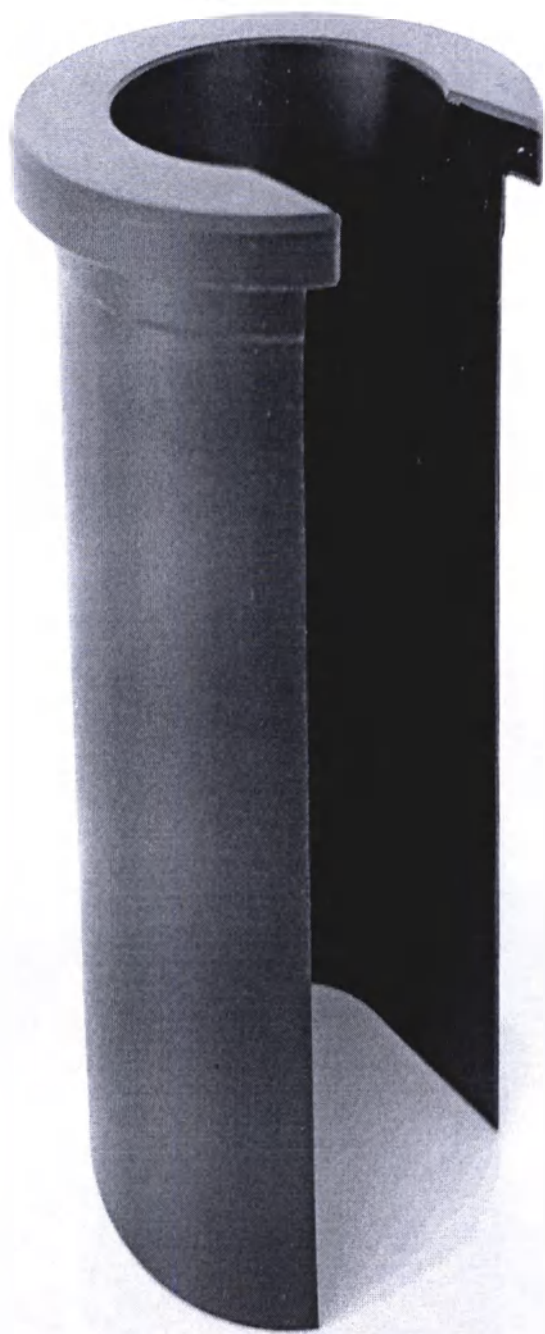


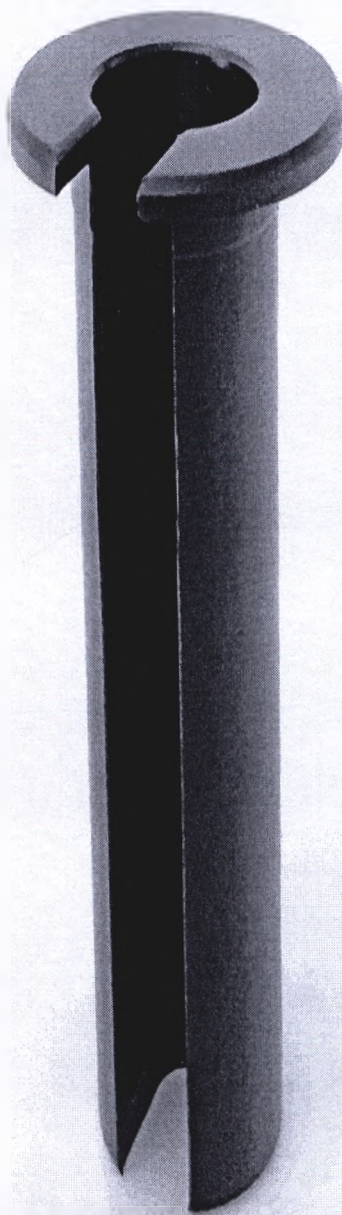

6.18. Разъём подключения прерывателя лазерного излучения при открытии входной двери



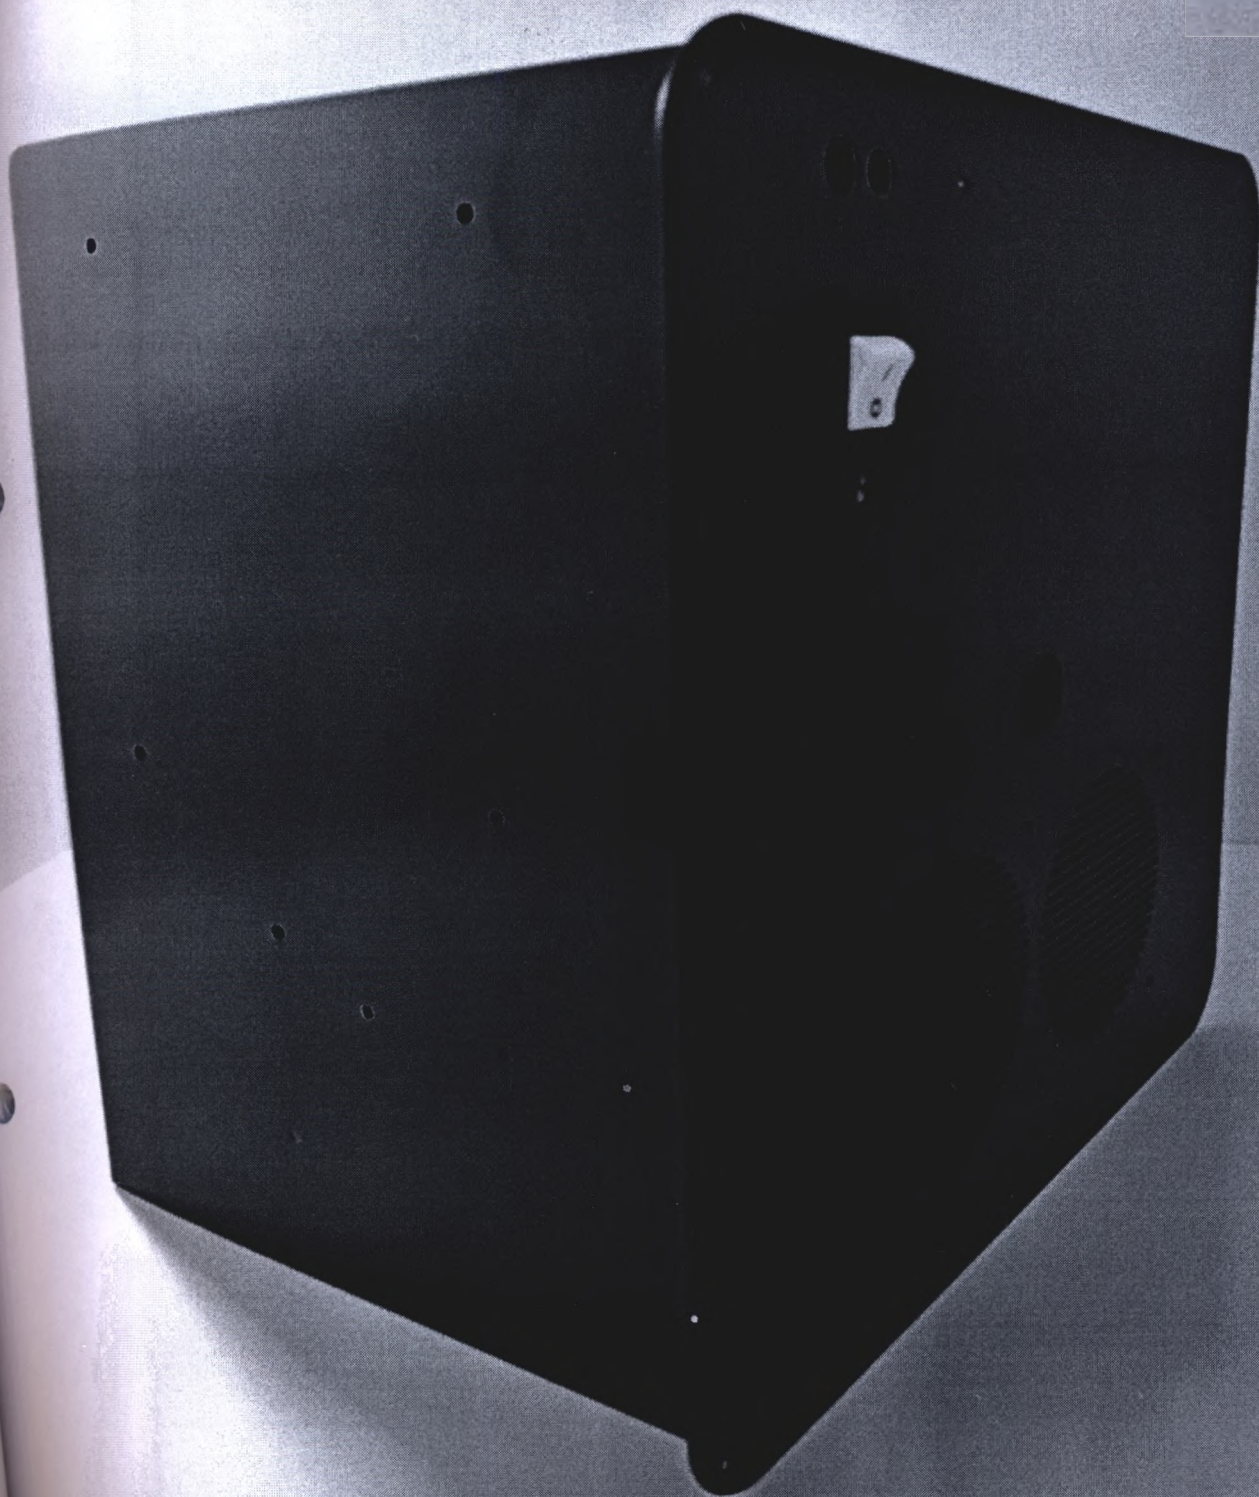

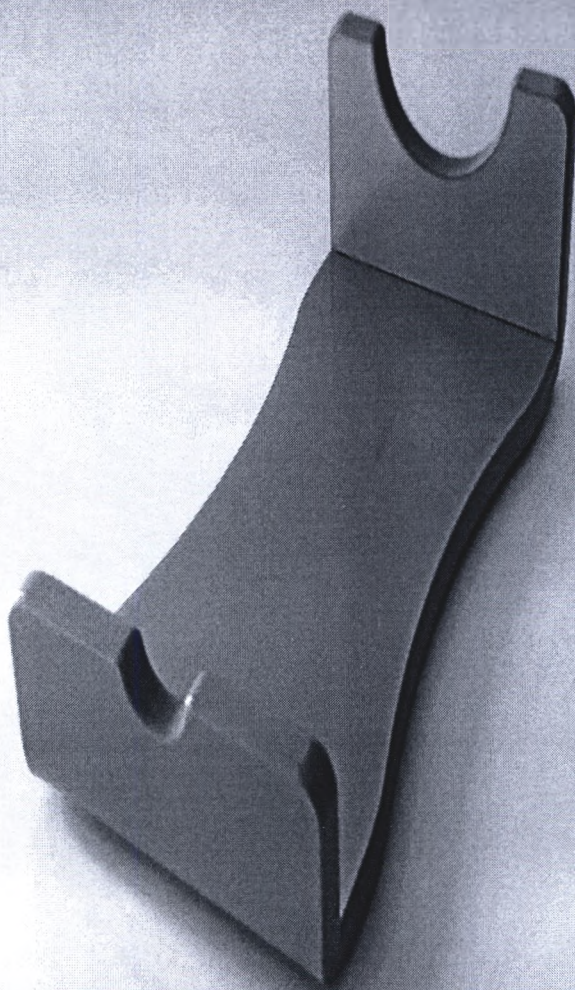





Принадлежности:

- Сумка транспортировочная




7. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdarescryo-thermal» в составе:




7.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 18 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм со световодом и держателем насадок






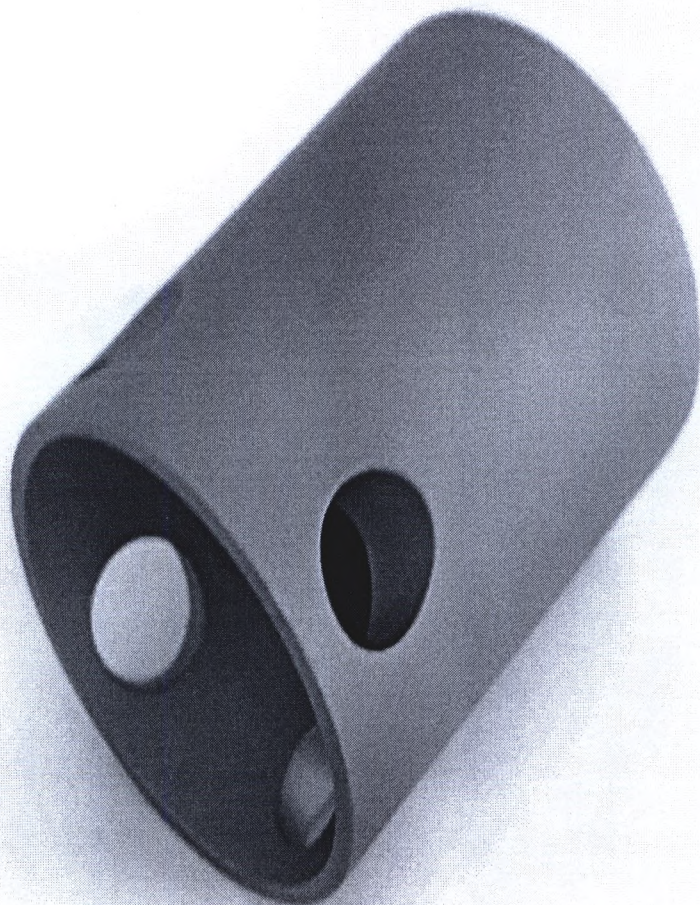



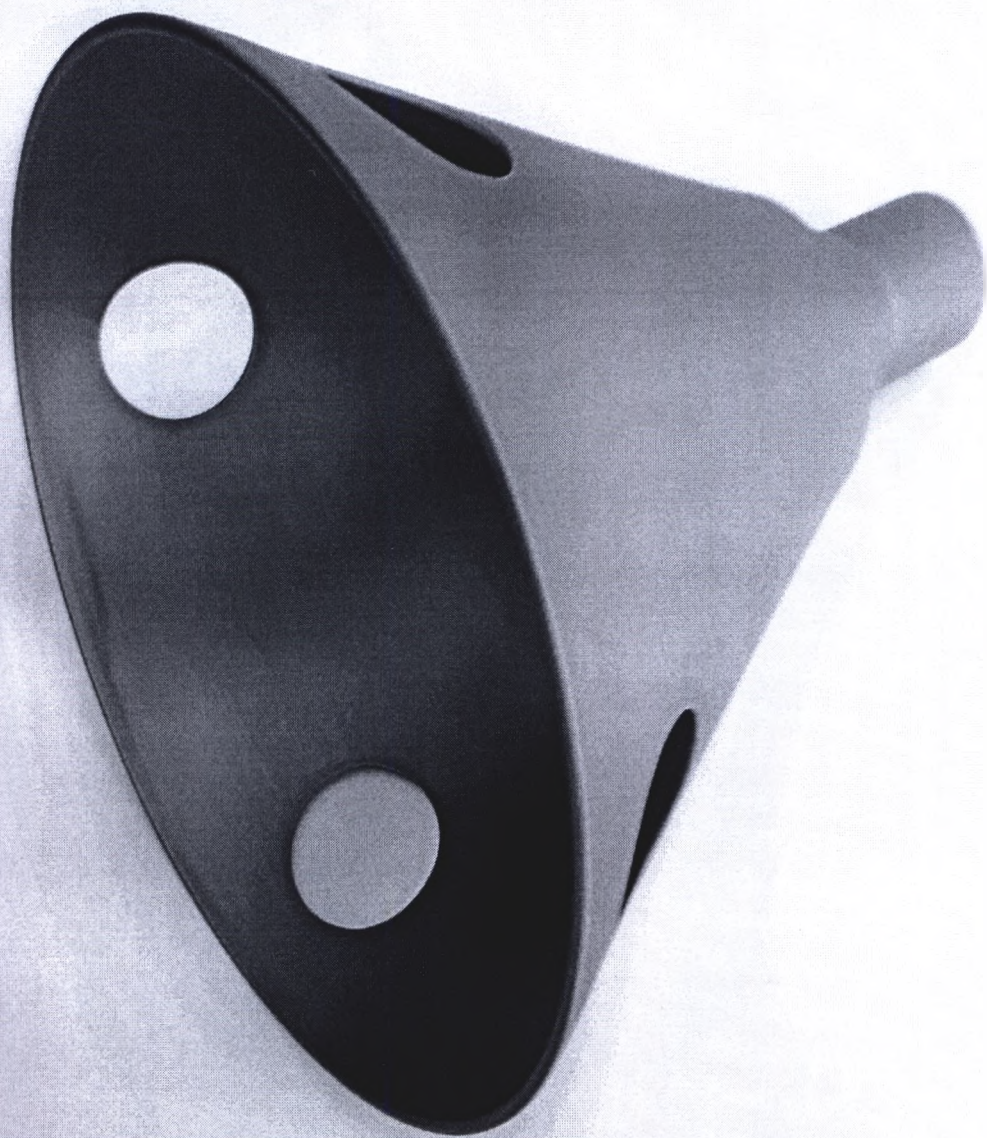

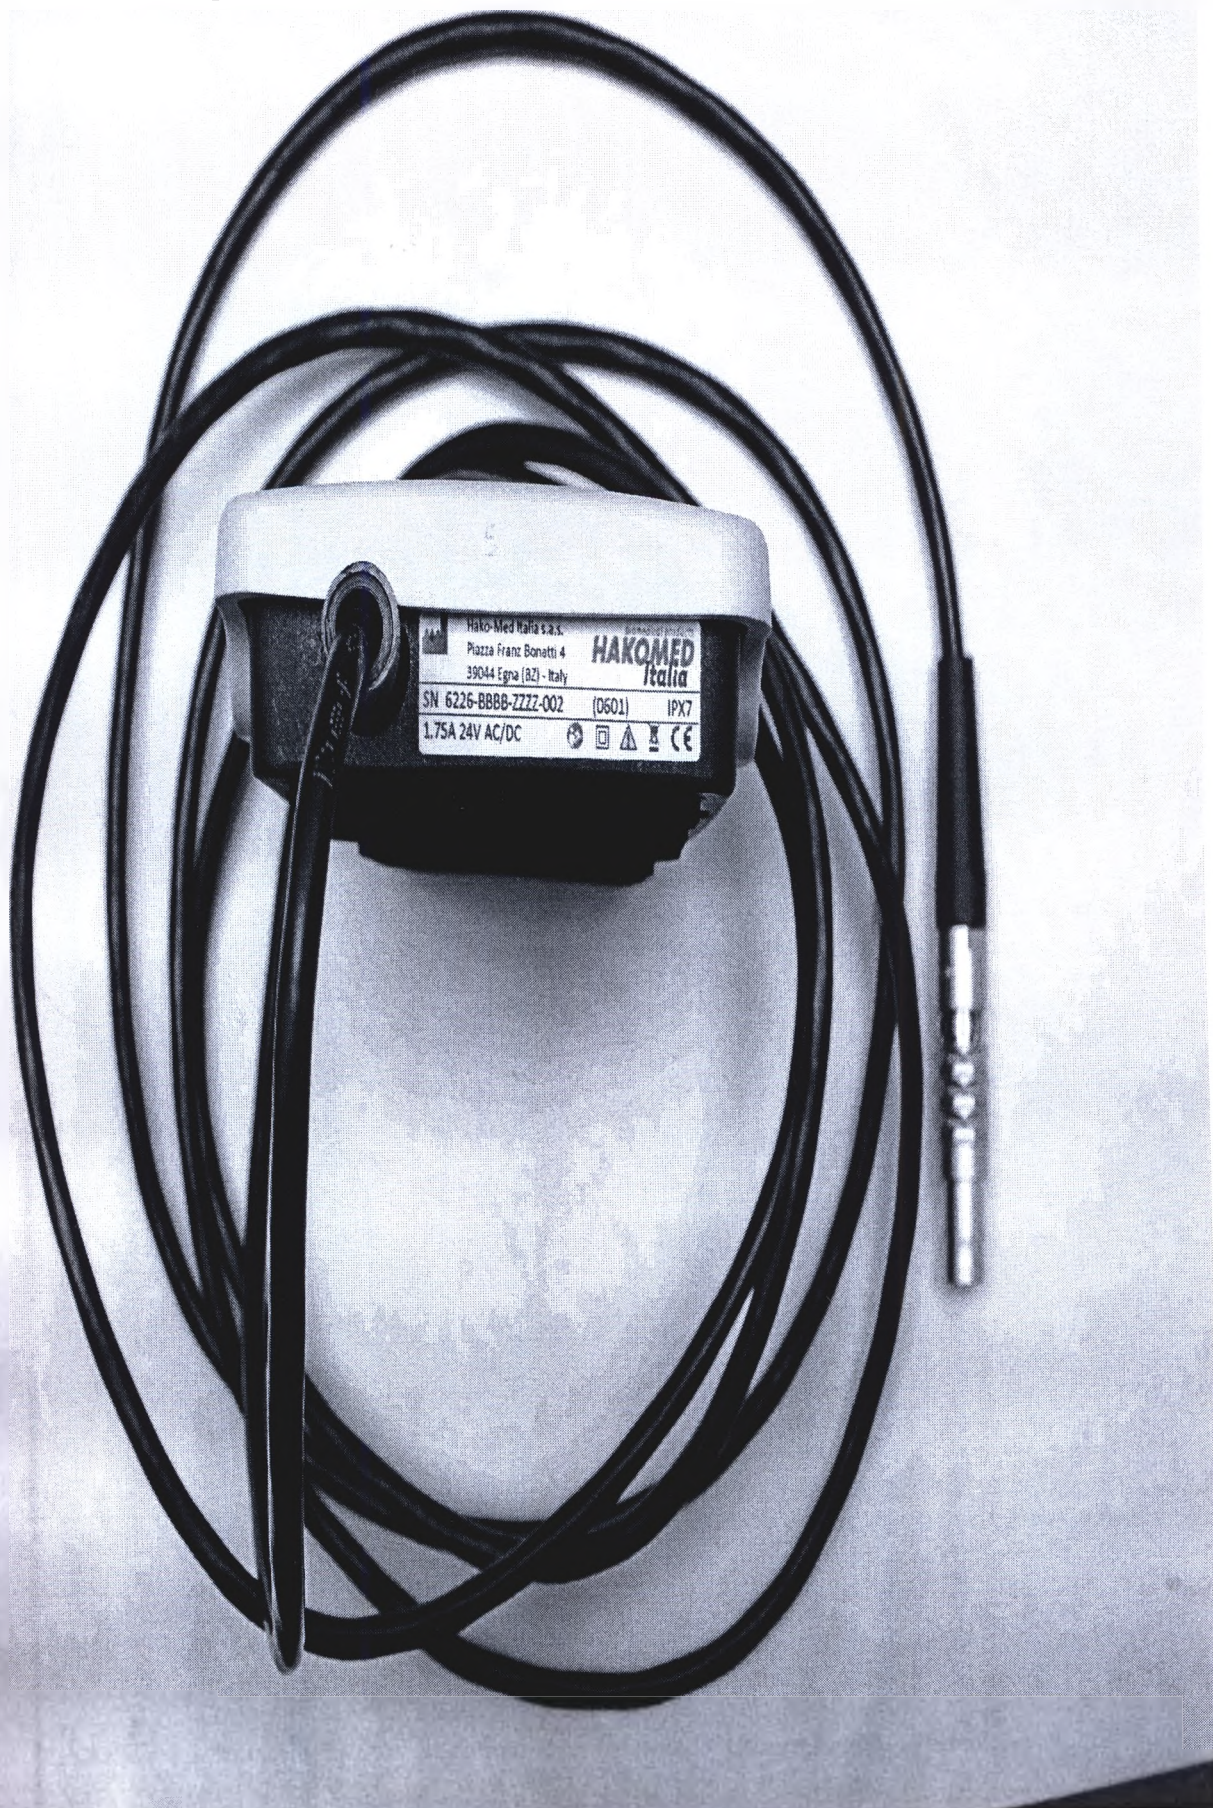



7.8. Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным аппликатором диаметром 6 см












Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:


qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

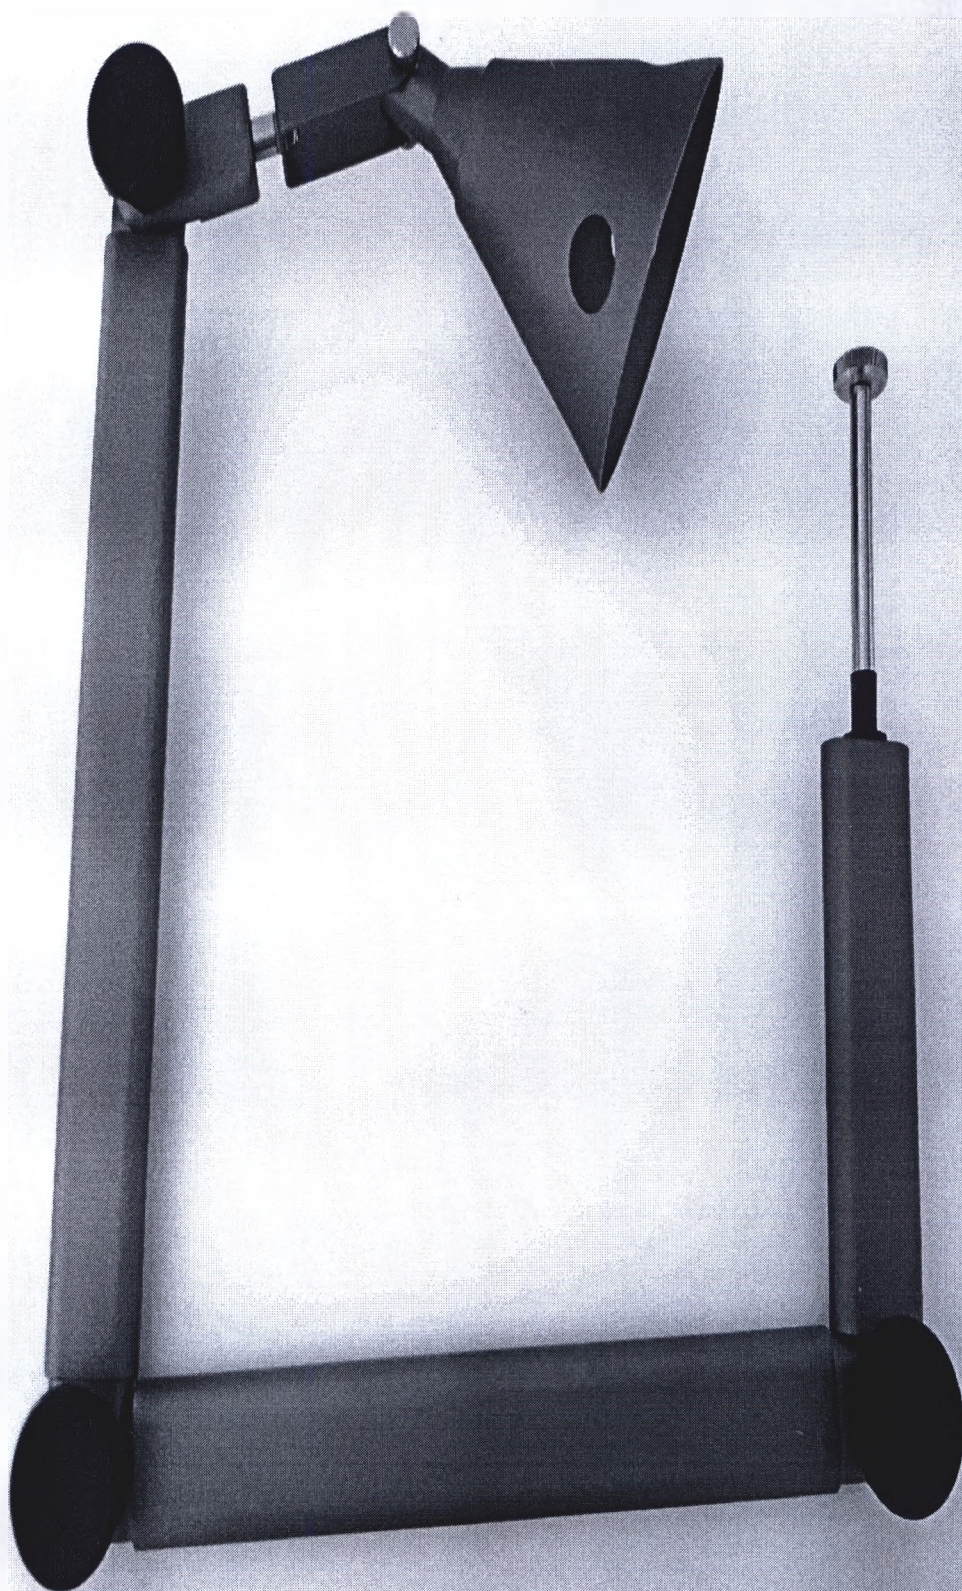

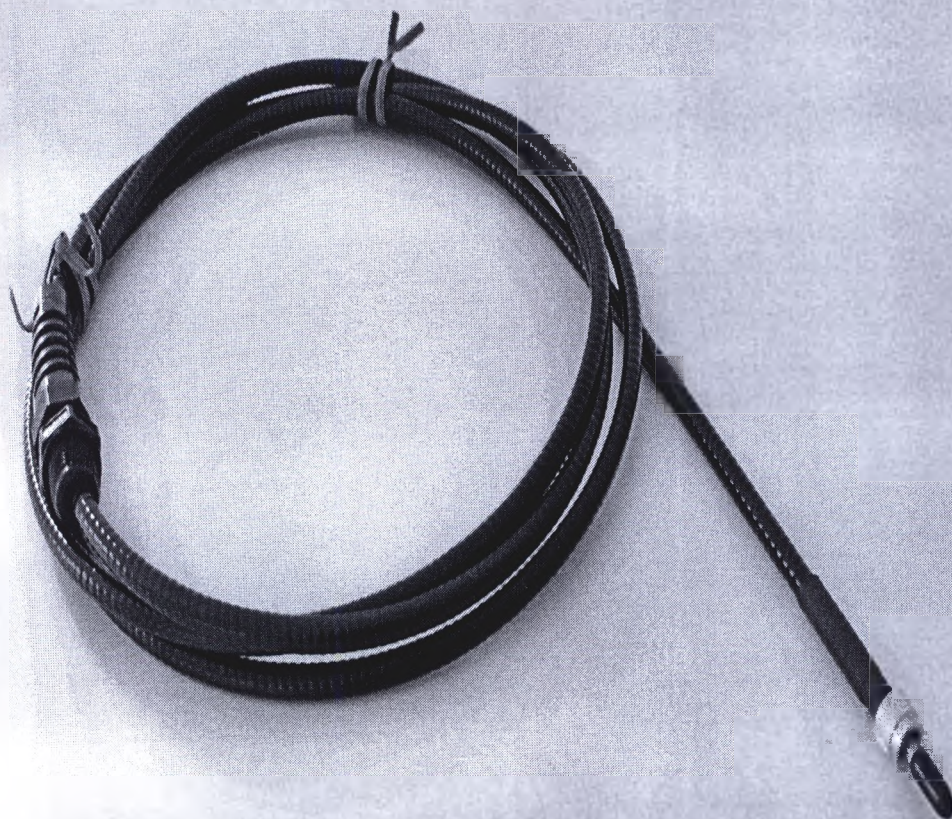





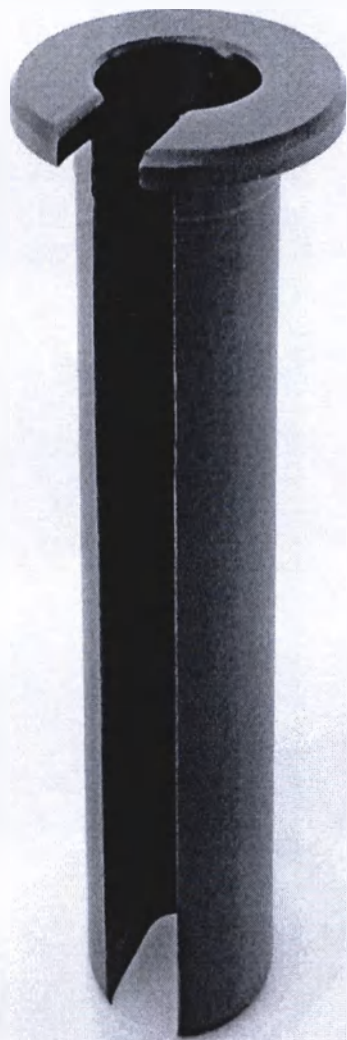






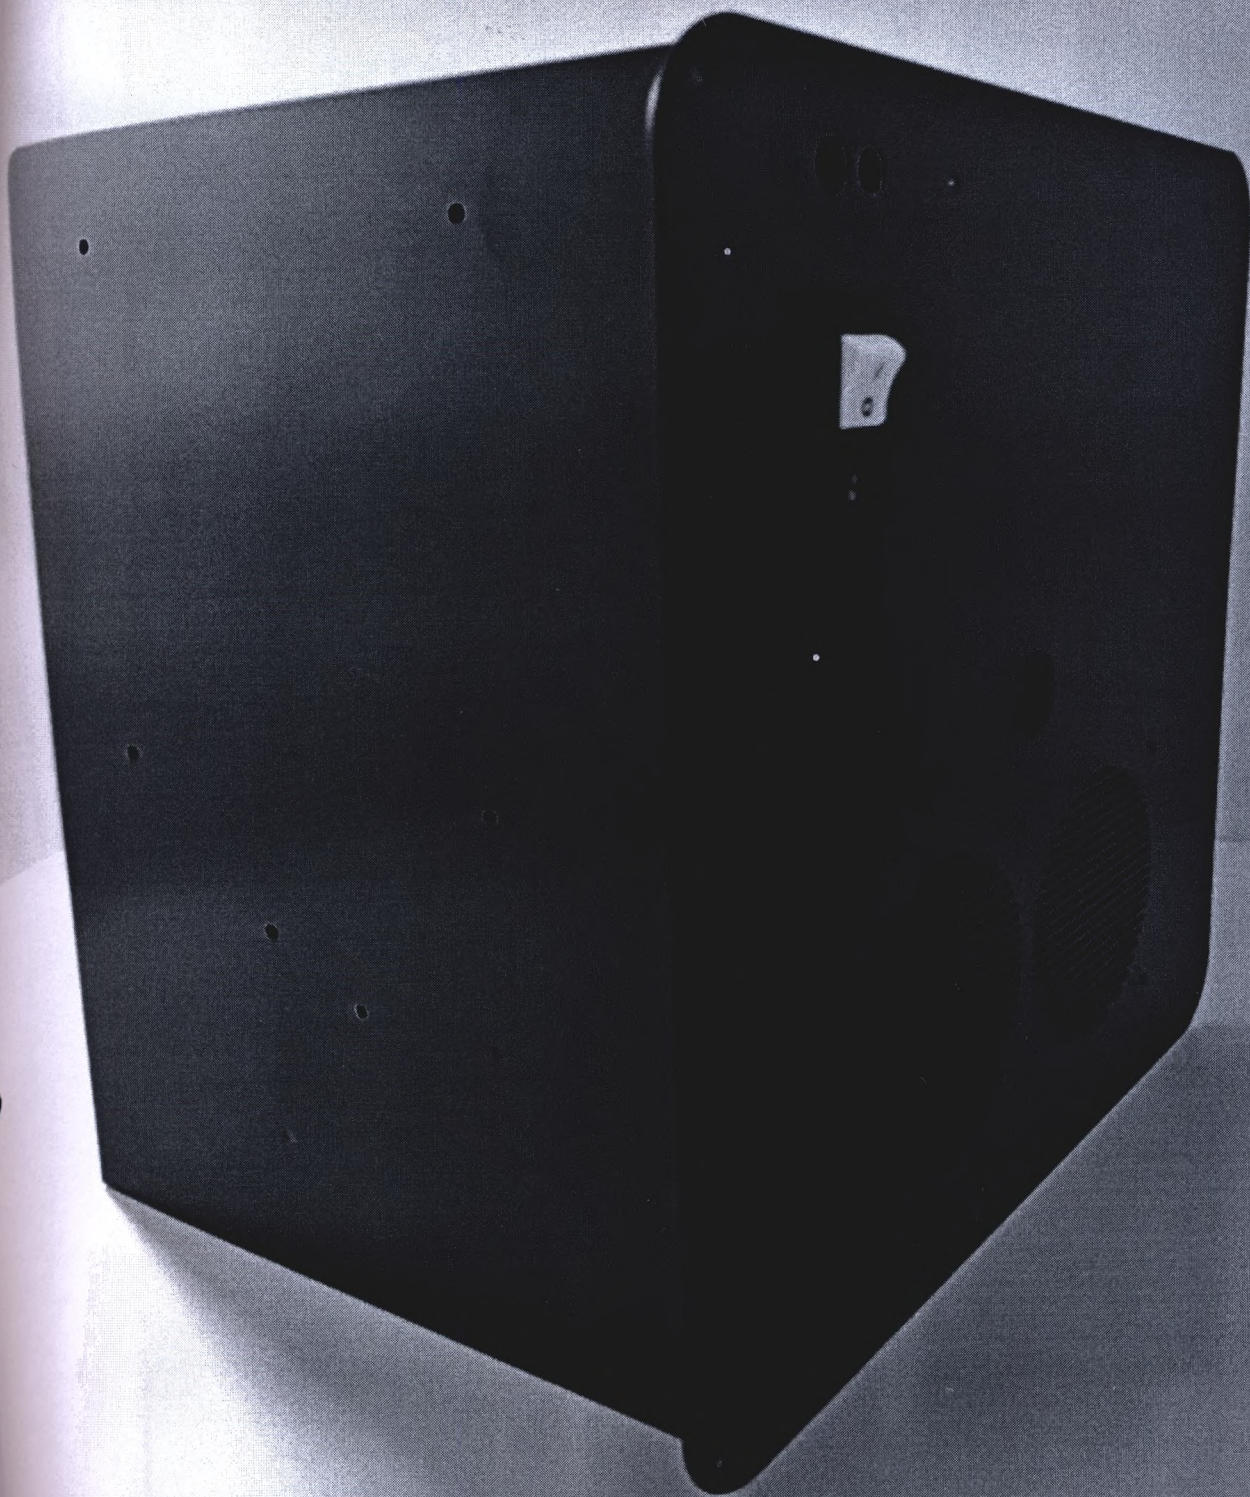

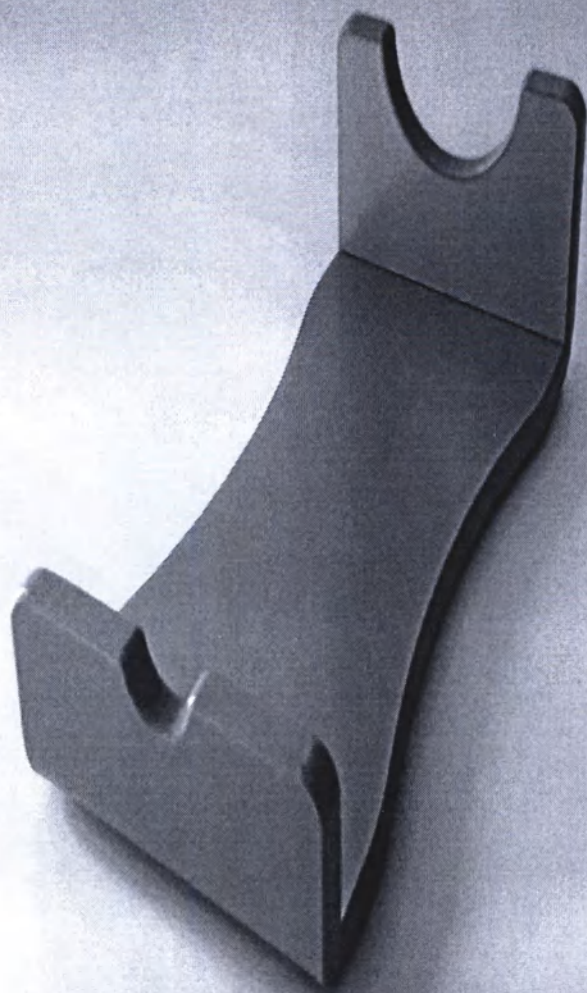



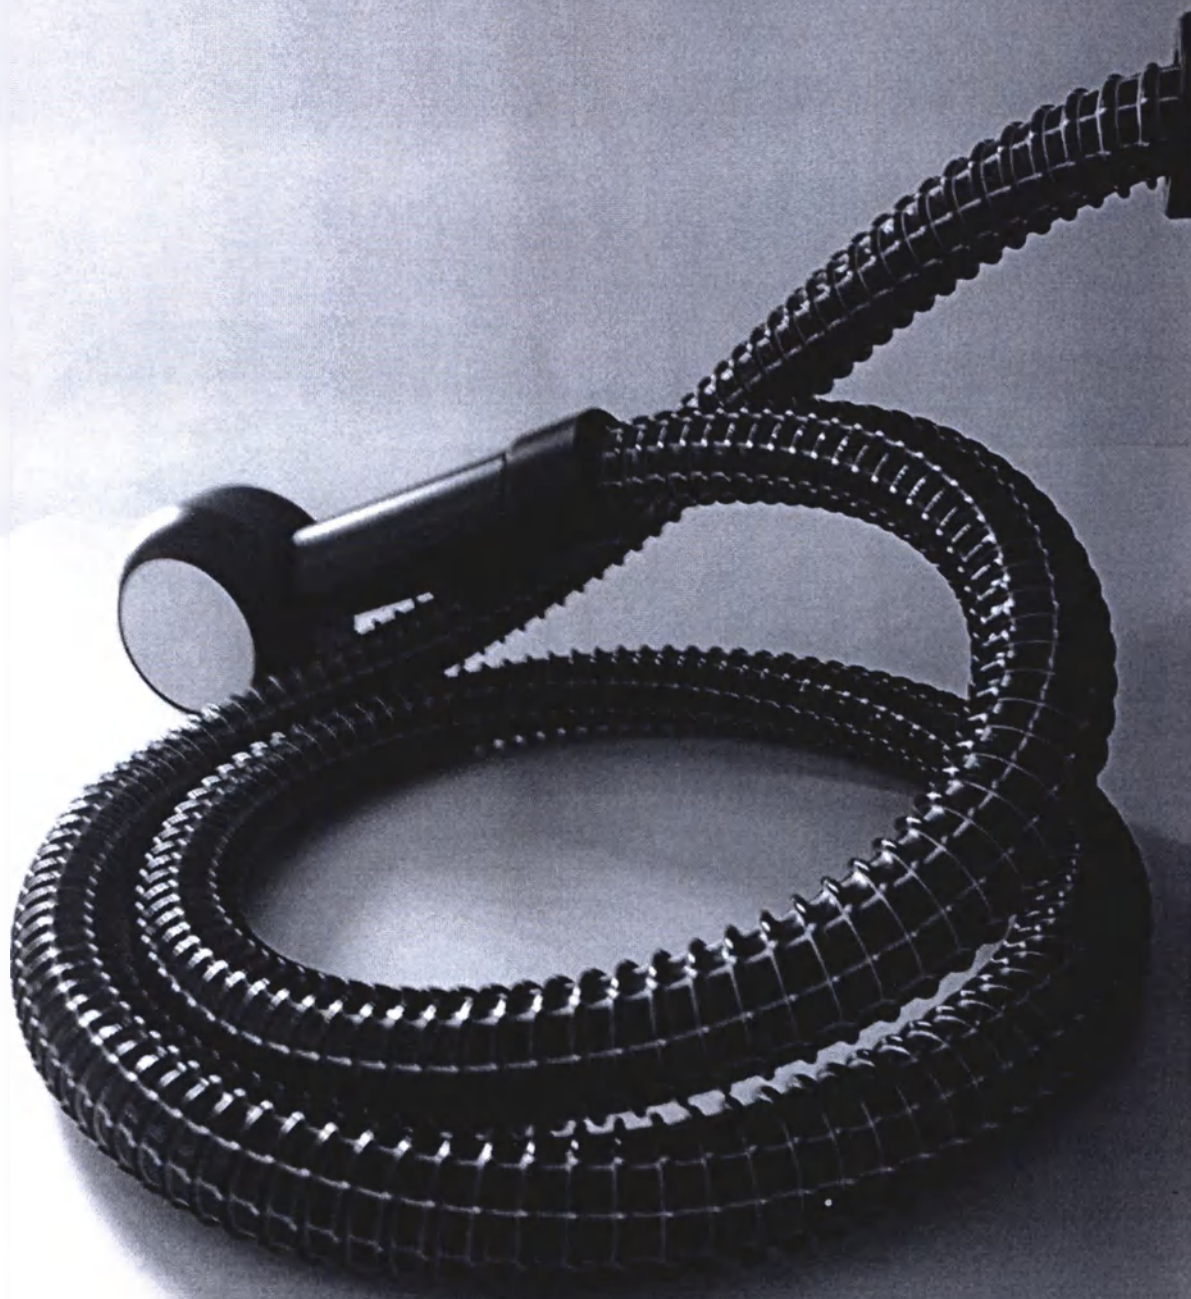


Принадлежности:

- Сумка транспортировочная



8. Аппарат физиотерапевтический многофункциональный «qmdhelioscryo-thermal» в составе:

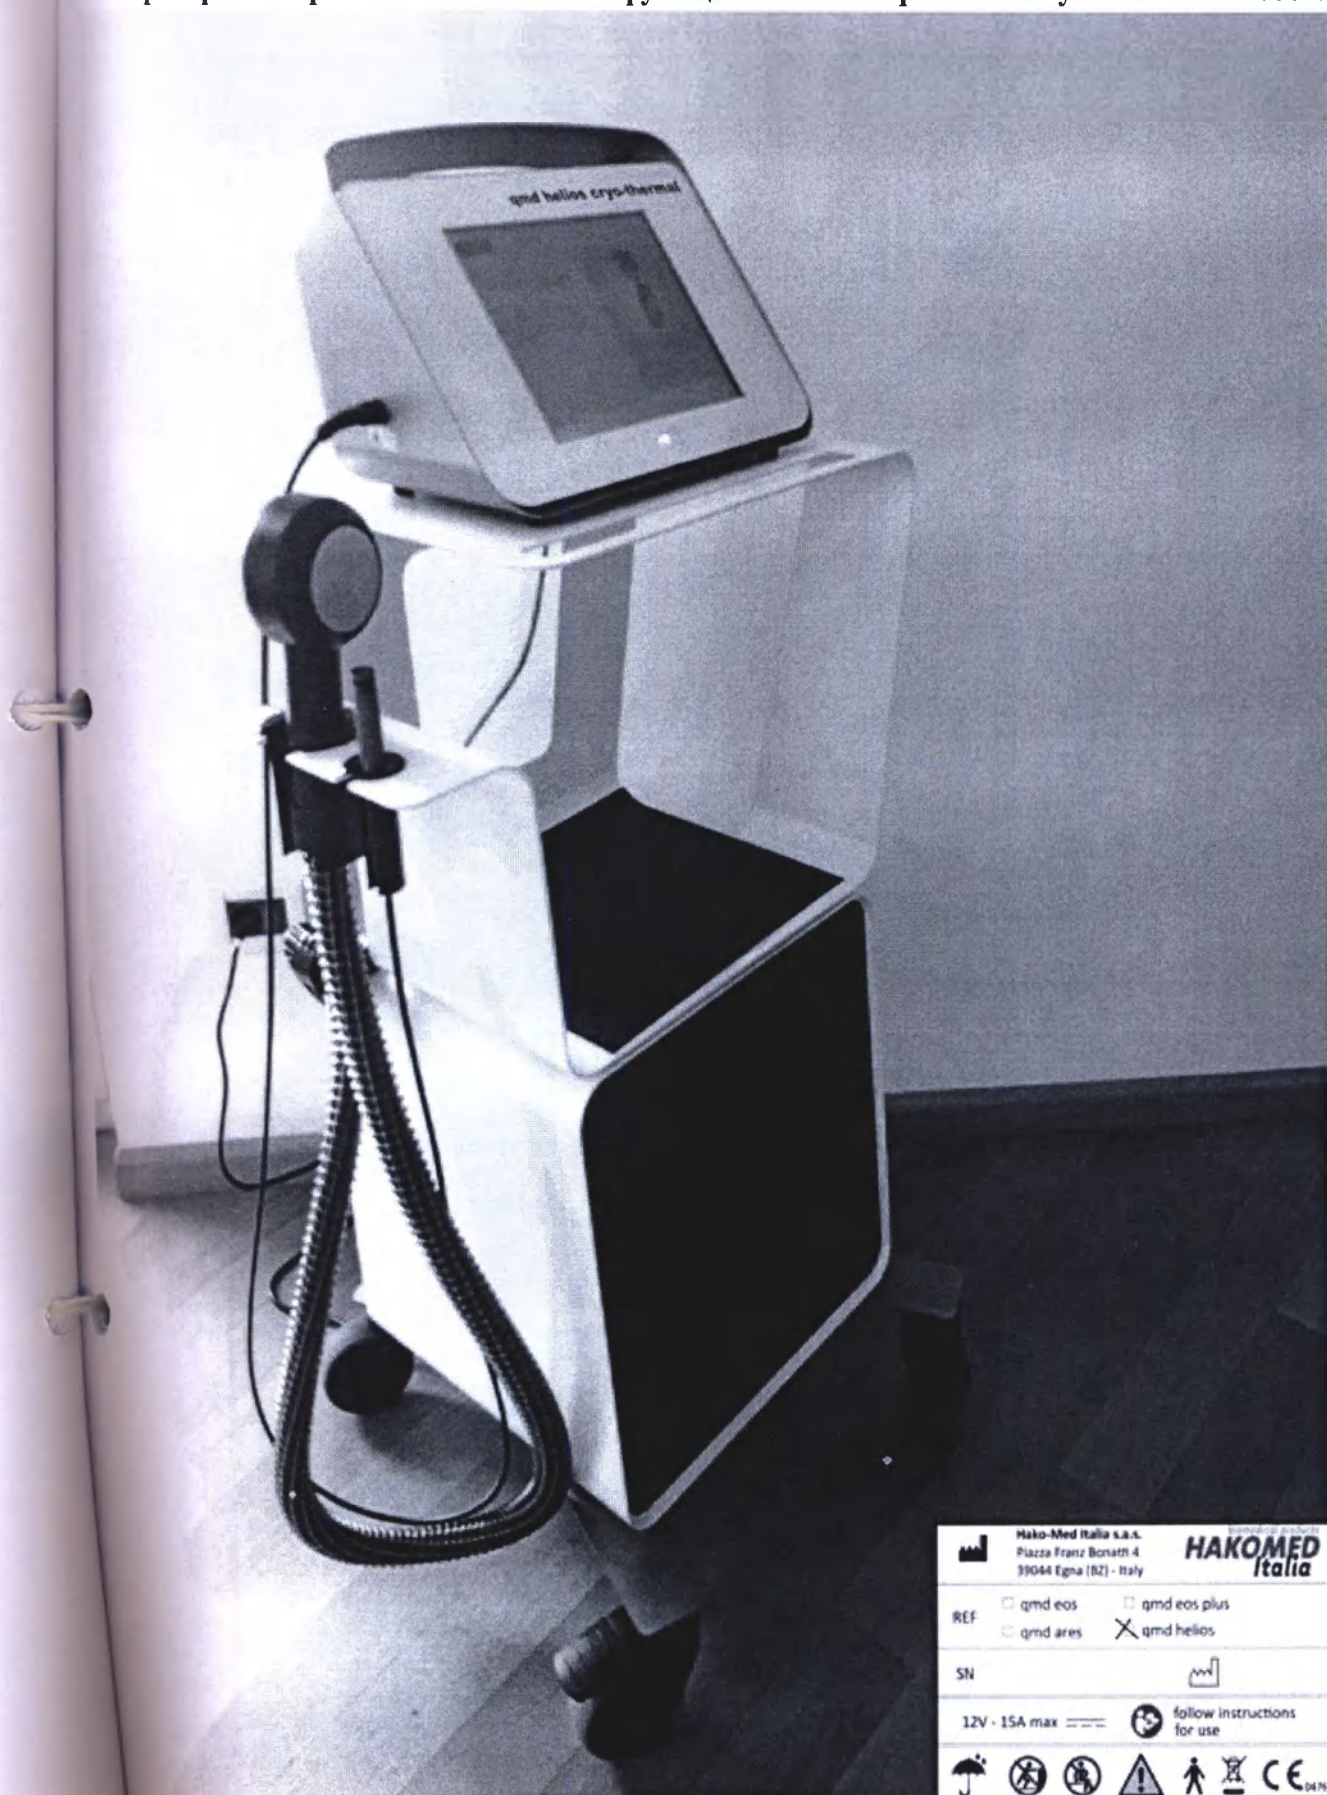


Hako-Med Italia s.a.s. Piazza Franz Bonatti 4 39044 Egna (BZ) - Italy		HAKOMED Italia
REF	☐ qmd eos ☐ qmd eos plus ☐ qmd ares ☒ qmd helios	
SN		
12V - 15A max	follow instructions for use	

1.1. Основной блок управления с лазерным излучателем мощностью 24 Вт, длины волн: 808 нм, 1064 нм, 1120 нм со световодом и держателем насадок







Очки защитные

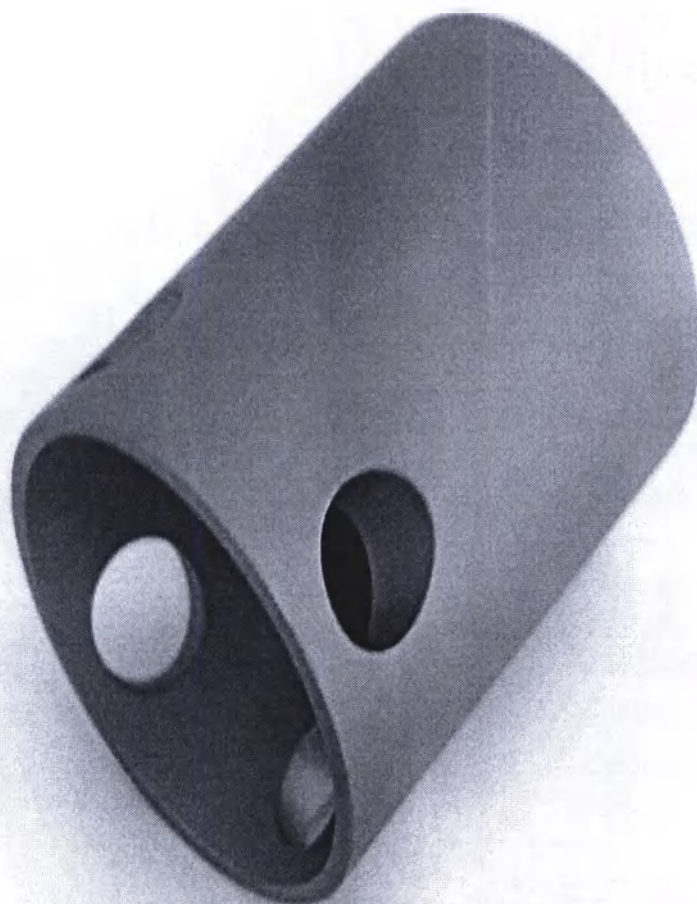




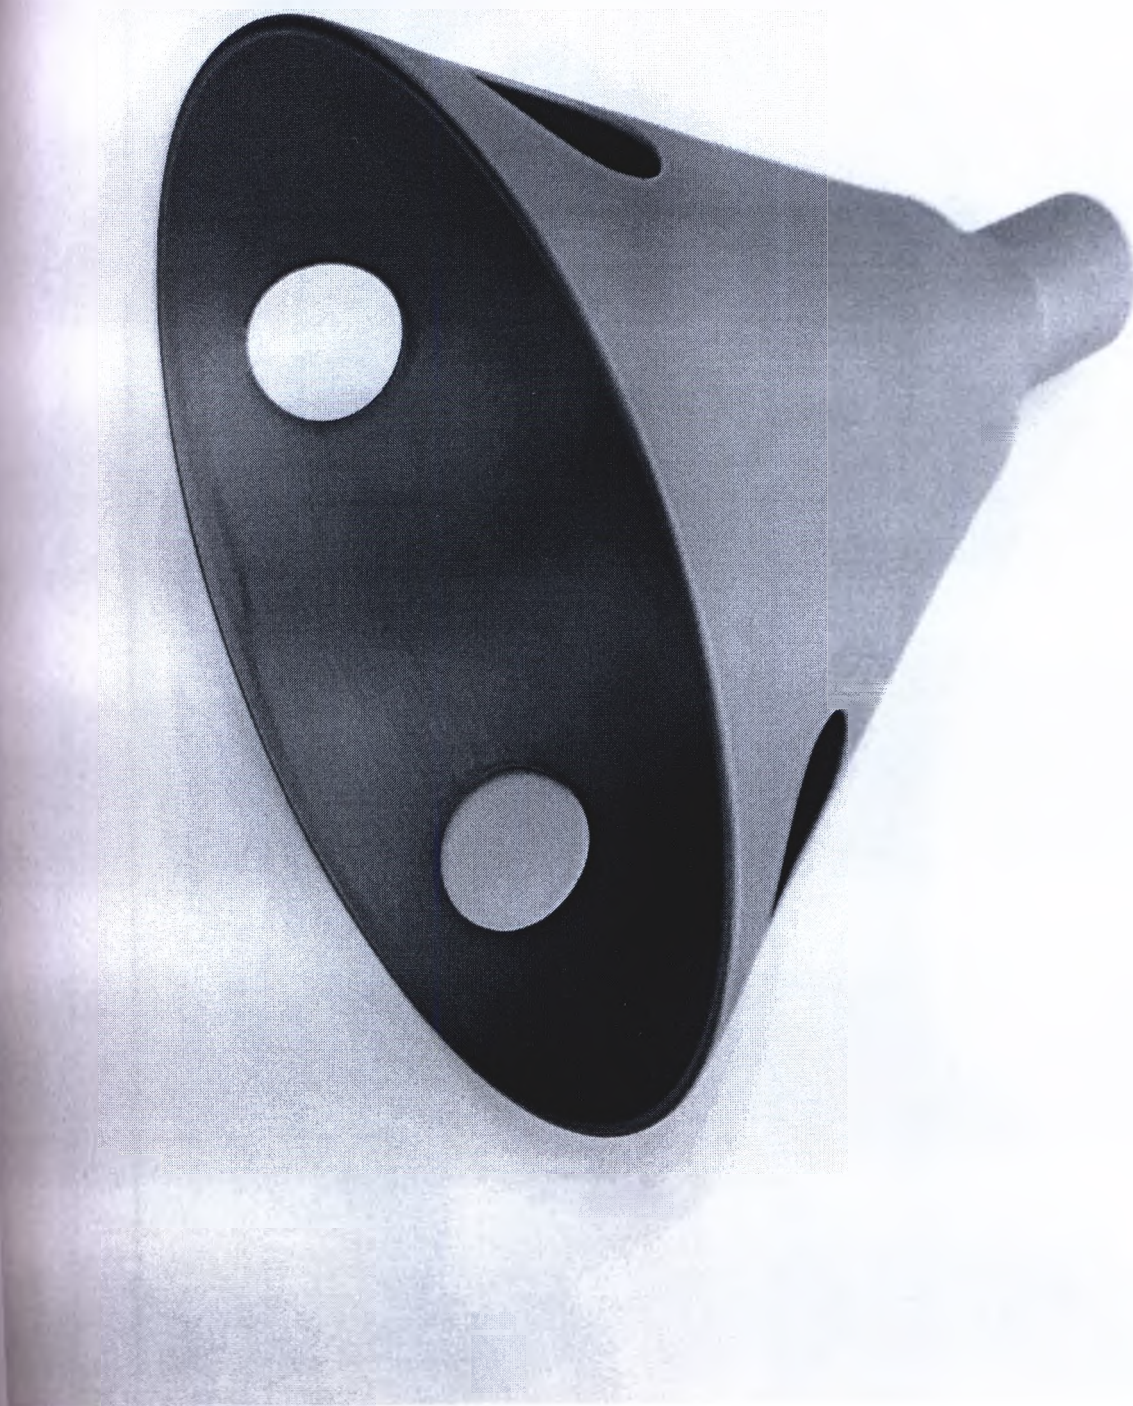


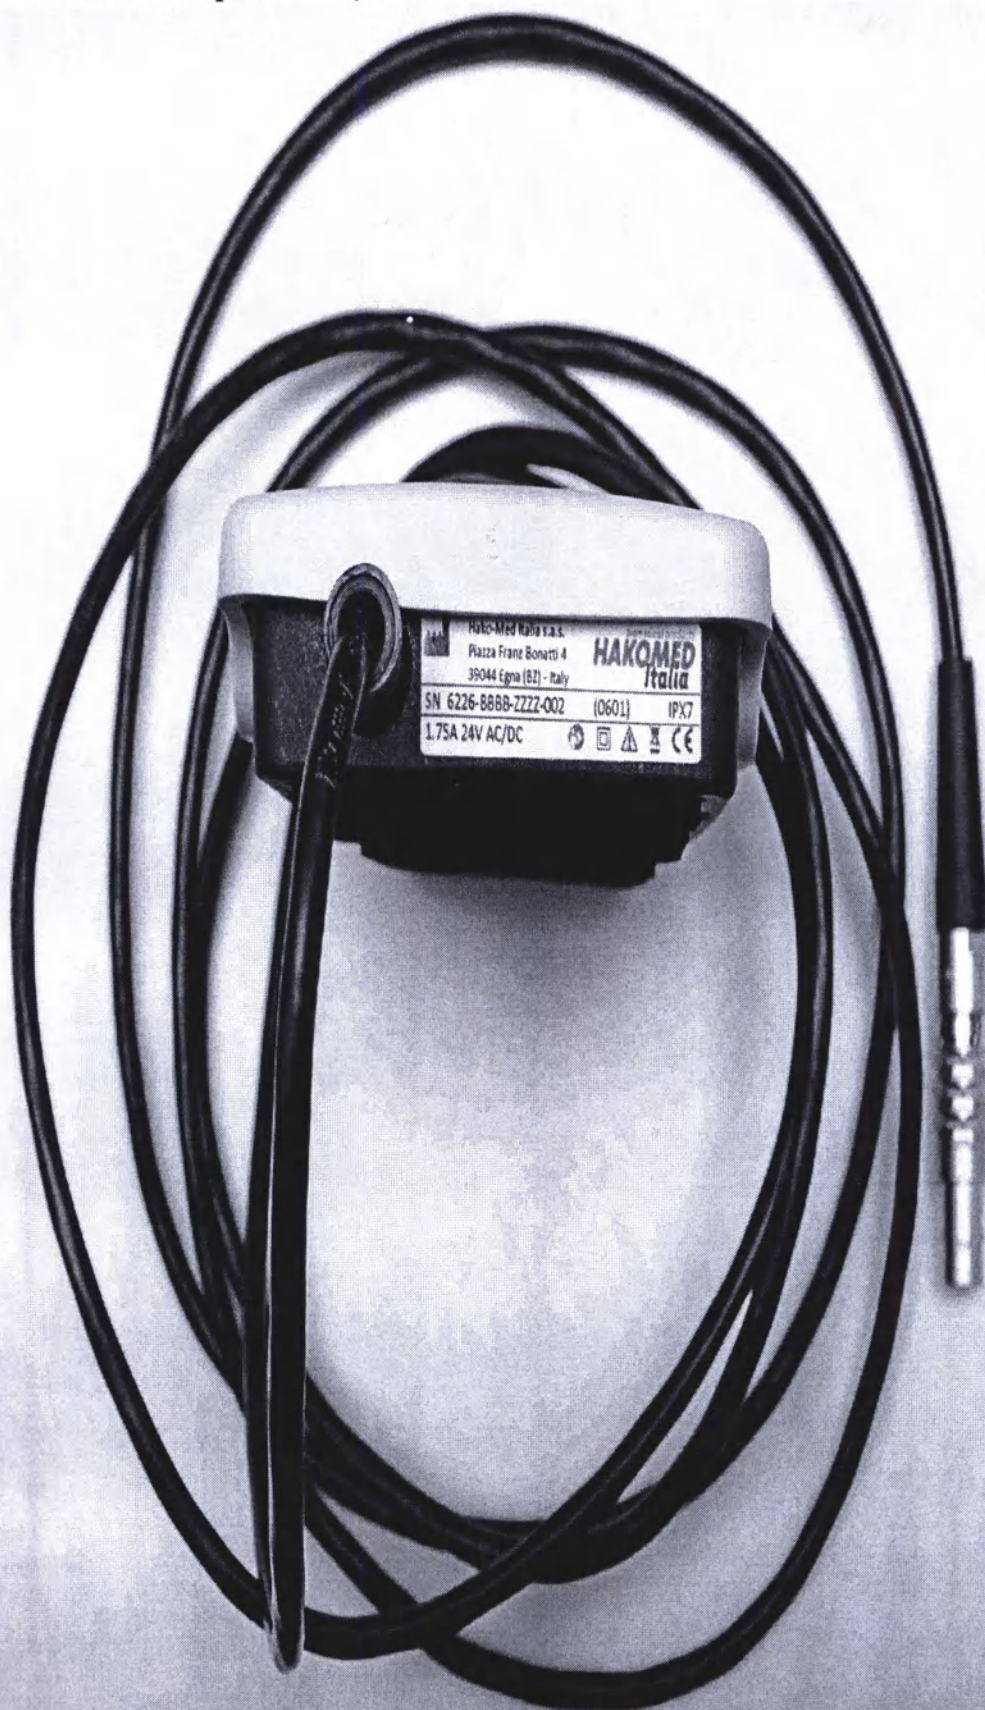




Тележка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным датчиком диаметром 6 см

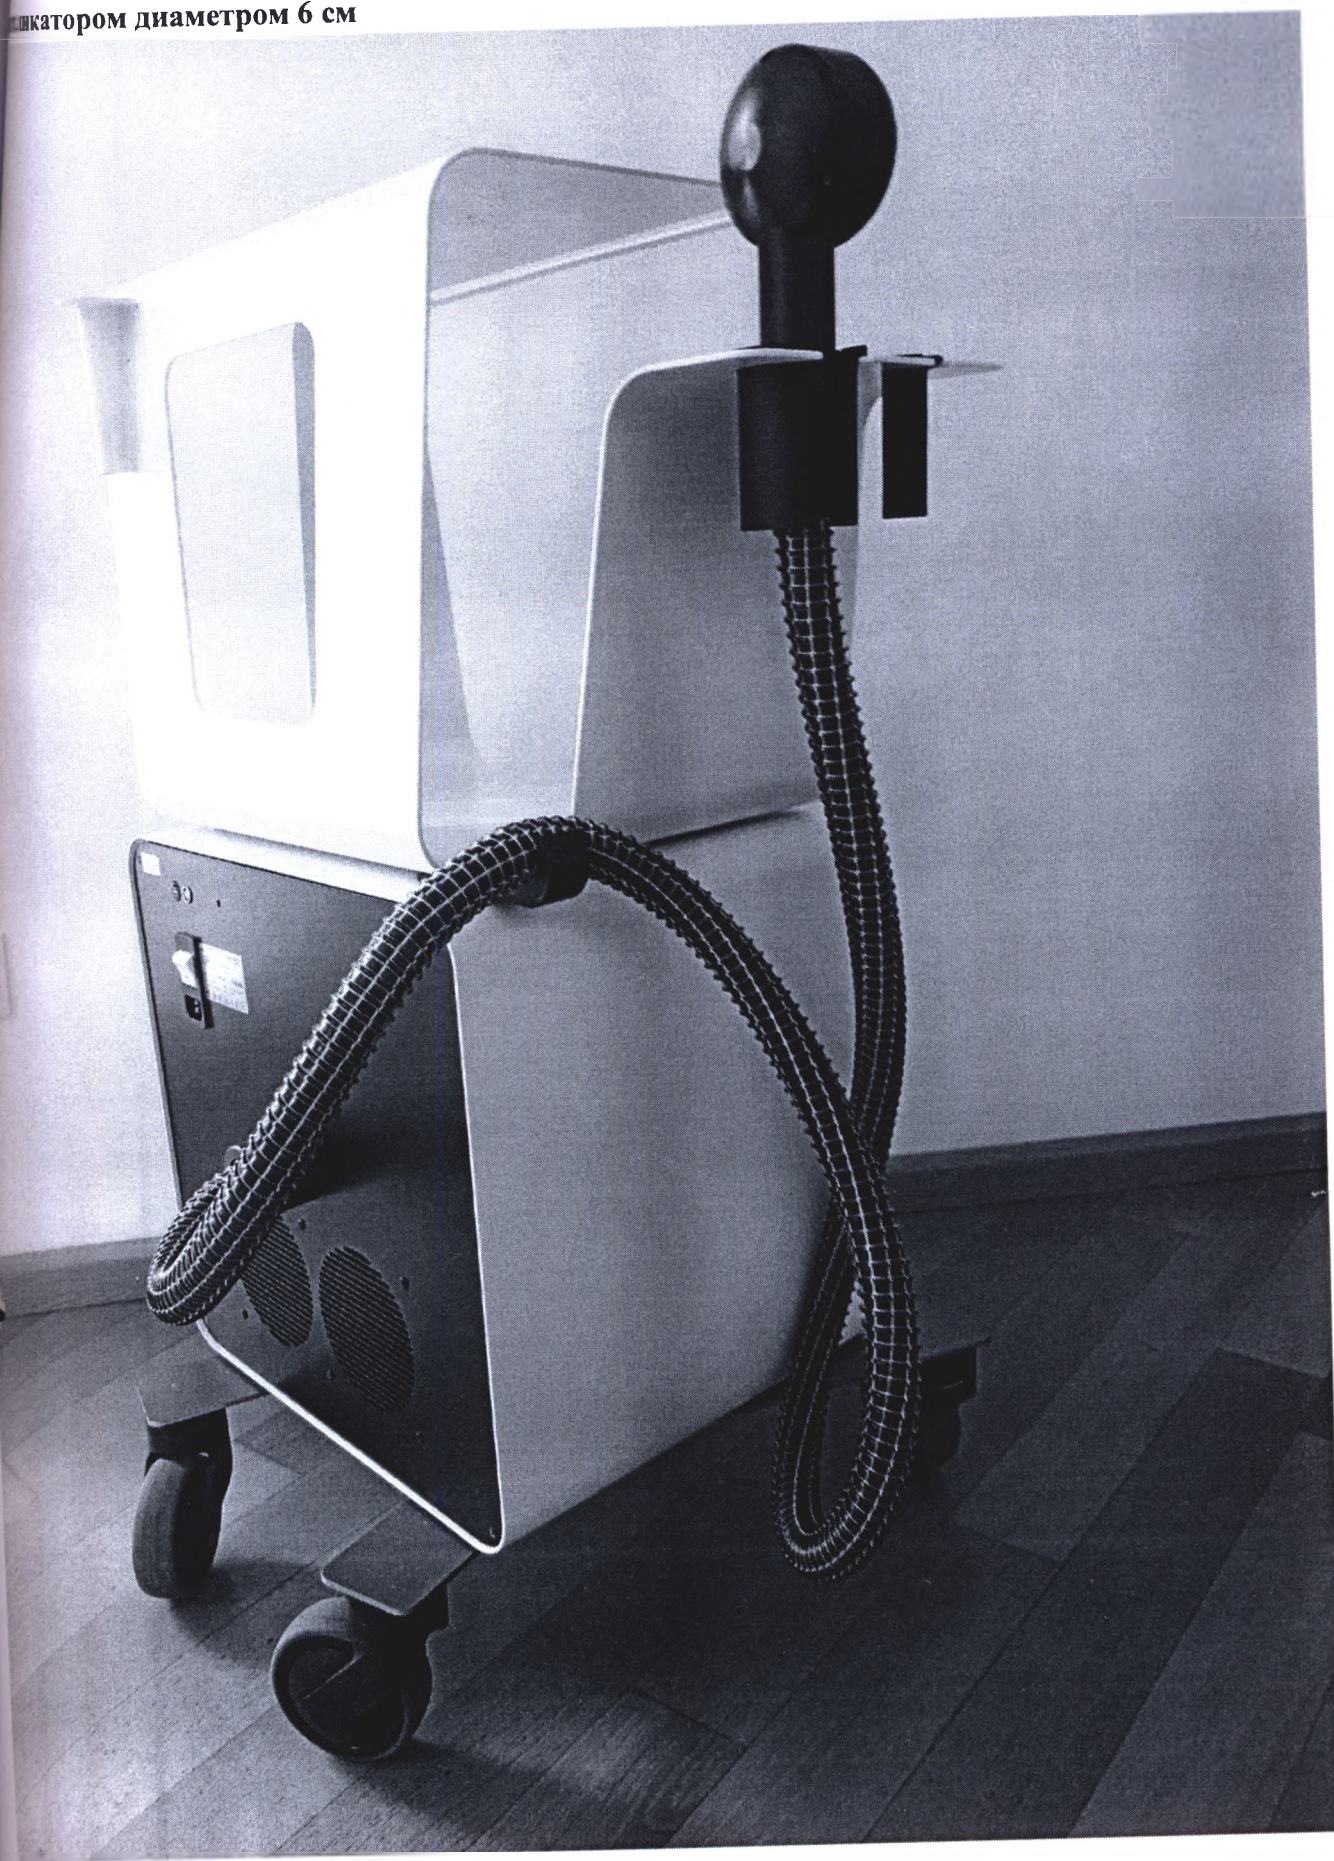

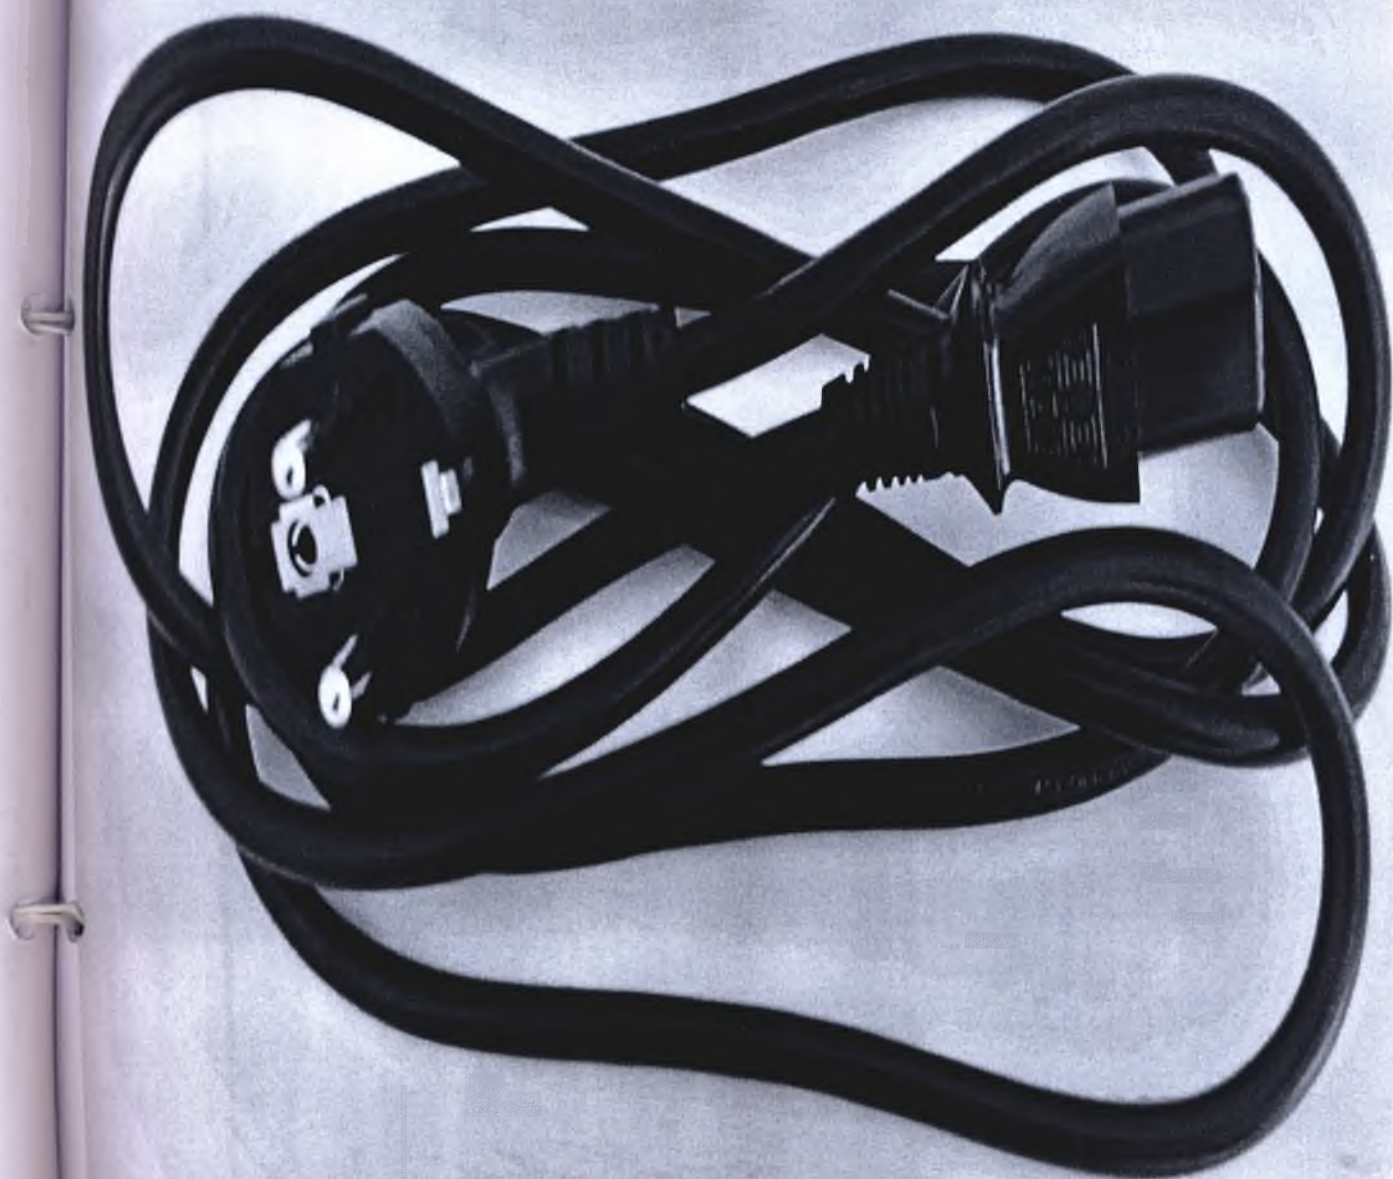


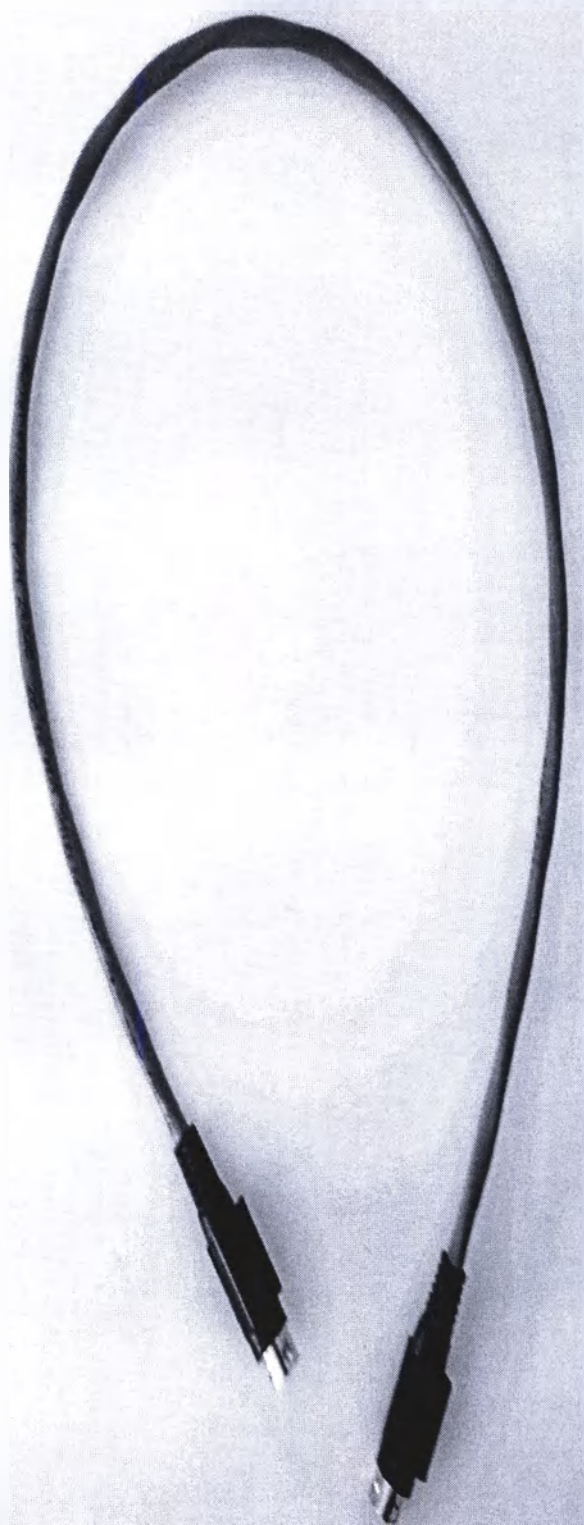






Руководство по эксплуатации

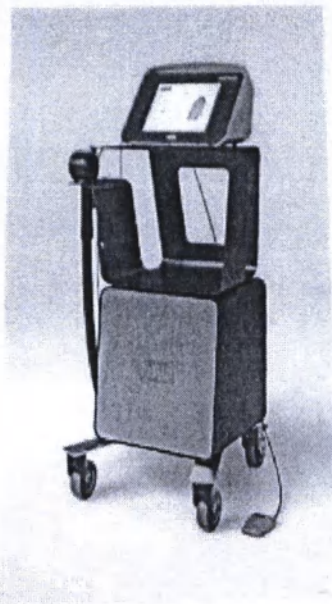


Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:


qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02

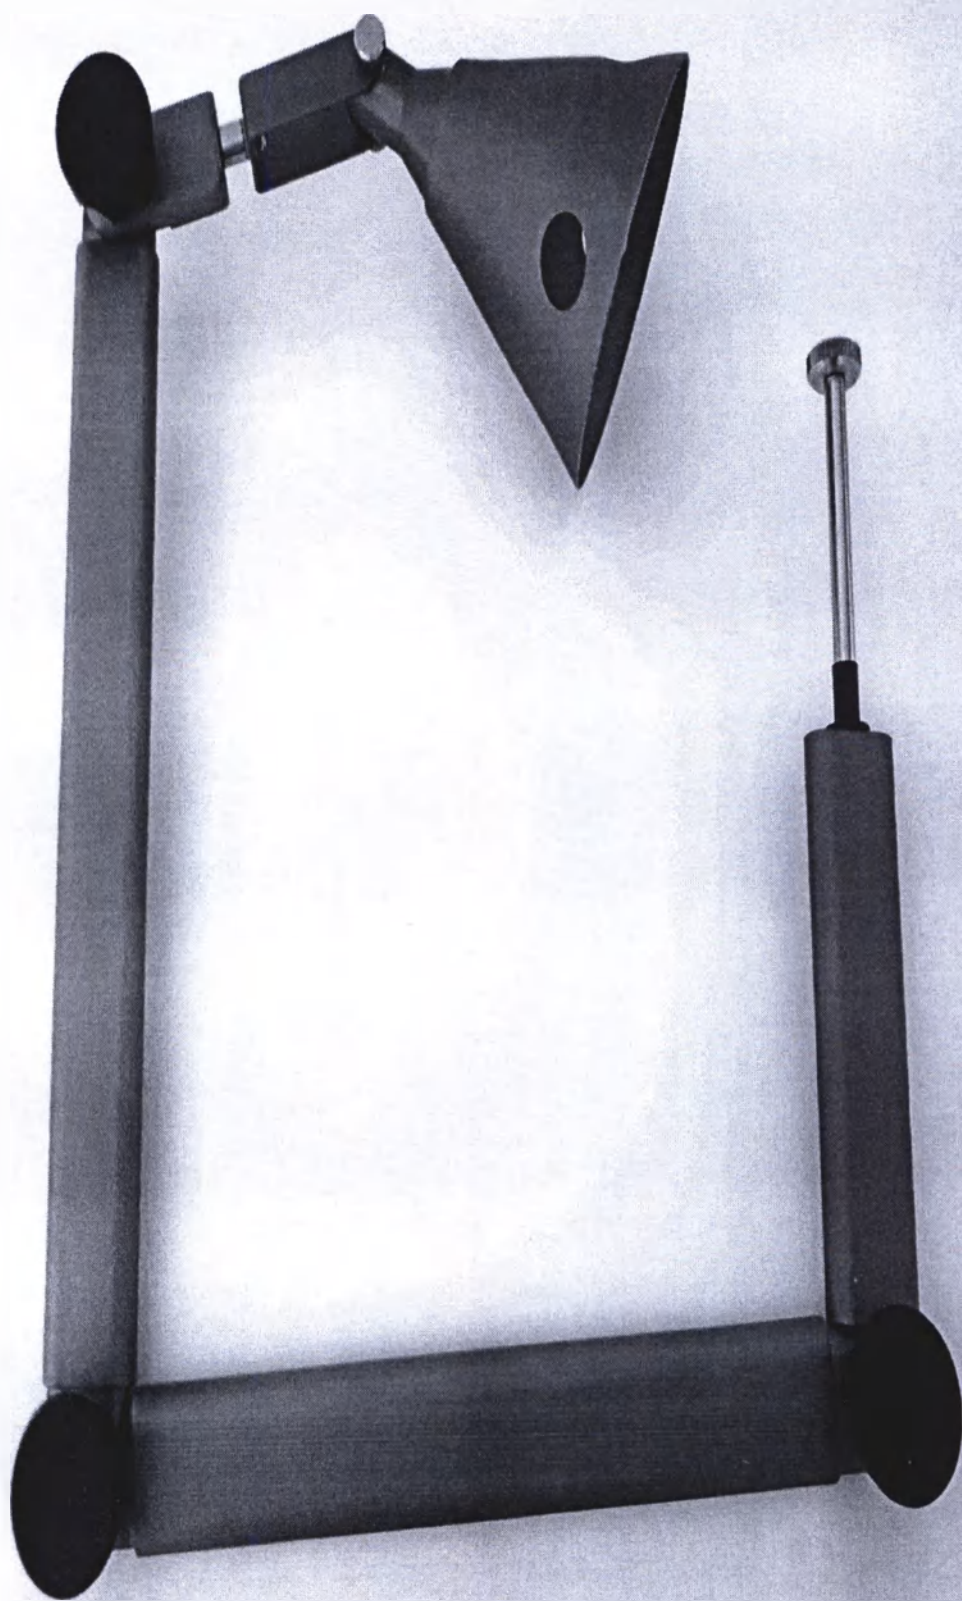

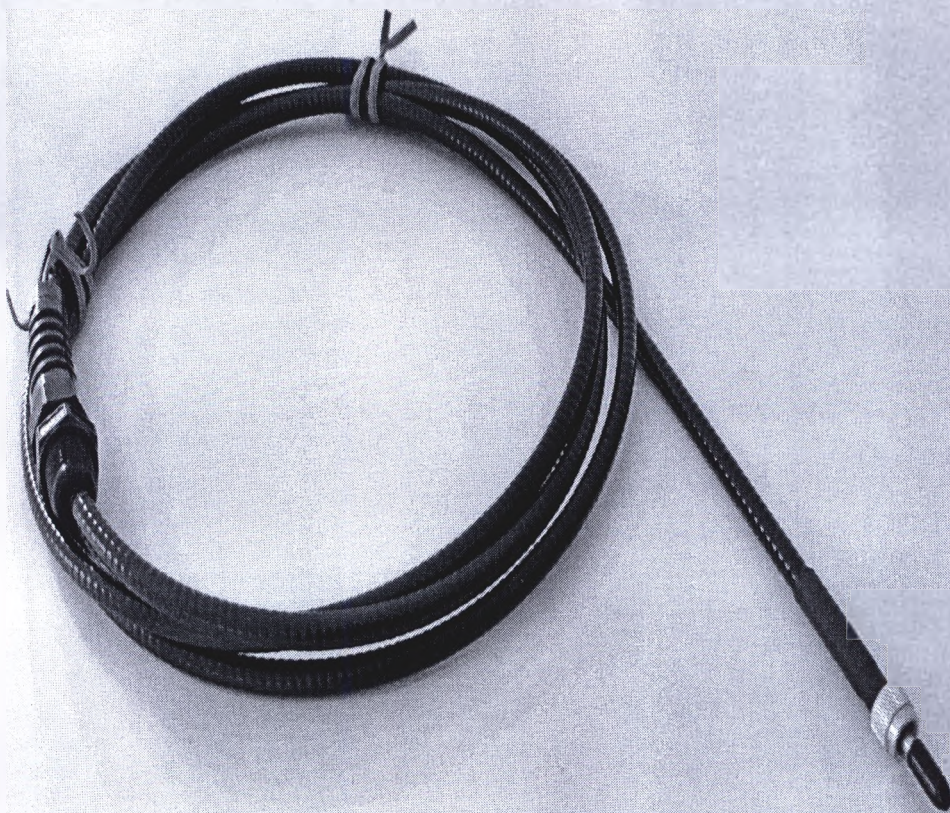





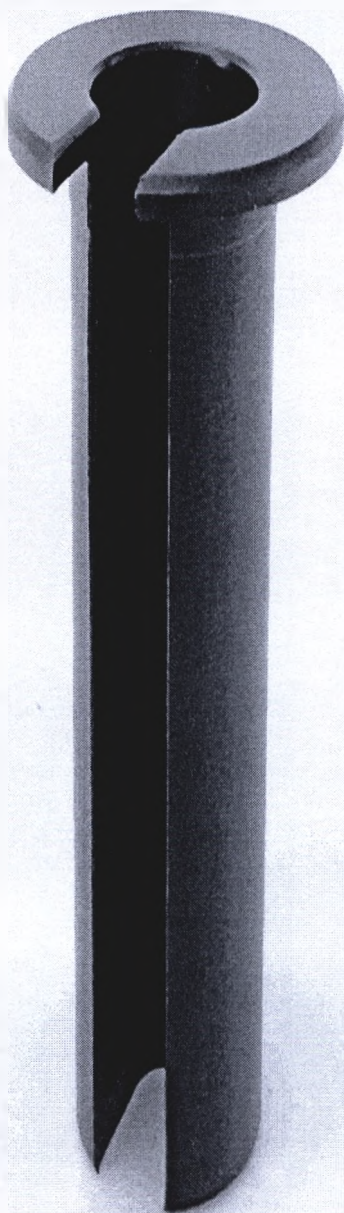






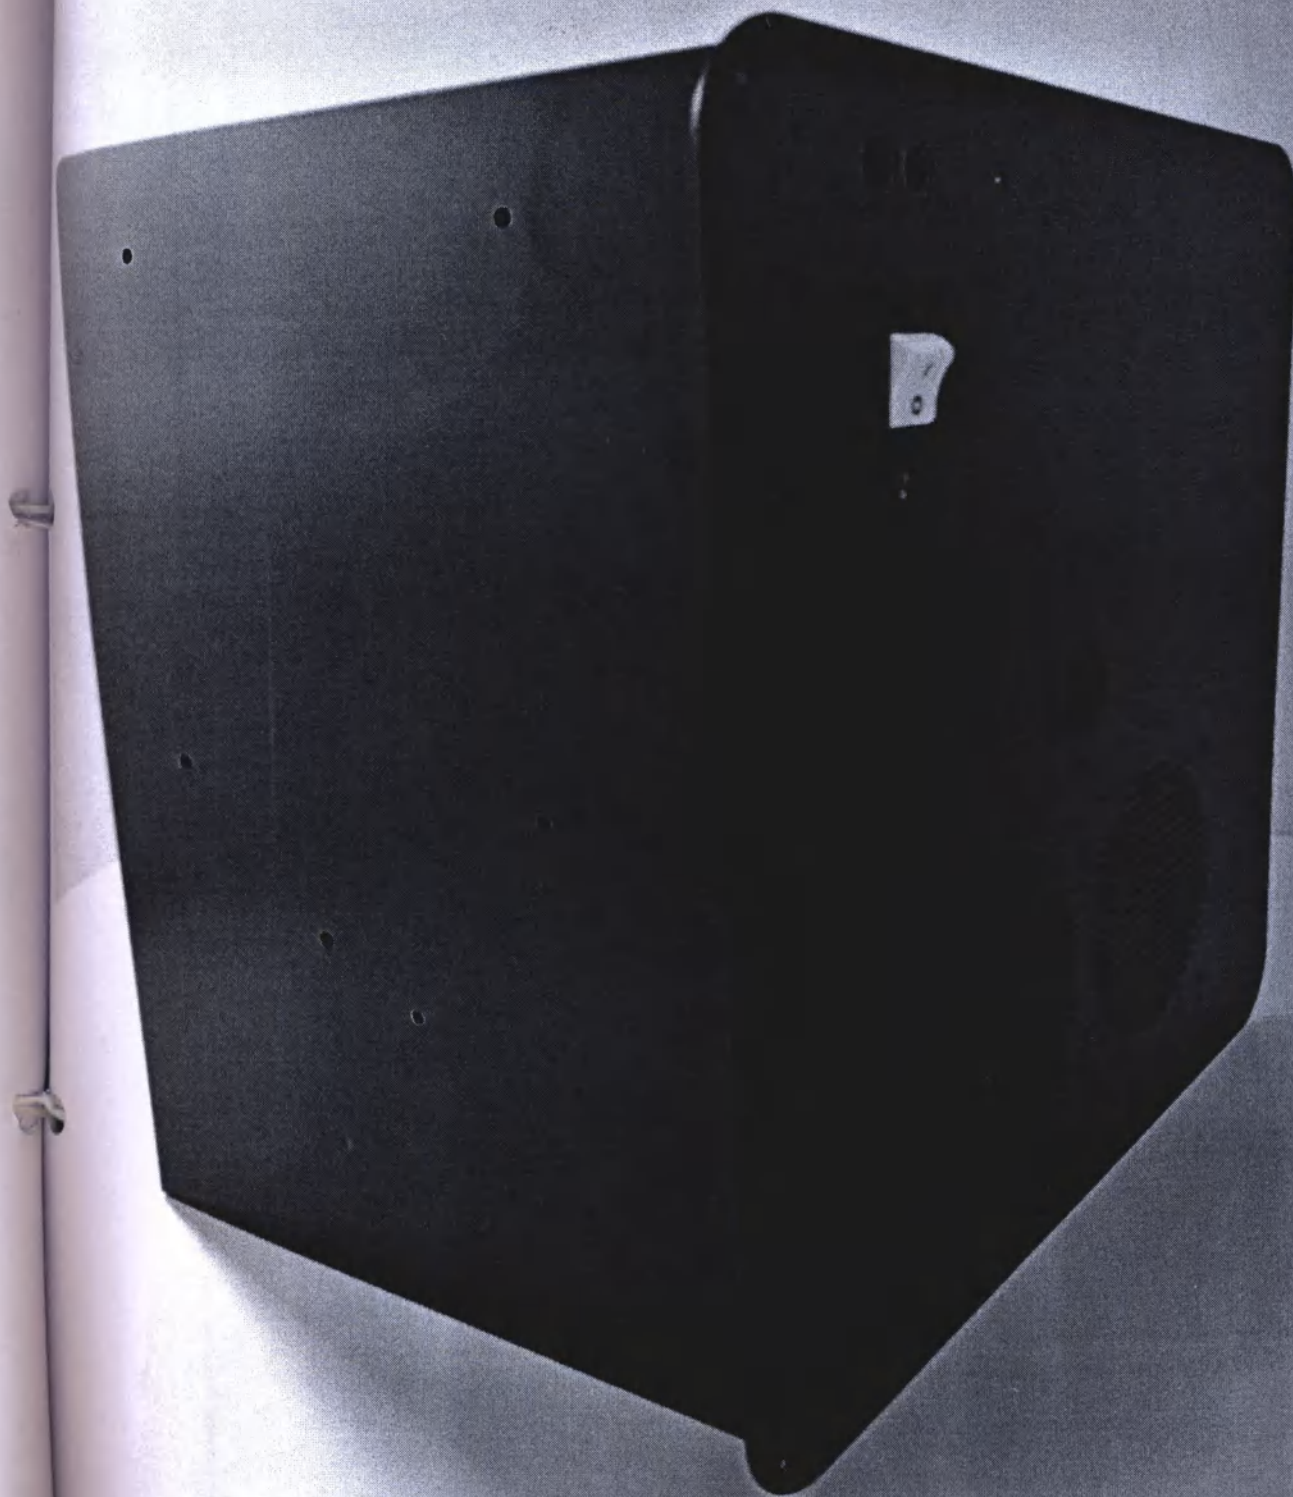

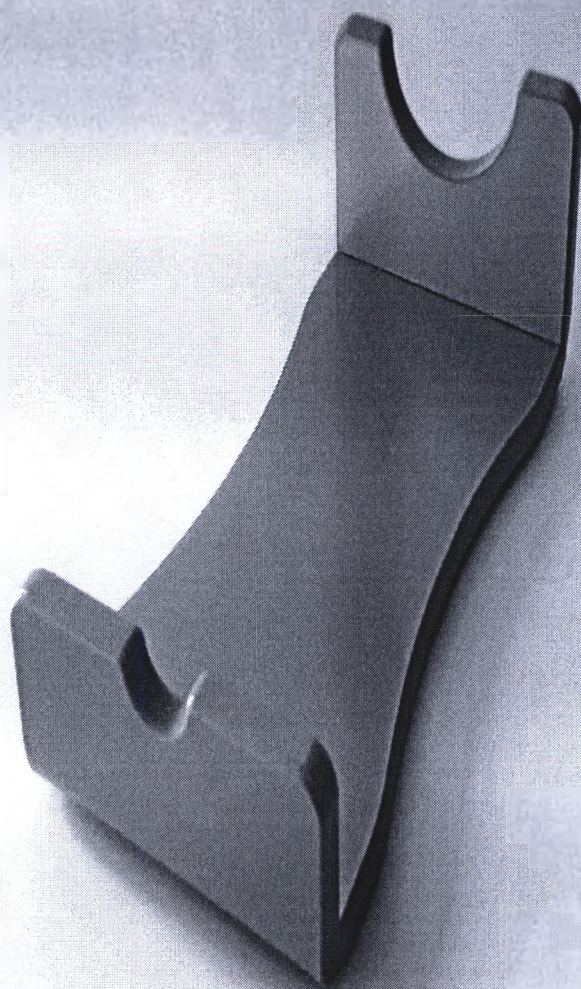

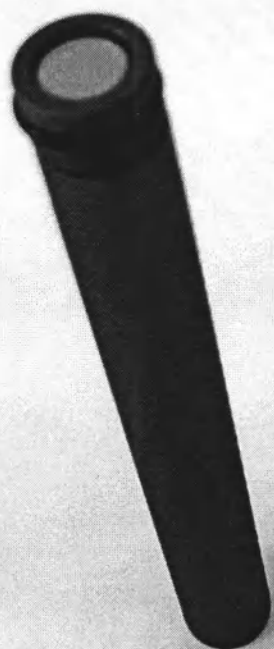



надлежаности:

шка транспортировочная



апарат физиотерапевтический многофункциональный «qmd cryo-thermal» в составе:






лежка аппаратная с блоком питания, контуром регулировки температуры и контактным датчиком диаметром 6 см





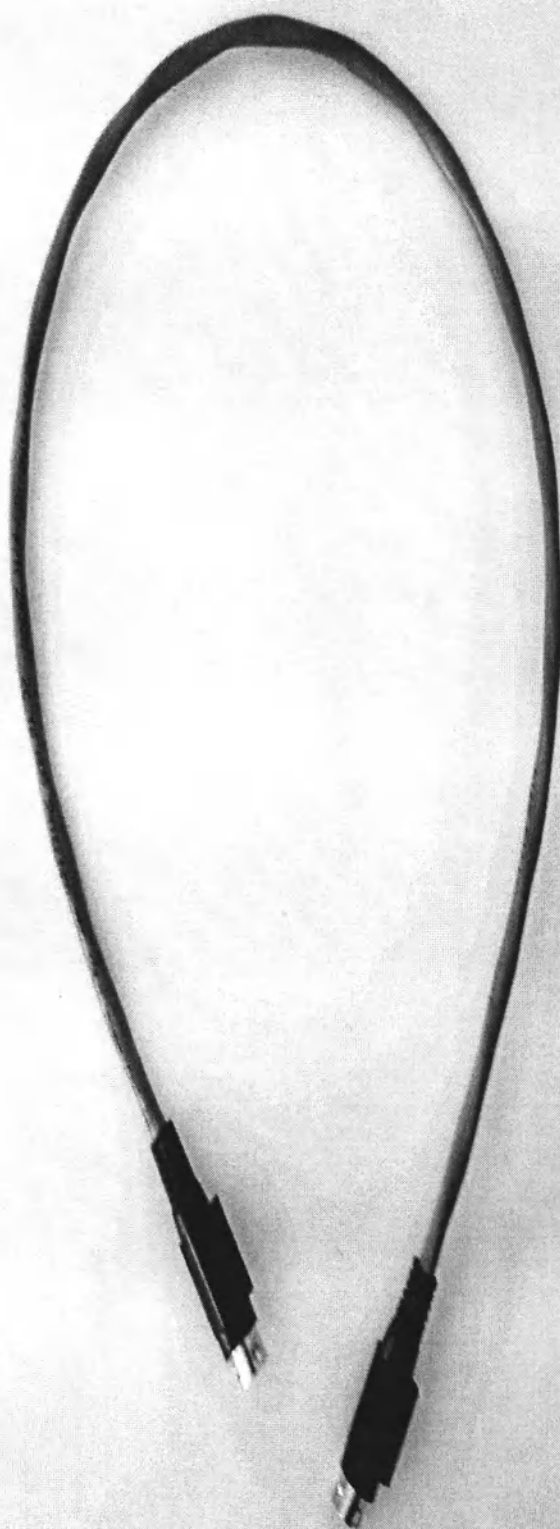



to feel better
qmd
medical device

Руководство по эксплуатации




Аппарат физиотерапевтический многофункциональный
«qmd», варианты исполнения:

qmd eos,
qmd eos plus,
qmd ares,
qmd helios,
qmd eos cryo-thermal,
qmd eos plus cryo-thermal,
qmd ares cryo-thermal,
qmd helios cryo-thermal,
qmd cryo-thermal

Дата создания: 02.08.2017
Версия: 02





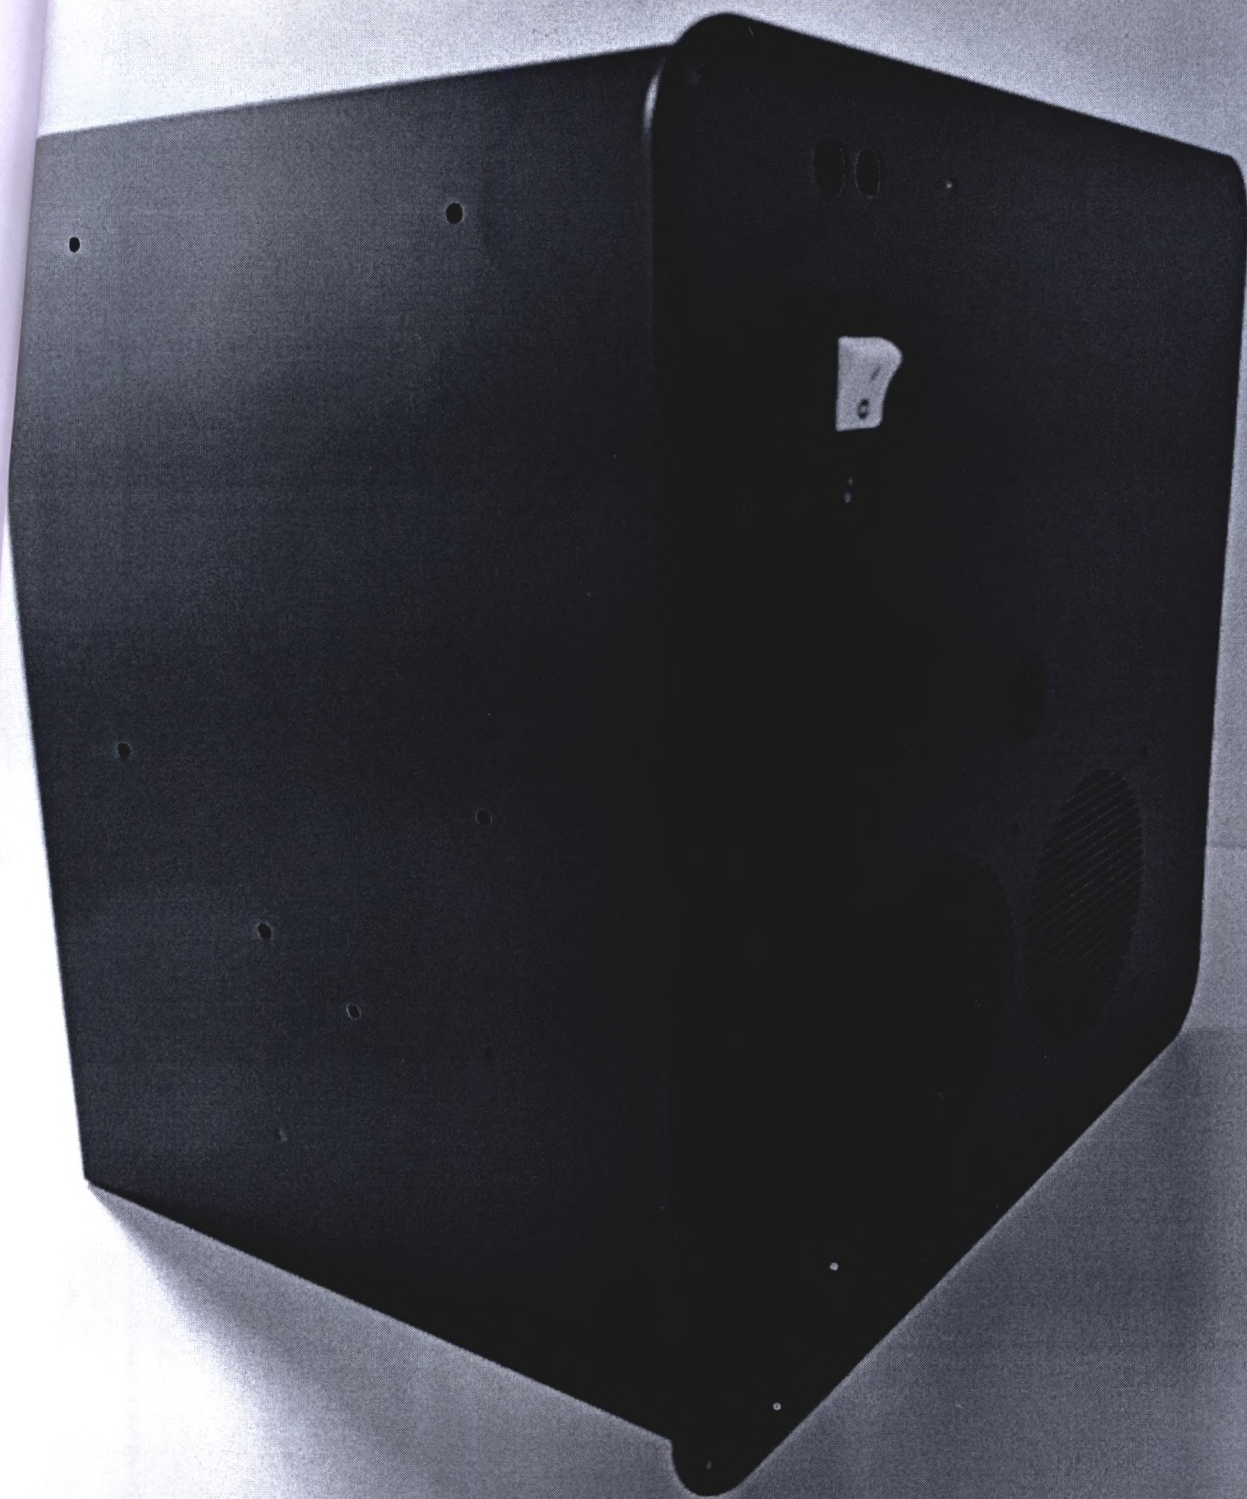




ежности:

транспортировочная



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 200 листов

Генеральный директор
ООО "Асвомед"



Стройков С.П.

