

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «биоМерье Рус»

Бердникова Н.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Набор реагентов FilmArray Gastrointestinal (GI) panel» для
обнаружения и идентификации нуклеиновых кислот бактерий,
вирусов и паразитов, ассоциированных с инфекциями
желудочно-кишечного тракта, методом мультиплексной ПЦР
на системах семейства FilmArray»**

1. Кассета с реагентами FilmArray Gastrointestinal (GI) panel – 30 шт.
2. Раствор буферный –1,0 мл × 32 шт. (ампула)
3. Раствор регидратирующий – 1,5 мл × 32 шт. (флакон с канюлей)
4. Флакон с канюлей для внесения образца – 32 шт.
5. Пипетка – 32 шт.

Фотография общего вида



BioFire Diagnostics, LLC

515 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108, USA | +1-801-736-6354

Avoid release to the environment.

Wear protective gloves, clothing, eye and face protection.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

DANGER

Harmful if swallowed, causes skin irritation and serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.

DANGER

Noctif en cas d'ingestion, provoque une irritation cutanée et provoque de graves lésions des yeux. Noctif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Danger | BAHAYA | ОПАСНОСТЬ | OPASNOST | NEBEZPEČÍ | PARE | GEVAAR | OHT | DANGER | ภัยอันตราย | GEFAHR | KENDYNDCE | VESZÉLY | PERICOLO | BİTANIR | PAVOJUS | PARE | NEBEZPEČENSTVO | PERICOLO | PERICOLO | ОПАСНОСТЬ | OPASNOST | NEBEZPEČENSTVO | NEVARNOST | PELIGRO | PARA | TEHLIKE | NGUY HIEM | 危險 | 위험 | 危險 | 危險



BIO FIRE

A BIOMÉRIEUX COMPANY

Salt Lake City, Utah, USA
+1-801-736-6354 | www.BioFireDX.com

FilmArray® Gastrointestinal (GI) Panel

For FilmArray® systems | Pro systémy FilmArray® | Untuk sistem FilmArray® | Za sisteme FilmArray® | За системи FilmArray® | Για συστήματα FilmArray® | Voor FilmArray®-systeem | FilmmArray®-systeem | Do systeme FilmArray® | Per sistem FilmArray® | For FilmArray®-system | Za FilmArray®-sistem | Paix sistema FilmArray® | Pentru sistema FilmArray® | Pre systémy FilmArray® | For FilmArray®-system | Для систем FilmArray® | Pour les systèmes FilmArray® | FilmArray® rendszerhez | FilmArray® 시스템 | FilmArray® 用 | 适用于 FilmArray® 系统 | 適用於 FilmArray® 系統

KIT UOI

(01) 00815381020109
(17) 220401
(10) 1091221

Qasrd EC-REP BV
Pax 297
B-3640 Geel, Belgium

BioFire Diagnostics, LLC
+1-801-736-6354 | support@biofiredx.com
515 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108, USA
Pat: http://www.biofiredx.com/legal-notices/

RPIT-ABT-0116

30

LOT 1091221


2022-04-01

(32) CNSB-PIP-0009
(32) FAIV-SUB-0001
(32) FAIV-SUB-0002
(32) FAIV-GEN-0003
(30) RPIT-SUB-0328

CE IVD
Rx Only

Внешний вид компонентов набора

1. Кассета с реагентами FilmArray Gastrointestinal (GI) panel

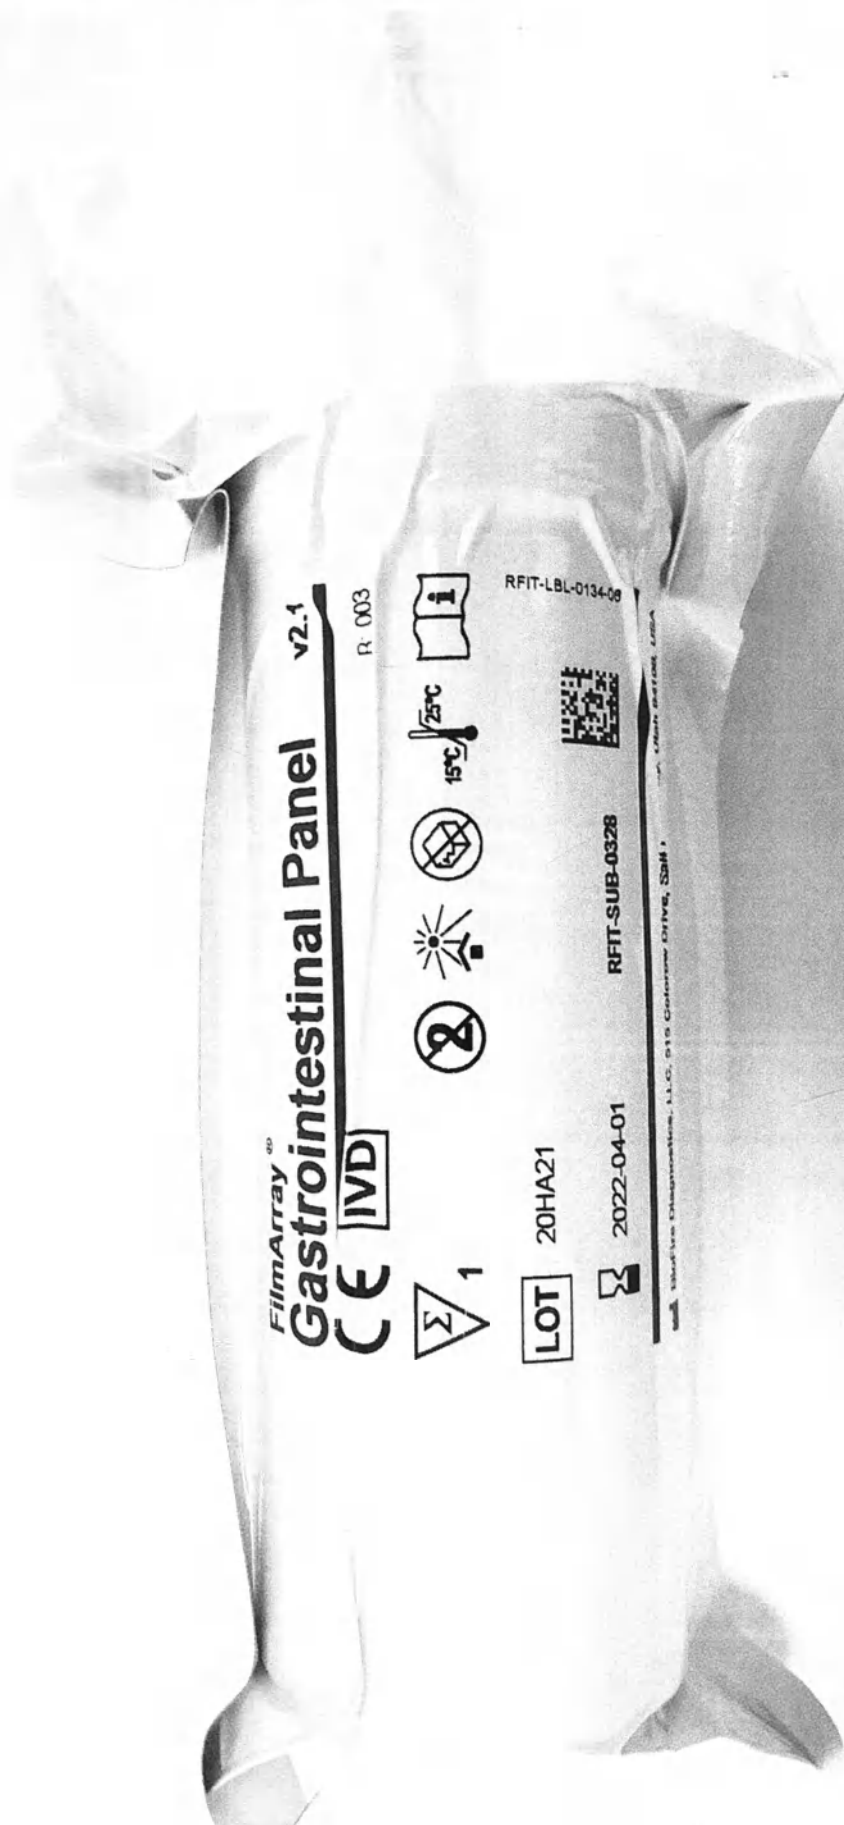

FilmArray[®] GI Panel v2.1

LOT 20QB21

2022-04-06

SN 44423928



IVD

B: 001




SAMPLE ID HERE or REVERSE SIDE


SAMPLE MIX

BioFire Diagnostics, LLC • Salt Lake City, Utah, USA

HYDRATION SOLUTION

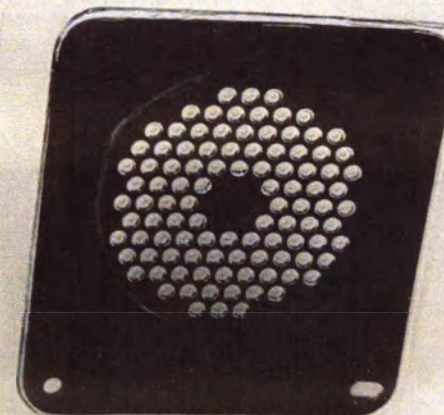

2. Раствор буферный - 1,0 мл

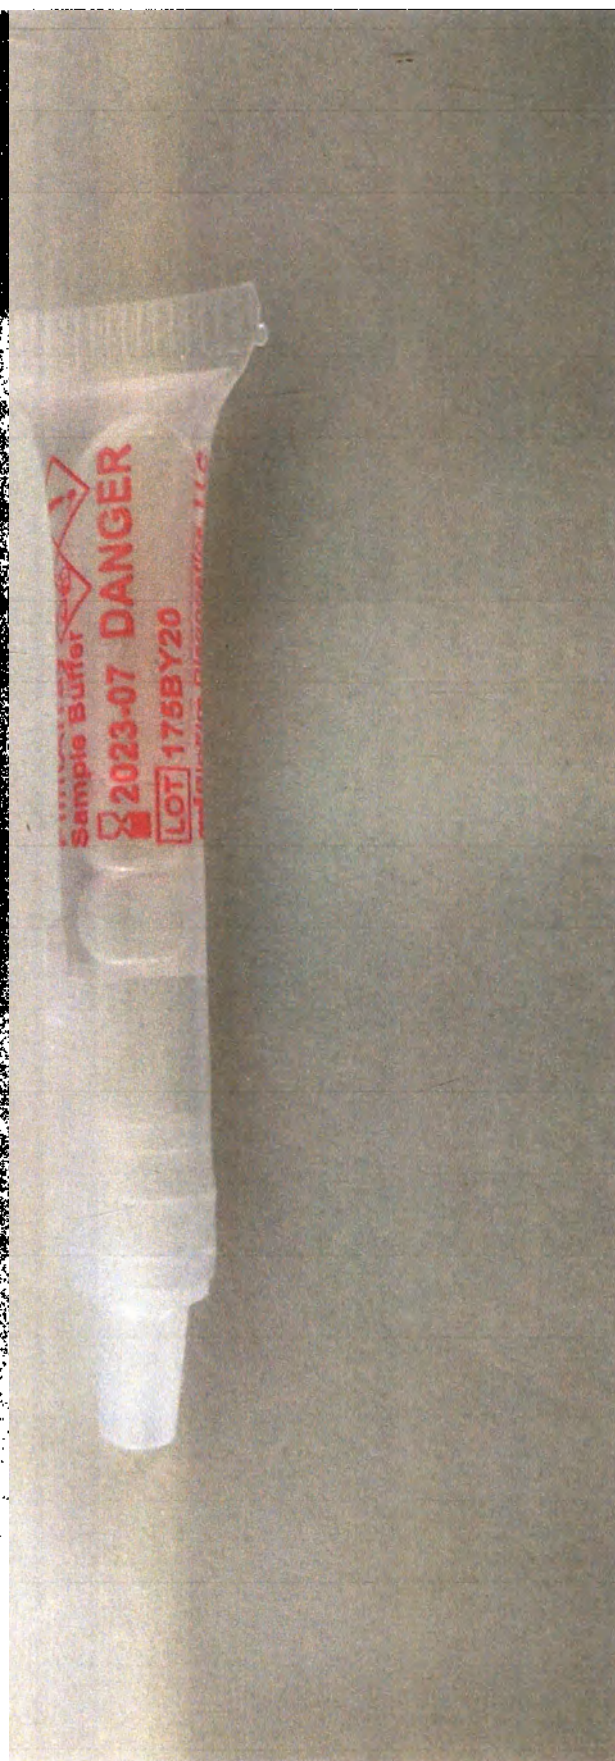


3. Раствор регидратирующий – 1,5 мл



4. Флакон с канюлей для внесения образца



5. Пипетка

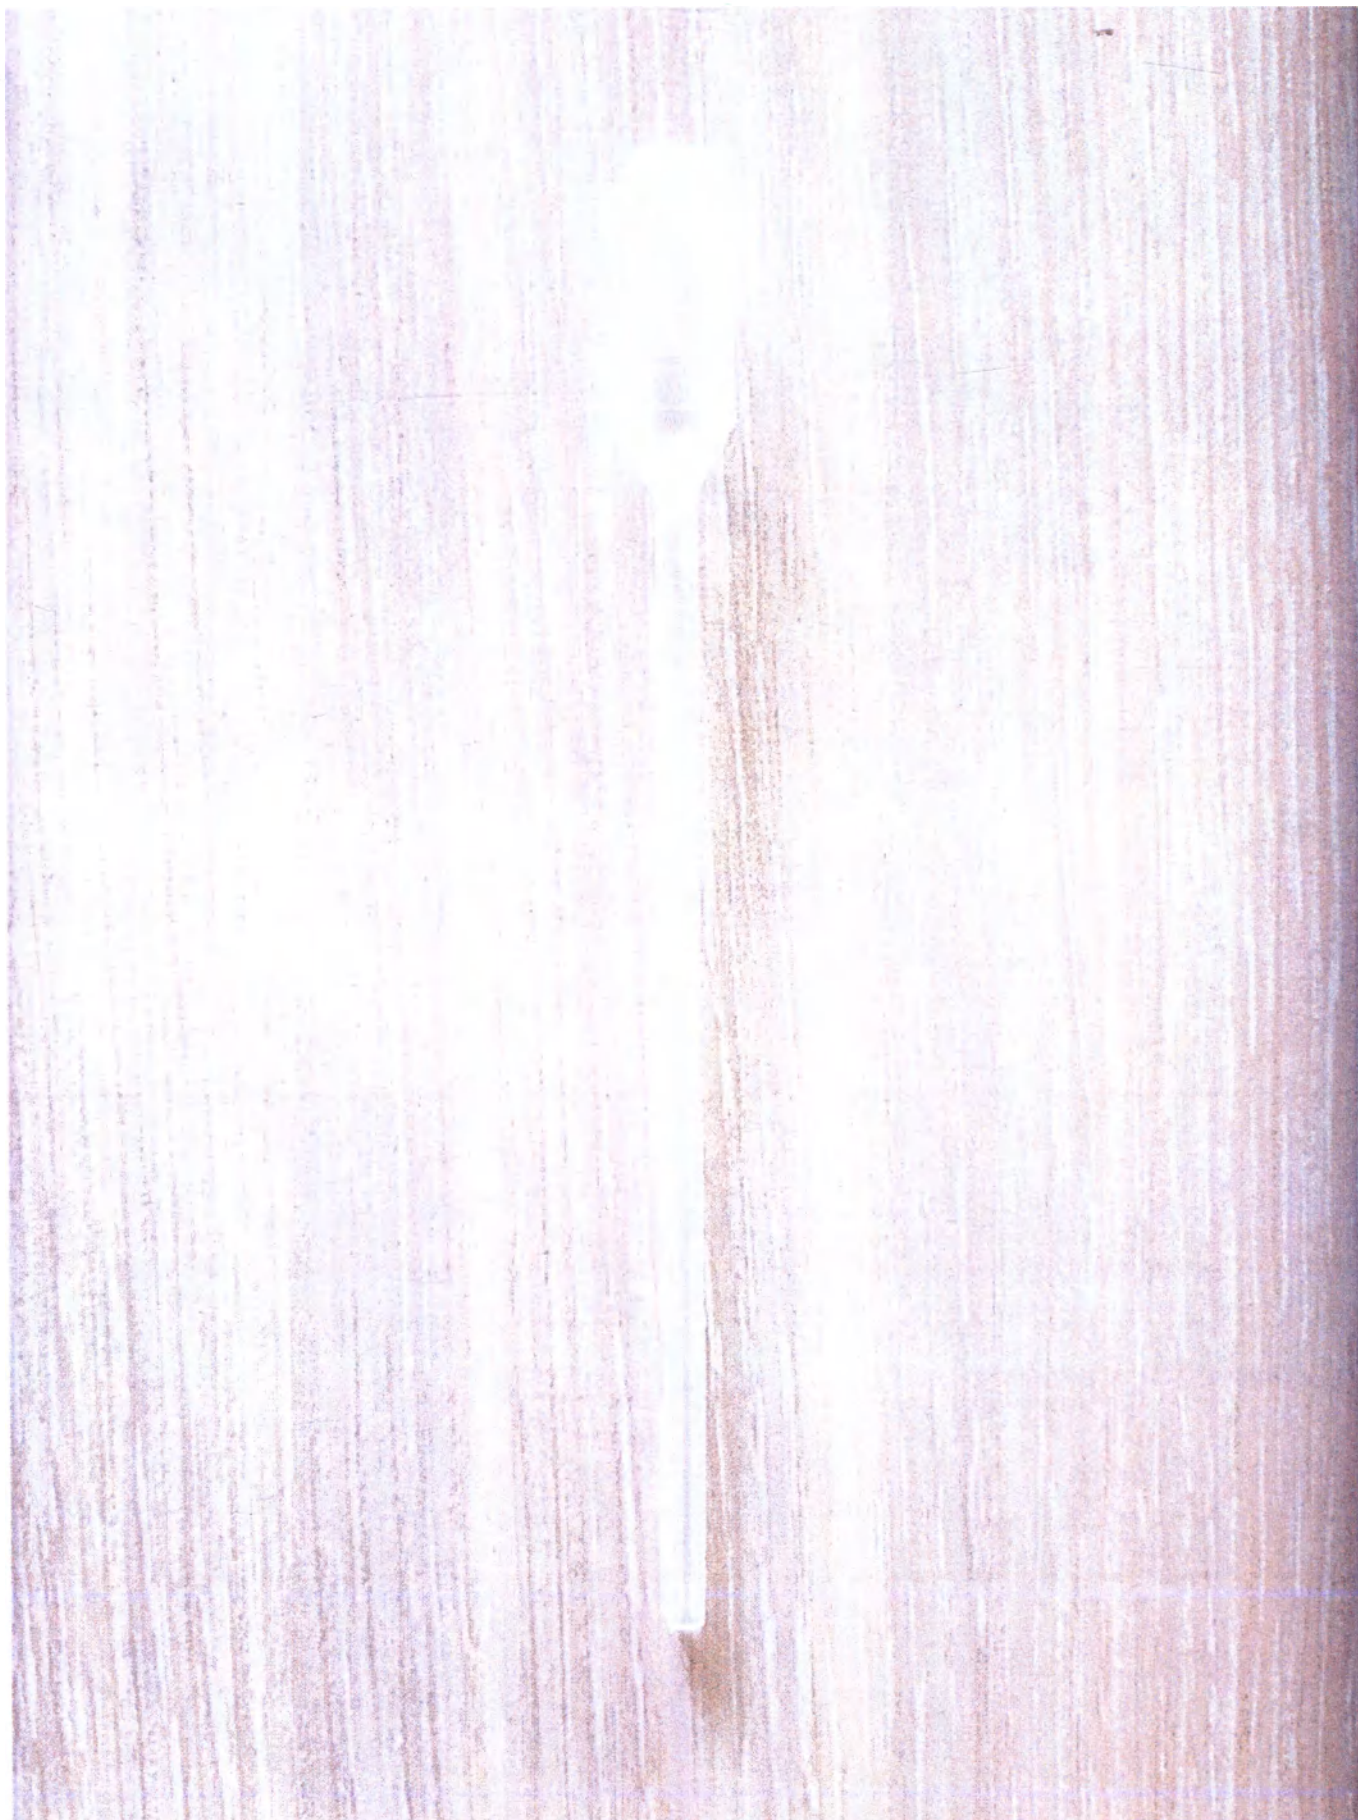

Прошито и пронумеровано
10 листов
"13" сентября 2021 года
Генеральный директор
Бердникова Н.В.