

ООО "Малти-Системс Текнолоджи" // Multi-Systems Technology Ltd.



ИНН 7725074588/ КПП 770401001

119435 Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 18, оф. 101

119435 Russian Federation, Moscow, Malaya Pirogovskaya Str., 18, 101

+7 495 7378126 // <http://www.mst.ru> // info@mst.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МАЛТИ-СИСТЕМС ТЕКНОЛОДЖИ»

А.Н. Ищенко/
2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ медицинского изделия

«Зонд для чрескожной дискэктомии DISKOM, в вариантах исполнения»

1. Медицинское изделие «Зонд для чрезкожной дискэктомии DISKOM в вариантах исполнения», вариант исполнения (артикул) DKR1716CDE1.10(17G) – красный ограничитель

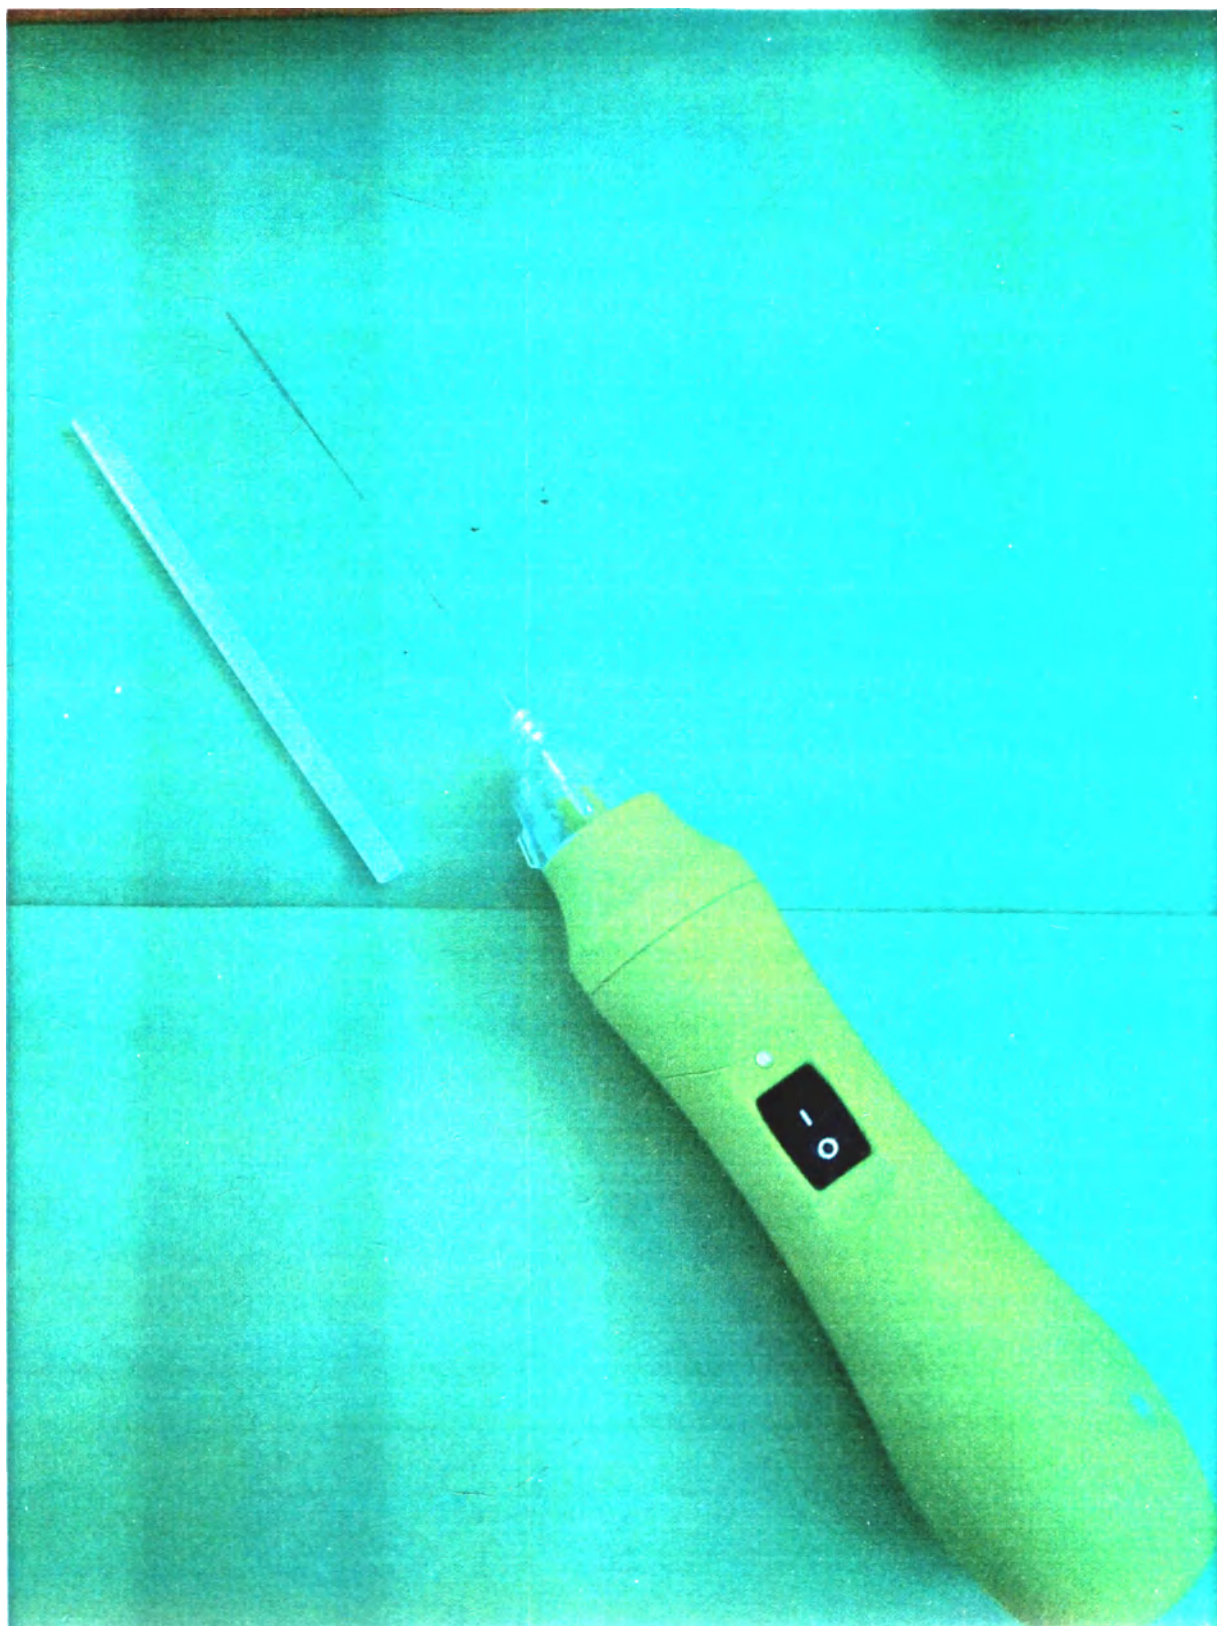


Рисунок 1. Внешний вид: Зонд титановый с ручкой (кнопка включения и индикатор), жидкотопливный



Рисунок 2. Внешний вид: потребительская упаковка – картонная коробка, этикетка производителя на коробке

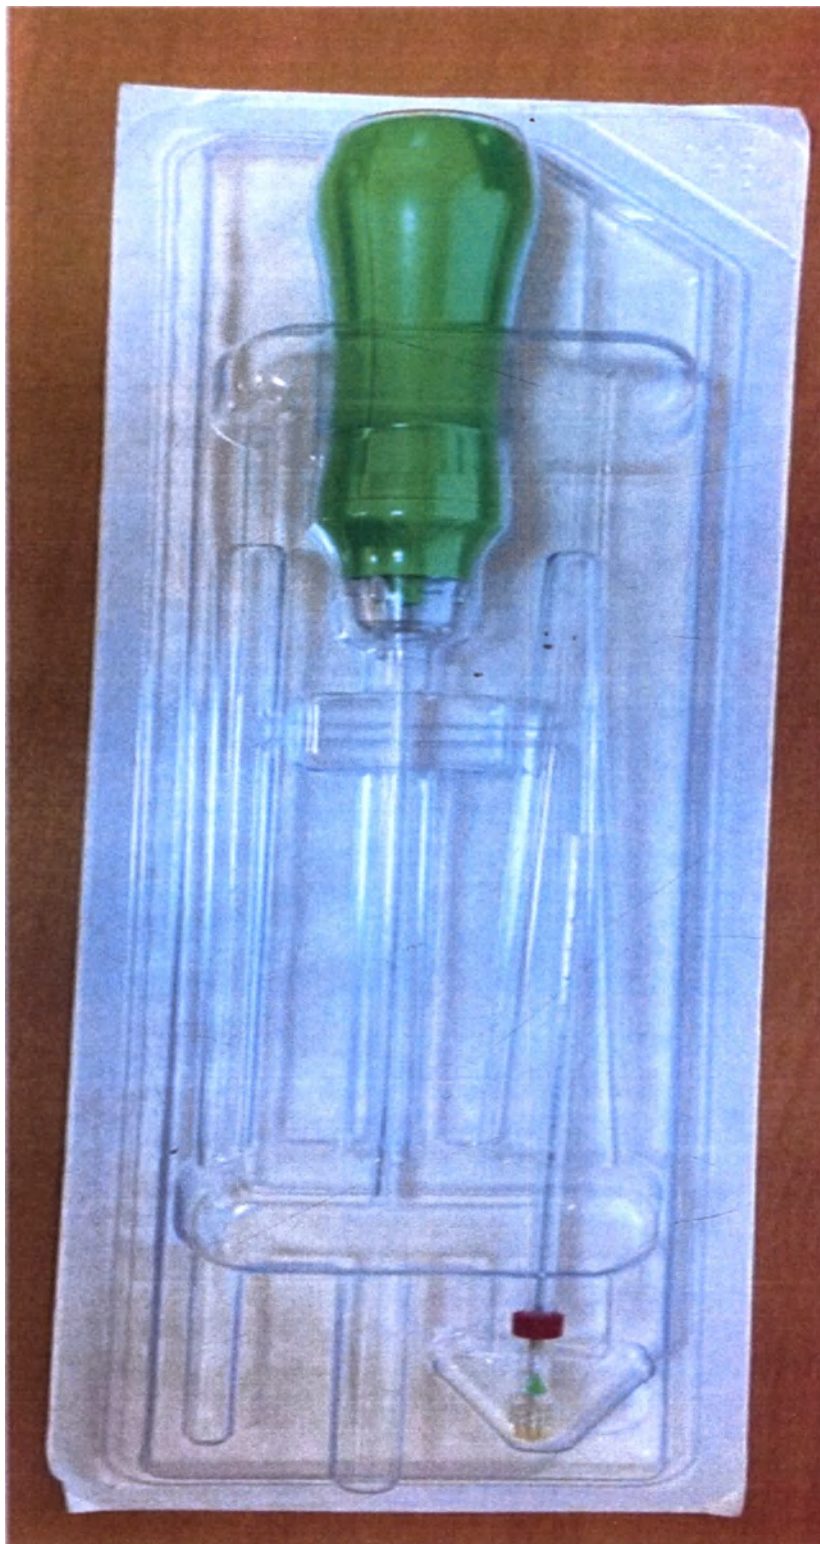


Рисунок 3. Внешний вид изделия в стерильной упаковке: первичная упаковка блистер с крышкой вариант исполнения, артикул DKR1716CDFL10(17G) – красный ограничитель



Рисунок 4. Этикетка на пакете для стерилизации (вторичная упаковка, термобумага)

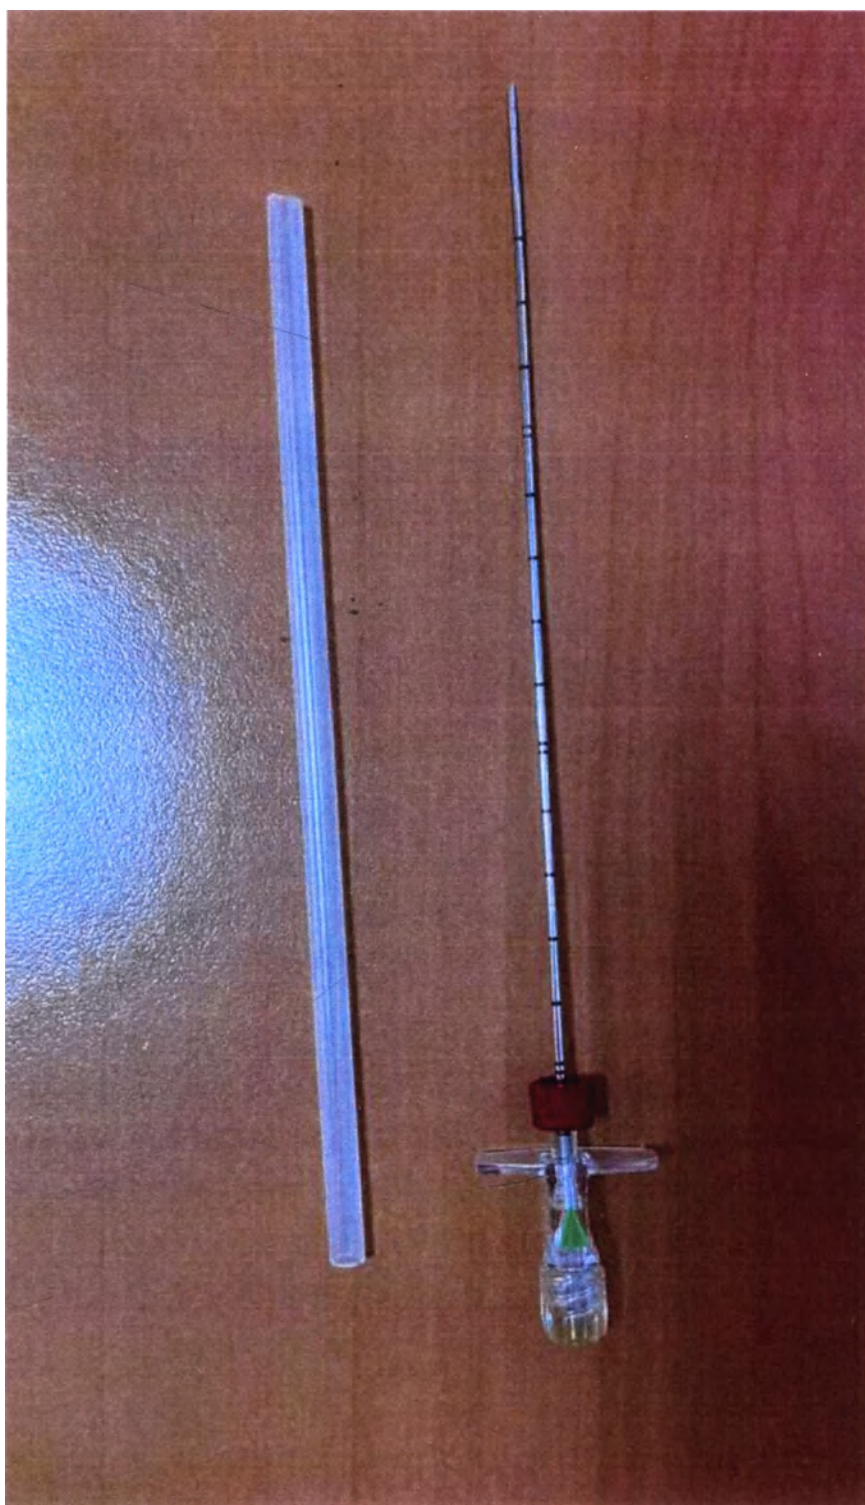


Рисунок 5. Внешний вид: Аспирационная канюля со скользящим ограничителем и защитным колпачком, вариант исполнения (артикул) DKR1716CDFL10(17G) – красный ограничитель



Рисунок 6. Внешний вид: транспортная упаковка (гофротара)

2. Медицинское изделие «Зонд для чрескожной дискэктомии DISKOM в вариантах исполнения», вариант исполнения (артикул) DKR1908CDFL10 (19G) – бежевый ограничитель

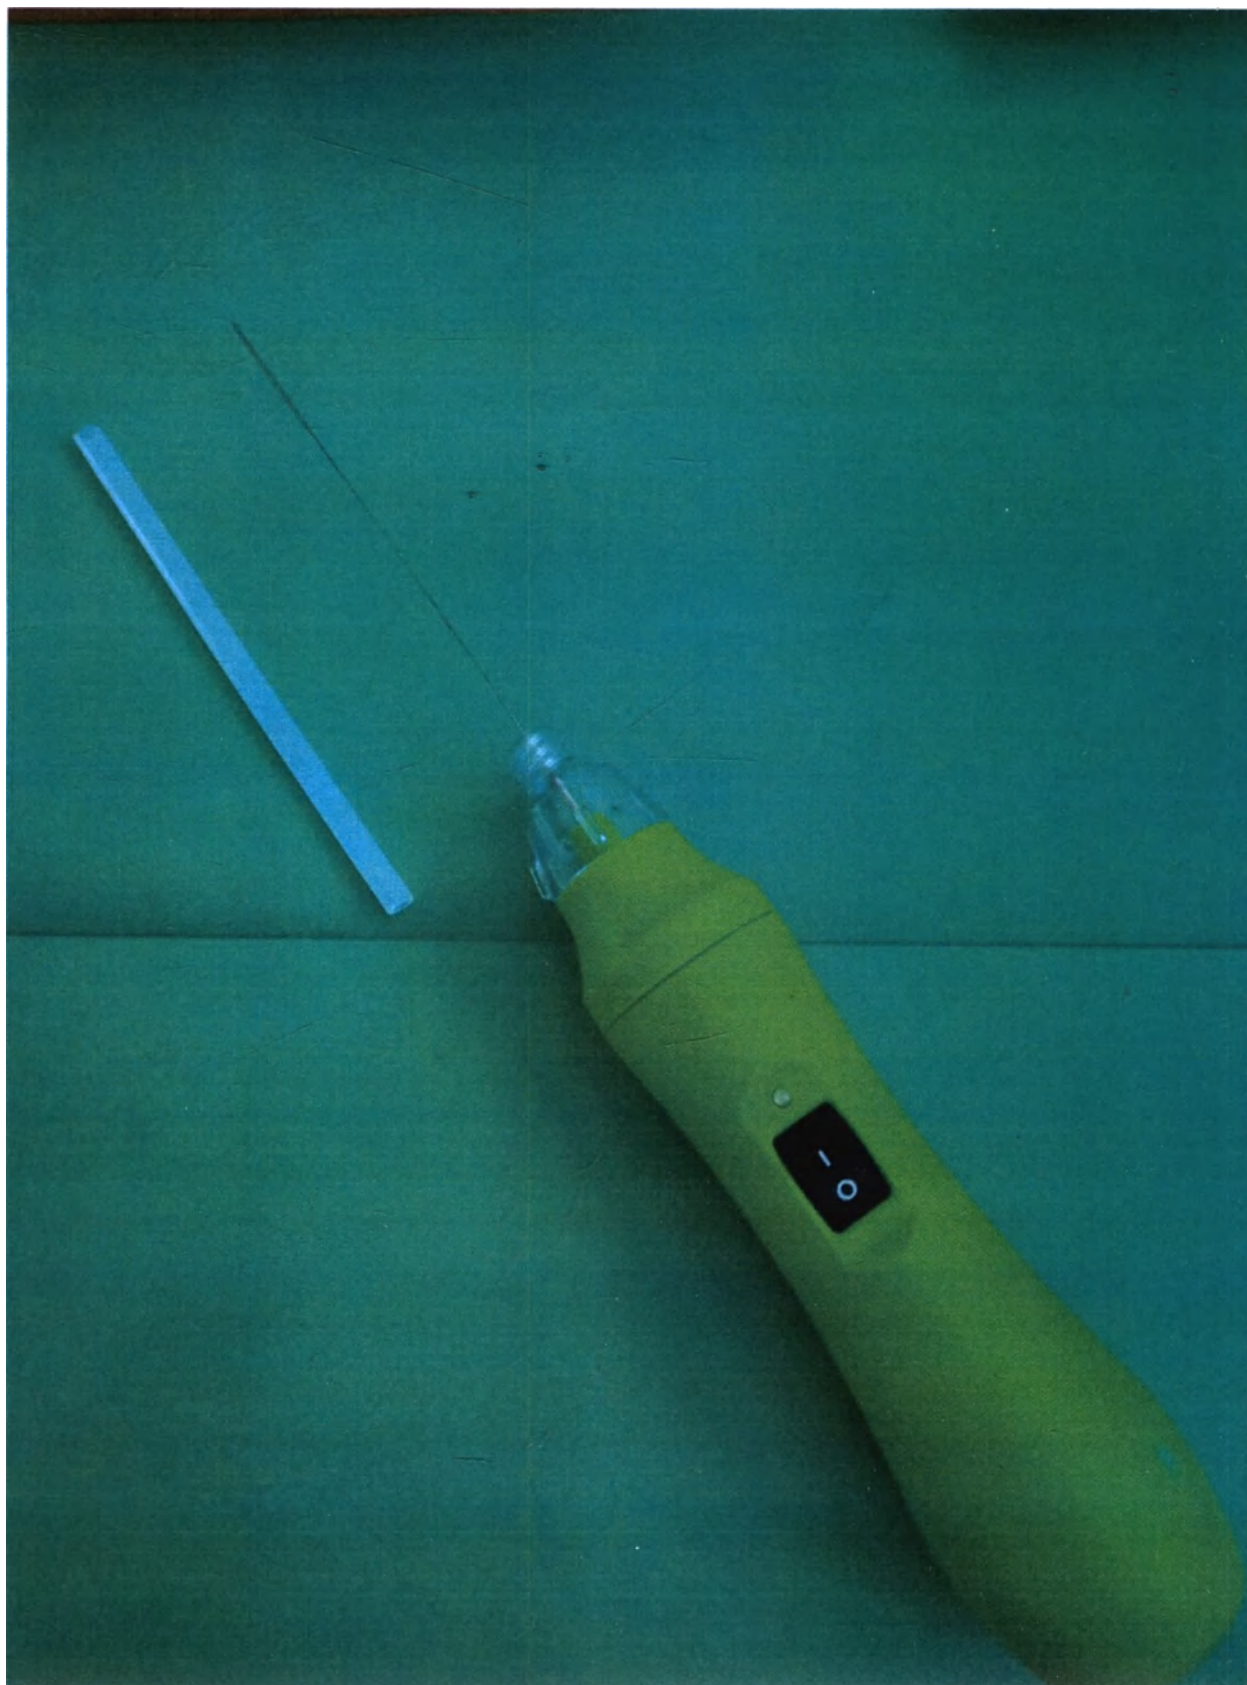


Рисунок 1. Внешний вид: Зонд титановый с ручкой (кнопка вкл/выкл и индикатор), колпачок защитный.



Рисунок 2. Внешний вид изделия в стерильной упаковке: первичная – блистер с крышкой. вторичная – пакет для стерилизации (термобумага из поливинилхлорида).

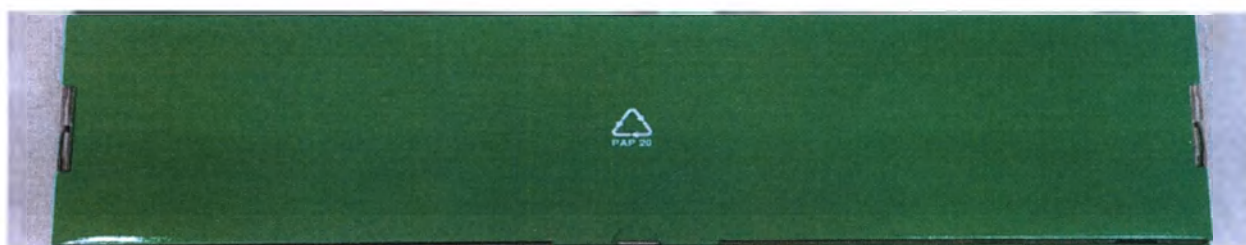


Рисунок 3. Внешний вид: потребительская упаковка – картонная коробка, этикетка производителя

DISKOM

AGO PER DECOMPRESSIONE DISCALE
 DISC DECOMPRESSION NEEDLE
 AGULHA PARA DESCOMPRESSÃO DISCAL
 DISKUS-DEKOMPRESSIONSNADEL
 AGUJA PARA DESCOMPRESIÓN DISCAL
 AIGUILLE POUR DÉCOMPRESSION DISCALE
 DISK DEKOMPRESYON İĞNESİ

Länge Lunghezza Longitud Lunghezza Comprimento	80 mm	Diameter Durchmesser Diamètre Diámetro Diámetro Diámetro	19G 1.15 mm	CE 0123 Rx only
--	-------	---	----------------	--------------------

REF DKR1908CDFL10

LOT 2201182



2022-01-21

Manufacture (YYYY-MM-DD)



2025-01-20

Use by (YYYY-MM-DD)

QTY 1

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide



Do not use if package is damaged



Do not re-sterilize



Do not reuse



Caution



Refer to instruction manual/leaflet



Consult instructions for use

biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526 www.biopsybell.it

DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it



DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it



DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it



DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it

2025-01-20
 LOT 2201182
 REF DKR1908CDFL10

DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it

2025-01-20
 LOT 2201182
 REF DKR1908CDFL10

DISKOM
 biopsybell s.r.l.
 VIA A. DE MANUCCI 11/A 410187 MANTOVA (MO) ITALY
 Tel: +39 0376 27850 Fax: +39 0376 33526
 www.biopsybell.it

2025-01-20
 LOT 2201182
 REF DKR1908CDFL10

Рисунок 4. Этикетка на пакете для стерилизации (вторичная упаковка, термобумага)



Рисунок 5. Внешний вид: Аспирационная канюля со скользящим ограничителем и защитным колпачком, вариант исполнения (артикул) DKR1908CDFL10(19G) – бежевый ограничитель

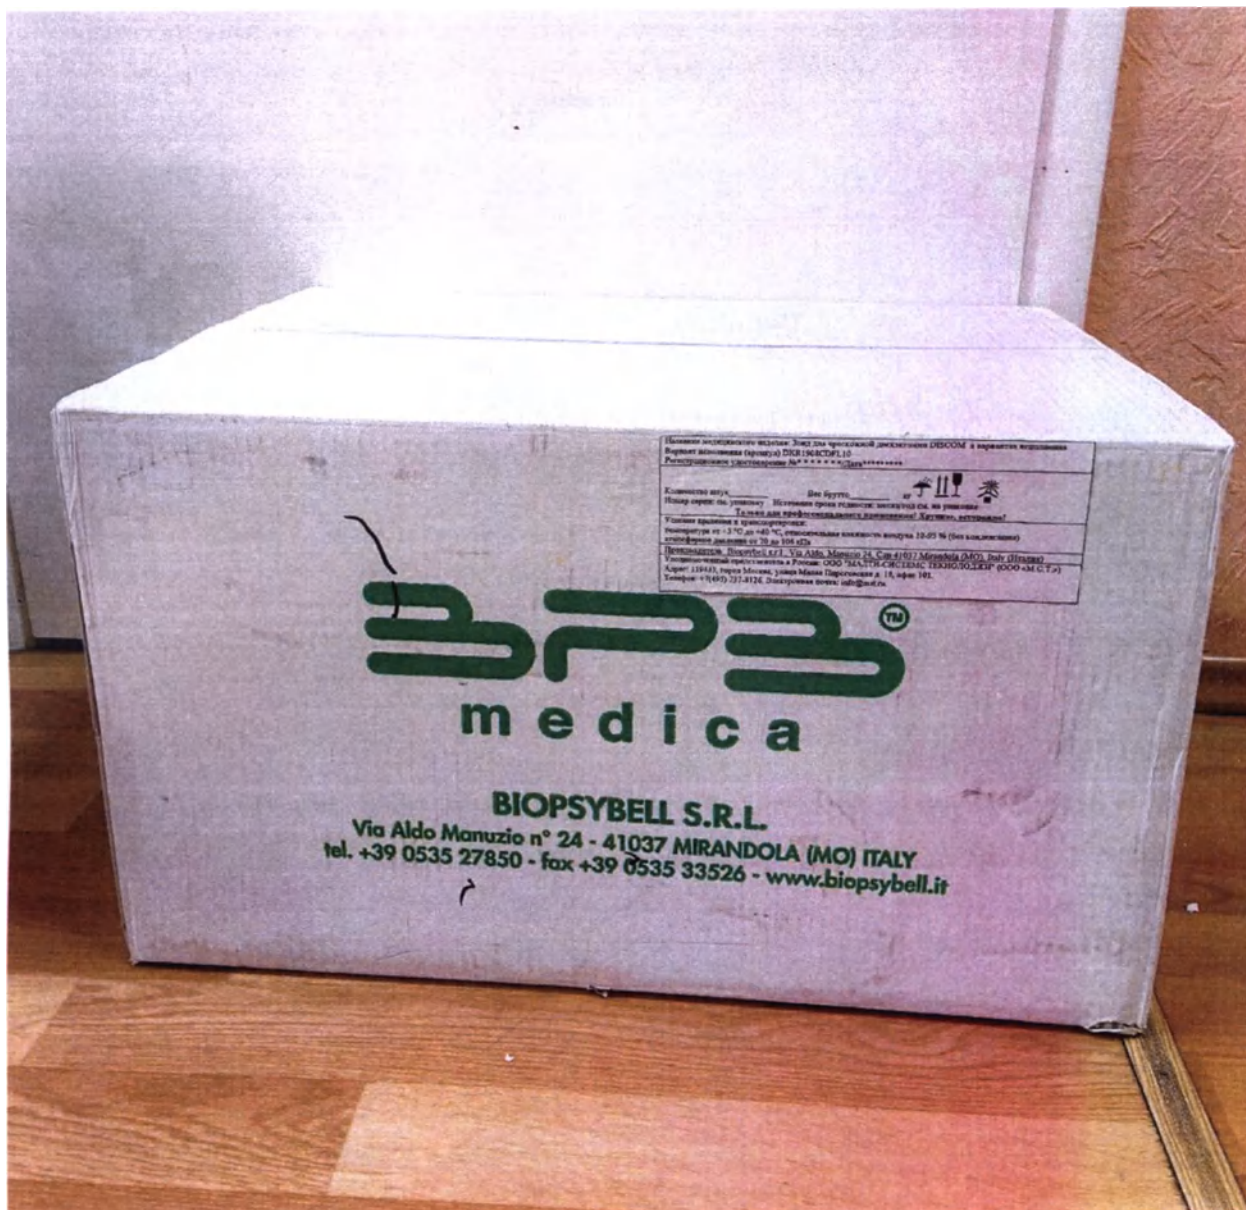


Рисунок 6. Внешний вид: транспортная упаковка (гофротара)



Рисунок 7. Внешний вид: потребительская упаковка с этикеткой производителя и этикеткой для обращения изделия в РФ.



Рисунок 8. Макет маркировки потребительской этикетки, для обращения изделия в РФ.

Название медицинского изделия: Зонд для чрескожной дискэктомии DISCOM в вариантах исполнения

Вариант исполнения (артикул) DKR1908CDFL10

Регистрационное удостоверение № * * * * * /Дата * * * * *

Количество штук _____ Вес брутто _____ кг

Номер серии: см. упаковку Истечение срока годности: месяц/год см. на упаковке

Только для профессионального применения! Хрупкое, осторожно!

Условия хранения и транспортировки:
температура от +5 °C до +40 °C, относительная влажность воздуха 10-95 % (без конденсации) атмосферное давление от 70 до 106 кПа

Производитель: Biopsybell s.r.l , Via Aldo, Manuzio 24, Cap 41037 Mirandola (MO), Italy (Италия)

Уполномоченный представитель в России: ООО "МАЛТИ-СИСТЕМС ТЕКНОЛОДЖИ" (ООО «М.С.Т.»)

Адрес: 119435, город Москва, улица Малая Пироговская д. 18, офис 101.

Телефон: +7(495) 737-8126, Электронная почта: info@mst.ru.

Рисунок 9. Макет транспортной этикетки для обращения изделия в РФ

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(15) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «МАЛТИ-СИСТЕМ
ТЕКНОЛОДЖИ»
А.Н.Ищенко

