

ООО «ВМС (РУС)»

ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»

109147, Россия, Москва

ул. Таганская, д.17-23, 5 этаж

Бизнес-центр Мосэнка

тел. +7 495 604 44 24/23

факс +7 495 660 11 37



Руководитель сервисной службы

ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»

Каримов М.А.

« 19 » августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система брахитерапии Bravos с принадлежностями».



«Система брахитерапии Bravos с принадлежностями», Общий вид.



1. Афтерлоадер Bravos с дистанционным управлением, включая:

Current Time:
2019-06-04 15:08:39

BRAVOS

Test Mode


varian

varian is a leading provider of
radiation protection solutions
for the nuclear industry.




Exit Password

Exit Screen

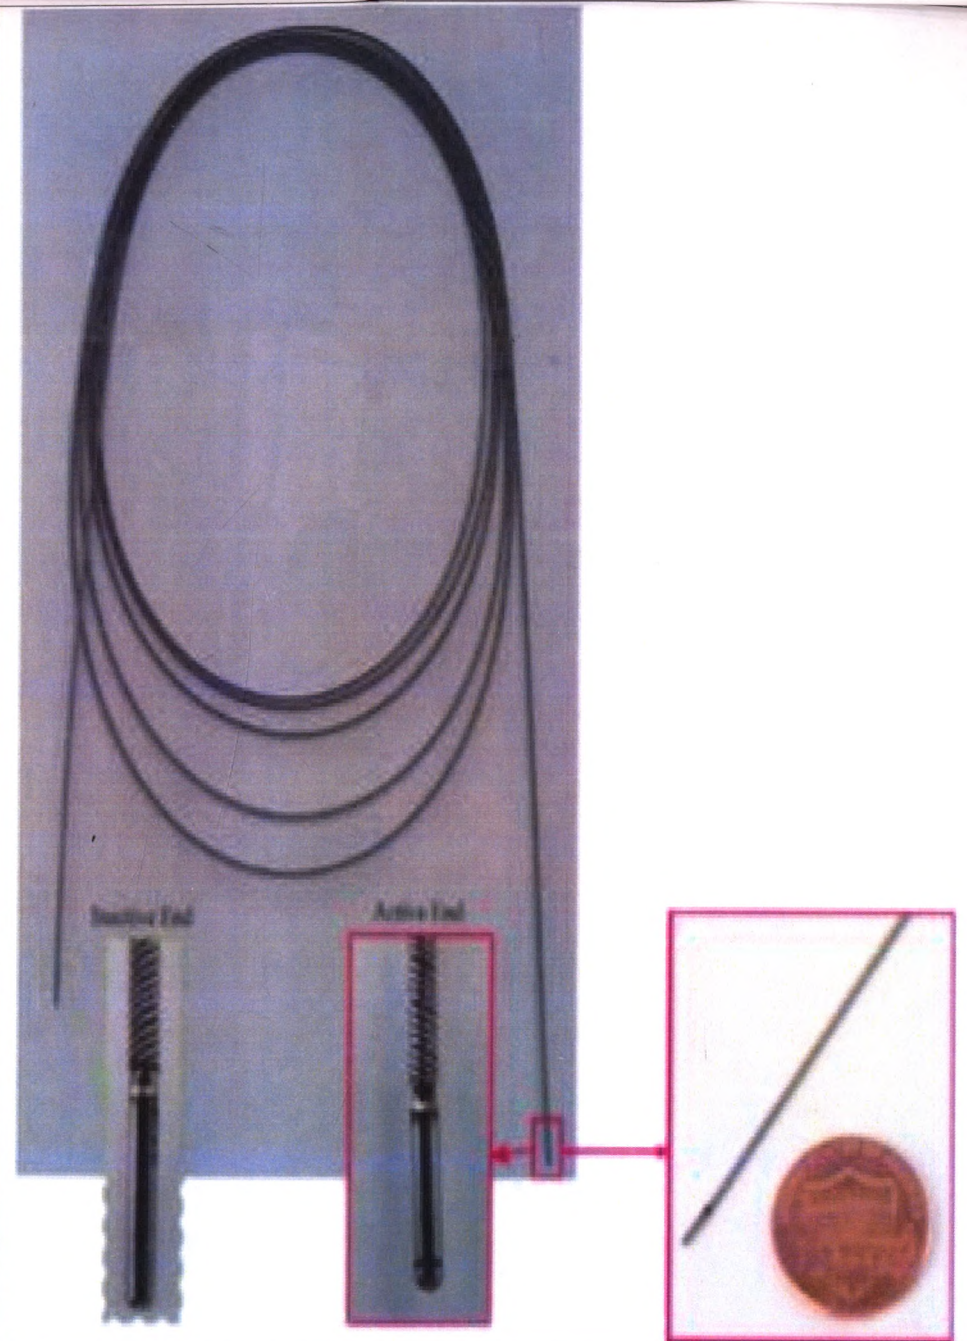


- Транспортировочный контейнер с источником ионизирующего излучения Ir -192.

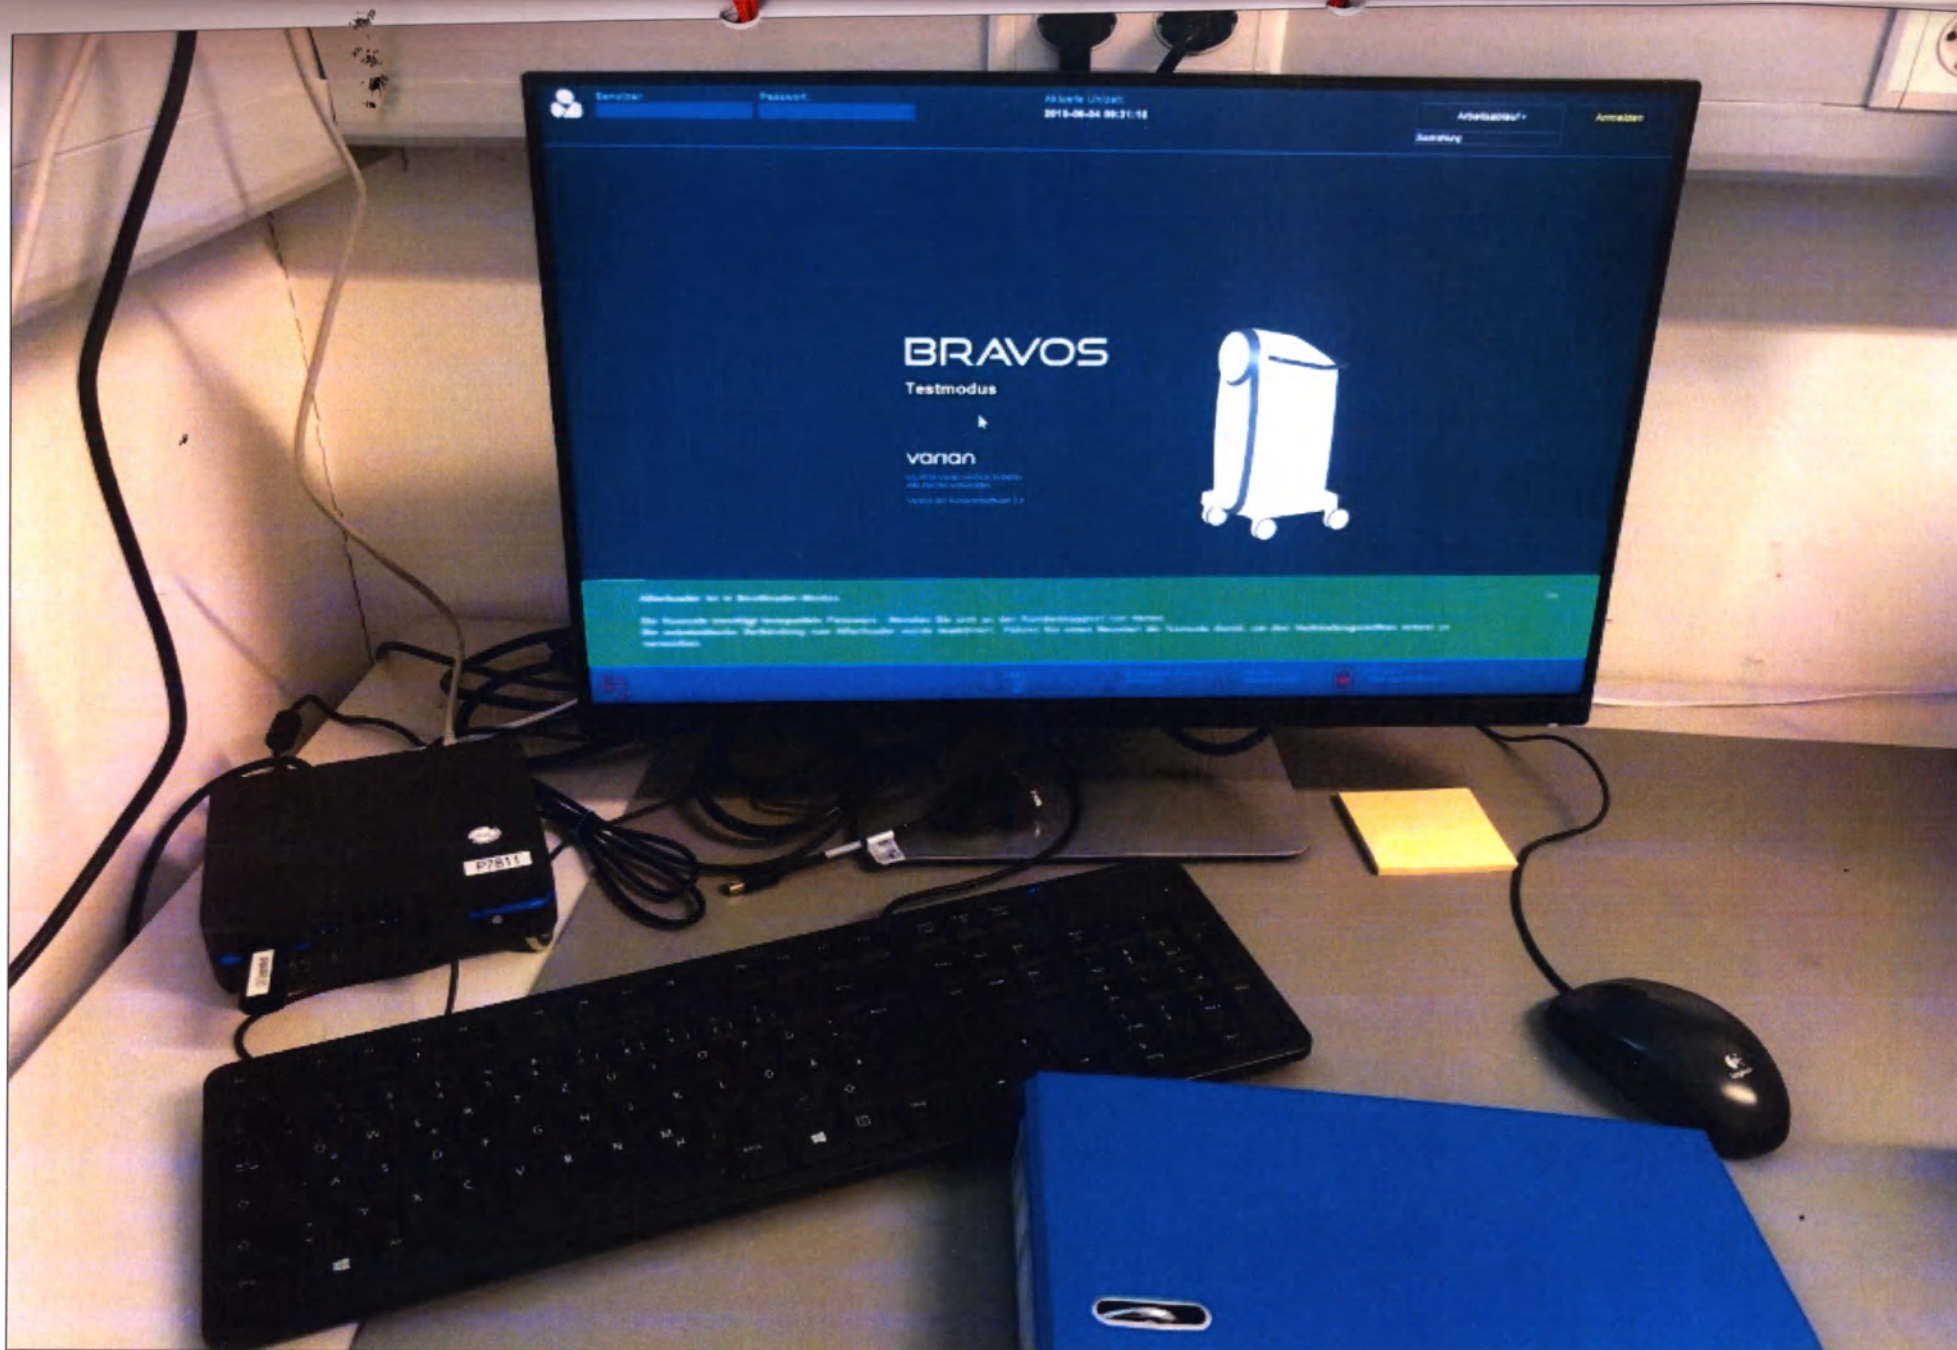




3. Система автоматизированной калибровки и верификации положения источника CamScale Bravos

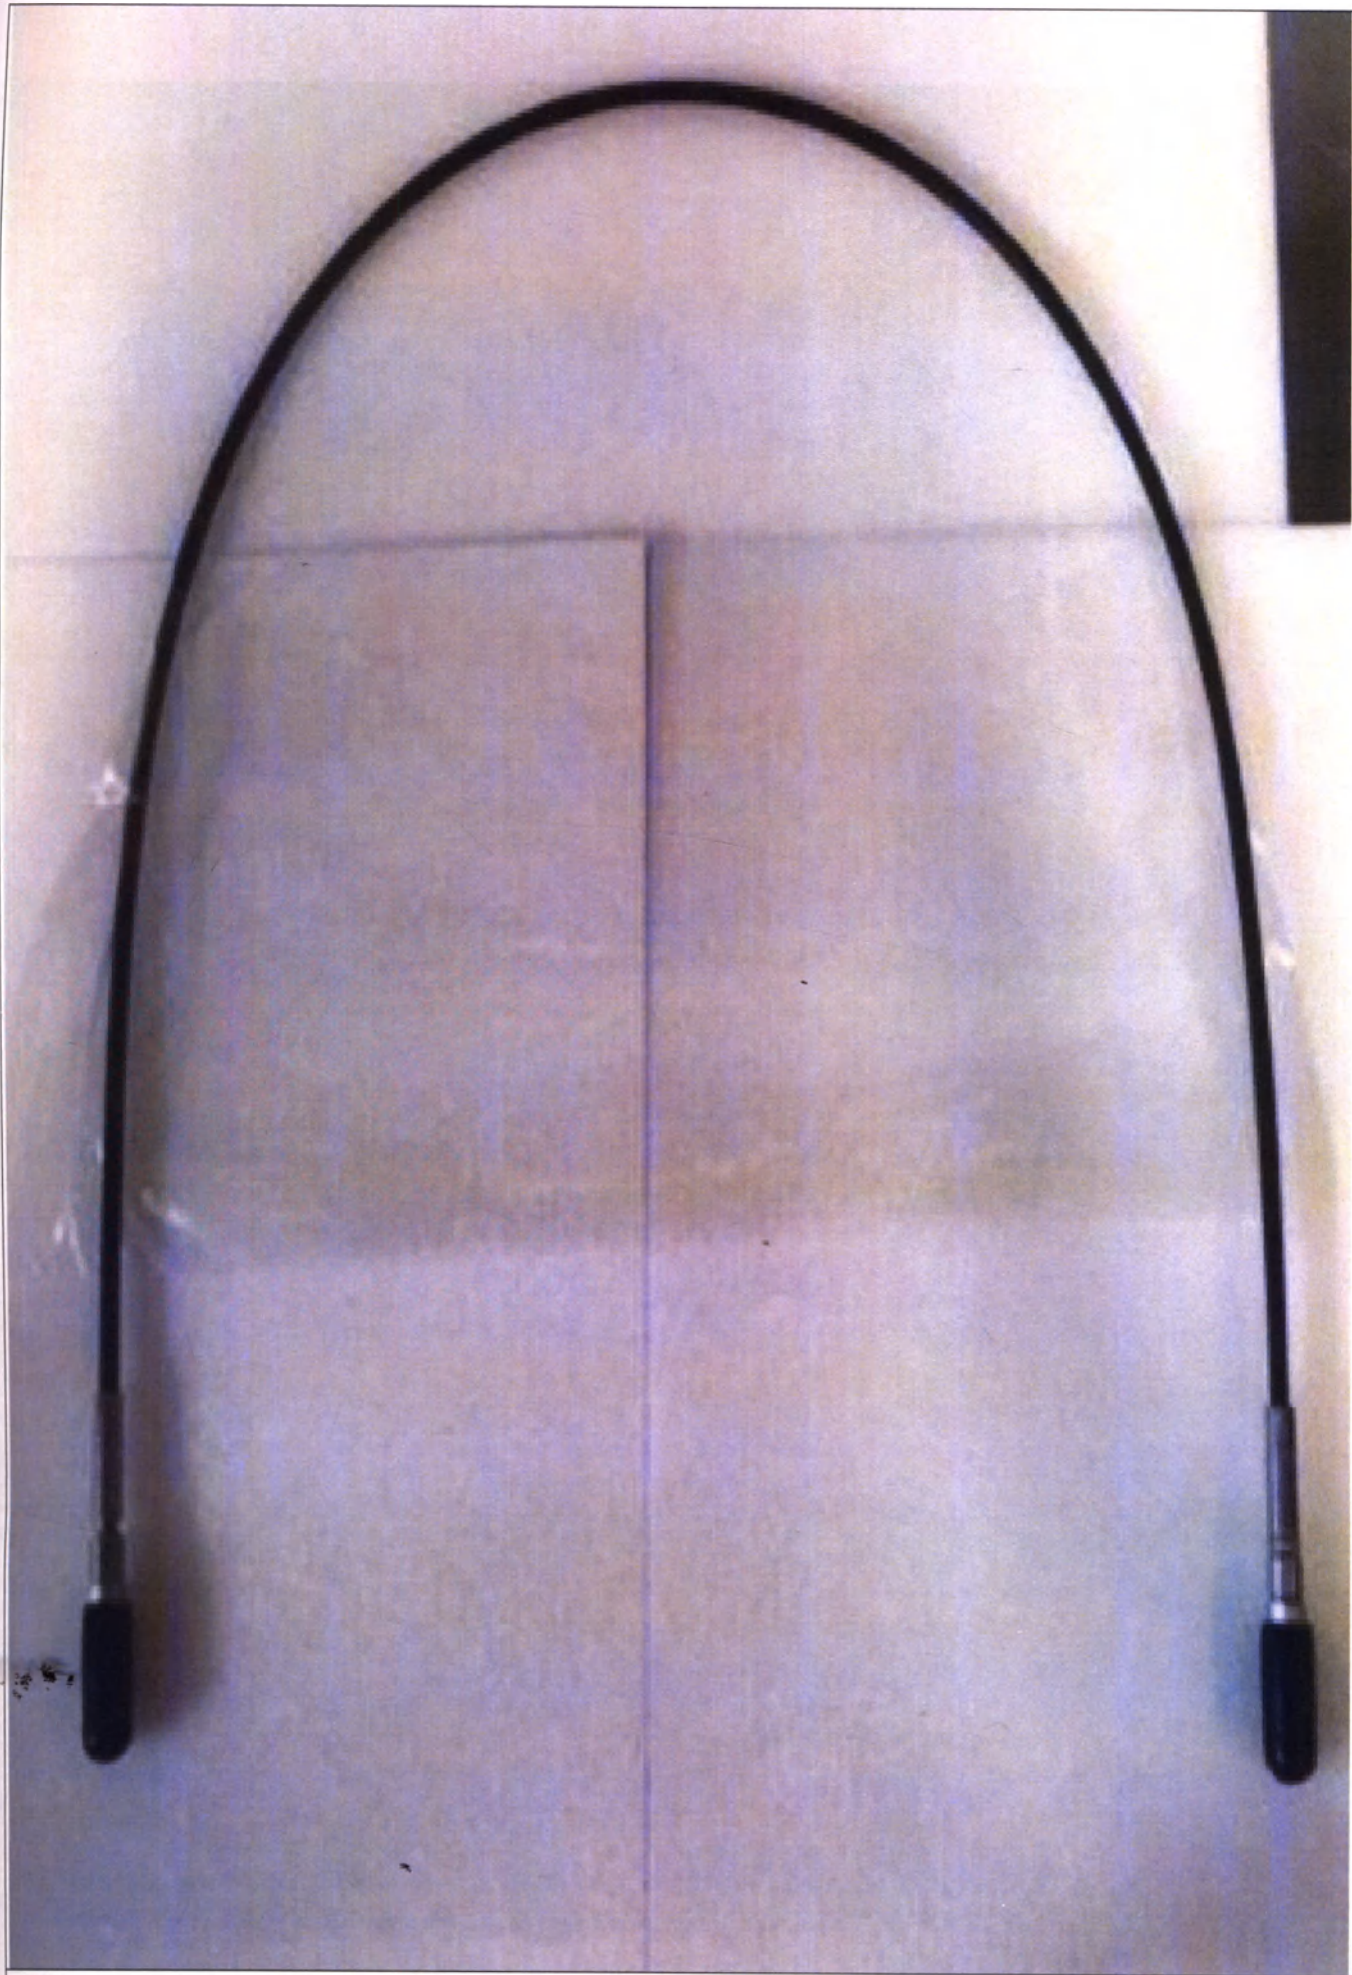

4. Направляющий транспортировочный шланг CamScale

TPE-99



VARTAN

Manager

File Workup Assessments Manage Tx View Pharmacy System Admin Window Applications Help

Open Dictionary History Flow Sheet Vital Signs Exam Toddler Rx Phys Orders Notes Billing Etc Discharge Admin Pt Educ Deal Mgmt Pres Appr Reports

Medications - Jackson, Stella H - ABL54321

Start Treatment Orders / Rx Medication History Plan History E-Prescribing

Breast

AC-T 8 cycles x 21 days

Day 1 Apr 12, 2012

- ☒ Day 1 Apr 12, 2012
- Ondansetron HCl 8 mg Intravenous daily for 1 day
- Dexamethasone 8 mg Tablet Oral daily for 1 day
- Doxorubicin HCl 60 mg/m² Intravenous daily for 1 day
- Cyclophosphamide 600 mg/m² Intravenous daily intermittent over 30 minutes for 1 day in NS 250 mL (1)

Order... Intent to Tx... Scores

Select

Cycle 1

Information Consent

Close

Adjunct

- Adjunct Hormonal
- Adjunct Node/Her2 -
- 5-FLU-300 CIV-ER
- AC - Dose Dense
- AC-80/800
- AC-T
- AC-T - VMIS CT
- AT-60/75
- CAF IV
- CAF PO
- CMF
- CMF IV
- CMF PO
- Dose Dense Sequential A-C-P
- Dose-Dense Concurrent AC-P
- FAC
- Adjunct/Her2+
- AC-80/800

Clinical Trial


Related	Code	Stage	Date of Diagnosis	Clinical Description
☒	174.4	Stage IIA T1, pN1a, M0	Apr 12, 2012	Malignant neoplasm of upper-outer quadrant of female breast

Ready

Frederick, Dr. Bill


ABC North Clinic OP

Apr 12, 2012 17:26

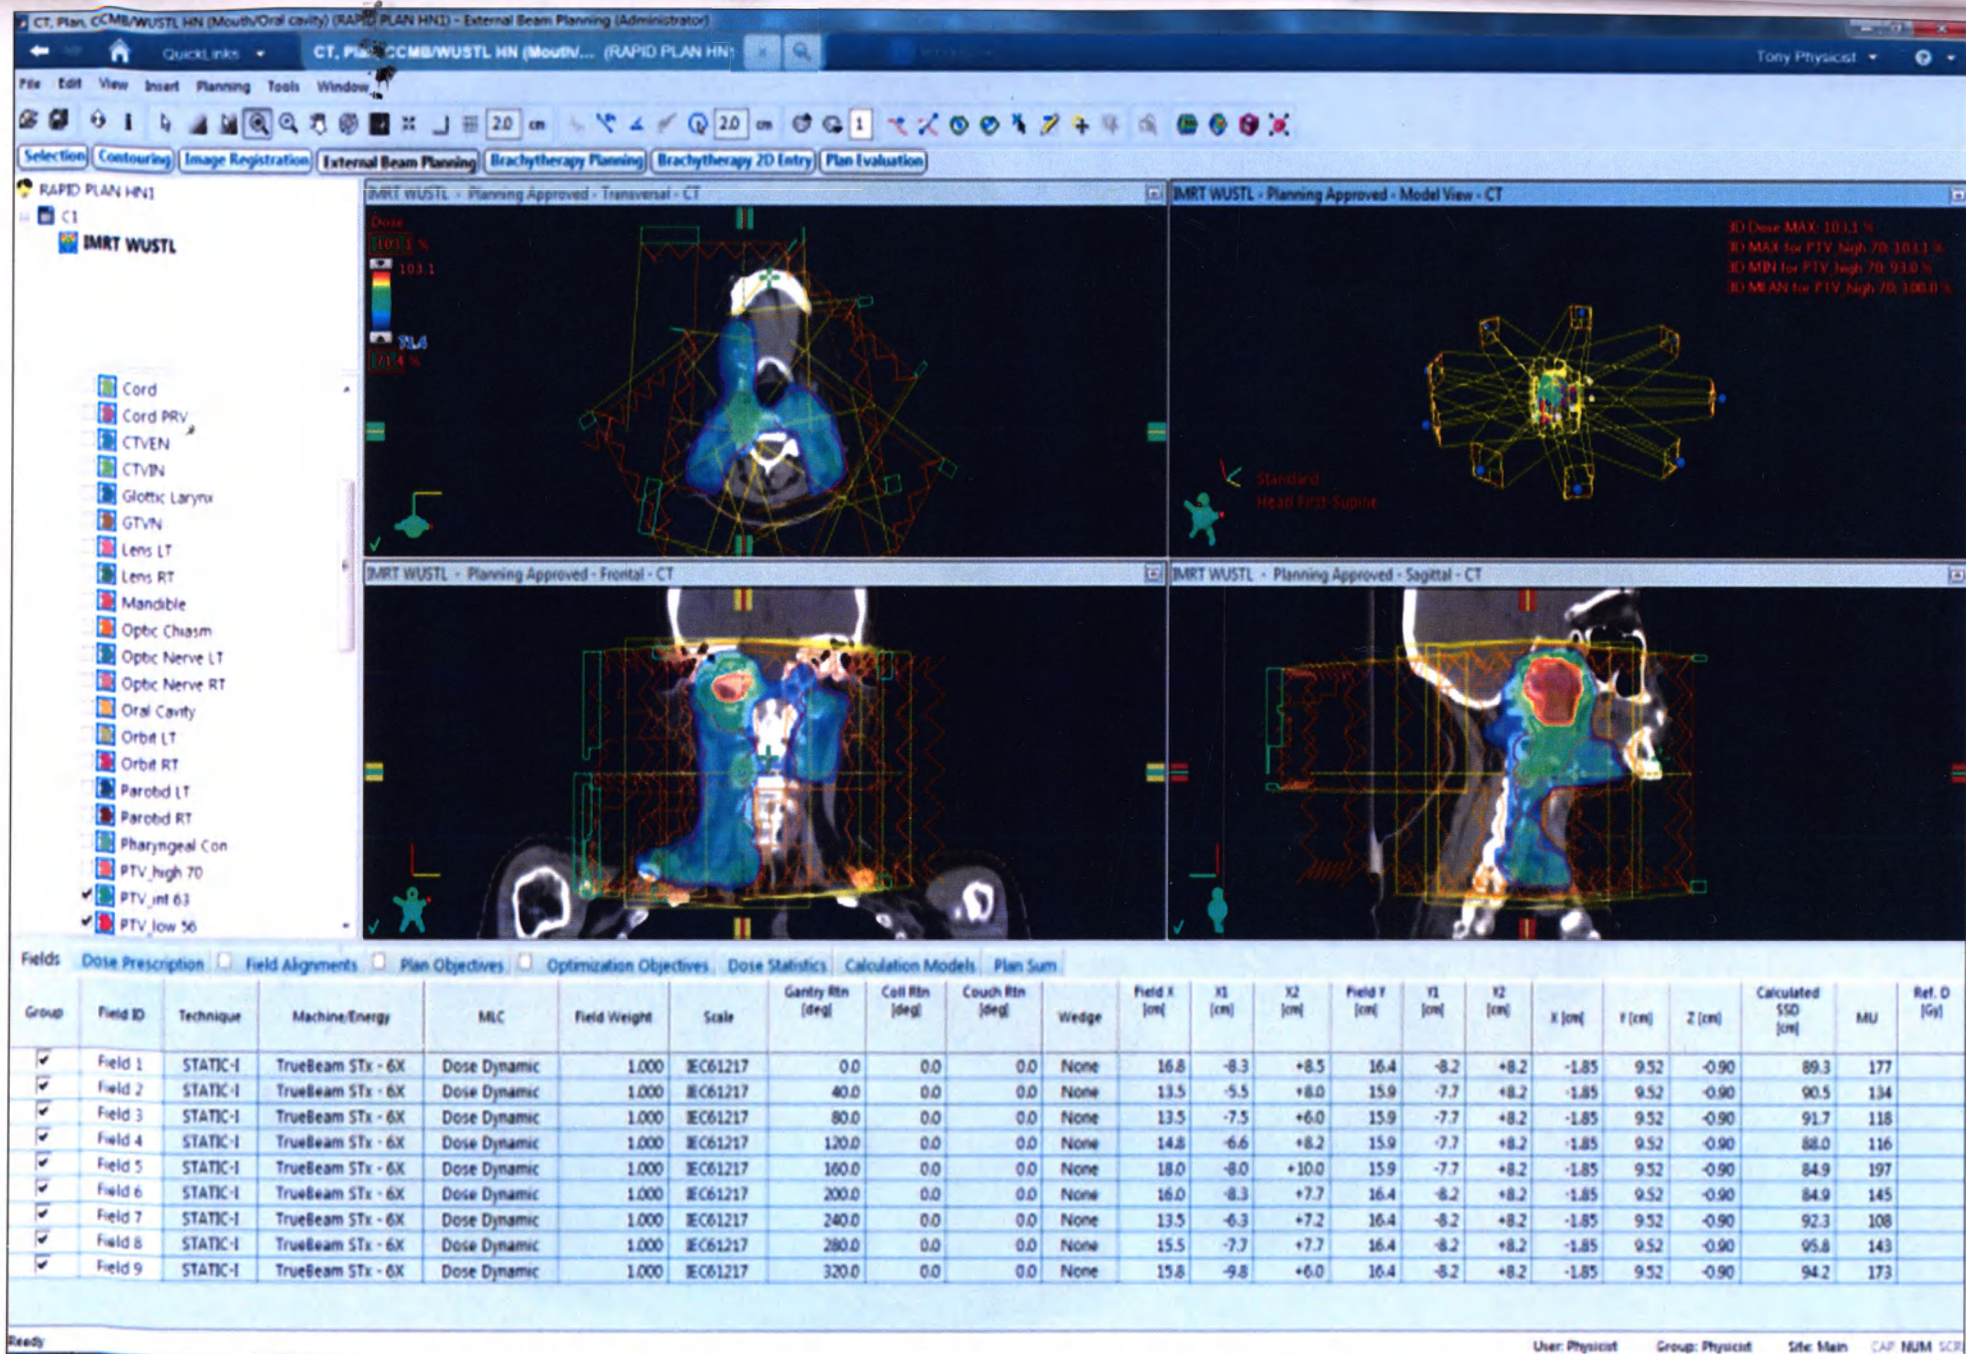







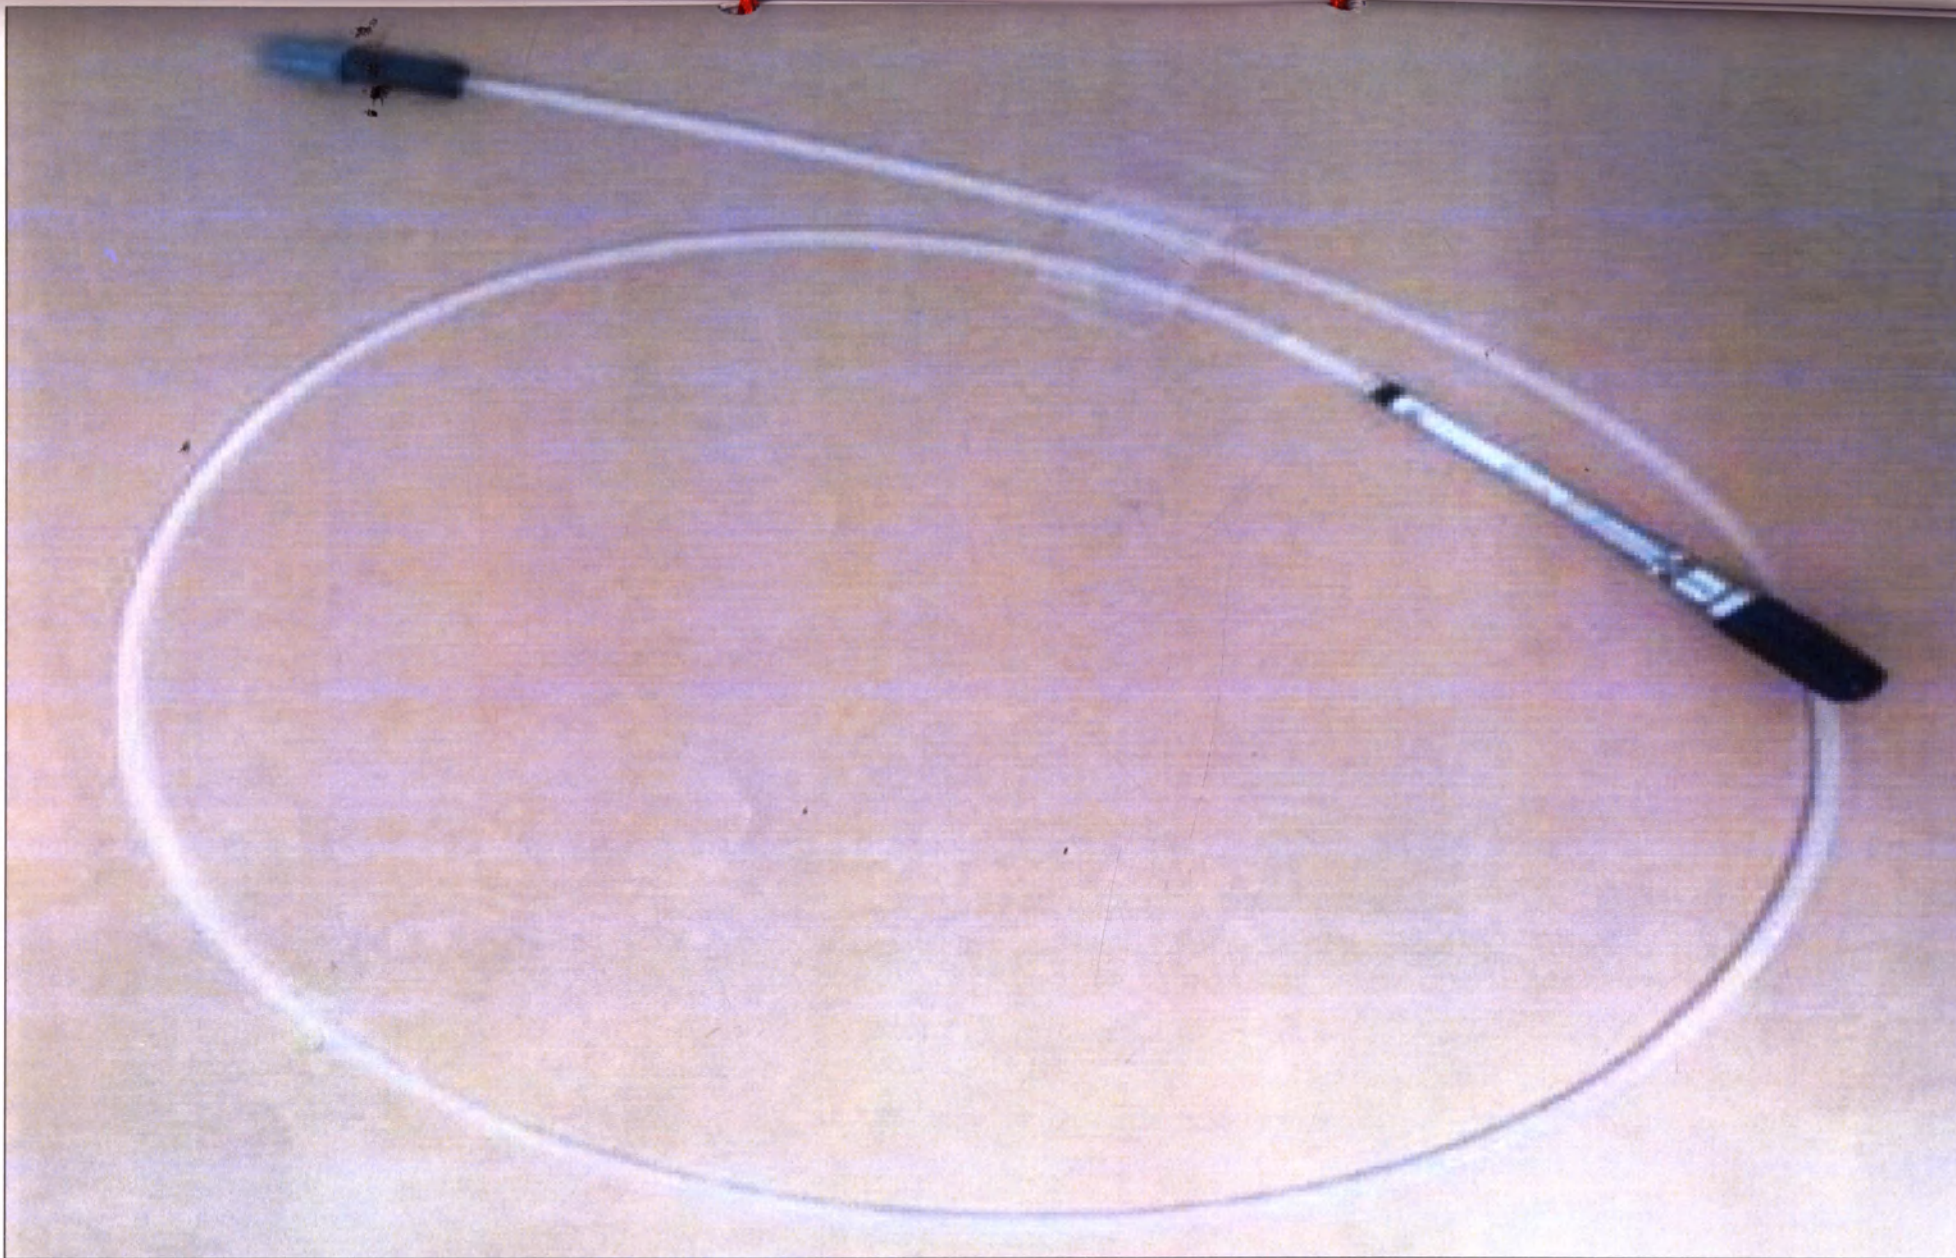


10. Шланги для перемещения источника к аппликаторам и иглам соответственно типам аппликаторов, не более 300 шт.

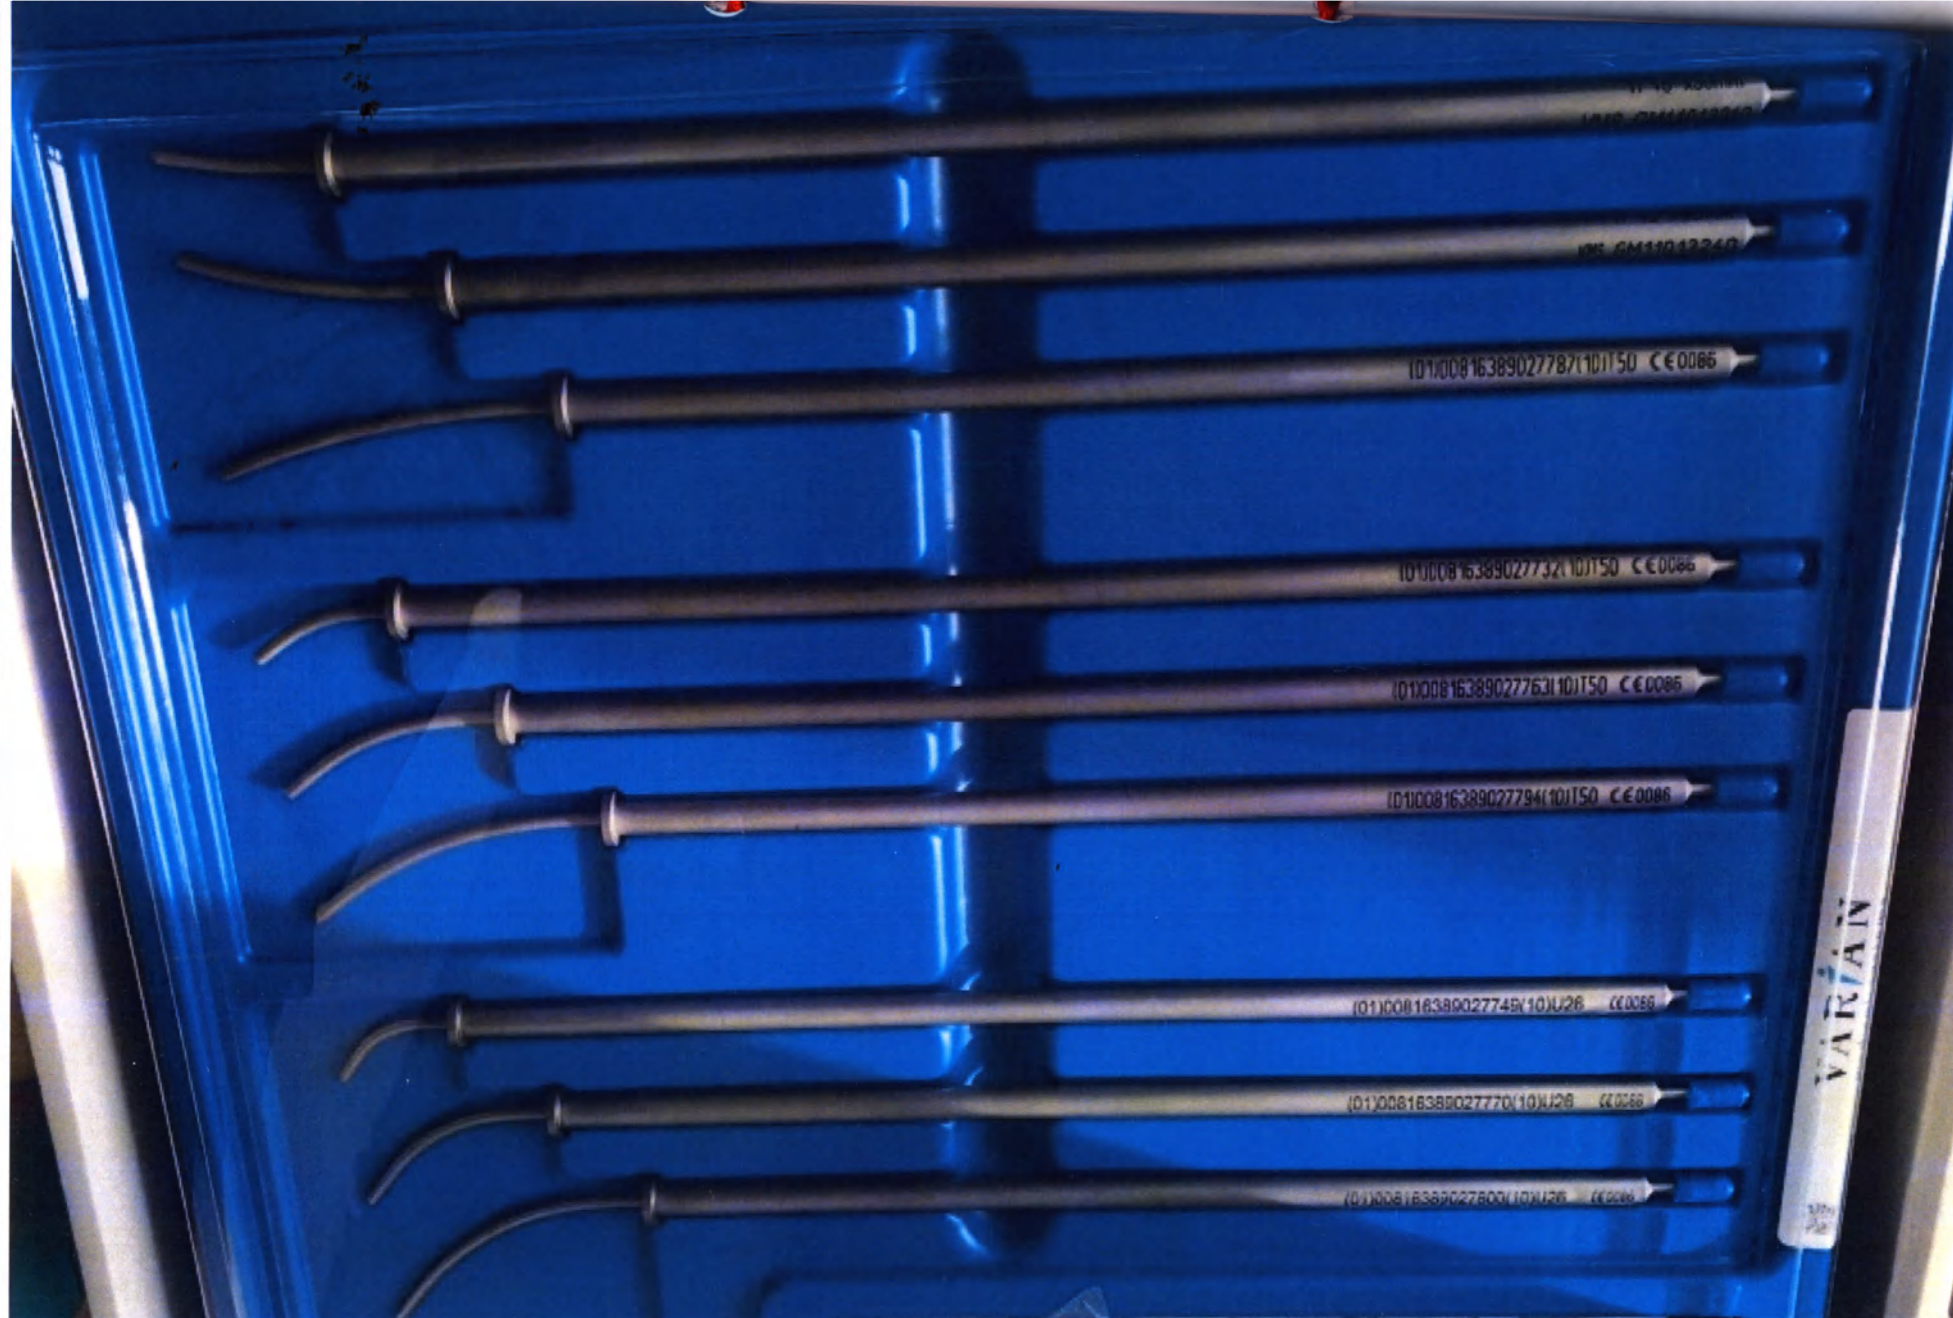


11. Комплект аппликаторов/эндостатов для различных локаций, любые из перечисленных: Внутриполостные, не более 100 шт.; Внутритканевые, не более 100 шт.; Внутрипросветные, не более 100 шт.; Поверхностные, не более 100 шт.

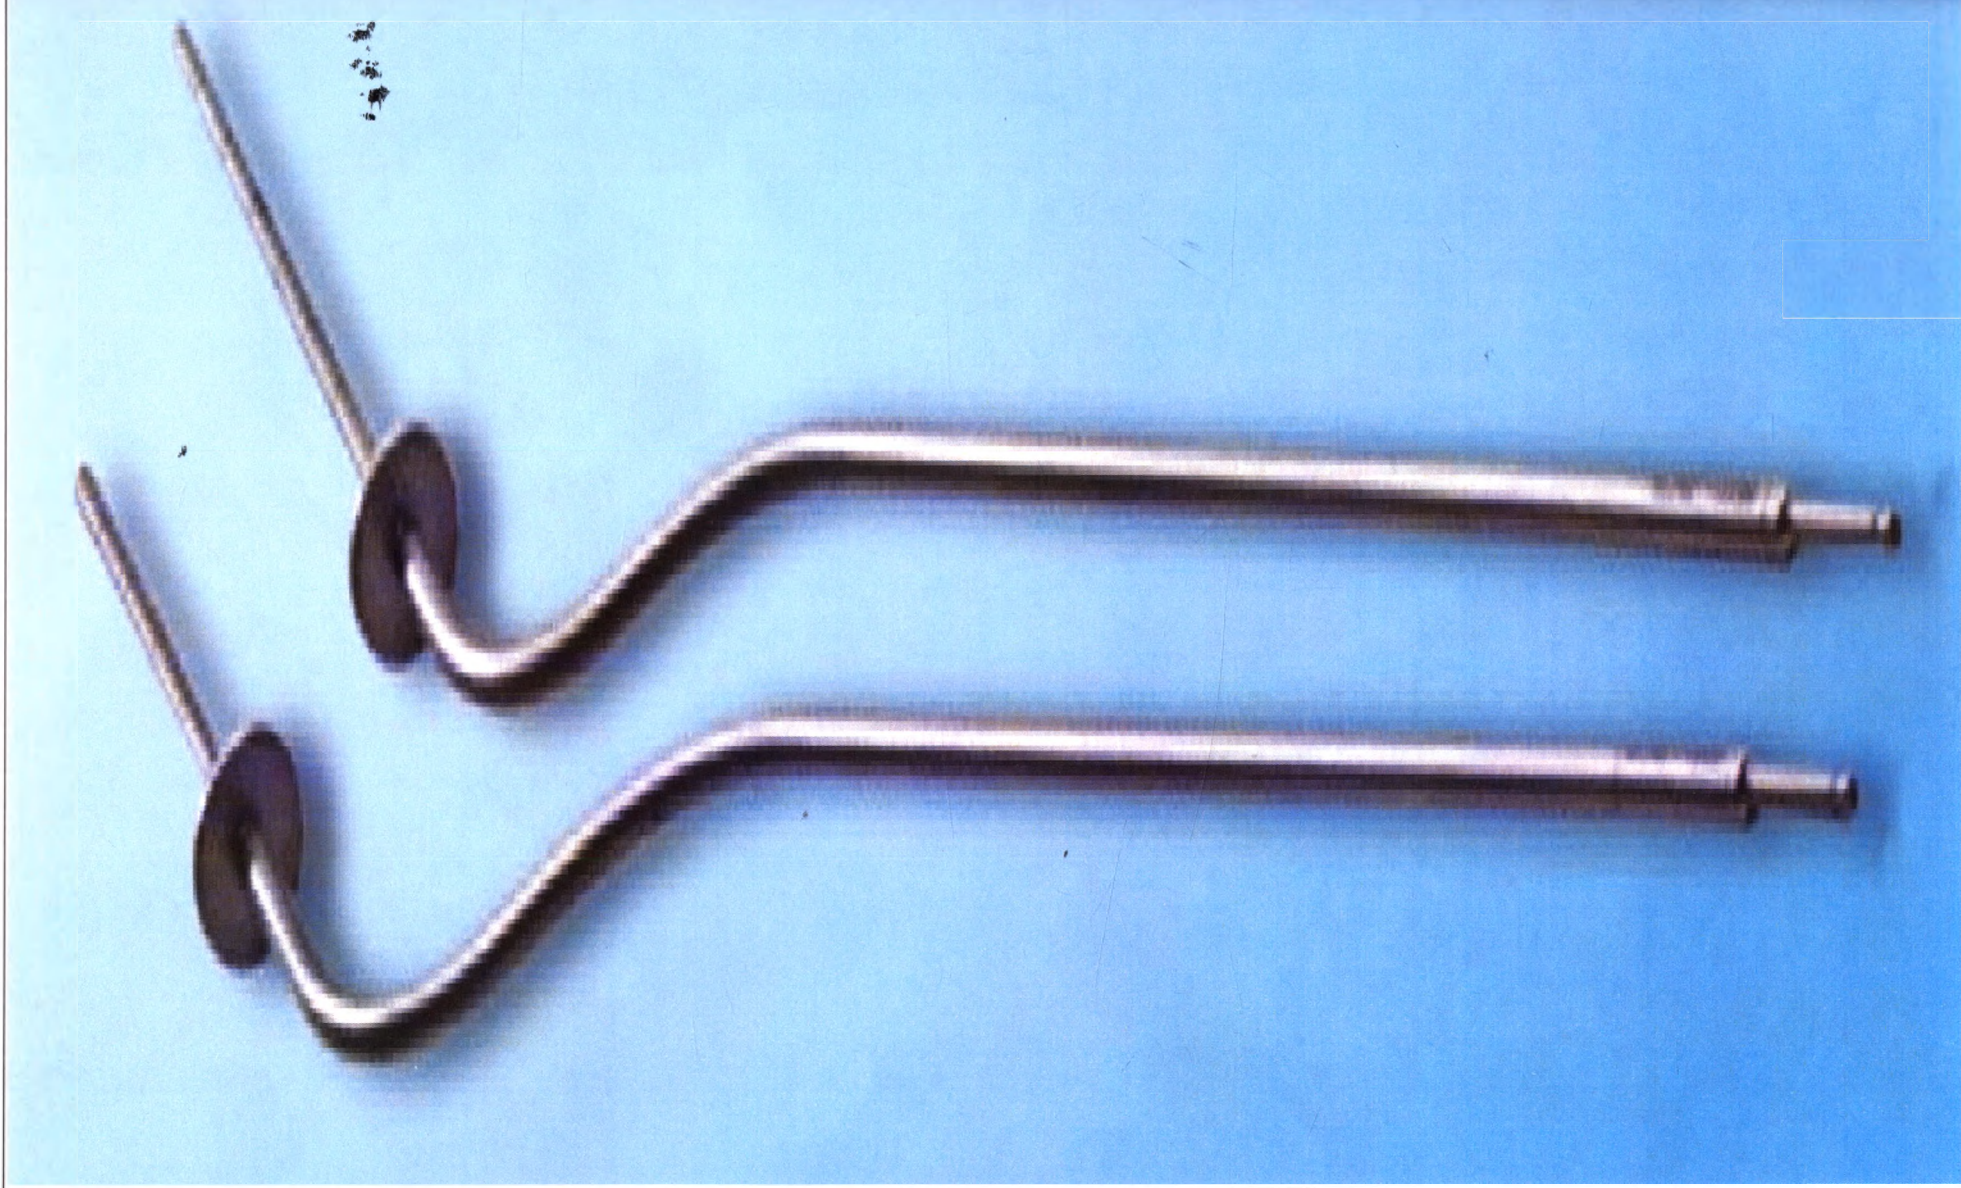




Комплект аппликаторов/эндостатов для различных локаций, любые из перечисленных: Внутриполостные, не более 100 шт; Внутритканевые, не более 100 шт.; Внутрипросветные, не более 100 шт.; Поверхностные, не более 100 шт.

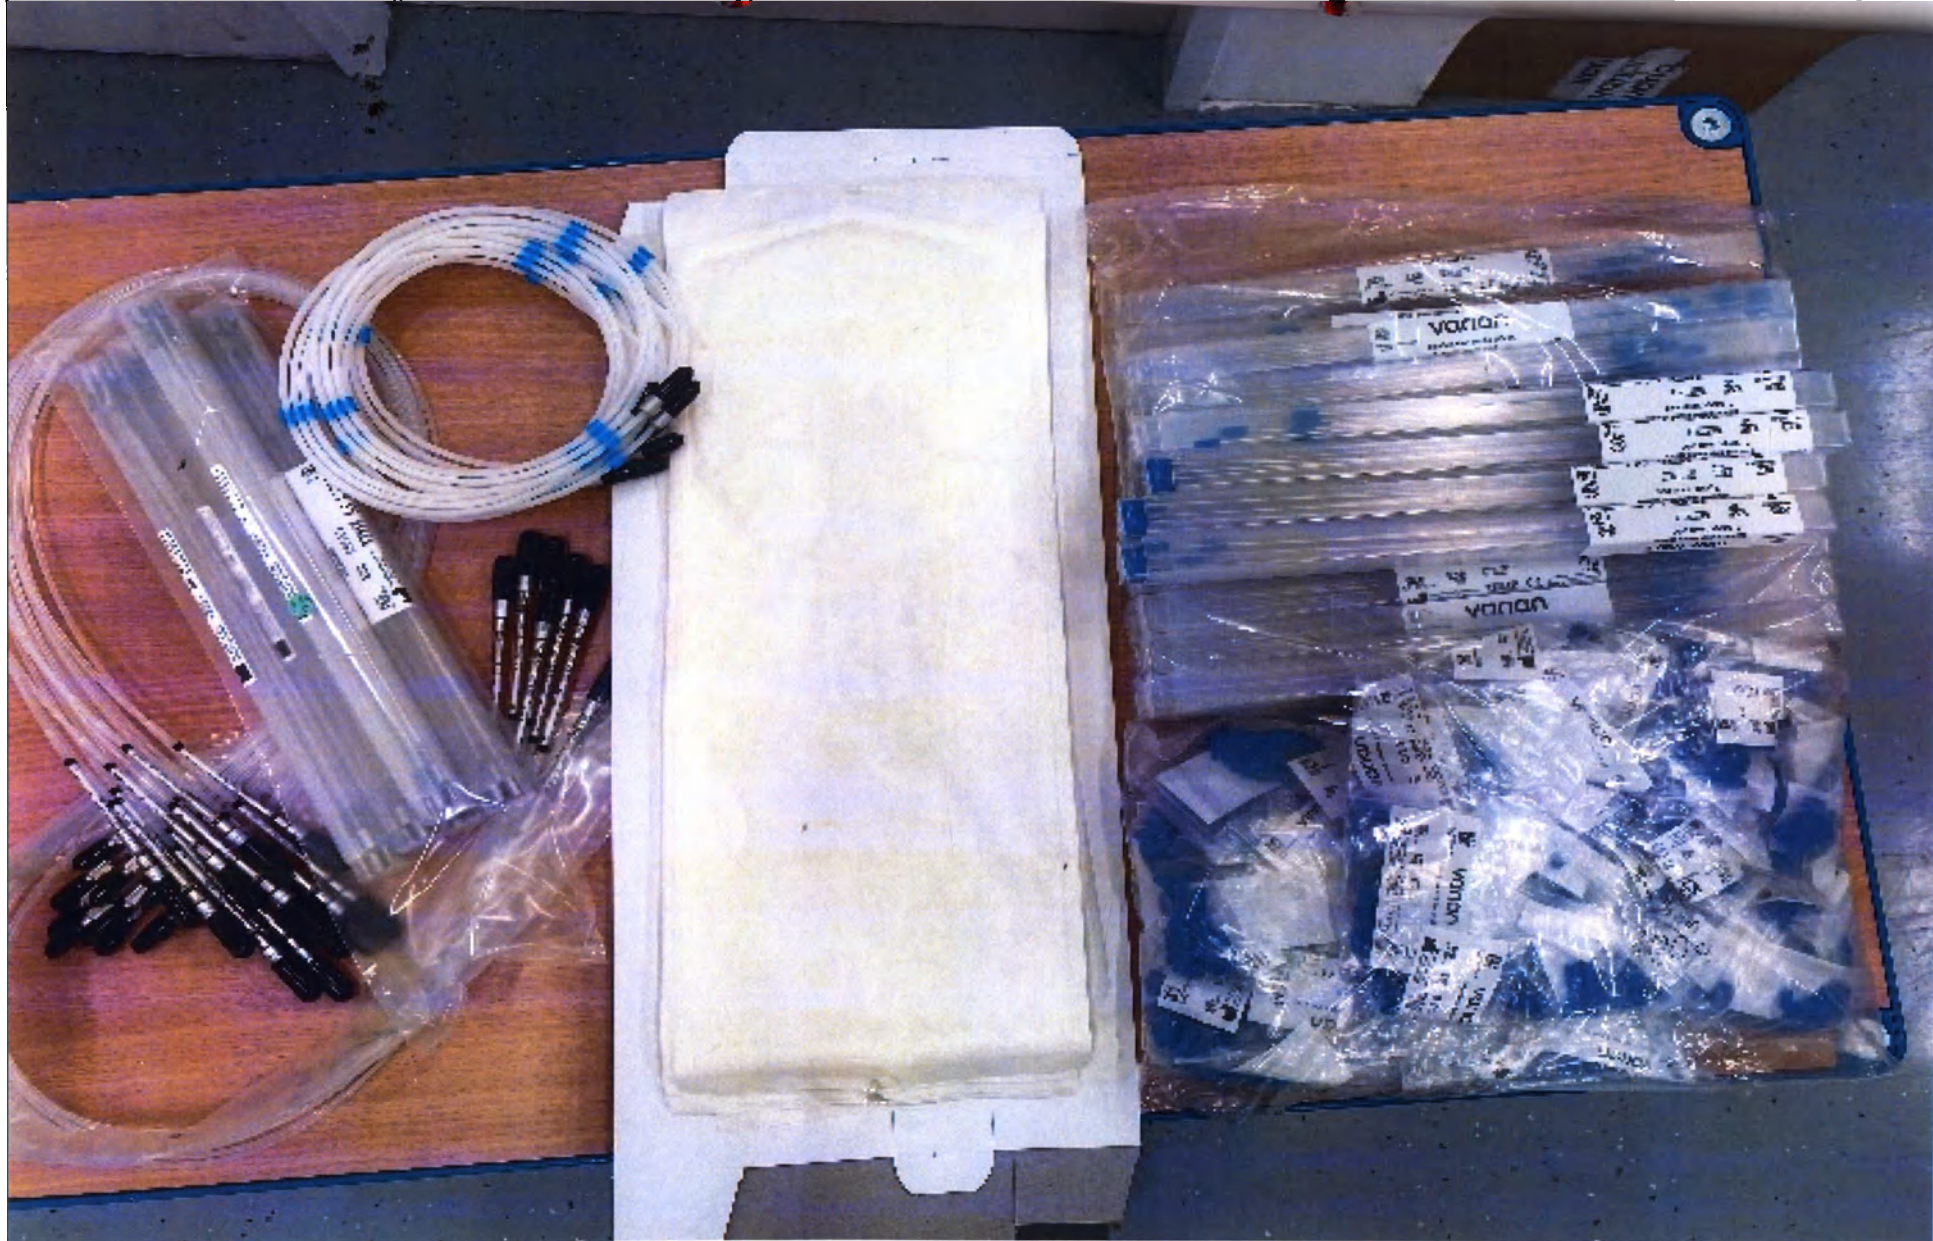

12. Вспомогательные комплектующие к аппликаторам для облучения, в составе: Направляющие монтажные трубки; Соединительные (крепежные) элементы; Инструменты для сборки и разборки аппликаторов.

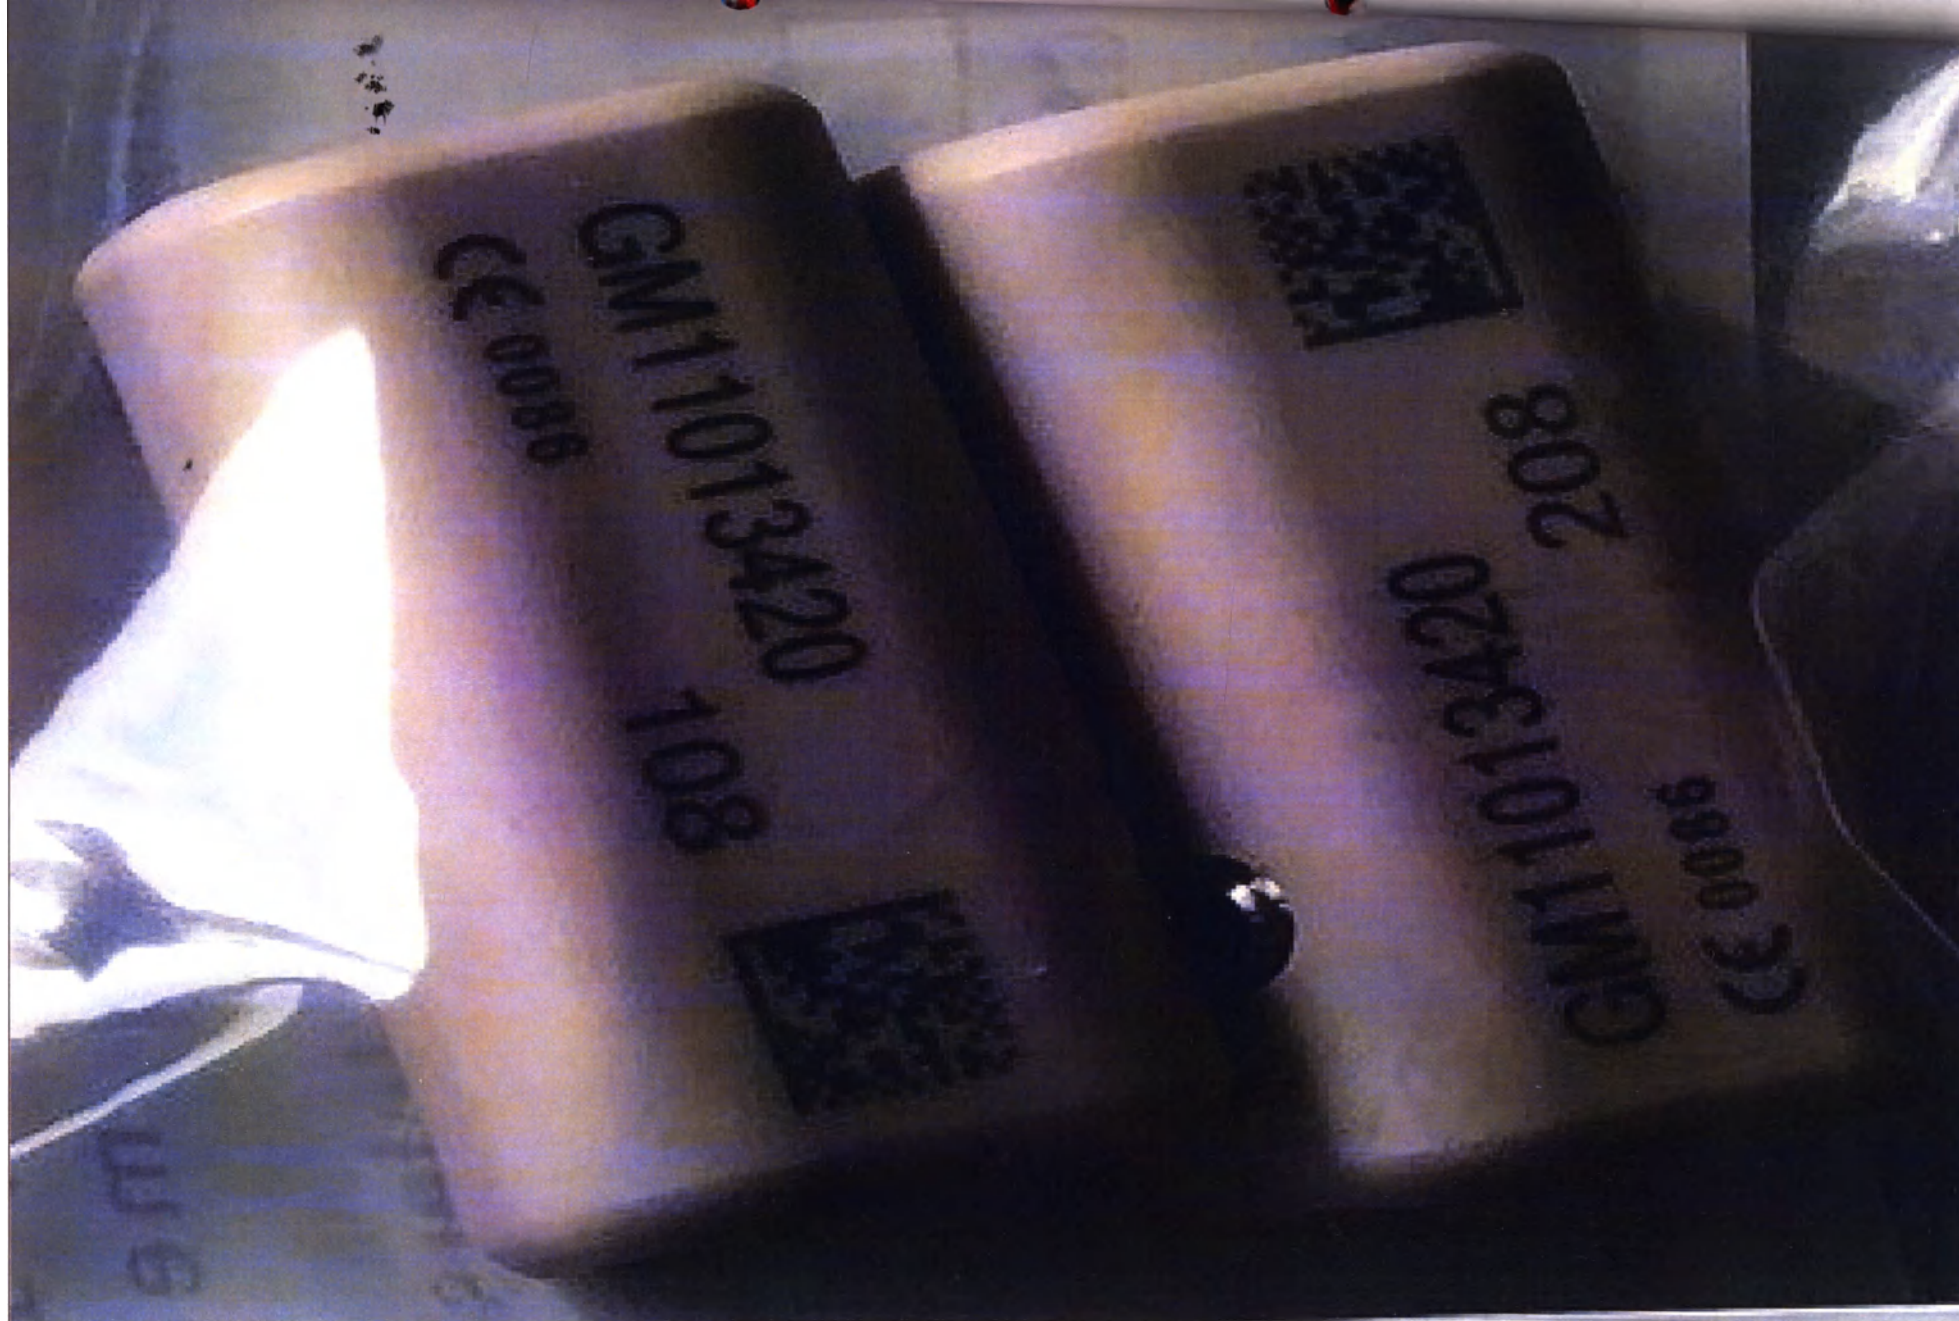


13. Овоиды, не более 1000 шт.

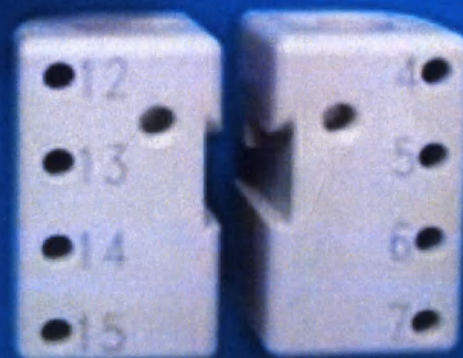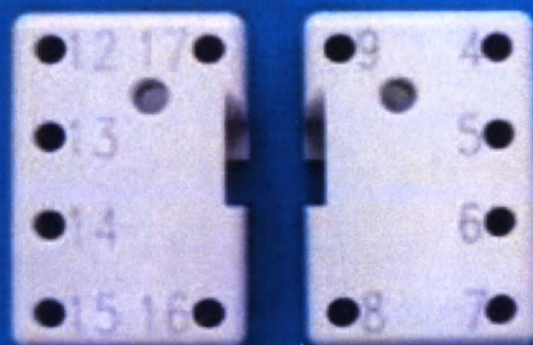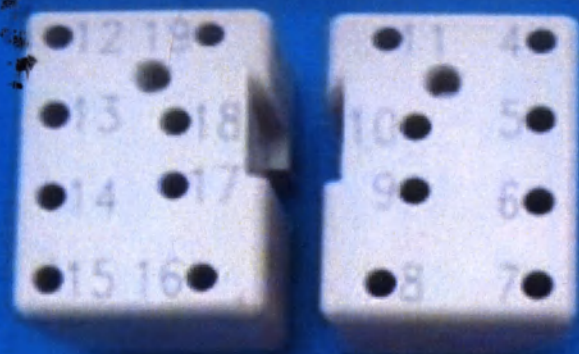


14. Овоиды внутритканевые для аппликаторов, не более 100 шт.




15. Экранирующие вставки в аппликаторы для радиационной защиты здоровых тканей.

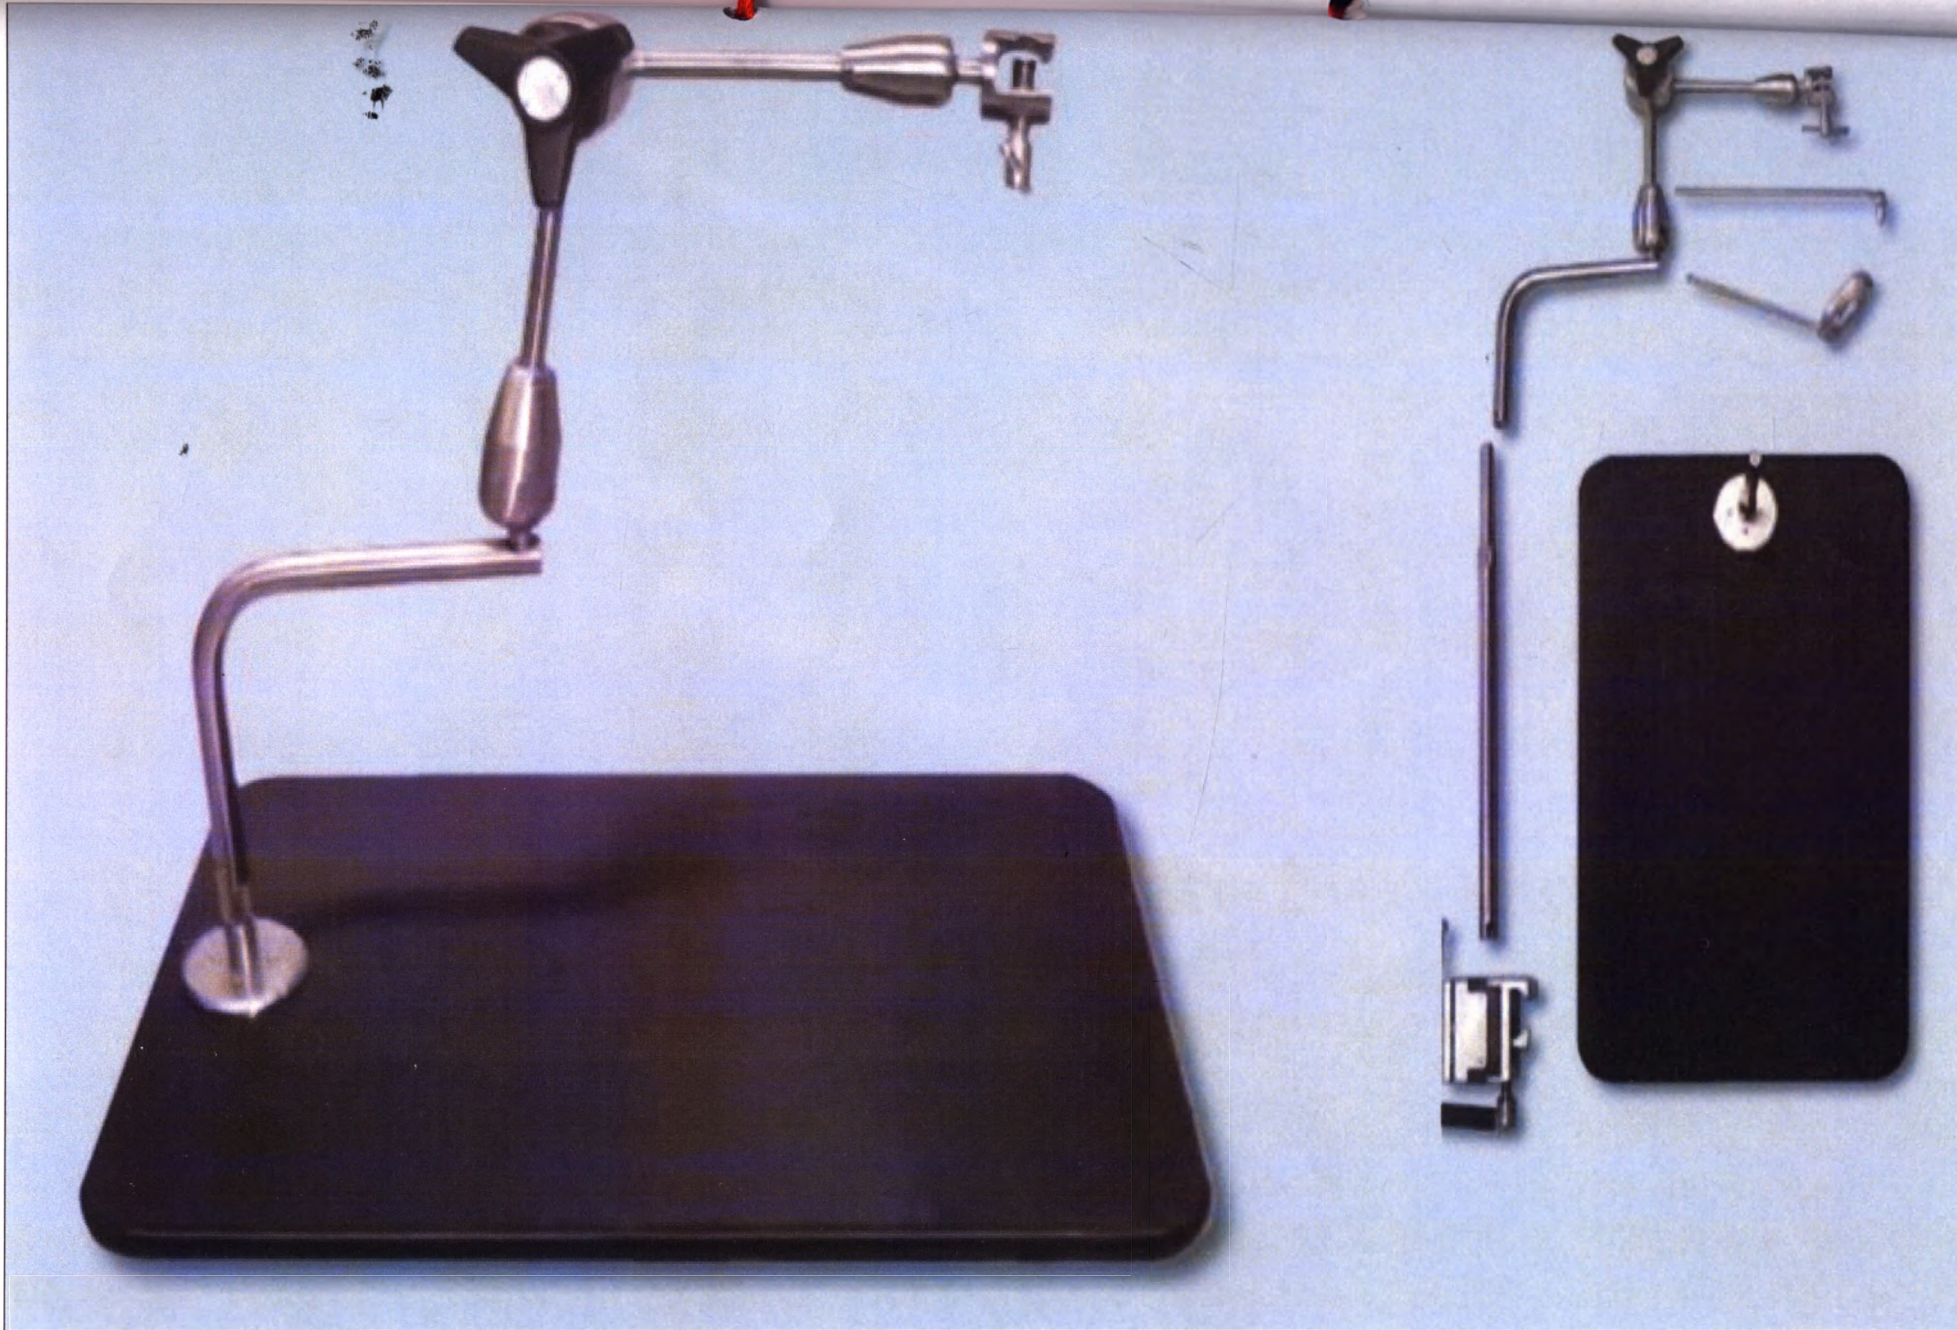


16. Система фиксации эндостатов (аппликаторов).

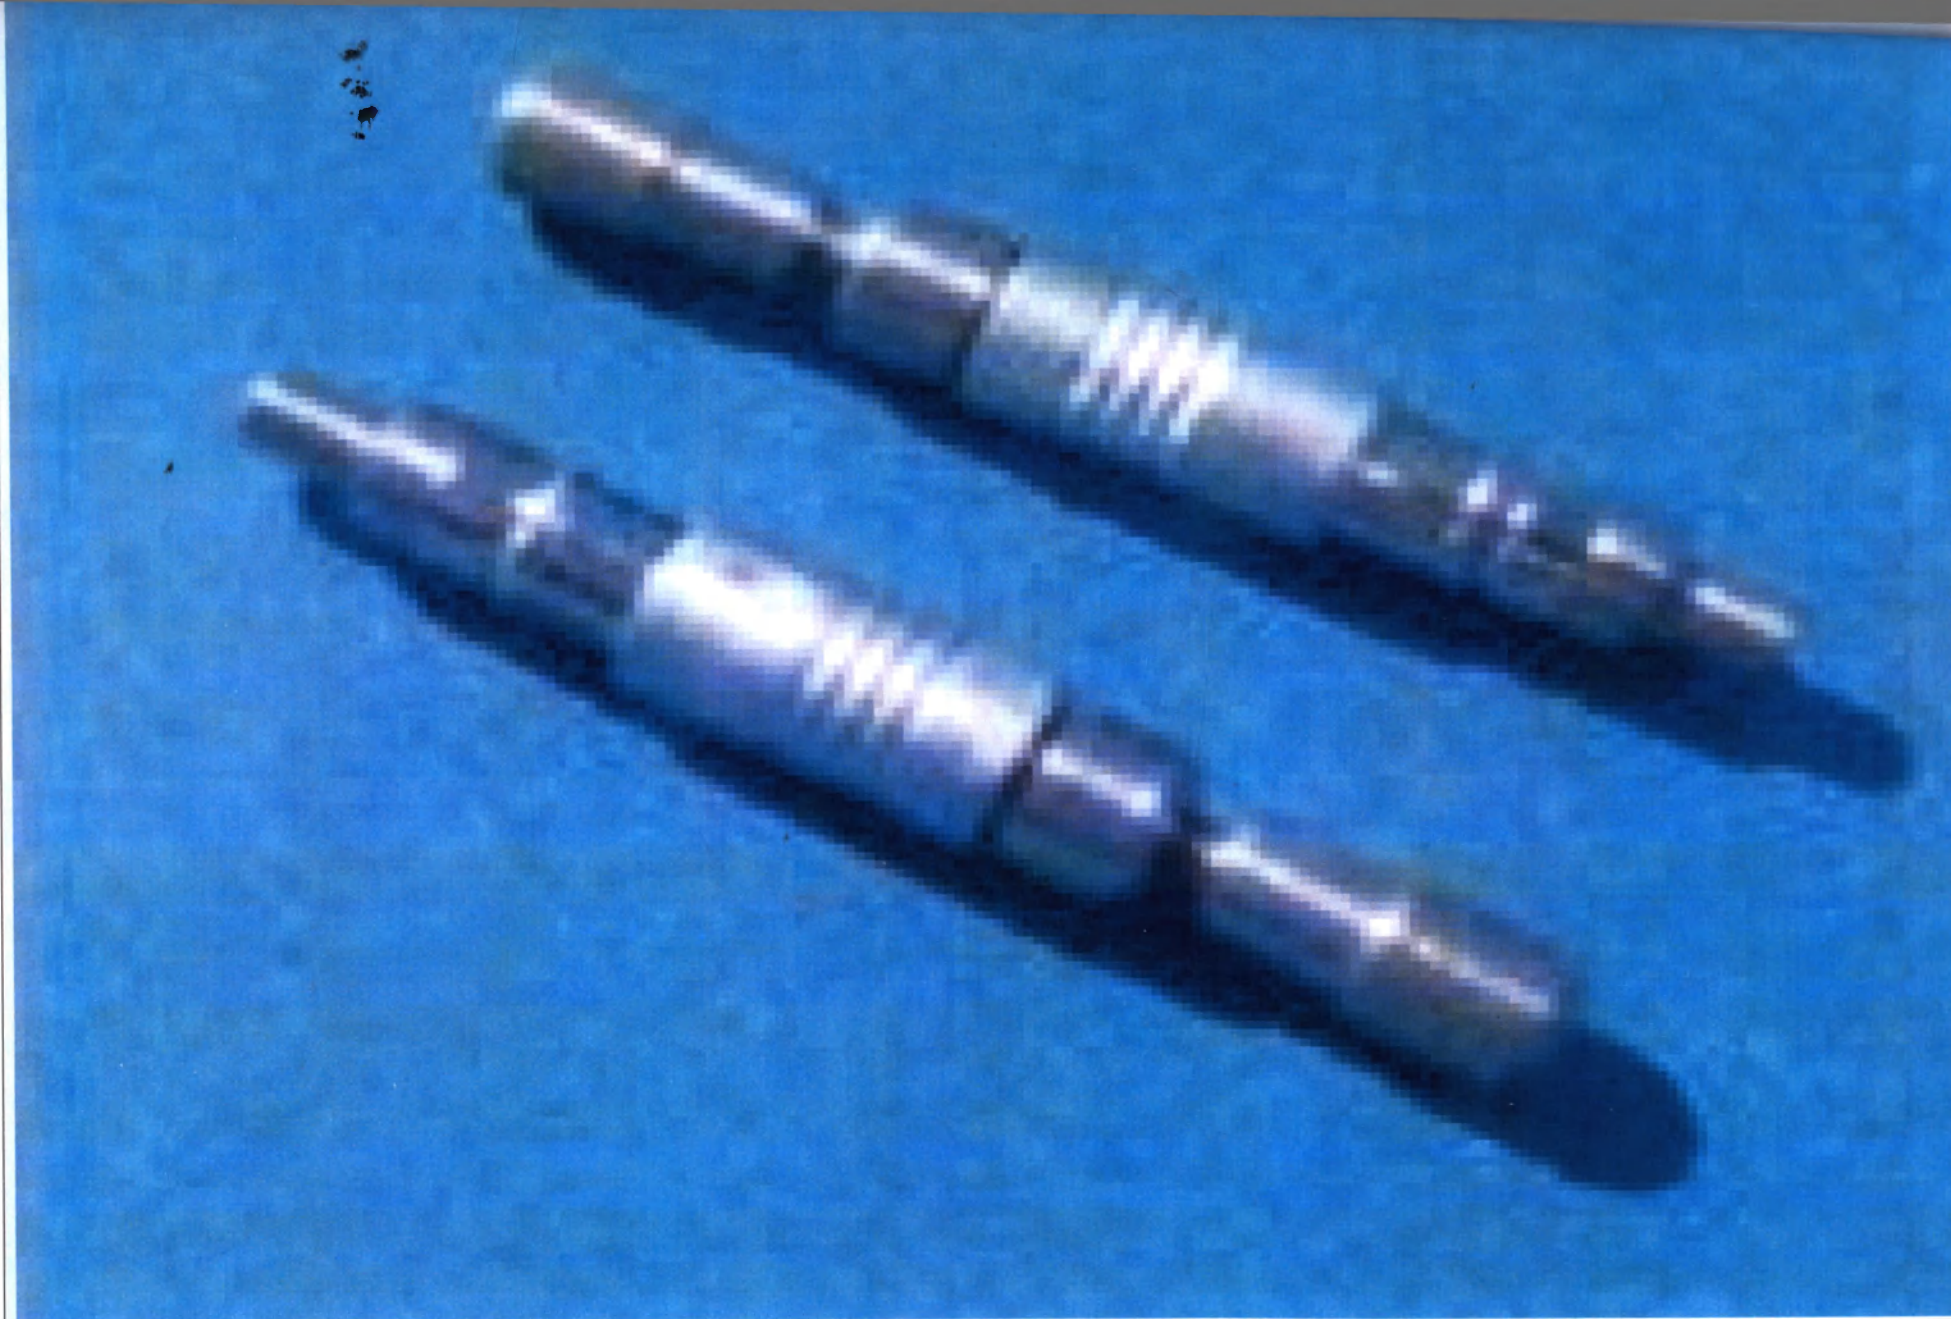


17. Адаптер для системы фиксации эндостатов (аппликаторов).

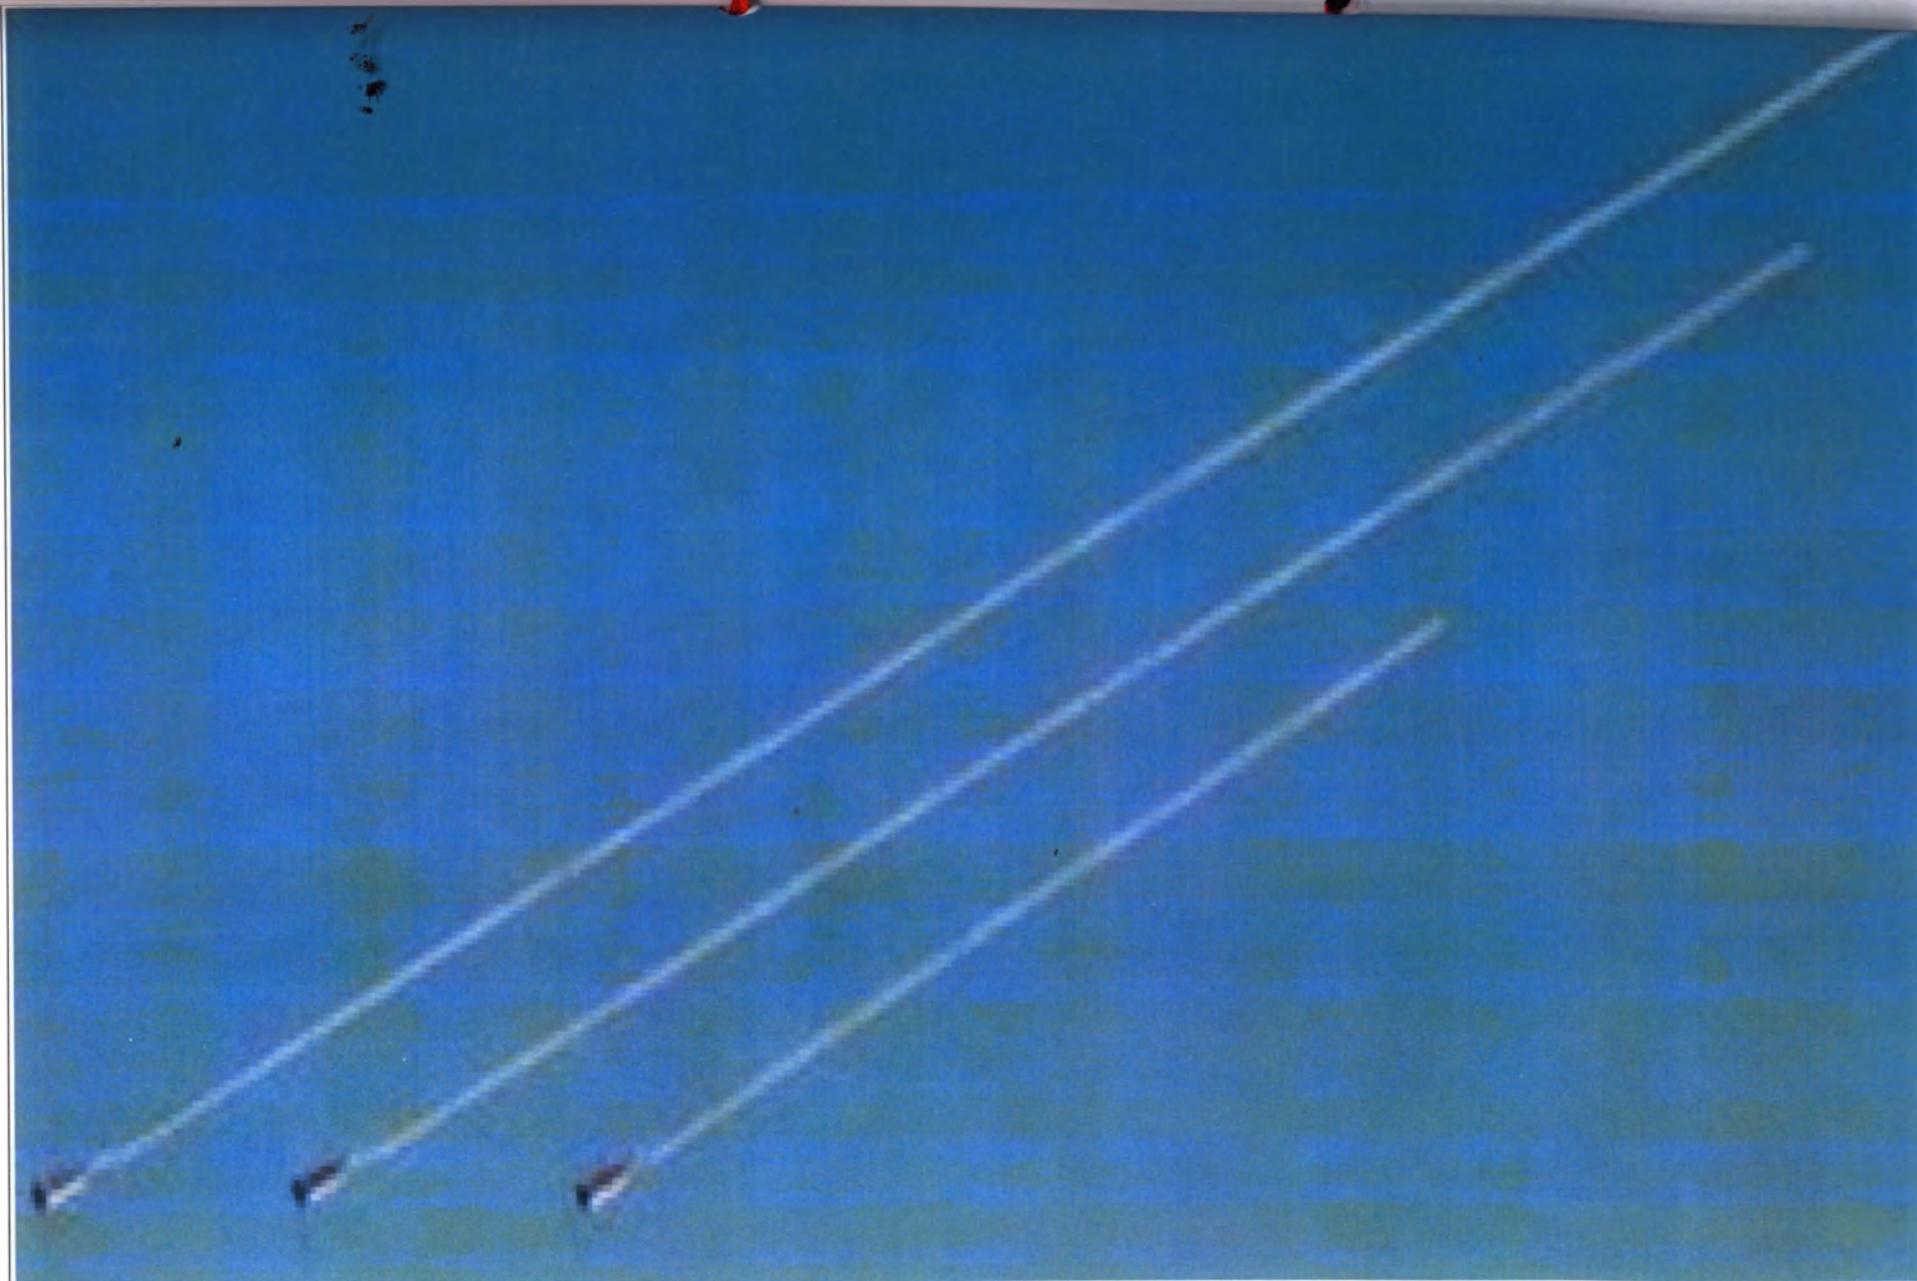

18. Обтураторы.

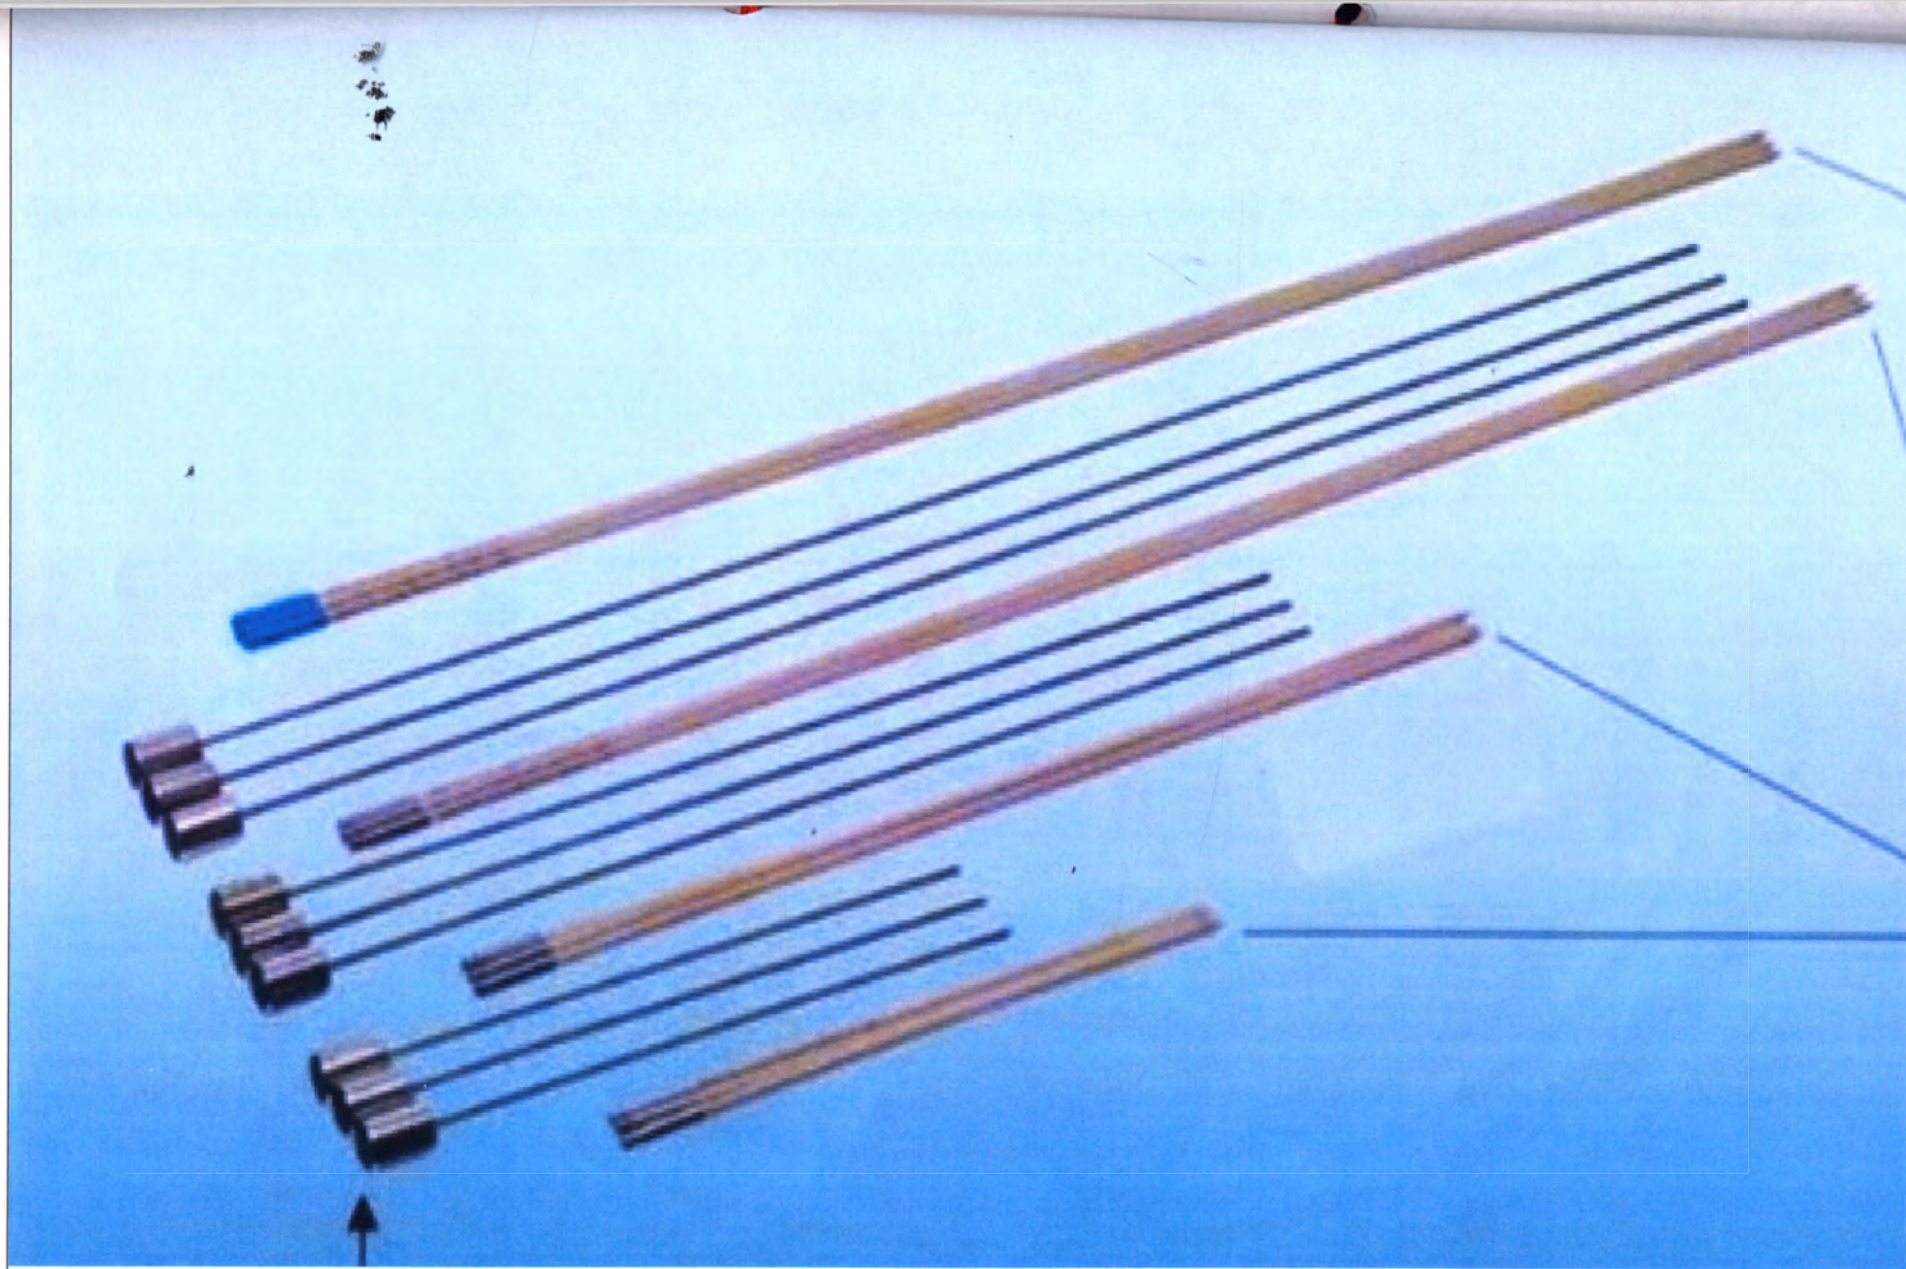

19. Мандрены.

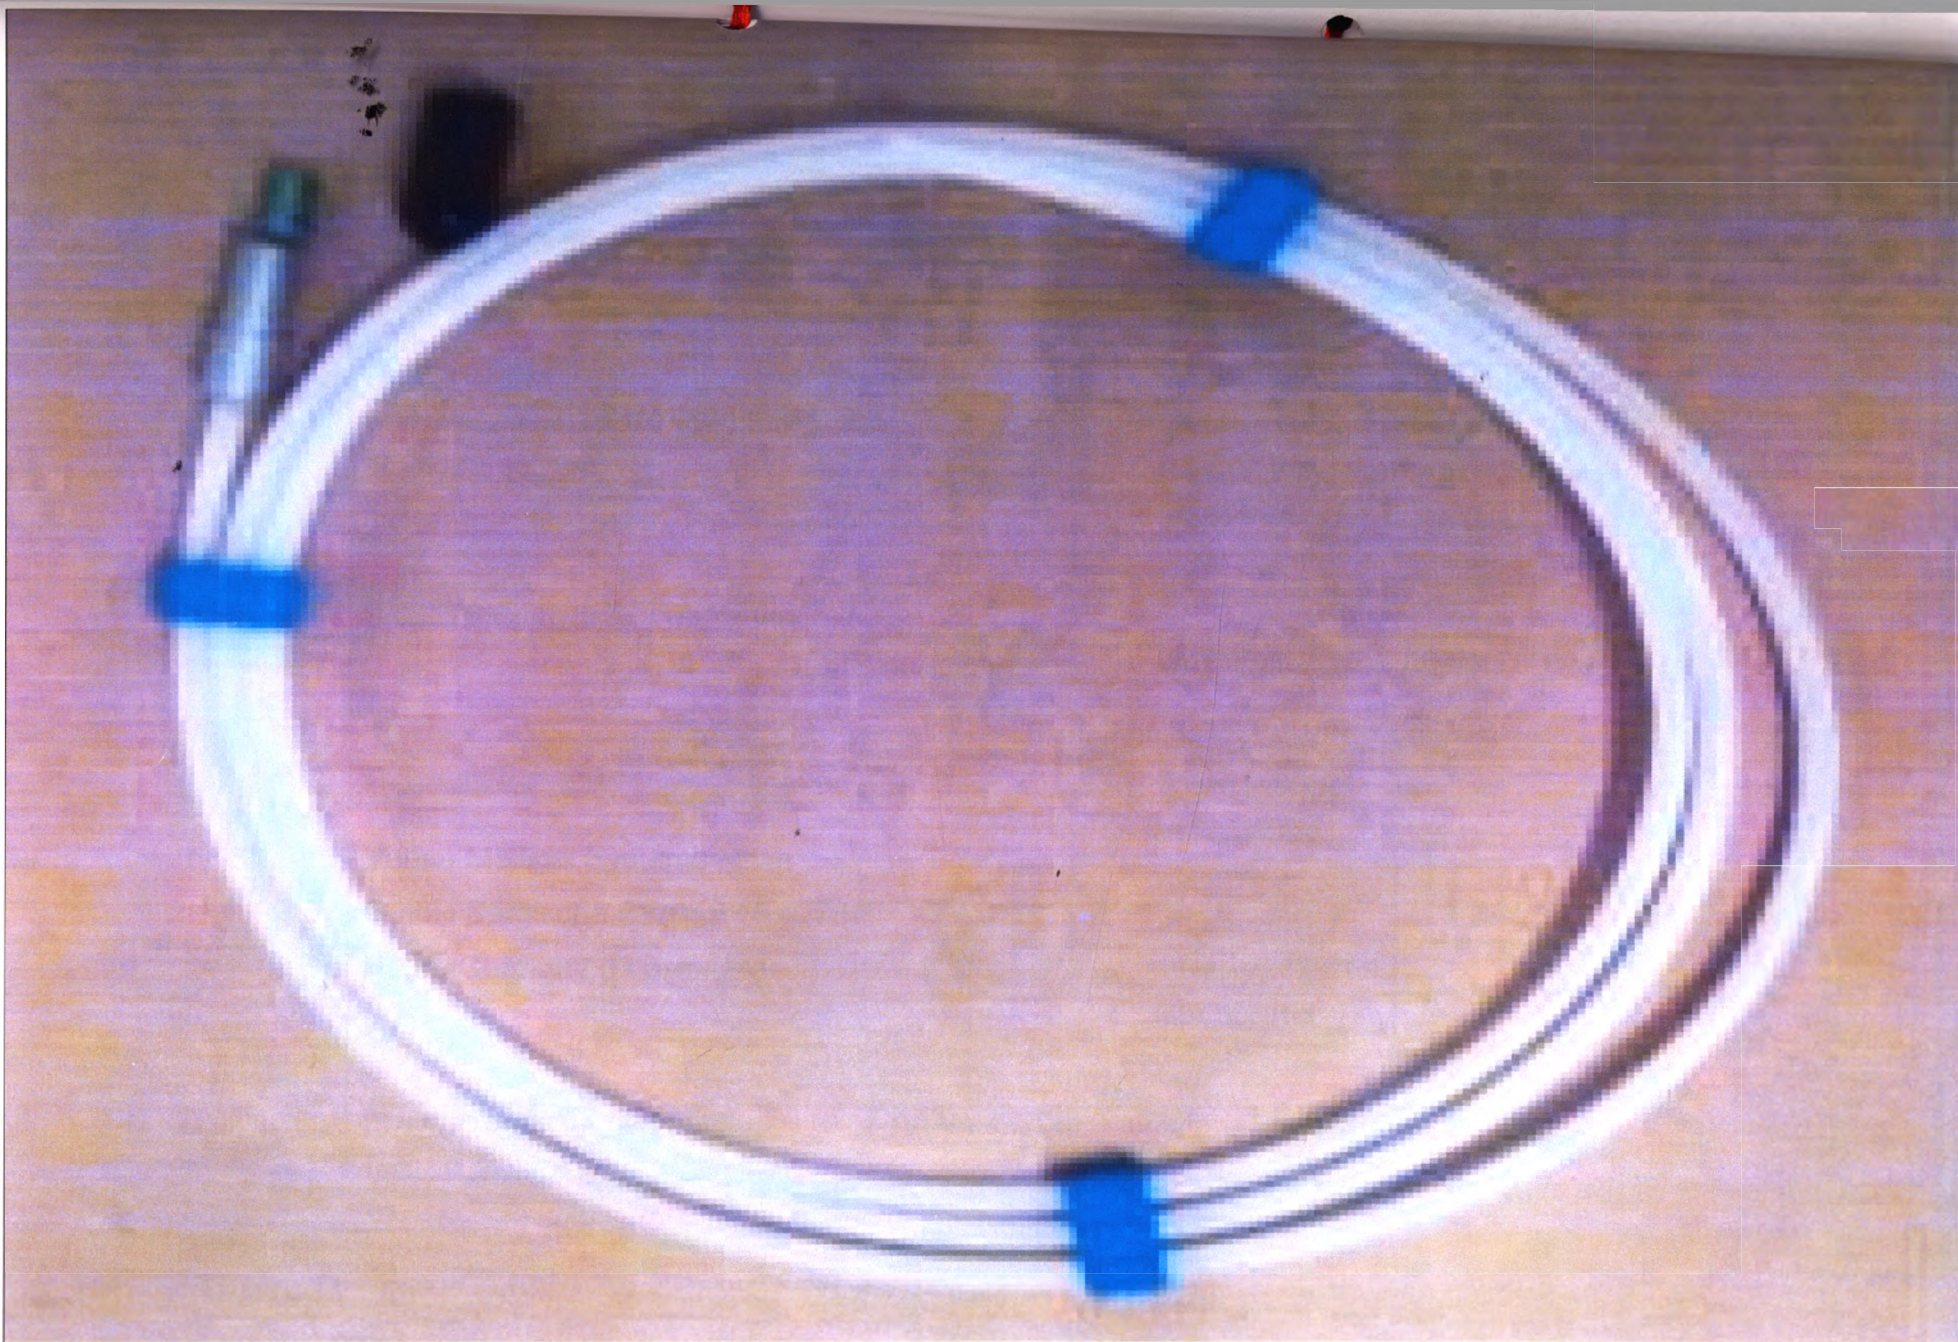

20. Рентгенконтрастные маркеры, не более 1000 шт.

varian

Система брахитерапии



REF

Bravos

SN

XXXX



Переключение напряжения
электропитания, со 100 - 240 В пер. тока/
50 - 60 Гц, 100 ВА



Производитель

Varian Medical Systems, Inc. (Вариан
Медикал Системс, Инк., США) 3100
Hansen Way Palo Alto, California
94304 USA.

Страна производства: Германия



Дата производства ДД-ММ-ГГГГ

Место производства

Varian Medical Systems Haan
GmbH Bergische Strasse 16 42781
Haan, Germany (Германия)




Электрическое
медицинское
изделие,
удовлетворяет
стандарту ГОСТ Р
МЭК 60601-1




www.MyVarian.com

Регистрационное удостоверение № от ДД-ММ-ГГГГ срок действия бессрочно


Принадлежности:

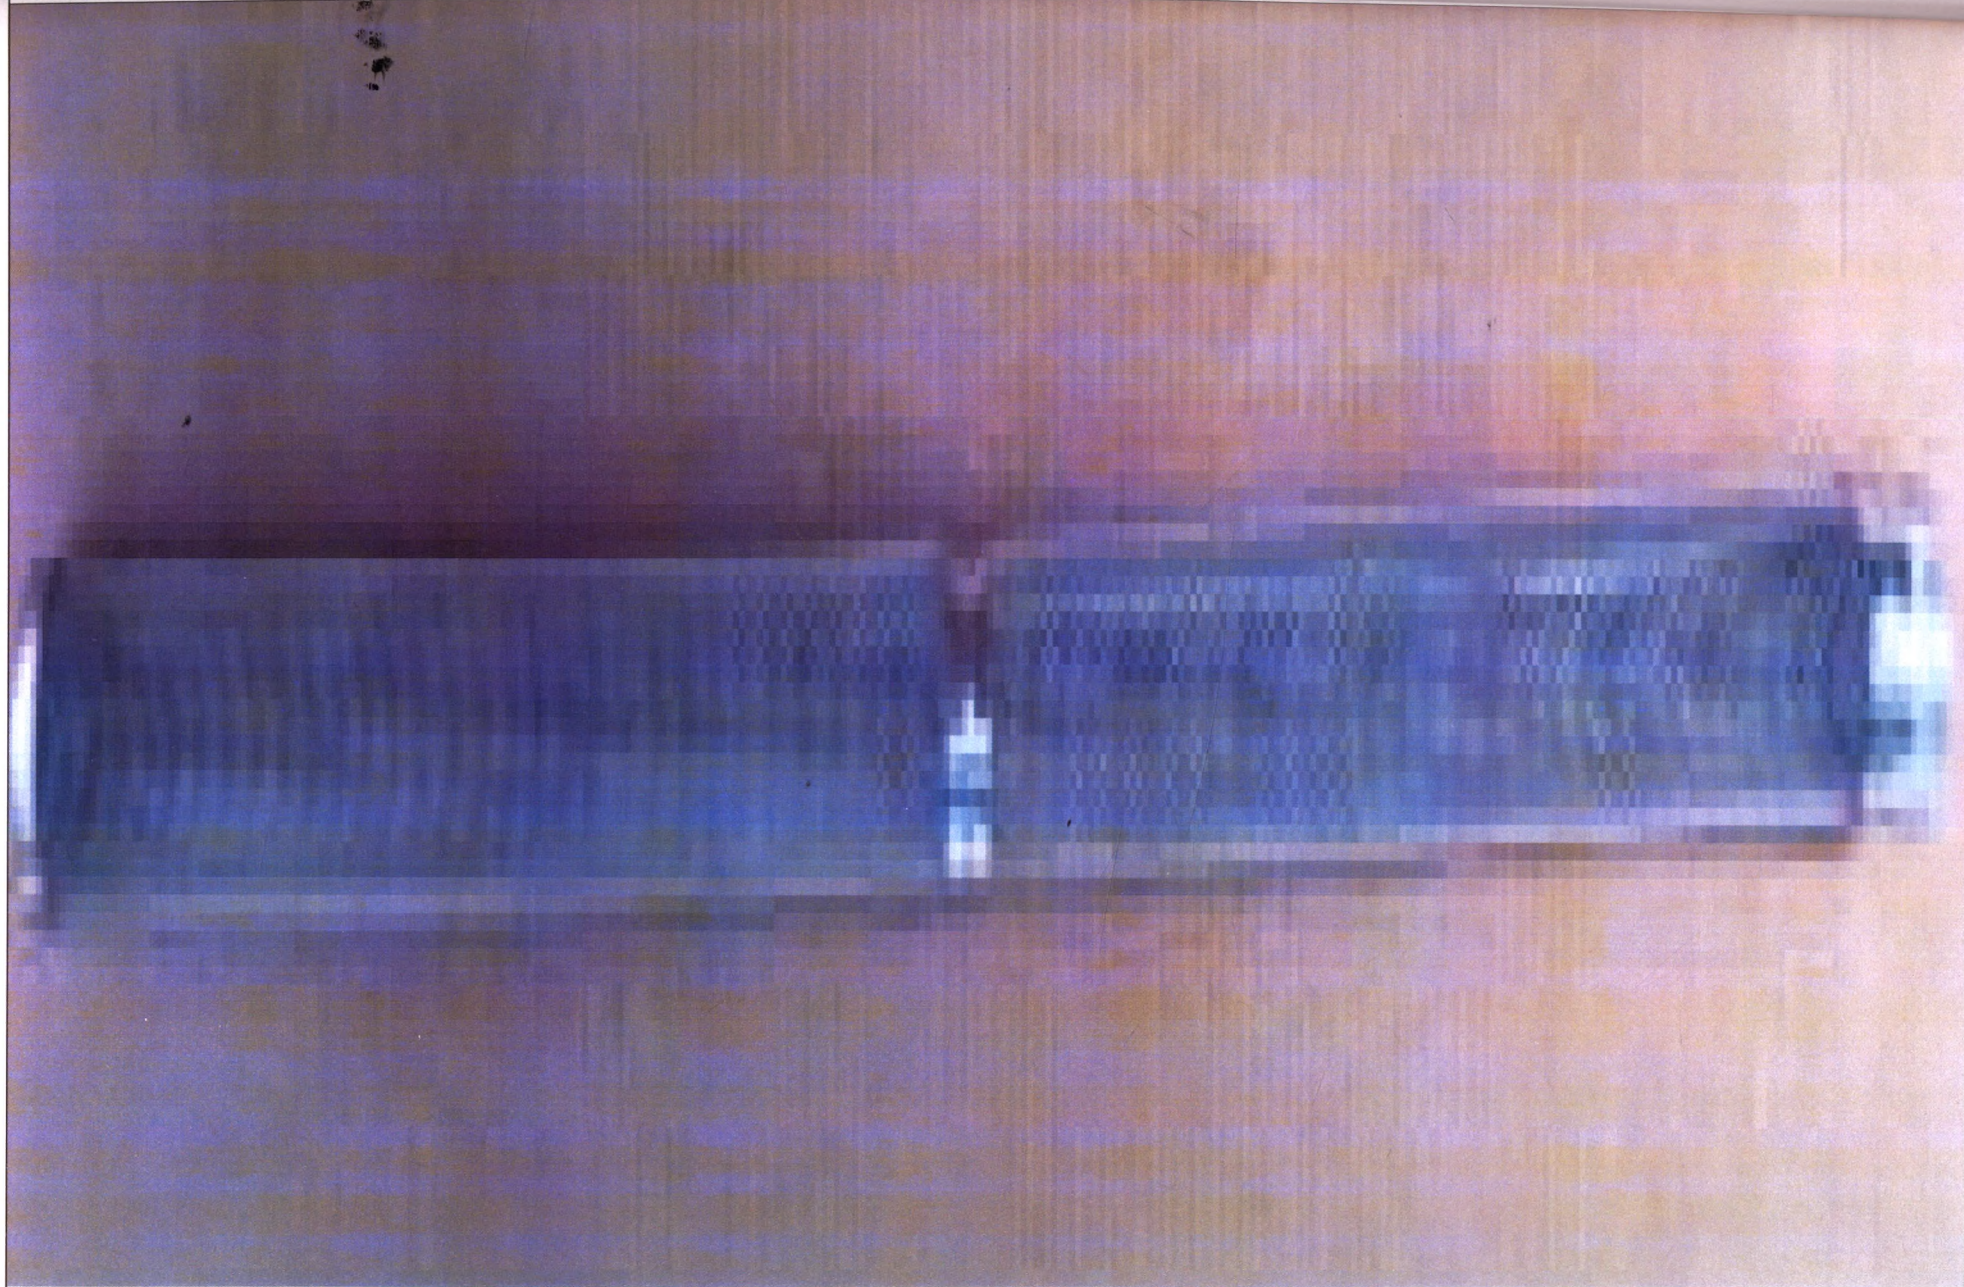


1. Приспособление для хранения принадлежностей

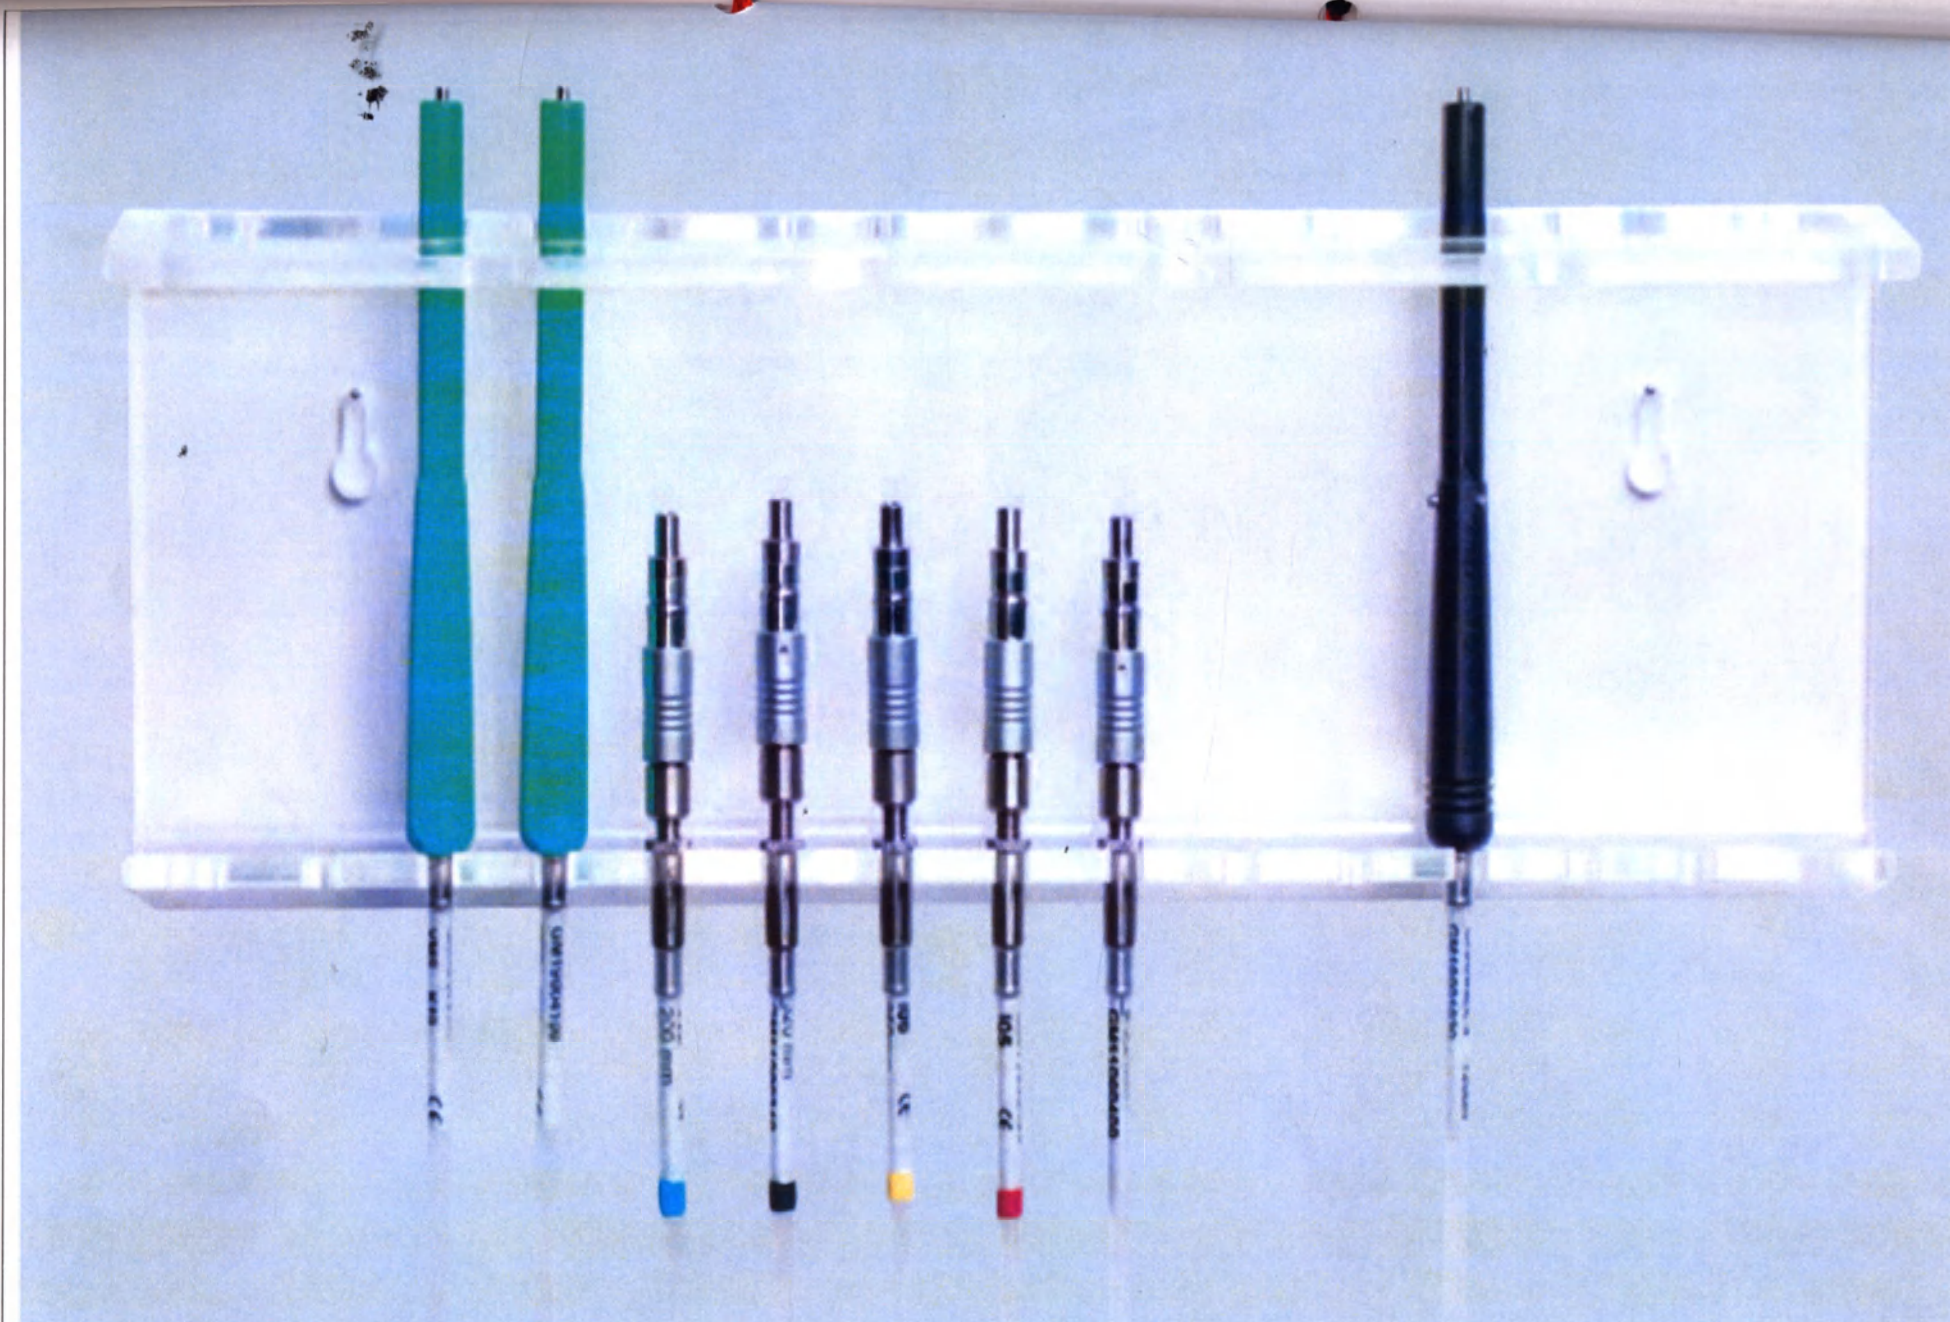

2. Настенный держатель для шлангов.

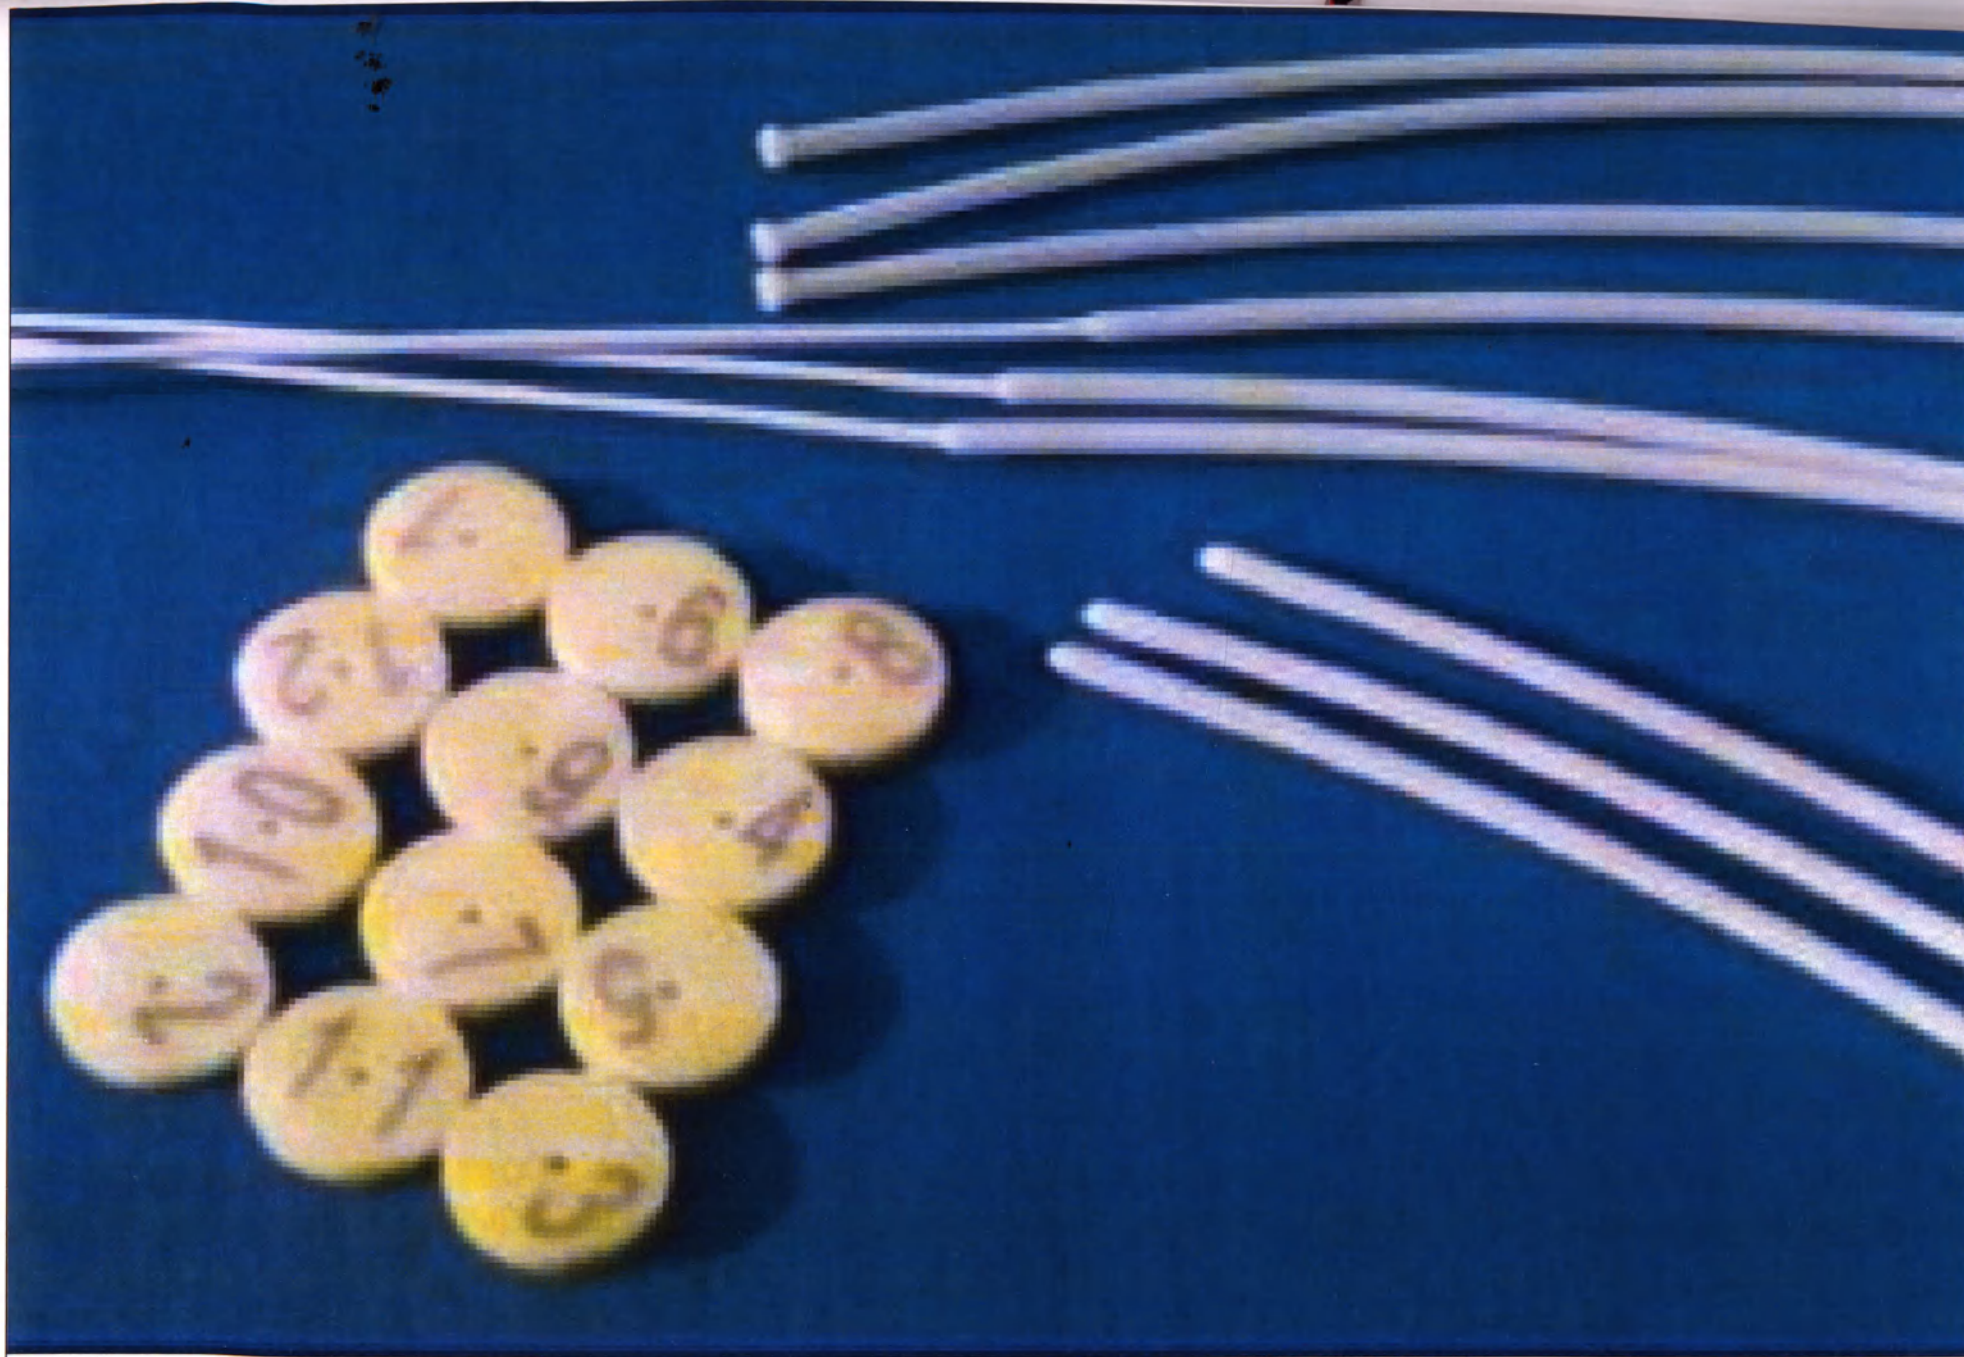


3. Набор маркеров предотвращающих протечку в каналах.

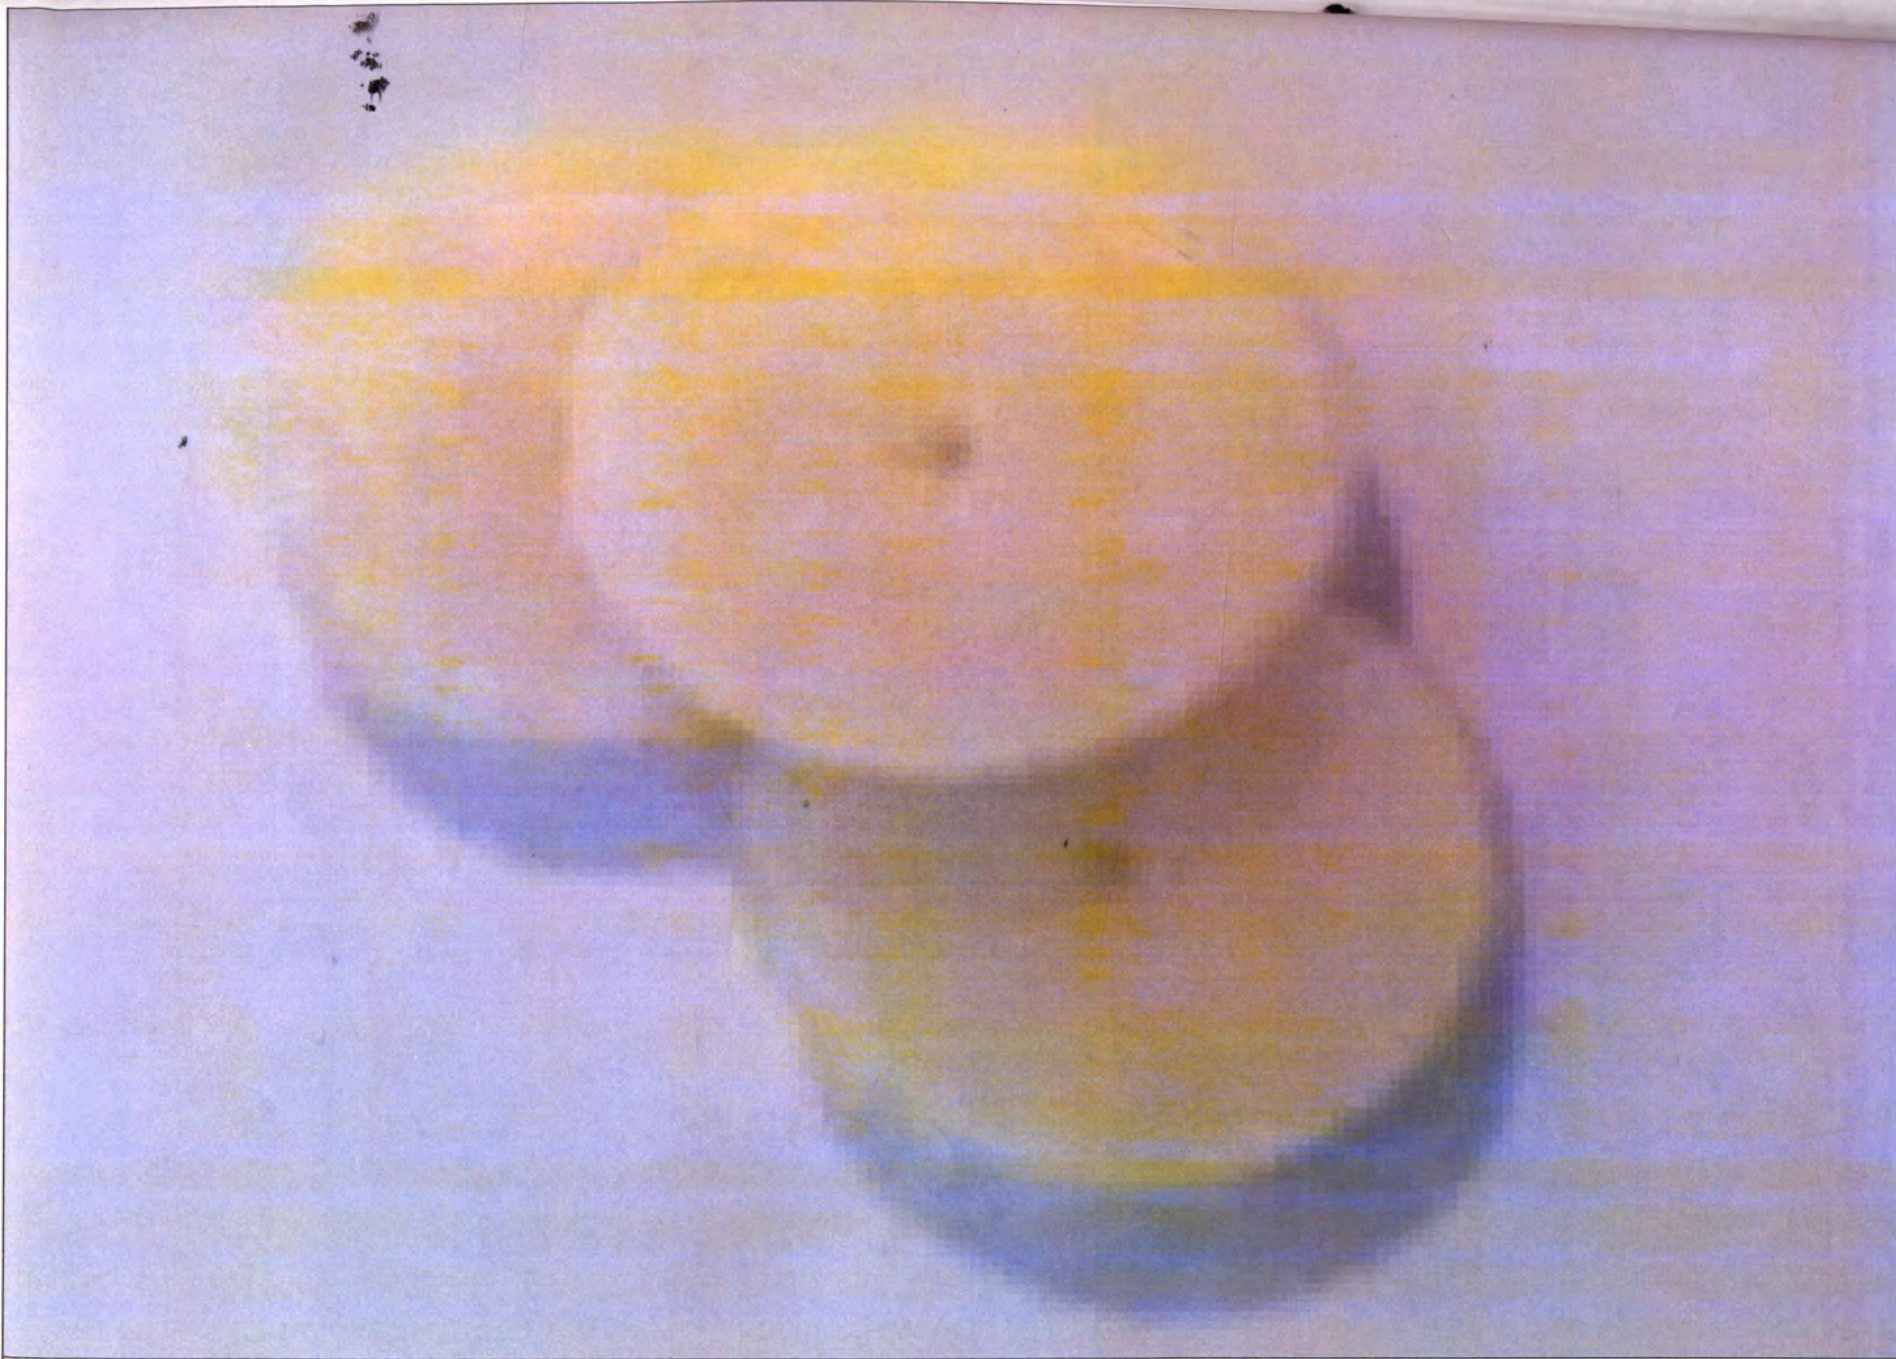


4. Набор торцевых стопоров, предотвращающих протечку.



5. Набор заглушек с защитой от протекания

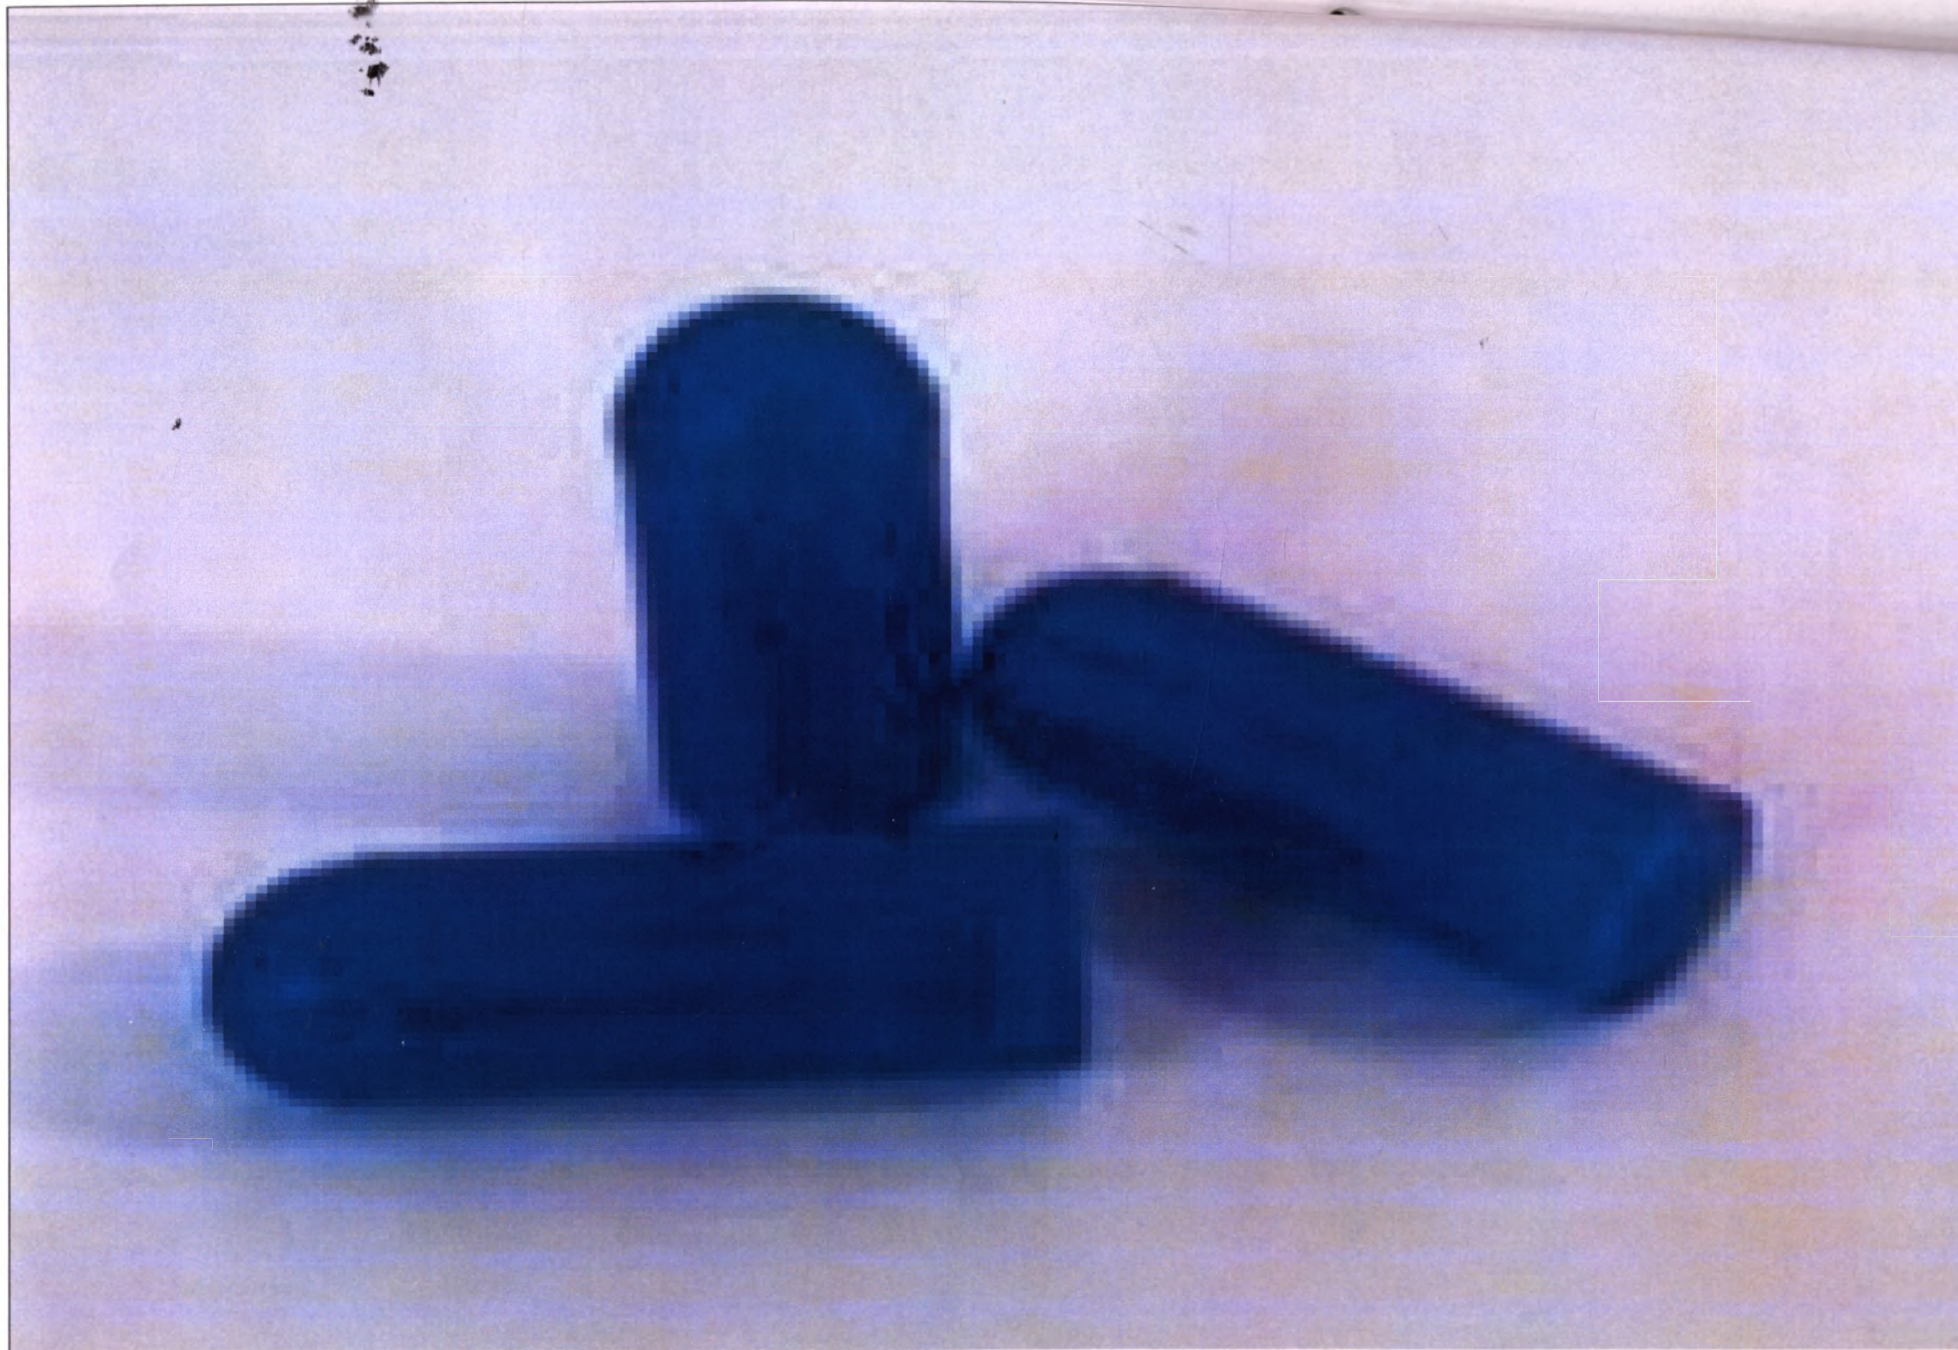


6. Колпачки защитные для энлостатов и шлангов различных цветов и размеров, не более 1000 шт.

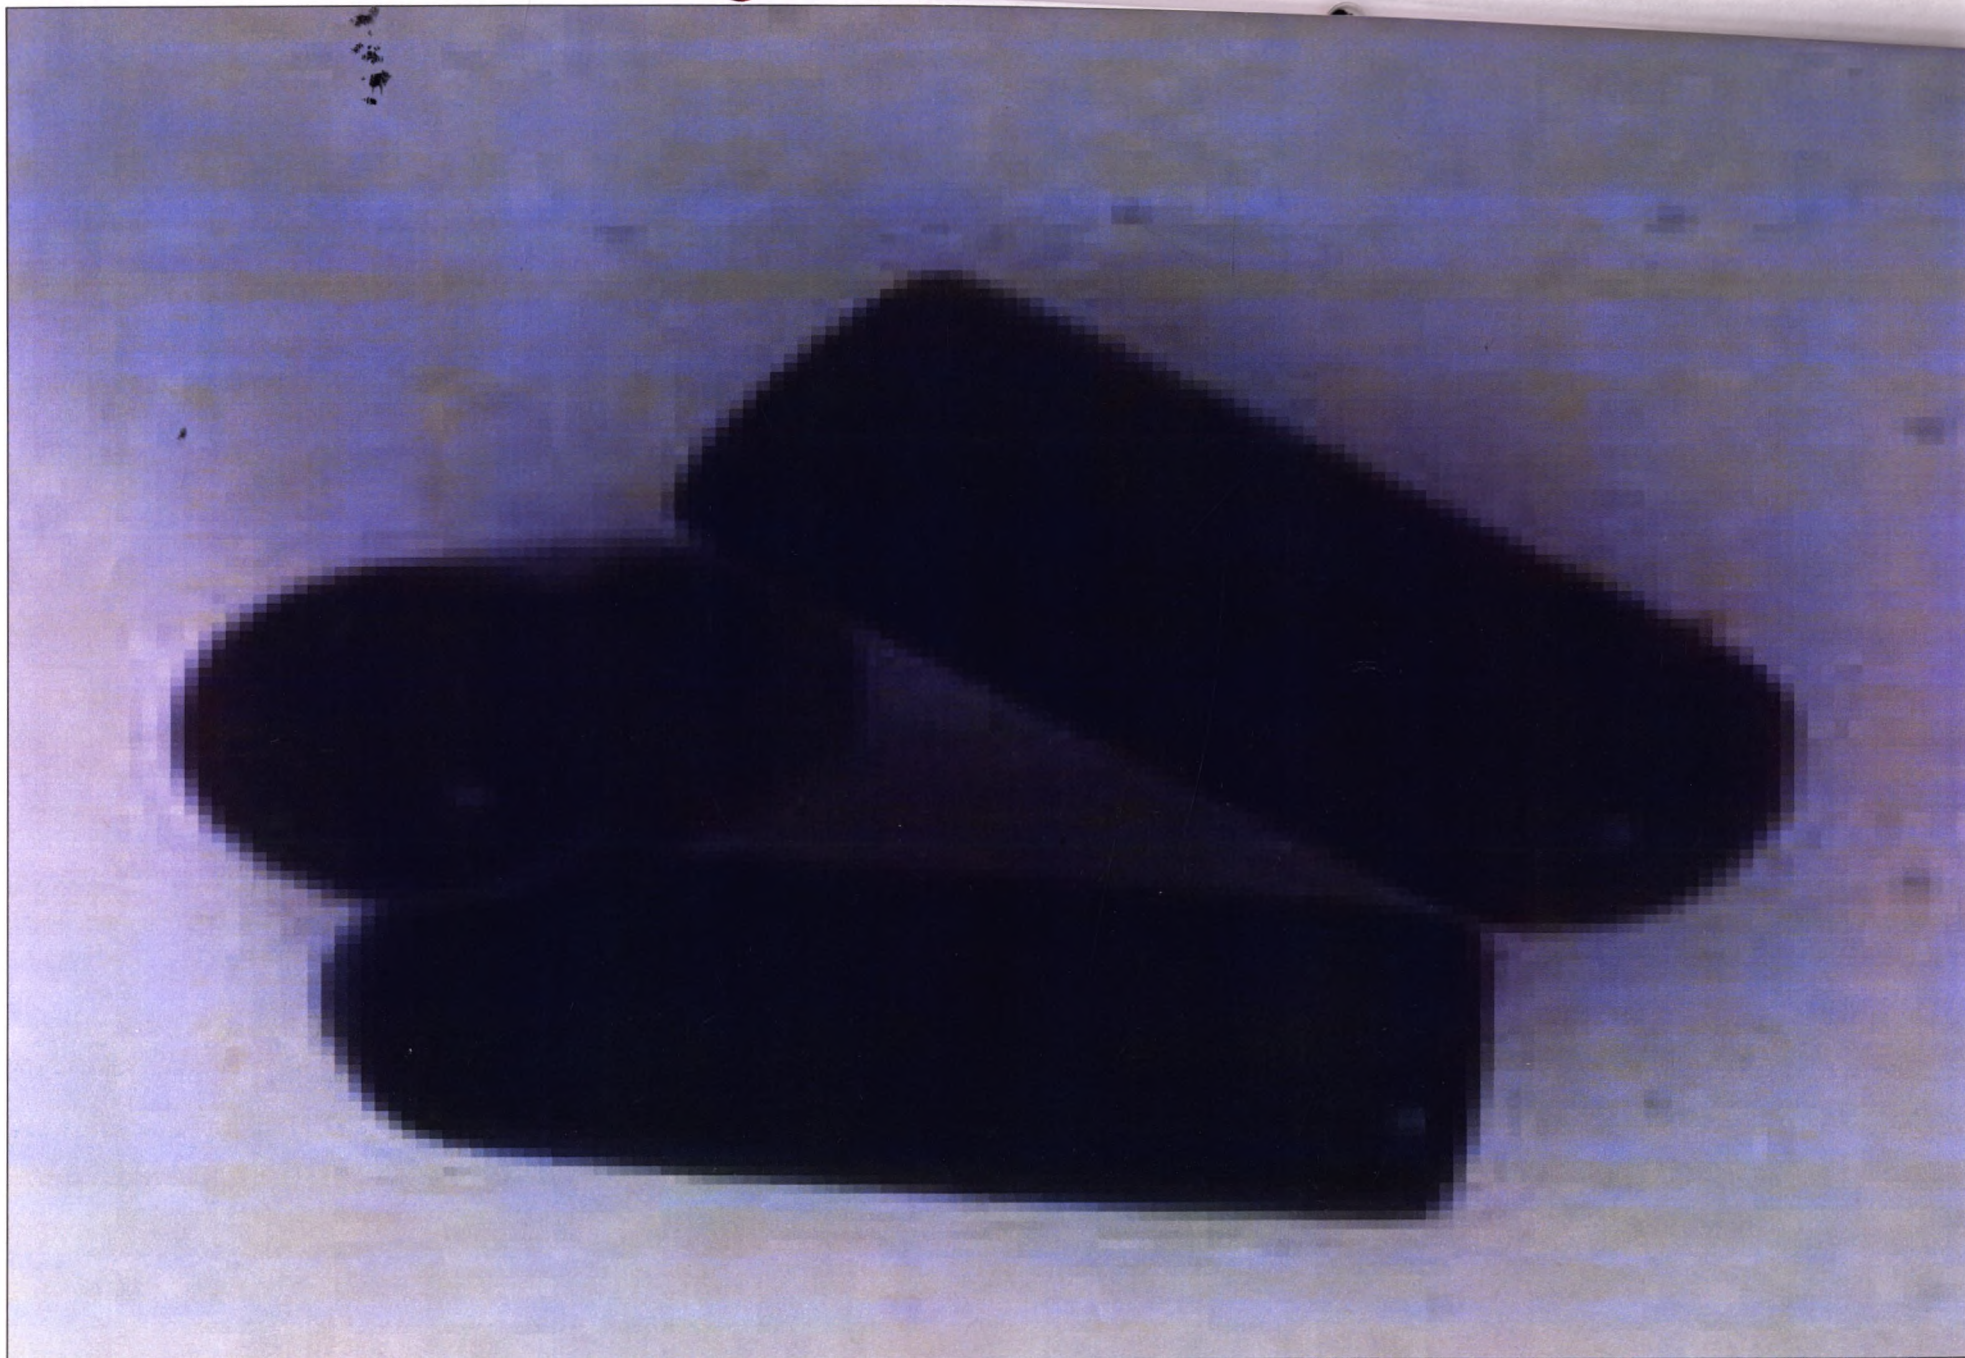

Колпаки защитные для эндостатов и шлангов различных цветов и размеров, не более 1000 шт.



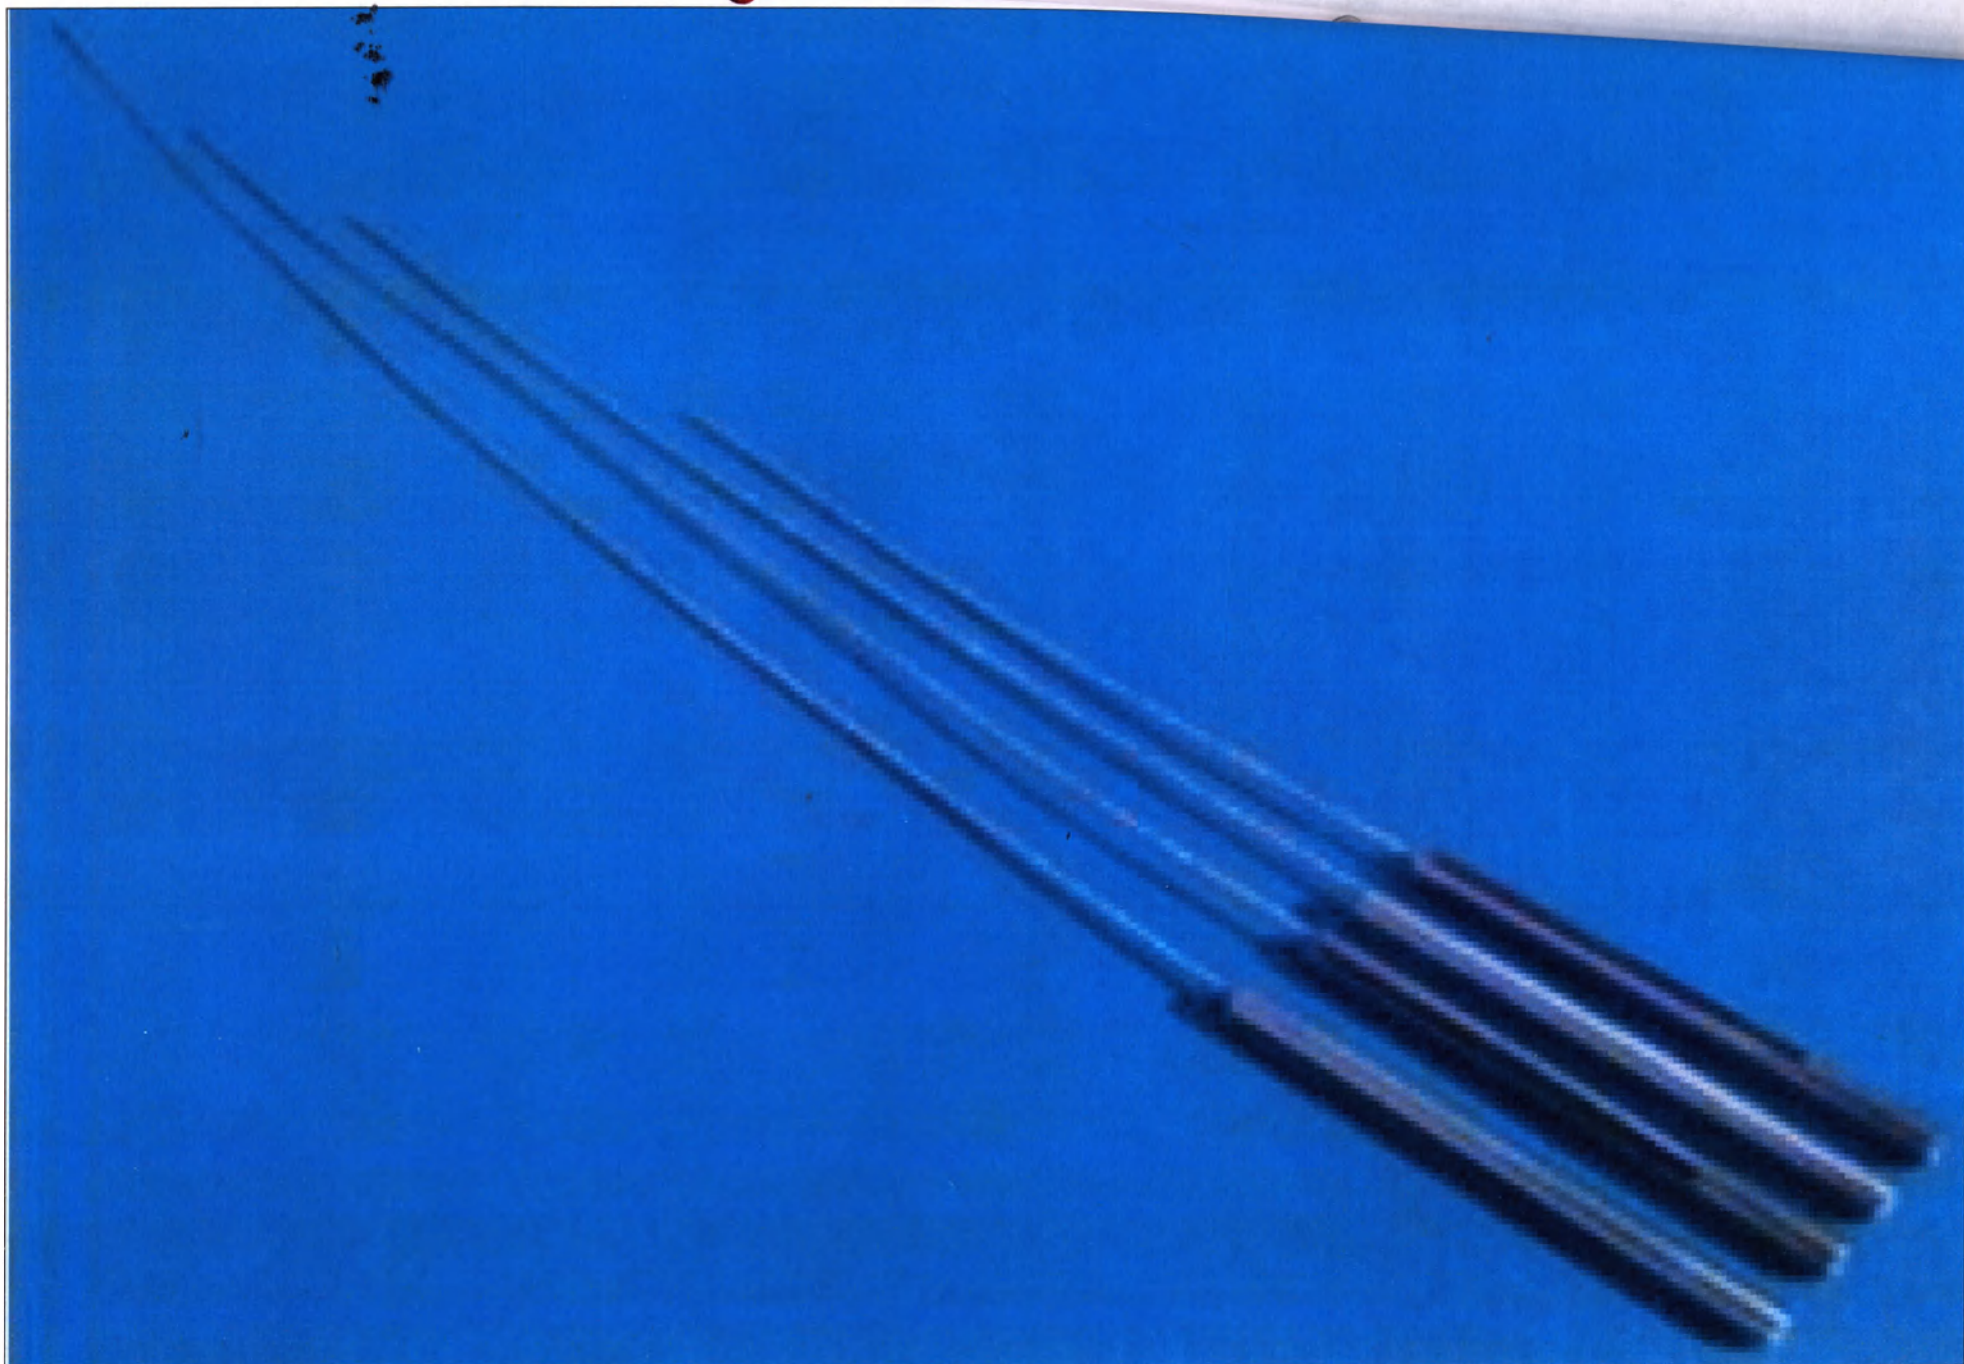



8. Блок связи помещения для лечения (TRIB): Периферические блоки; - Ключевой переключатель блокировки; - Блокировочный переключатель (LSS); - Система контроля выхода последнего человека; - Переключатель двери; - Внутренняя система связи и видеонаблюдения; - Индикатор "Излучение включено"; - Источник бесперебойного питания.



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
36 листа (ов)