



varian


ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»
109147, Россия, Москва
ул. Таганская, д.17-23
Бизнес-центр Москэнка
тел. +7 495 604 44 24/23
факс +7 495 660 11 37
www.varian.com

Генеральный директор
ООО «Вариан Медикал Системз (РУС)»
Фельдманн Маркус
«23» июля 2018 г.





ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

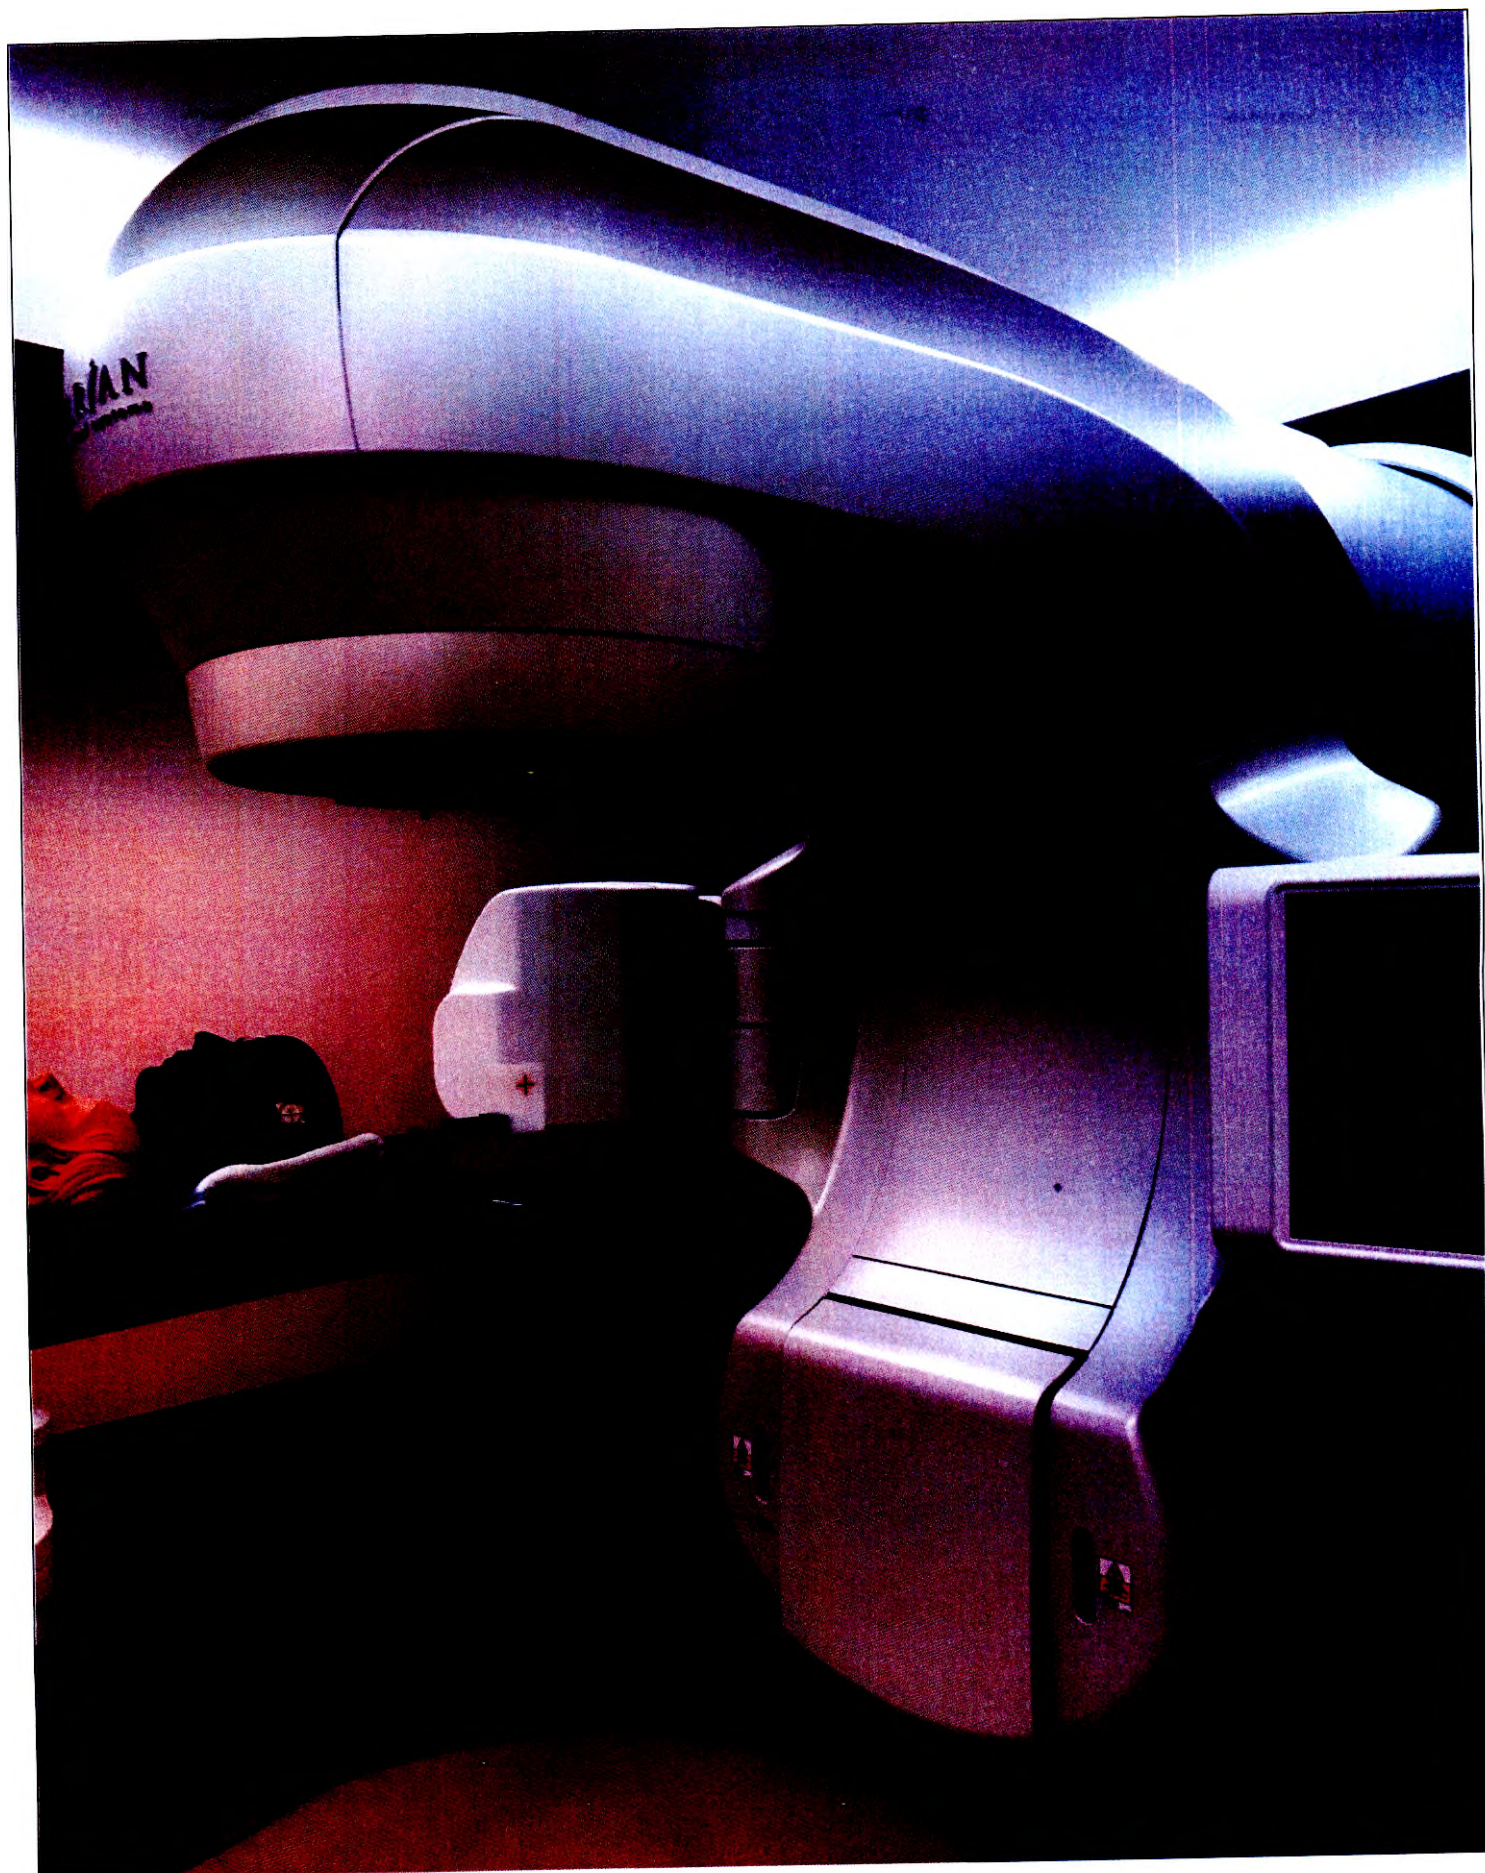


Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

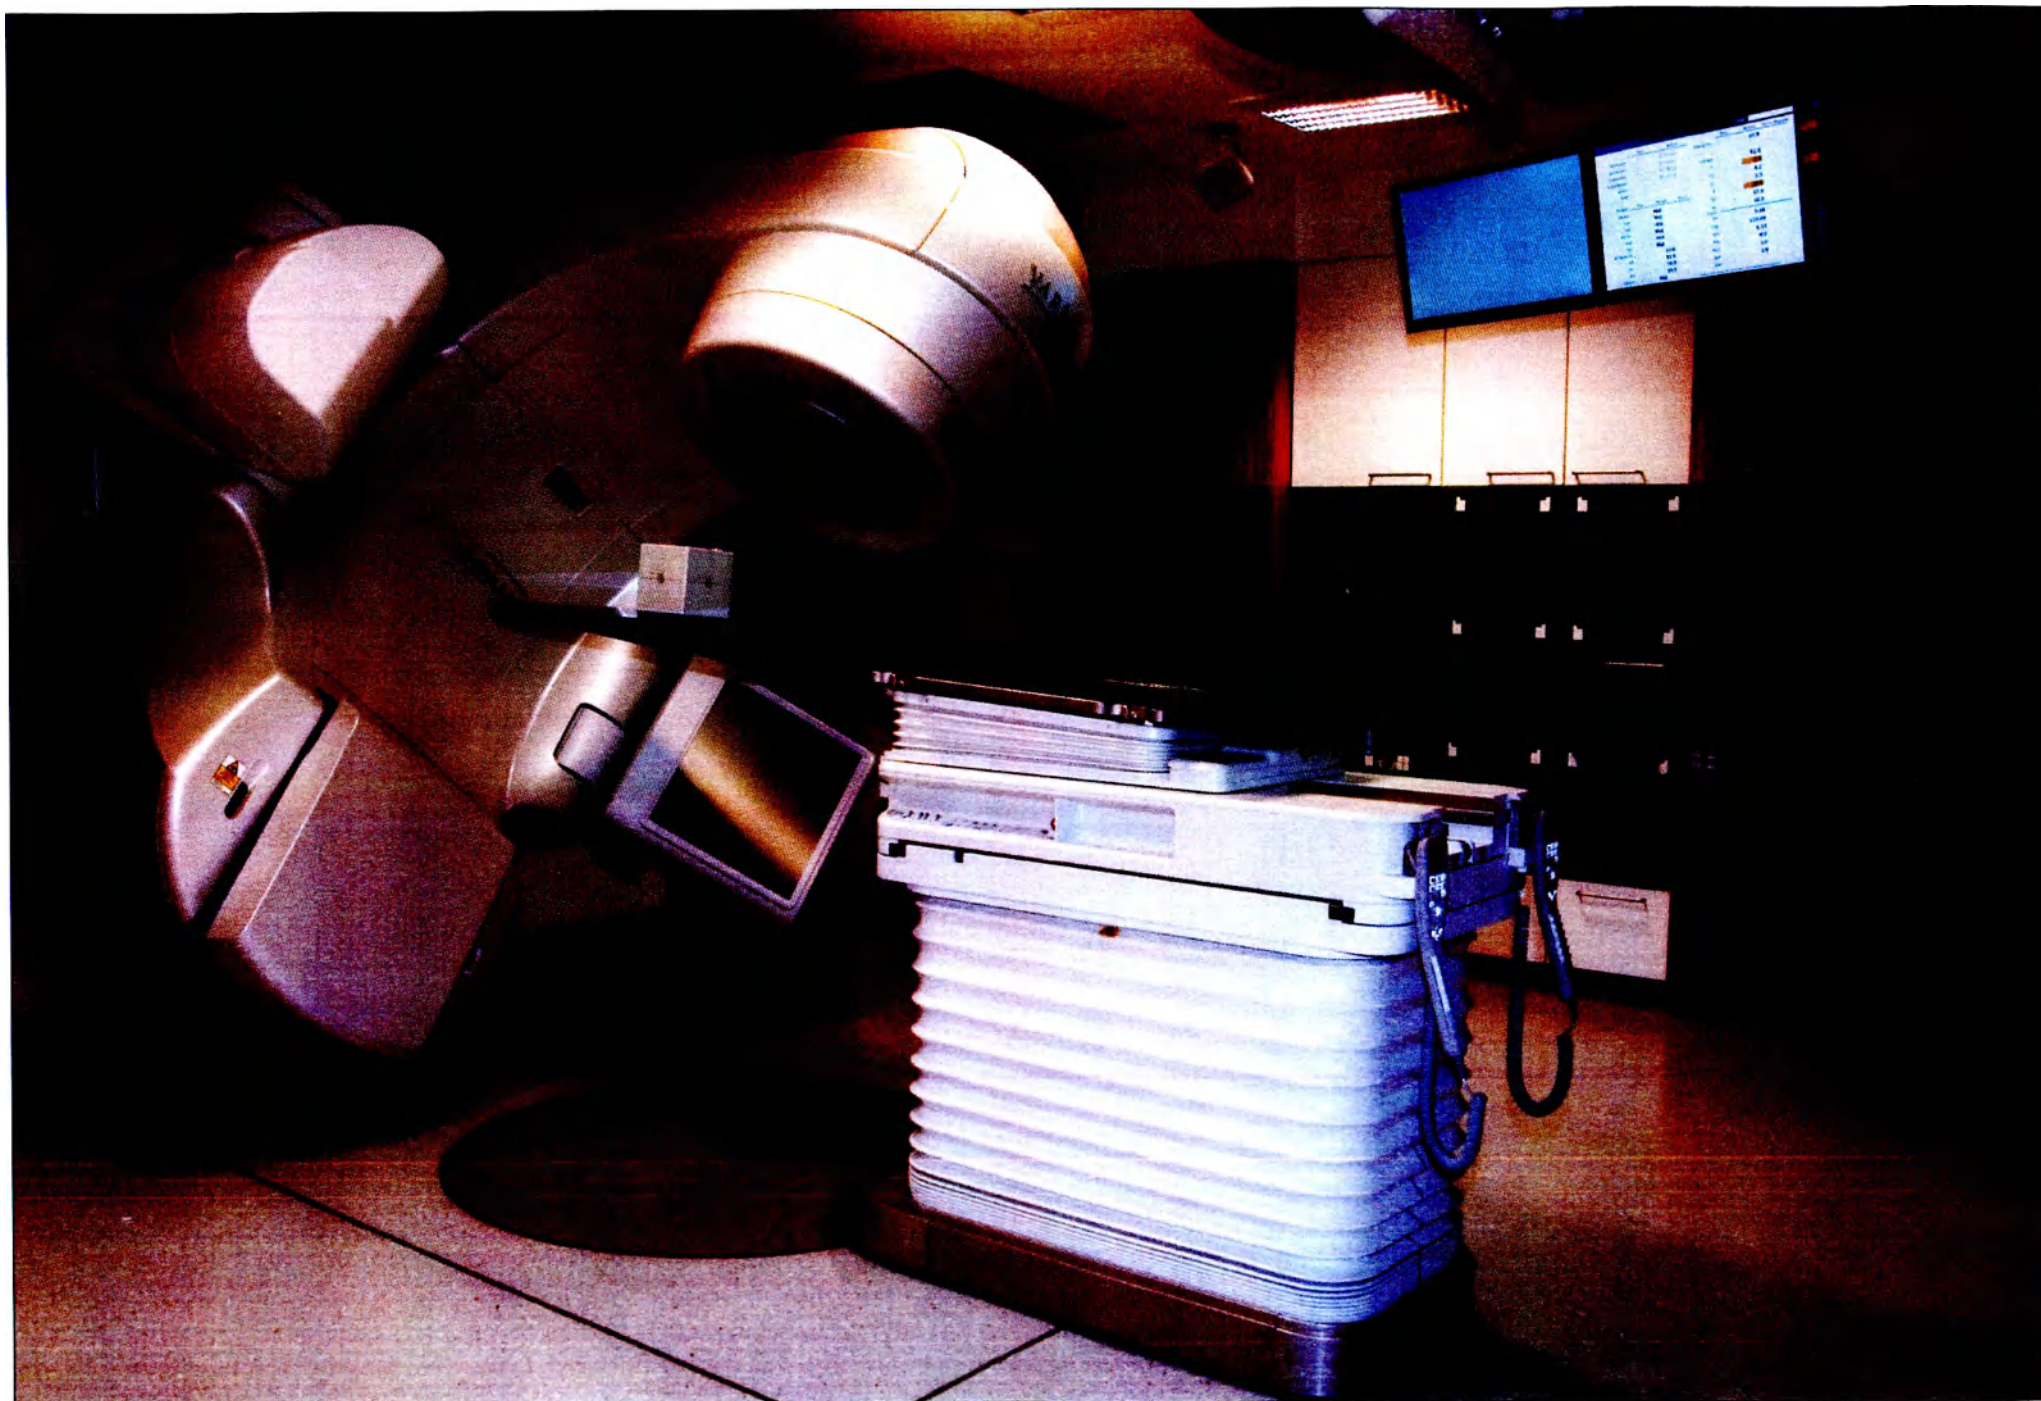


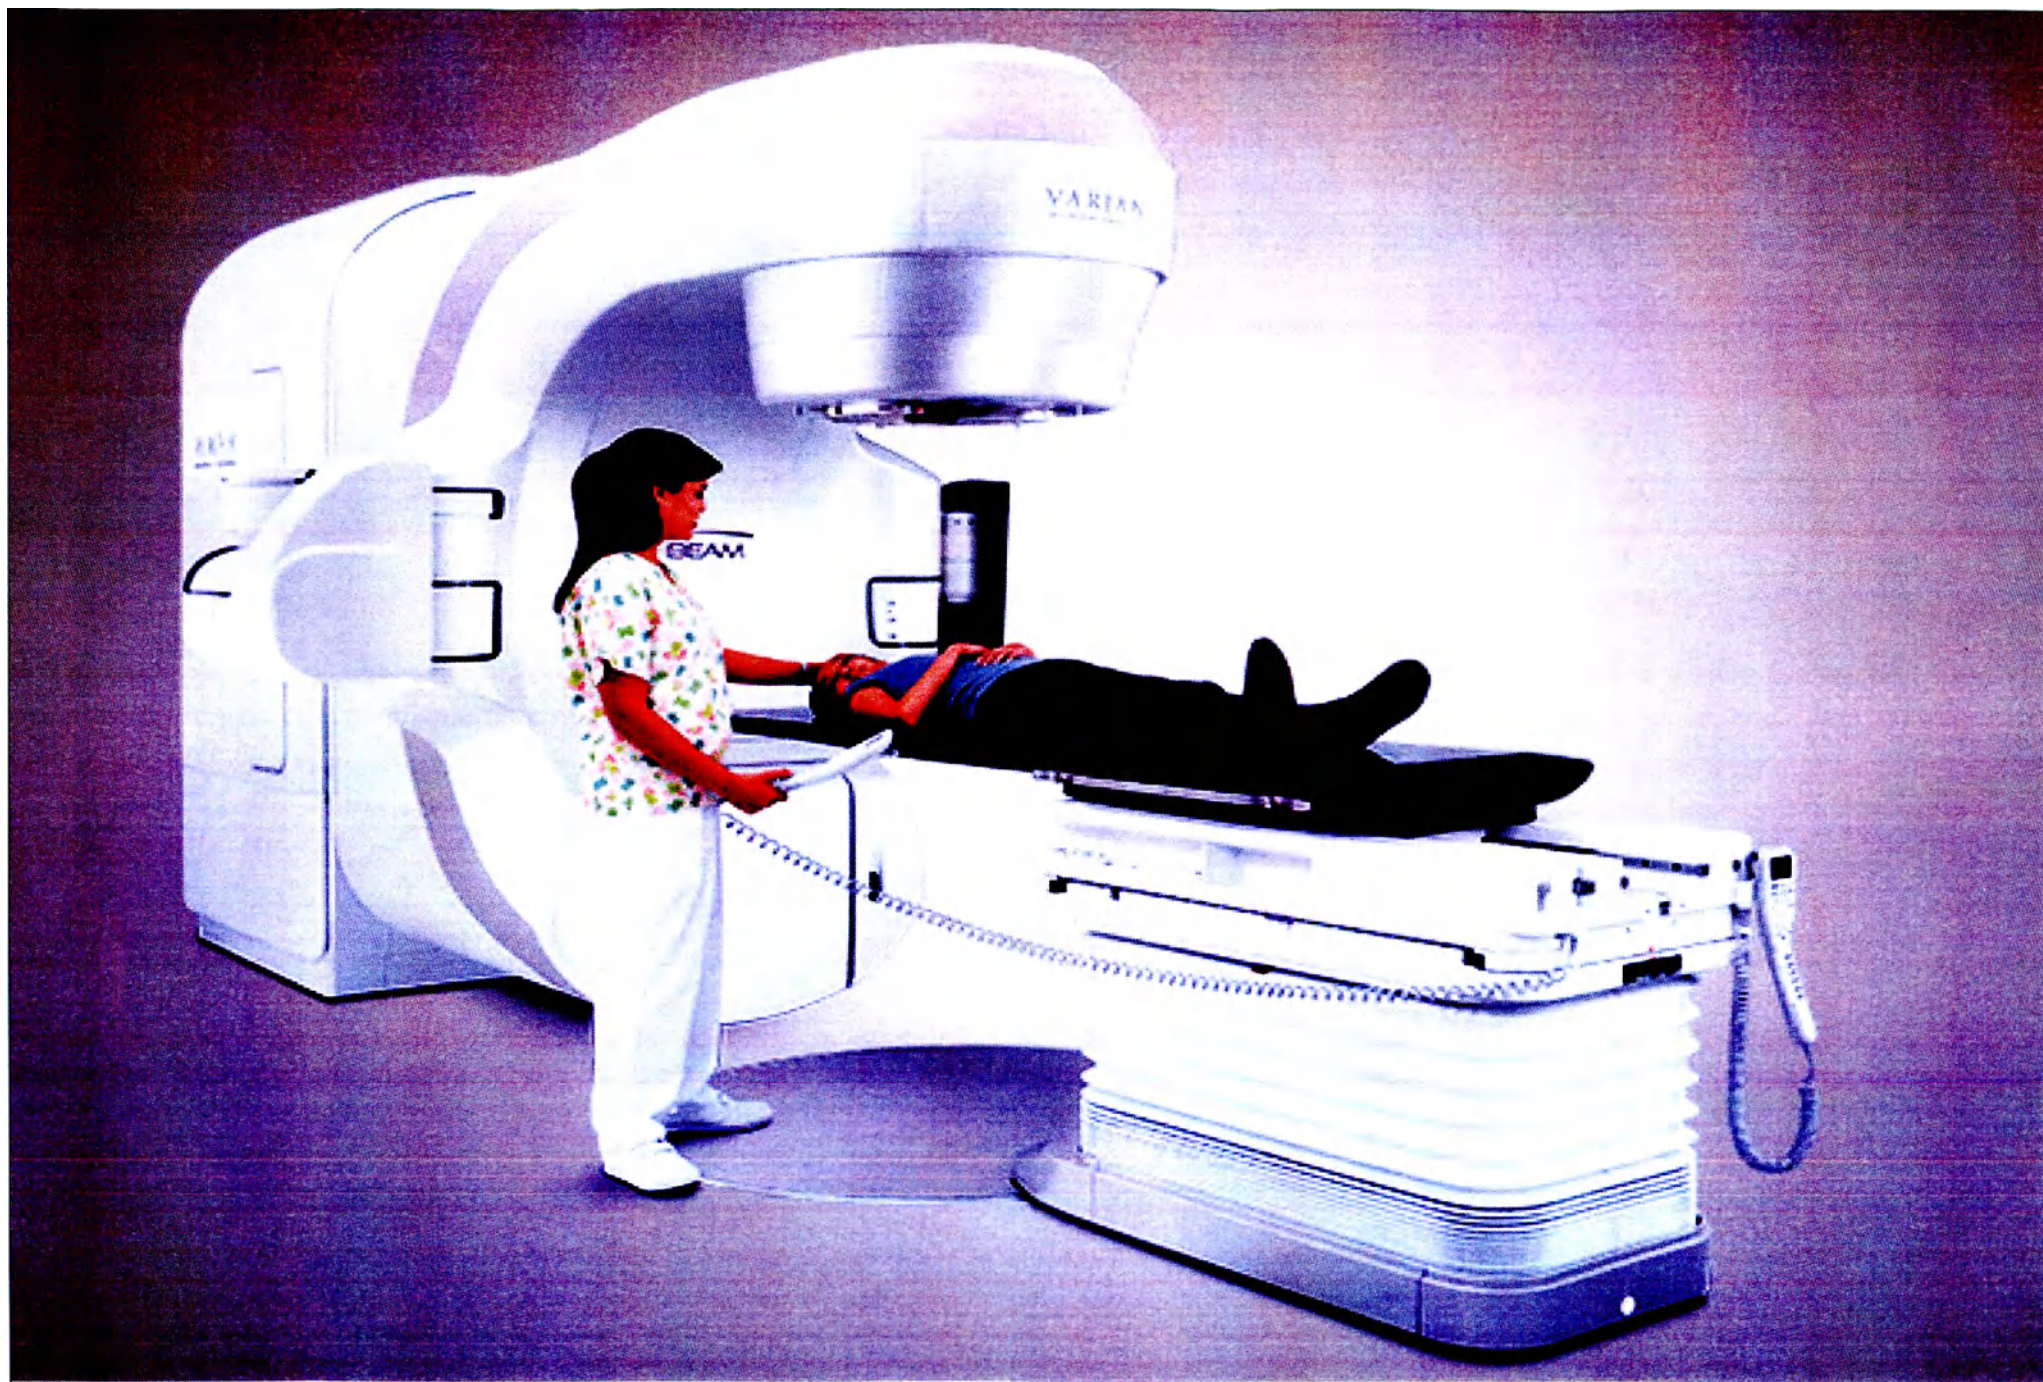


Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

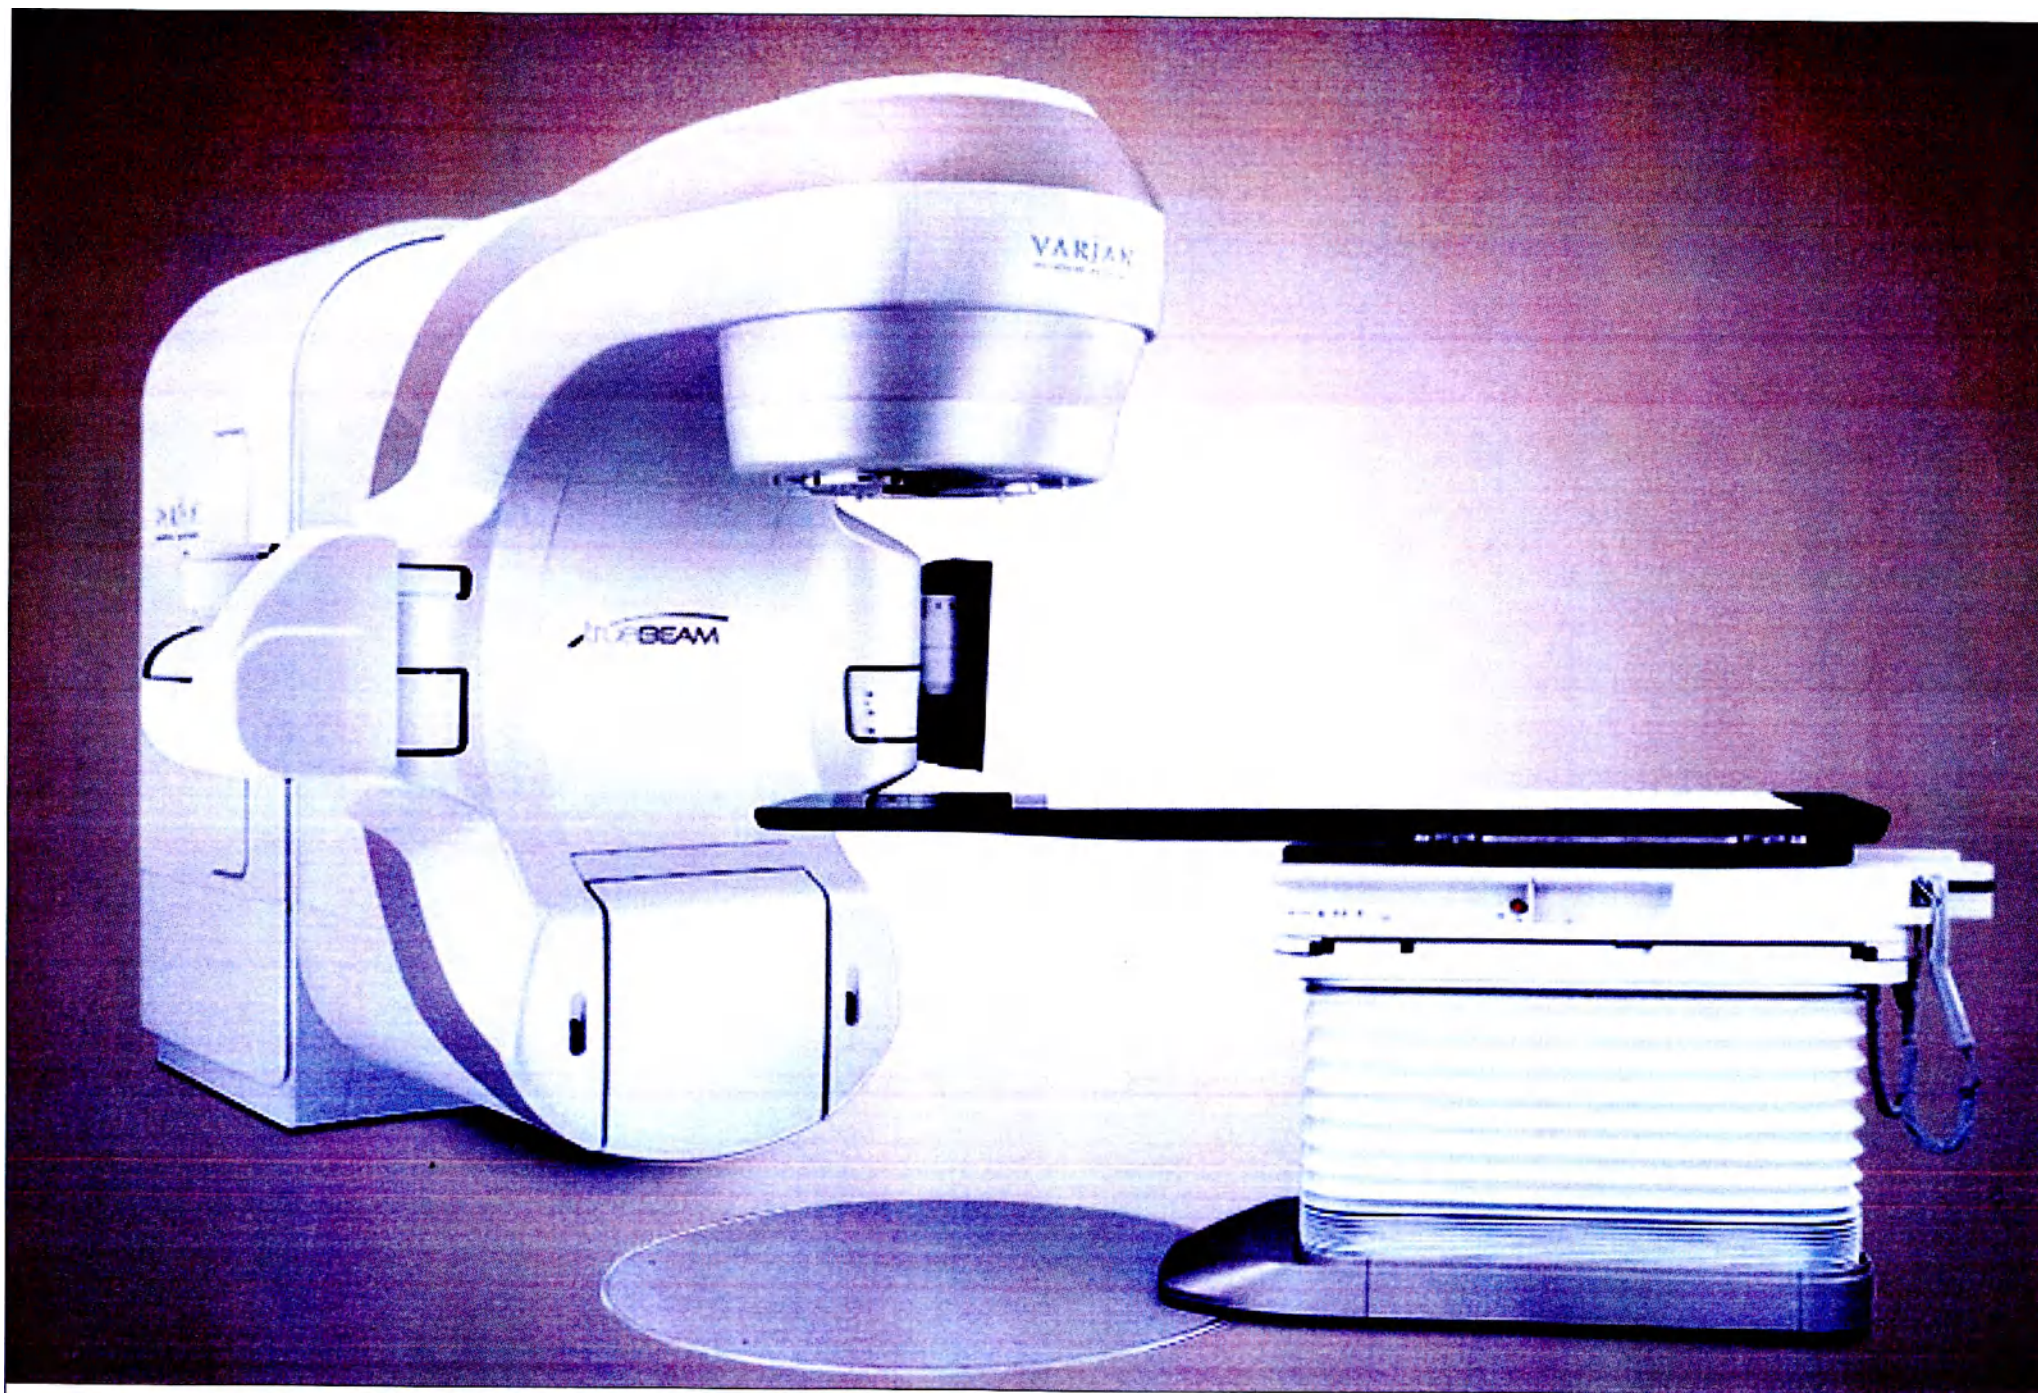


Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

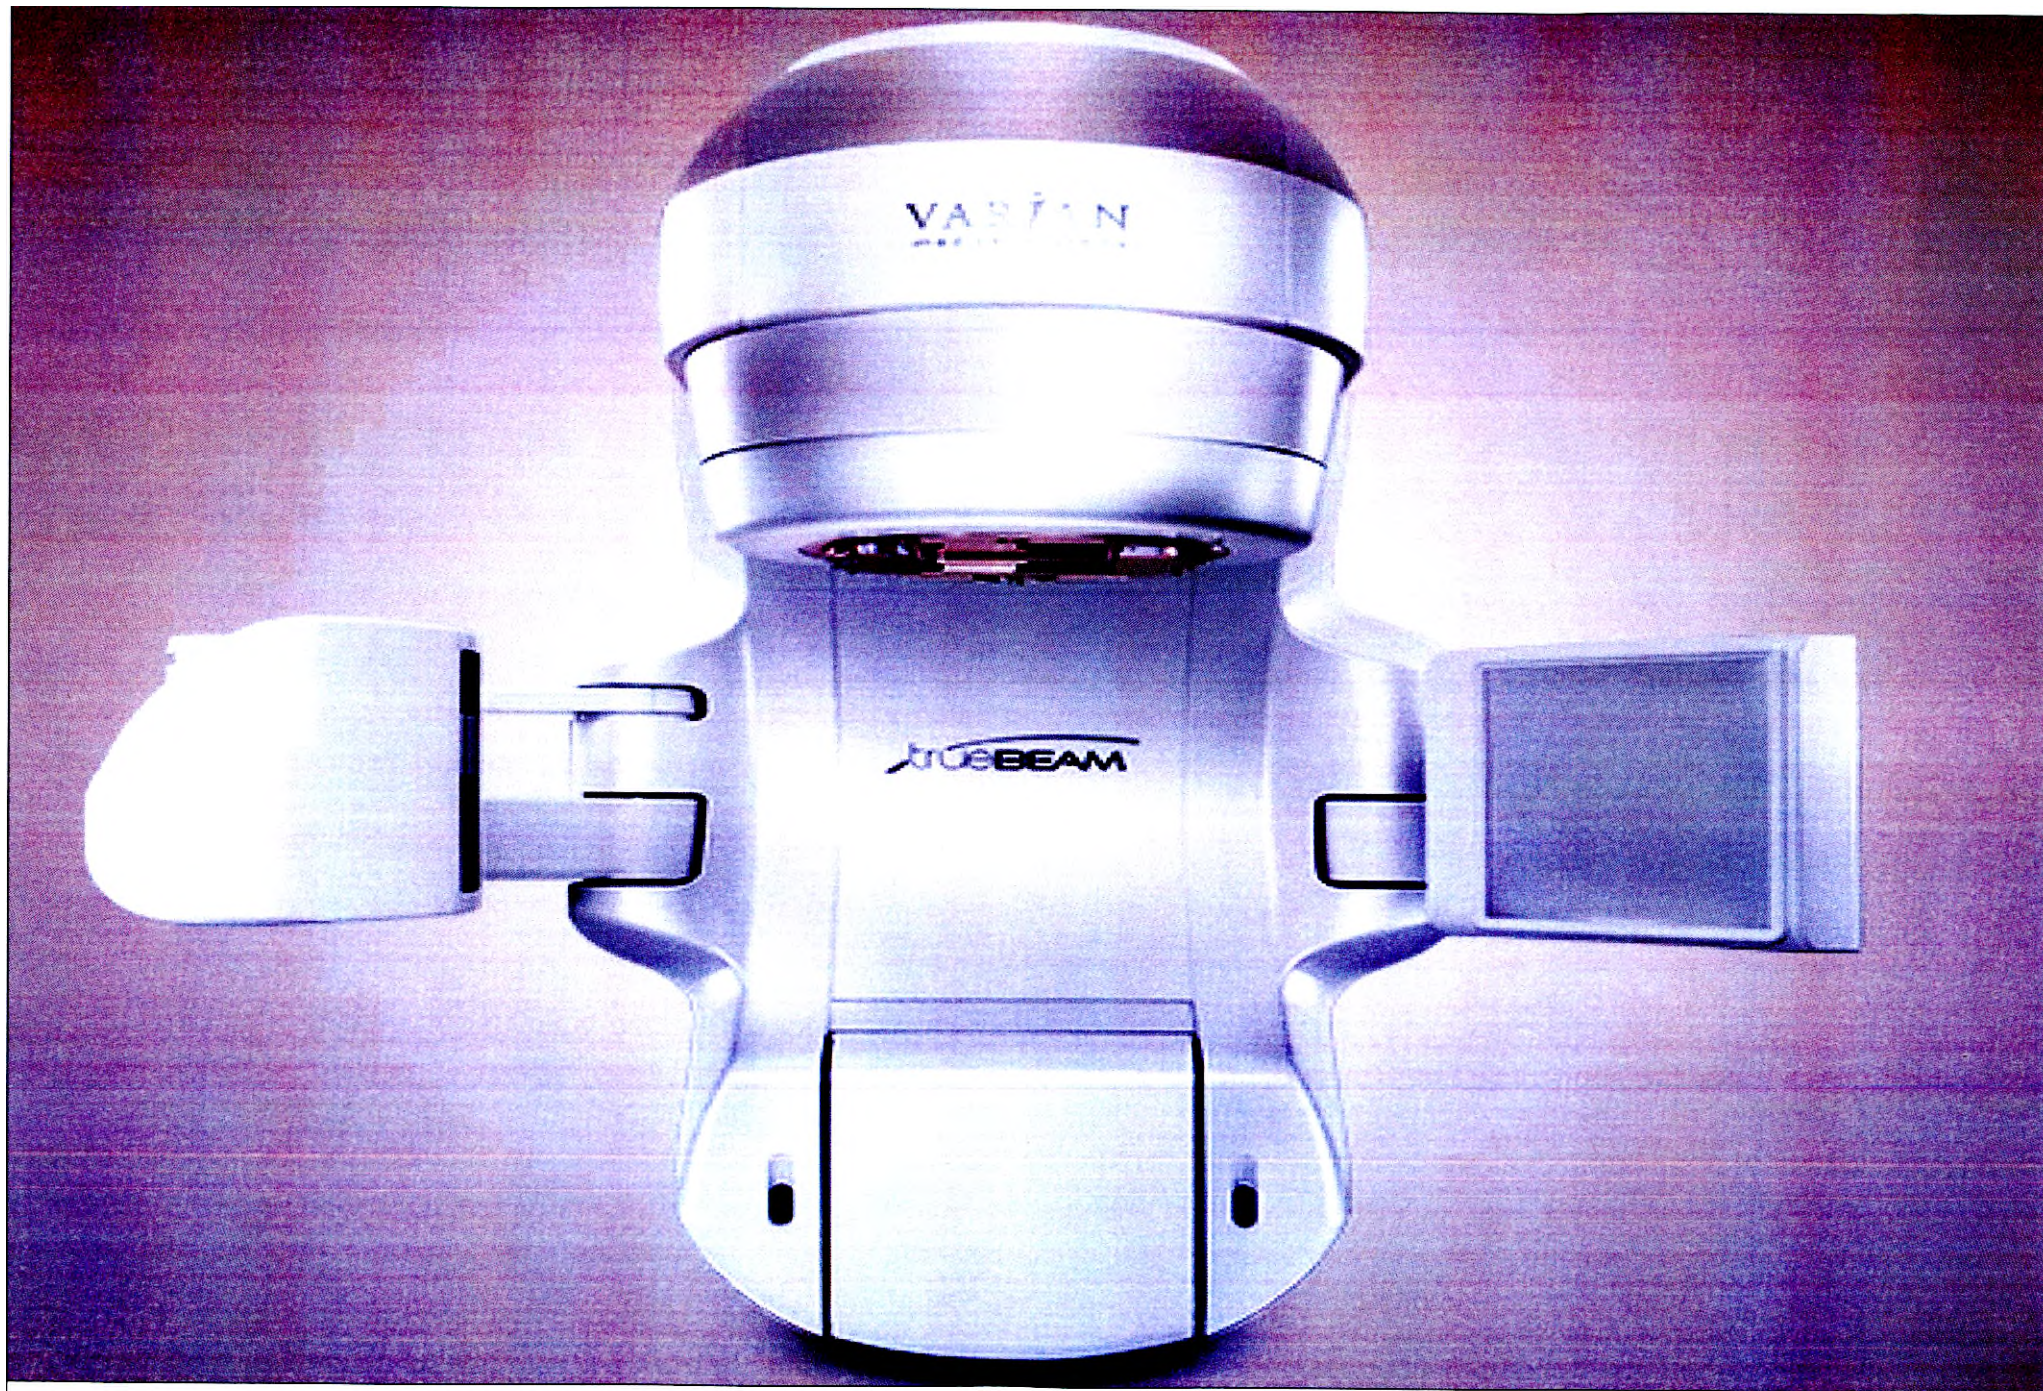


Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

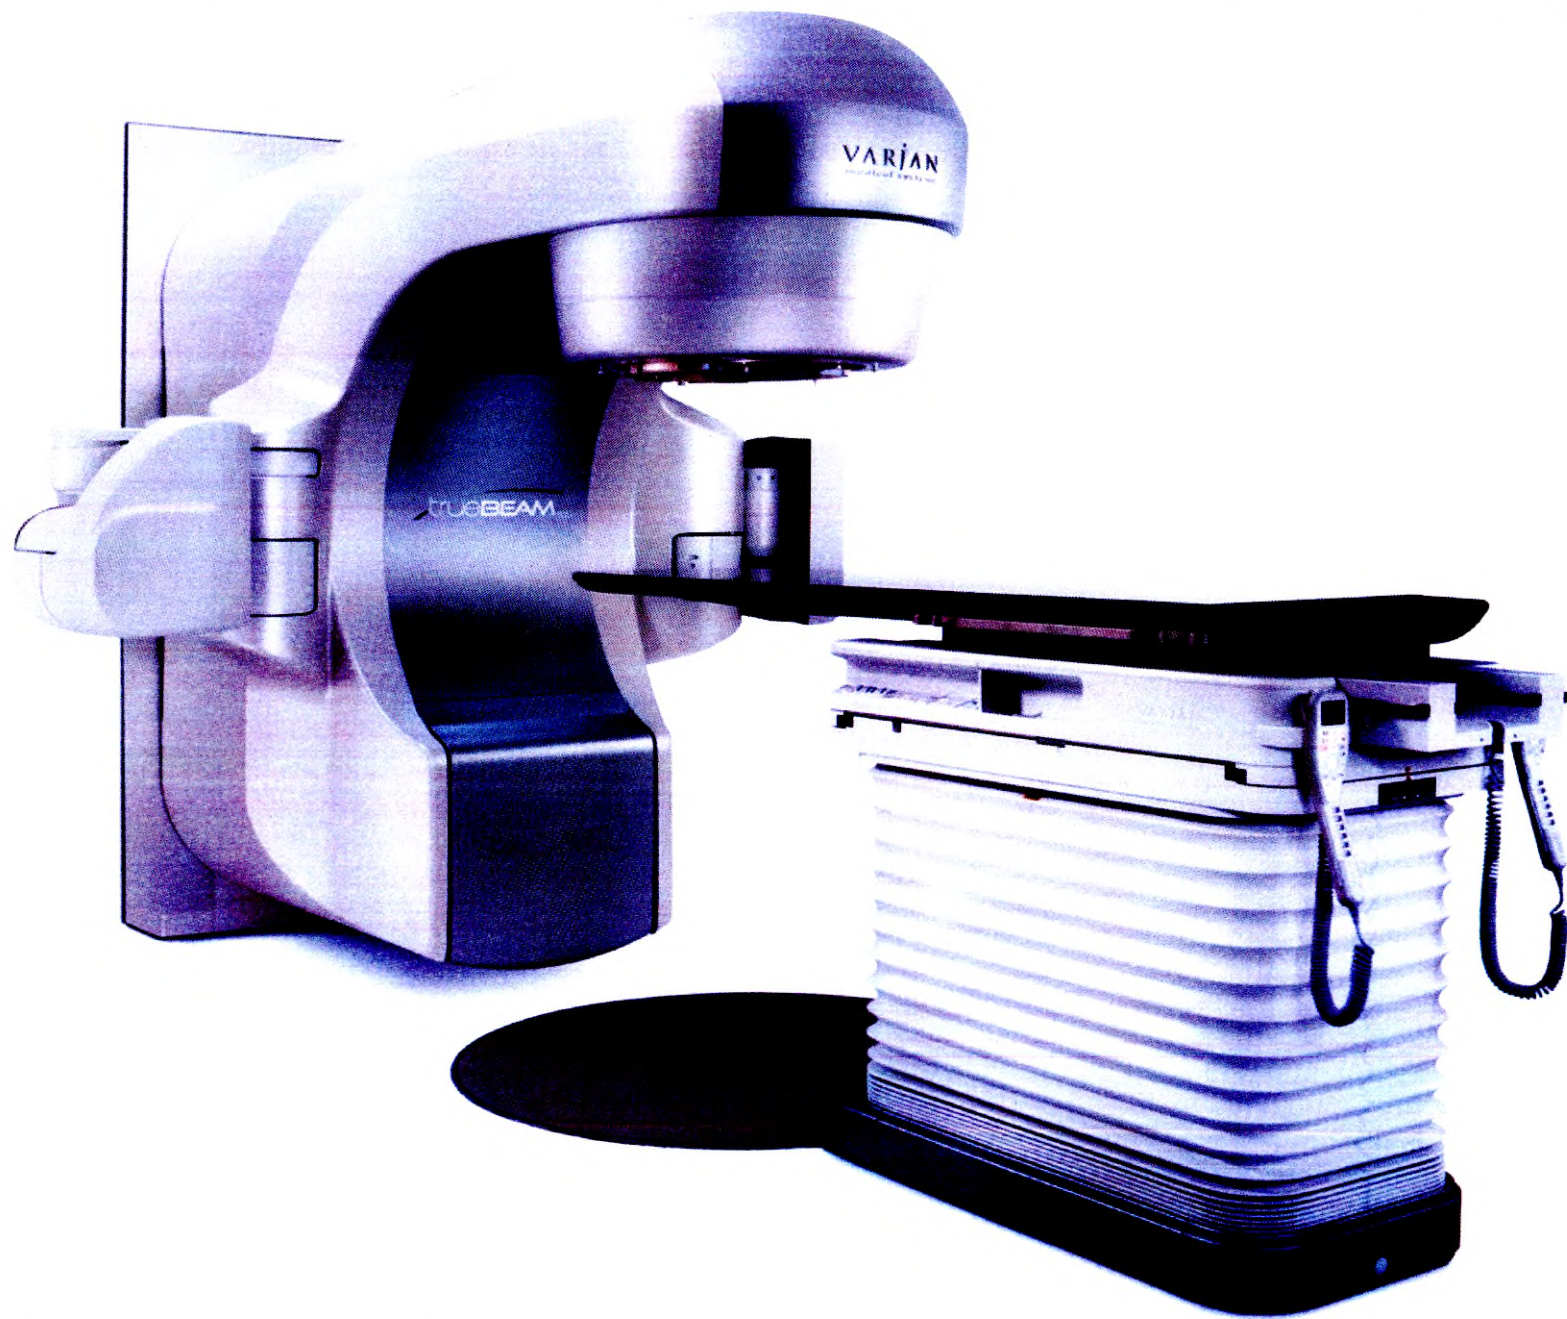

Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

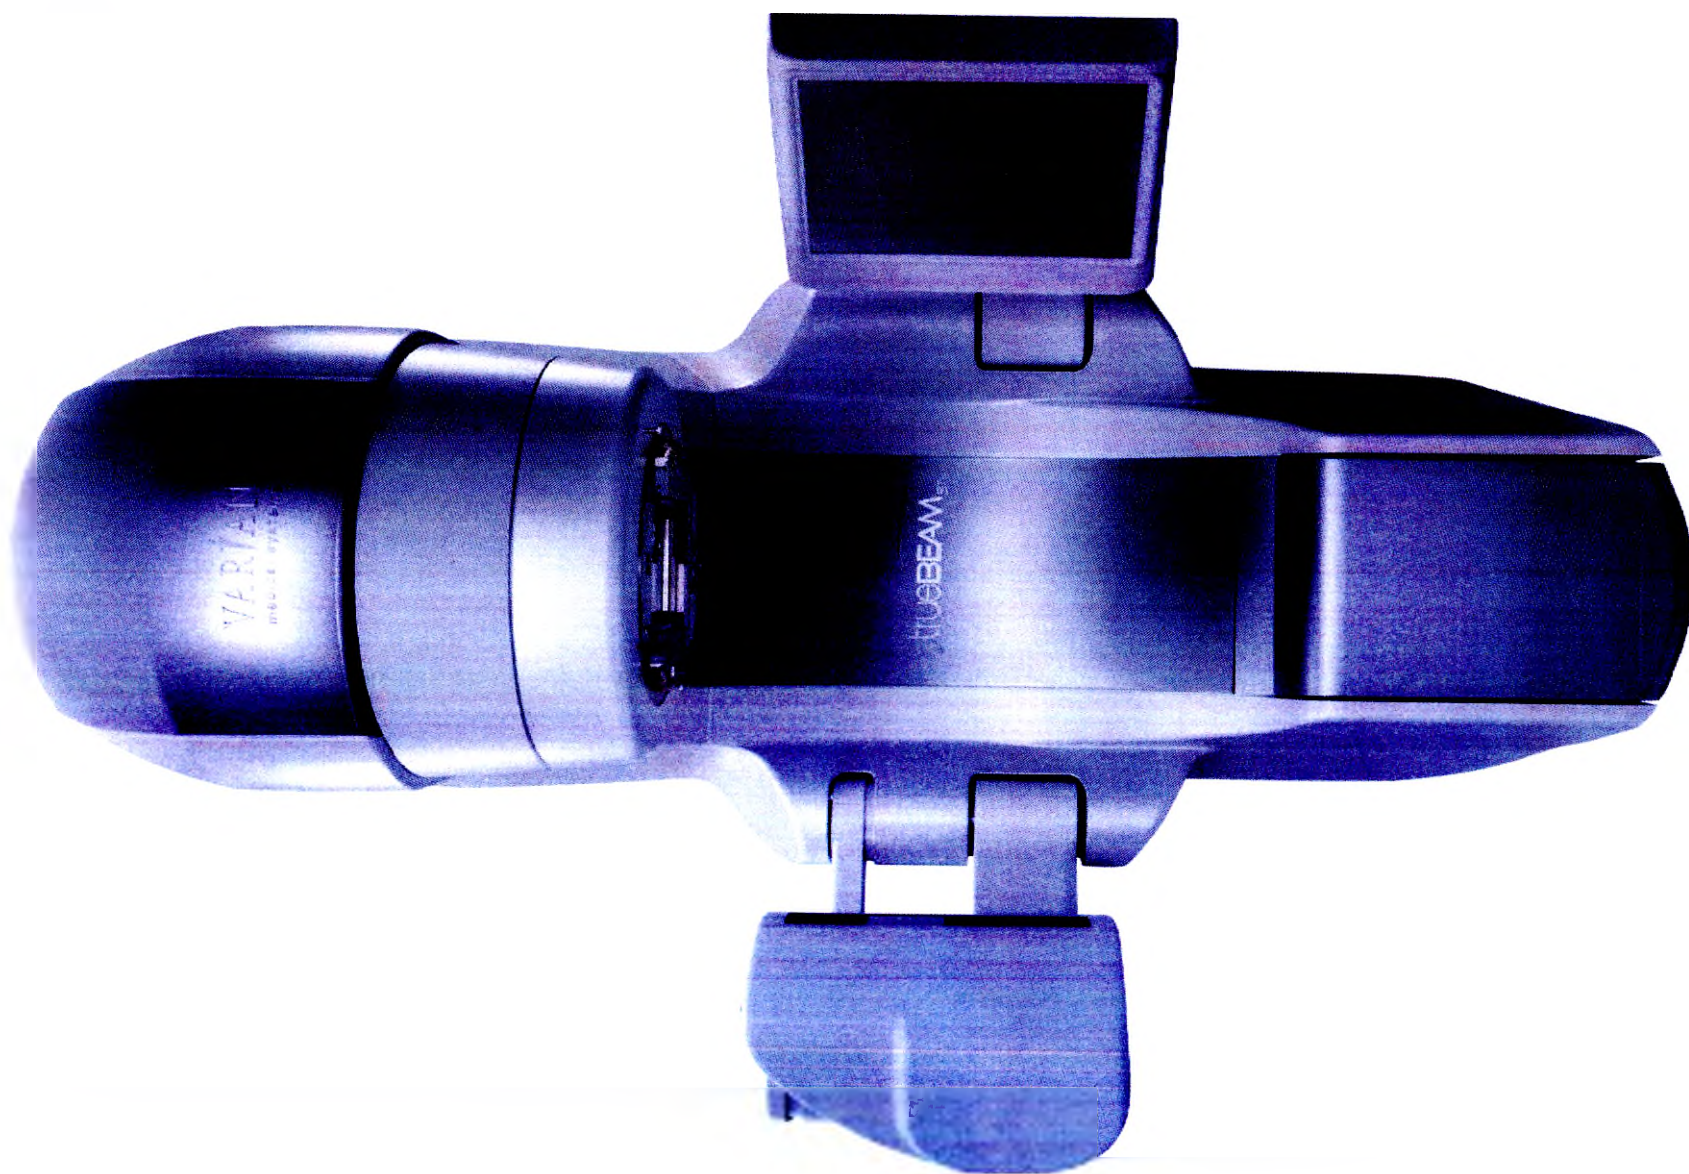

Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

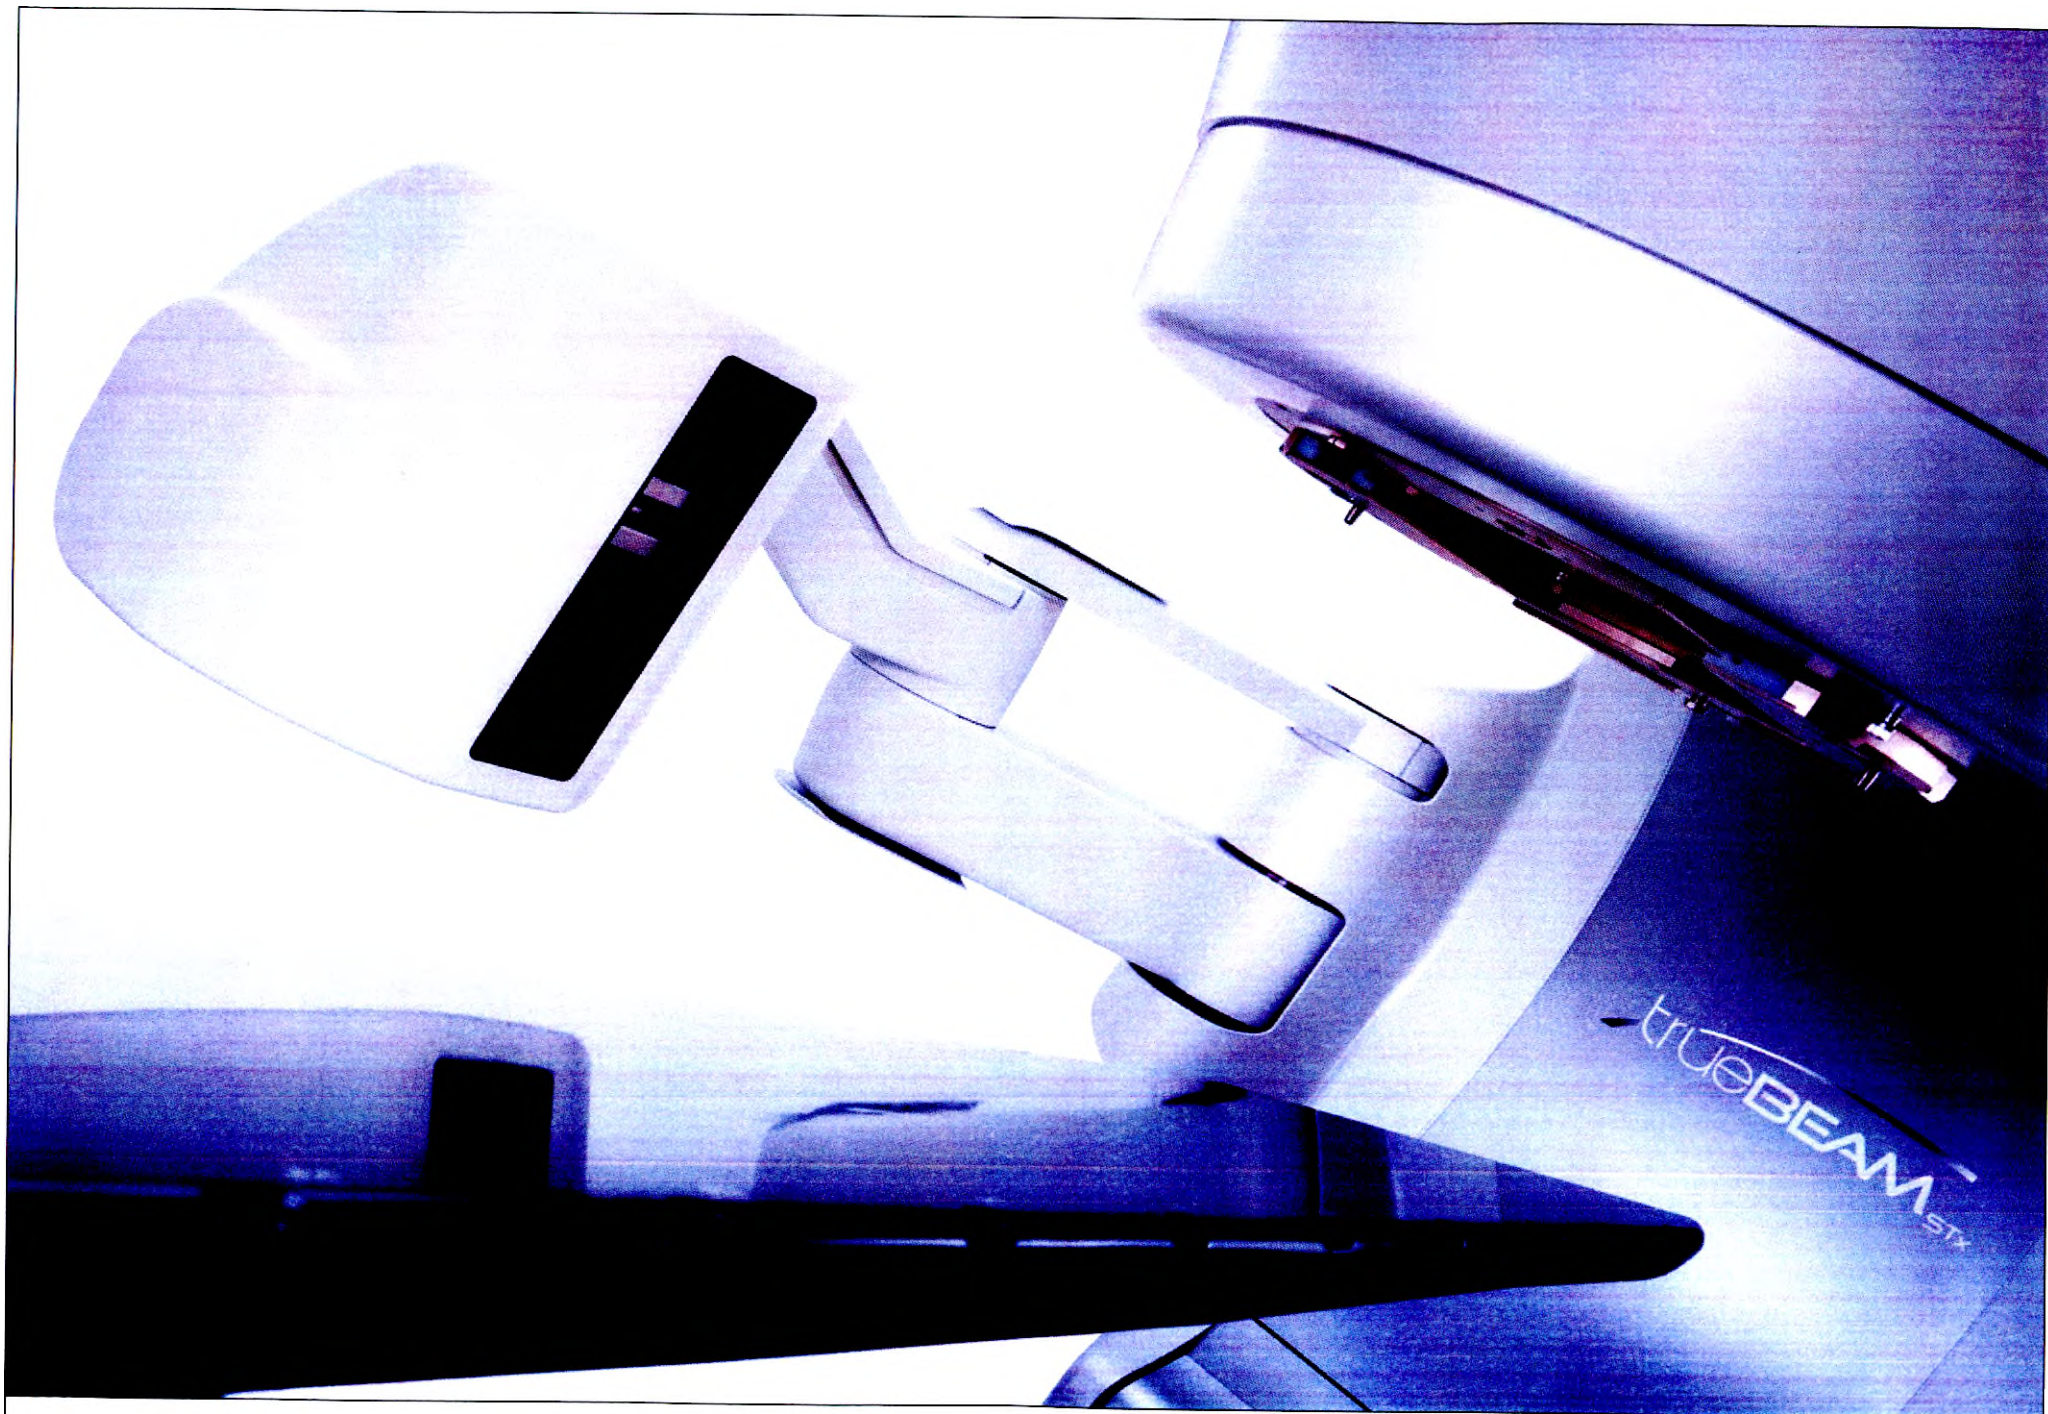

Общий вид медицинского изделия «Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями».

«Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями», в составе:



1. Линейный ускоритель *TrueBeam* или *TrueBeam STx*.



Инструкции по эксплуатации TrueBeam

TrueBeam® System
TrueBeam® STx System
Edge® Radiosurgery System

CE 0086




P1020029-003-C

АВГУСТ 2017 г.

Принадлежности:




1. Монтажная рама.

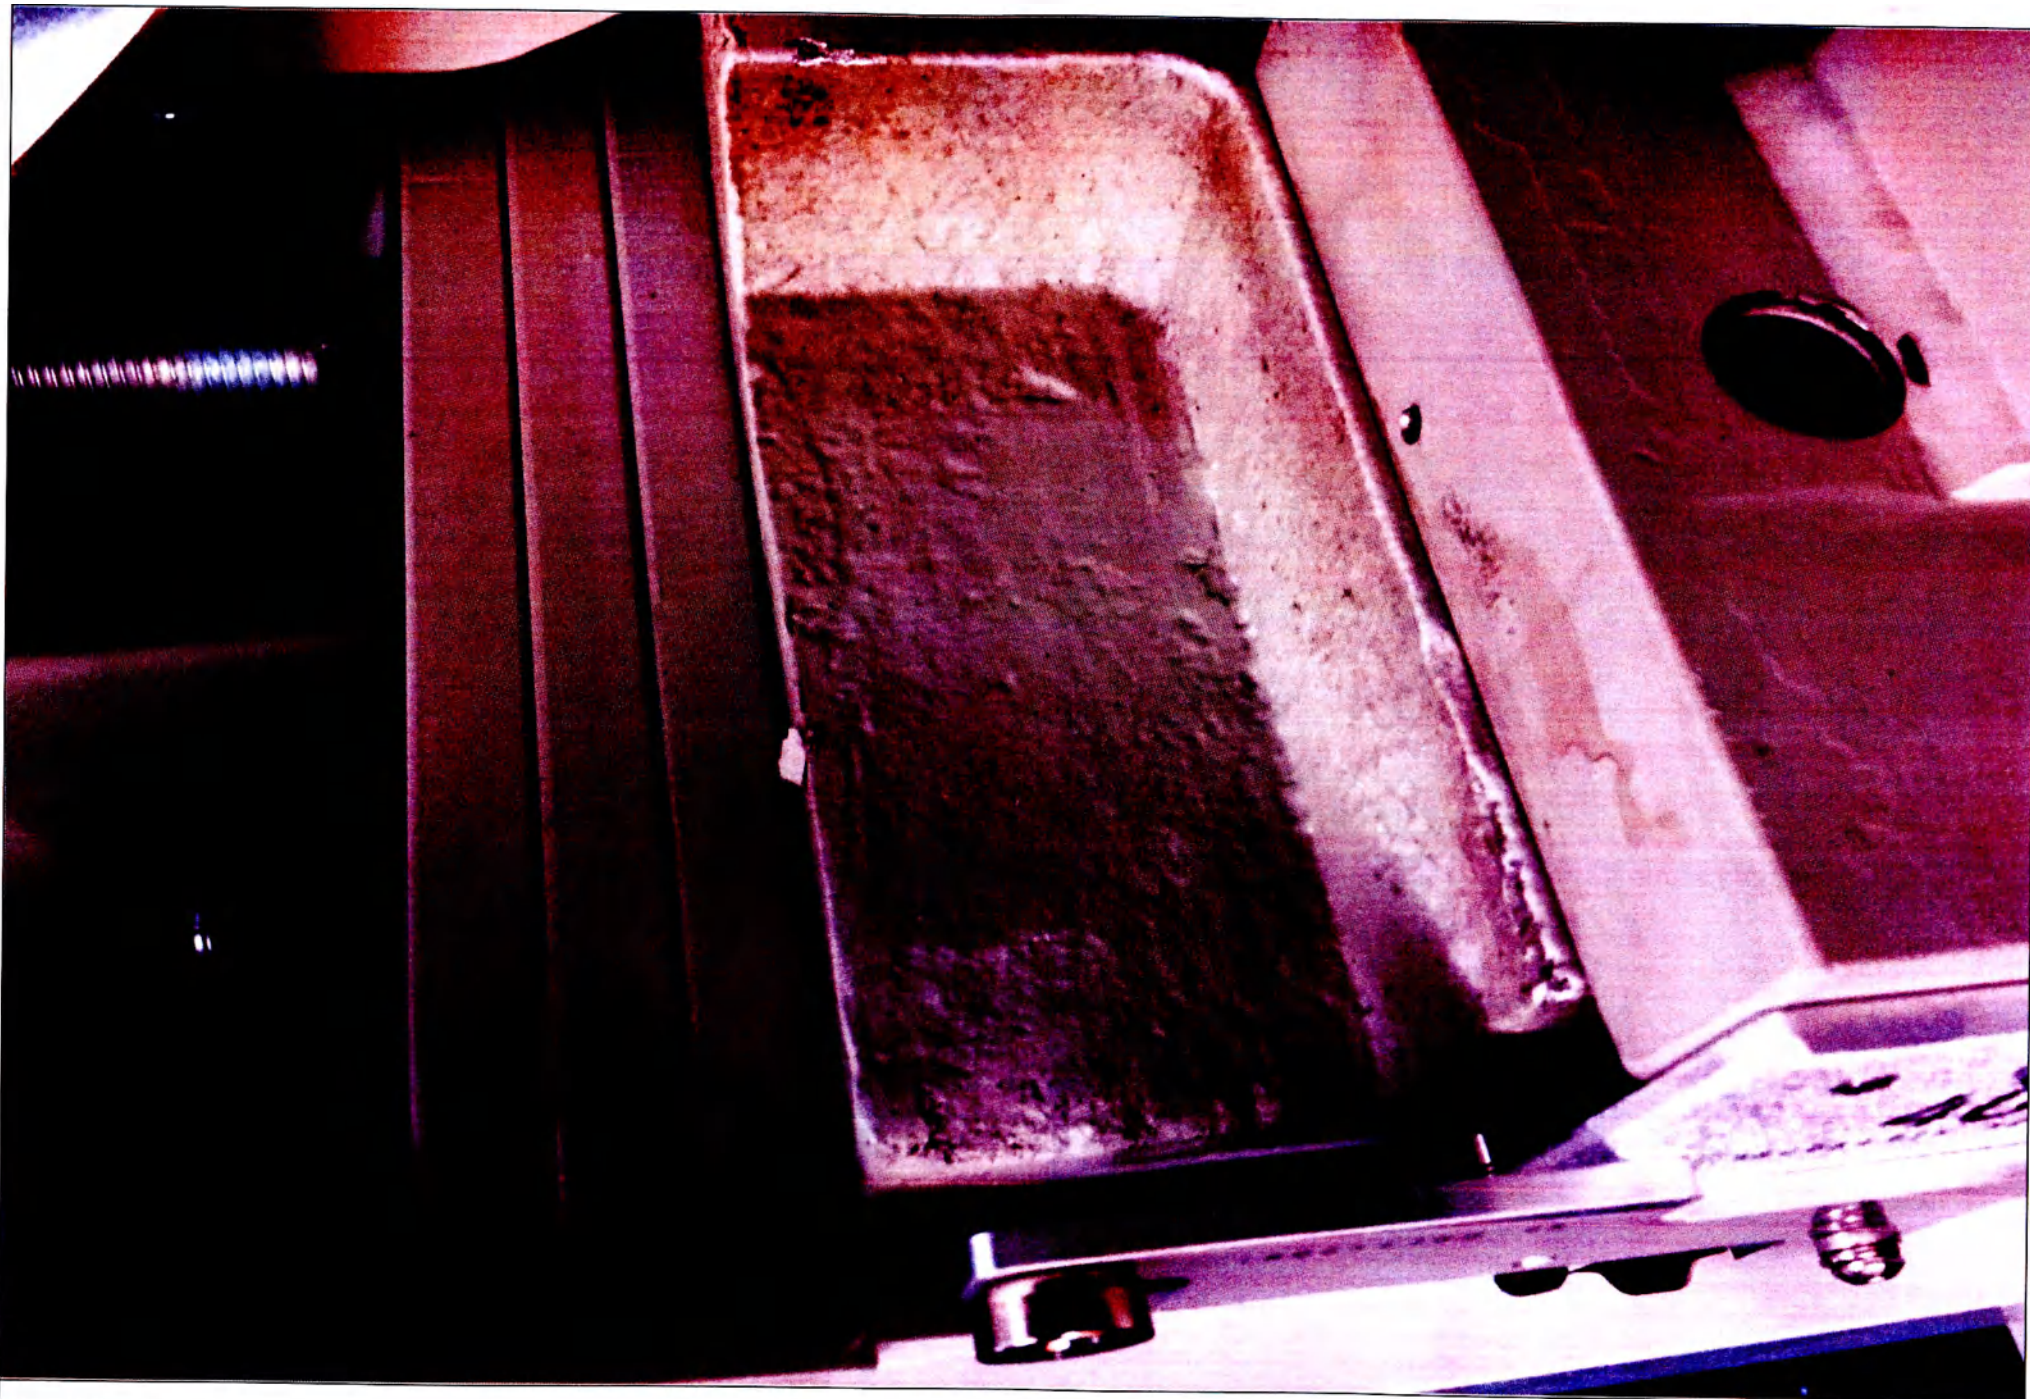


2. Противовес.




3. Стабилизатор ТруБим.

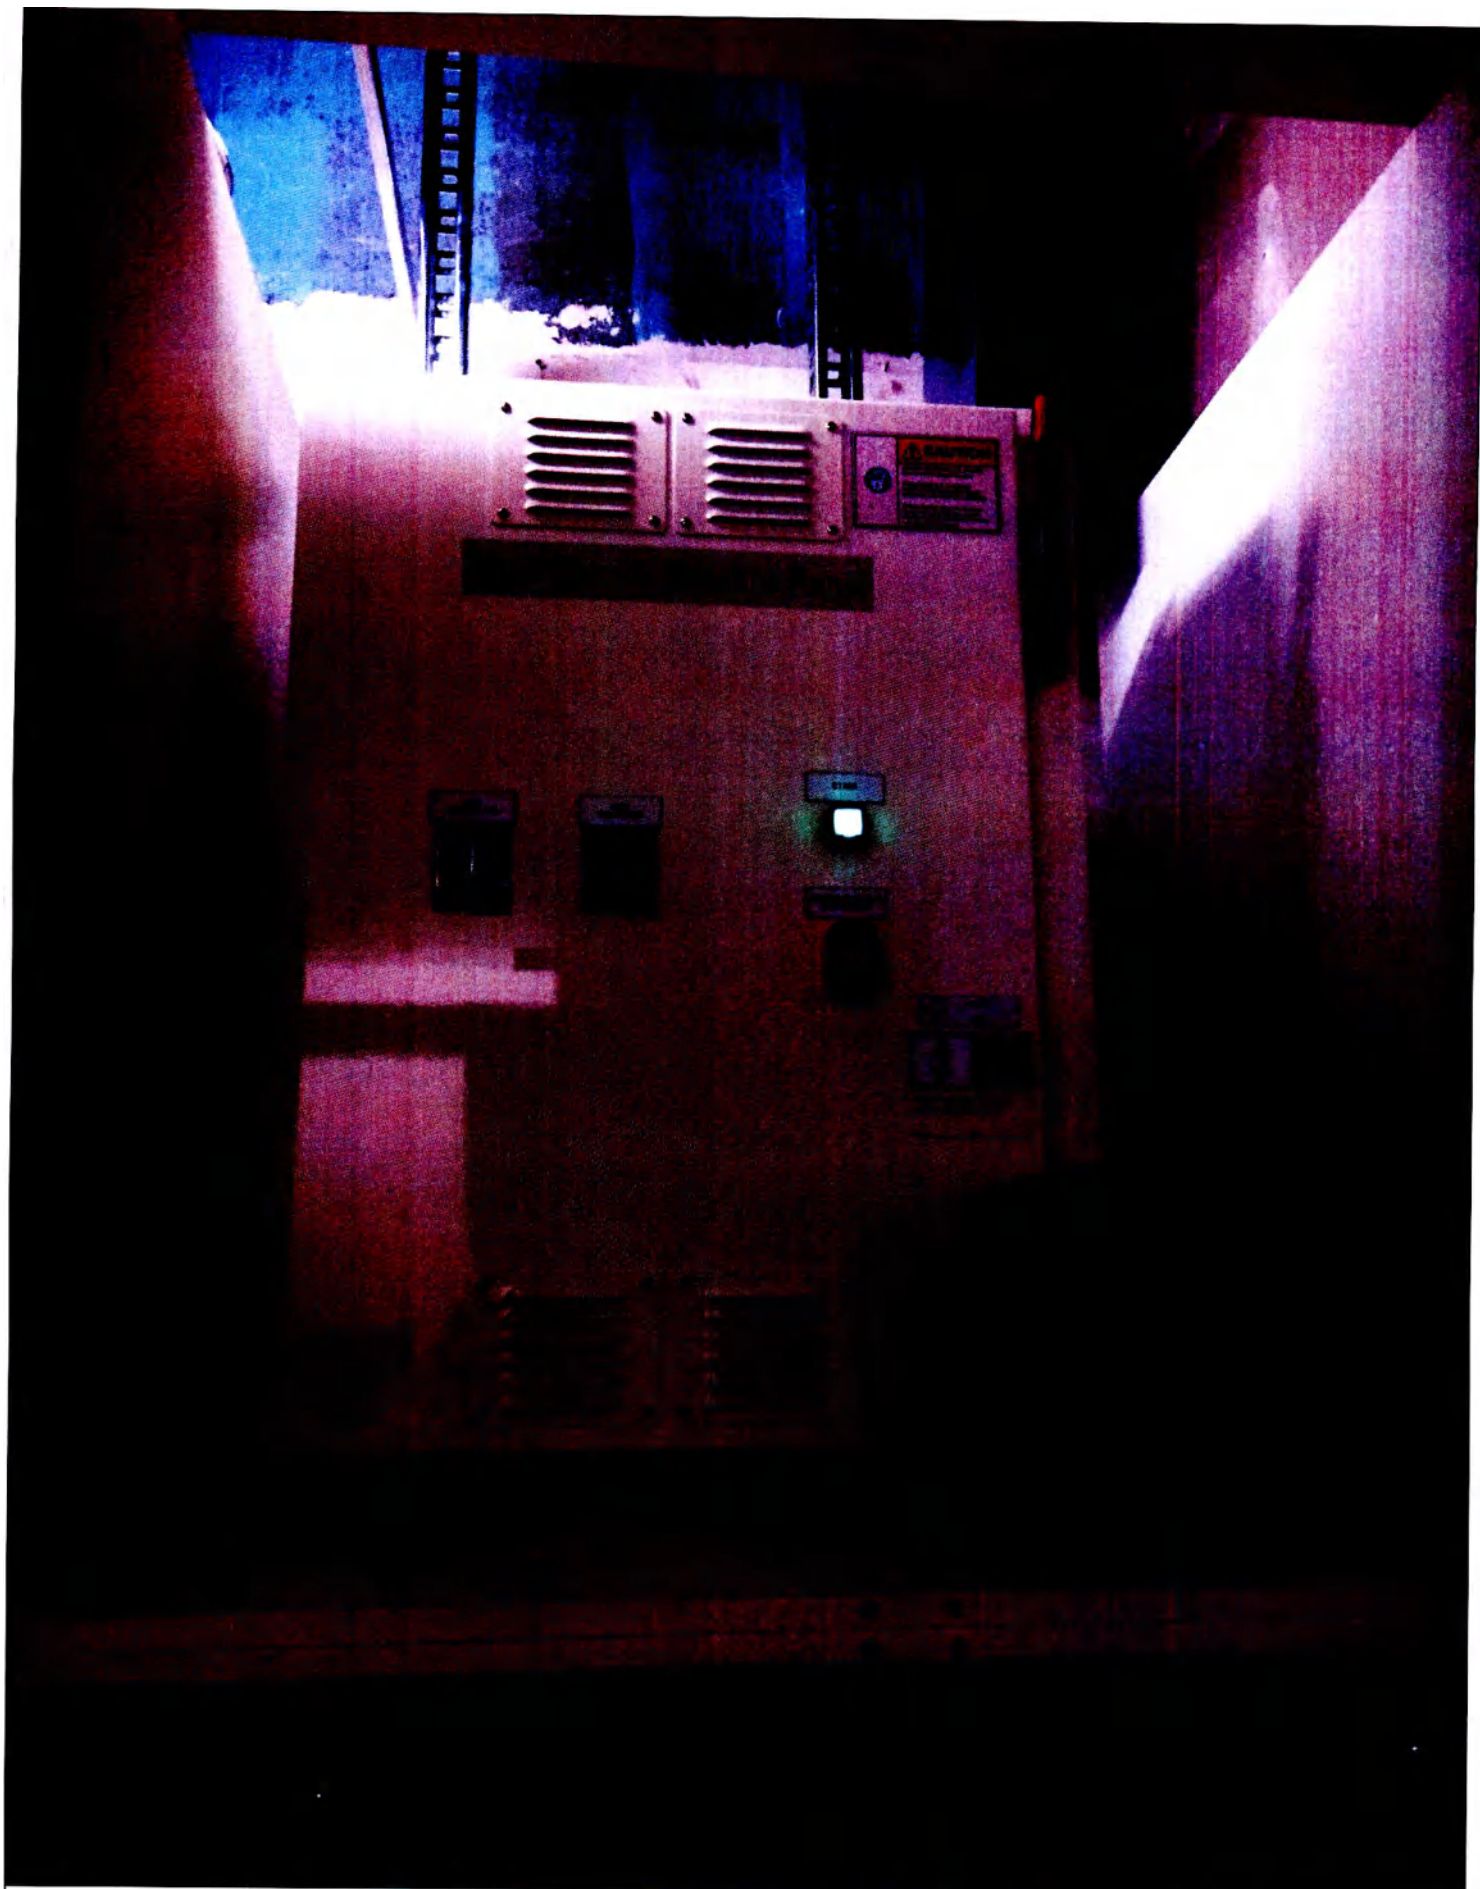


4. Электрораспределительный щит.

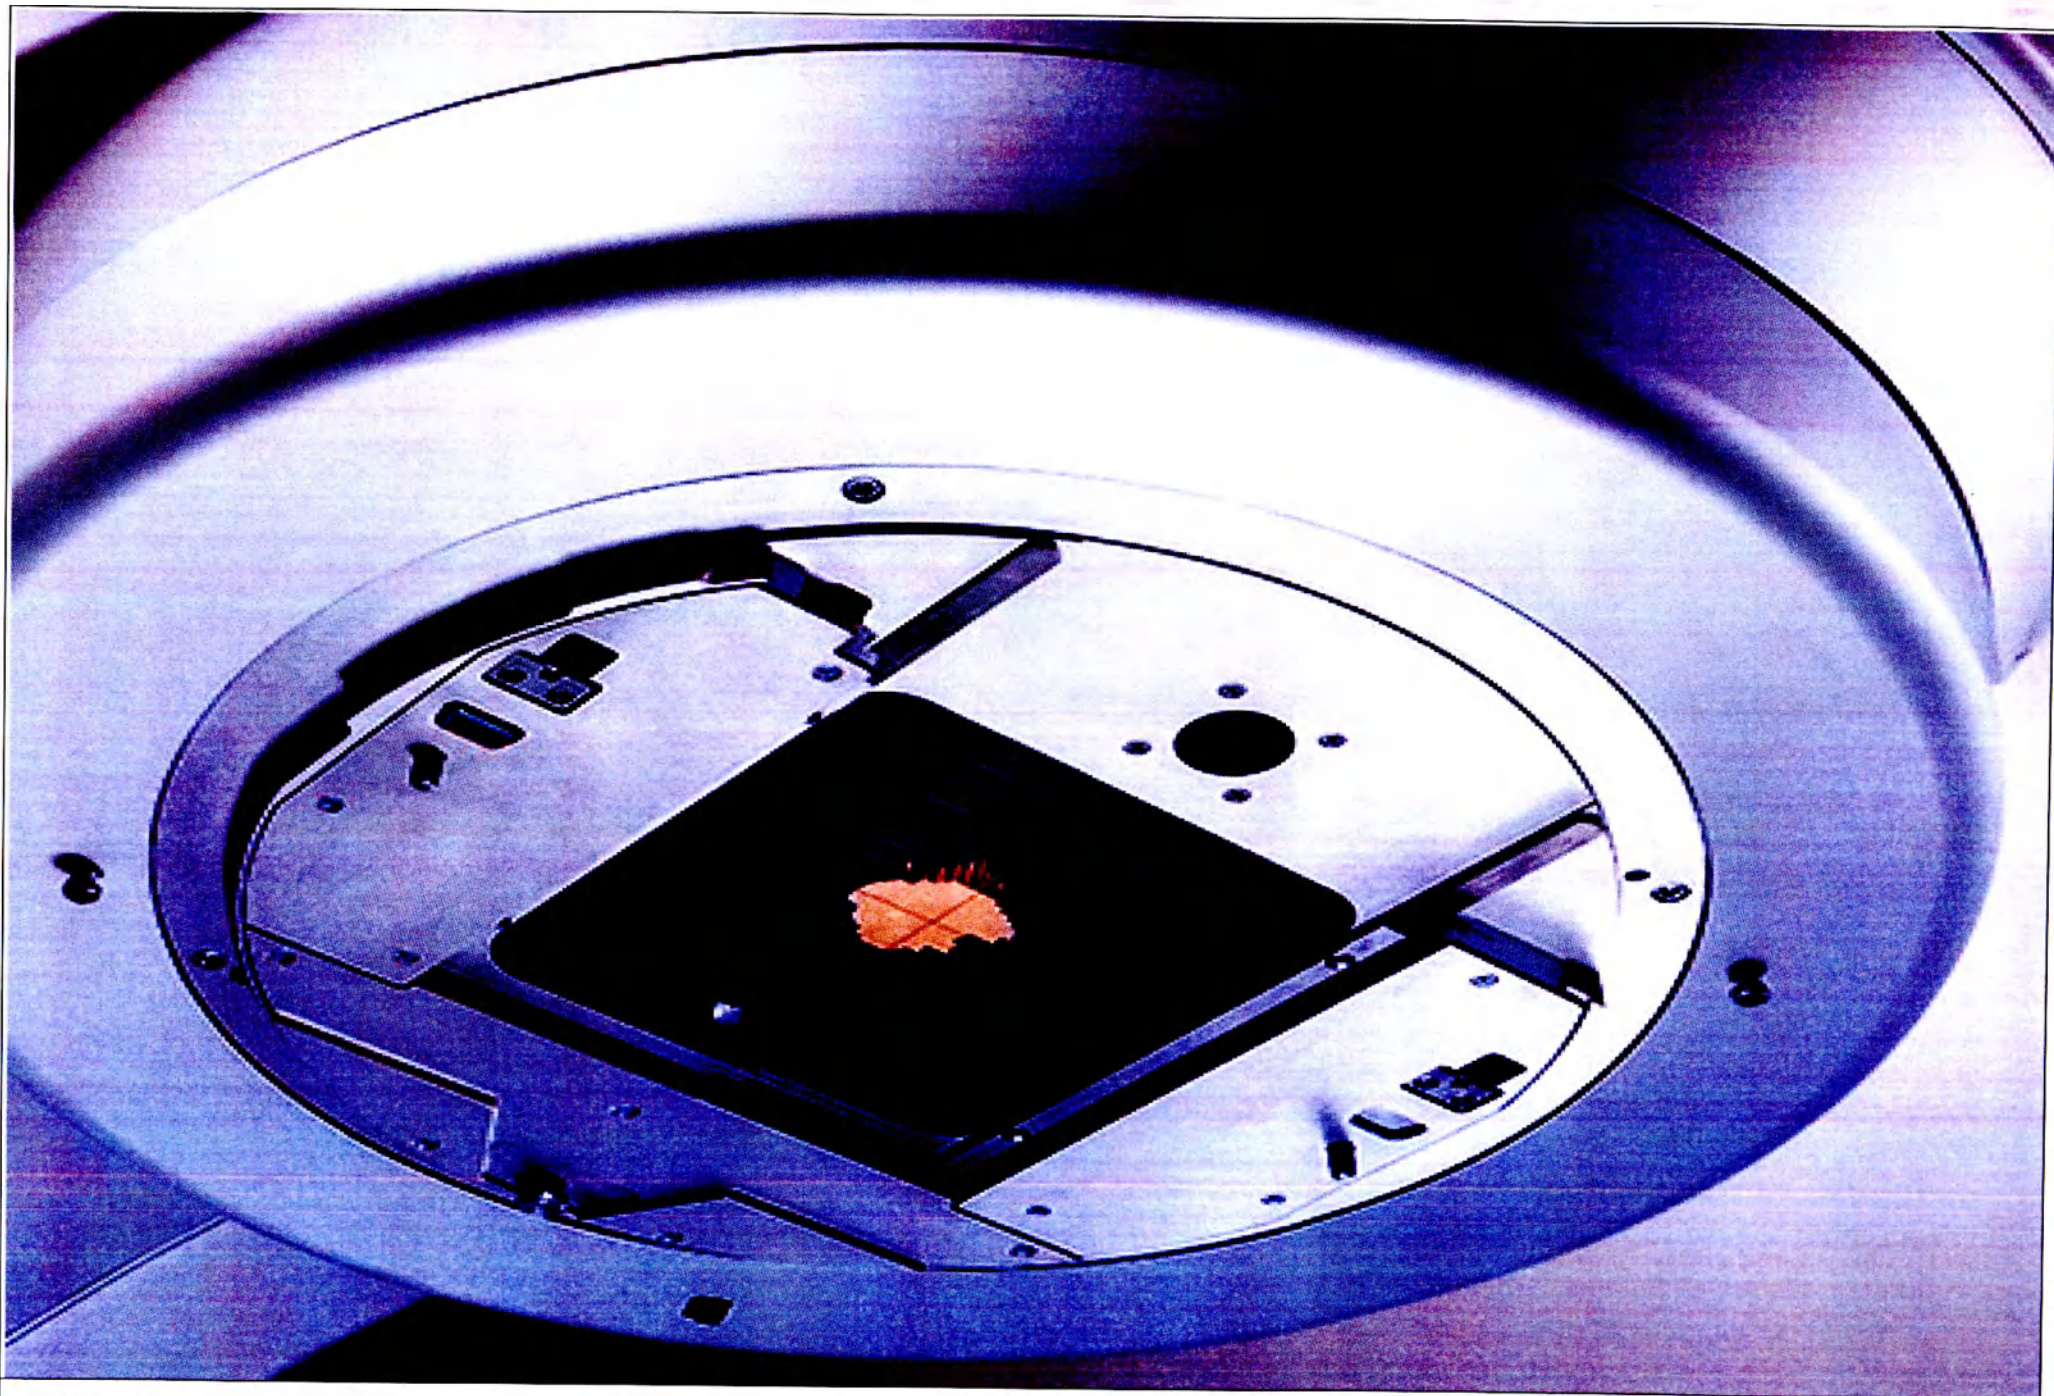


5а. Многолепестковый коллиматор 120 или 120HD.

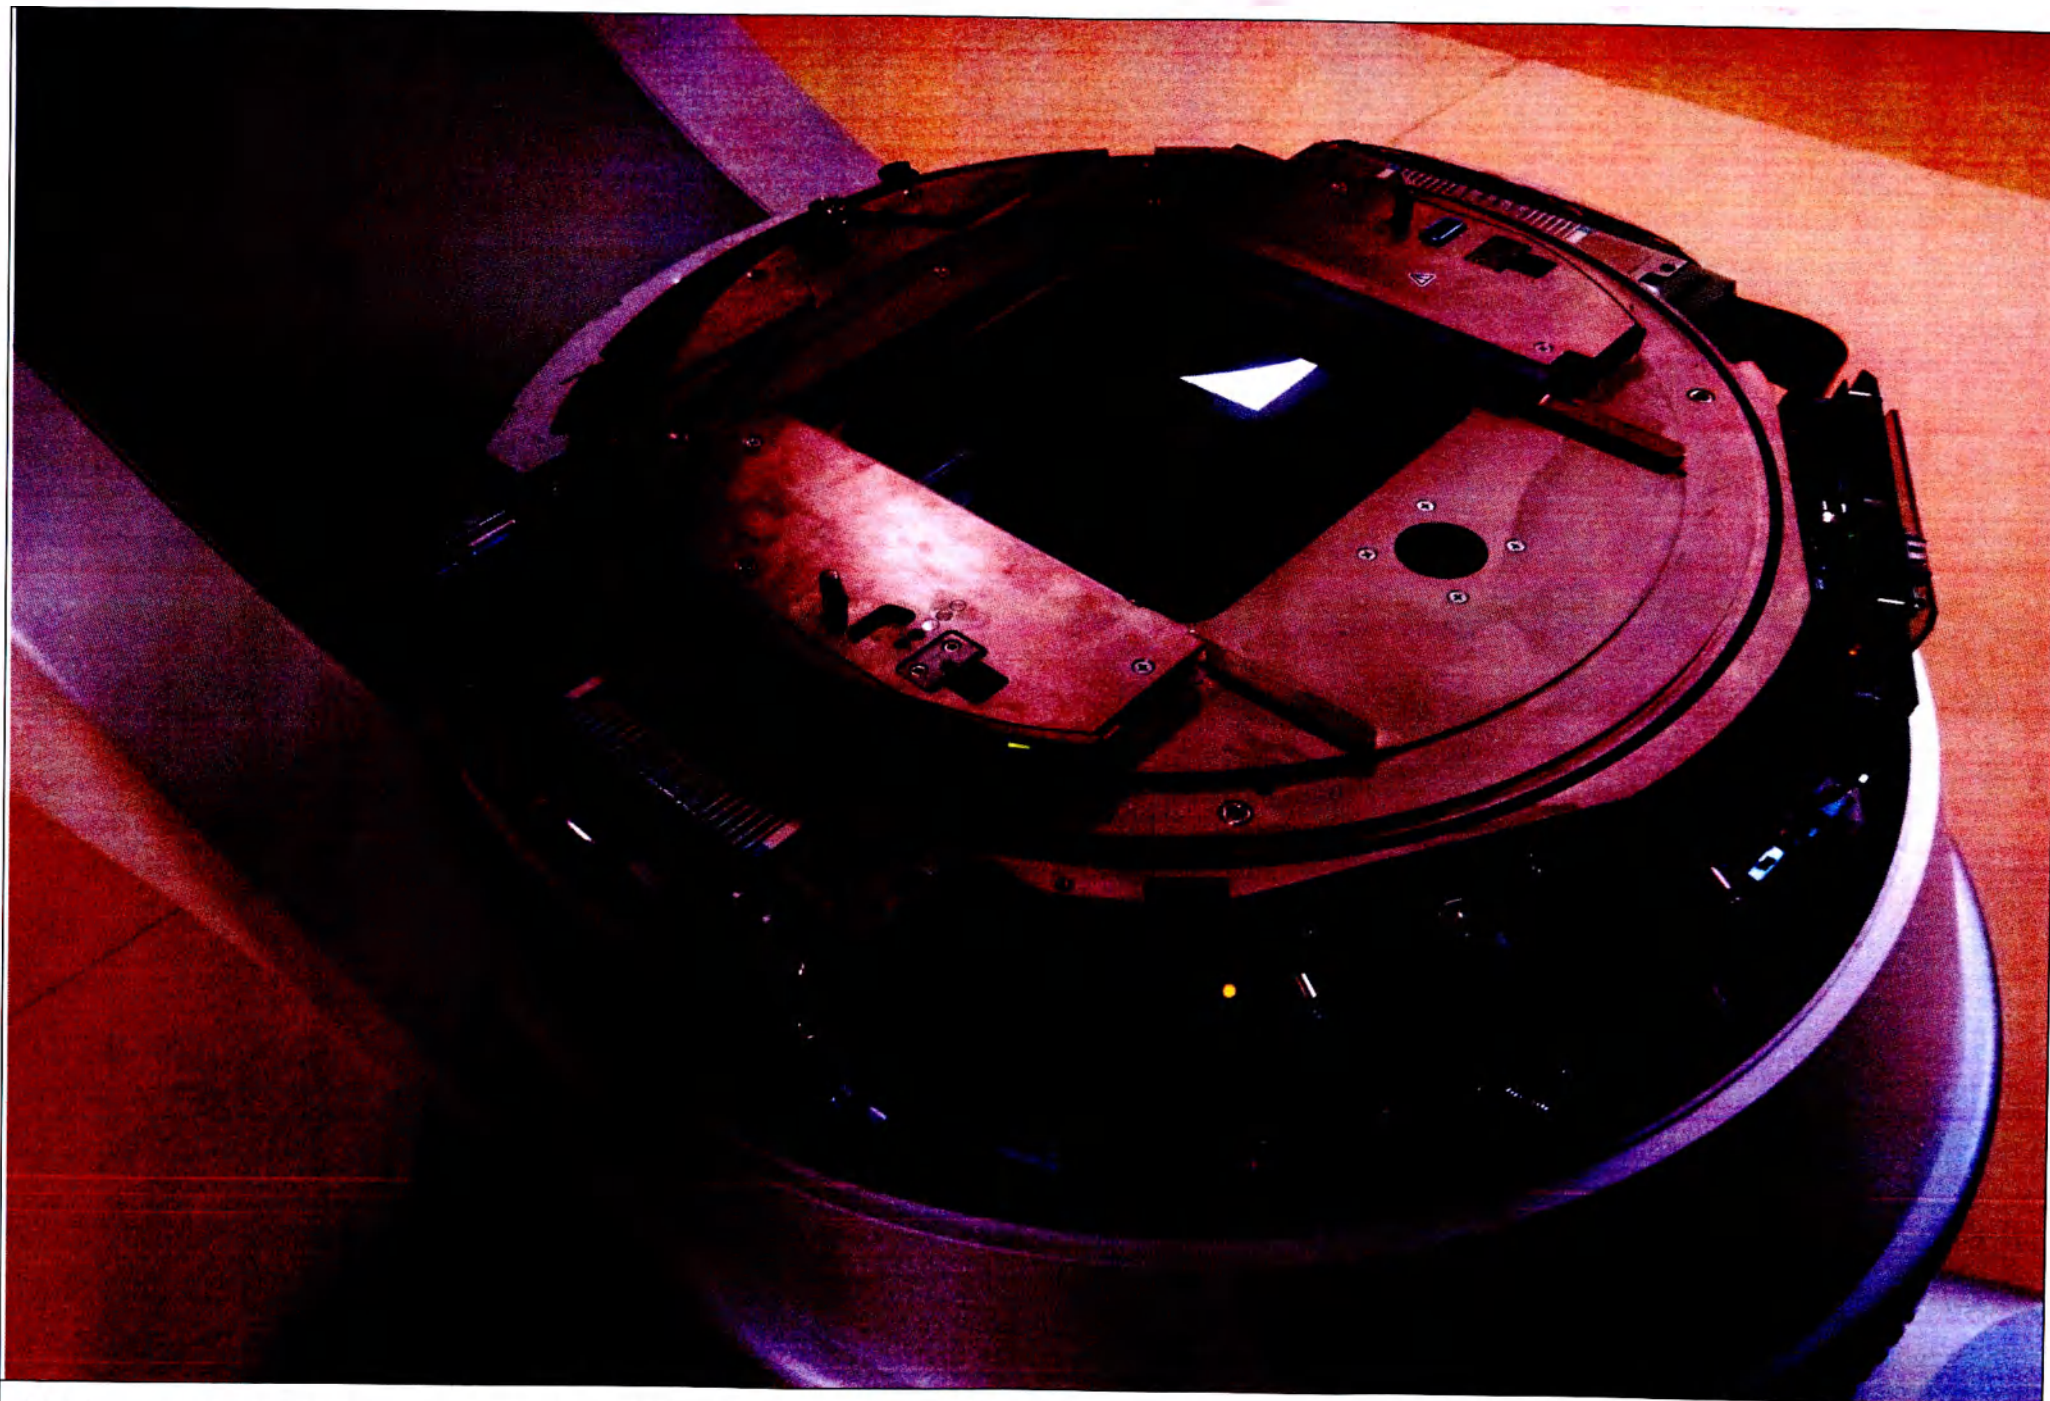


56. Многолепестковый коллиматор 120 или 120HD.

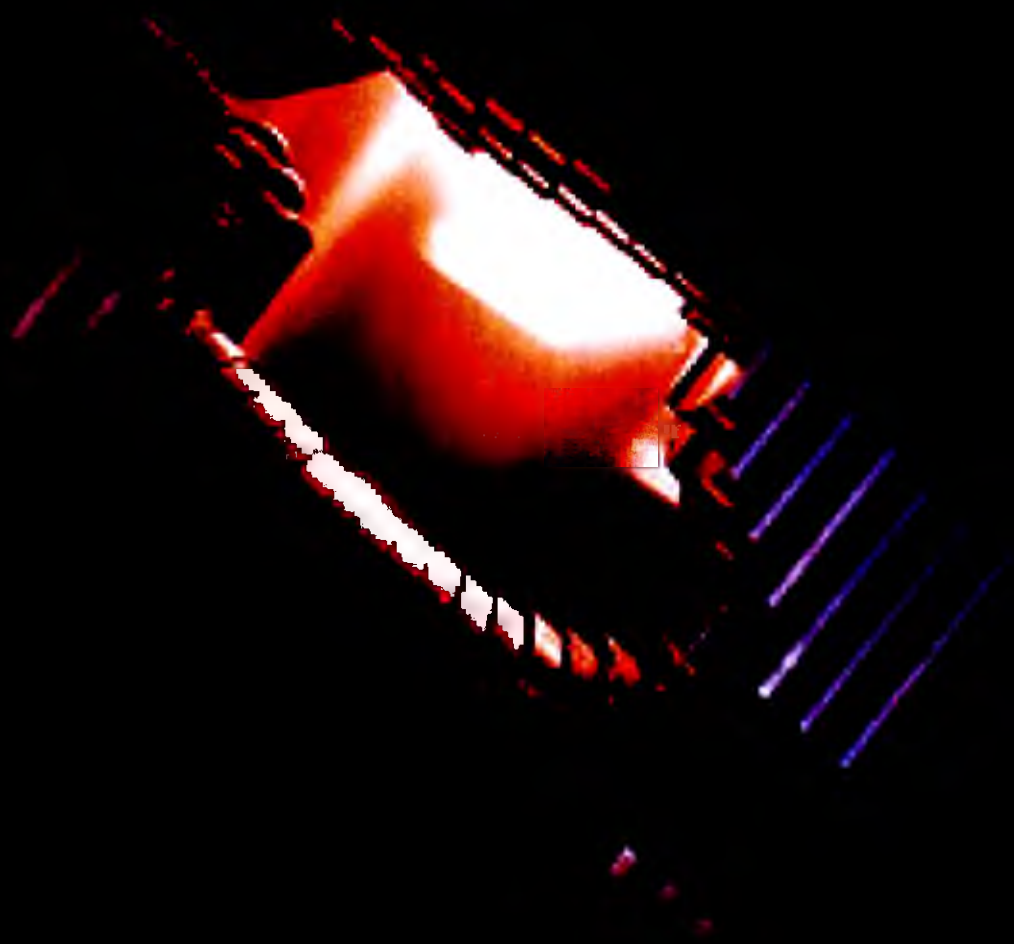


5в. Многоплестковый коллиматор 120 или 120HD.

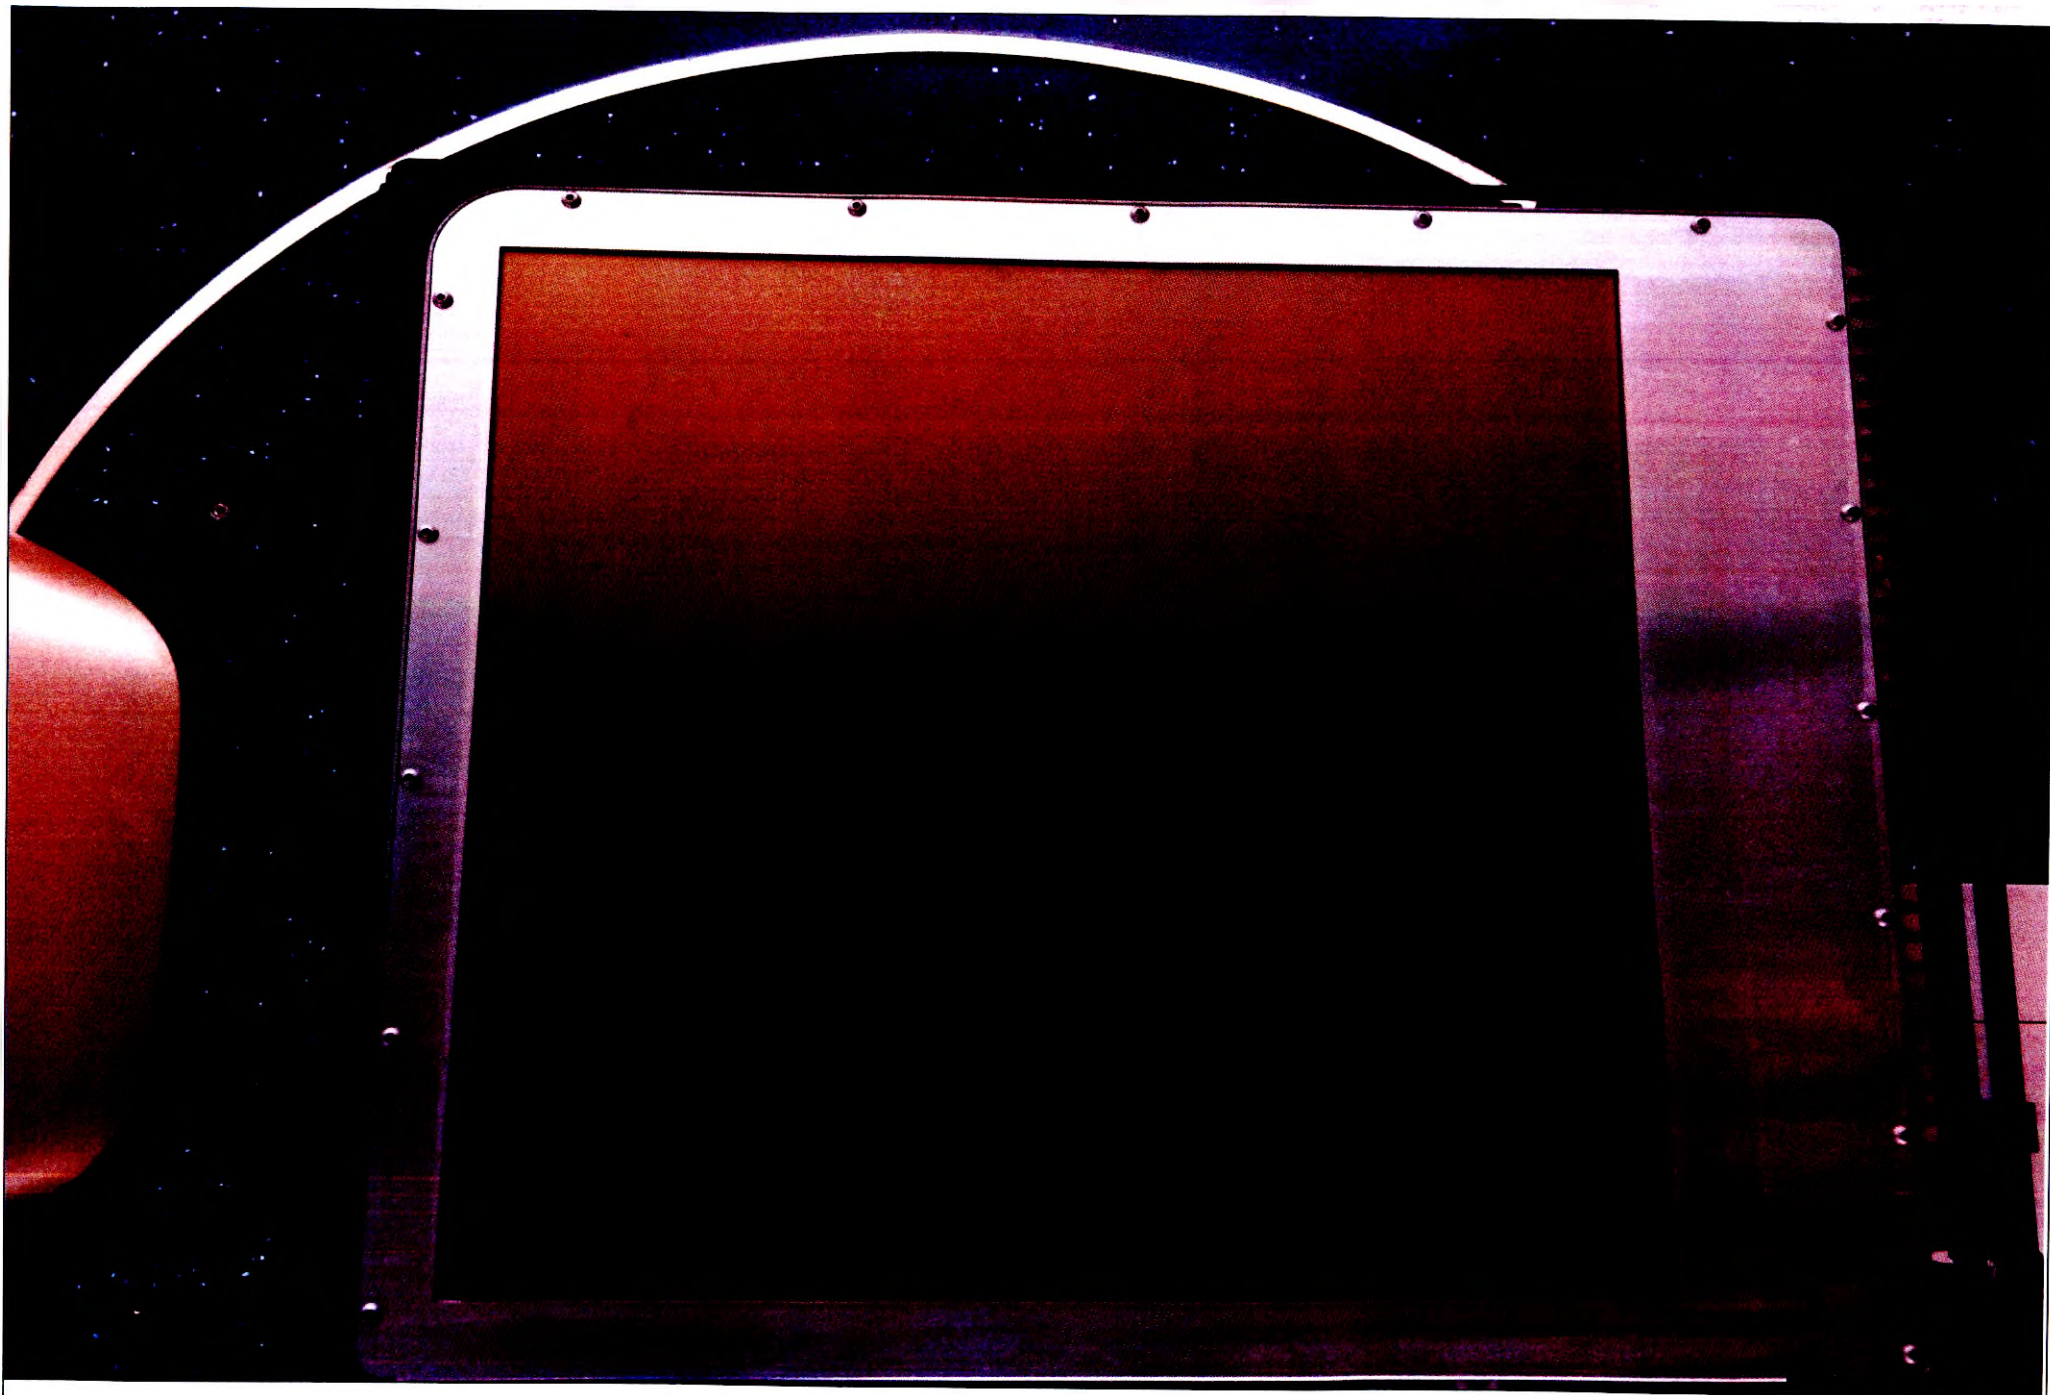


ба. Устройство портальной визуализации.

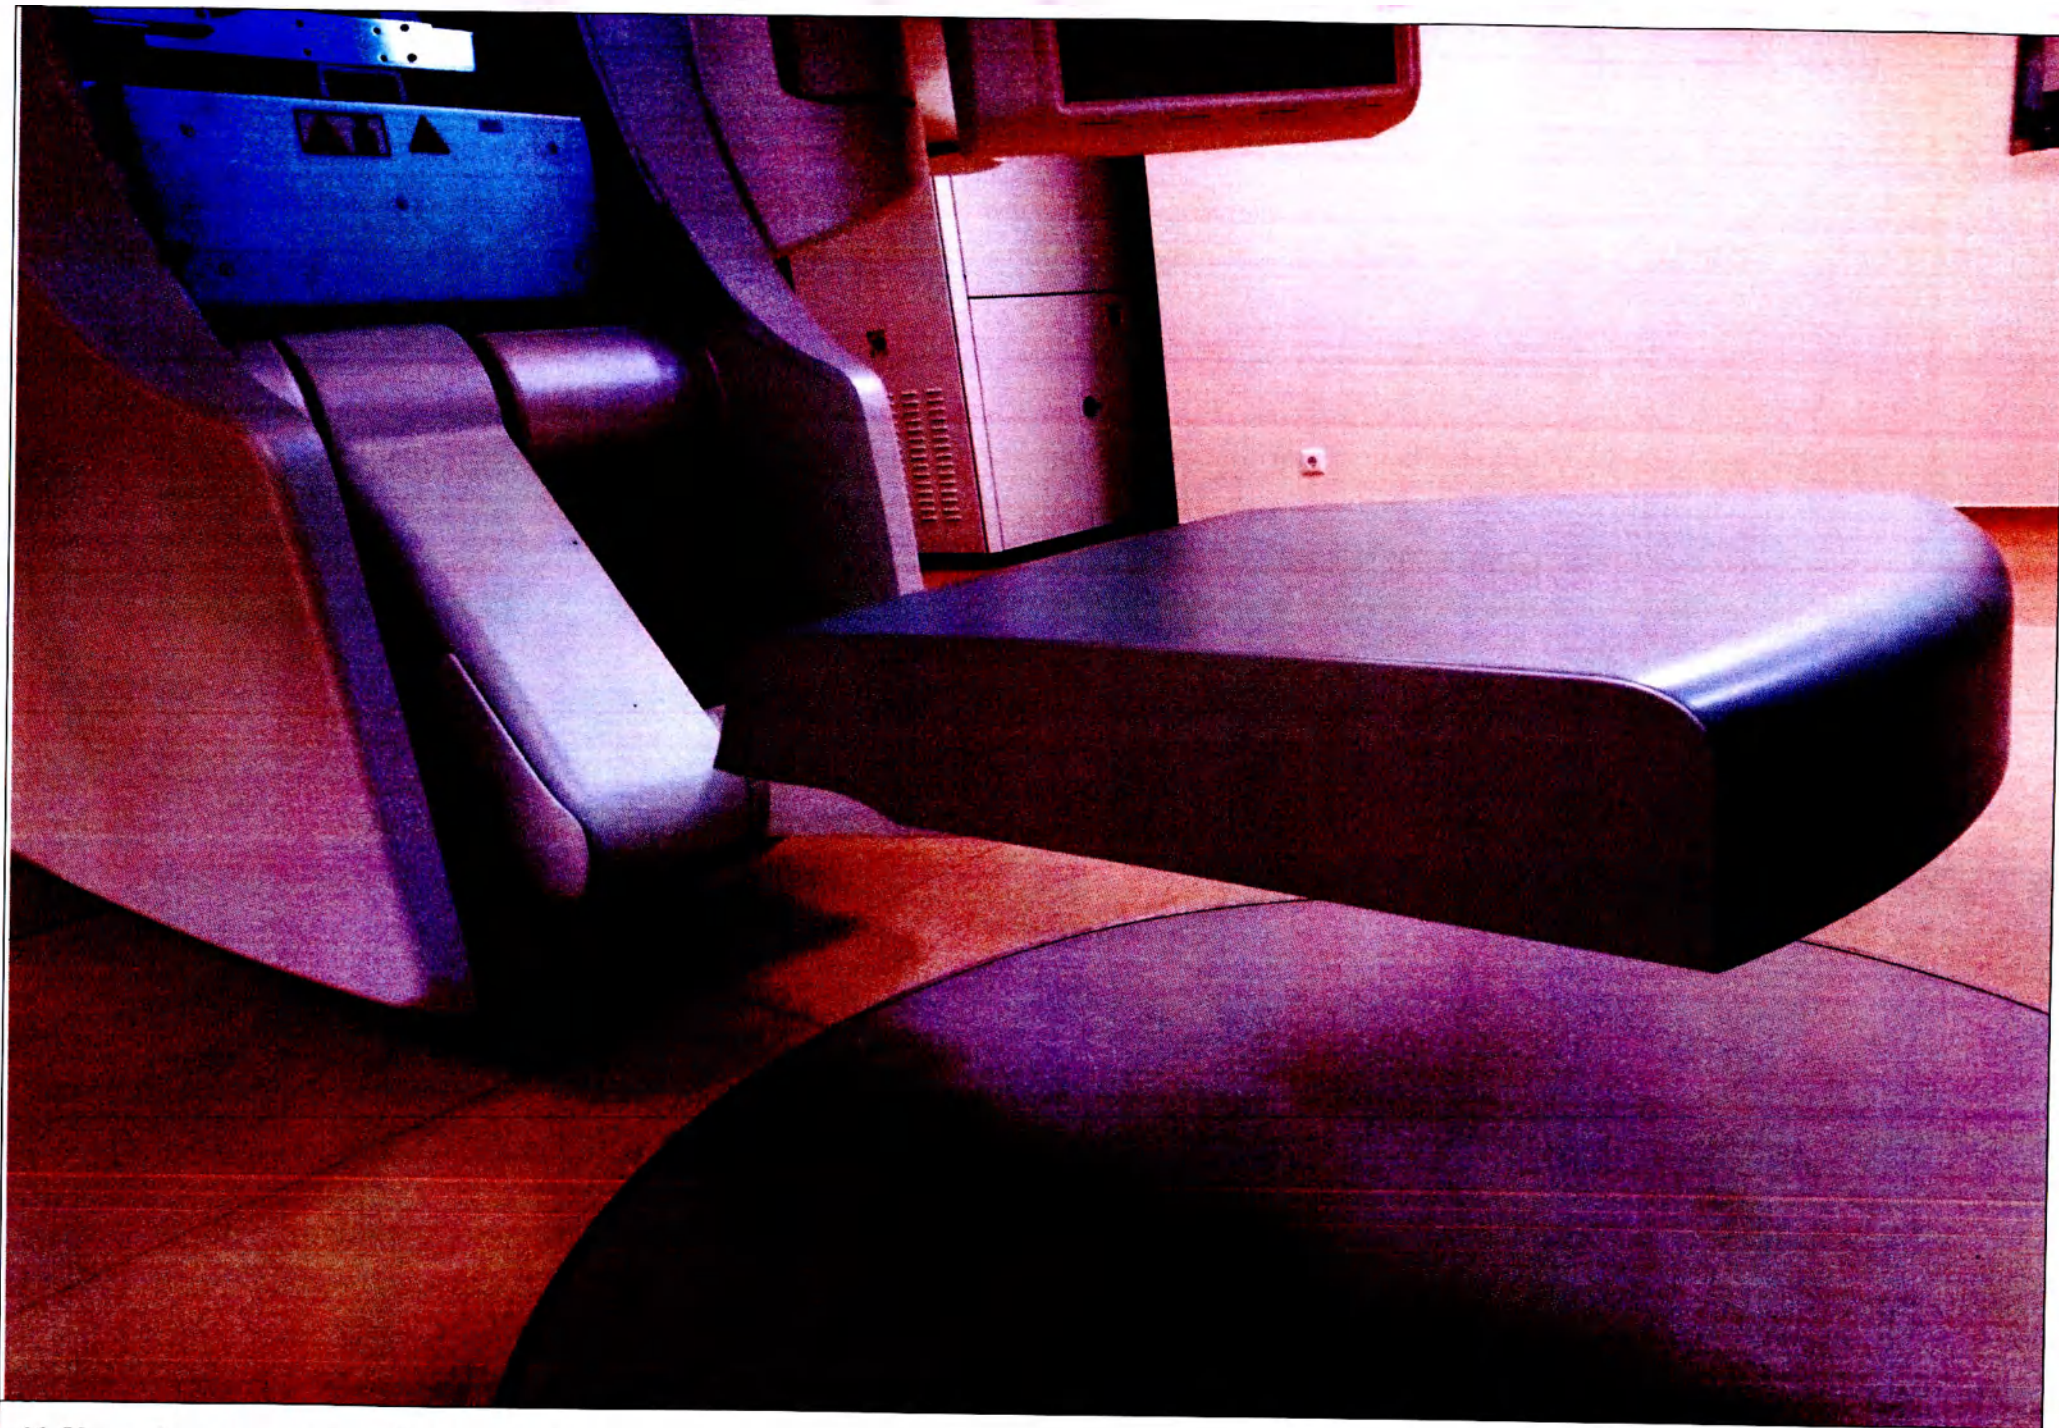

66. Устройство портальной визуализации.

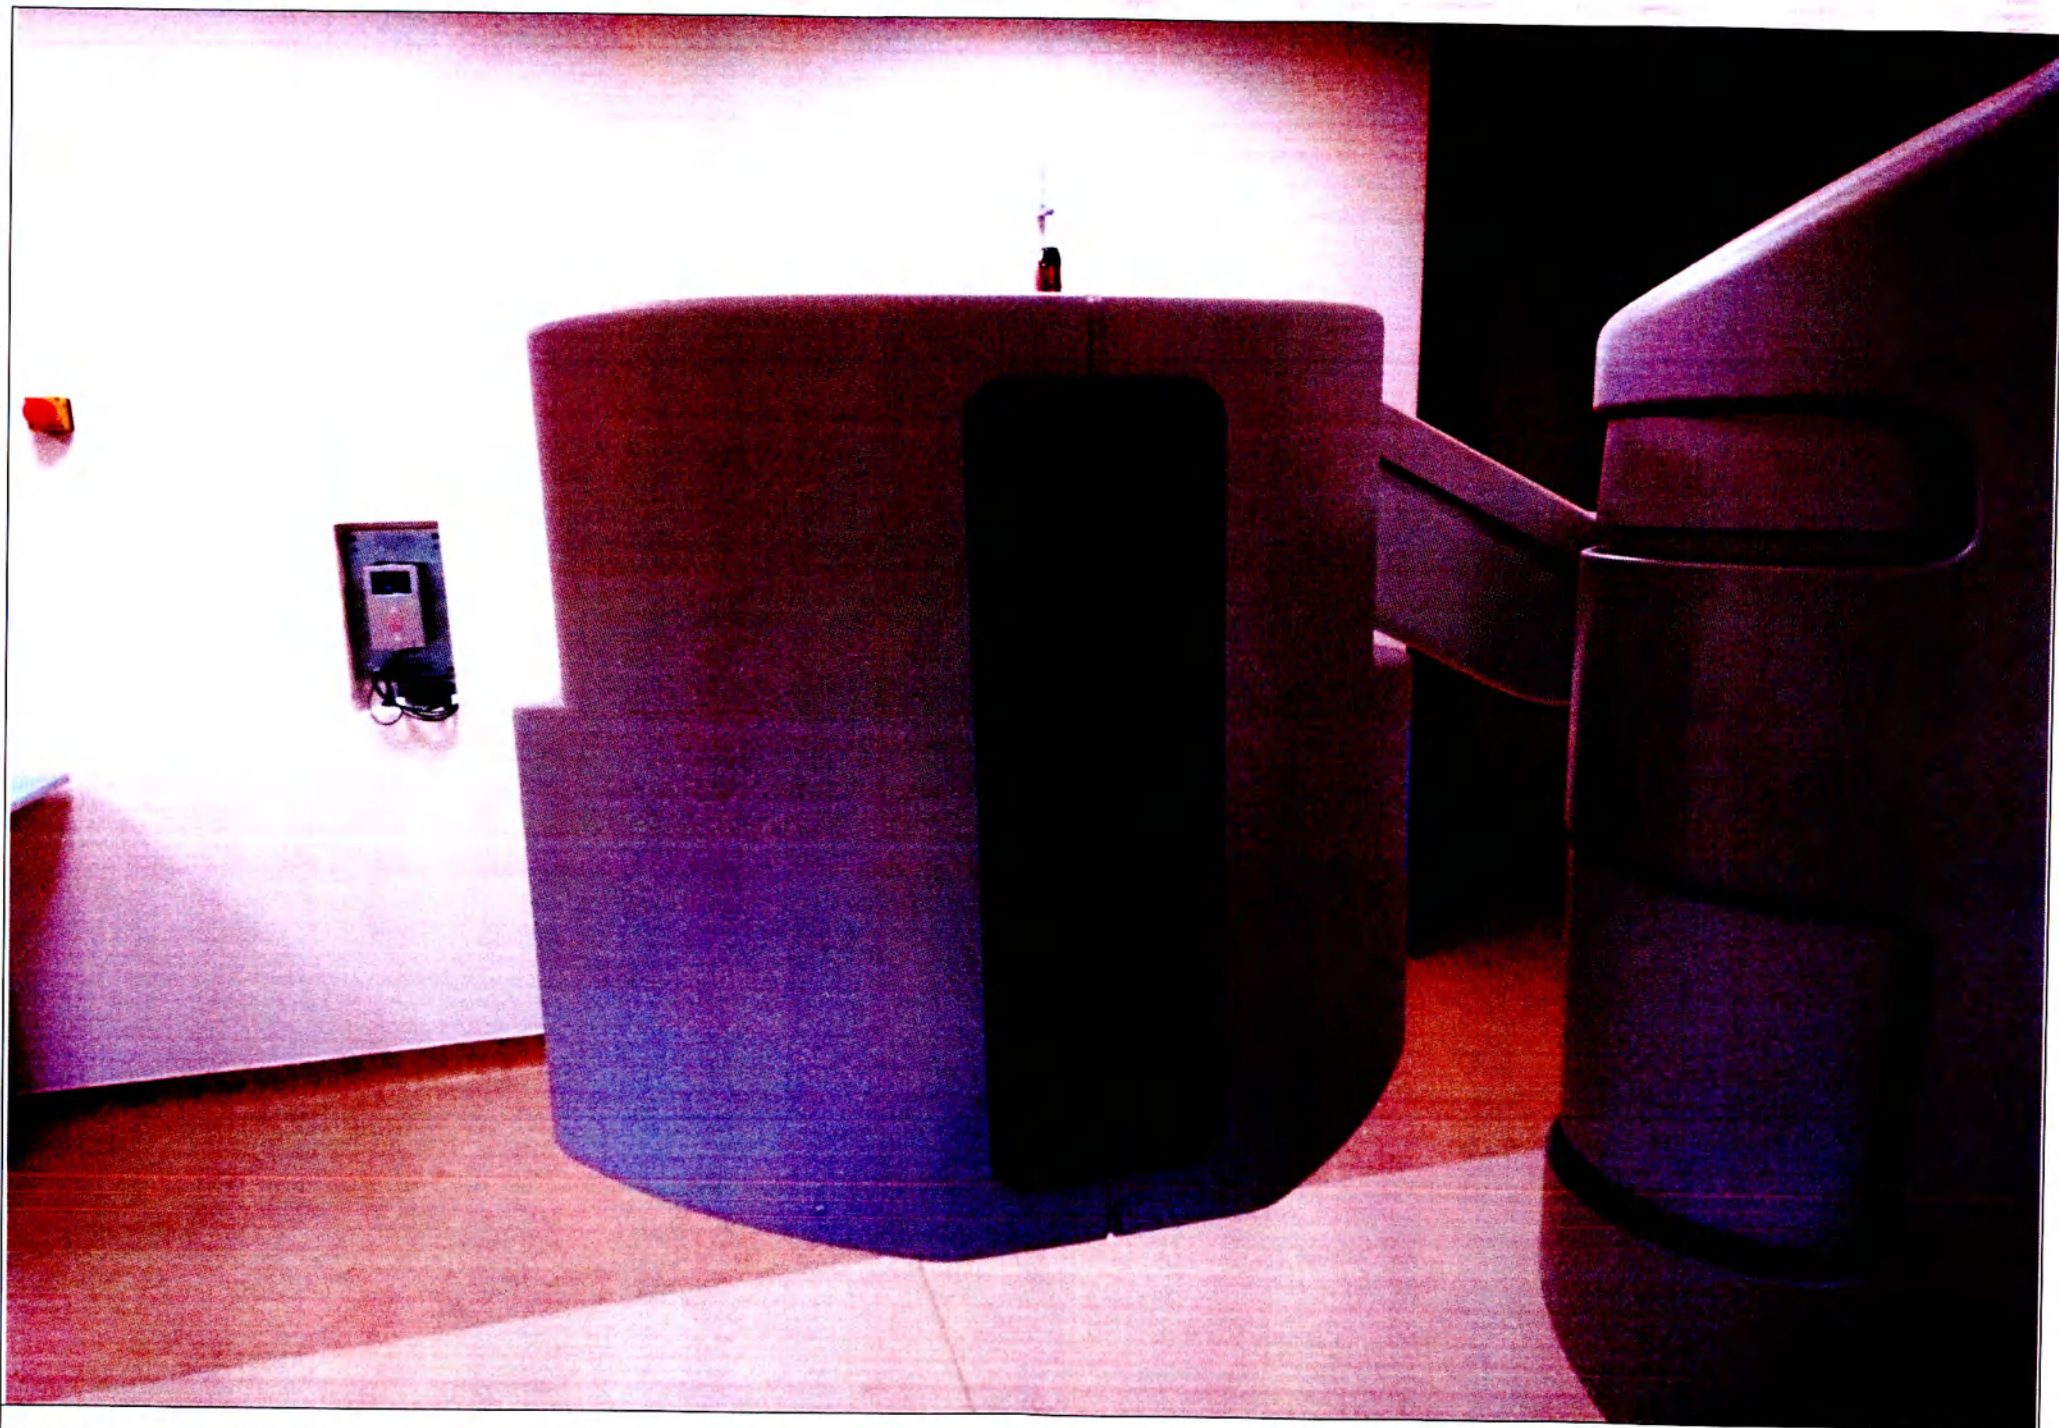


7а. Встроенная система рентгеновизуализации.

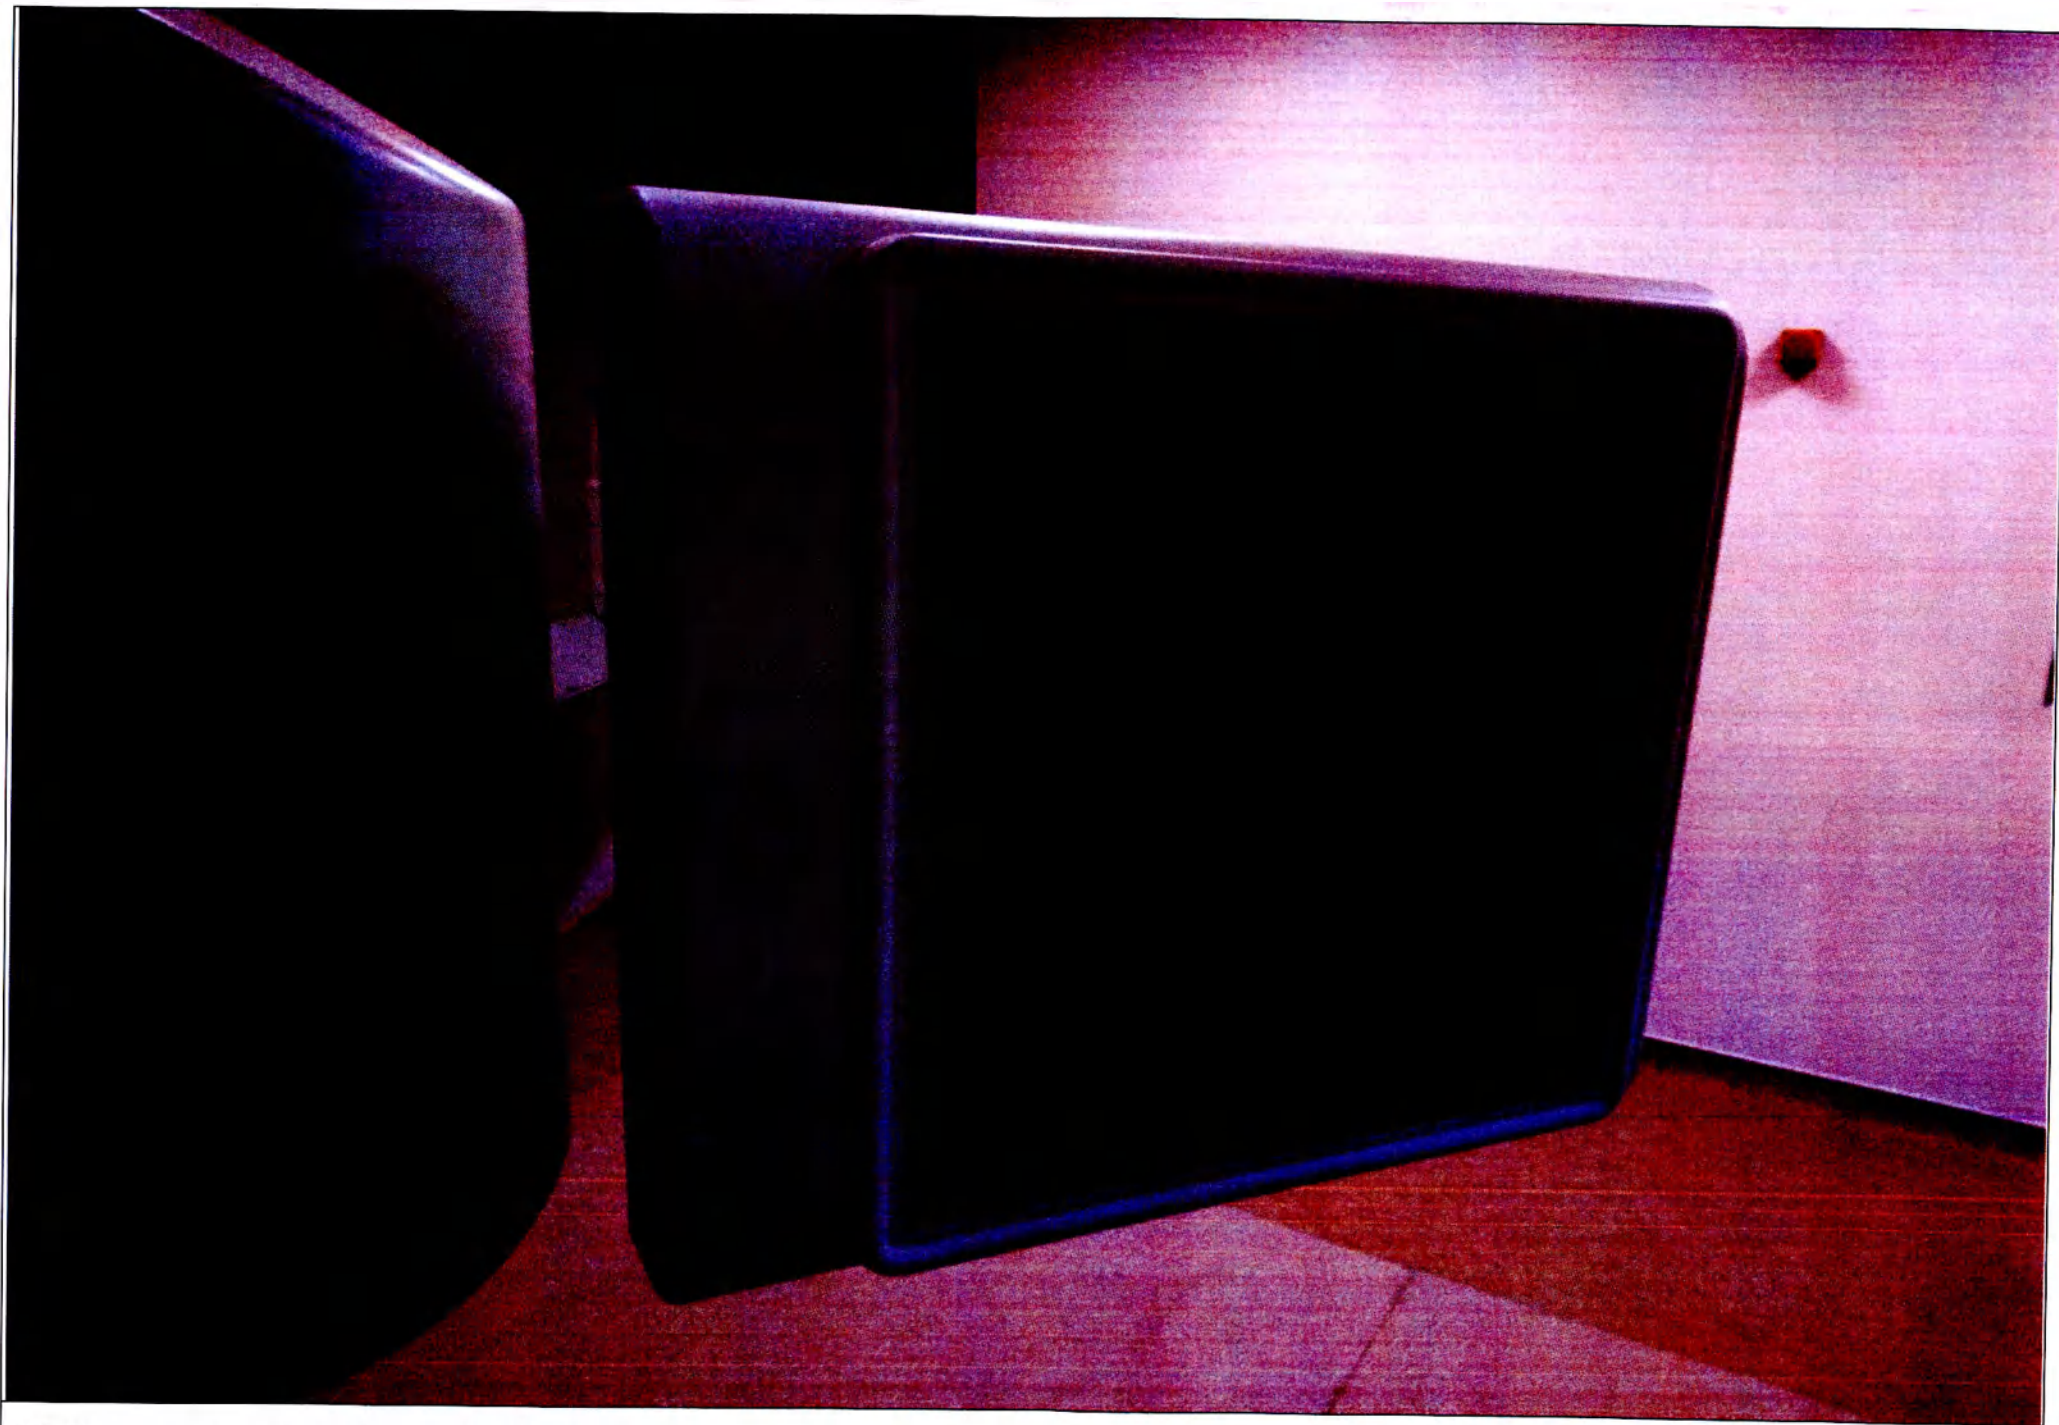

76. Встроенная система рентгеновизуализации.




76. Встроенная система рентгеновизуализации.

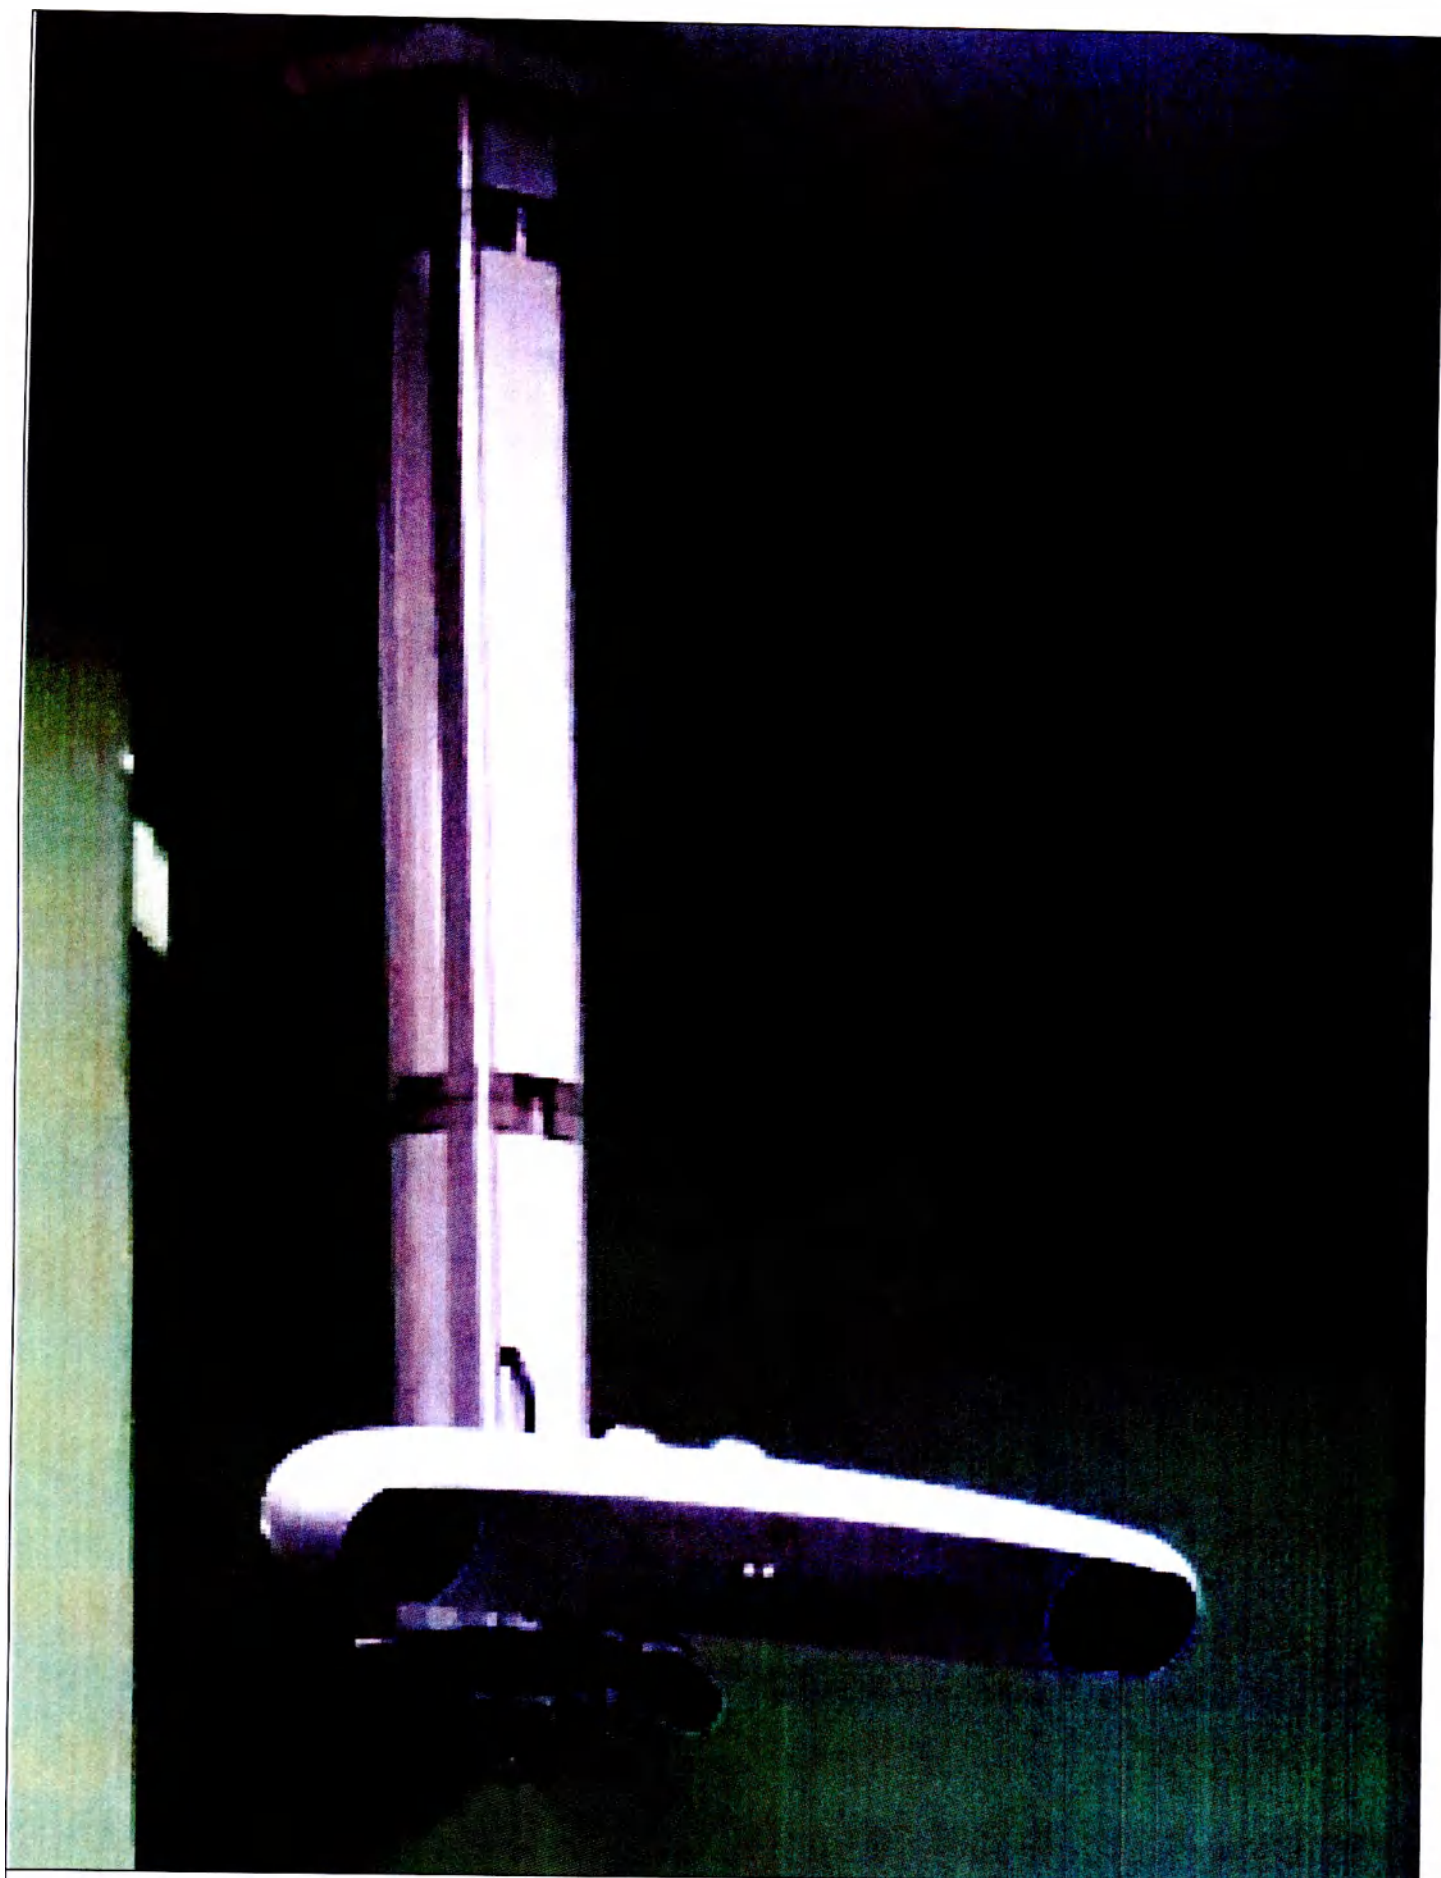


8. Устройство оптической визуализации.



9а. Набор для стереотаксического облучения (стартовый набор).

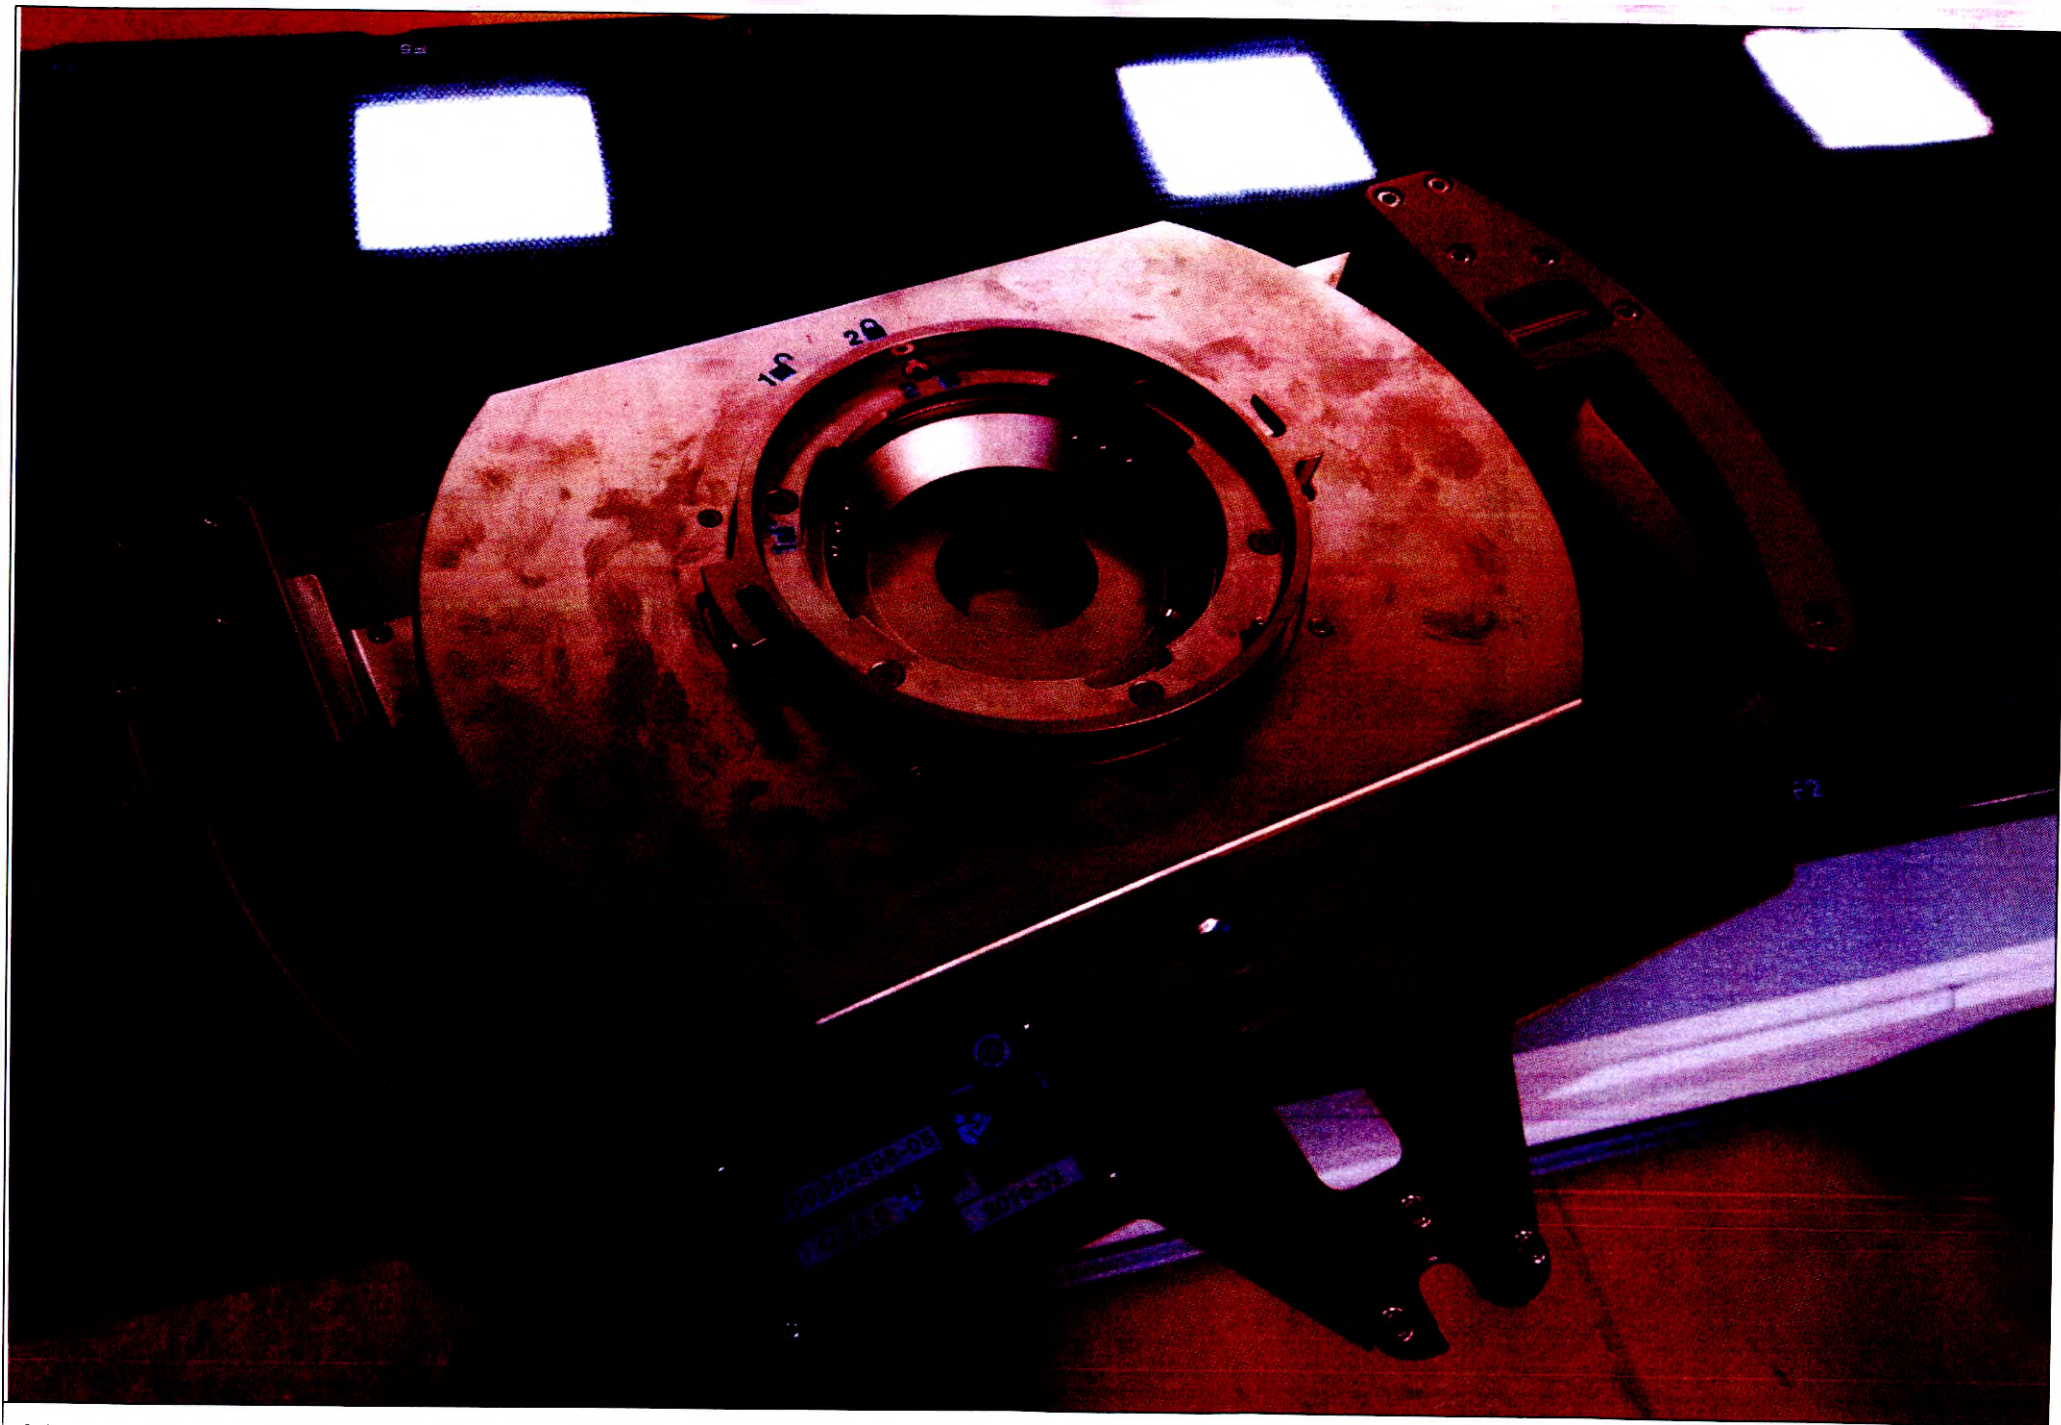


96. Набор для стереотаксического облучения (стартовый набор).

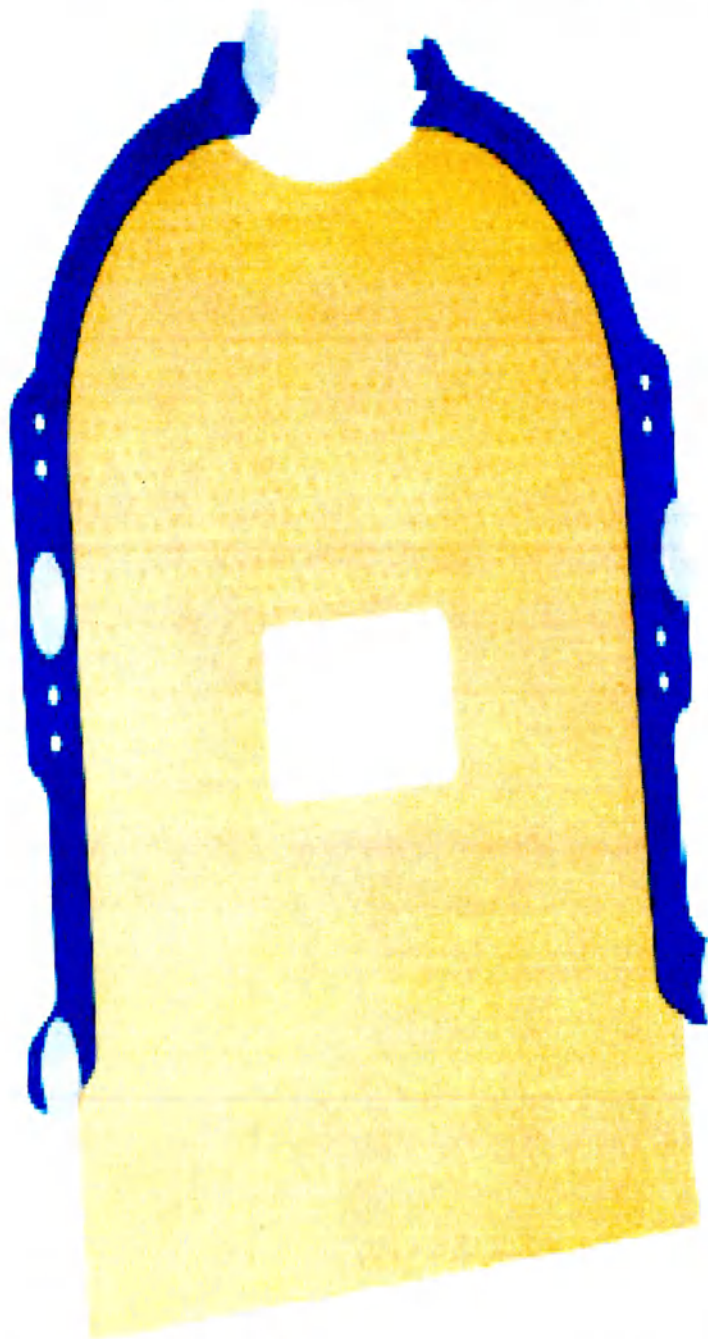

10а. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).




106. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

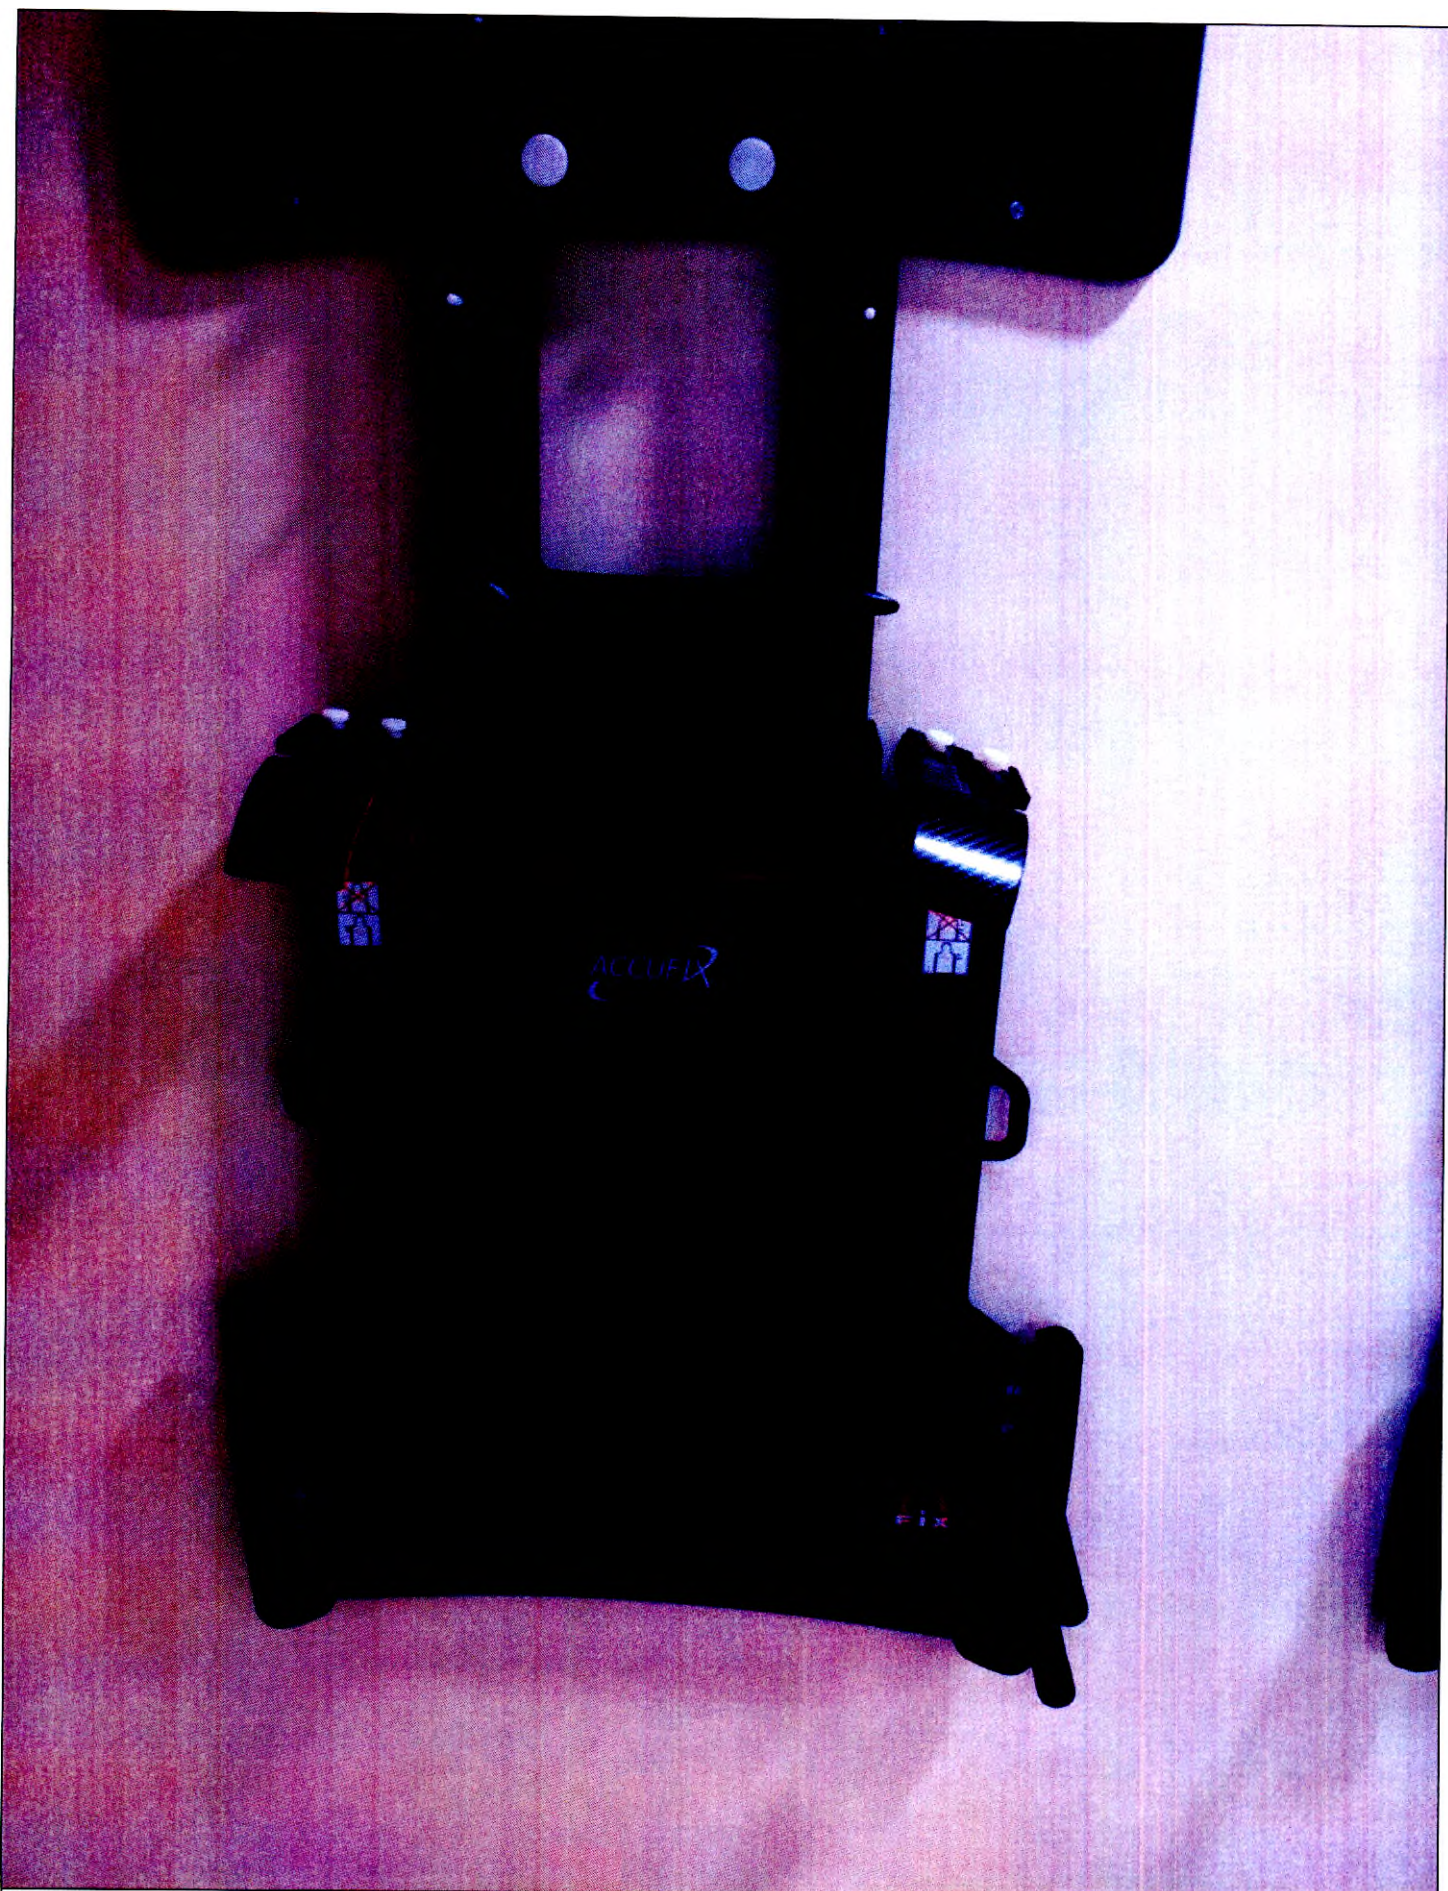


10в. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).




10г. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

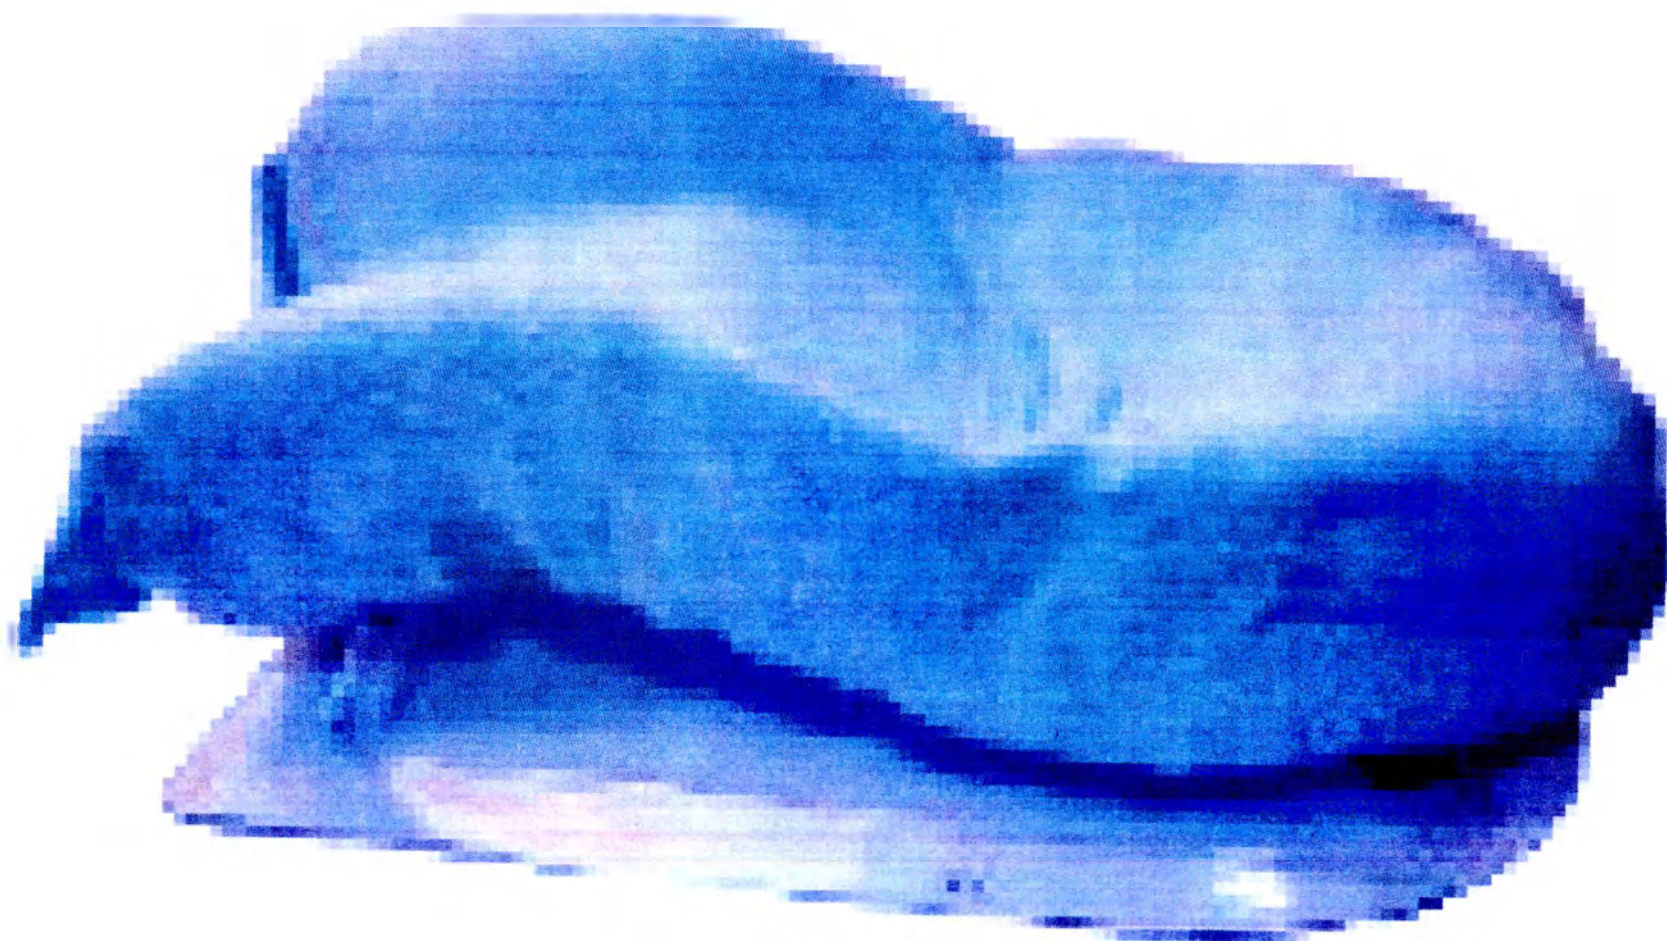


10д. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

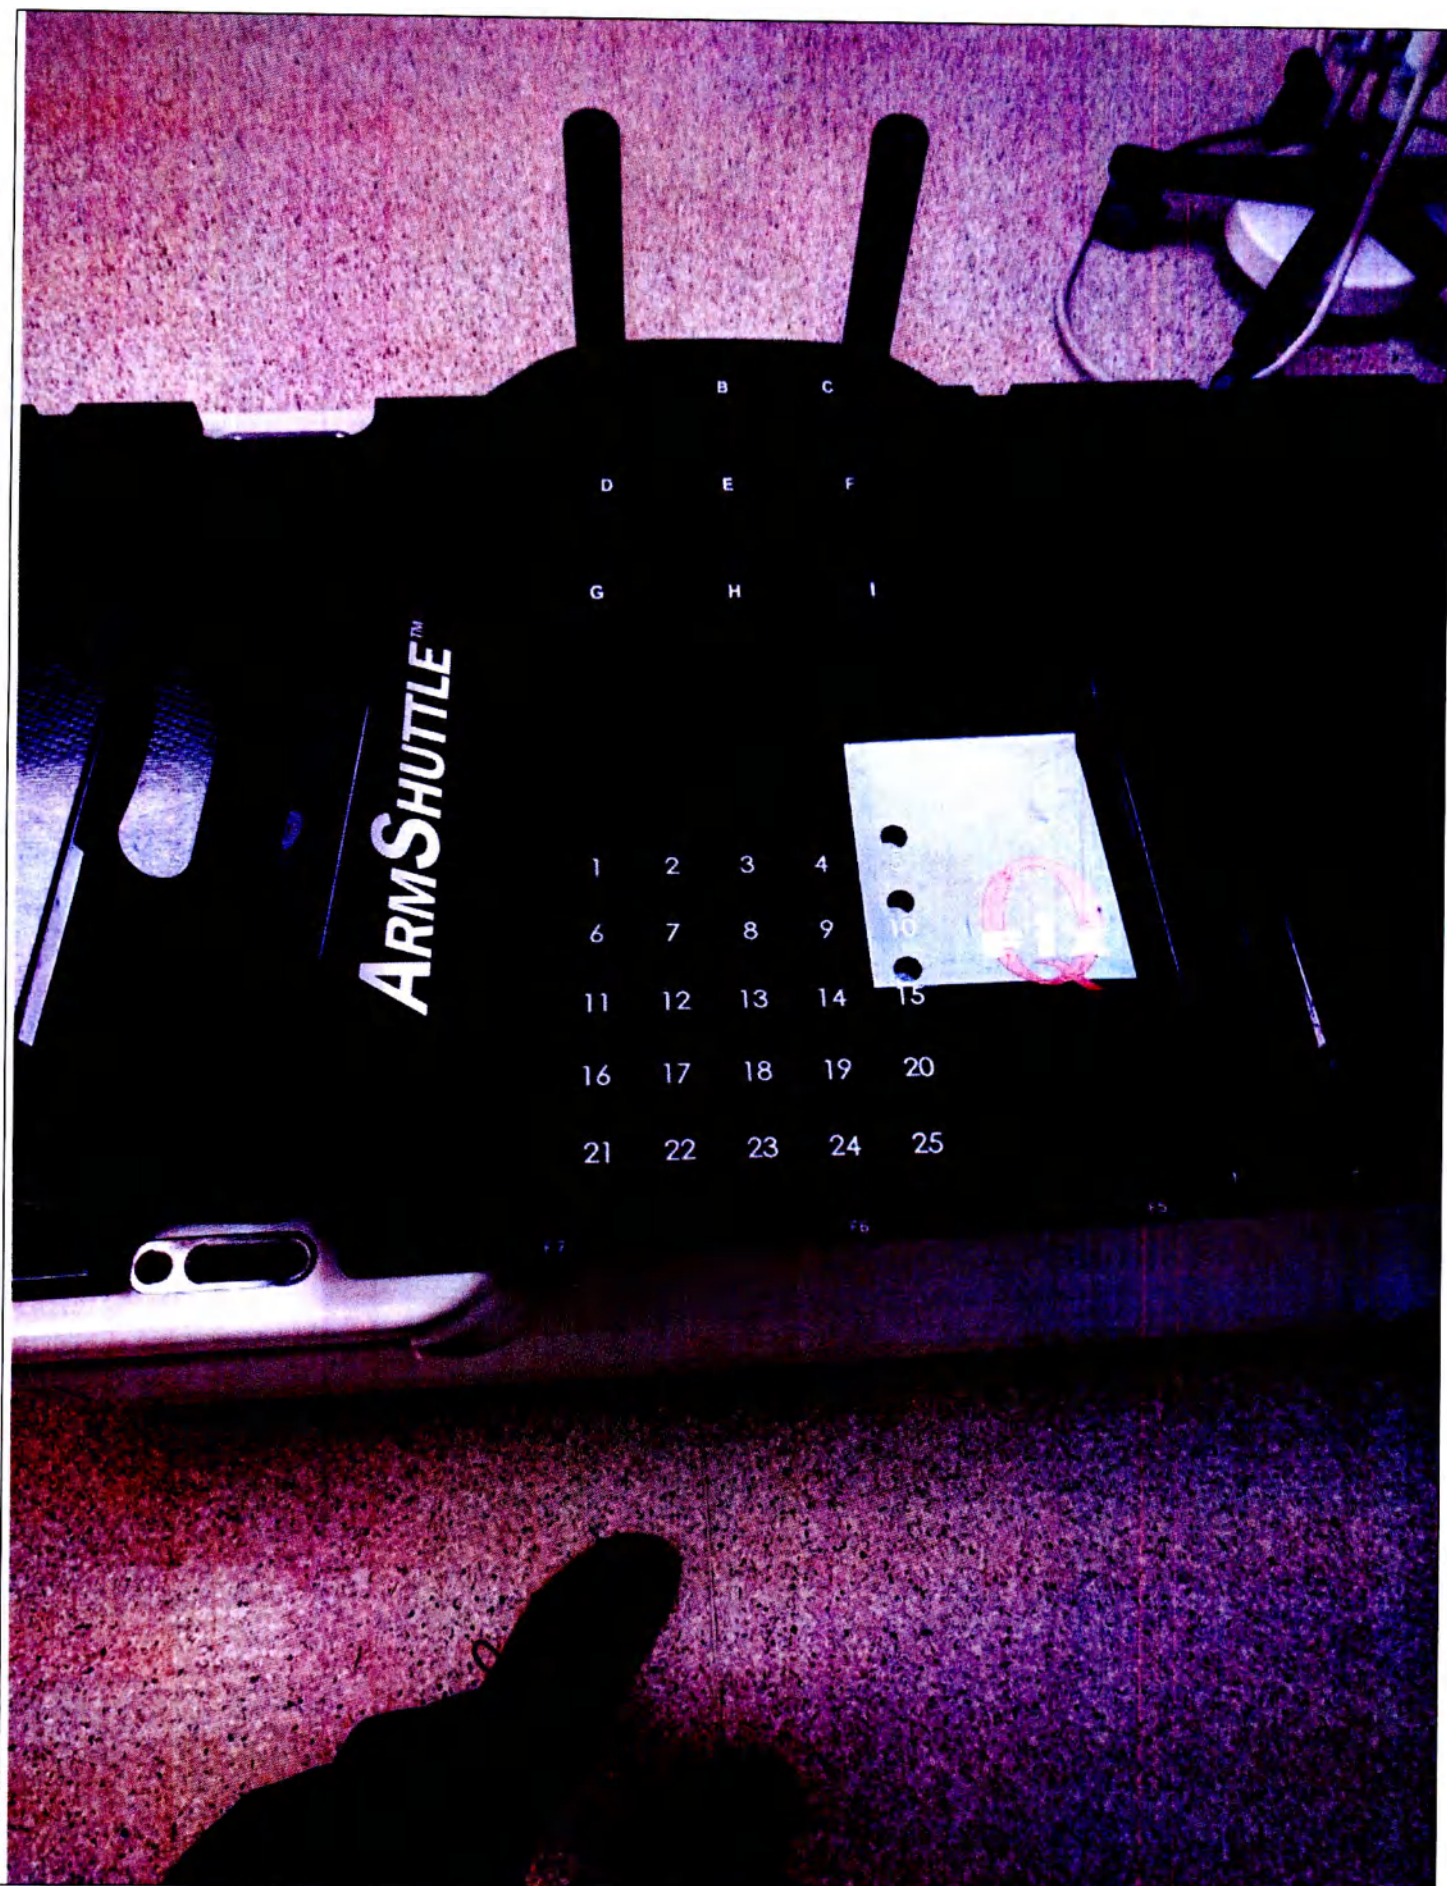

10е. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

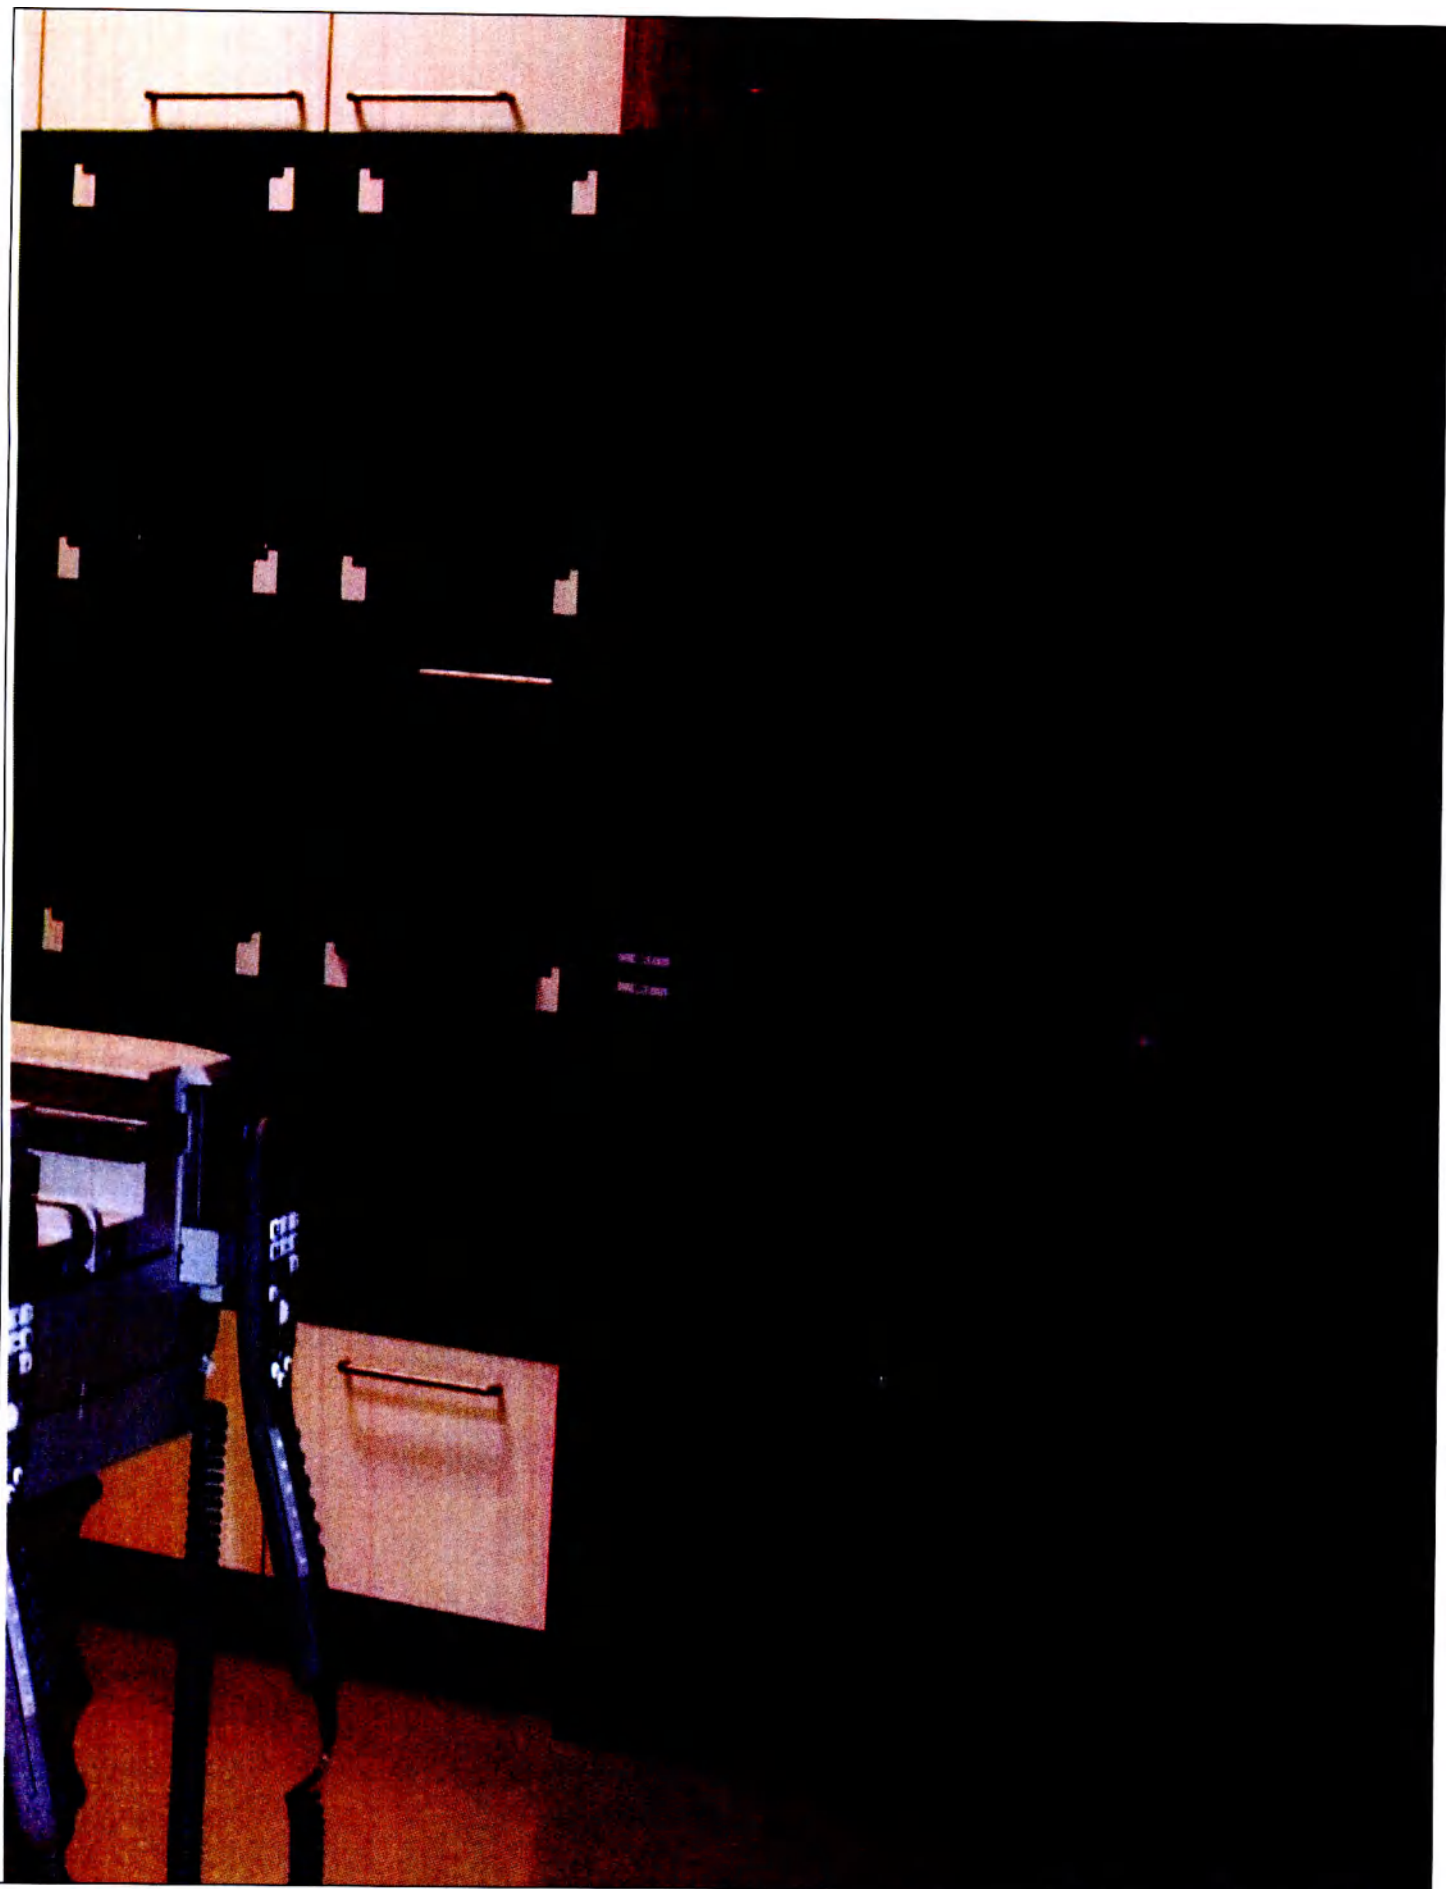

10ж. Набор для фиксации пациента (стартовый набор).

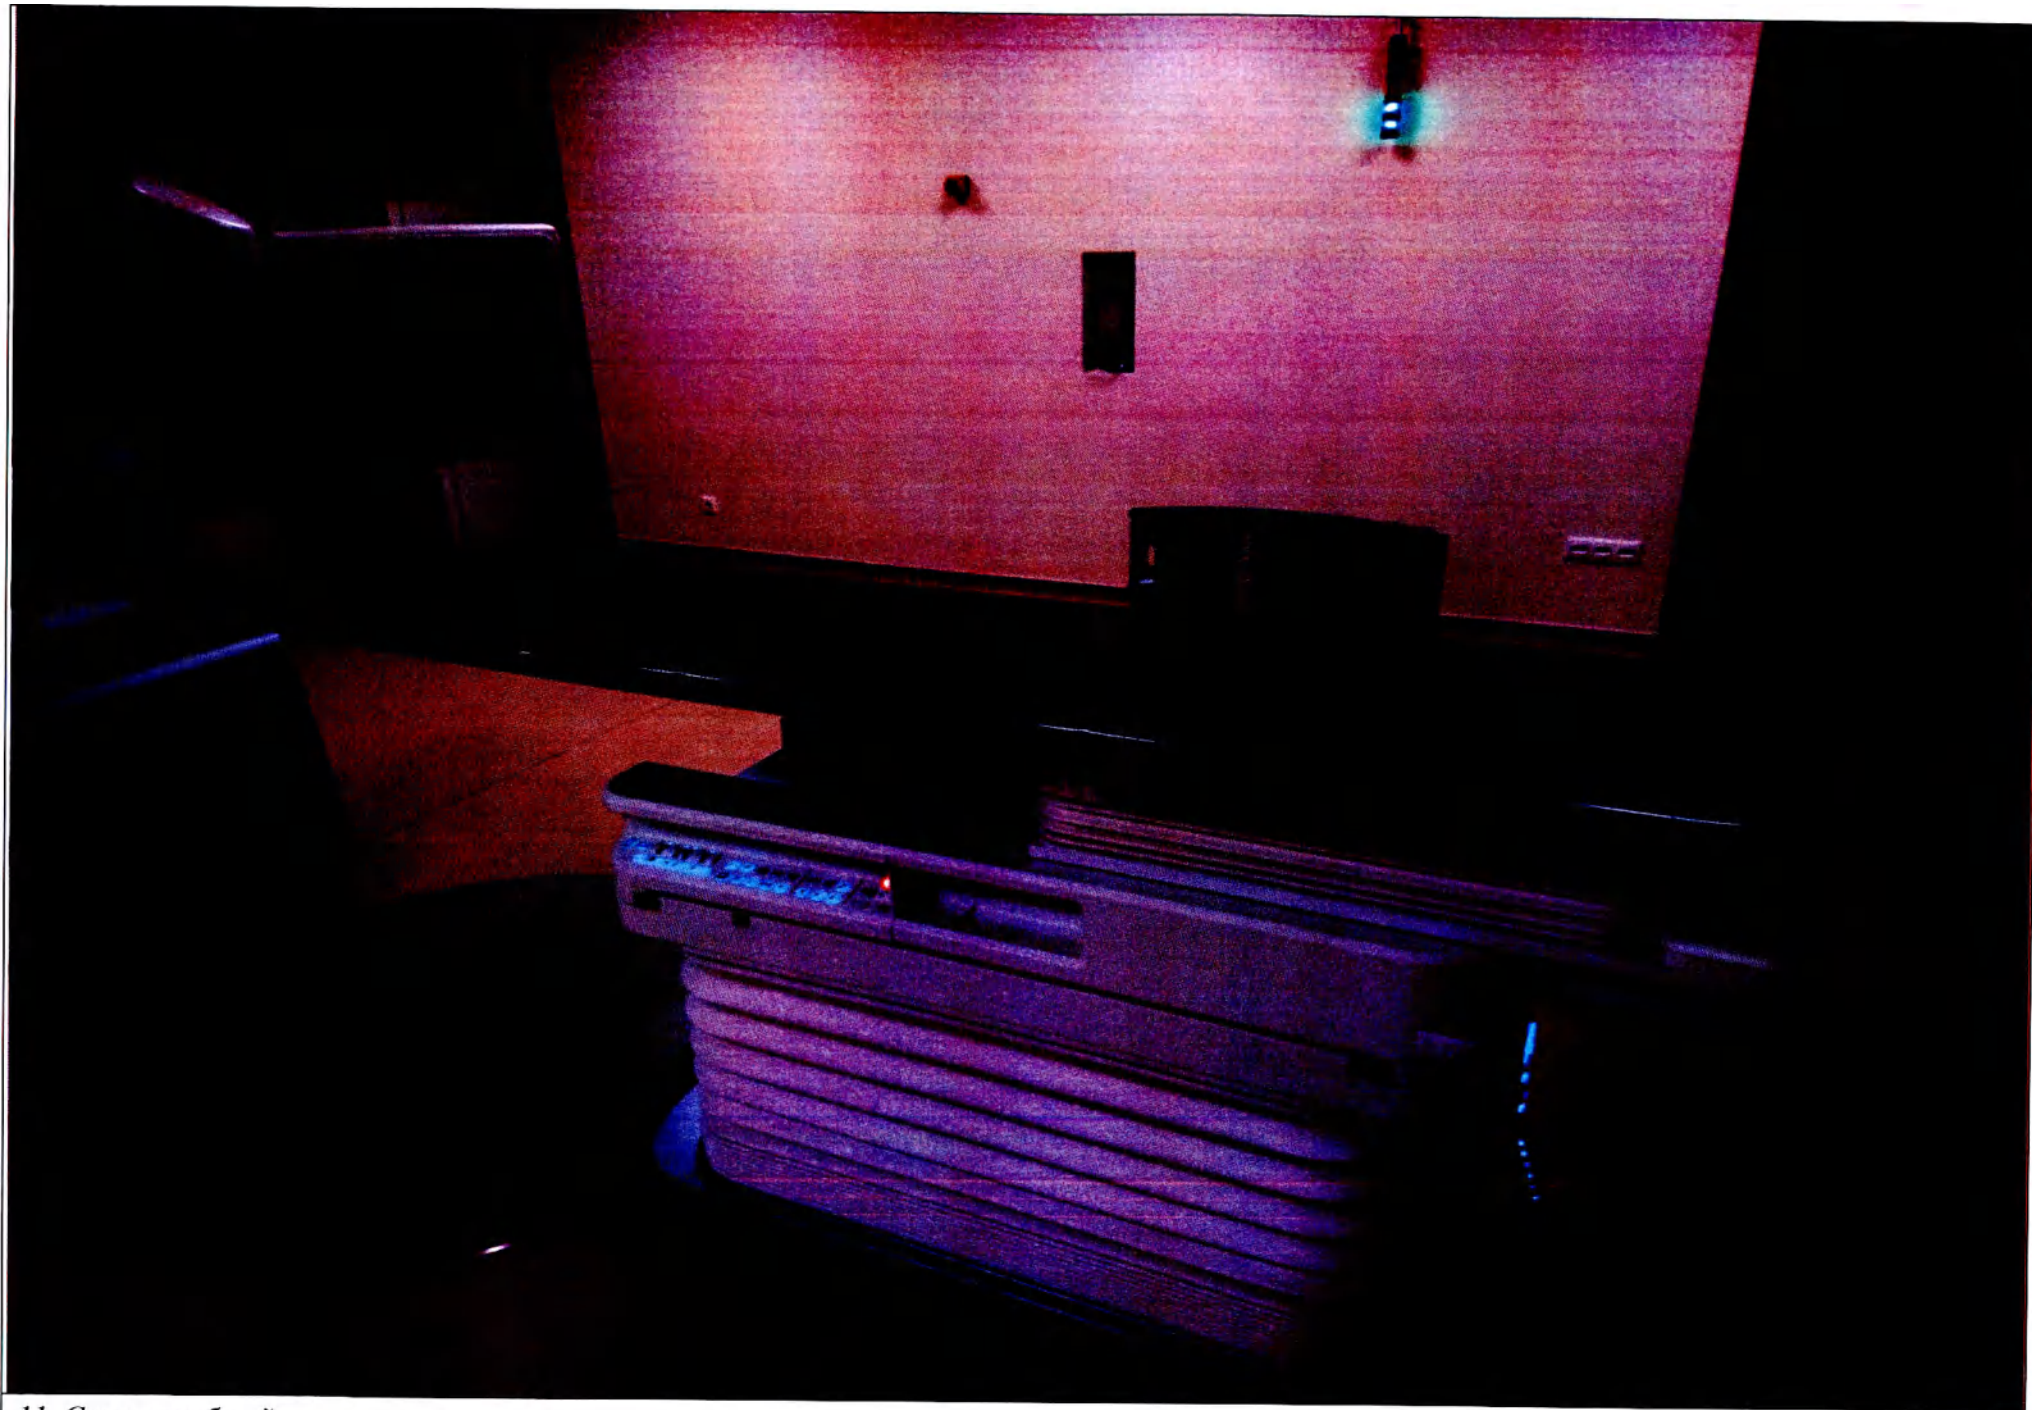


11. Стол лечебный.



12. Дека лечебного стола.



13. Фильтры нижние клиновидные.

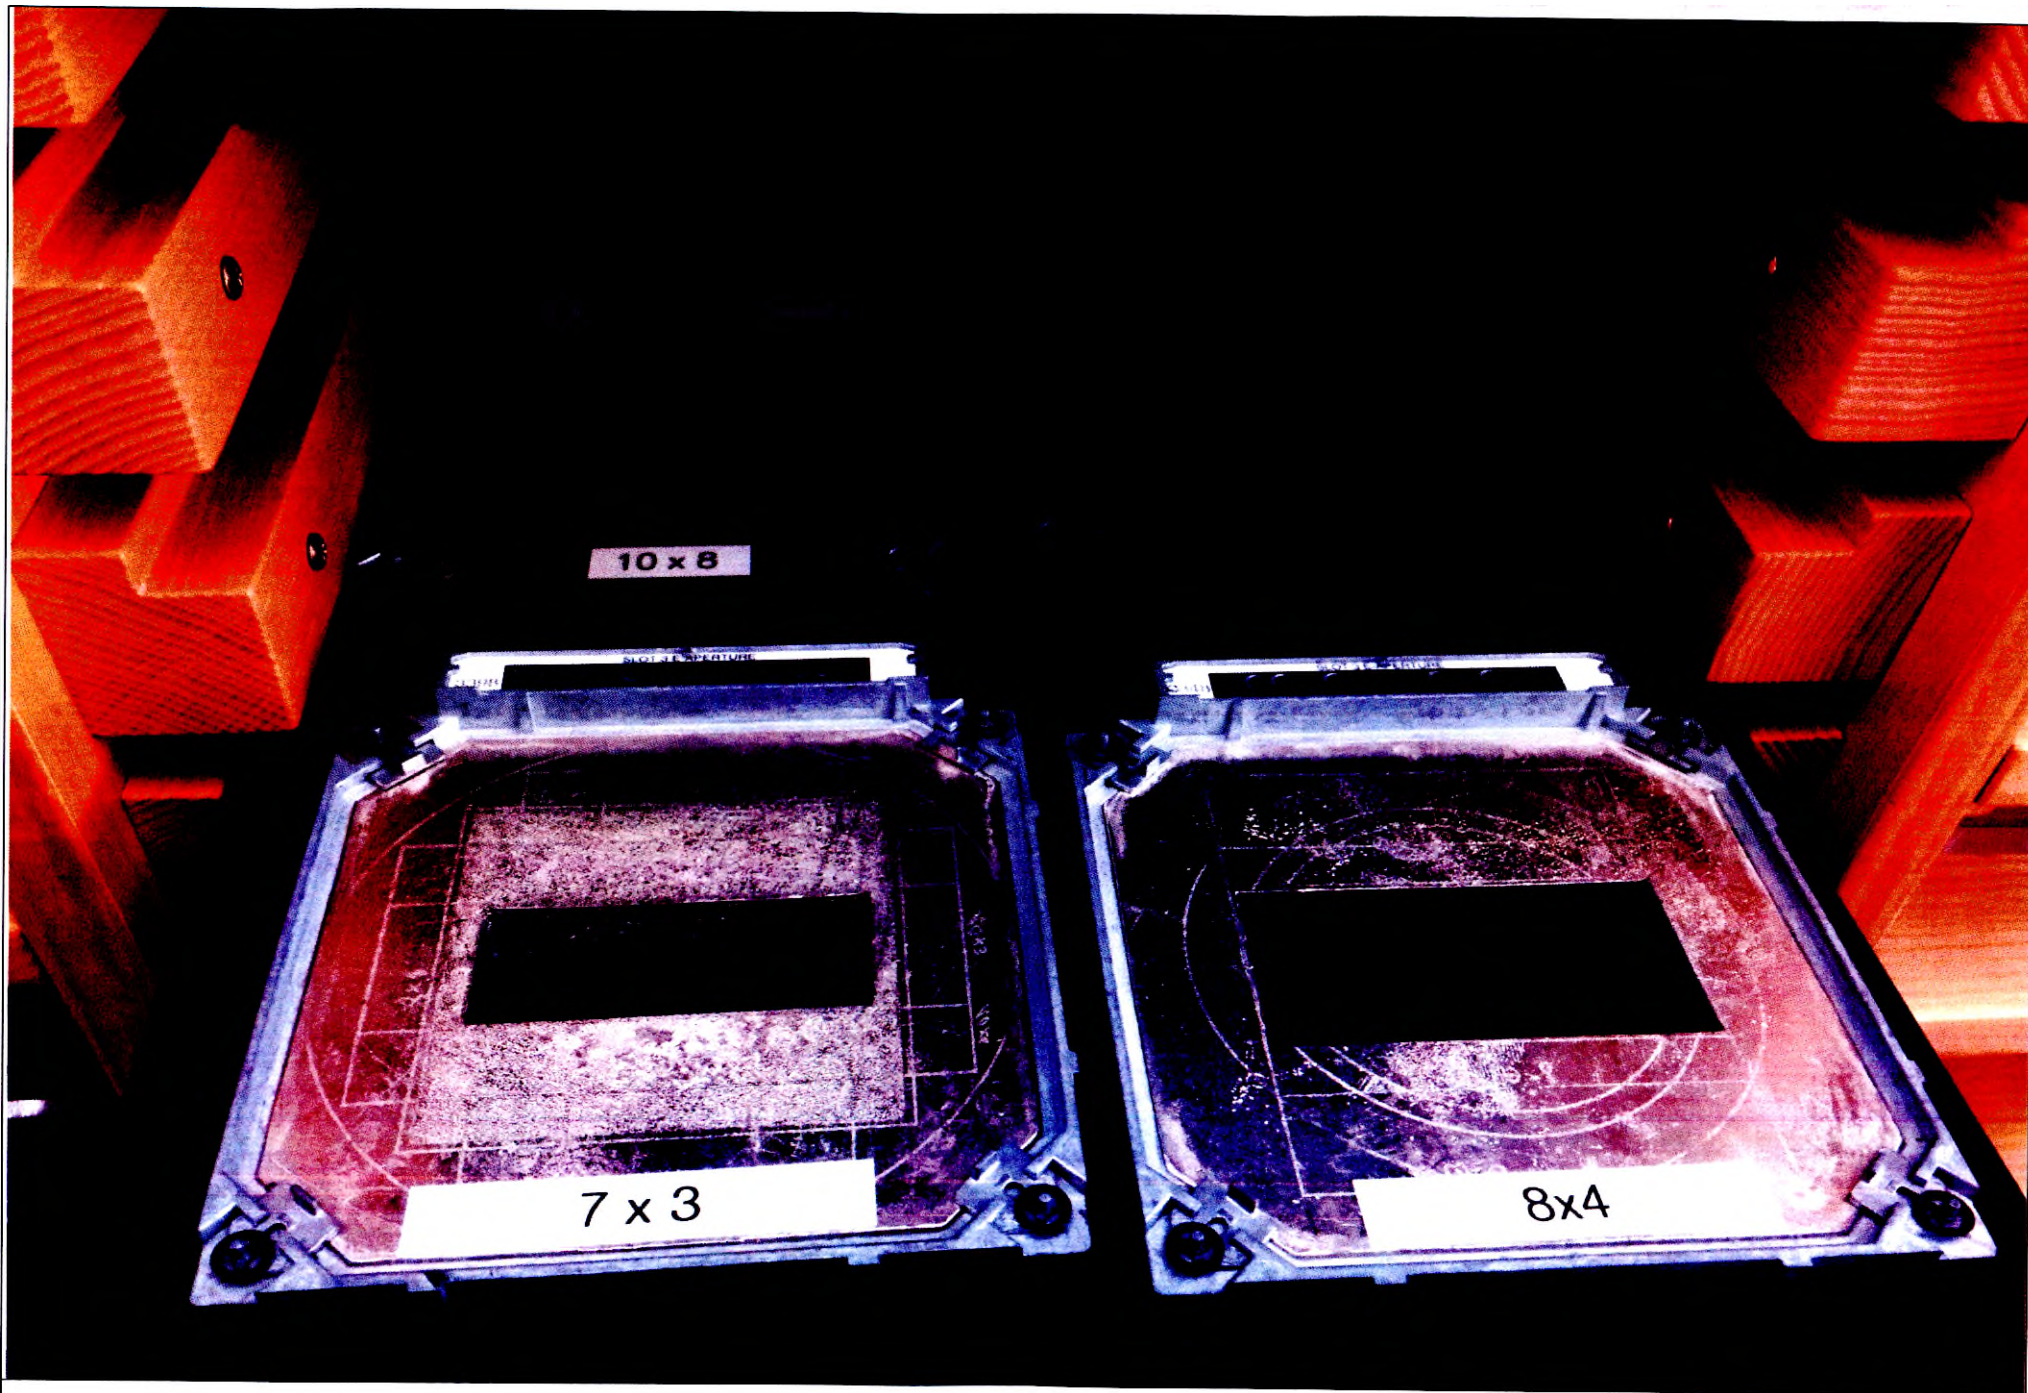

14. Фильтры верхние клиновидные.



15. Поддоны просверленные звездчатые.



16. Поддоны сплошные.



17. Поддоны для компенсаторов.



18а. Аппликаторы электронные.



186. Аппликаторы электронные.



Varian Verification System

Patient ID **Jack_001**



Plan Label Plan1


Field ID Field 1

Accy. **Block1**



Accy. **Bolus**

Scan the highlighted item(s) to proceed.

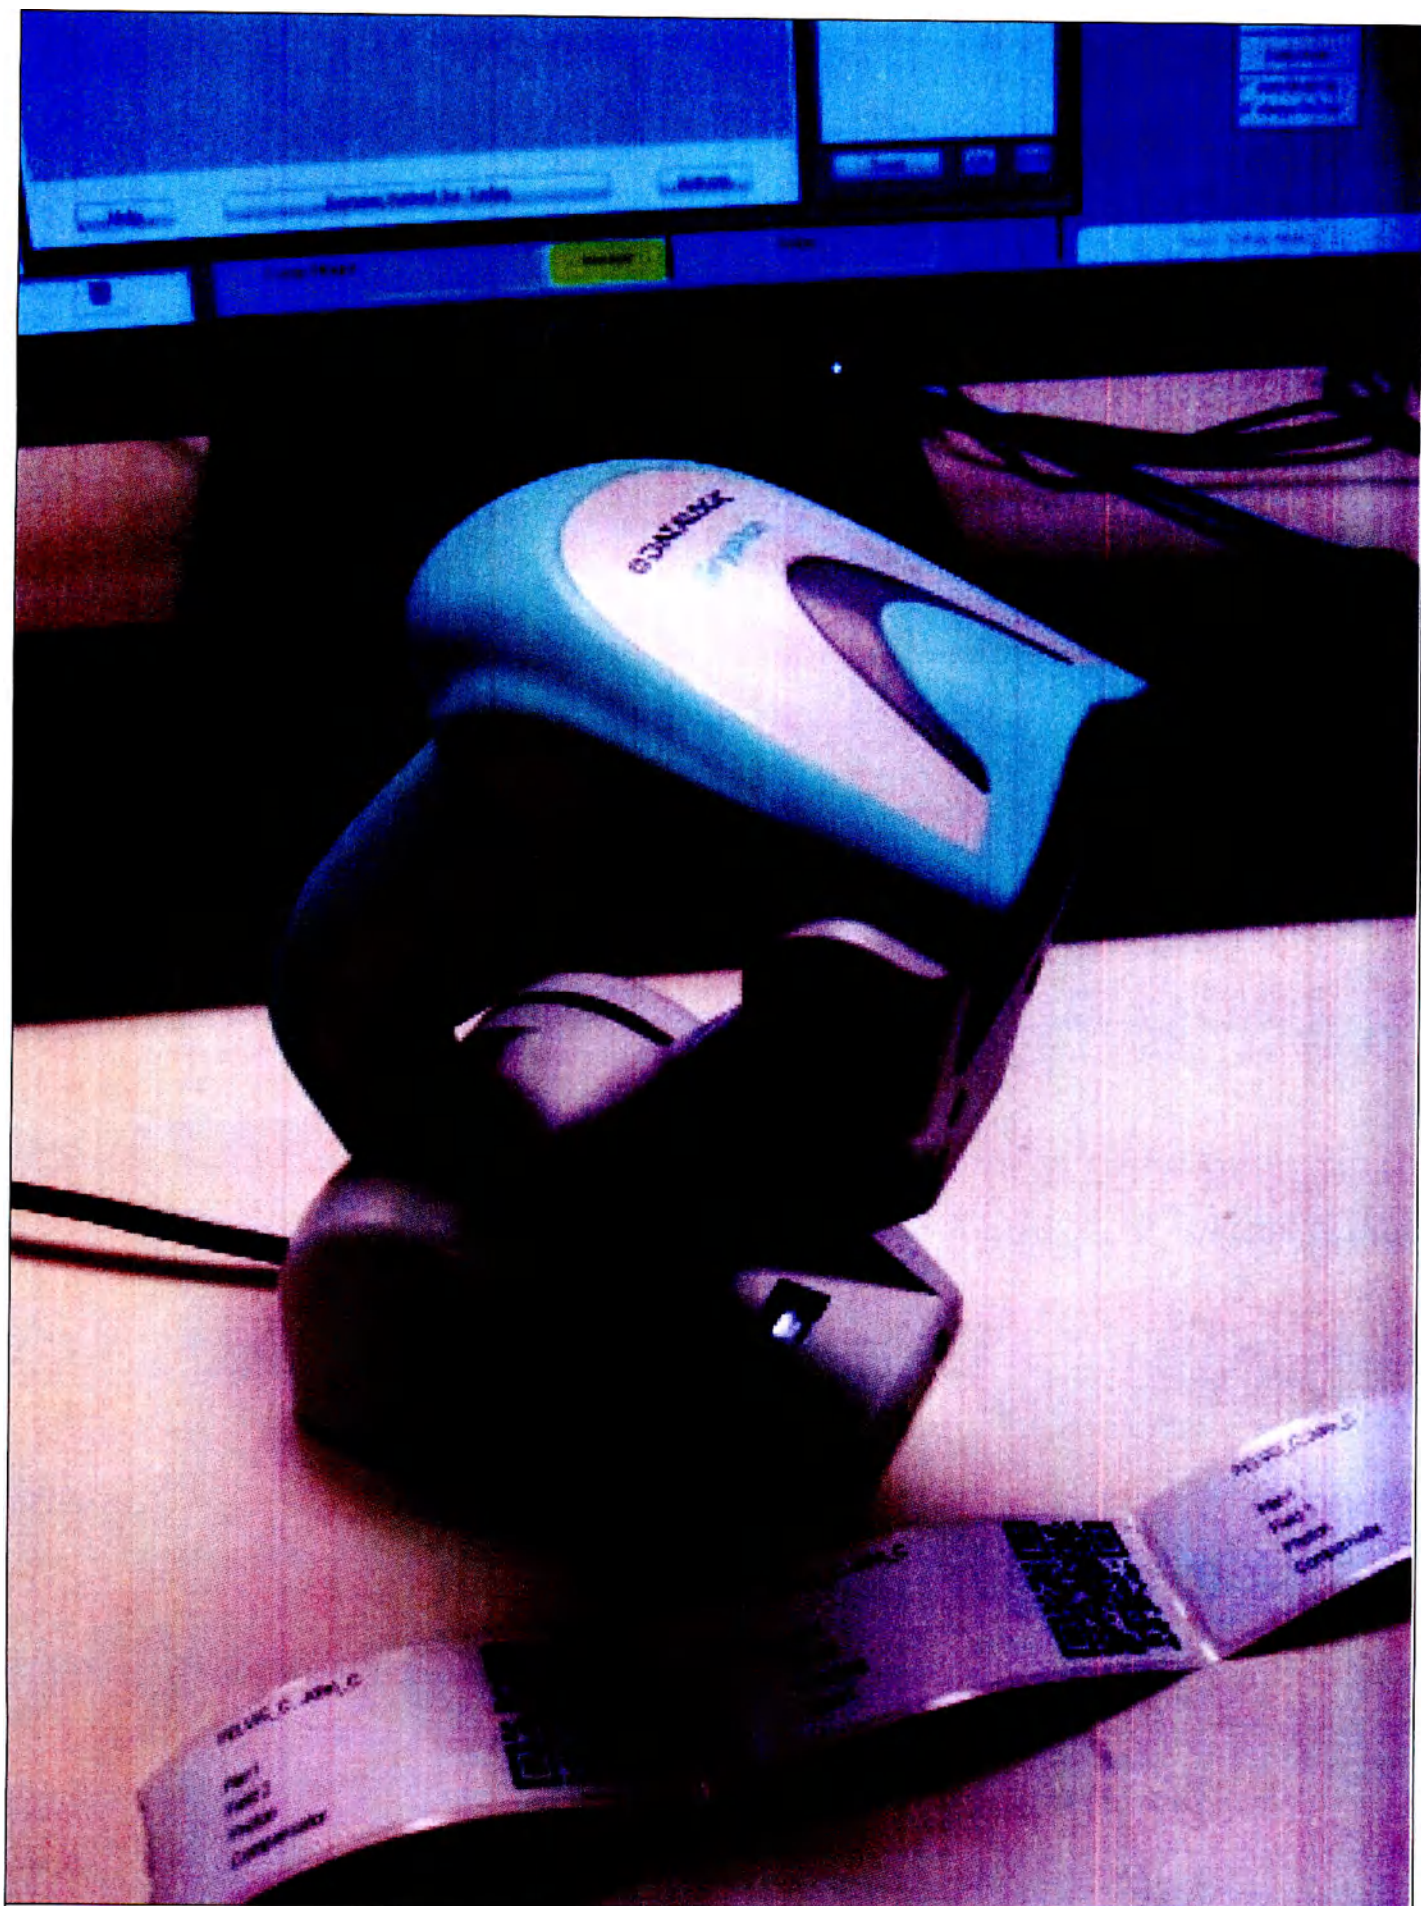

196. Устройство идентификации пациента и принадлежностей.




20. Устройство слежения за движениями пациента и ускорителя.




21. Устройство предупреждения столкновений «Лазергард 2».




22. Лазерные указатели изоцентра.

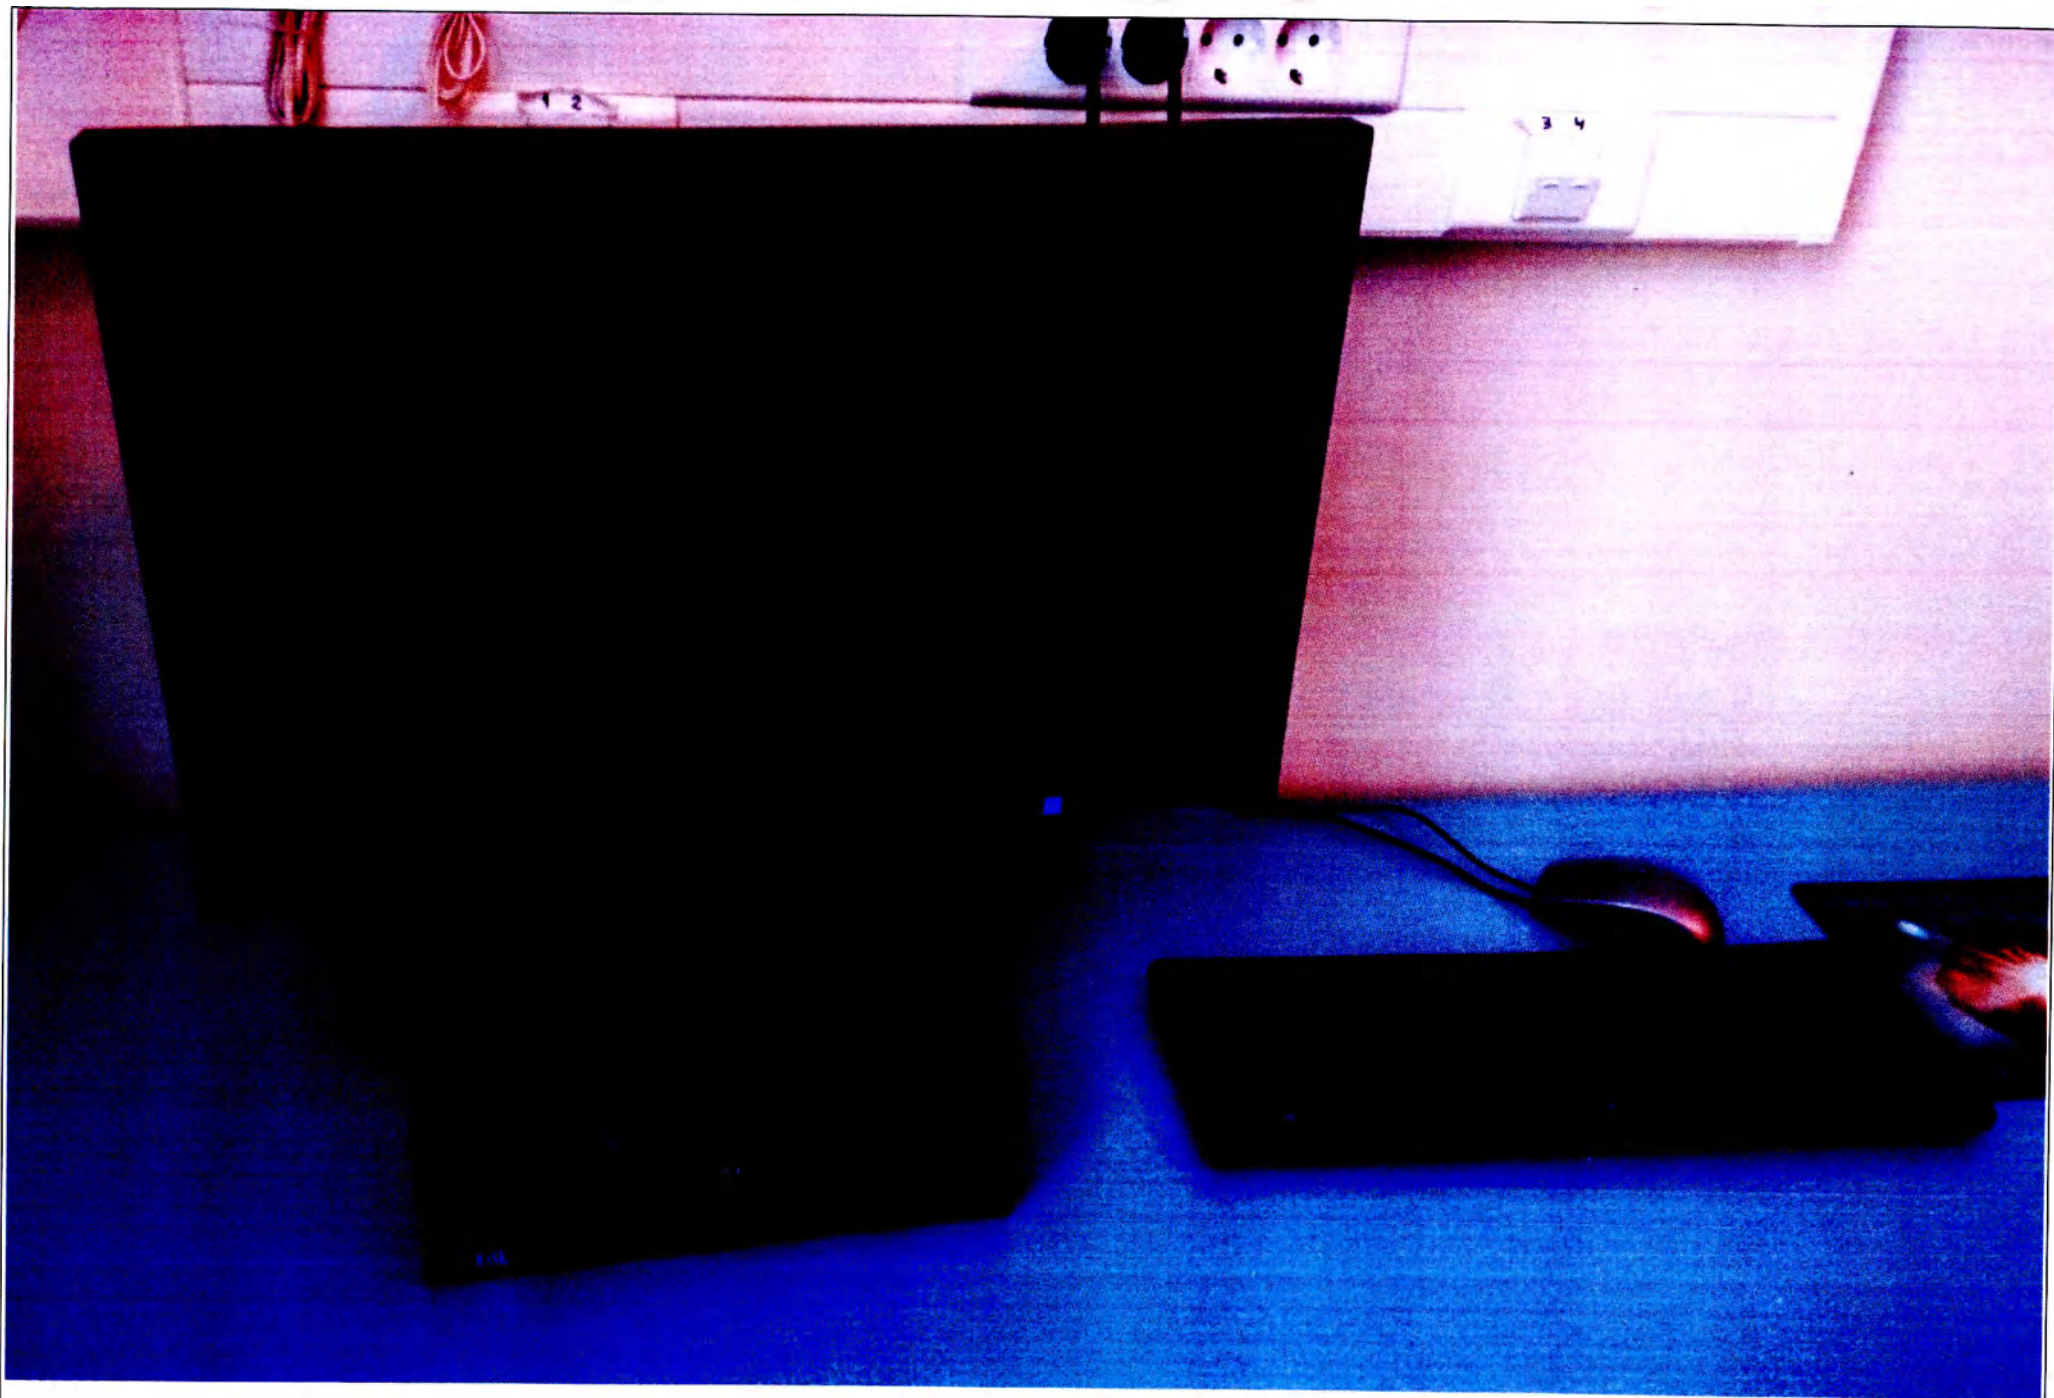

23а. Информационно-управляющая онкологическая система «Ария».

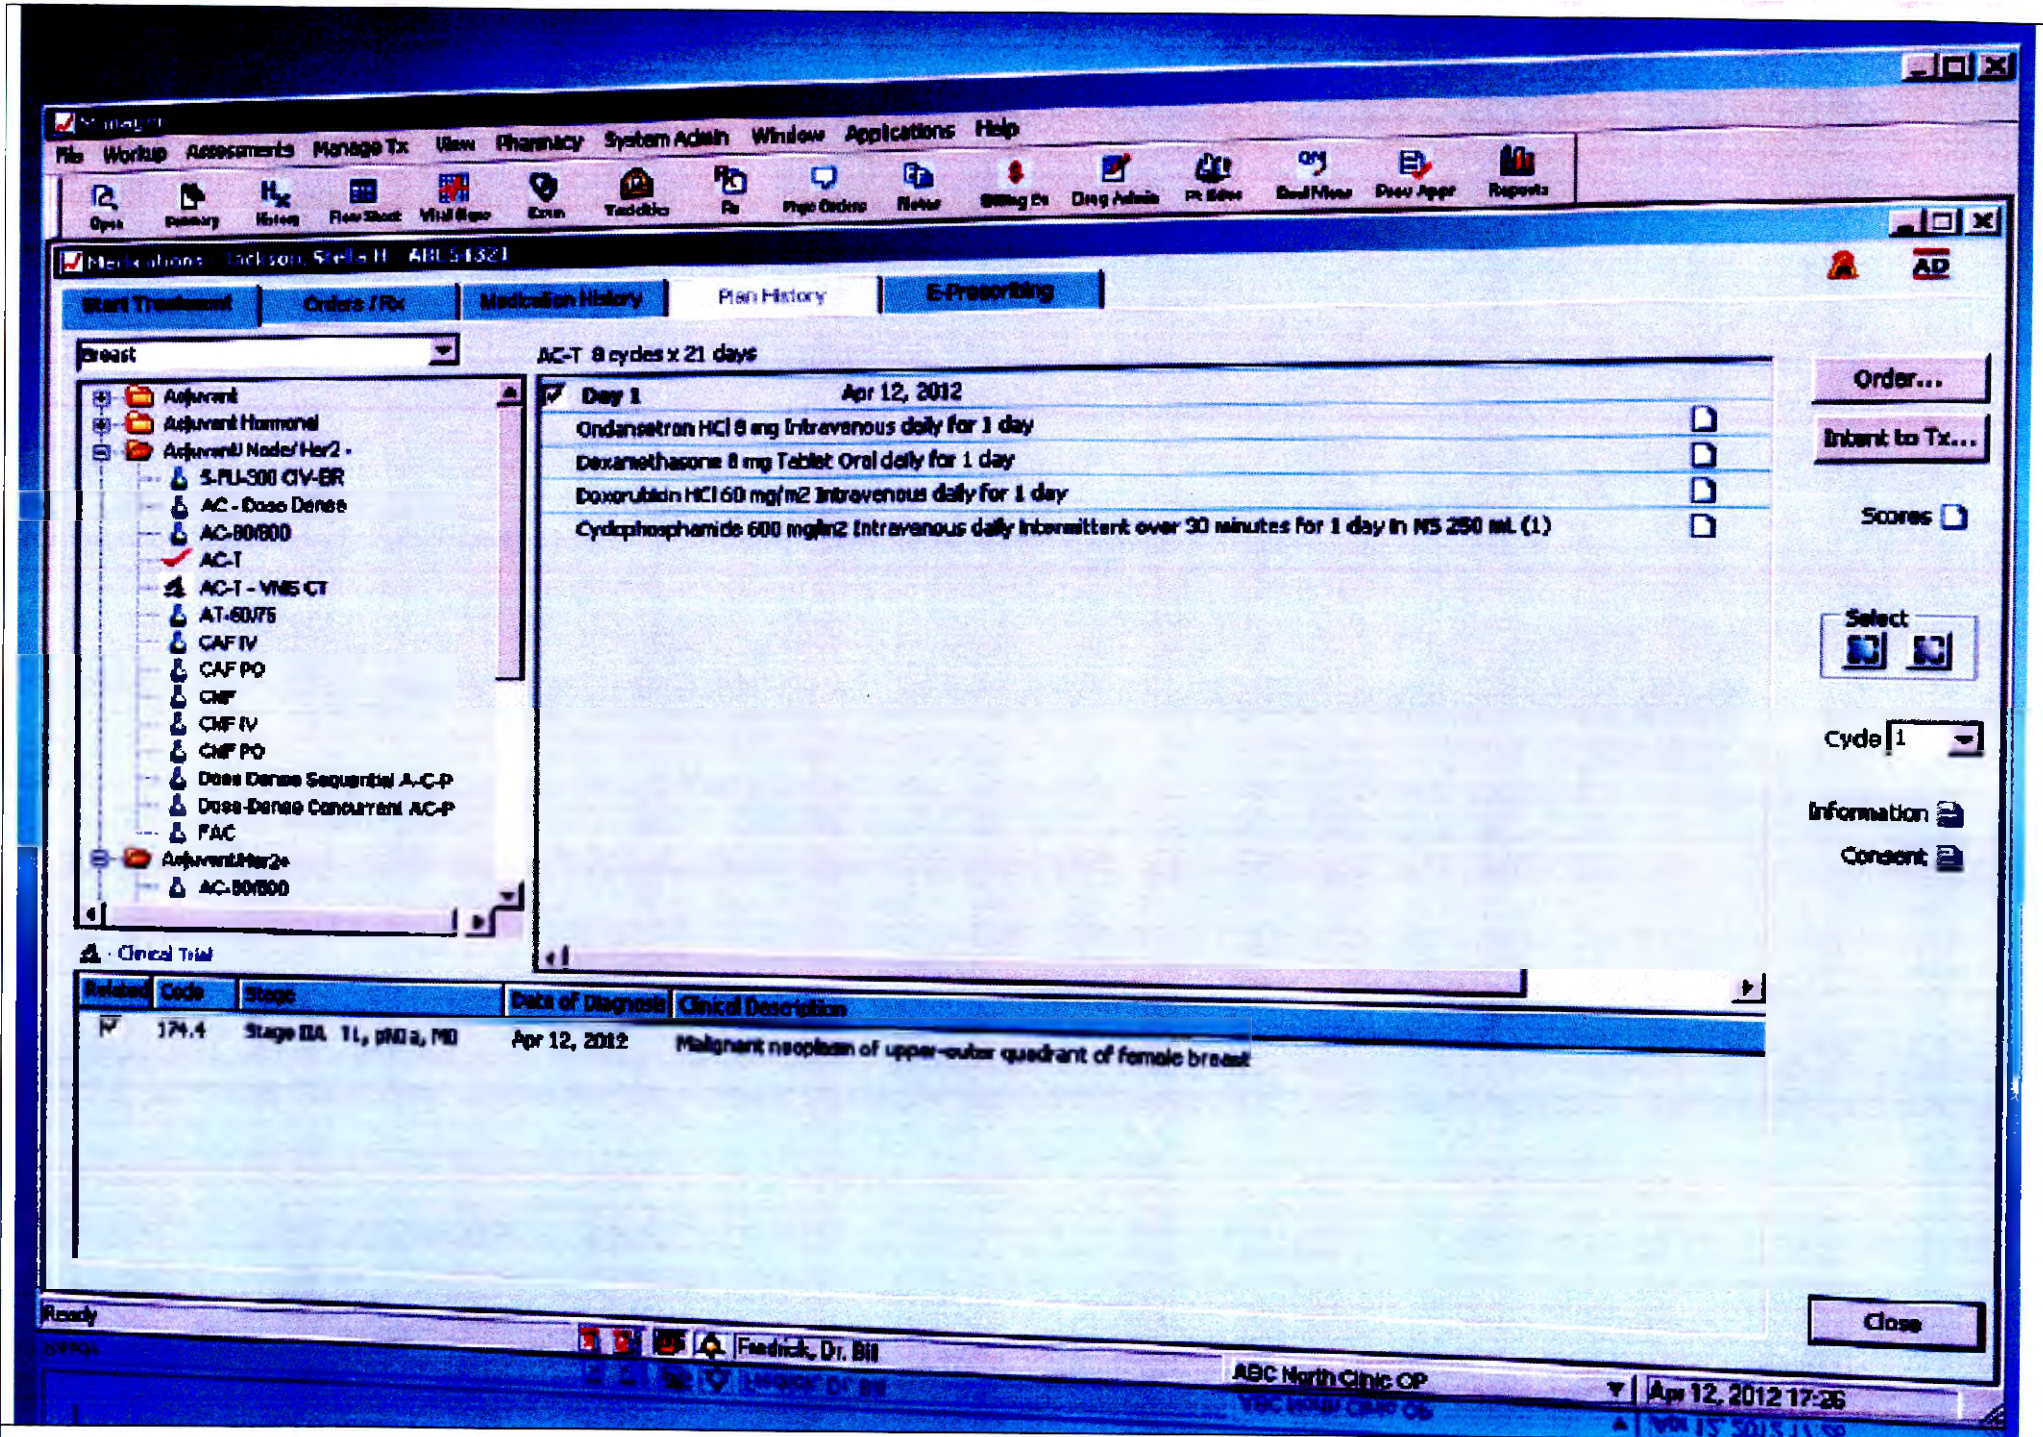


236. Информационно-управляющая онкологическая система «Ария».

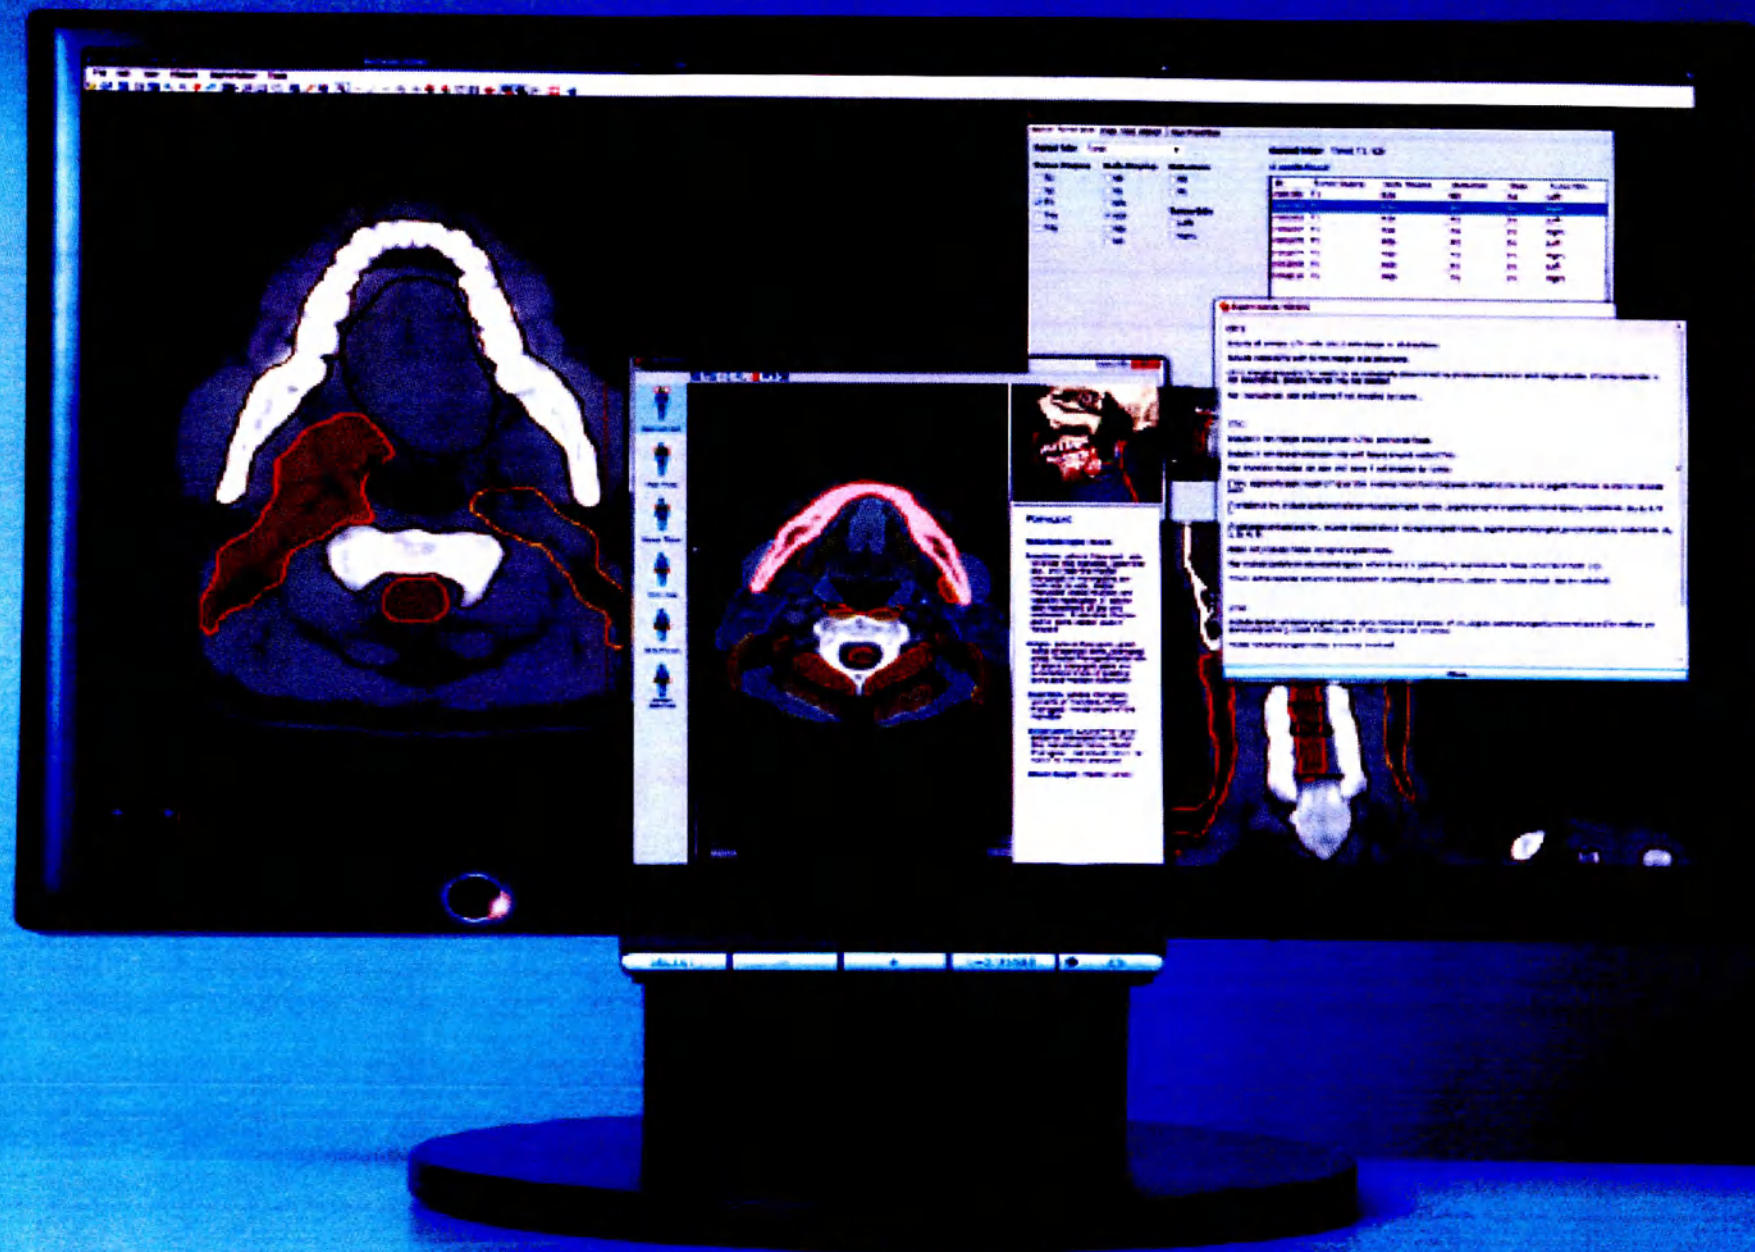


24а. Система планирования облучения «Эклипс».




246. Система планирования облучения «Эклипс».

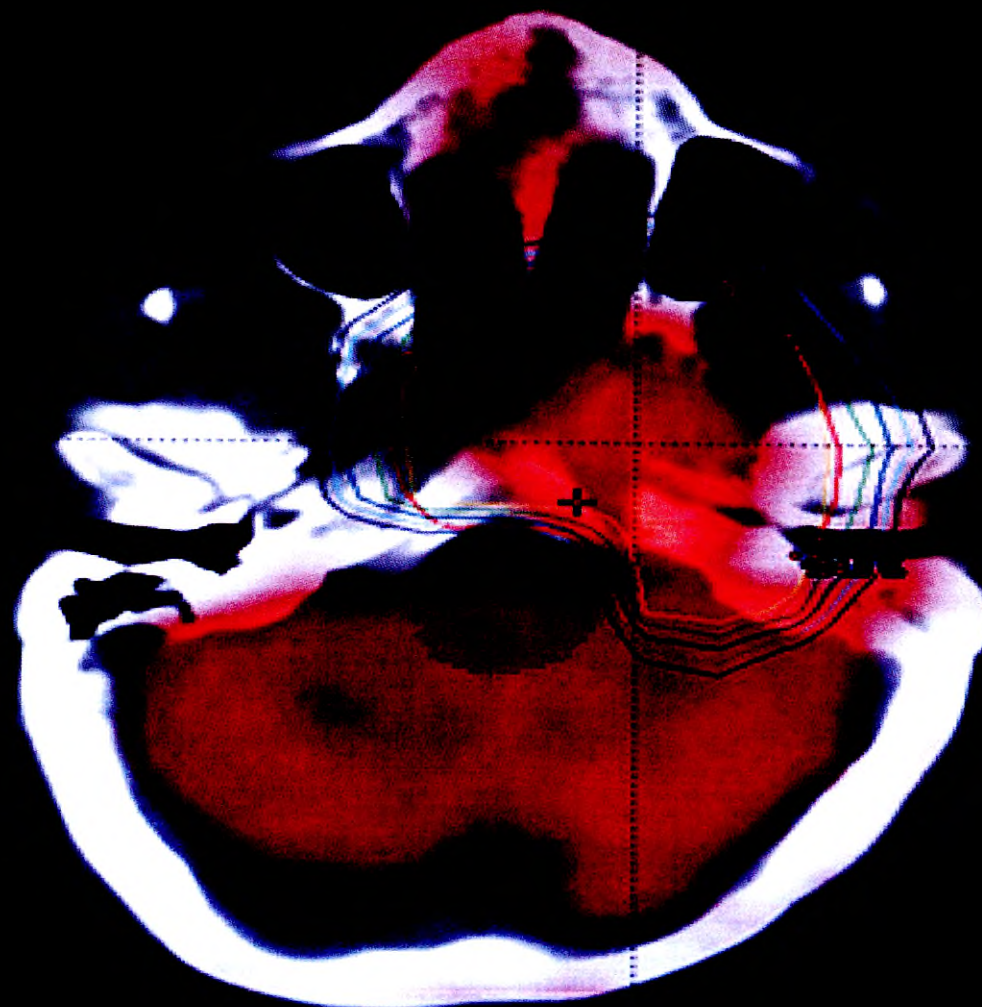


24в. Система планирования облучения «Эклипс».

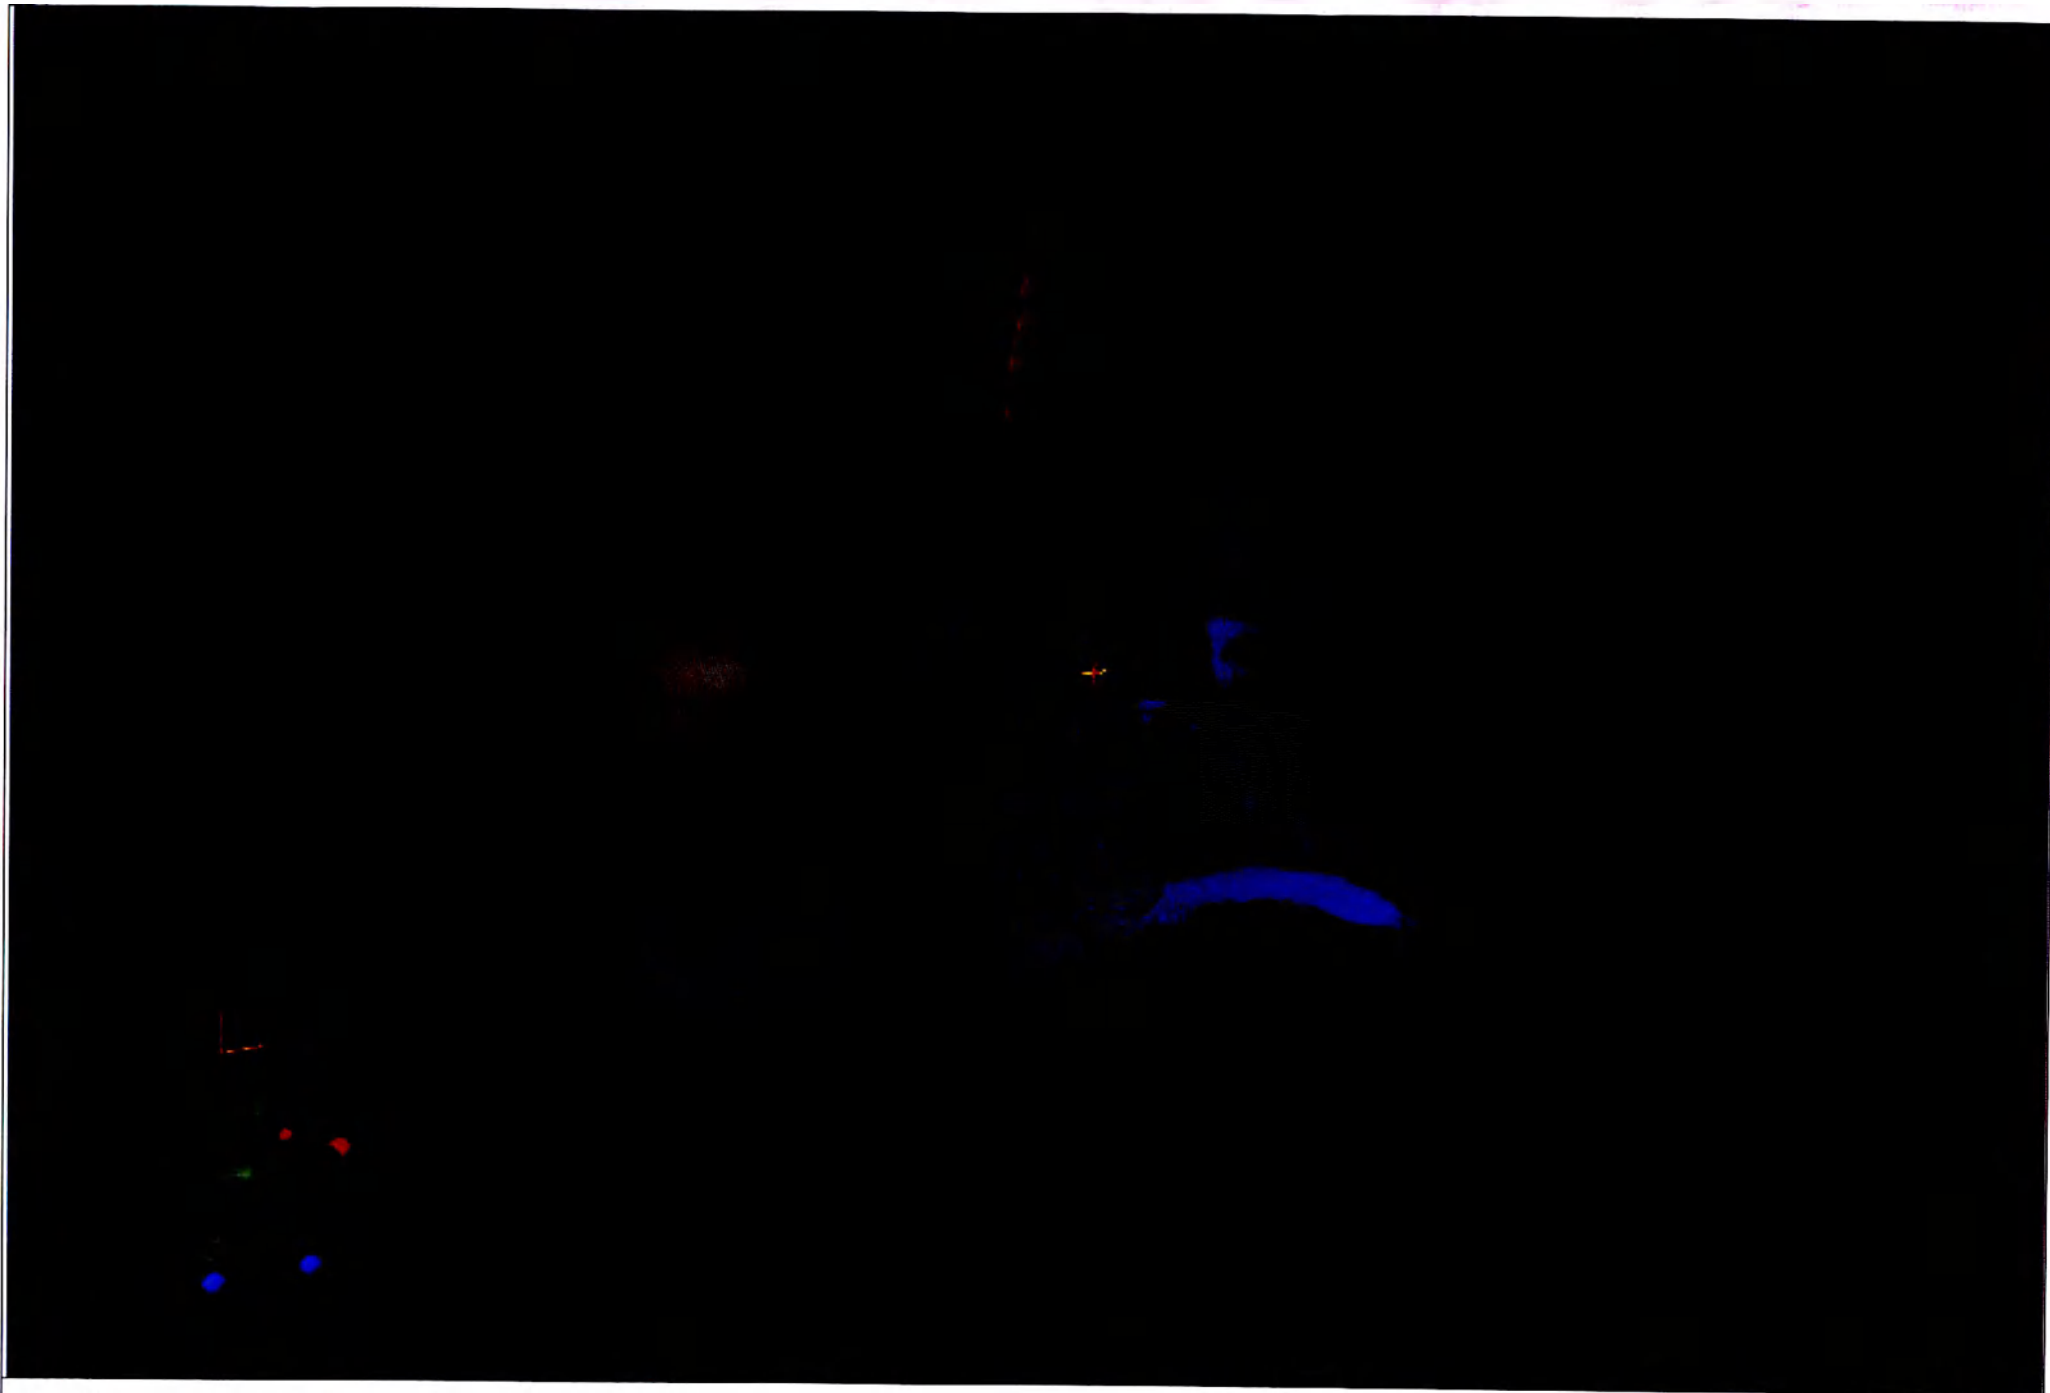


24г. Система планирования облучения «Эклипс».

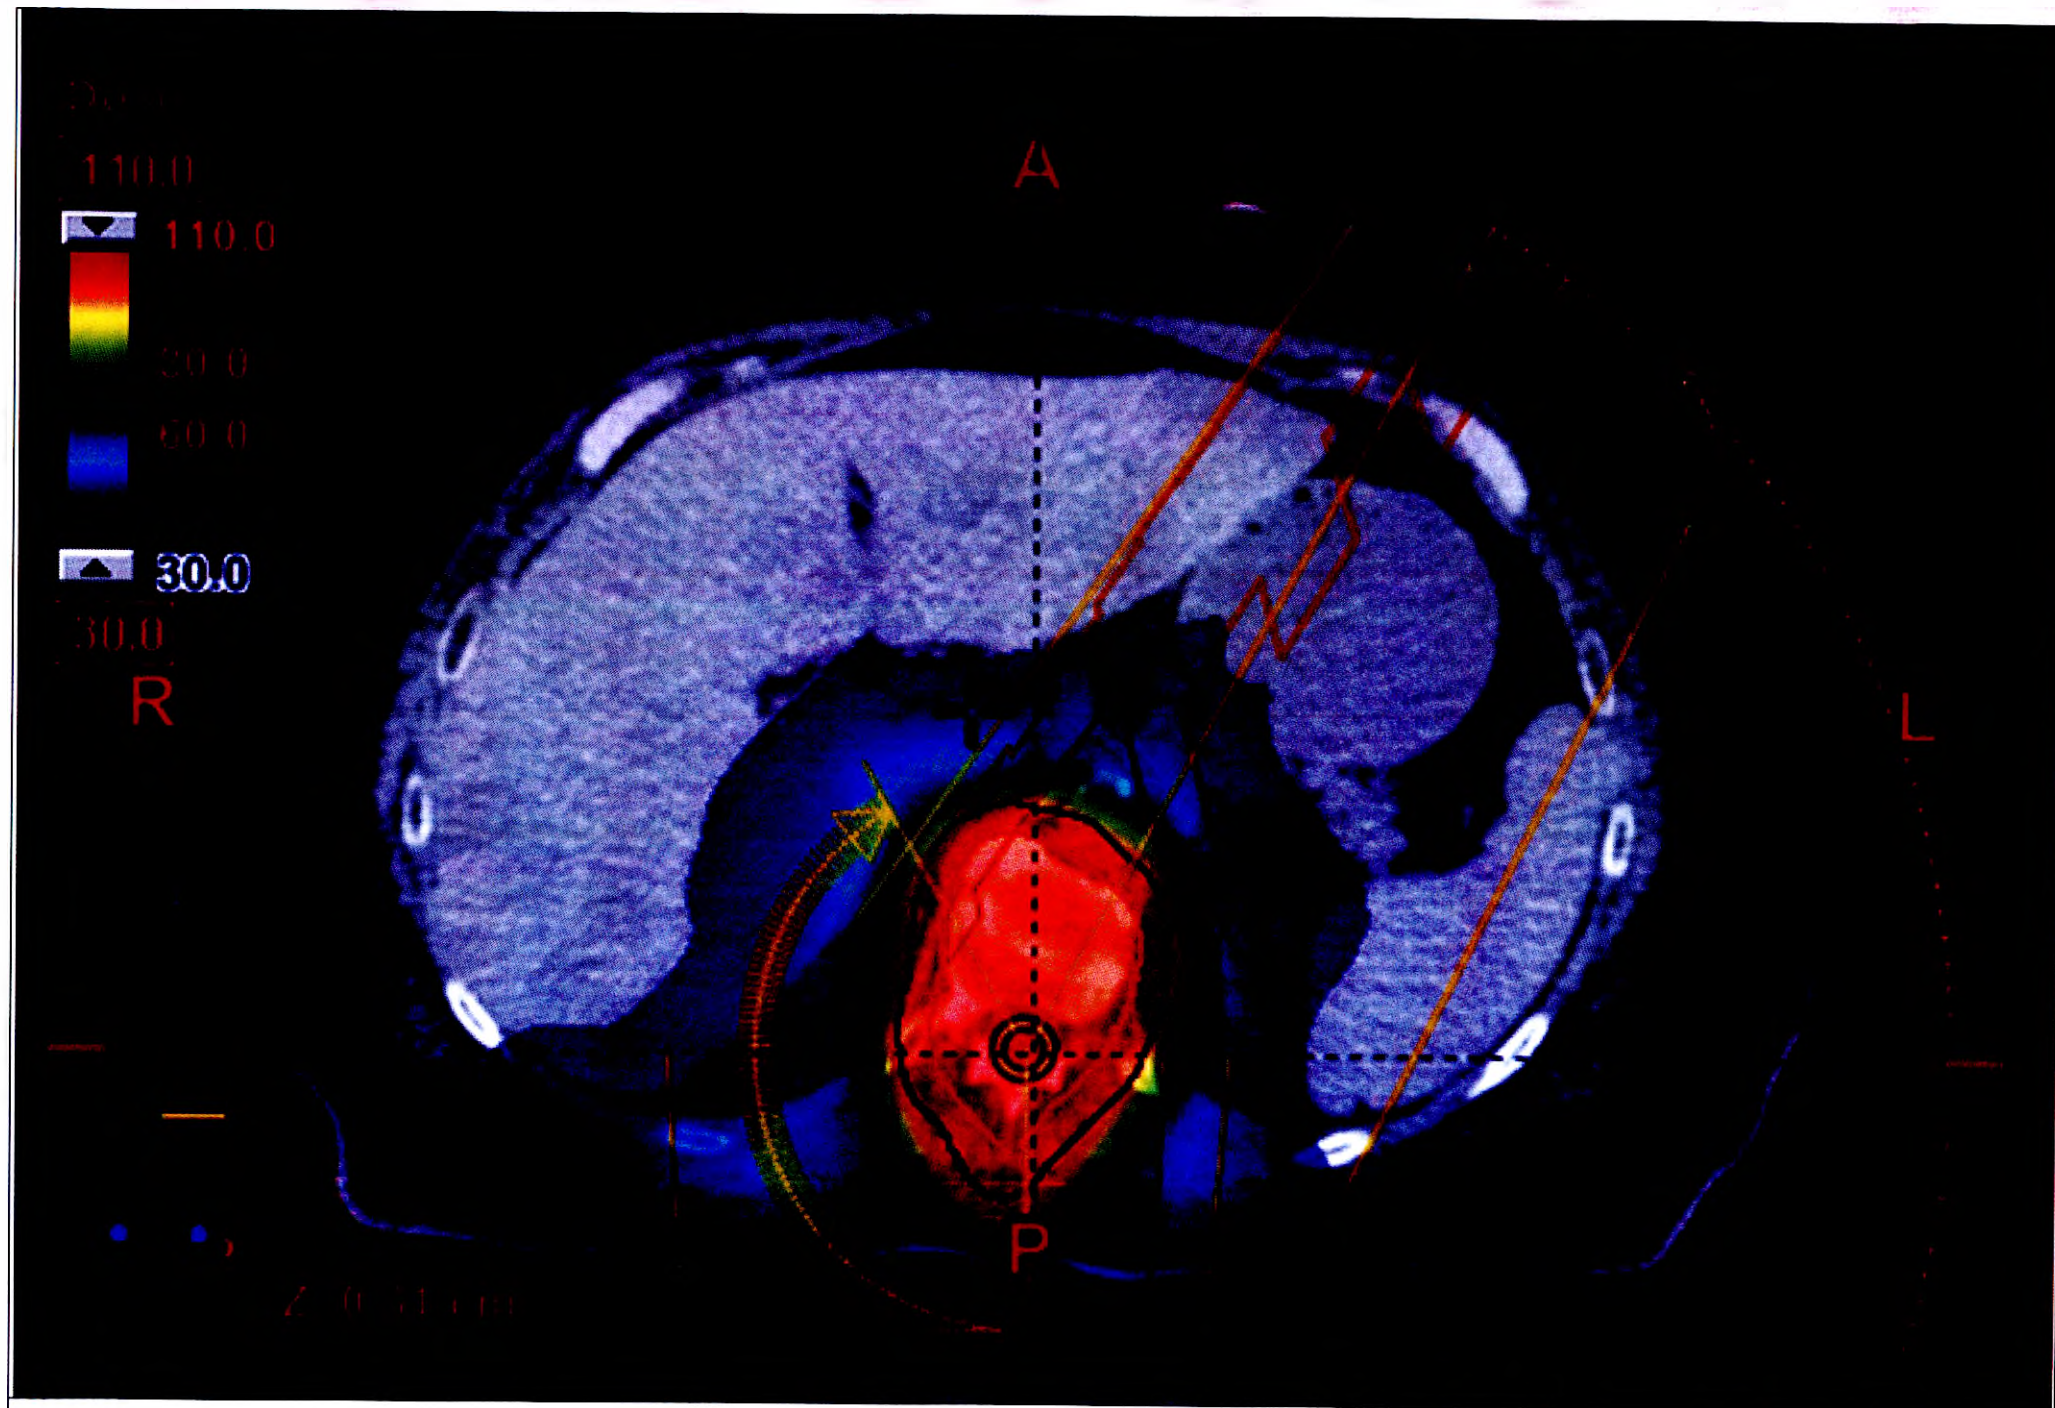

24д. Система планирования облучения «Эклипс».

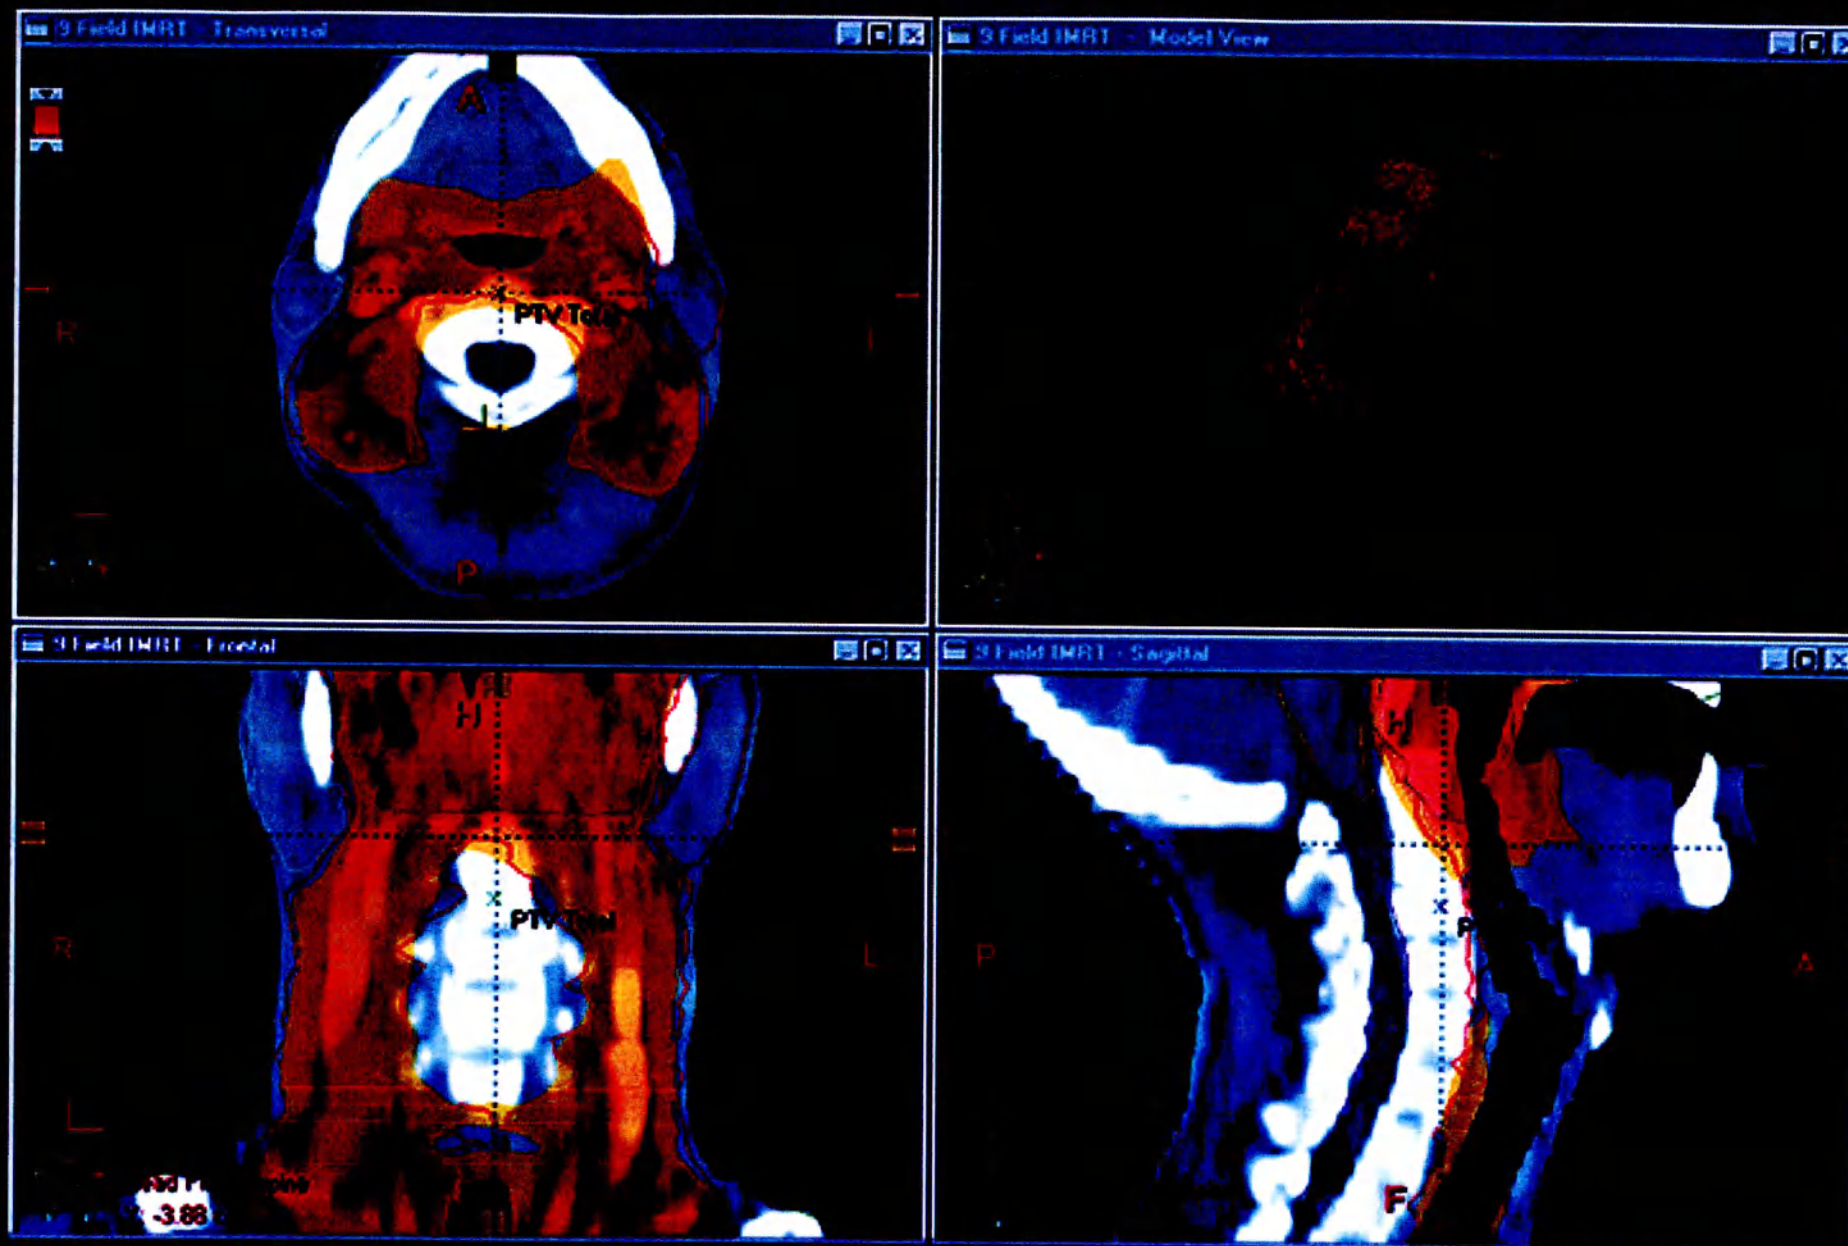

24е. Система планирования облучения «Эклипс».

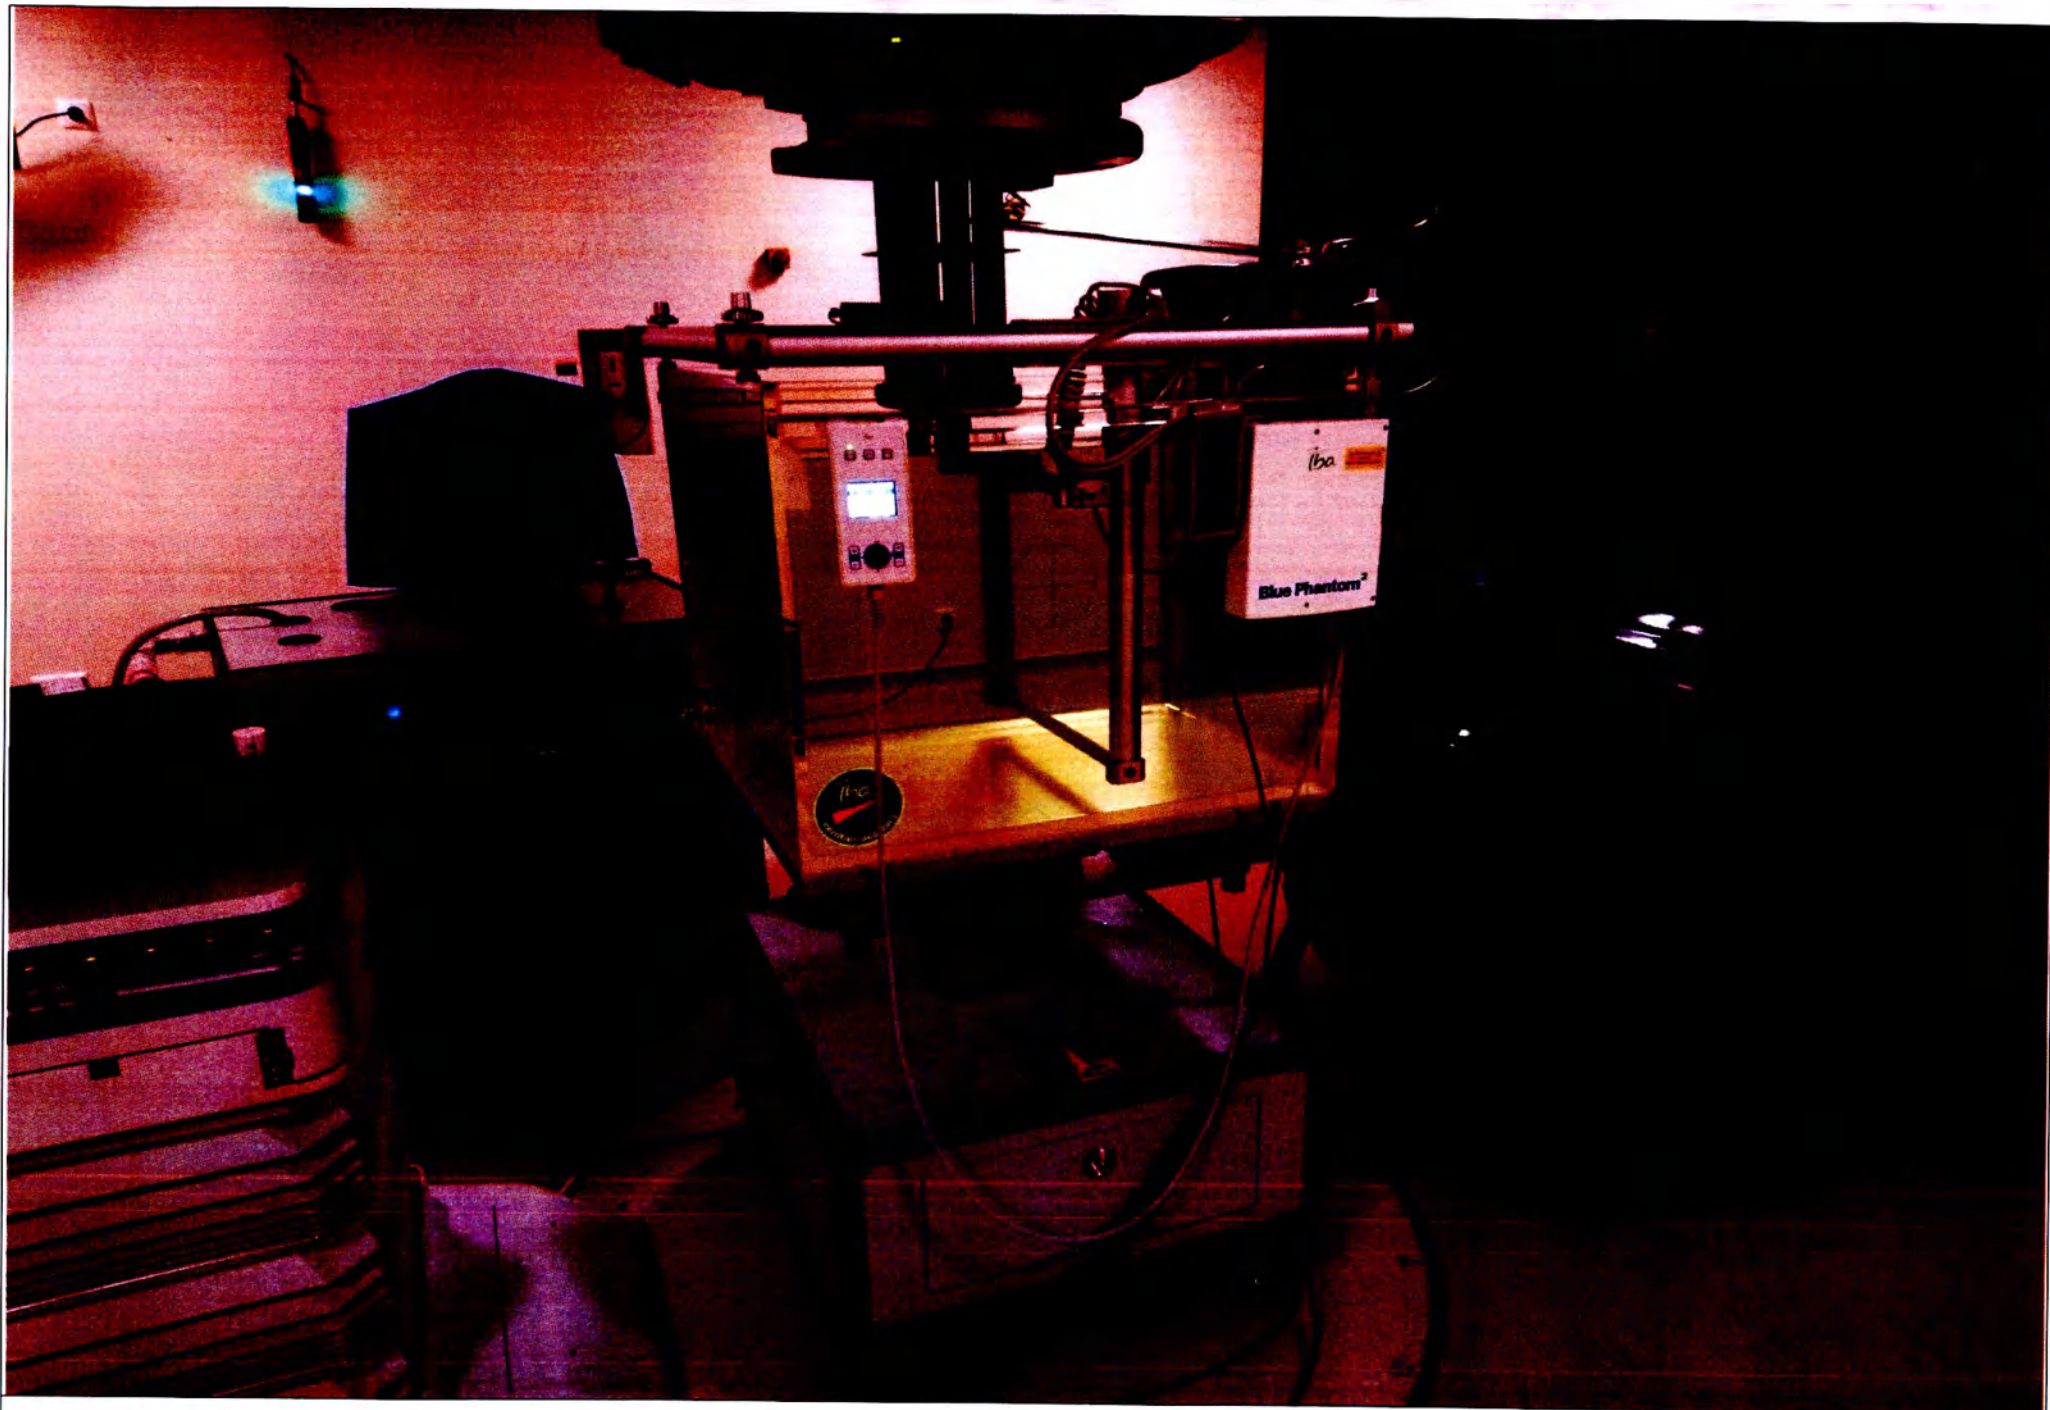

25. Набор для дозиметрии (стартовый набор).

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
56 листа

