

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

стр. 2,3,4

Вариант исполнения 2

стр. 5,6,7

Калибраторы 1,2,3,4

стр. 8,9,10,11

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**




Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Кат. № 1030101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

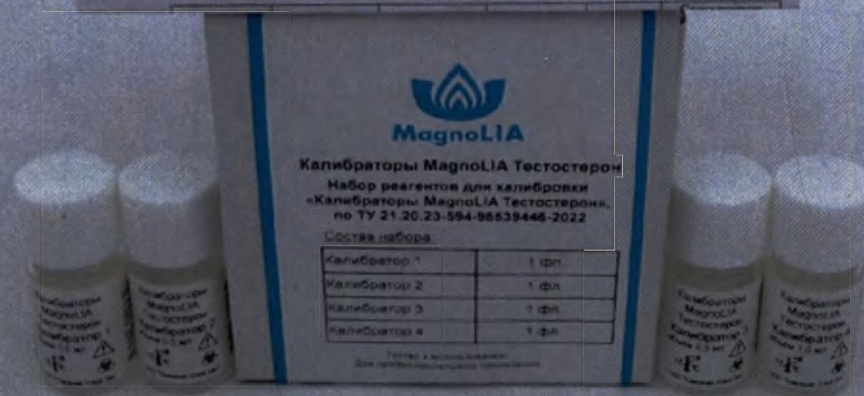

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Кат. № 1030101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Кат. № 1030101 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

no TY 21.20.23-594-98539446-2022

Формирование № 1. Колитис.



Magnolia

Калибраторы MagnoLIA Тестостерон

no TY 21.20.23-594-98539446-2022

Состав набора

Калибратор 1	5 фп.
Калибратор 2	5 фп.
Калибратор 3	5 фп.
Калибратор 4	5 фп.

TY 21 20 23 594 98526446 2022
PV No XXXXX XXXXXX

LOT E003

REF 1030105

IVD

2022-04-04

2023-04-04

 $+2\frac{1}{2}$

△

Судебная психология — это наука, изучающая психические процессы и состояния человека в контексте правосудия.

Для профессионального применения
Антитела к ВИЧ 1.2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы Magnolia Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Кат. № 1030105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы Magnolia Тестостерон

LOT E003

2023-04-04

REF 1030105

+2⁺⁸
K

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003


Набор реактивов для калибровки «Калибраторы Magnolia Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Кат. № 1030105 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.





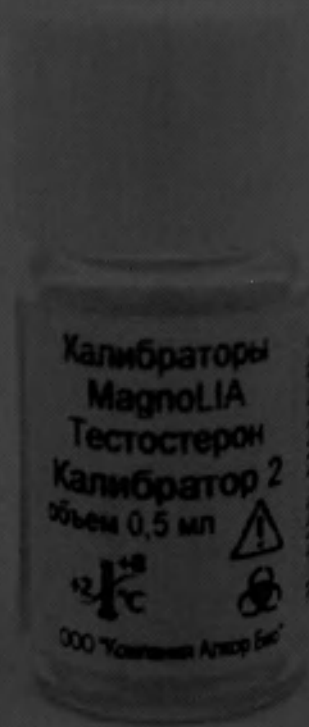

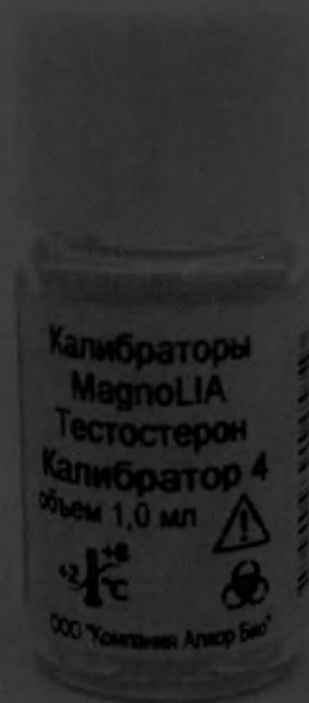

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (одинадцать) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Тюлынец



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Тестостерон», по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 1030101

На коробку:



Калибраторы MagnaLIA Тестостерон
Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnaLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Состав набора:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.

Готово к использованию
Для профессионального применения



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
ТУ 21.20.23-594-98539446-2022
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnaLIA
Тестостерон
Калибратор 1
объем 1,0 мл
+2⁺8⁺°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnaLIA
Тестостерон
Калибратор 2
объем 0,5 мл
+2⁺8⁺°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnaLIA
Тестостерон
Калибратор 3
объем 0,5 мл
+2⁺8⁺°C
000 "Компания Алкор Био"



Калибраторы
MagnaLIA
Тестостерон
Калибратор 4
объем 1,0 мл
+2⁺8⁺°C
000 "Компания Алкор Био"



ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР-БИО

На коробку:



Калибраторы MagnoLIA Тестостерон

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-594-98539446-2022

Готово к использованию.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.



Состав набора:

Калибратор 1	5 фл.
Калибратор 2	5 фл.
Калибратор 3	5 фл.
Калибратор 4	5 фл.

LOT E003

2022-04-04

REF 1030105

2023-04-04

IVD

50

192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
Тел./факс: +7(812)6778179, 6772162
info@alokorbio.ru, www.alokorbio.ru

На флаконы:

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (ТМ) лист а

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

