




Светодиодный источник света для жесткой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 1

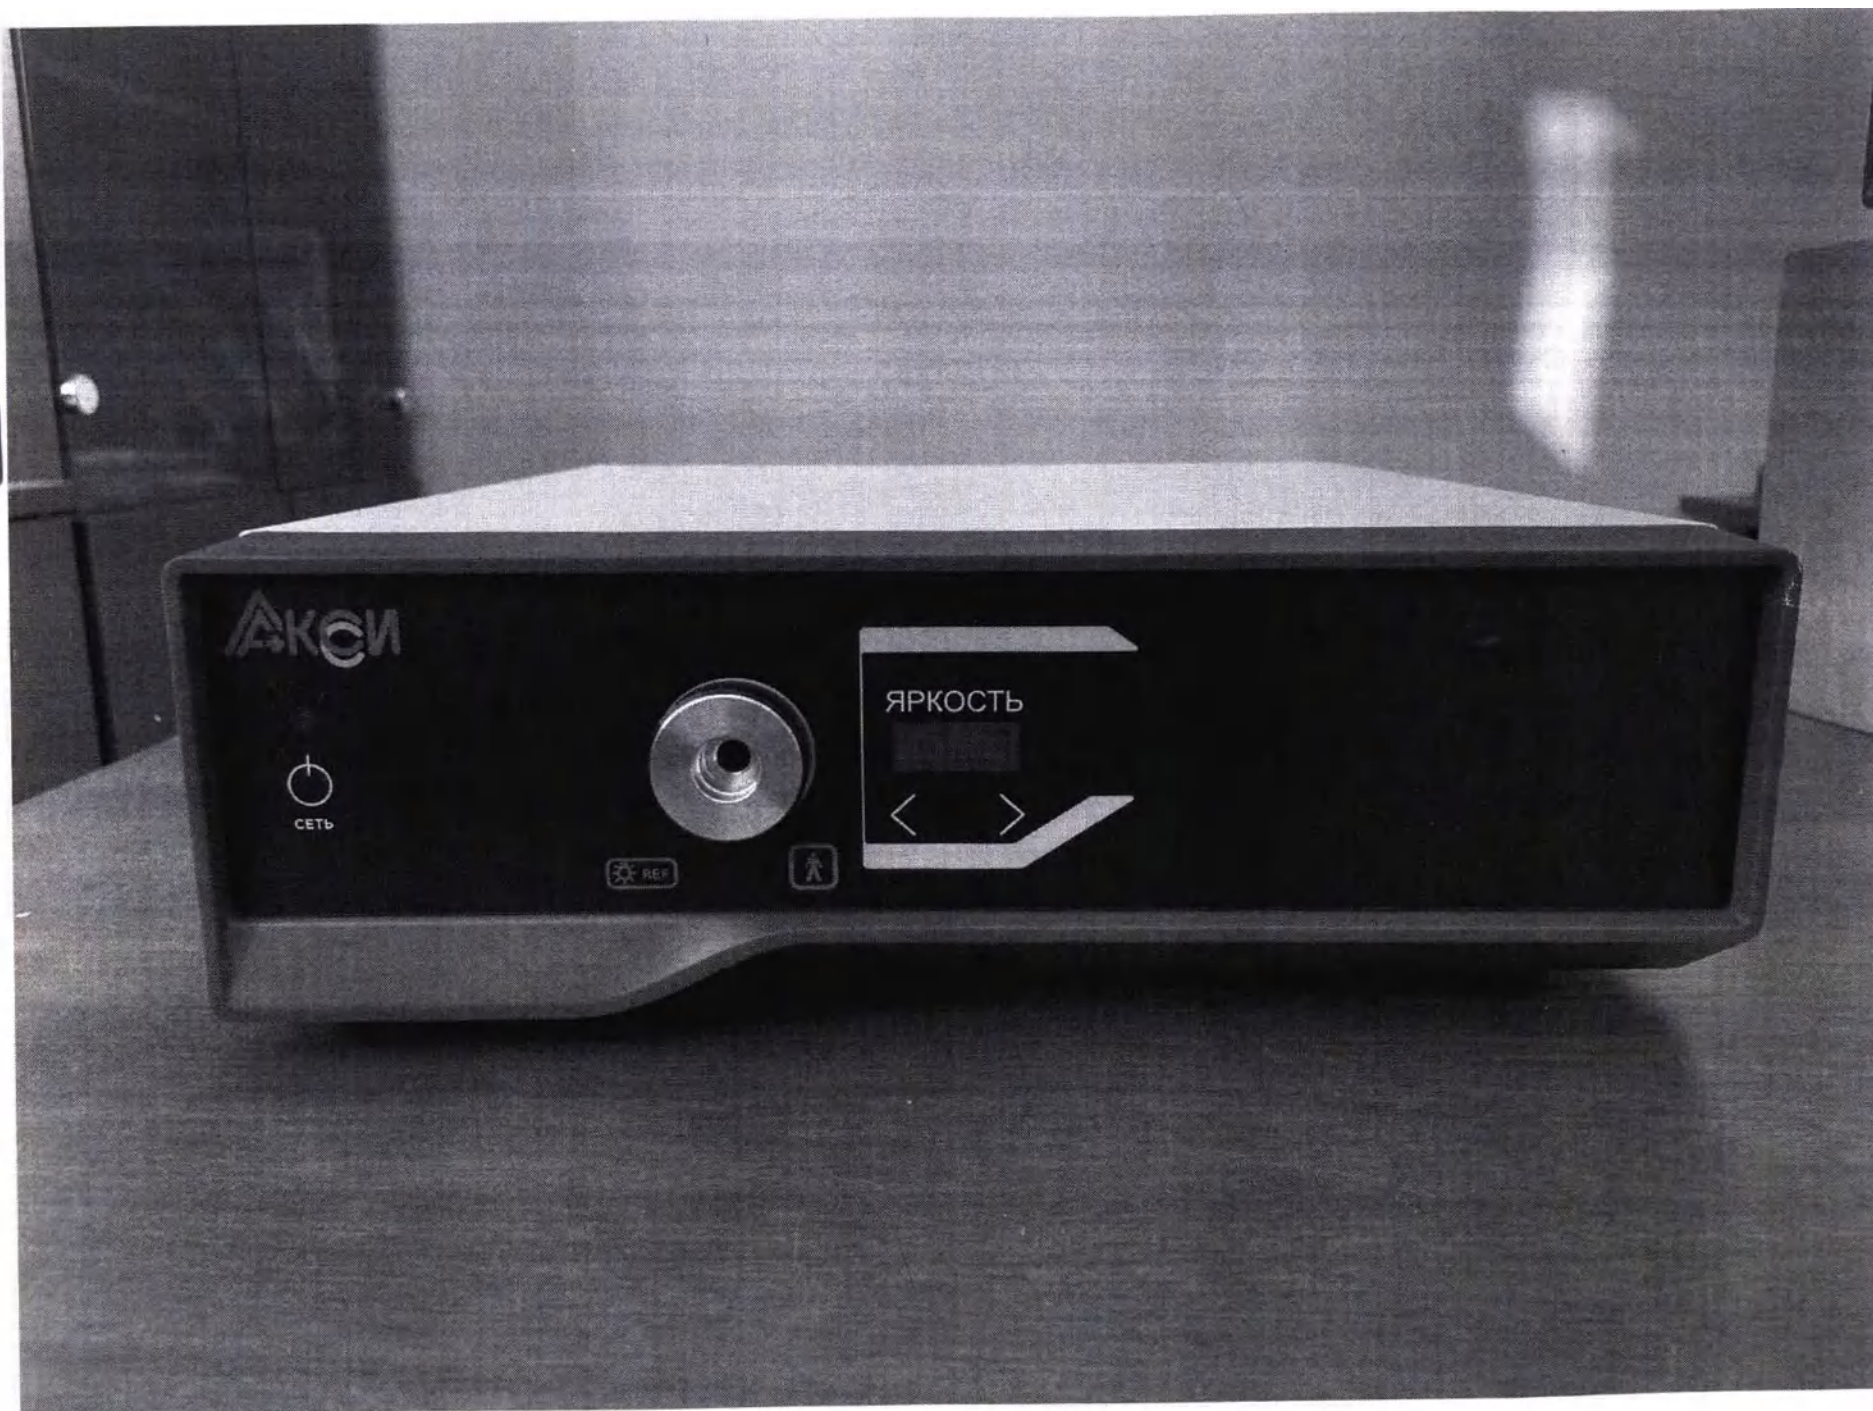

АКСИ

«Осветитель эндоскопический с
светодиодным источником света для
жесткой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 1
Руководство по эксплуатации

9707.1РЭ





Шнур питания SP 7748.




**«Осветитель эндоскопический с
светодиодным источником света для
жесткой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ»
тип 1**


Руководство по эксплуатации

9707.1РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 1

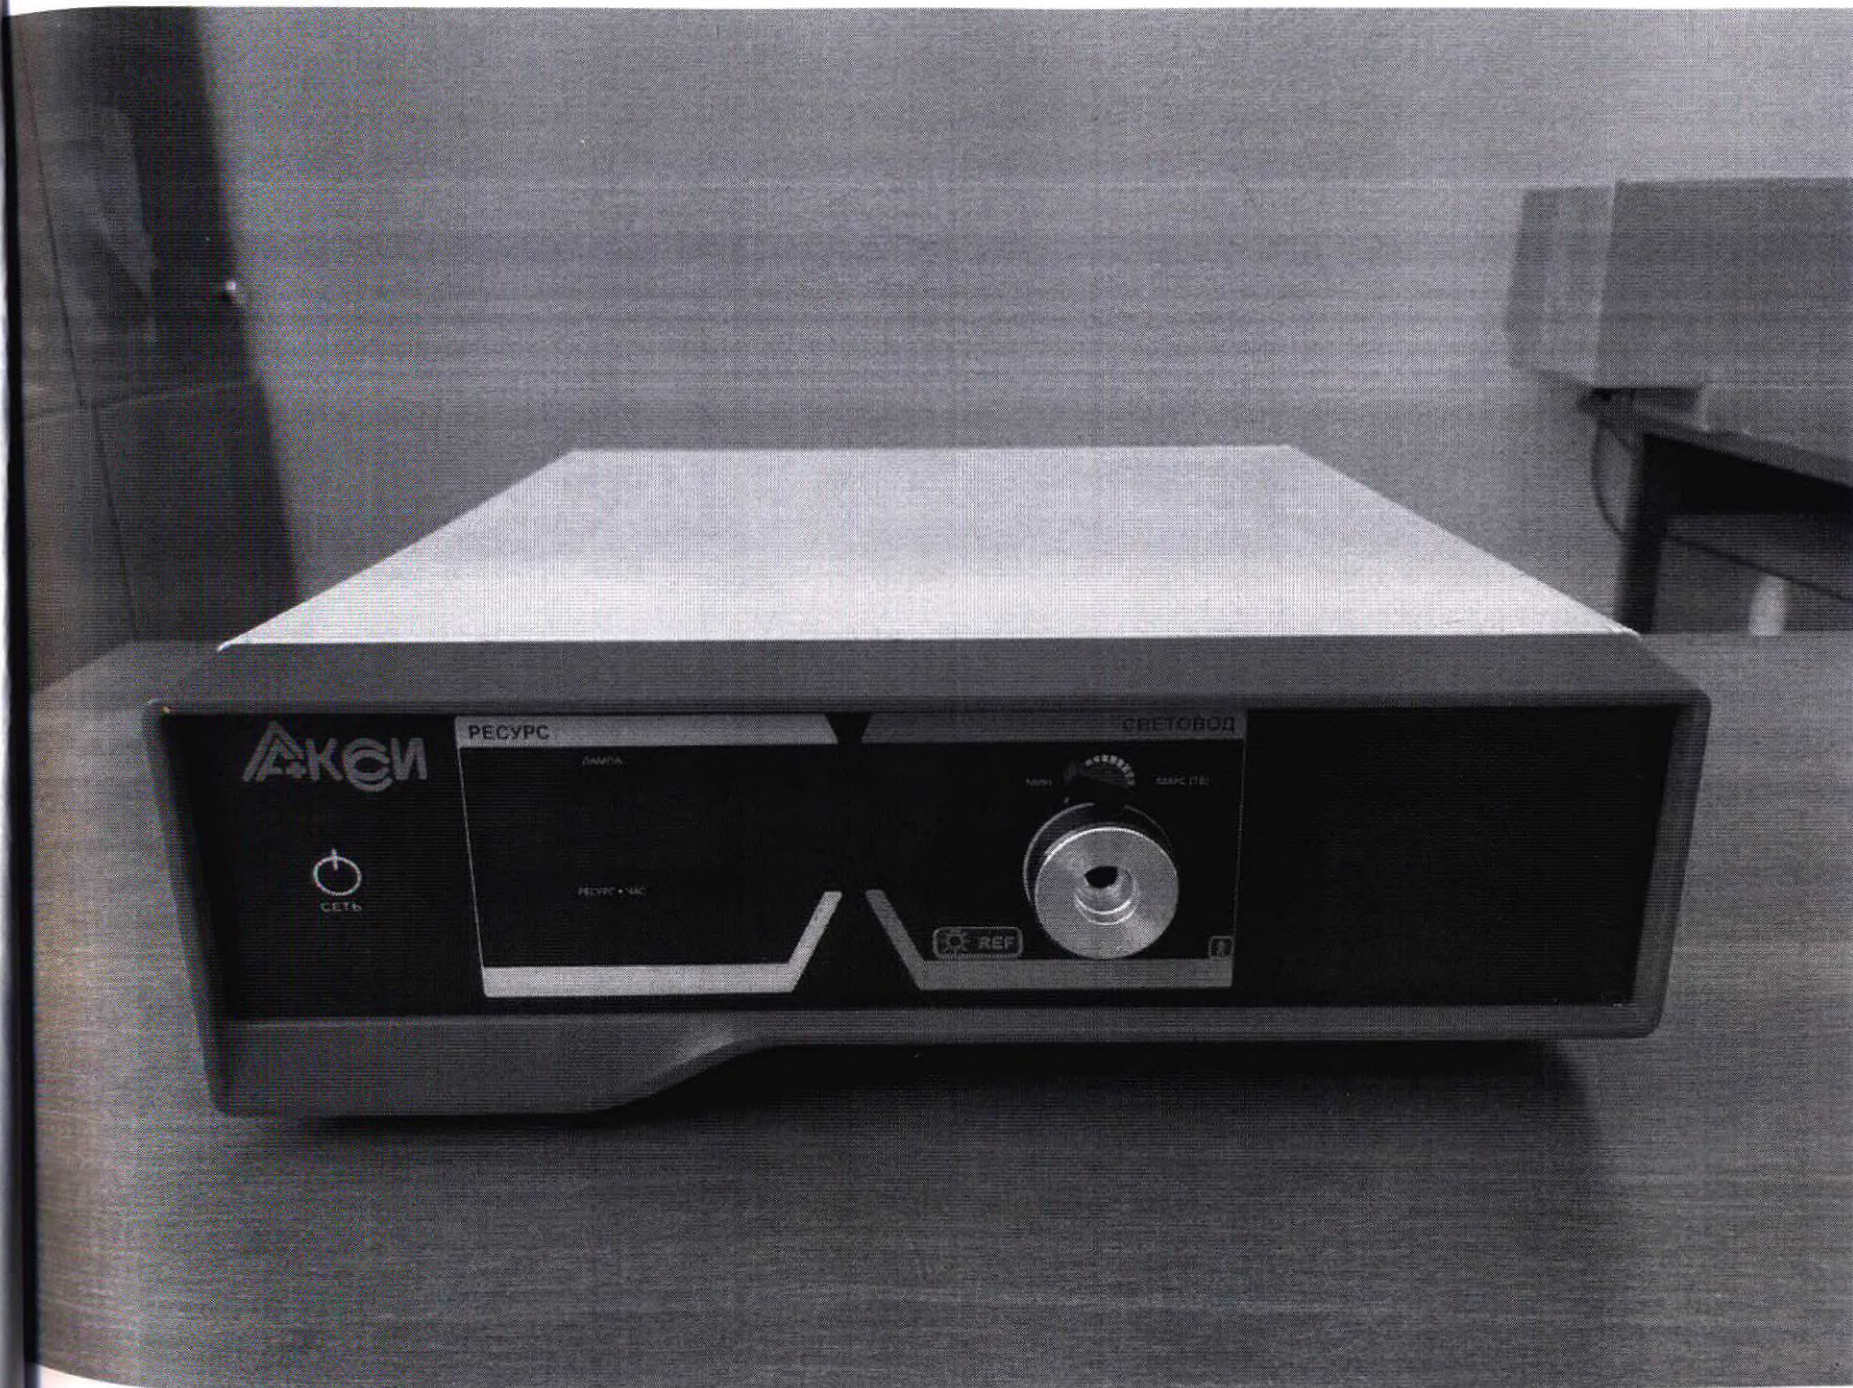

Осветитель эндоскопический с ксеноновым источником света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru
ОЭКГМ – «АКСИ» тип 2

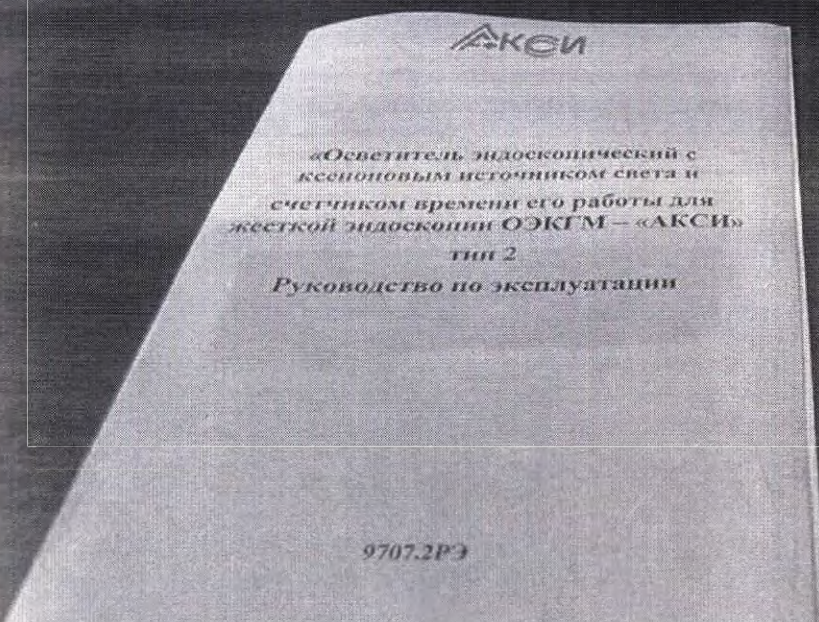






**«Осветитель эндоскопический с
ксеноновым источником света и
счетчиком времени его работы для
жесткой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ»
тип 2
Руководство по эксплуатации**

9707.2РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 2



«Осветитель эндоскопический с светодиодным источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 3

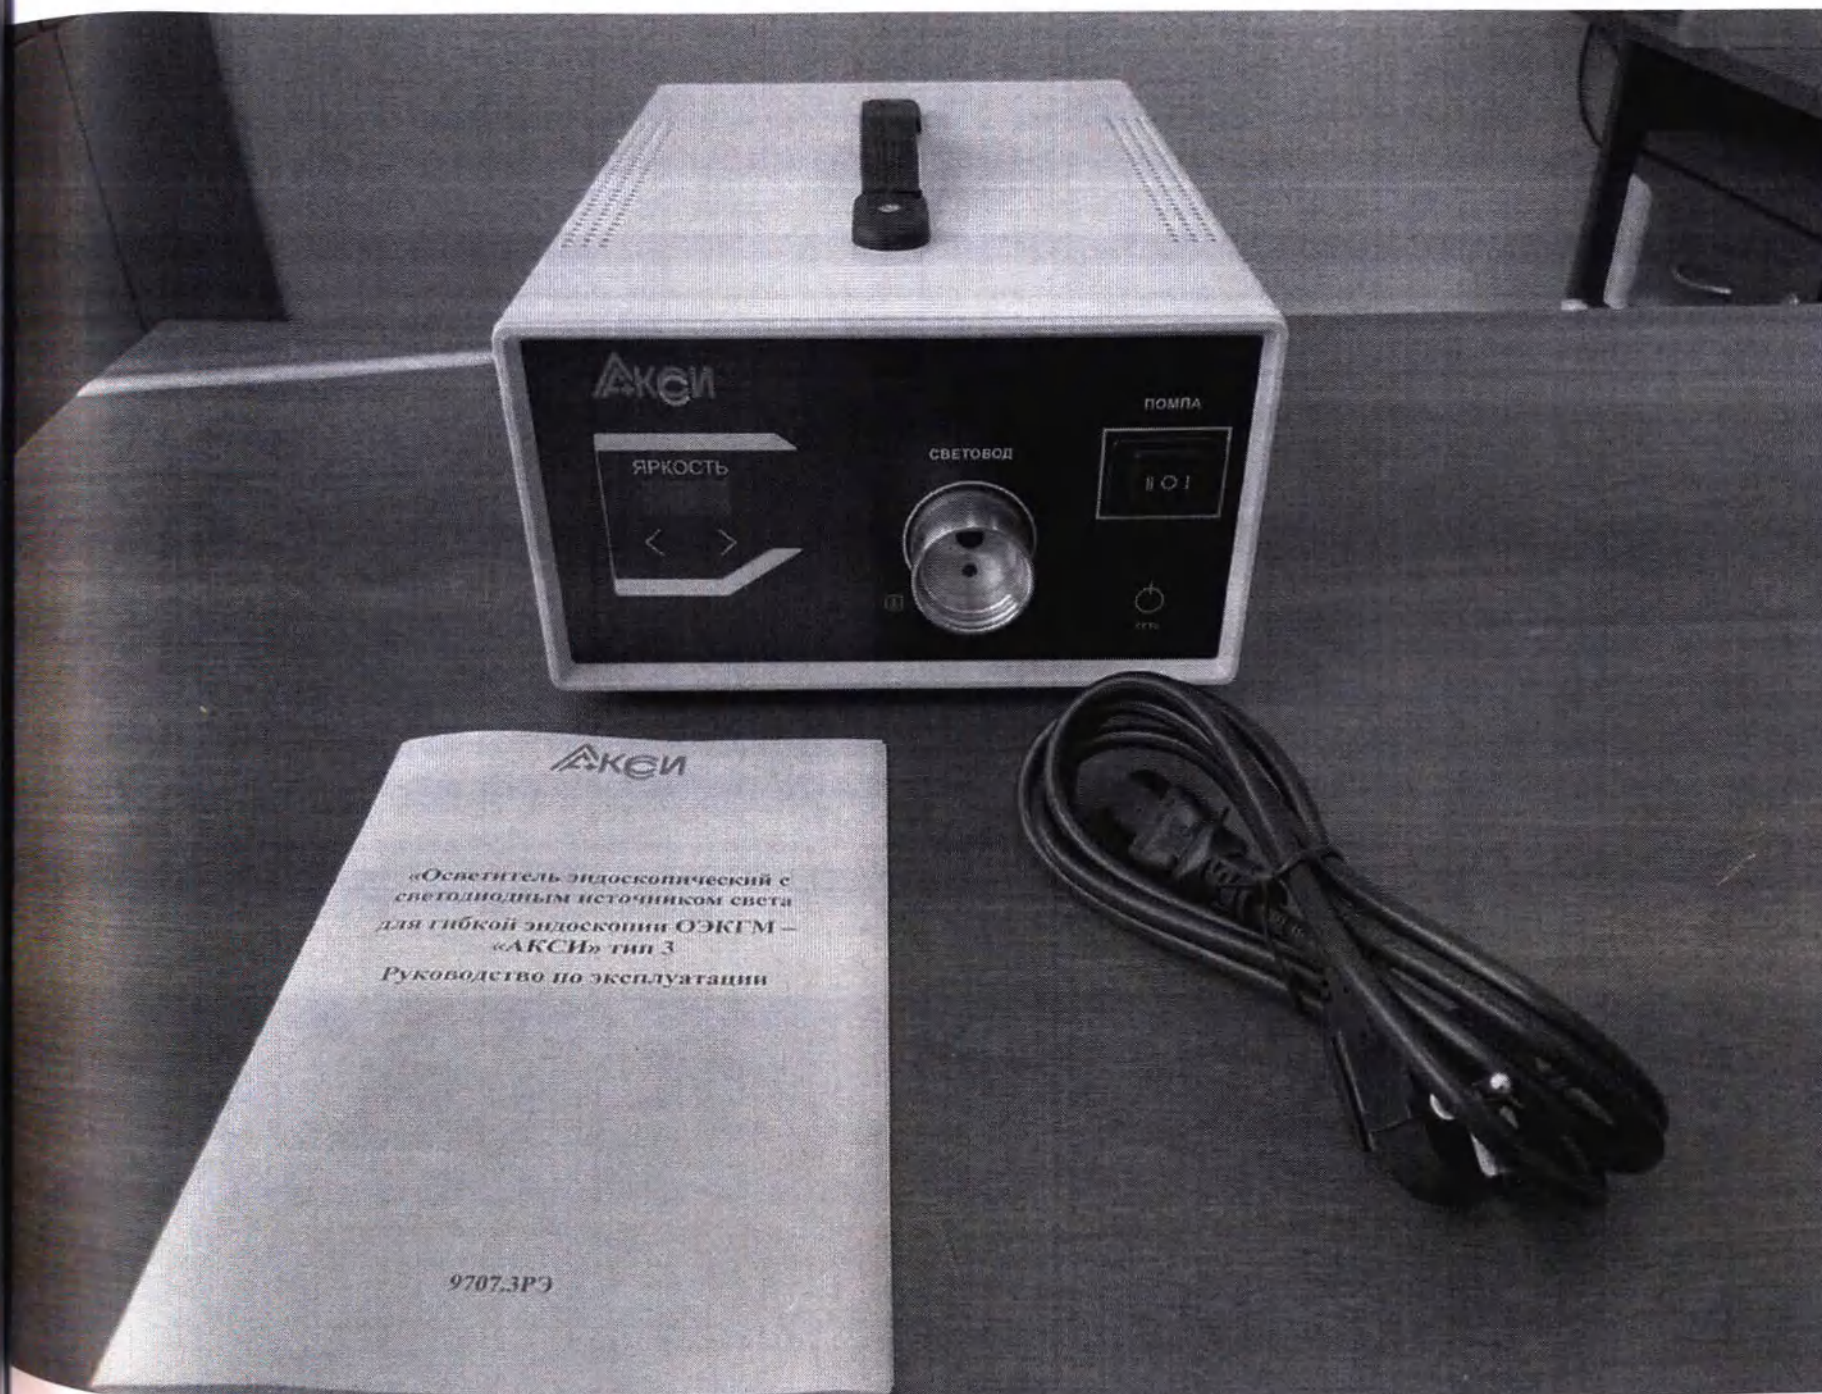





**«Осветитель эндоскопический с
светодиодным источником света
для гибкой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 3**


Руководство по эксплуатации

9707.3РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 3



Осветитель эндоскопический с светодиодным источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 4

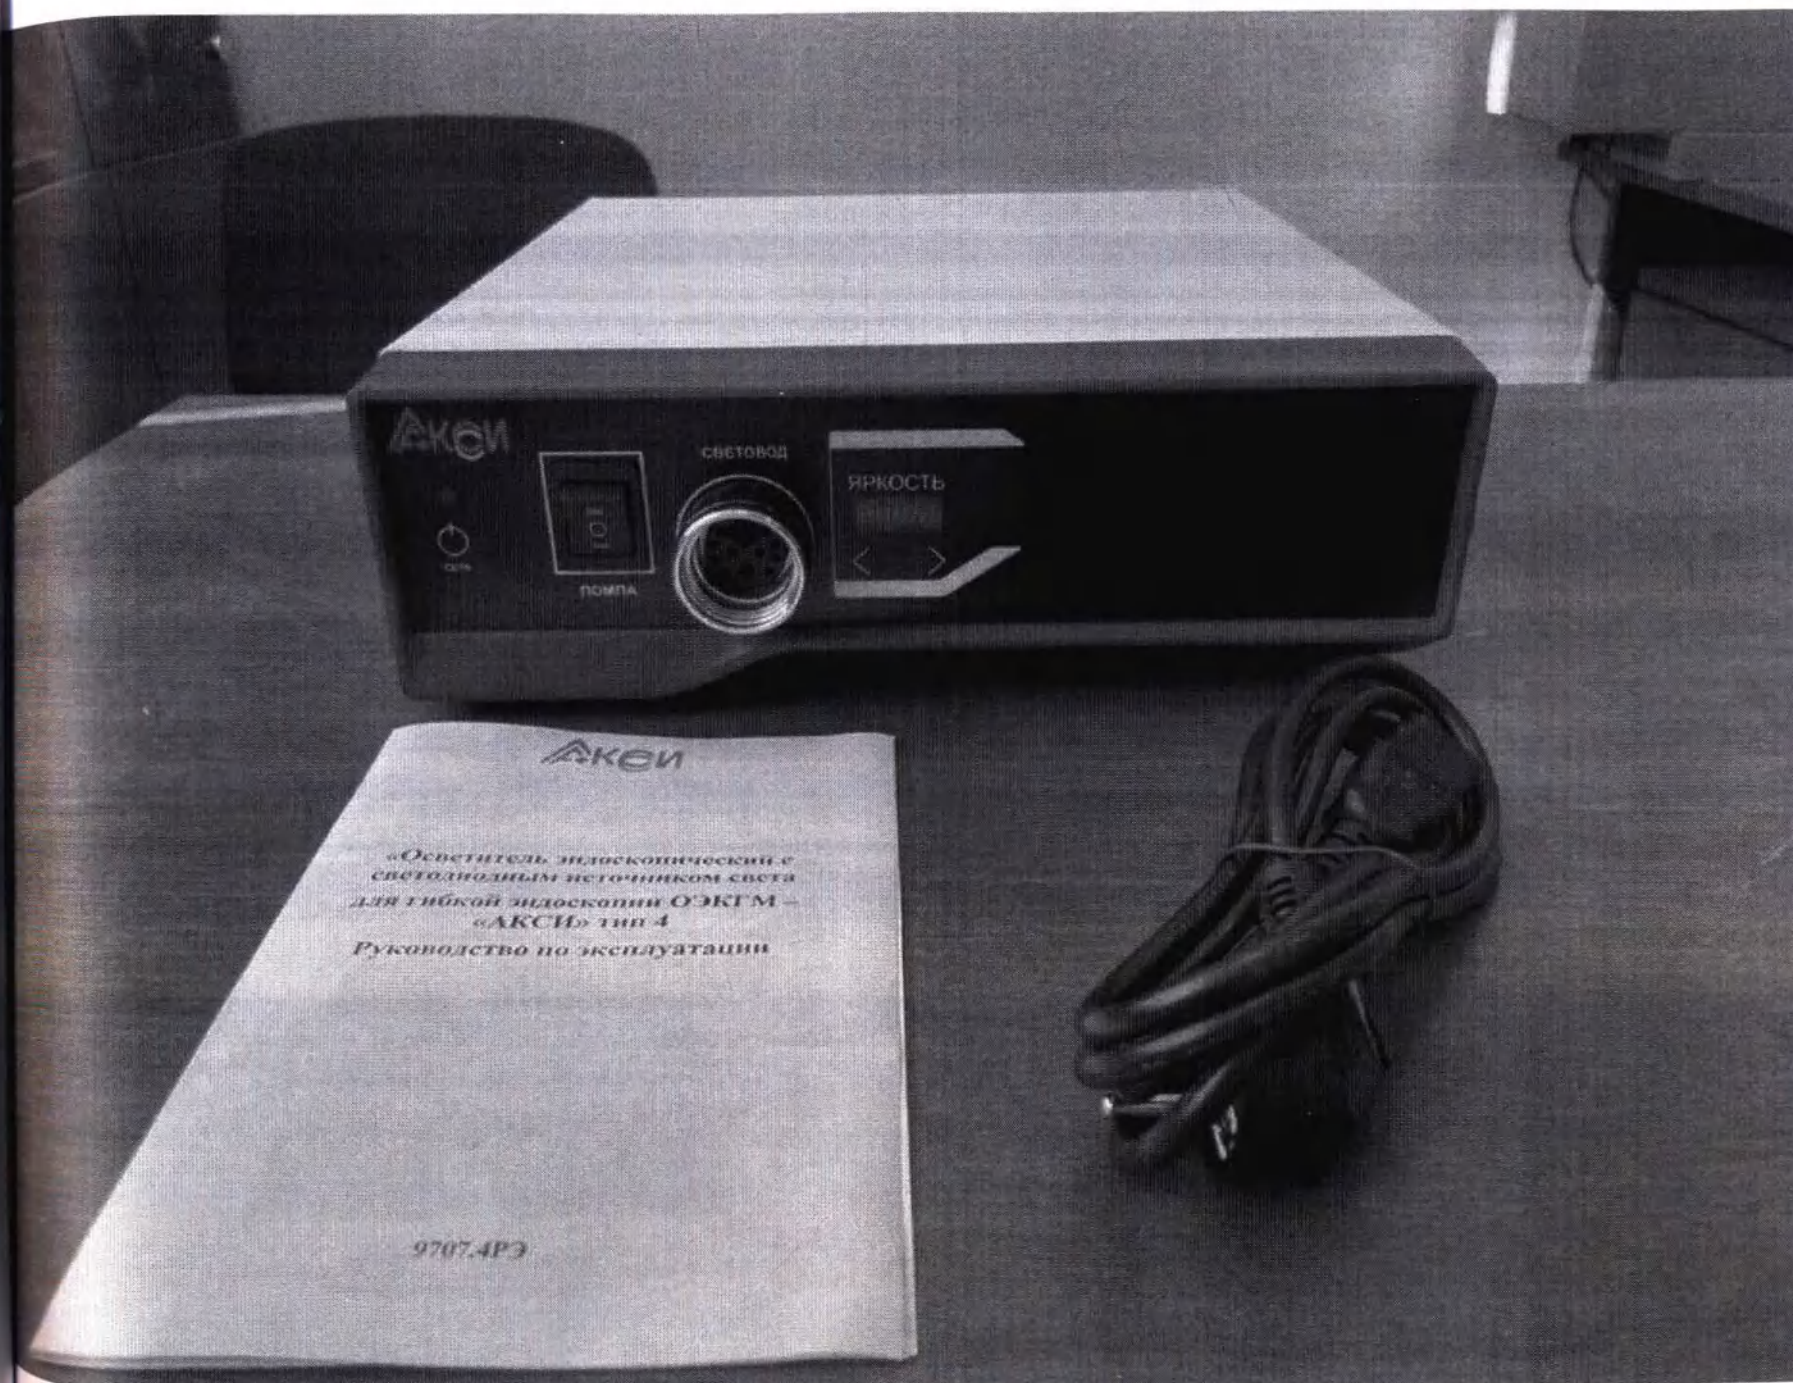

Осветитель эндоскопический с светодиодным источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 4






**«Осветитель эндоскопический с
светодиодным источником света
для гибкой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 4**


Руководство по эксплуатации

9707.4РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 4

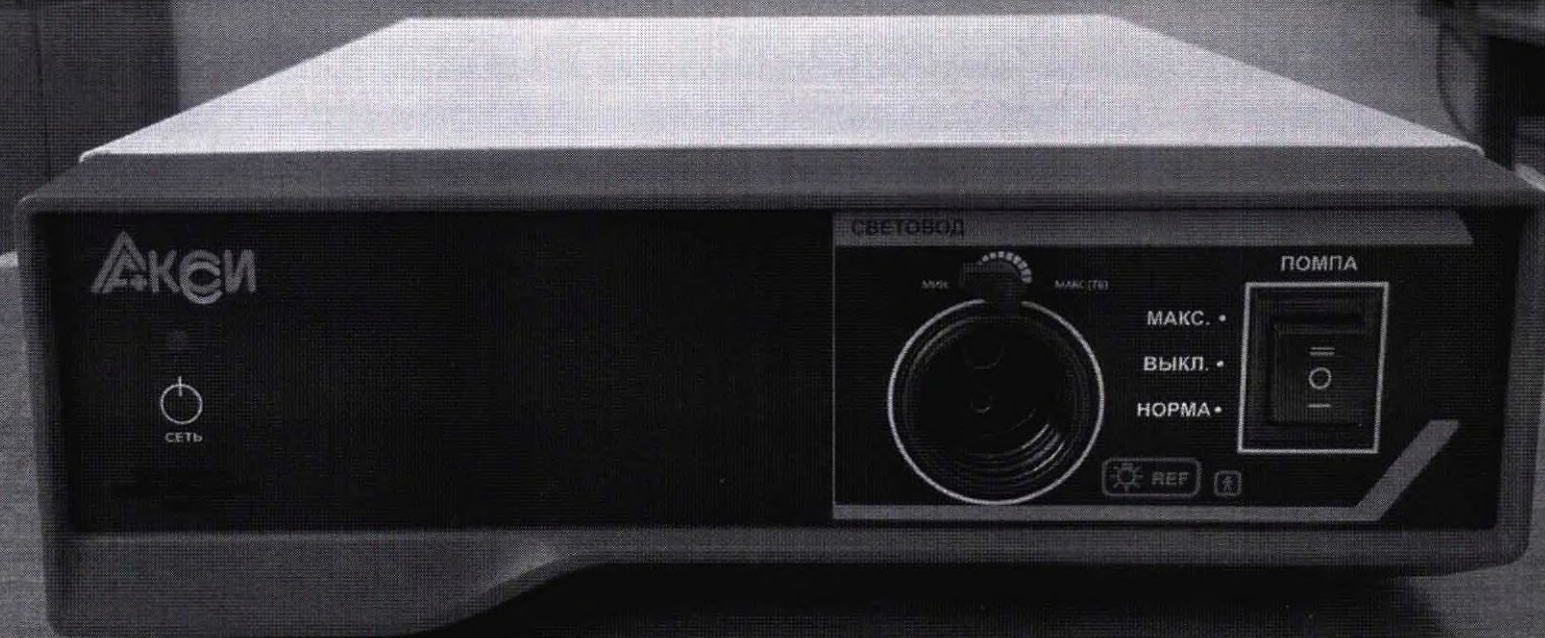

Осветитель эндоскопический с галогеновым источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 11

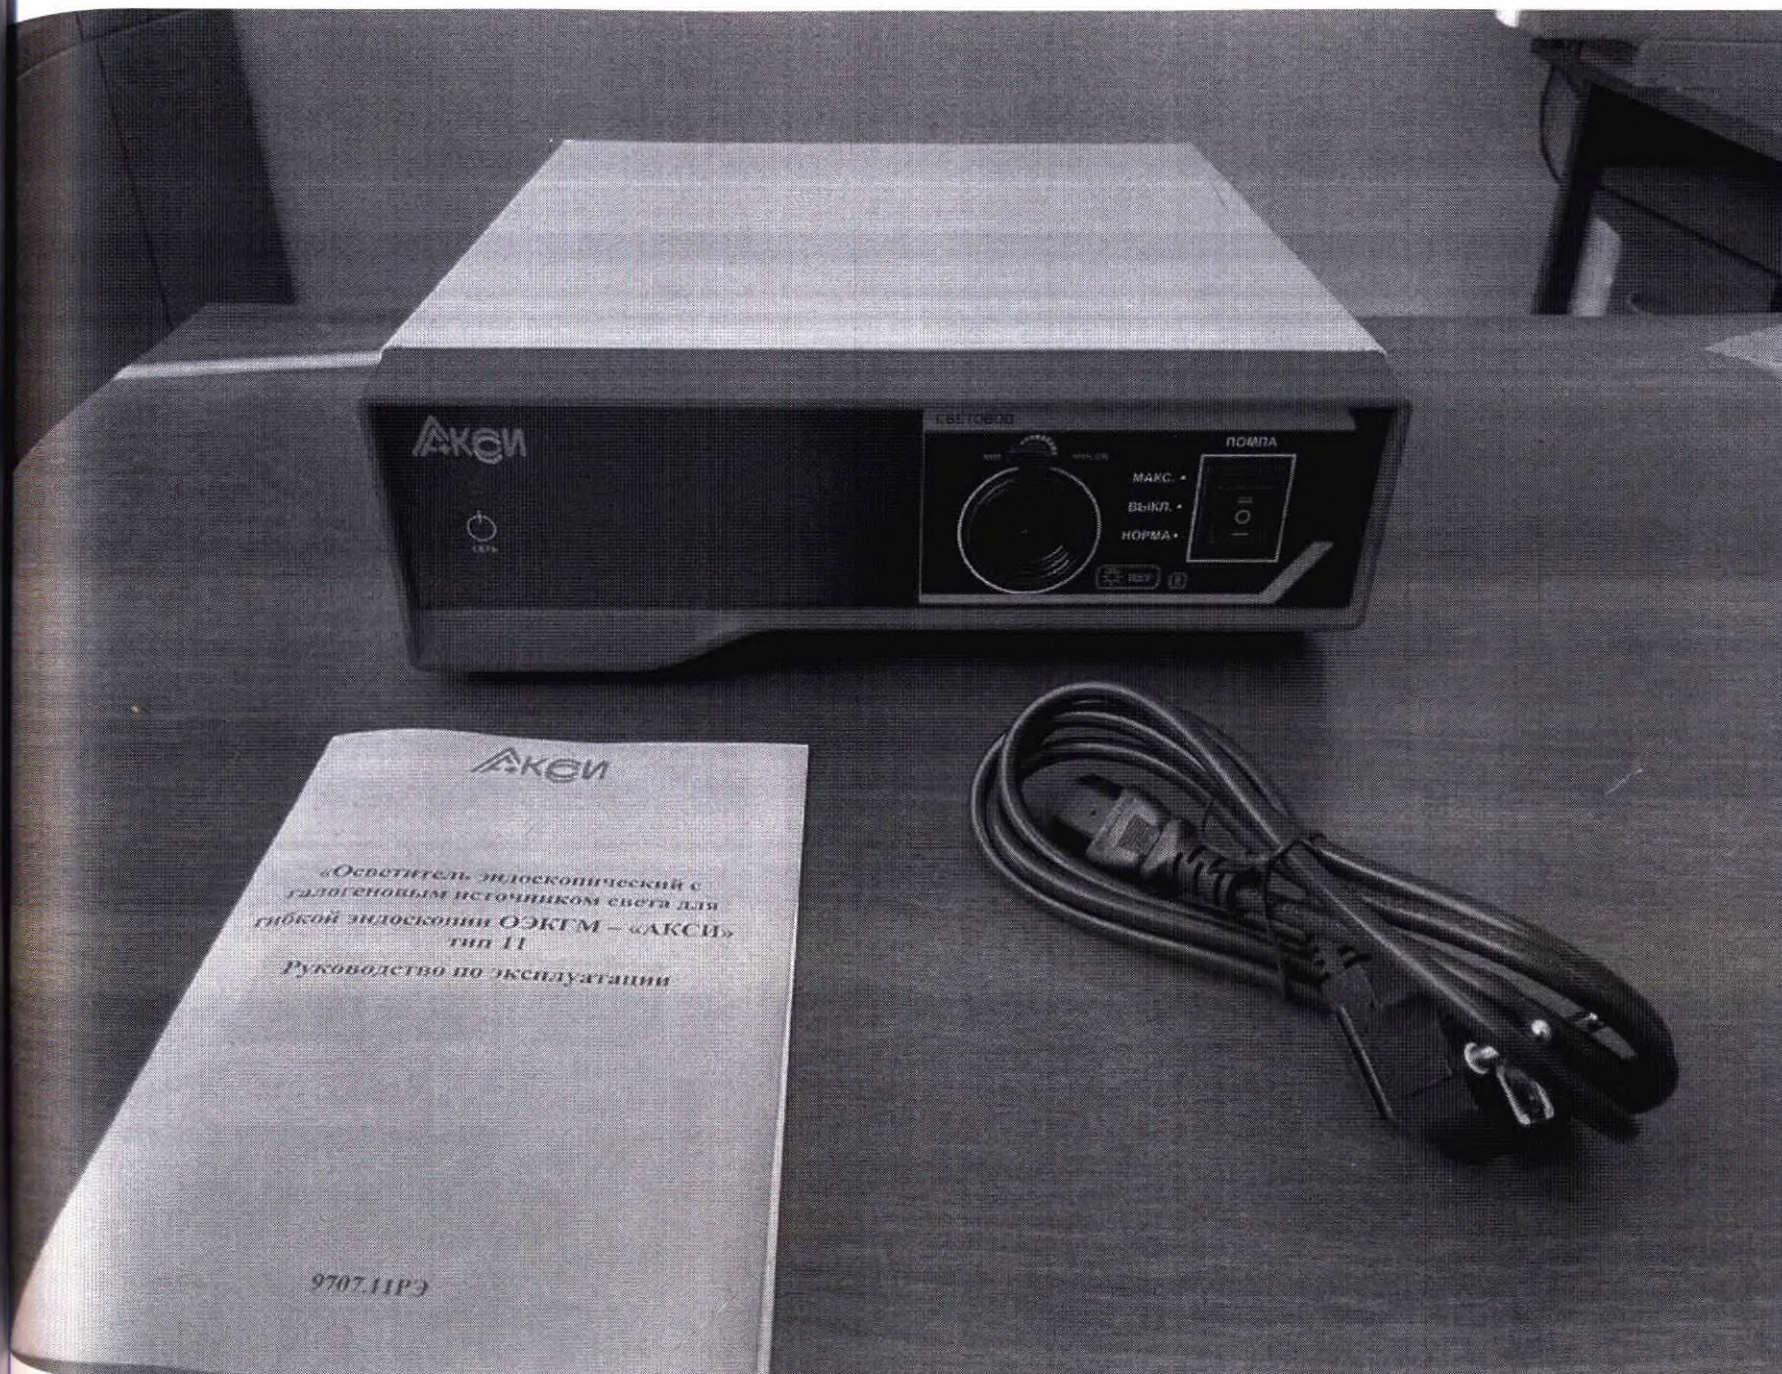

«Осветитель эндоскопический с
галогеновым источником света для
гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ»
тип 11
Руководство по эксплуатации

9707.11PЭ

Осветитель эндоскопический с галогеновым источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 11






**«Осветитель эндоскопический с
галогеновым источником света для
гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ»
тип 11**

Руководство по эксплуатации

9707.11РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 11

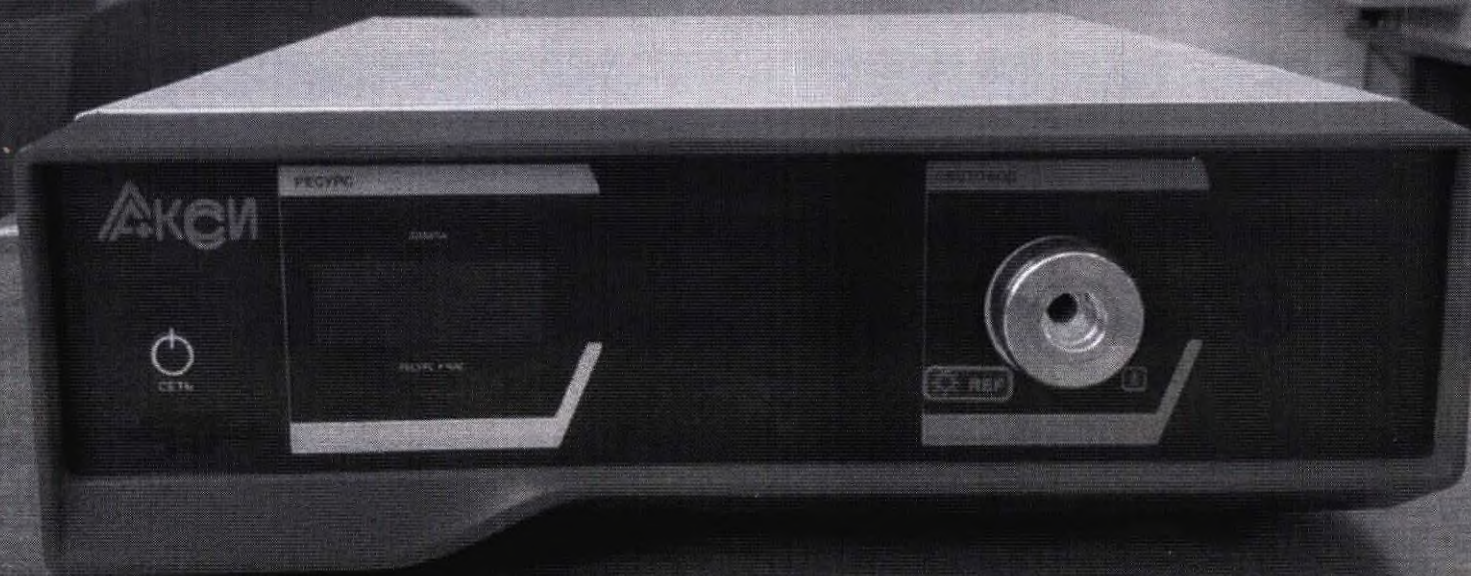



АКСИ

«Осветитель эндоскопический с
металлогалогенным источником
света и счетчиком времени его работы
для жесткой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 14
Руководство по эксплуатации

9707.14РЭ



«Осветитель эндоскопический с металлогалогенным источником света и счетчиком времени его работы для жесткой эндоскопии
ОЭКГМ – «АКСИ» тип 14






**«Осветитель эндоскопический с
металлогалоидным источником
света и счетчиком времени его работы
для жесткой эндоскопии ОЭКГМ –**

«АКСИ» тип 14

Руководство по эксплуатации

9707.14РЭ

Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 14

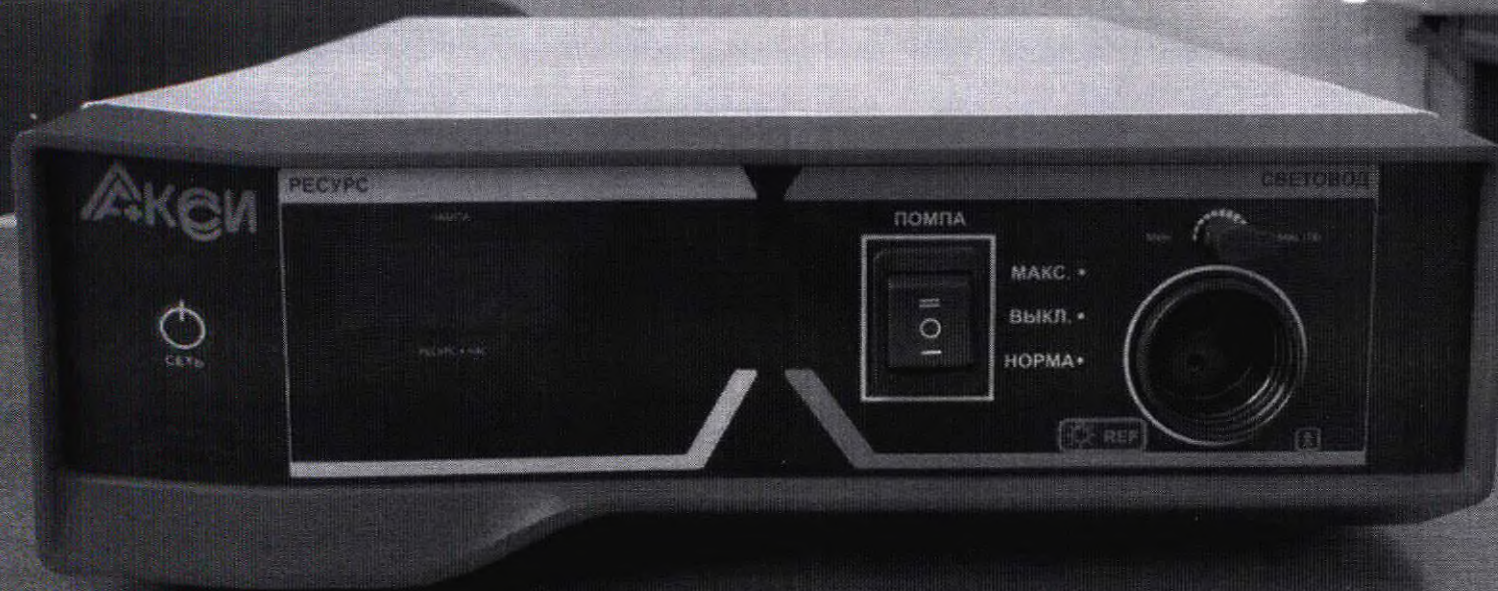

Светитель эндоскопический с металлогалогенным источником света и счетчиком времени его работы для гибкой эндоскопии ОЭКГМ
– «АКСИ» тип 16



АКСИ

«Осветитель эндоскопический с
металлогалогенным источником
света и счетчиком времени его работы
для гибкой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 16
Руководство по эксплуатации

9707.16РЭ







**«Осветитель эндоскопический с
металлогалоидным источником
света и счетчиком времени его работы
для гибкой эндоскопии ОЭКГМ –
«АКСИ» тип 16
Руководство по эксплуатации**

9707.16РЭ


Руководство по эксплуатации «Осветитель эндоскопический с металлогалоидным источником света и счётчиком времени его работы для жёсткой эндоскопии ОЭКГМ - «АКСИ» тип 16

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 28 лист(ов)

Руководитель организации

Александр Верин





Осветитель эндоскопический с ксеноновым
источником света и счетчиком времени его
работы для жесткой эндоскопии

ОЭКМ - «АКСИ» тип 2

ТУ 9442-042-27507632-2009

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07029 от 03.03.2010



ЗАО «Аксиома – Сервис», 194100, Россия,
Санкт – Петербург, ул. Кантемировская, д.5, корп.9, лит. Б



02.11.2021

SN

№ 042.002E19




IP 20 ~ 220В, 50Гц, 350ВА

Мощность лампы ~ 175 Вт

F 1,6A



Макет маркировки изделия

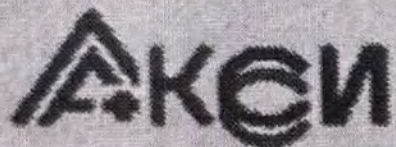

Осветитель эндоскопический с светодиодным
источником света для гибкой эндоскопии ОЭКГМ – «АКСИ» тип 4
ТУ 9442-042-27507632-2009

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07029 от _____ г.

ЗАО «Аксиома – Сервис» , 194100, Россия, г.Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, ул., Литовская, д. 10,
литера А, помещ. 2-Н, ком. 608 (офис 3310)

Количество – 1

Дата упаковки _____

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня продажи.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 по ГОСТ
15150-69 .

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

Масса брутто не более 10 кг.



042.004E19

